

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
 “Вектоген HBsAg плюс” (комплект 1)
 серия 1

Генеральный директор
 АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
 “13” 06 2023 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Вектоген HBsAg плюс” (комплект 1) № 1
серия 1

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” _____ М.Д. Хусаинов
“ 13 ” _____ 2023 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Вектогеп HBsAg плюс” (комплект 1) № 2
серия 1

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест”



М.Д. Хусаинов
2023 г.

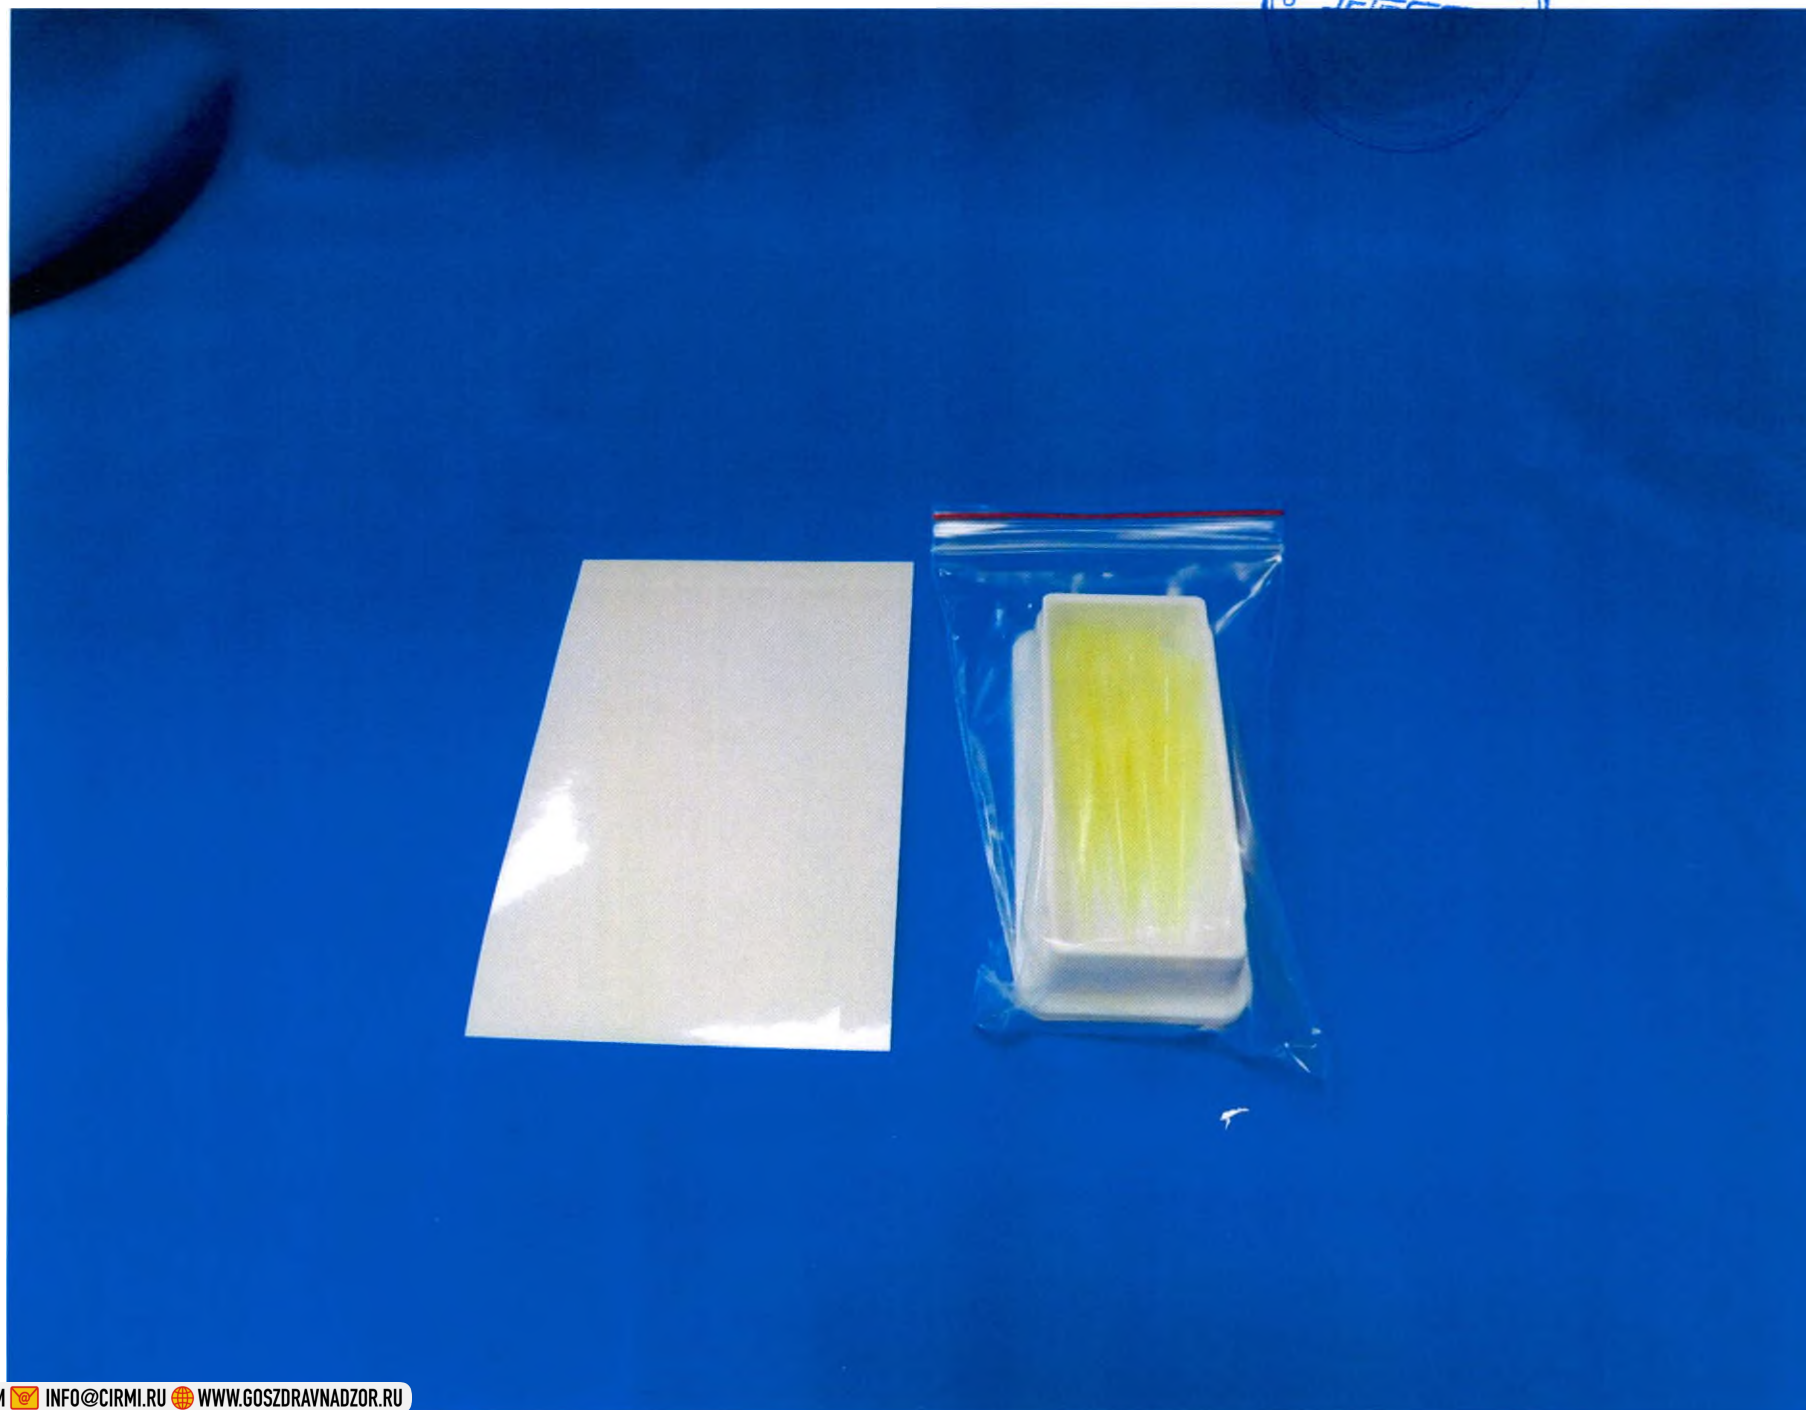

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Вектогеп HBsAg плюс” (комплект 1) № 3
серия 1

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

М.Д. Хусаинов
13 06 2023 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Вектоген HBsAg плюс” (комплект 1) № 4
серия 1

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
2023 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Вектоген HBsAg плюс” (комплект 1) № 5
серия 1

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов



13.06.2023 г.



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
"Вектоген HBsAg плюс" (комплект 1) № 1
серия 1


Генеральный директор
АО "Вектор-Бест"

М.Д. Хусамов
2023 г.



BEKTOP

БЕСТ

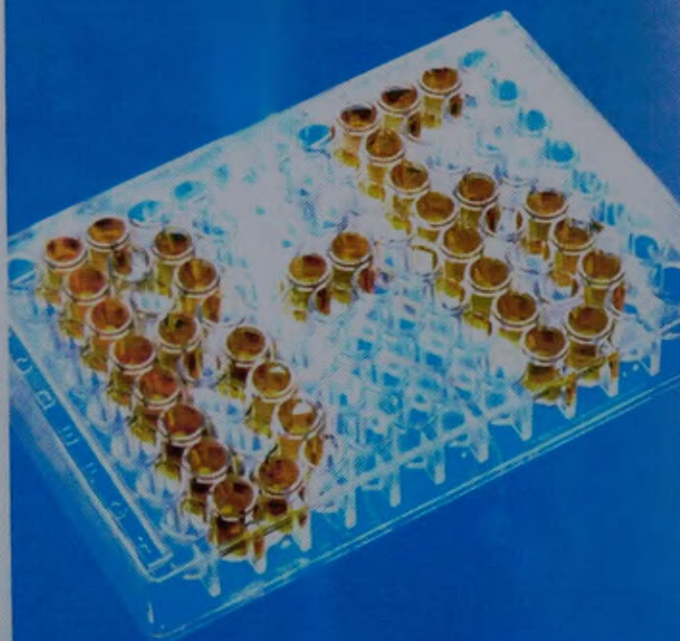

REF

X-XXXX

набор реагентов для
иммуноферментного выявления
HBsAg

Вектоген HBsAg плюс
(комплект 1)

LOT 1

СОСТАВ:

LOT


1. Планшет разборный с иммобилизованными моноклональными антителами к HBsAg	1 шт.		1
2. Отрицательный контрольный образец (K ⁻)	1 фл.	3.0 мл	1
3. Слабоположительный контрольный образец (K ⁺ слаб.)	1 фл.	2.5 мл	1
4. Положительный контрольный образец (K ⁺)	1 фл.	2.5 мл	1
5. Конъюгат	1 фл.	8.0 мл	1
6. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твинном (ФСБ-Т=25)	1 фл.	28.0 мл	1
7. Раствор тетраметилбензидина (Раствор ТМБ)	1 фл.	13.0 мл	1
8. Стоп-реагент	1 фл.	12.0 мл	1
9. Плёнки для заклеивания планшета	1 шт.		
10. Наконечники для дозаторов	16 шт.		
11. Ванночки для реагентов	2 шт.		

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“Вектоген HBsAg плюс” (комплект 1) № 2
серия 1

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» М.Д. Хусаинов
13.06.2023 г.



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
"Вектоген HBsAg плюс" (комплект 1) № 3
серия 1

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»  М.Д. Хусайнов
"13" 06 2023 г.



АО «Вектор-Бест»
Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211
тел/факс.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67
E-mail: vbmarket@vector-best.ru
www.vector-best.ru

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
 “Вектоген HBsAg плюс” (комплект 1)
 серия 2

Генеральный директор
 АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
 “13” 06/ 2023 г.





Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"Вектоген HBsAg плюс" (комплект 1) № 1
серия 2

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
"13" 06/ 2023 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"Вектоген HBsAg плюс" (комплект 1) № 2
серия 2

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
"13" 06 2023 г.

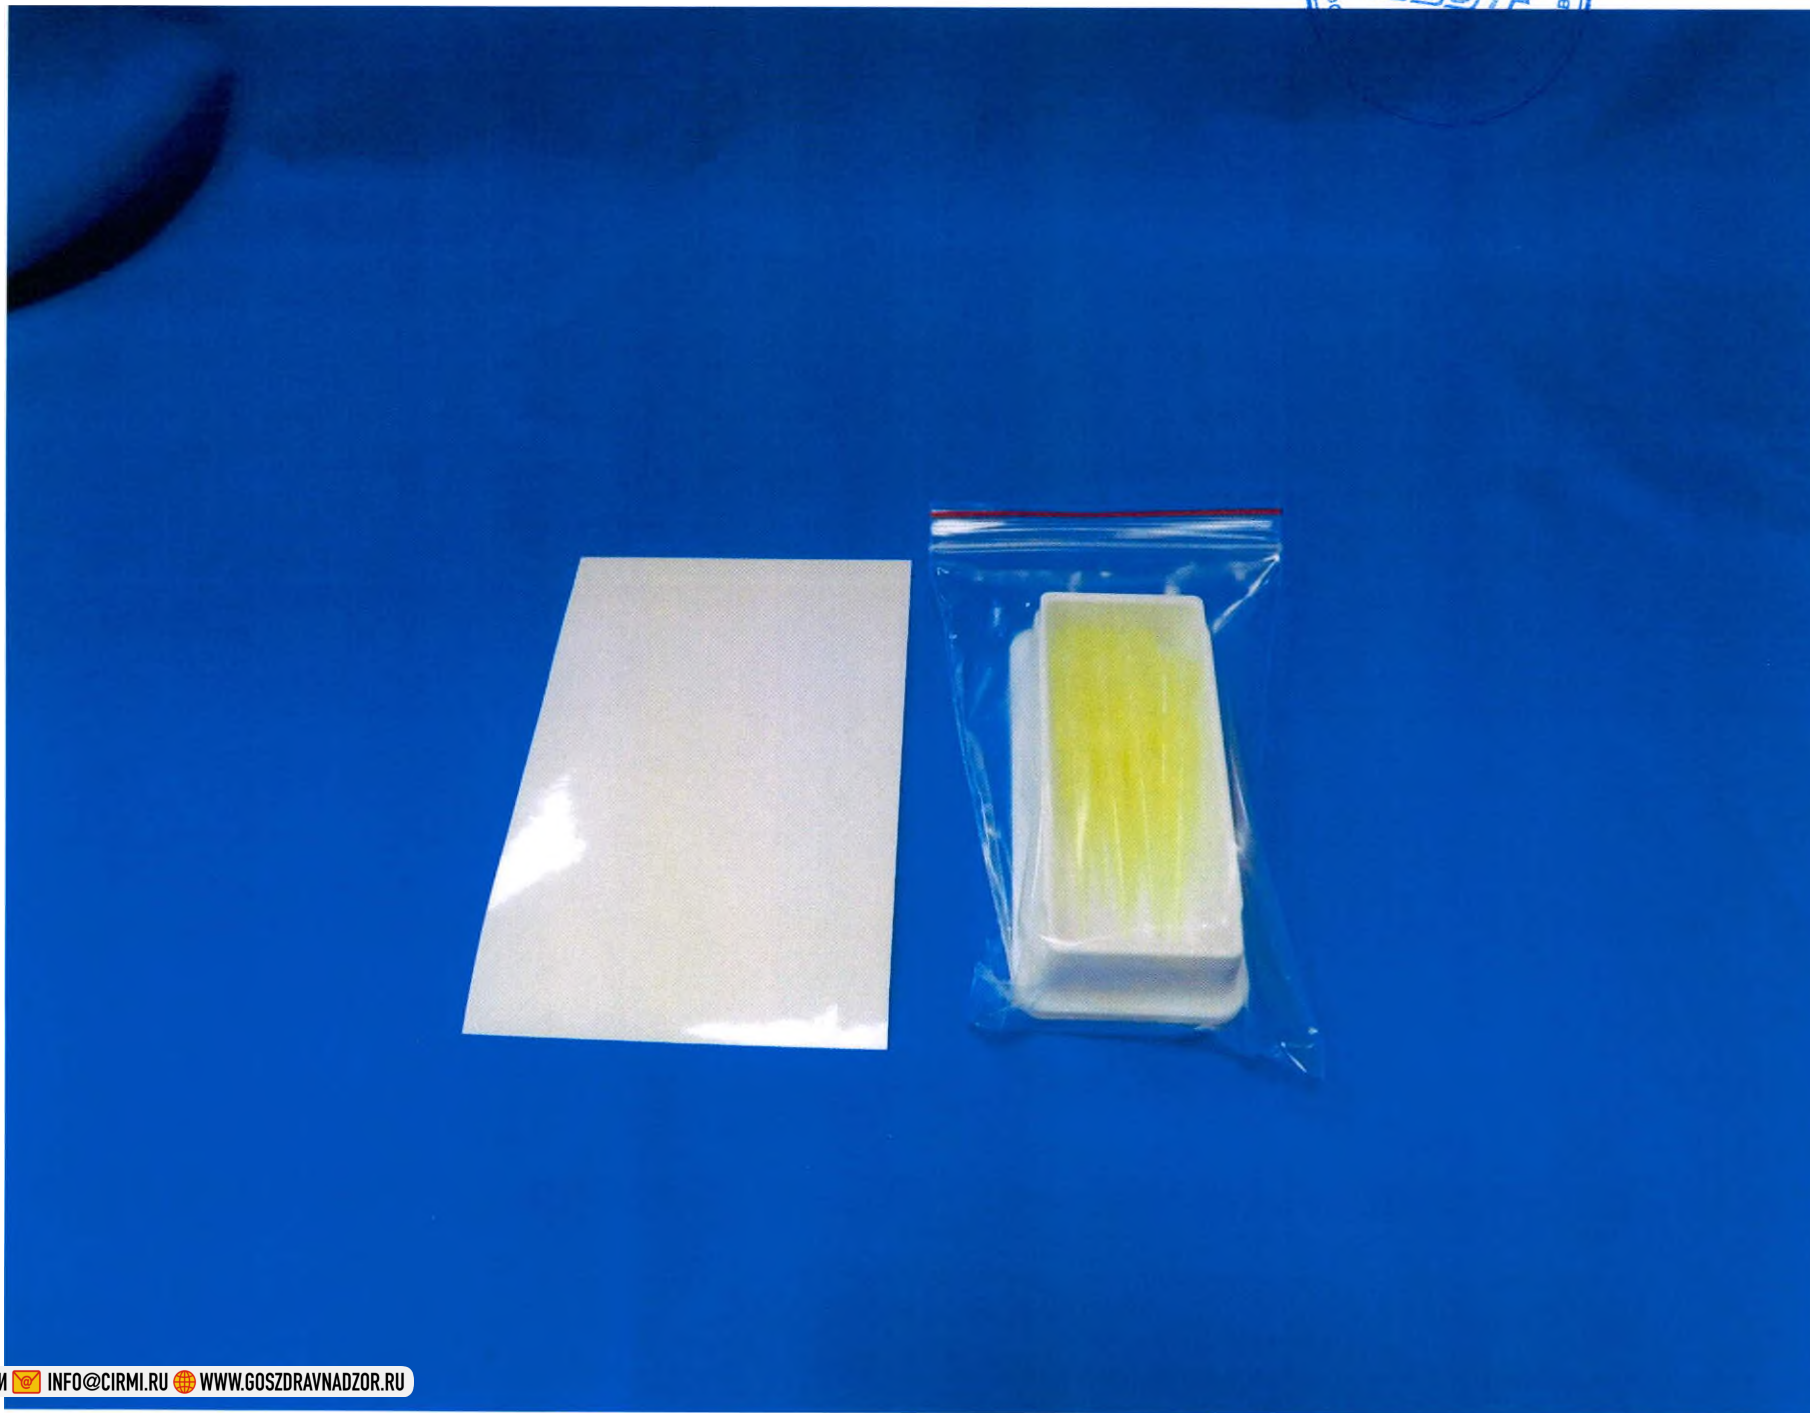


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"Вектоген HBsAg плюс" (комплект 1) № 3
серия 2

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусанов
"13" 06 2023 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Вектоген HBsAg плюс” (комплект 1) № 4
серия 2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»  М.Д. Хусаинов
13" 06 2023 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"Вектогеп HBsAg плюс" (комплект 1) № 5
серия 2

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест"


М.Д. Хусаинов
2023 г.




Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
"Вектоген HBsAg плюс" (комплект 1) № 1
серия 2

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест"

М.Д. Хусаинов
2023 г.



ВЕКТОР
БЕСТ

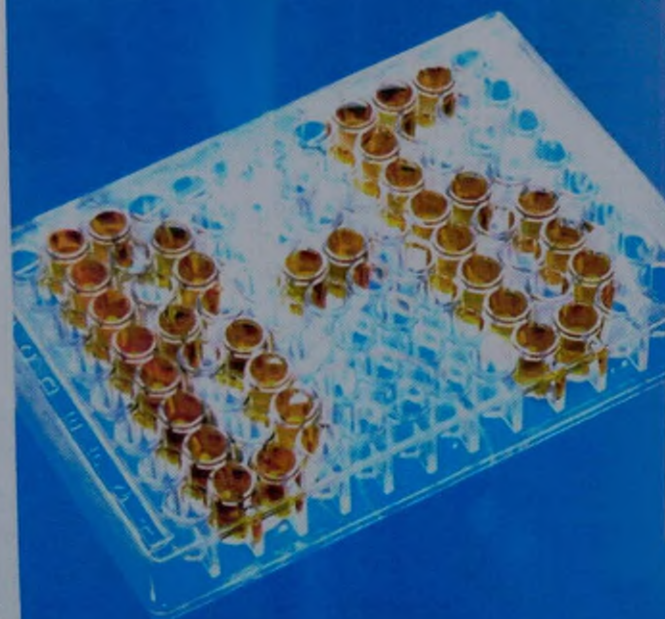

REF
X-XXXX

набор реагентов для
иммуноферментного выявления
HBsAg

Вектоген HBsAg плюс
(комплект 1)

LOT 2

СОСТАВ:

LOT

1. Планшет разборный с иммобилизованными моноклональными антителами к HBsAg	1 шт	2
2. Отрицательный контрольный образец (K ⁻)	1 фл.	3,0 мл 2
3. Слабopоложительный контрольный образец (K ⁺ слаб)	1 фл.	2,5 мл 2
4. Положительный контрольный образец (K ⁺)	1 фл.	2,5 мл 2
5. Конъюгат	1 фл.	8,0 мл 2
6. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т+25)	1 фл.	28,0 мл 2
7. Раствор тетраметилбензидина (Раствор ТМБ)	1 фл.	13,0 мл 2
8. Стоп-реагент	1 фл.	12,0 мл 2
9. Плёнки для заклеивания планшета	1 шт	
10. Наконечники для дозаторов	16 шт	
11. Ванночки для реагентов	2 шт	


Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“Вектоген HBsAg плюс” (комплект 1) № 2
серия 2

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“06” 06 2023 г.



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“Вектоген HBsAg плюс” (комплект 1) № 3
серия 2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» М.Д. Хусаинов
2023 г.



АО «Вектор-Бест»
Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211
тел/факс.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67
E-mail: vbmarket@vector-best.ru
www.vector-best.ru

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
 “Вектоген HBsAg плюс” (комплект 2)
 серия 3

Генеральный директор
 АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
 “13” 06 / 2023 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Вектогеп HBsAg плюс” (комплект 2) № 1
серия 3

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест”

М.Д. Хусаинов
2023 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Вектоген HBsAg плюс” (комплект 2) № 2
серия 3

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“13” 06 2023 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Вектоген HBsAg плюс” (комплект 2) № 3
серия 3

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
13.06.2023 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Вектоген HBsAg плюс” (комплект 2) № 4
серия 3

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“13” 06 2023 г.

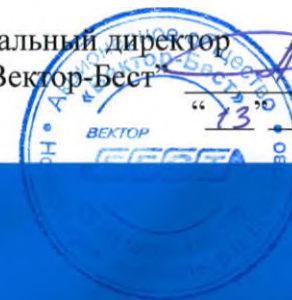

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"Вектоген HBsAg плюс" (комплект 2) № 5
серия 3

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест"  М.Д. Хусайнов
13" 06 2023 г.




Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
"Вектоген HBsAg плюс" (комплект 2) № 1
серия 3


Генеральный директор
АО "Вектор-Бест"

М.Д. Хусаинов
2023 г.

13.06

ВЕКТОР

БЕСТ

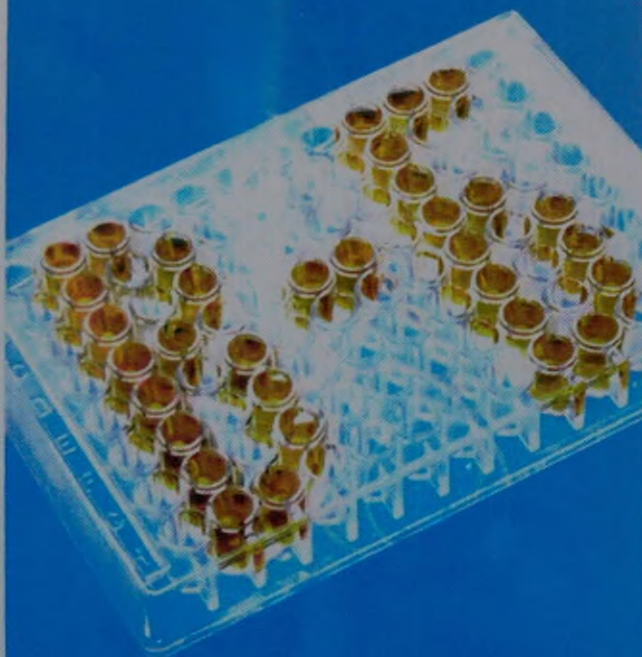

REF

X-XXXX

набор реагентов для
иммуноферментного выявления
HBsAg

Вектоген HBsAg плюс (комплект 2)

LOT 3


СОСТАВ:

LOT

1. Планшет разборный с иммобилизованными моноклональными антителами к HBsAg	2 шт.	3
2. Отрицательный контрольный образец (K ⁻)	2 фл. по 3,0 мл	3
3. Слабopоложительный контрольный образец (K ⁺ слаб)	1 фл. 2,5 мл	3
4. Положительный контрольный образец (K ⁺)	1 фл. 2,5 мл	3
5. Конъюгат	1 фл. 15,0 мл	3
6. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т*25)	1 фл. 28,0 мл	3
7. Раствор тетраметилбензидина (Раствор ТМБ)	2 фл. по 13,0 мл	3
8. Стоп-реагент	2 фл. по 12,0 мл	3
9. Плёнки для заклеивания планшета	2 шт.	
10. Наконечники для дозаторов	16 шт.	
11. Ванночки для реагентов	2 шт.	

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“Вектоген HBsAg плюс” (комплект 2) № 2
серия 3

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
2023 г.

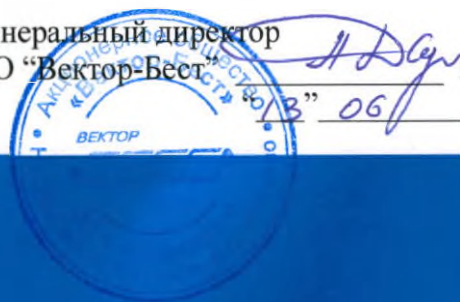

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“Вектоген HBsAg плюс” (комплект 2) № 3
серия 3

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» М.Д. Хусаинов
13.06.2023 г.



АО «Вектор-Бест»
Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211
тел/факс.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67
E-mail: vbmarket@vector-best.ru
www.vector-best.ru


Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
 “Вектоген HBsAg плюс” (комплект 2)
 серия 4

Генеральный директор
 АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
 “13” 06 2023 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Вектоген HBsAg плюс” (комплект 2) № 1
серия 4

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест”

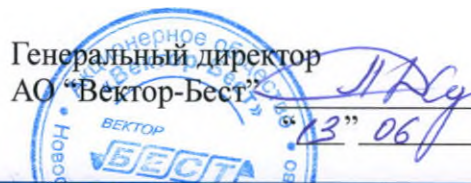


М.Д. Хусаинов
2023 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Вектогеп HBsAg плюс” (комплект 2) № 2
серия 4

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
13.06.2023 г.

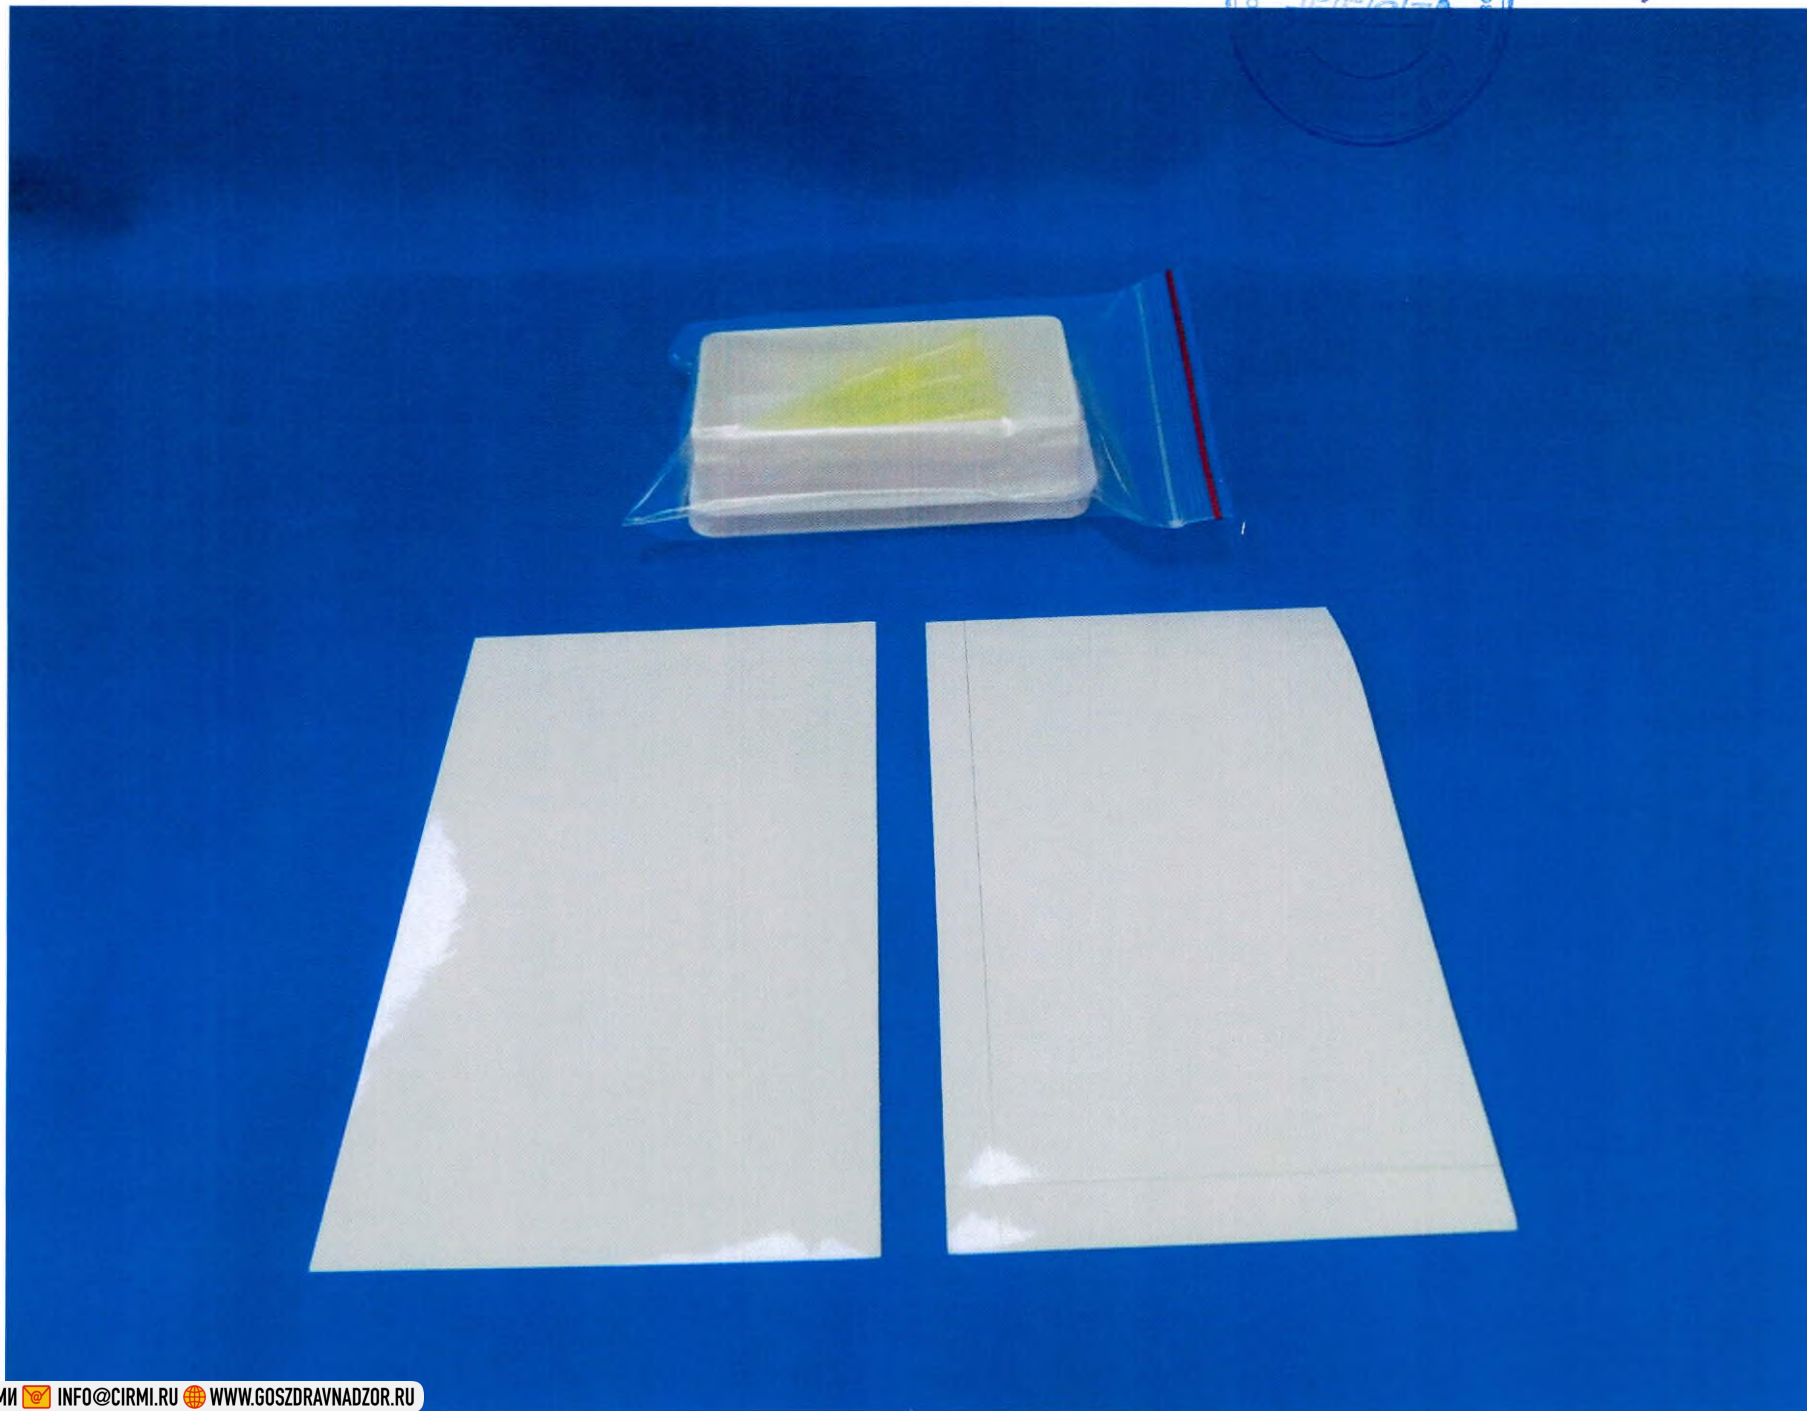

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"Вектоген HBsAg плюс" (комплект 2) № 3
серия 4


Генеральный директор
АО "Вектор-Бест"

М.Д. Хусаинов
"13" 06 2023 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Вектогеп HBsAg плюс” (комплект 2) № 4
серия 4

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
13.06.2023 г.

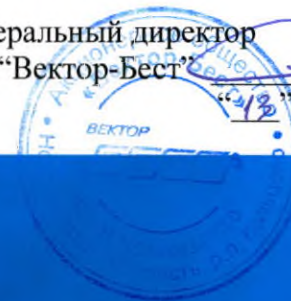

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Вектоген HBsAg плюс” (комплект 2) № 5
серия 4

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“13” 06 2023 г.



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“Вектоген HBsAg плюс” (комплект 2) № 1
серия 4

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“13” 06 2023 г.



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“Вектоген HBsAg плюс” (комплект 2) № 2
серия 4

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
13 ” 06 / 2023 г.



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“Вектоген HBsAg плюс” (комплект 2) № 3
серия 4

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
13.06.2023 г.



АО «Вектор-Бест»
Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211
тел/факс.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67
E-mail: vbmarket@vector-best.ru
www.vector-best.ru

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
“Вектоген HBsAg плюс” (комплект 3)
серия 5

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
2023 г.





Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Вектогеп HBsAg плюс” (комплект 3) № 1
серия 5

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусанов
“13” 06 2023 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Вектоген HBsAg плюс” (комплект 3) № 1(1)
серия 5

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“13” 06 2023 г.

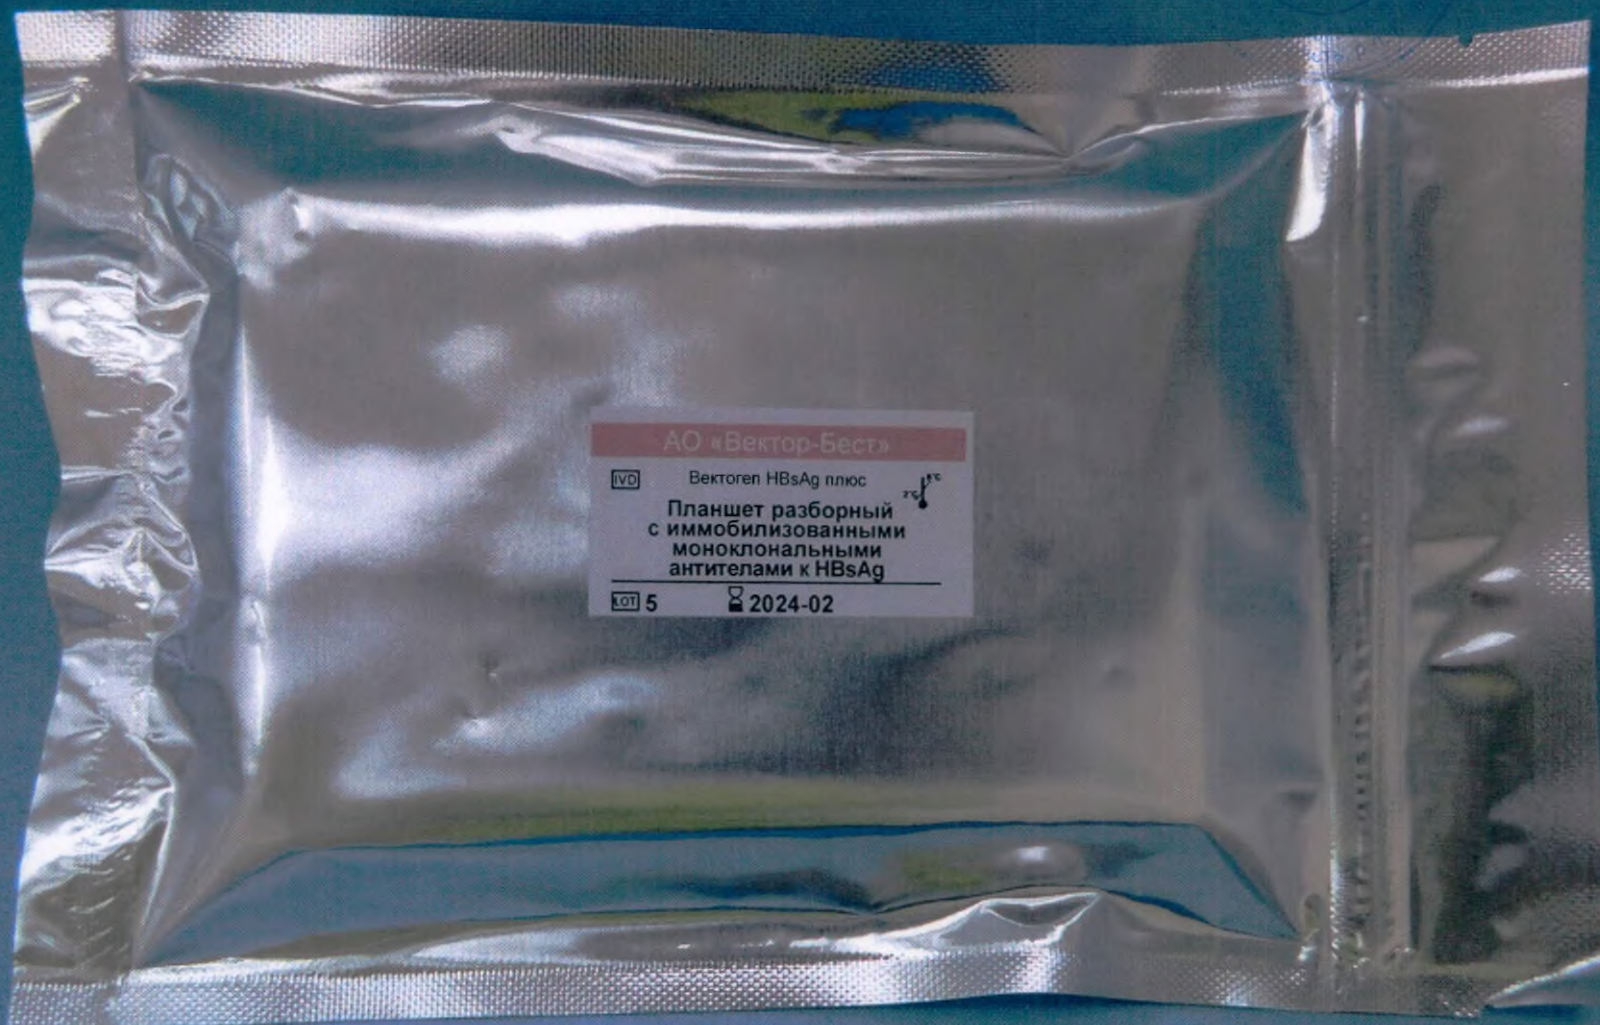

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Вектогеп HBsAg плюс” (комплект 3) № 2
серия 5

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
13.06.2023 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Вектоген HBsAg плюс” (комплект 3) № 3
серия 5

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусанов
“13.06” 2023 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Вектогеп HBsAg плюс” (комплект 3) № 4
серия 5

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
06 2023 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Вектогеп HBsAg плюс” (комплект 3) № 5
серия 5


Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
2023 г.



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
"Вектор-Бест HBsAg плюс" (комплект 3) № 1
серия 5


Генеральный директор
АО "Вектор-Бест"

М.Д. Хусаинов
2023 г.



ВЕКТОР

БЕСТ

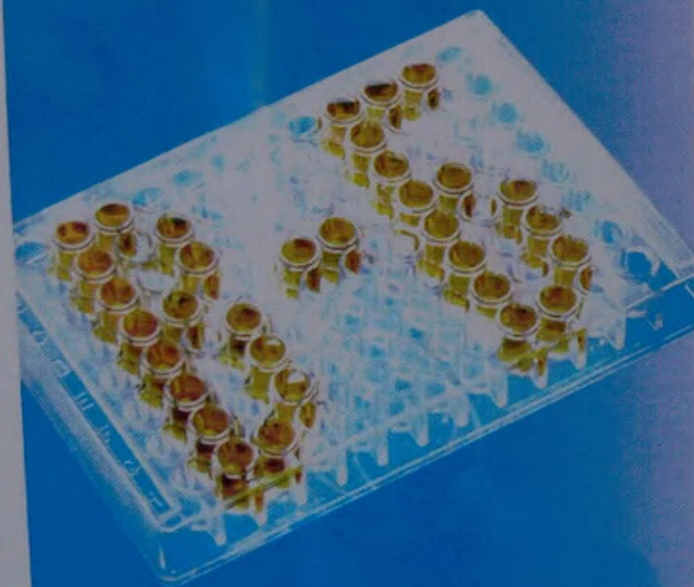

REF

X-XXXX

набор реагентов для
иммуноферментного выявления
HBsAg

Вектор-Бест HBsAg плюс
(комплект 3)

5


СОСТАВ:

5

1. Планшет разборный с иммобилизованными моноклональными антителами к HBsAg	5 шт.	5
2. Отрицательный контрольный образец (K ⁻)	2 фл. по 3,0 мл	5
3. Слабоположительный контрольный образец (K ⁺ слаб)	1 фл. 2,5 мл	5
4. Положительный контрольный образец (K ⁺)	1 фл. 2,5 мл	5
5. Конъюгат	2 фл. по 15,0 мл	5
6. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т+25)	1 фл. 100,0 мл	5
7. Раствор тетраметилбензидина (Раствор ТМБ)	3 фл. по 20,0 мл	5
8. Стоп-реагент	3 фл. по 21,0 мл	5
9. Пленки для заклеивания планшета	5 шт.	
10. Наконечники для дозаторов	16 шт.	
11. Ванночки для реагентов	2 шт.	

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“Вектоген HBsAg плюс” (комплект 3) № 2
серия 5

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
13.06 2023 г.

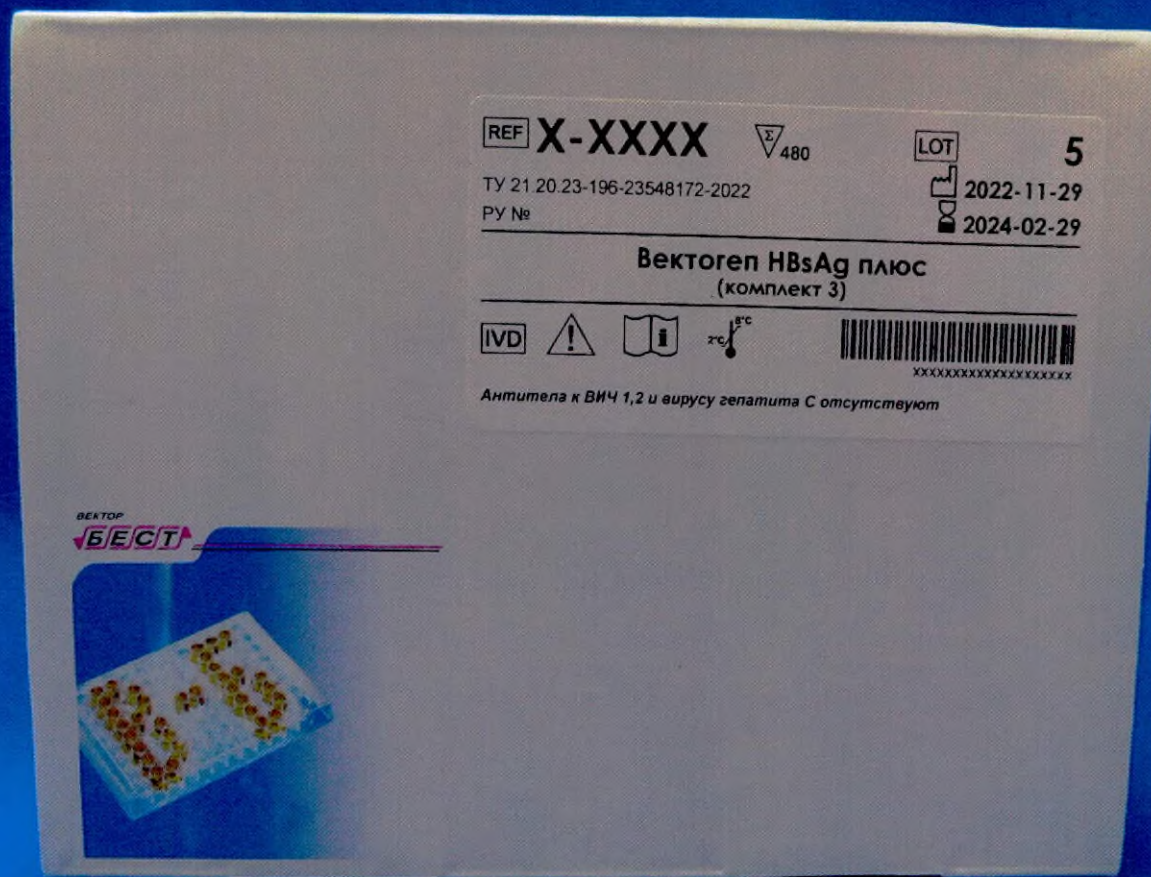

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“Вектоген HBsAg плюс” (комплект 3) № 3
серия 5

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
2023 г.



АО «Вектор-Бест»
Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,
тел.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

E-mail: vbmarket@vector-best.ru
www.vector-best.ru

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
 “Вектоген HBsAg плюс” (комплект 3)
 серия 6

Генеральный директор
 АО “Вектор-Бест”

М.Д. Хусаинов
 2023 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Вектогеп HBsAg плюс” (комплект 3) № 1
серия 6

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
06/06/2023 г.





Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Вектоген HBsAg плюс” (комплект 3) № 1
серия 6

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“08” 06 2023 г.

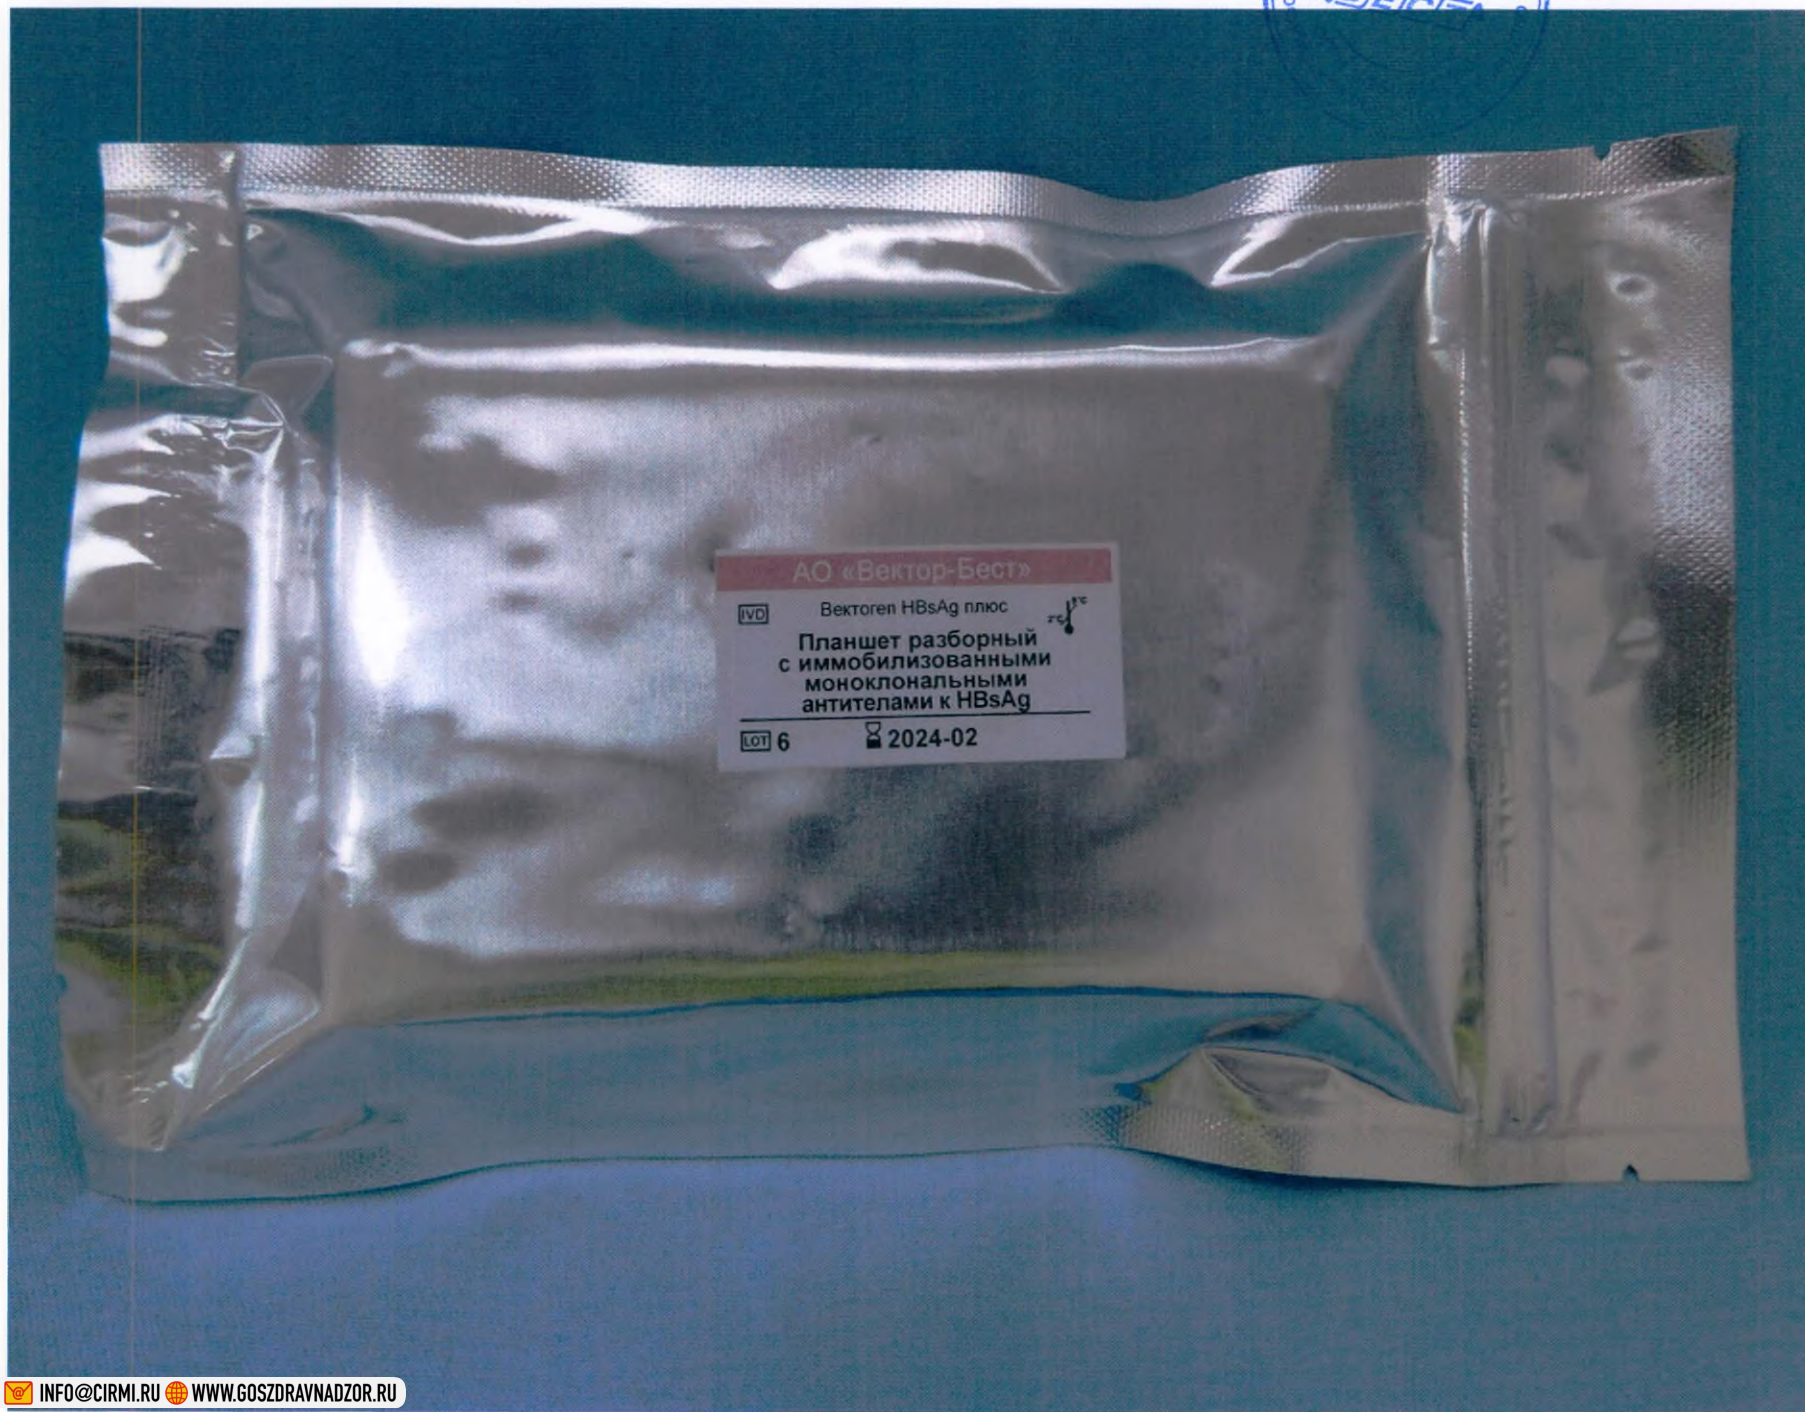

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Вектоген HBsAg плюс” (комплект 3) № 2
серия 6

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест”  М.Д. Хусанов
06 2023 г.

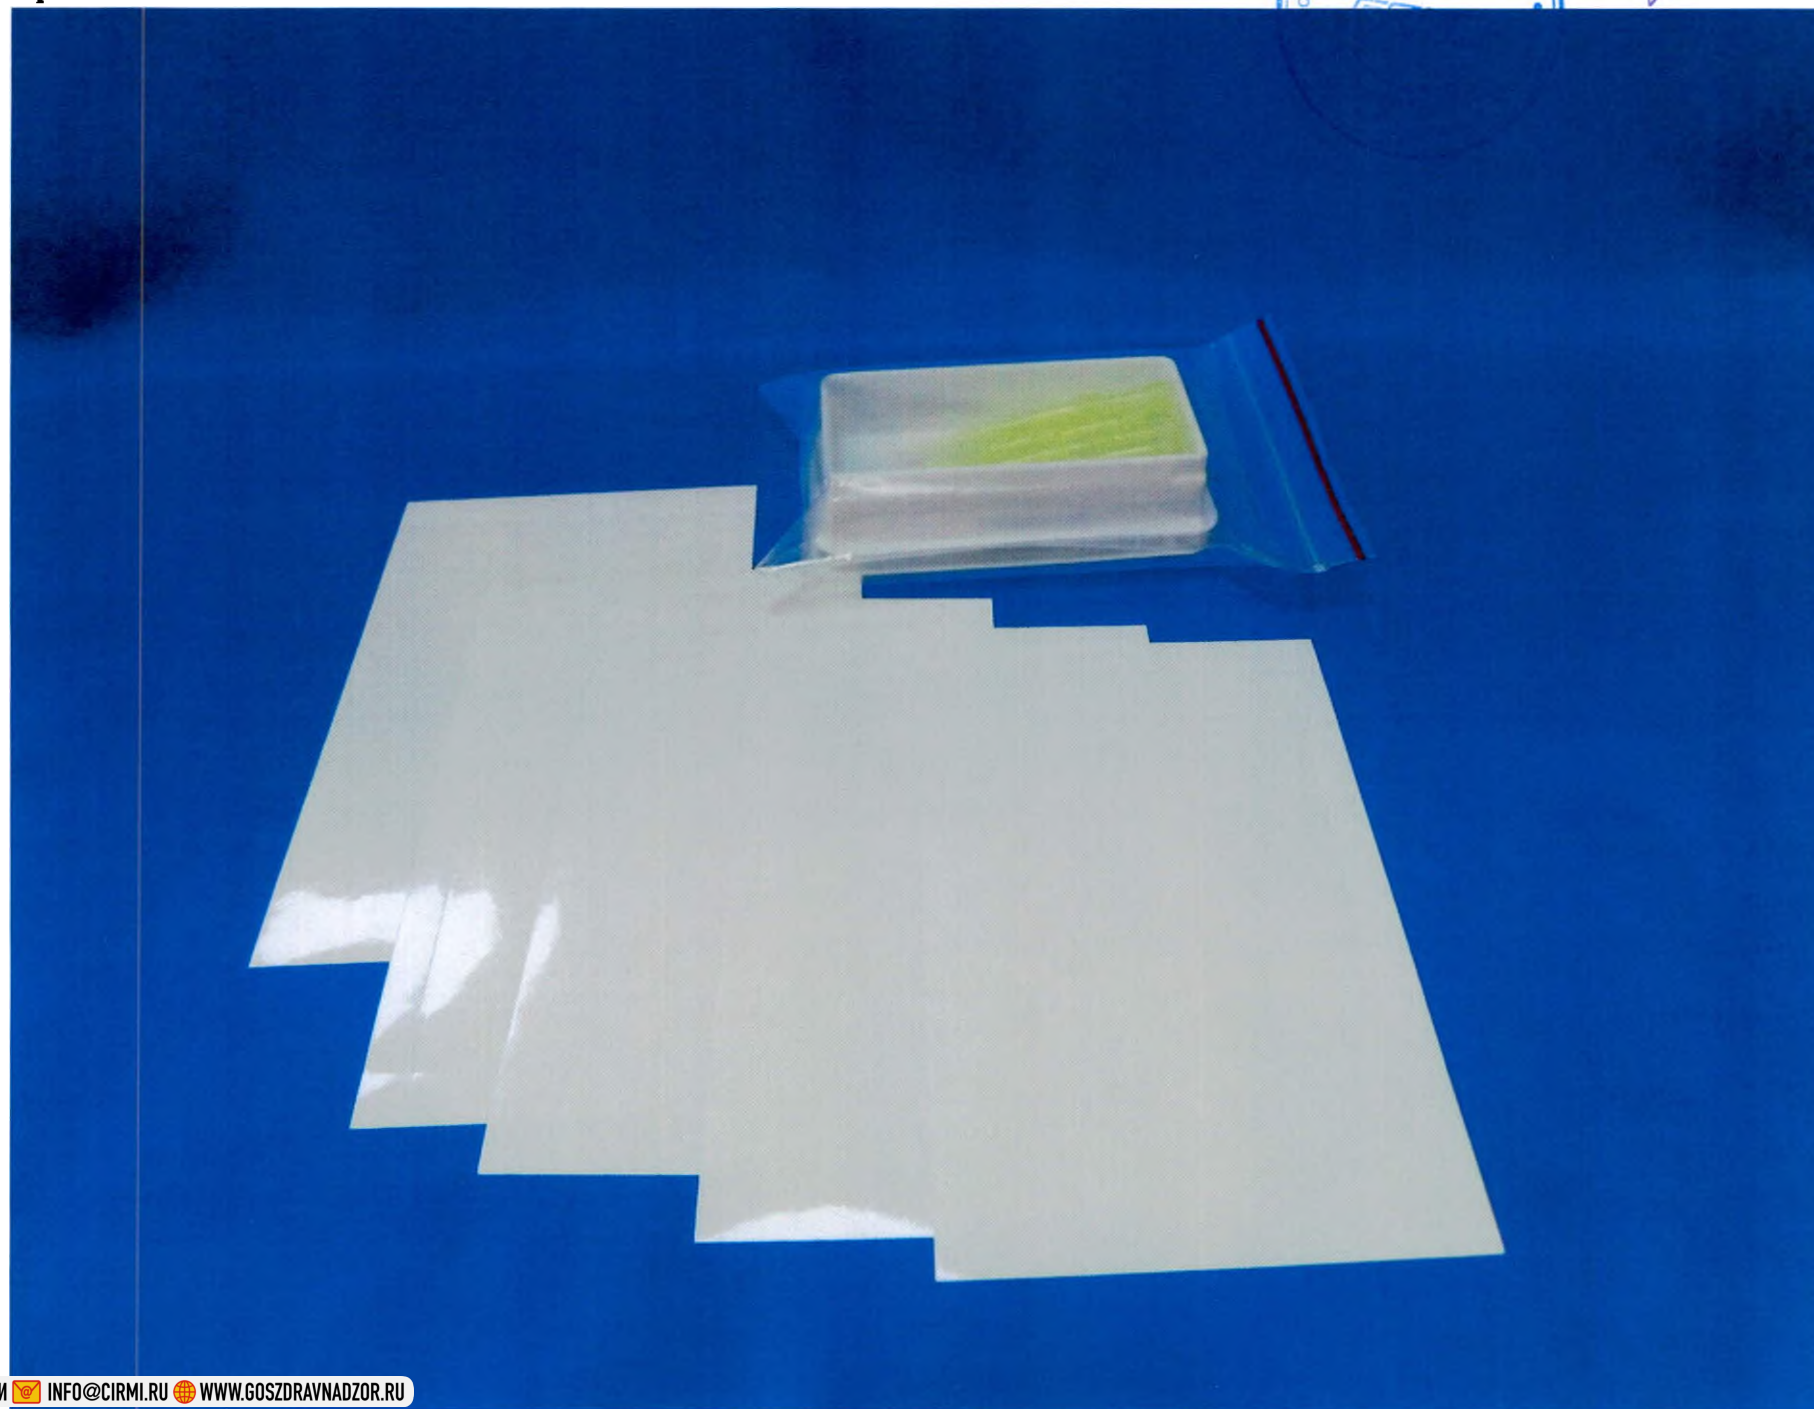


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Вектоген HBsAg плюс” (комплект 3) № 3
серия 6

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
2023 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Вектогеп HBsAg плюс” (комплект 3) № 4
серия 6

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
13.06.2023 г.

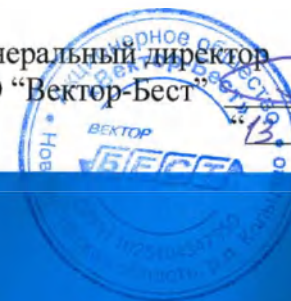

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Вектор HBsAg плюс” (комплект 3) № 5
серия 6


Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“13” 06 2023 г.

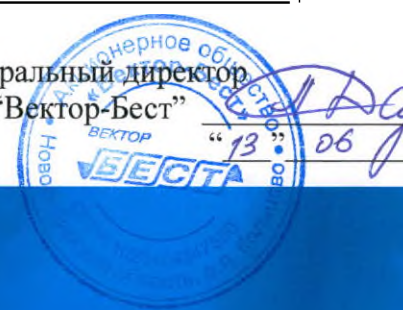

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
"Вектоген HBsAg плюс" (комплект 3) № 1
серия 6


Генеральный директор
АО "Вектор-Бест"

М.Д. Хусаинов
2023 г.

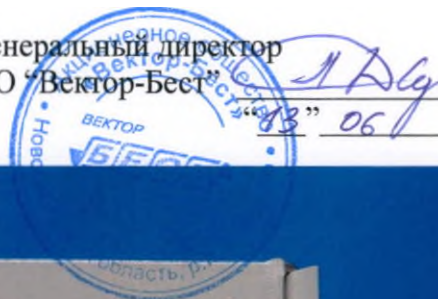

BEKTOP

БЕСТ

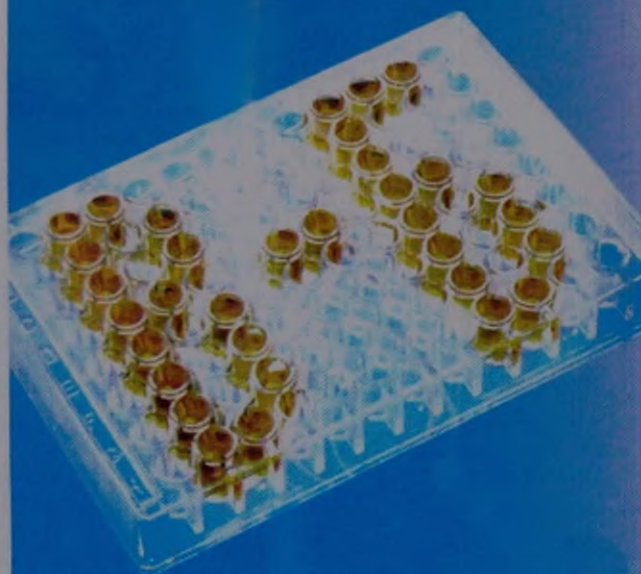

REF

X-XXXX

набор реагентов для
иммуноферментного выявления
HBsAg

Вектоген HBsAg плюс
(комплект 3)

LOT 6


СОСТАВ:

LOT


1. Планшет разборный с иммобилизованными моноклональными антителами к HBsAg	5 шт	6
2. Отрицательный контрольный образец (K ⁻)	2 фл. по 3.0 мл	6
3. Слабopоложительный контрольный образец (K ⁺ слаб.)	1 фл. 2.5 мл	6
4. Положительный контрольный образец (K ⁺)	1 фл. 2.5 мл	6
5. Конъюгат	2 фл. по 15.0 мл	6
6. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т+25)	1 фл. 100.0 мл	6
7. Раствор тетраметилбензидина (Раствор ТМБ)	3 фл. по 20.0 мл	6
8. Стоп-реагент	3 фл. по 21.0 мл	6
9. Пленки для заклеивания планшета	5 шт	
10. Наконечники для дозаторов	16 шт	
11. Ванночки для реагентов	2 шт	

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
"Вектоген HBsAg плюс" (комплект 3) № 2
серия 6

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
2023 г.

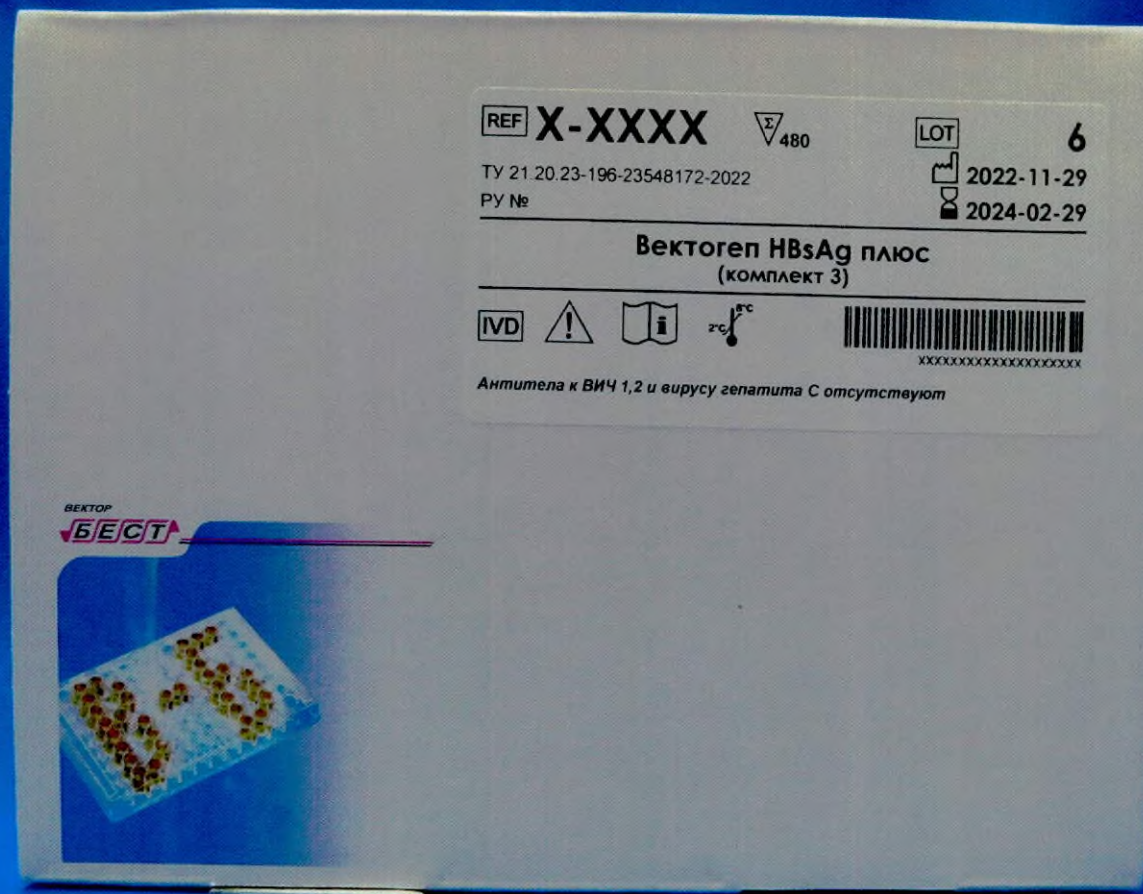

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“Вектоген HBsAg плюс” (комплект 3) № 3
серия 6

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест”  М.Д. Хусаинов
“08” 06 2023 г.



АО «Вектор-Бест»
Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,
тел.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

E-mail: vbmarket@vector-best.ru
www.vector-best.ru



«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»
М.Д. Хусаинов
2023 г.

Образцы маркировки на Набор реагентов
для иммуноферментного выявления HBsAg
«Вектоген HBsAg плюс»

1. Образцы этикеток на компоненты набора «Вектоген HBsAg плюс»
(комплект 1)

Наименование компонента	Этикетка
Планшет разборный с иммобилизованными моноклональными антителами к HBsAg	
Отрицательный контрольный образец (K ⁻)	
Слабоположительный контрольный образец (K ⁺ слаб.)	
Положительный контрольный образец (K ⁺)	
Конъюгат	
Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25)	
Раствор тетраметилбензидина (Раствор ТМБ)	
Стоп-реагент	

2. Образцы этикеток на коробке набора «Вектогеп HBsAg плюс» (комплект 1)

2.1. Верхняя этикетка.

REF	X-XXXX		набор реагентов для иммуноферментного выявления HBsAg																																		
Вектогеп HBsAg плюс (комплект 1)																																					
LOT	XXXX	Состав:	LOT																																		
<table border="0"> <tr> <td>1. Планшет разборный с иммобилизованными моноклональными антителами к HBsAg</td> <td>1 шт.</td> <td>XXXX</td> </tr> <tr> <td>2. Отрицательный контрольный образец (K⁻)</td> <td>1 фл., 3,0 мл</td> <td>XXXX</td> </tr> <tr> <td>3. Слабоположительный контрольный образец (K⁺ слаб)</td> <td>1 фл., 2,5 мл</td> <td>XXXX</td> </tr> <tr> <td>4. Положительный контрольный образец (K⁺)</td> <td>1 фл., 2,5 мл</td> <td>XXXX</td> </tr> <tr> <td>5. Конъюгат</td> <td>1 фл., 8,0 мл</td> <td>XXXX</td> </tr> <tr> <td>6. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25)</td> <td>1 фл., 28,0 мл</td> <td>XXXX</td> </tr> <tr> <td>7. Раствор тетраметилбензидаина (Раствор ТМБ)</td> <td>1 фл., 13,0 мл</td> <td>XXXX</td> </tr> <tr> <td>8. Стоп-реагент</td> <td>1 фл., 12,0 мл</td> <td>XXXX</td> </tr> <tr> <td>9. Пленка для заклеивания планшета</td> <td>1 шт.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10. Наконечники для дозаторов</td> <td>16 шт.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11. Ванночки для реагентов</td> <td>2 шт.</td> <td></td> </tr> </table>					1. Планшет разборный с иммобилизованными моноклональными антителами к HBsAg	1 шт.	XXXX	2. Отрицательный контрольный образец (K ⁻)	1 фл., 3,0 мл	XXXX	3. Слабоположительный контрольный образец (K ⁺ слаб)	1 фл., 2,5 мл	XXXX	4. Положительный контрольный образец (K ⁺)	1 фл., 2,5 мл	XXXX	5. Конъюгат	1 фл., 8,0 мл	XXXX	6. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25)	1 фл., 28,0 мл	XXXX	7. Раствор тетраметилбензидаина (Раствор ТМБ)	1 фл., 13,0 мл	XXXX	8. Стоп-реагент	1 фл., 12,0 мл	XXXX	9. Пленка для заклеивания планшета	1 шт.		10. Наконечники для дозаторов	16 шт.		11. Ванночки для реагентов	2 шт.	
1. Планшет разборный с иммобилизованными моноклональными антителами к HBsAg	1 шт.	XXXX																																			
2. Отрицательный контрольный образец (K ⁻)	1 фл., 3,0 мл	XXXX																																			
3. Слабоположительный контрольный образец (K ⁺ слаб)	1 фл., 2,5 мл	XXXX																																			
4. Положительный контрольный образец (K ⁺)	1 фл., 2,5 мл	XXXX																																			
5. Конъюгат	1 фл., 8,0 мл	XXXX																																			
6. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25)	1 фл., 28,0 мл	XXXX																																			
7. Раствор тетраметилбензидаина (Раствор ТМБ)	1 фл., 13,0 мл	XXXX																																			
8. Стоп-реагент	1 фл., 12,0 мл	XXXX																																			
9. Пленка для заклеивания планшета	1 шт.																																				
10. Наконечники для дозаторов	16 шт.																																				
11. Ванночки для реагентов	2 шт.																																				

2.2. Боковая этикетка № 1.

REF	X-XXXX	Σ 96	LOT	XXXX
ТУ 21.20.23-196-23548172-2022 ПУ №			XXXX-XX-XX XXXX-XX-XX	
Вектогеп HBsAg плюс (комплект 1)				
IVD				
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx				
Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С отсутствуют				

2.3. Боковая этикетка № 2.

	АО «Вектор-Бест»
Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211 тел/факс: +7 383 252-51-64, +7 383 252-51-67 E-mail: vbmarket@vector-best.ru www.vector-best.ru	

Примечание. Текст боковой этикетки № 2 может быть нанесен непосредственно на коробку типографским способом.

«СОГЛАСОВАНО»

Директор по производству
АО «Вектор-Бест»

В.К. Ткачев

«13» июня

2023 г.



Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 2 листов.
Директор по технологии и качеству
АО «Вектор-Бест»

Масяго А.В. Масяго
"13" июня 2023 г.



«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»
М.Д. Хусаинов
« 13 » июня 2023 г.

Образцы маркировки на Набор реагентов
для иммуноферментного выявления HBsAg
«Вектогеп HBsAg плюс»

1. Образцы этикеток на компоненты набора «Вектогеп HBsAg плюс»
(комплект 2)

Наименование компонента	Этикетка
Планшет разборный с иммобилизованными моноклональными антителами к HBsAg	
Отрицательный контрольный образец (K ⁻)	
Слабоположительный контрольный образец (K ⁺ слаб.)	
Положительный контрольный образец (K ⁺)	
Конъюгат	
Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25)	
Раствор тетраметилбензидина (Раствор ТМБ)	
Стоп-реагент	

2. Образцы этикеток на коробке набора «Вектогеп HBsAg плюс» (комплект 2)

2.1. Верхняя этикетка.

REF

X-XXXX

набор реагентов для
иммуноферментного выявления HBsAg

Вектогеп HBsAg плюс
(комплект 2)

LOT XXXX

Состав:

LOT

1. Планшет разборный с иммобилизованными
моноклональными антителами к HBsAg

2 шт.

XXXX

2. Отрицательный контрольный образец (K⁻)

2 фл. по 3,0 мл

XXXX

3. Слабоположительный контрольный образец (K⁺ слаб)

1 фл., 2,5 мл

XXXX

4. Положительный контрольный образец (K⁺)

1 фл., 2,5 мл

XXXX

5. Конъюгат

1 фл., 15,0 мл

XXXX

6. Концентрат фосфатно-солевого буферного
раствора с твином (ФСБ-Т×25)

1 фл., 28,0 мл

XXXX

7. Раствор тетраметилбензидина (Раствор ТМБ)

2 фл. по 13,0 мл

XXXX

8. Стоп-реагент

2 фл. по 12,0 мл

XXXX

9. Пленки для заклеивания планшета

2 шт.

10. Наконечники для дозаторов

16 шт.

11. Ванночки для реагентов

2 шт.

2.2. Боковая этикетка № 1.

REF X-XXXX

Σ

192

LOT XXXX

ТУ 21.20.23-196-23548172-2022

РУ №

XXXX-XX-XX

XXXX-XX-XX

Вектогеп HBsAg плюс
(комплект 2)

IVD

⚠

ⓘ

2°C

8°C

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С отсутствуют

2.3. Боковая этикетка № 2.


АО «Вектор-Бест»

Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211
тел/факс: +7 383 252-51-64, +7 383 252-51-67
E-mail: vbmarket@vector-best.ru
www.vector-best.ru

Примечание. Текст боковой этикетки № 2 может быть нанесен непосредственно на коробку типографским способом.

«СОГЛАСОВАНО»

Директор по производству
АО «Вектор-Бест»



В.К. Ткачев

«13» июня

2023 г.

ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

2



Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 2 листов.
Директор по технологии и качеству
АО «Вектор-Бест»

А.В. Масыго А.В. Масыго
13 июля 2023 г.



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

АО «Вектор-Бест»

М.Д. Хусаинов
«13» _____ 2023 г.

**Образцы маркировки на Набор реагентов
для иммуноферментного выявления HBsAg
«Вектоген HBsAg плюс»**

**1. Образцы этикеток на компоненты набора «Вектоген HBsAg плюс»
(комплект 3)**

Наименование компонента	Этикетка
Планшет разборный с иммобилизованными моноклональными антителами к HBsAg	
Отрицательный контрольный образец (K ⁻)	
Слабоположительный контрольный образец (K ⁺ слаб.)	
Положительный контрольный образец (K ⁺)	
Конъюгат	
Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25)	
Раствор тетрамилбензидина (Раствор ТМБ)	
Стоп-реагент	

2. Образцы этикеток на коробке набора «Вектогеп HBsAg плюс» (комплект 3)

2.1. Верхняя этикетка.

REF	X-XXXX	набор реагентов для иммуноферментного выявления HBsAg
Вектогеп HBsAg плюс (комплект 3)		
LOT XXXX	Состав:	LOT
1. Планшет разборный с иммобилизованными моноклональными антителами к HBsAg 5 шт. XXXX 2. Отрицательный контрольный образец (K-) 2 фл. по 3,0 мл XXXX 3. Слабopоложительный контрольный образец (K+ слаб) 1 фл., 2,5 мл XXXX 4. Положительный контрольный образец (K+) 1 фл., 2,5 мл XXXX 5. Конъюгат 2 фл. по 15,0 мл XXXX 6. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25) 1 фл., 100,0 мл XXXX 7. Раствор тетраметилбензидина (Раствор ТМБ) 3 фл. по 20,0 мл XXXX 8. Стоп-реагент 3 фл. по 21,0 мл XXXX 9. Пленки для заклеивания планшета 5 шт. 10. Наконечники для дозаторов 16 шт. 11. Ванночки для реагентов 2 шт.		

2.2. Боковая этикетка № 1.

REF X-XXXX	Σ 480	LOT	XXXX
TY 21.20.23-196-23548172-2022 PY №		XXXX-XX-XX XXXX-XX-XX	
Вектогеп HBsAg плюс (комплект 3)			
IVD 2°C 8°C		 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С отсутствуют			

2.3. Боковая этикетка № 2.

	АО «Вектор-Бест» Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211 тел/факс: +7 383 252-51-64, +7 383 252-51-67 E-mail: vbmarket@vector-best.ru www.vector-best.ru
--	--

Примечание. Текст боковой этикетки № 2 может быть нанесен непосредственно на коробку типографским способом.

«СОГЛАСОВАНО»

Директор по производству
АО «Вектор-Бест»

В.К. Ткачев

«13» июня

2023 г.



Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 2 листов.
Директор по технологии и качеству
АО «Вектор-Бест»

А.В. Масыго

июня 2023 г.