



ЦЕНТР
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
СООТВЕТСТВИЯ

Общество с ограниченной ответственностью
«Центр Подтверждения Соответствия»
123308, г. Москва, ул. Мневники, дом 3, корпус 1
ИНН/КПП 7725790126/773401001
ОГРН 1137746368869
Тел/факс +7 495 532 92 10,
эл. почта: info@ctrps.ru



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «ЦПС»

Тихонов К.Ю.

«24» января 2022 г.

Фотографические изображения медицинского изделия

Микросферы для эмболизации кровеносных сосудов Bead,
в вариантах исполнения

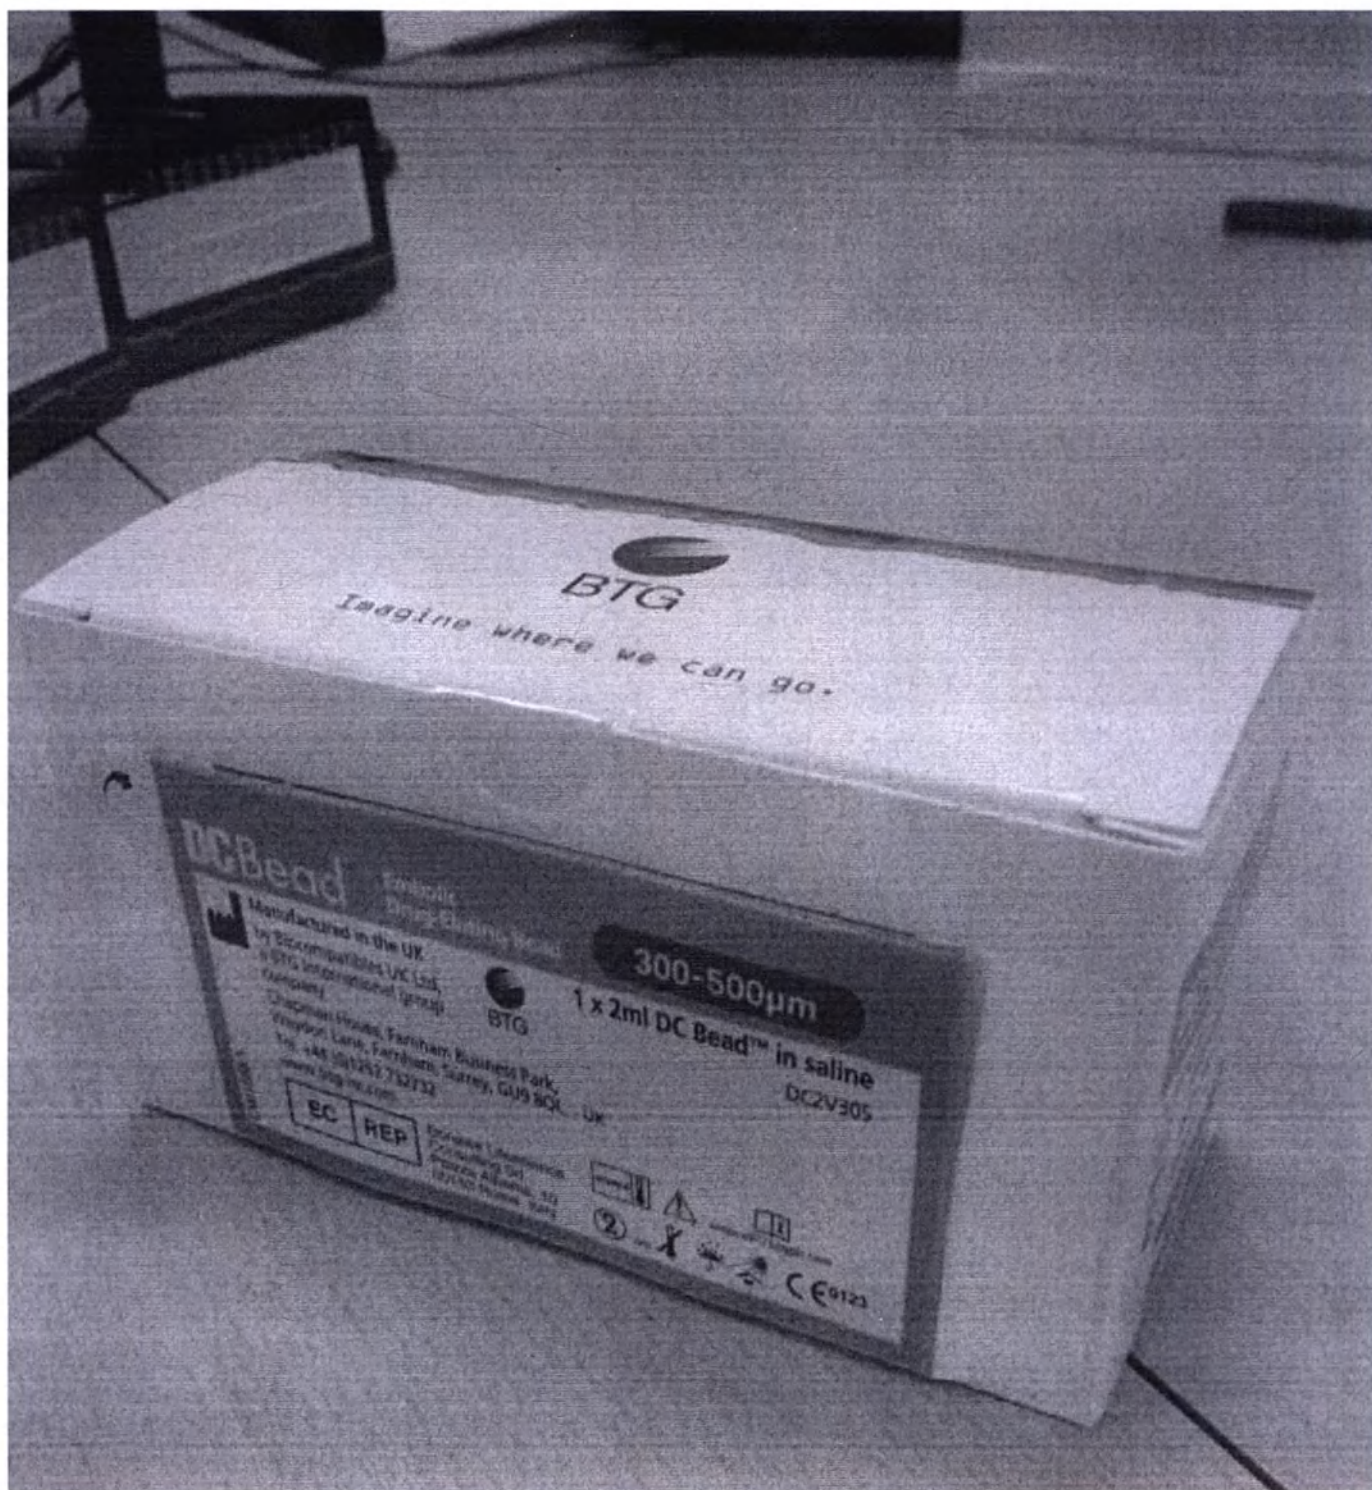


Рис.1 Общий вид упаковки медицинского изделия «Микросферы для эмболизации кровеносных сосудов Bead», вариант исполнения «Микросферы для эмболизации с лекарственным препаратом DC Bead, в физиологическом растворе, диаметр 300-500 мкм»

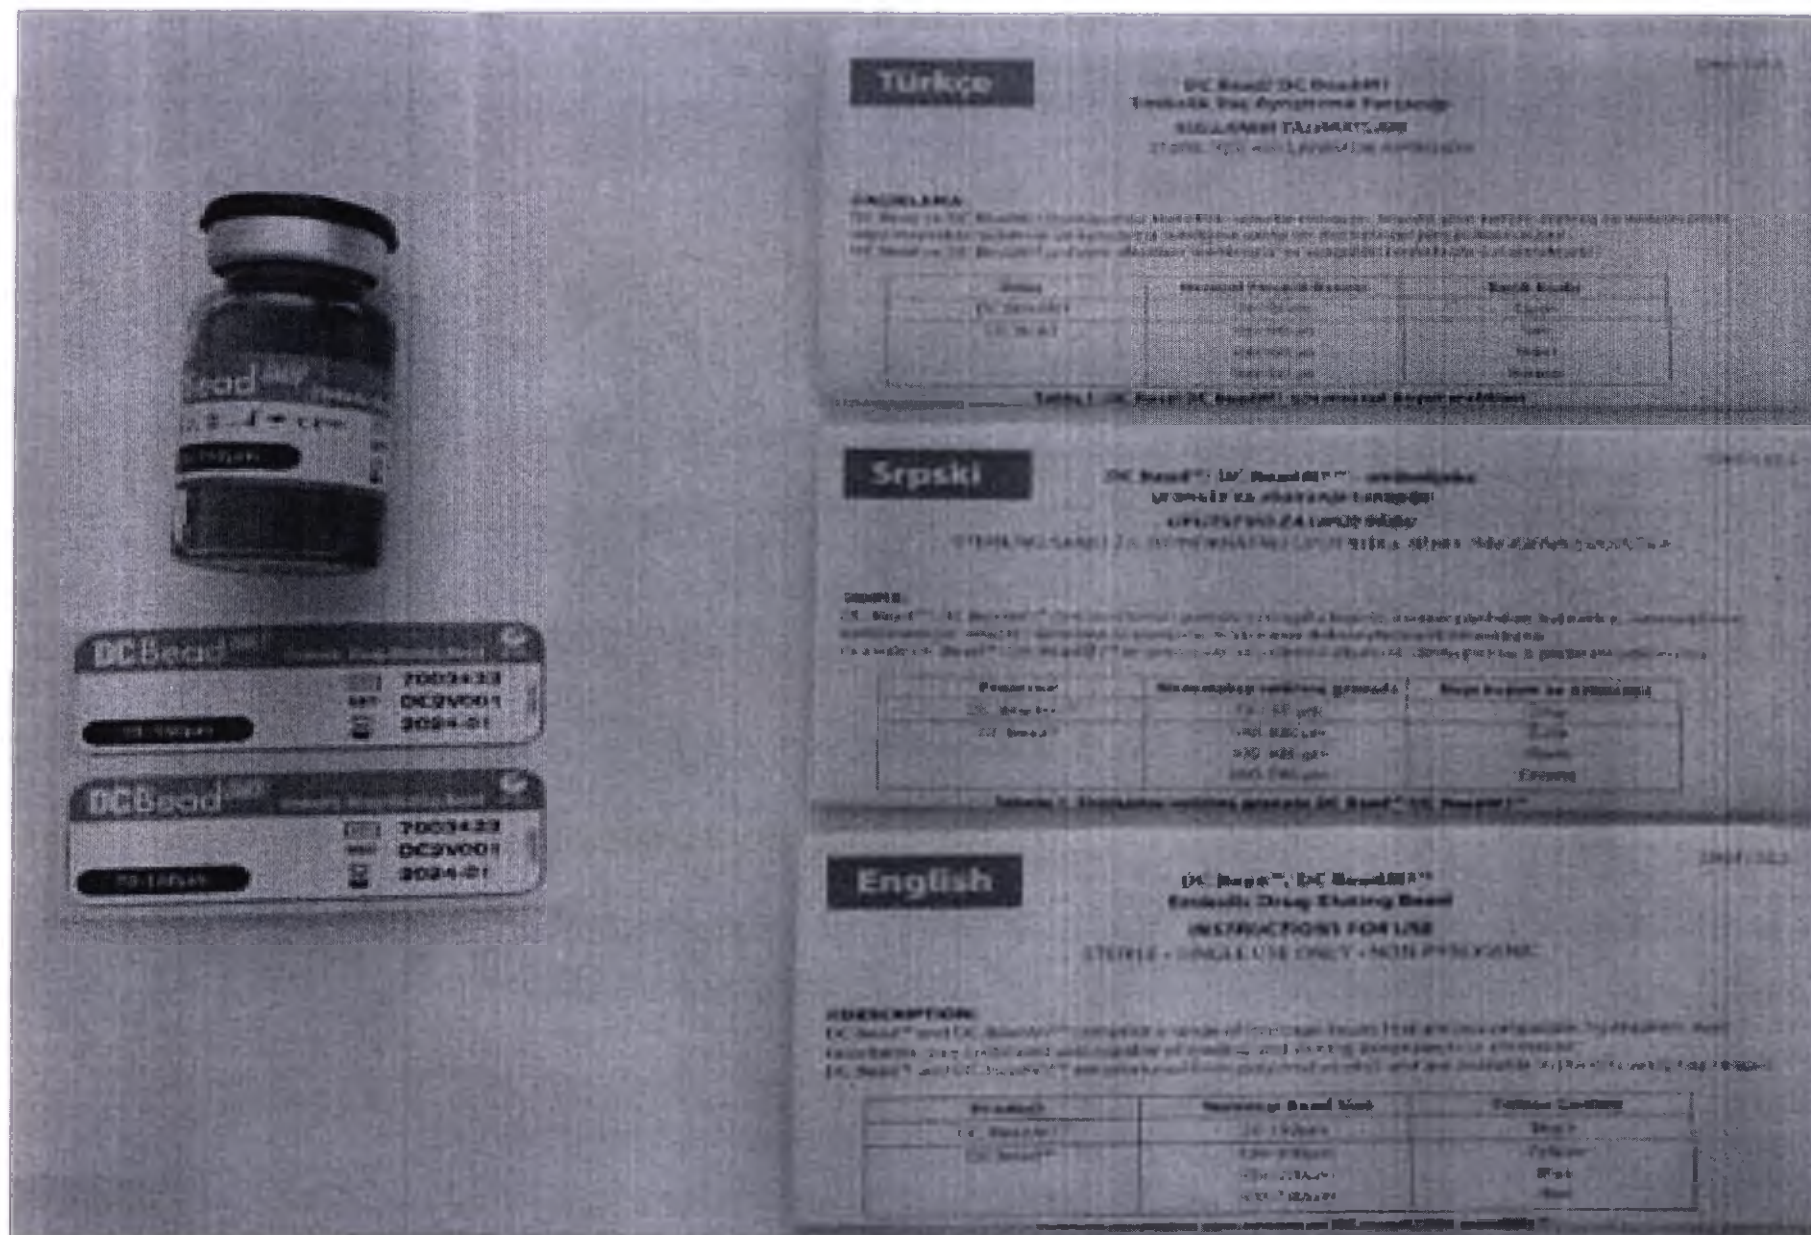


Рис.2 Общий вид содержимого упаковки медицинского изделия «Микросферы для эмболизации кровеносных сосудов Bead», вариант исполнения « Микросферы для эмболизации с лекарственным препаратом DC Bead, в физиологическом растворе, диаметр 70-150 мкм»



Рис.3 Общий вид первичной упаковки медицинского изделия «Микросферы для эмболизации кровеносных сосудов Bead», вариант исполнения «Микросферы для эмболизации с лекарственным препаратом DC Bead, в физиологическом растворе, диаметр 70-150 мкм»

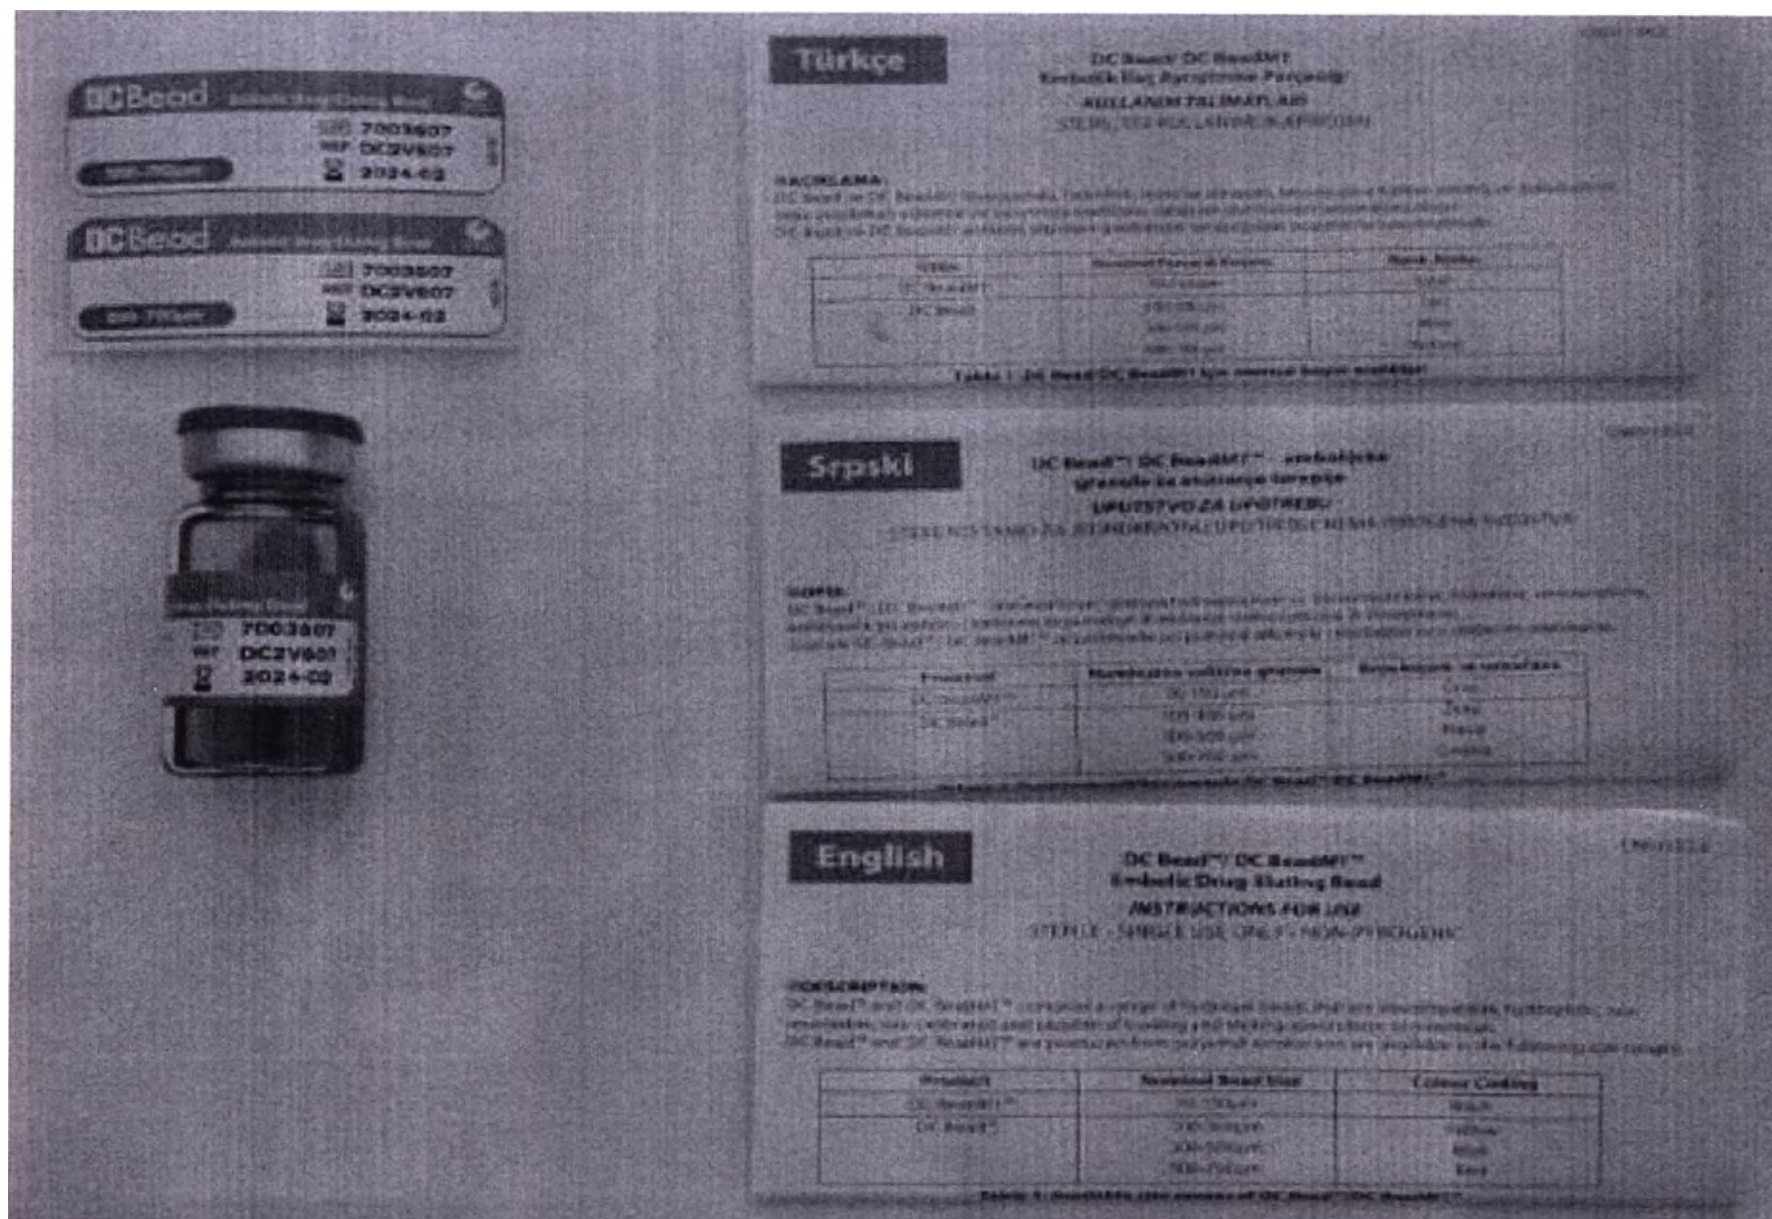


Рис.4 Общий вид содержимого упаковки медицинского изделия «Микросферы для эмболизации кровеносных сосудов Bead», вариант исполнения « Микросферы для эмболизации с лекарственным препаратом DC Bead, в физиологическом растворе, диаметр 500-700 мкм»




Рис.5 Общий вид первичной упаковки медицинского изделия «Микросферы для эмболизации кровеносных сосудов Bead», вариант исполнения «Микросферы для эмболизации с лекарственным препаратом DC Bead, в физиологическом растворе, диаметр 500-700 мкм»



Рис.6 Общий вид упаковки медицинского изделия «Микросферы для эмболизации кровеносных сосудов Bead», вариант исполнения «Микросферы для эмболизации Bead Block, в физиологическом растворе, диаметр 700-900 мкм»

BeadBlock




CAUTION: Federal (USA) Law restricts this device to sale by or on the order of a physician.



Manufactured in the UK by
Biocompatibles Ltd Ltd
a BTG International group company
Carter Road, Farnham Business Park
Weyhill Lane, Farnham, Surrey GU14 8QL, UK
Tel: +44(0) 1252 732732

Do not use if opened or damaged
Do not resterilise

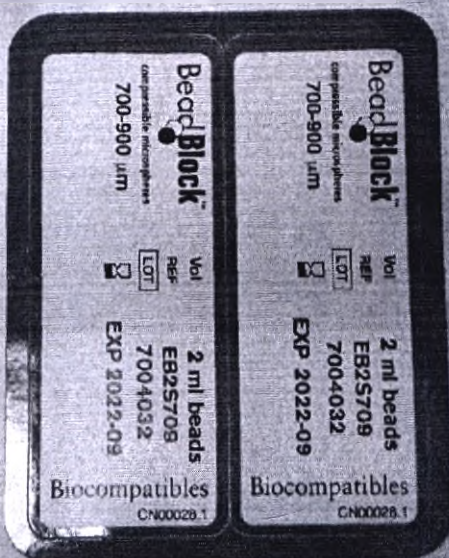

REF	Catalogue number	⌚	Use before / Expiry
LOT	Batch number / Lot number	☀️	Protect from light
⚠️	Do not reuse	☔	Protect from moisture
⚠️	Attention see instructions for use	❄️	Do not freeze
🧼	Steam sterilised	🏭	Manufacturer

CN00998.2

Рис. 7 Общий вид упаковки и маркировки шприца медицинского изделия «Микросферы для эмболизации кровеносных сосудов Bead», вариант исполнения «Микросферы для эмболизации BeadBlock, в физиологическом растворе, диаметр 700-900 мкм»

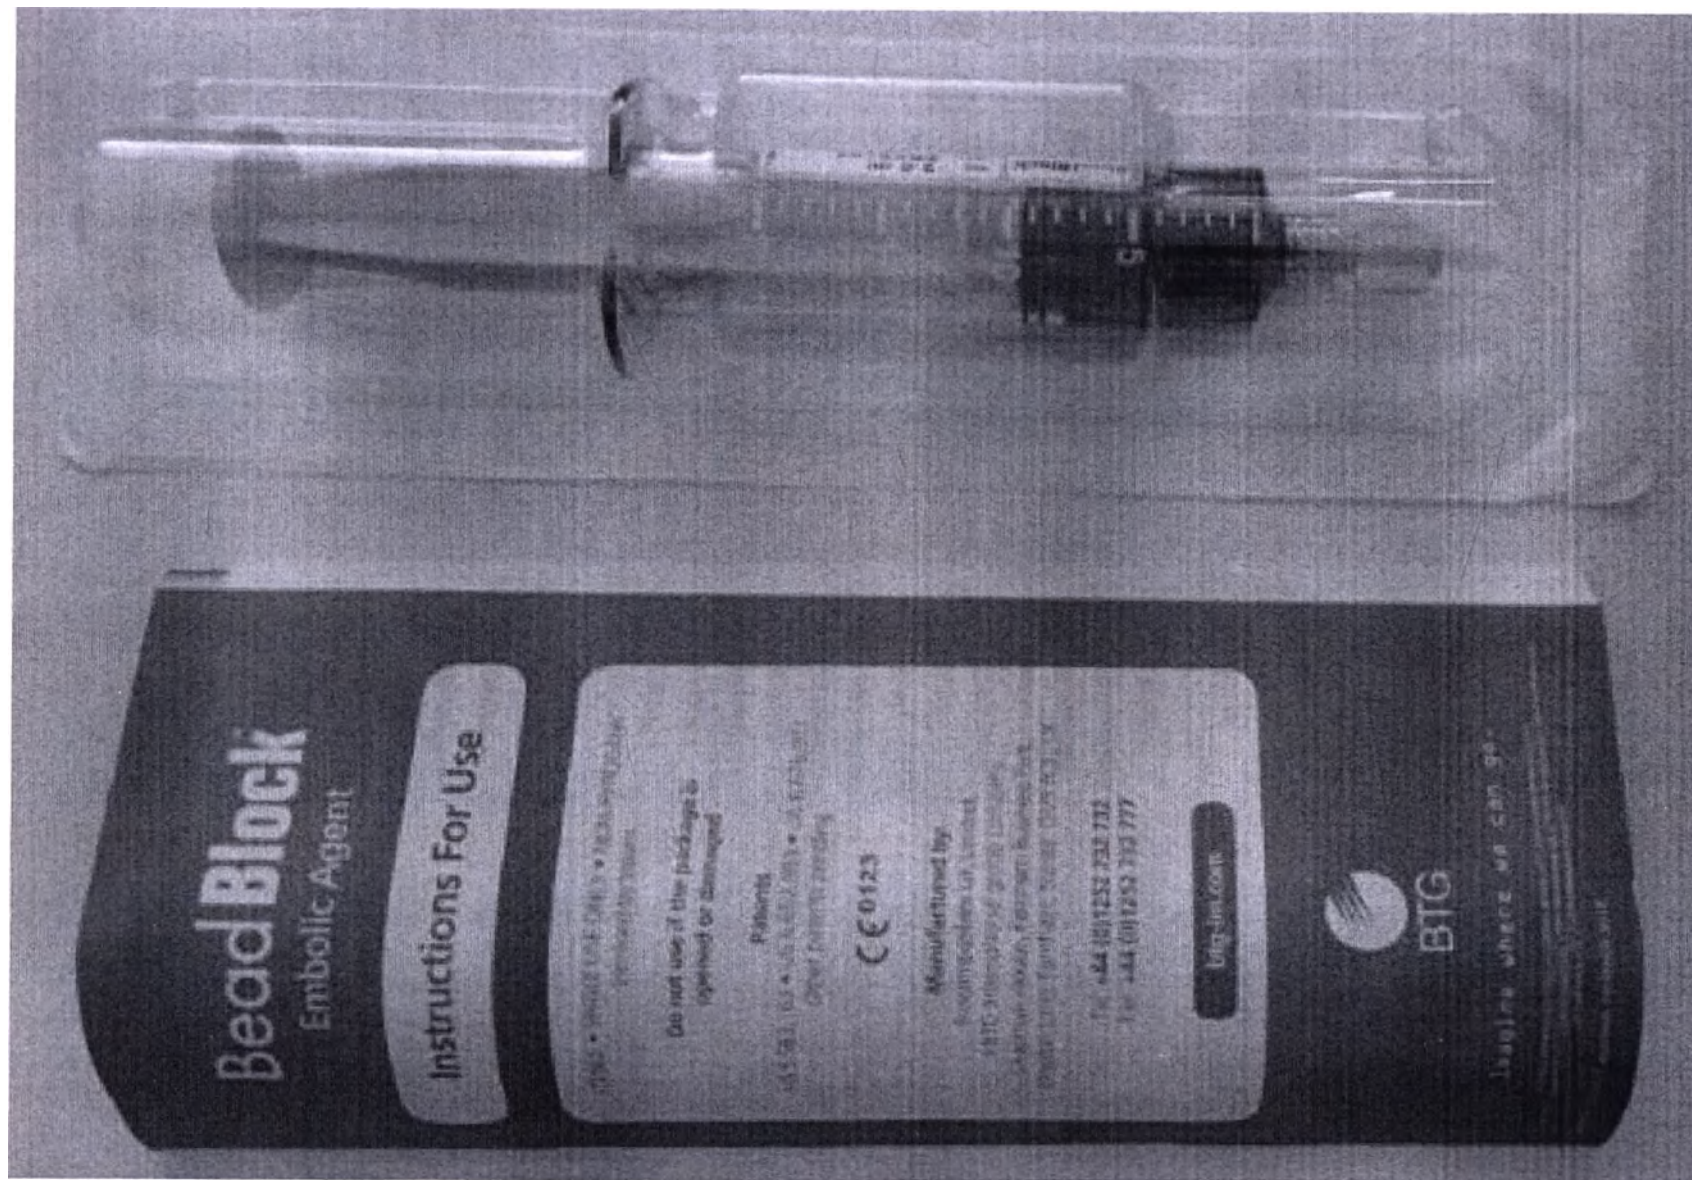


Рис.8 Общий вид содержимого упаковки медицинского изделия «Микросферы для эмболизации кровеносных сосудов Bead», вариант исполнения «Микросферы для эмболизации Bead Block, в физиологическом растворе, диаметр 100-300 мкм»

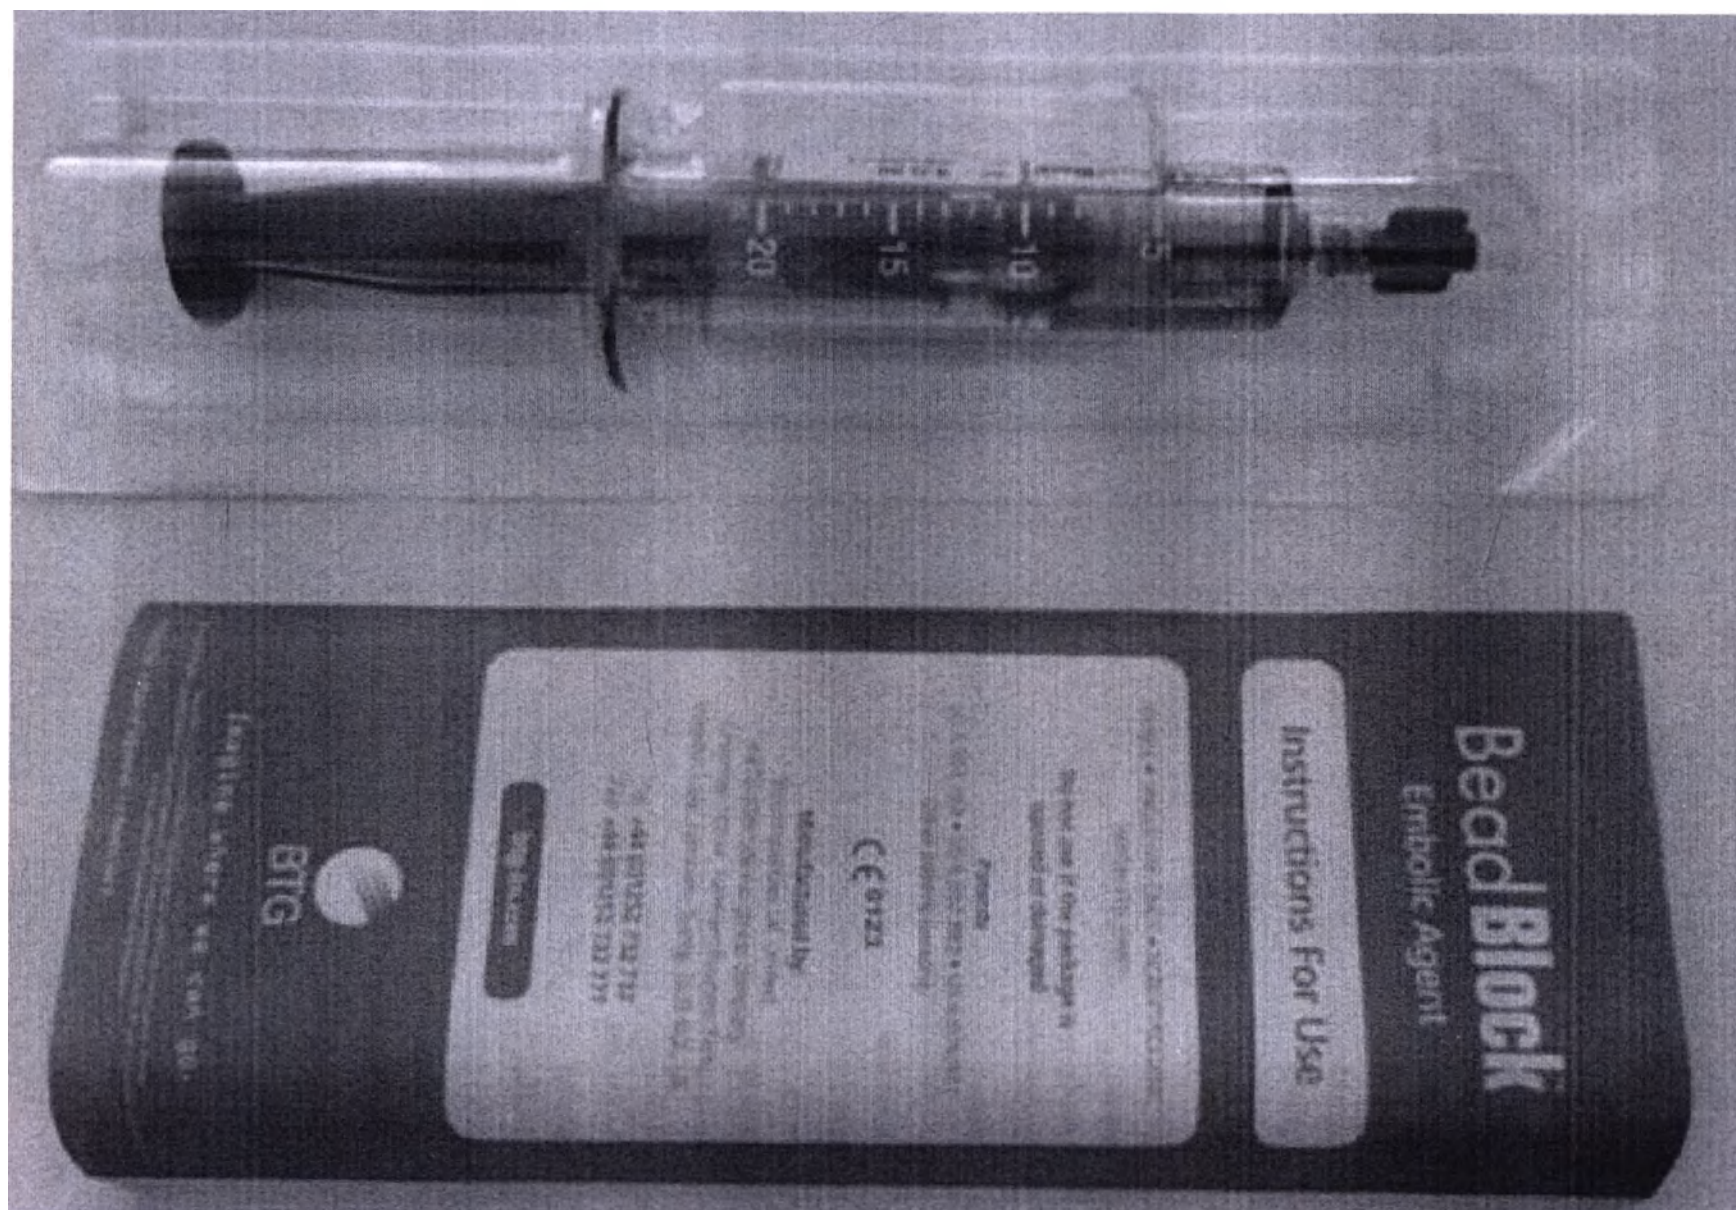


Рис.9 Общий вид содержимого упаковки медицинского изделия «Микросферы для эмболизации кровеносных сосудов Bead», вариант исполнения «Микросферы для эмболизации Bead Block, в физиологическом растворе, диаметр 900-1200 мкм»

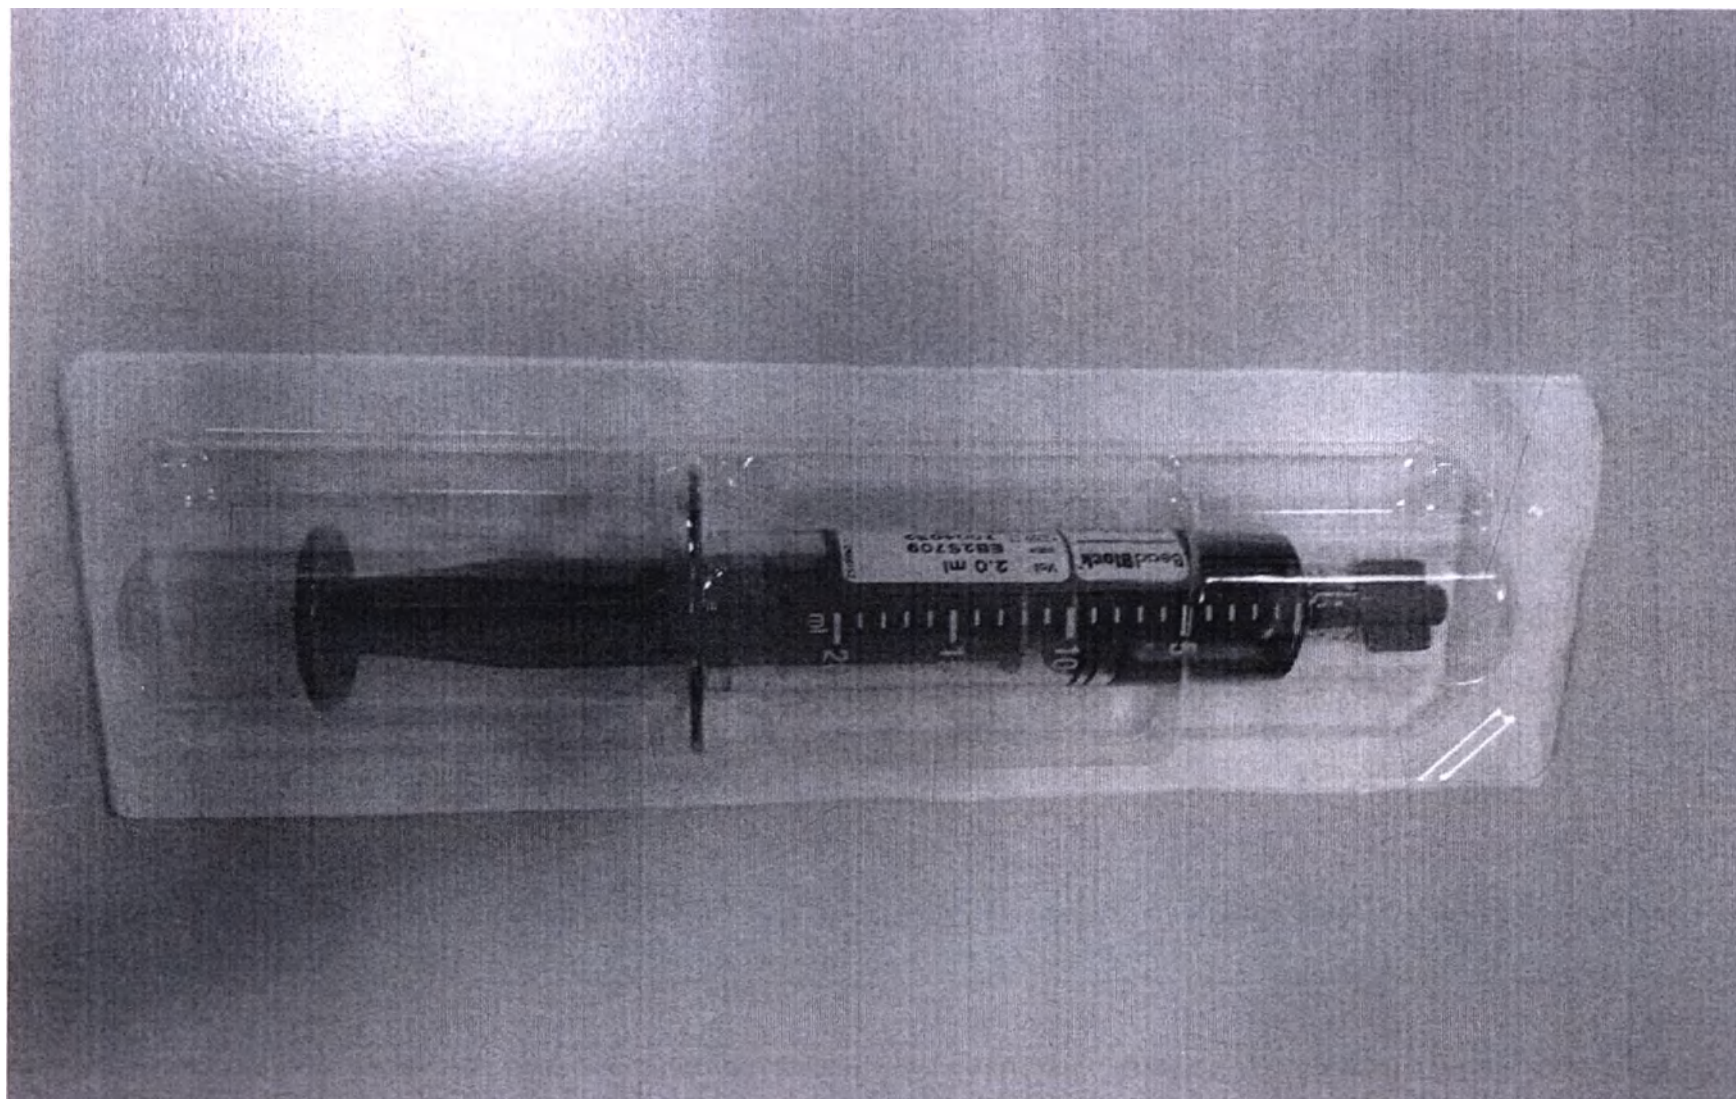


Рис.10 Общий вид медицинского изделия «Микросферы для эмболизации кровеносных сосудов Bead»
вариант исполнения «Микросферы для эмболизации Bead Block, в физиологическом растворе, диаметр 700-900 мкм»

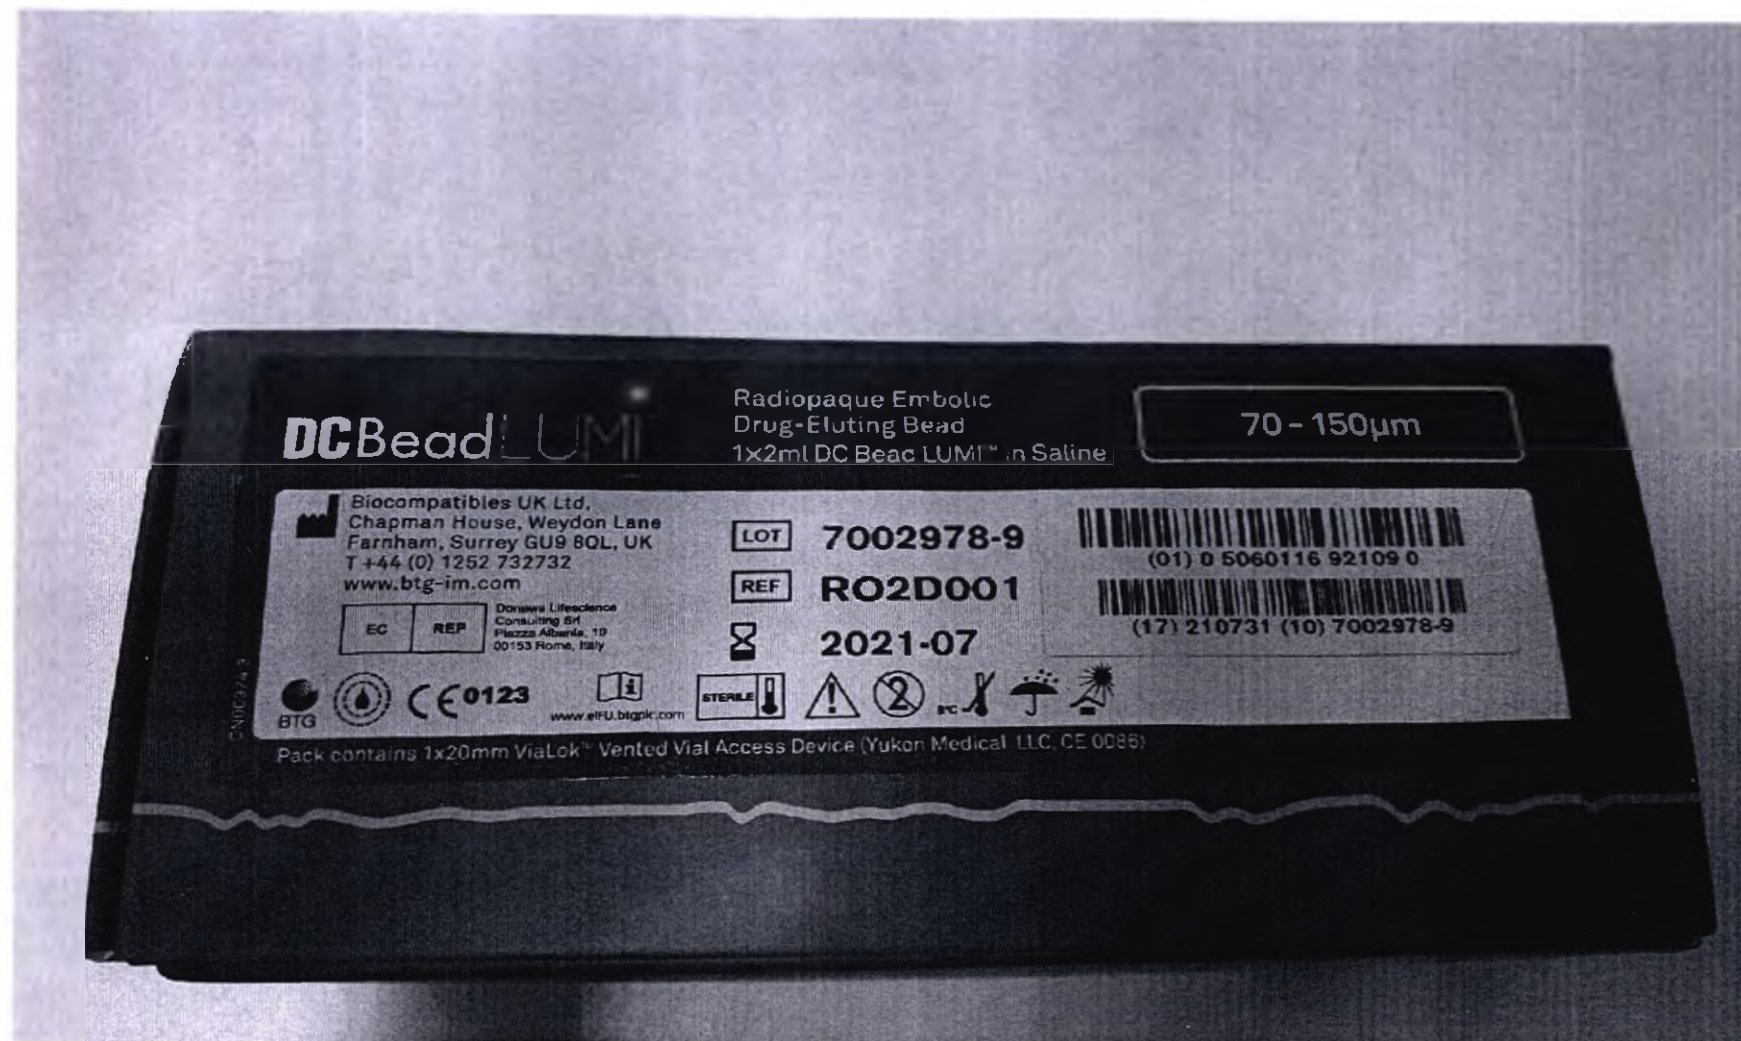


Рис.11 Общий вид упаковки медицинского изделия «Микросферы для эмболизации кровеносных сосудов Bead», вариант исполнения «Рентгеноконтрастные микросферы для эмболизации с лекарственным препаратом DC Bead LUMI, в физиологическом растворе, диаметр 70-150 мкм»

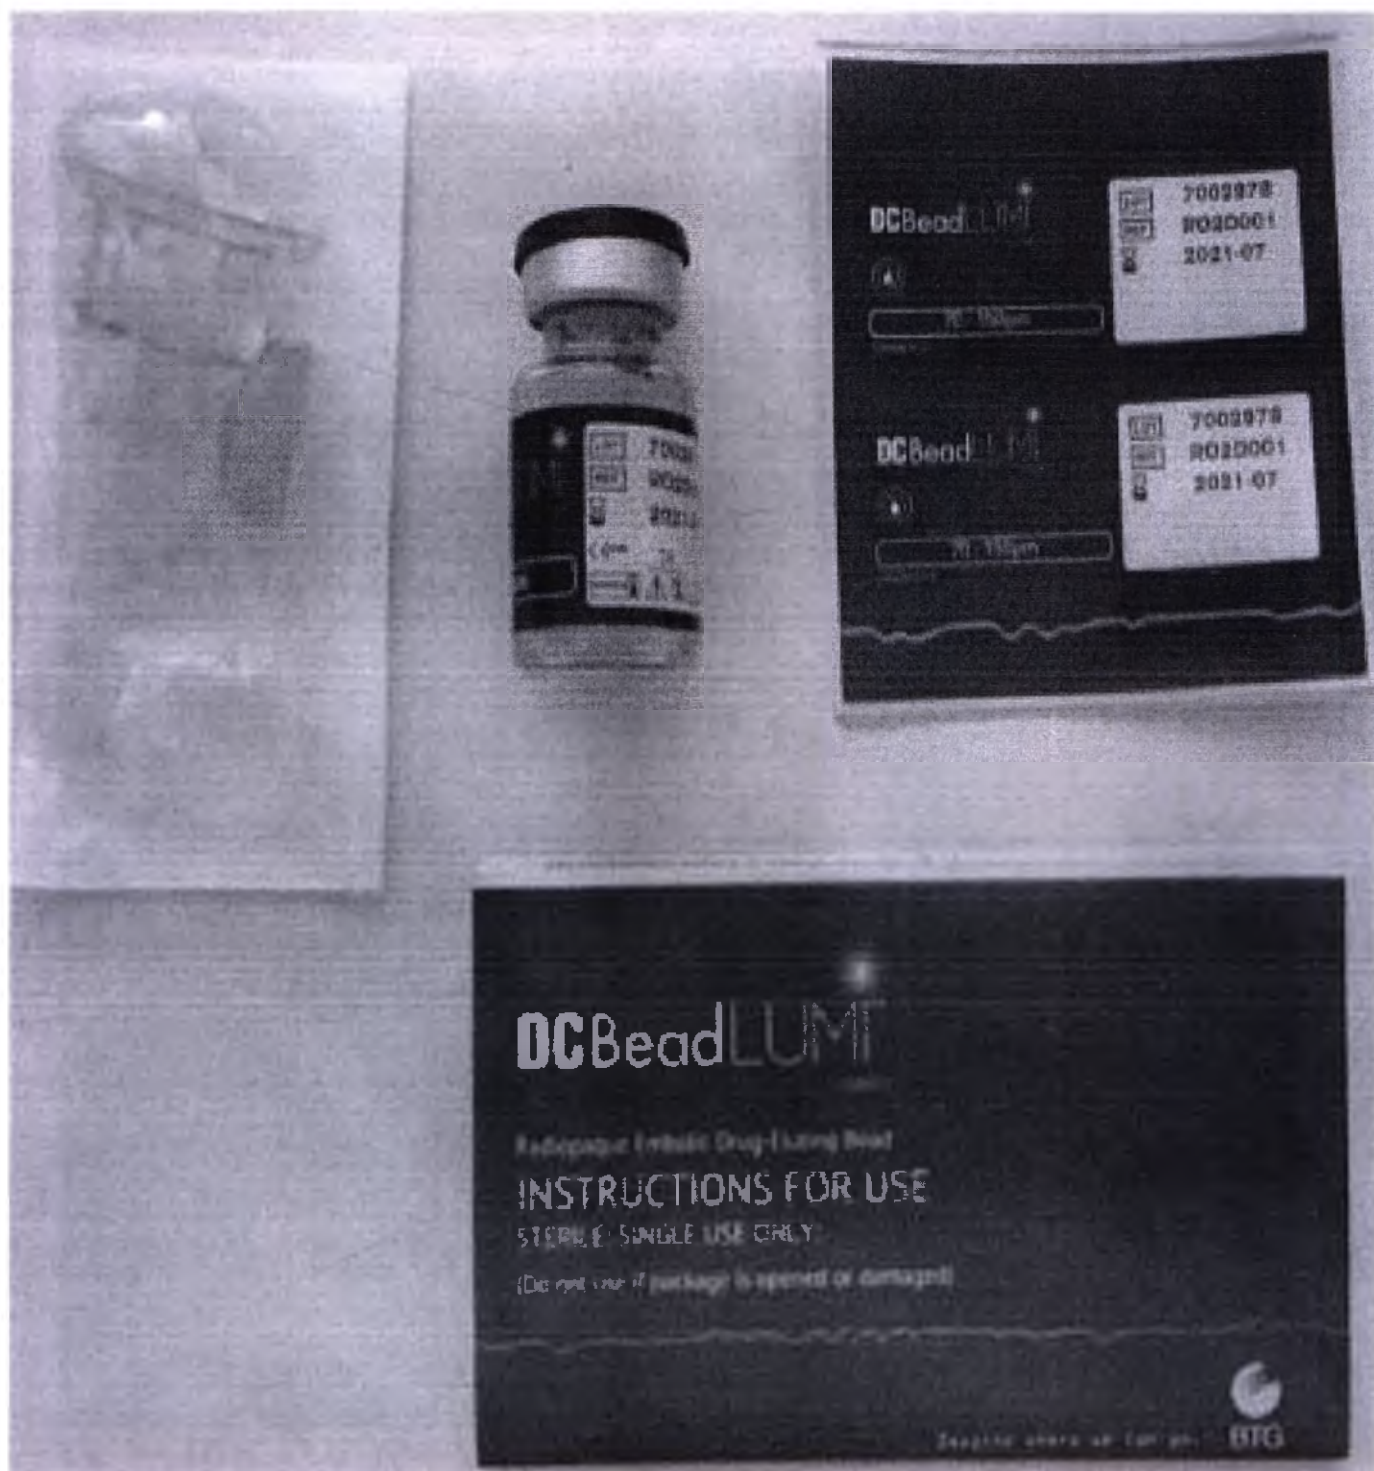


Рис.12 Общий вид содержимого упаковки медицинского изделия «Микросферы для эмболизации кровеносных сосудов Bead», вариант исполнения «Рентгеноконтрастные микросферы для эмболизации с лекарственным препаратом DC Bead LUMI, в физиологическом растворе, диаметр 70-150 мкм»

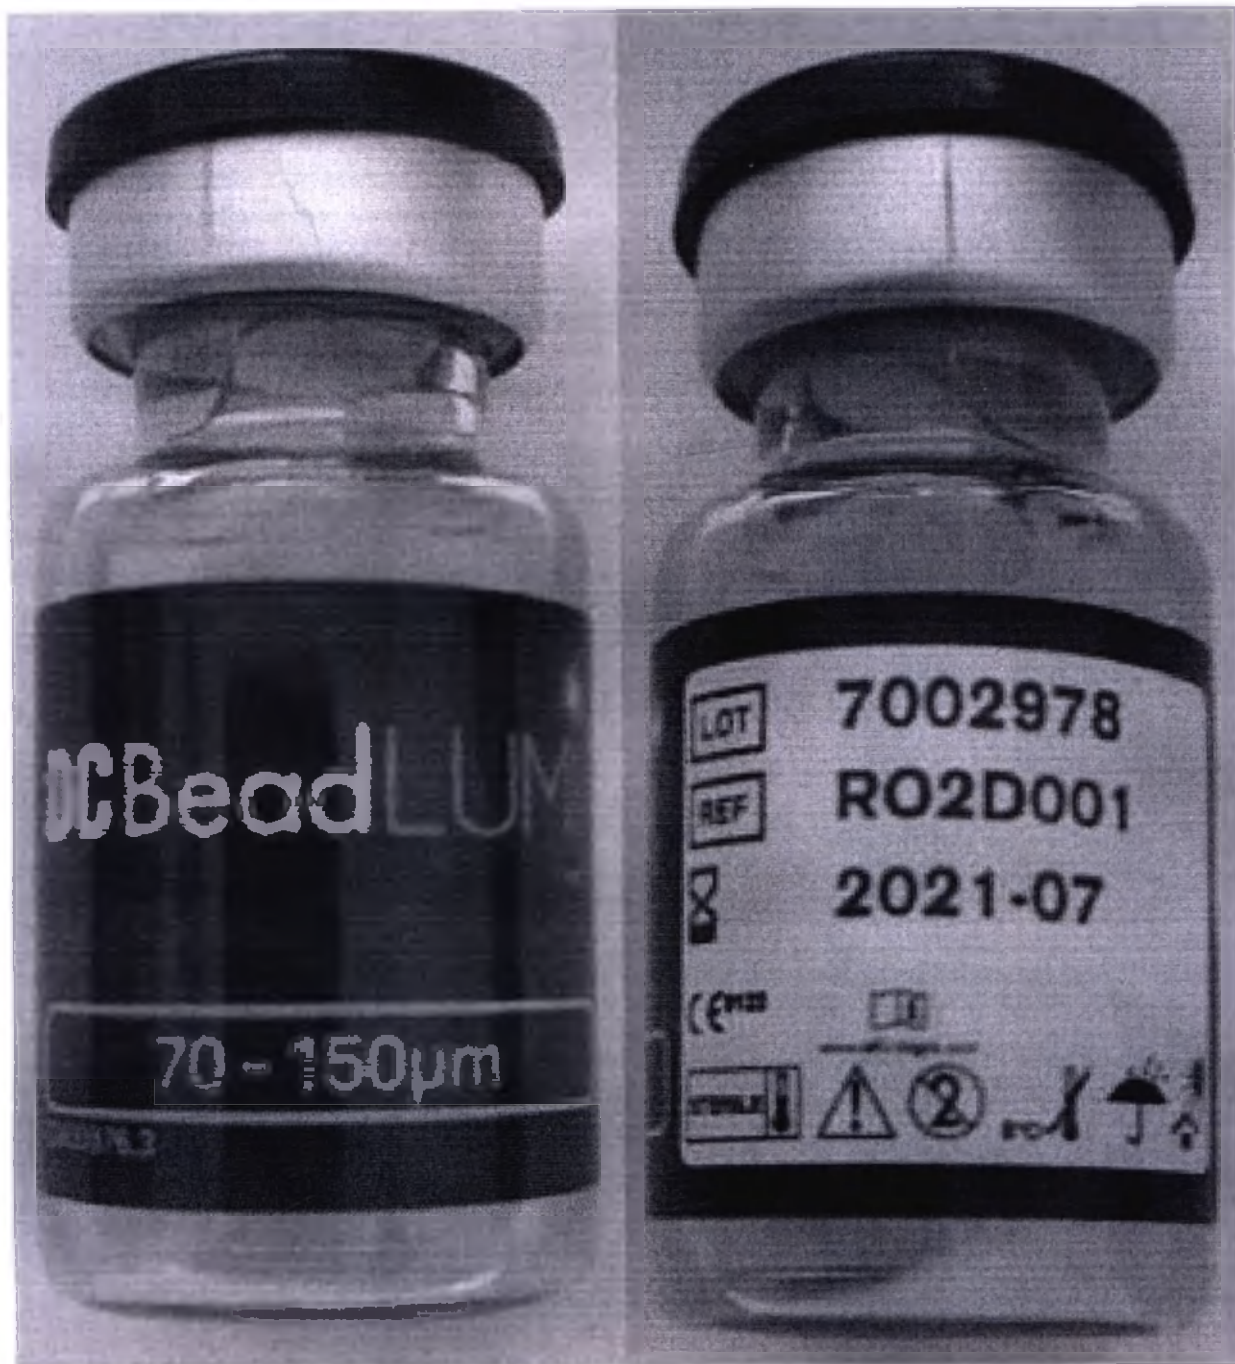


Рис.13 Общий вид первичной упаковки медицинского изделия «Микросферы для эмболизации кровеносных сосудов Bead», вариант исполнения «Рентгеноконтрастные микросферы для эмболизации с лекарственным препаратом DC Bead LUMI, в физиологическом растворе, диаметр 70-150 мкм

Микросферы для эмболизации кровеносных сосудов Bead
Микросферы для эмболизации с лекарственным препаратом DC Bead, в физиологическом растворе, 300-500 мкм

Регистрационное удостоверение:

От:

только для одноразового использования

стерильно

Апирогенно

Срок хранения указан на оригинальной упаковке

Нетоксично

Запрещается применять если упаковка вскрыта или повреждена

Уполномоченный представитель официального производителя на территории РФ «Бостон Сайентифик Корпорейшн»:

ООО «ЦПС», 123308, г. Москва, ул. Мневники, д. 3, корпус 1, комната эт. 3, пом. 1, ком. 17, Тел. +7 495 532 92 10

Пожалуйста, проинформируйте пациента о необходимости посетить веб-сайт www.bostonscientific.com/patientlabeling для получения инструкции по применению



Find ID: MO
92505282-01D

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт www.bostonscientific-elabeling.com, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe Reader, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.Adobe.com.

Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкции по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Примечание: эти инструкции по применению регулярно обновляются. Наиболее актуальная версия доступна на вышеуказанном веб-сайте.

Adobe® Reader® являются товарными знаками компании Adobe Systems Incorporated.

Рис. 14 Маркировка медицинского изделия на русском языке «Микросферы для эмболизации кровеносных сосудов Bead», вариант исполнения «Микросферы для эмболизации с лекарственным препаратом DC Bead, в физиологическом растворе, диаметр 300-500 мкм»

**Микросферы для эмболизации кровеносных сосудов Bead
Микросферы для эмболизации Bead Block, в физиологическом растворе
700-900 мкм**

Регистрационное удостоверение:

От:

только для однократного использования

стерильно

Апирогенно

Срок хранения указан на оригинальной упаковке

Нетоксично

Запрещается применять если упаковка вскрыта или повреждена

Уполномоченный представитель официального производителя на территории РФ «Бостон Сайентифик Корпорейшн»:

ООО «ЦПС», 123308, г. Москва, ул. Минёвники, д. 3, корпус 1, комната эт. 3, пом. 1, ком. 17, Тел. +7 495 532 92 10

Пожалуйста, проинформируйте пациента о необходимости посетить веб-сайт www.bostonscientific.com/patientlabeling для получения инструкции по применению



File ID: WO
92505282-01D

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт www.bostonscientific-labeling.com, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe Reader, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.Adobe.com.

Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкции по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Примечание: эти инструкции по применению регулярно обновляются. Наиболее актуальная версия доступна на вышеуказанном веб-сайте.

Adobe® Reader® являются товарными знаками компании Adobe Systems Incorporated.

Рис.15 Маркировка медицинского изделия на русском языке «Микросферы для эмболизации кровеносных сосудов Bead», вариант исполнения «Микросферы для эмболизации Bead Block, в физиологическом растворе, диаметр 700- 900 мкм»

**Микросферы для эмболизации кровеносных сосудов Bead
Рентгеноконтрастные микросферы для эмболизации с лекарственным препаратом DC Bead
LUMI, в физиологическом растворе
70 – 150 мкм**

Регистрационное удостоверение:

От:

только для одноразового использования
стерильно

Апирогенно

Срок хранения указан на оригинальной упаковке

Нетоксично

Запрещается применять если упаковка вскрыта или повреждена

Уполномоченный представитель официального производителя на территории РФ «Бостон
Сайентифик Корпорейшн»:

ООО «ЦПС», 123308, г. Москва, ул. Мнёвники, д. 3, корпус 1, эт. 3, пом. 1, ком. 17
Тел. +7 495 532 92 10

Пожалуйста, проинформируйте пациента о необходимости посетить веб-сайт
www.bostonscientific.com/patientlabeling для получения инструкции по применению



Field ID: WO
92505282-01D

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет. Посетите веб-сайт www.bostonscientific-elabeling.com, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe Reader, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.Adobe.com.

Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкции по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Примечание: эти инструкции по применению регулярно обновляются. Наиболее актуальная версия доступна на вышеуказанном веб-сайте.

Adobe® Reader® являются товарными знаками компании Adobe Systems Incorporated.

Рис. 16 Маркировка медицинского изделия на русском языке «Микросферы для эмболизации кровеносных сосудов Bead», вариант исполнения «Рентгеноконтрастные микросферы для эмболизации с лекарственным препаратом DC Bead LUMI, в физиологическом растворе, диаметр 70-150 мкм»

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 14
_____ листах

