

Руководитель группы

ООО «Сименс Здравоохранение»

И.И. Левитский

«28» августа 2023 г.



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

«Система магнитно – резонансной томографии MAGNETOM Free.Max с принадлежностями»




Общий вид - «Система магнитно-резонансной томографии MAGNETOM Free.Max с принадлежностями»


БАЗОВЫЙ БЛОК



Электромагнит сверхпроводящий с активным экранированием и встроенными катушками шиммирования

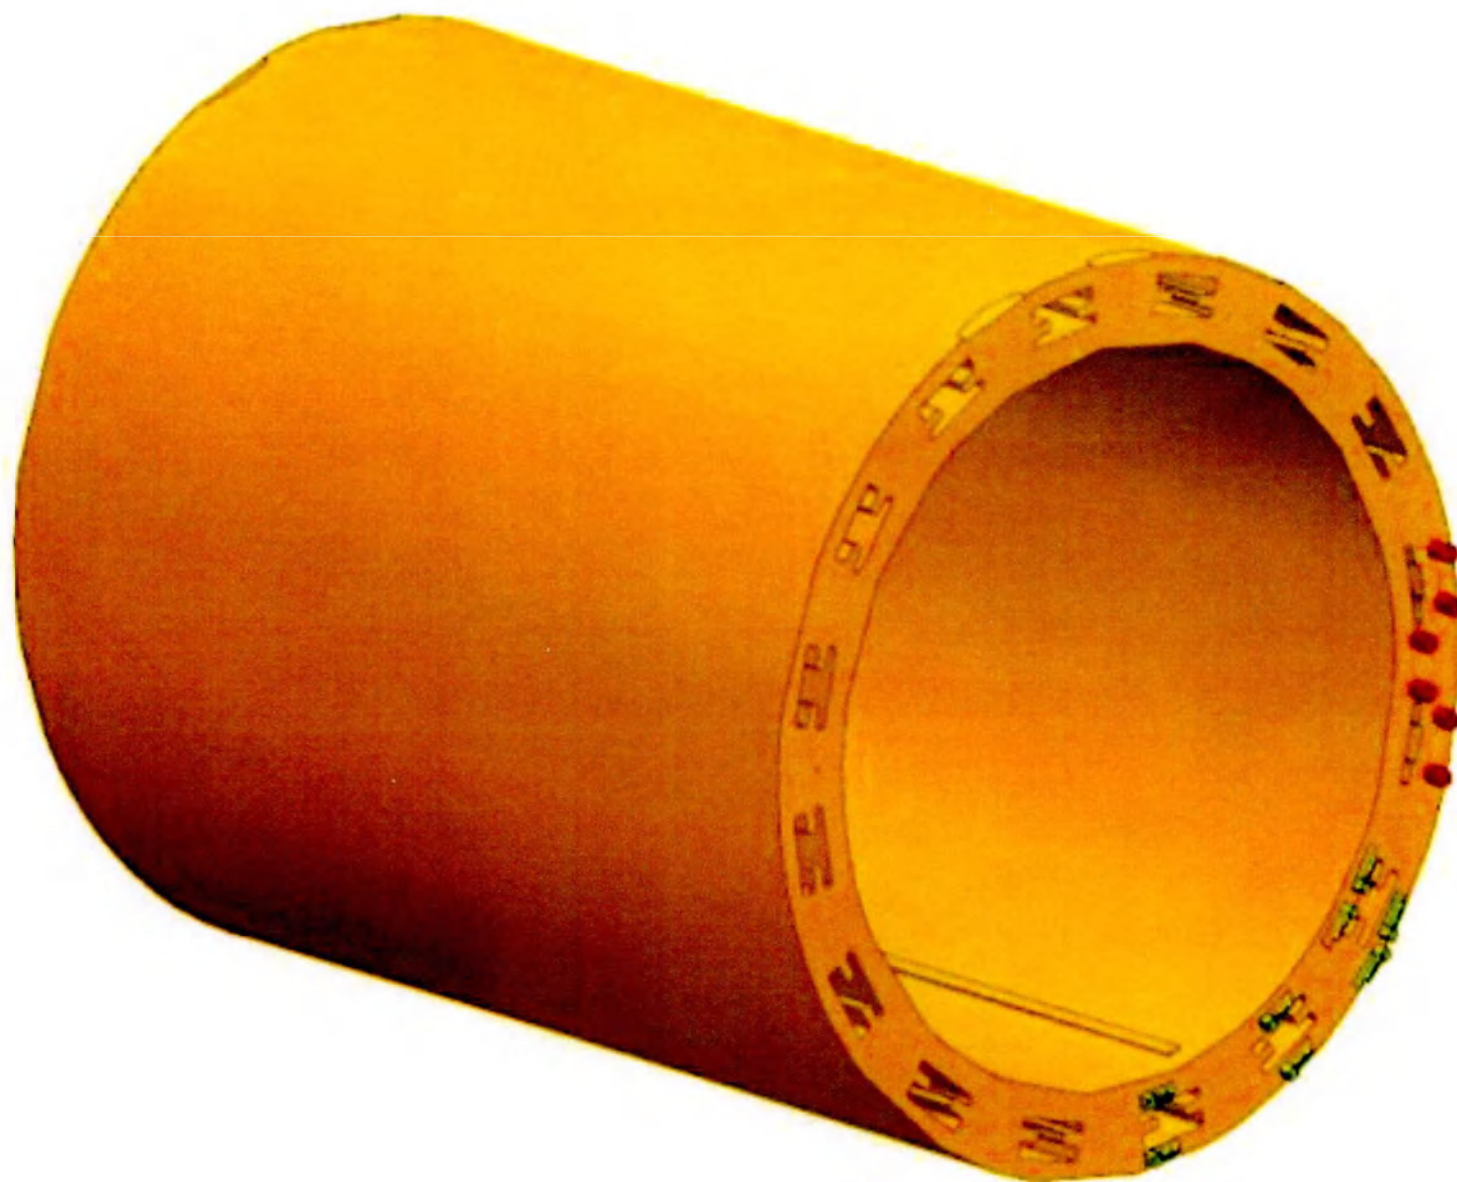


Система градиентная в составе: катушки градиентные, усилитель градиентный

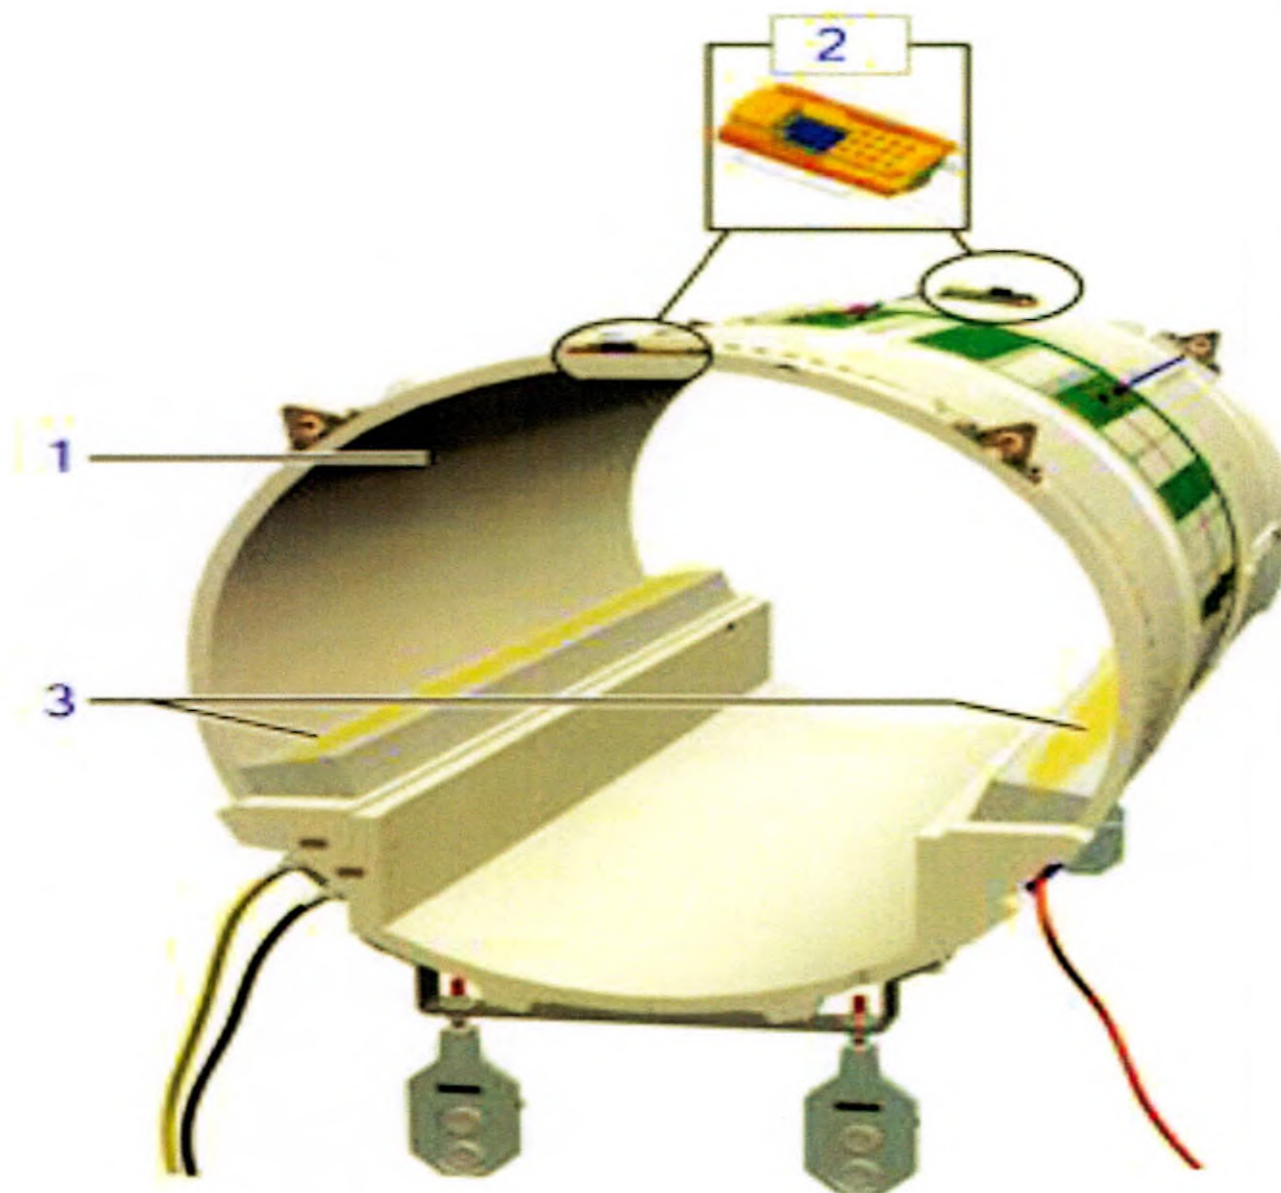

Катушка для тела, интегрированная в магнит



Кожух магнита

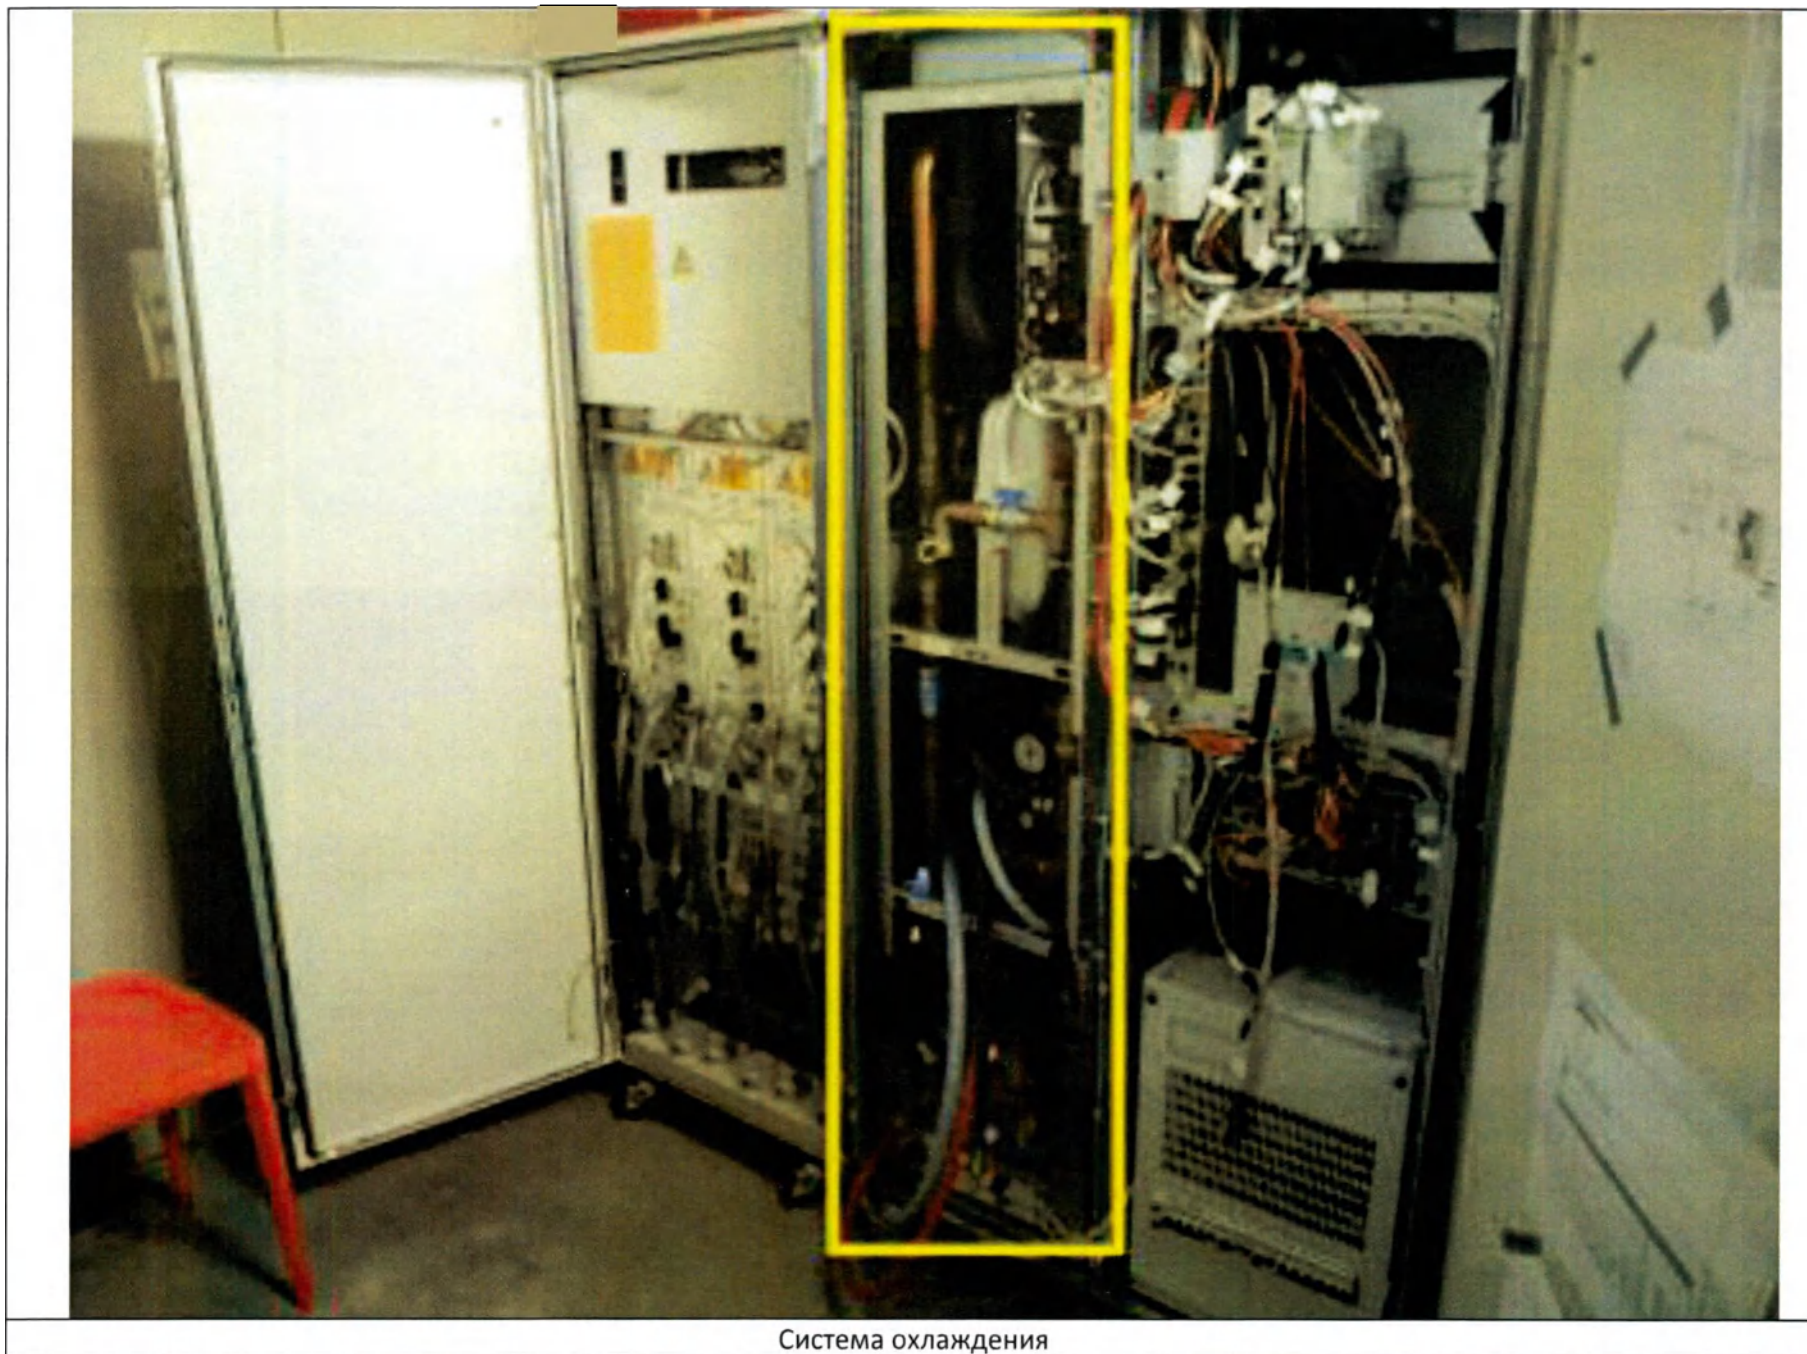


Система охлаждения




Стол пациента стандартный




Стол пациента с вертикальным приводом

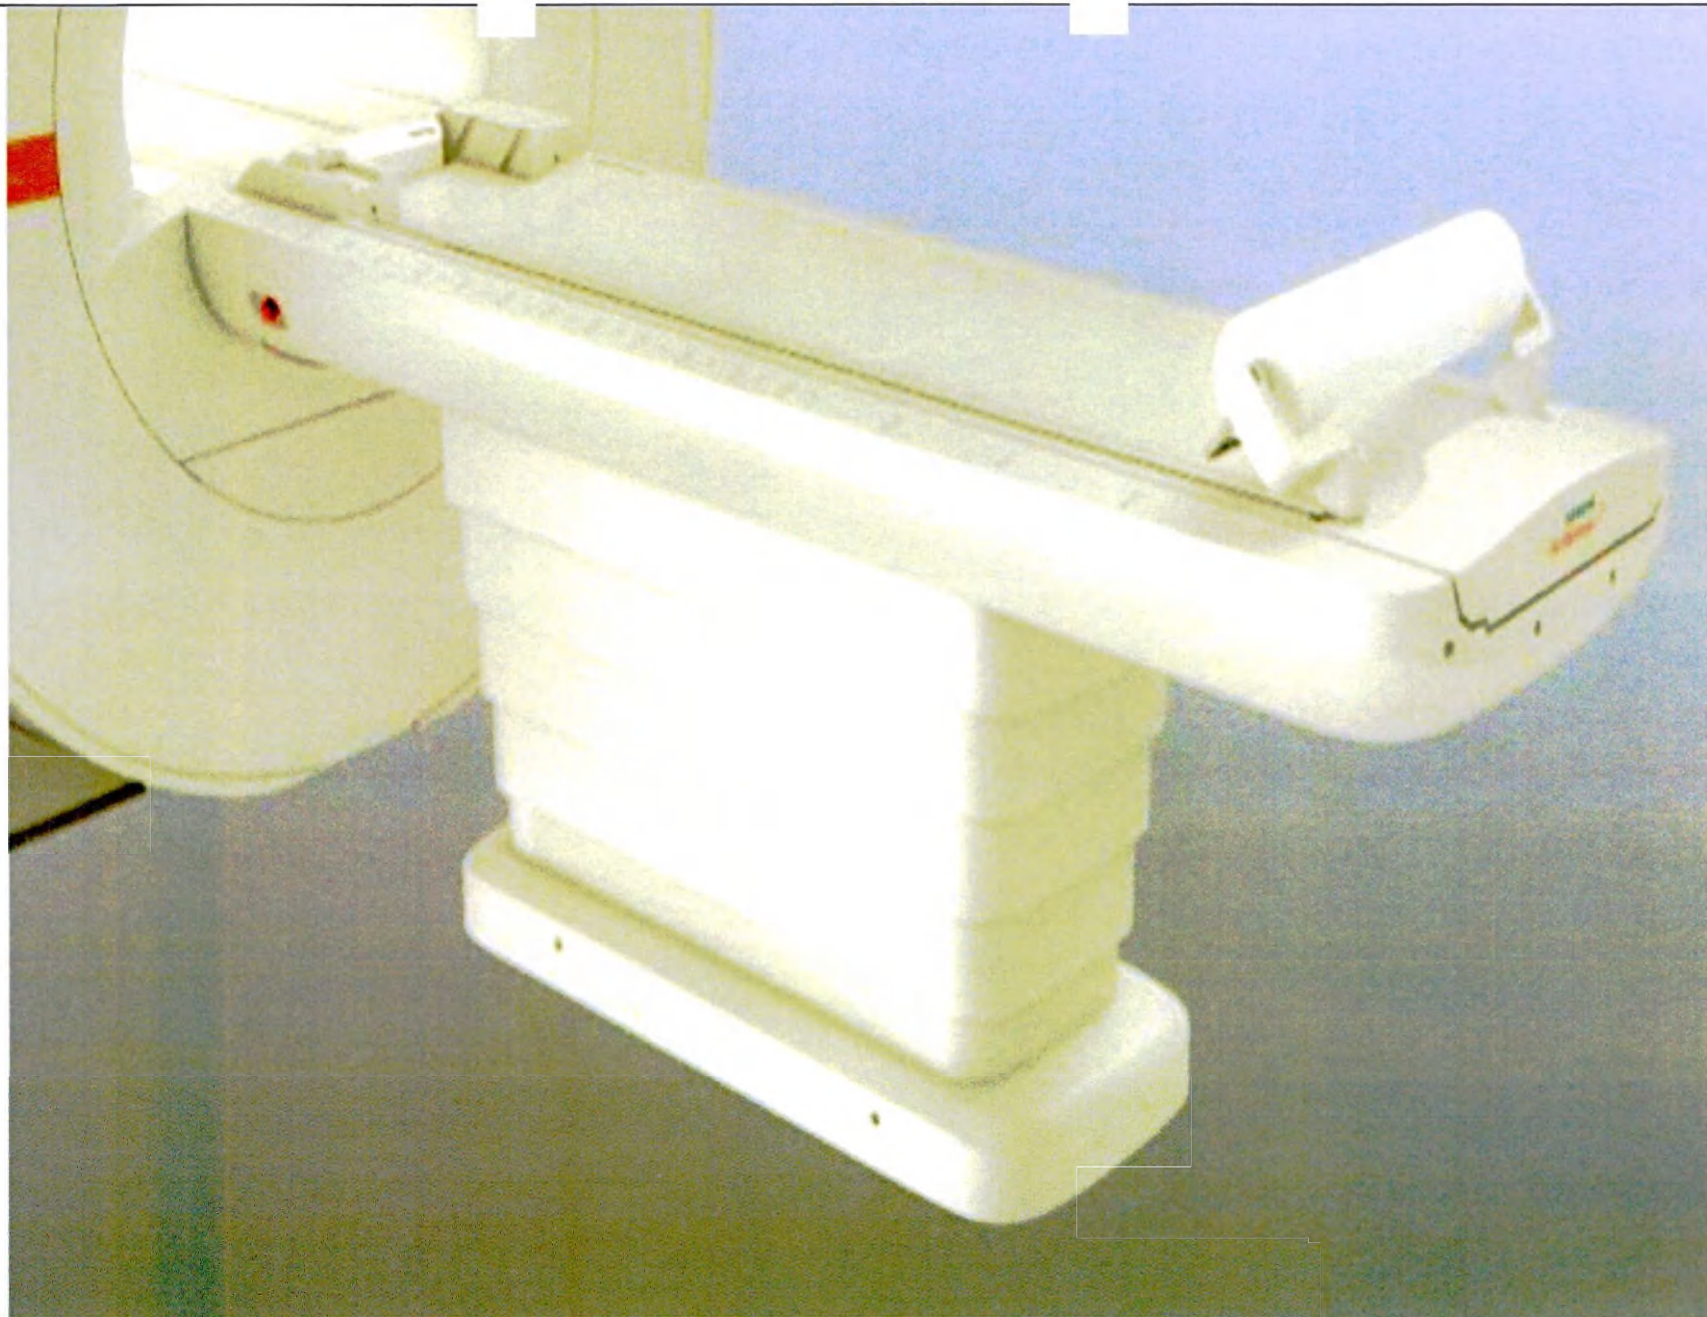

Стол пациента с высокой нагрузкой

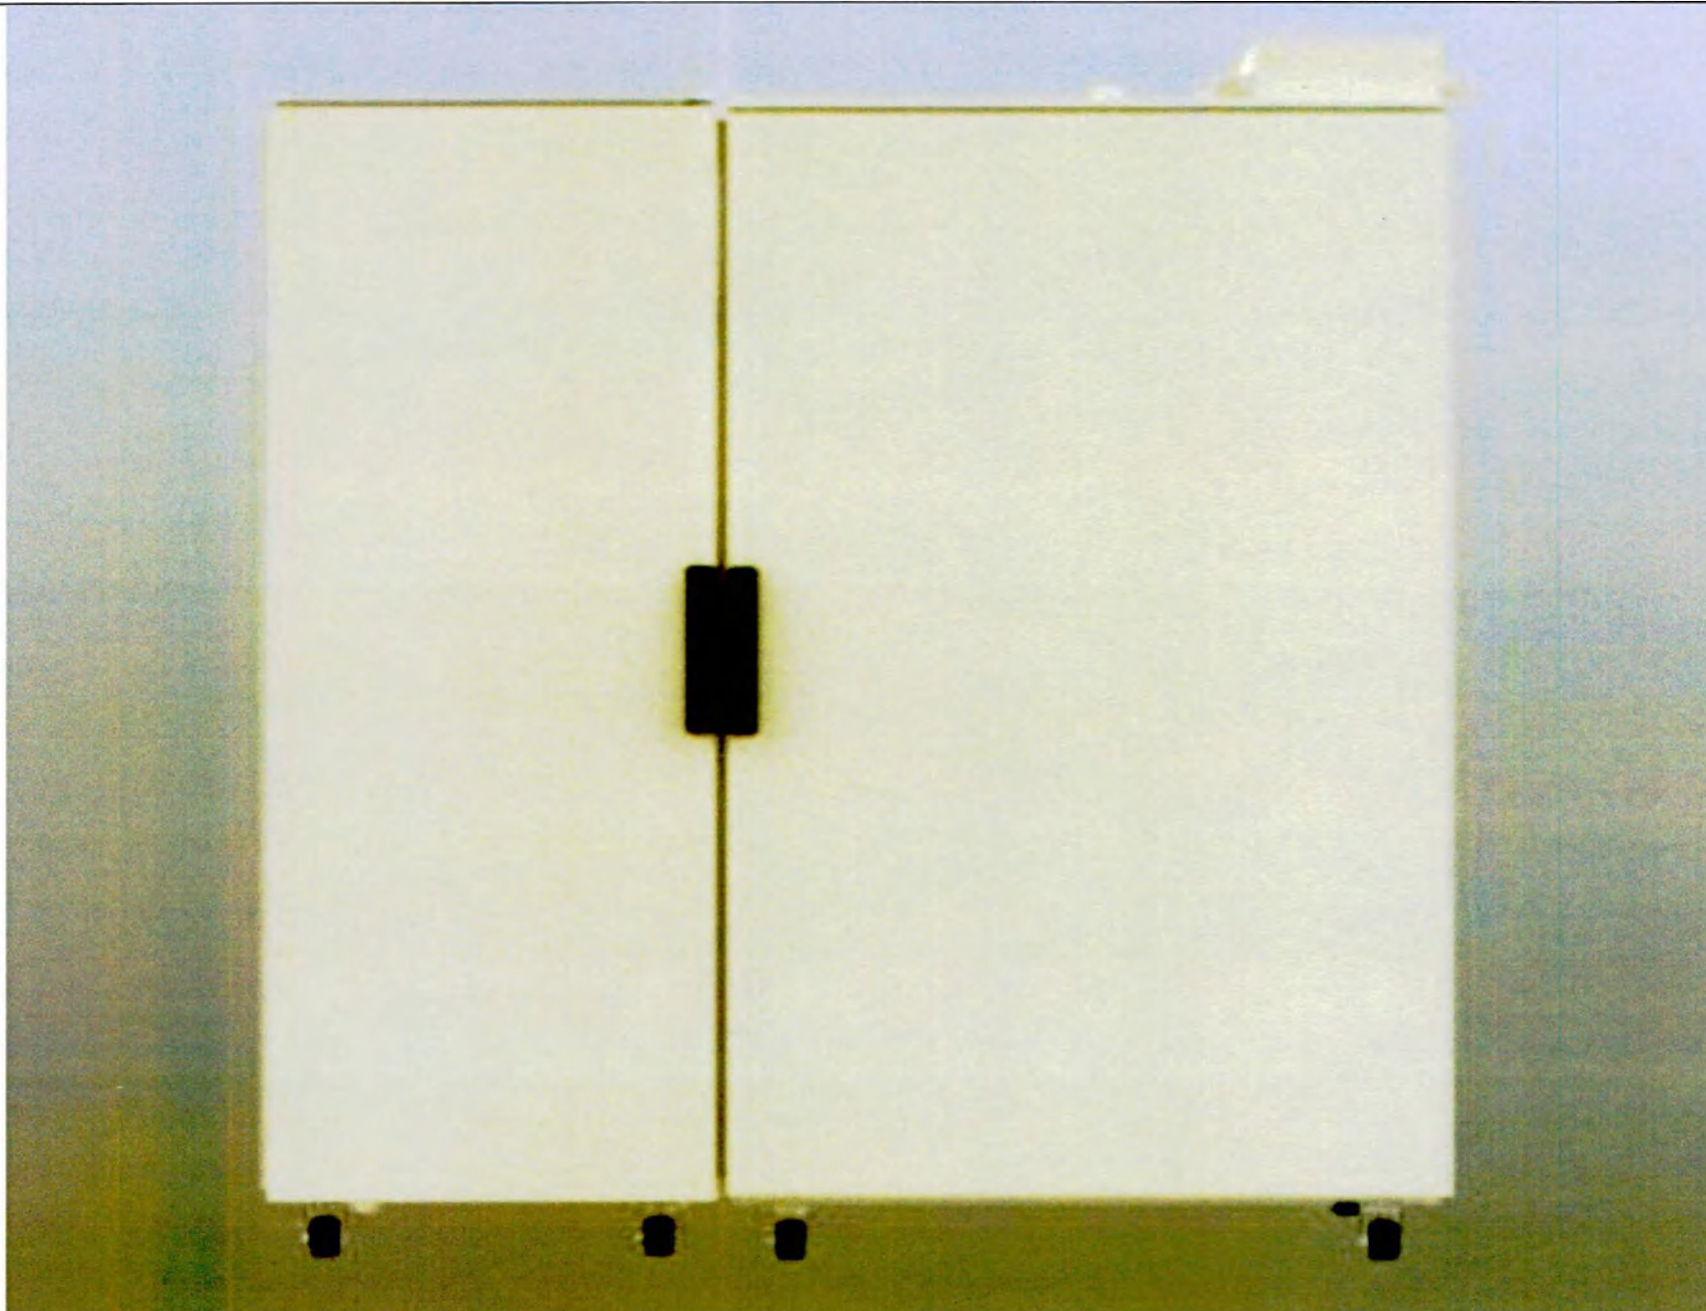


Шкафы с электронной аппаратурой для управления системами сбора данных томографа: шкаф градиентов

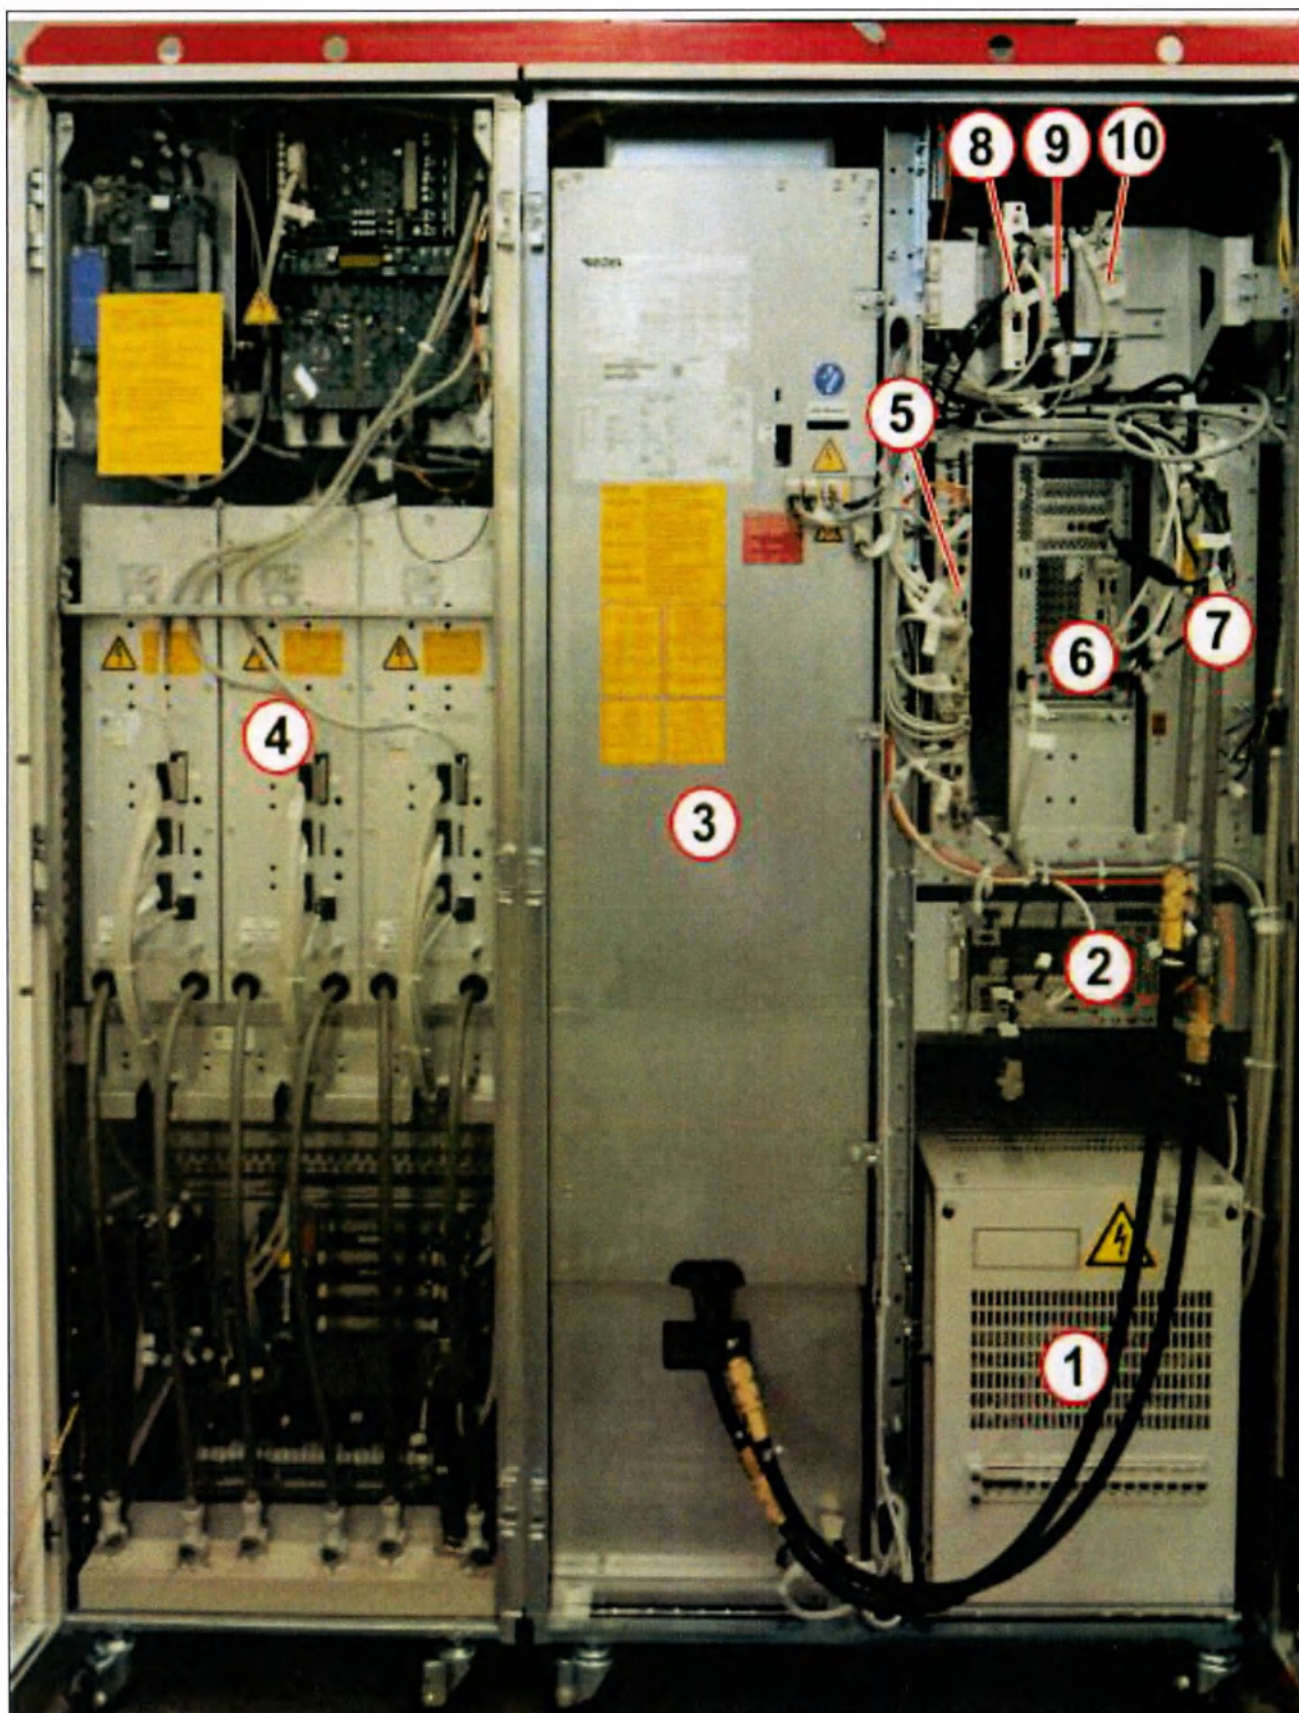

Шкафы с электронной аппаратурой для управления системами сбора данных томографа: шкаф управления



Пульт аварийного выключения системы

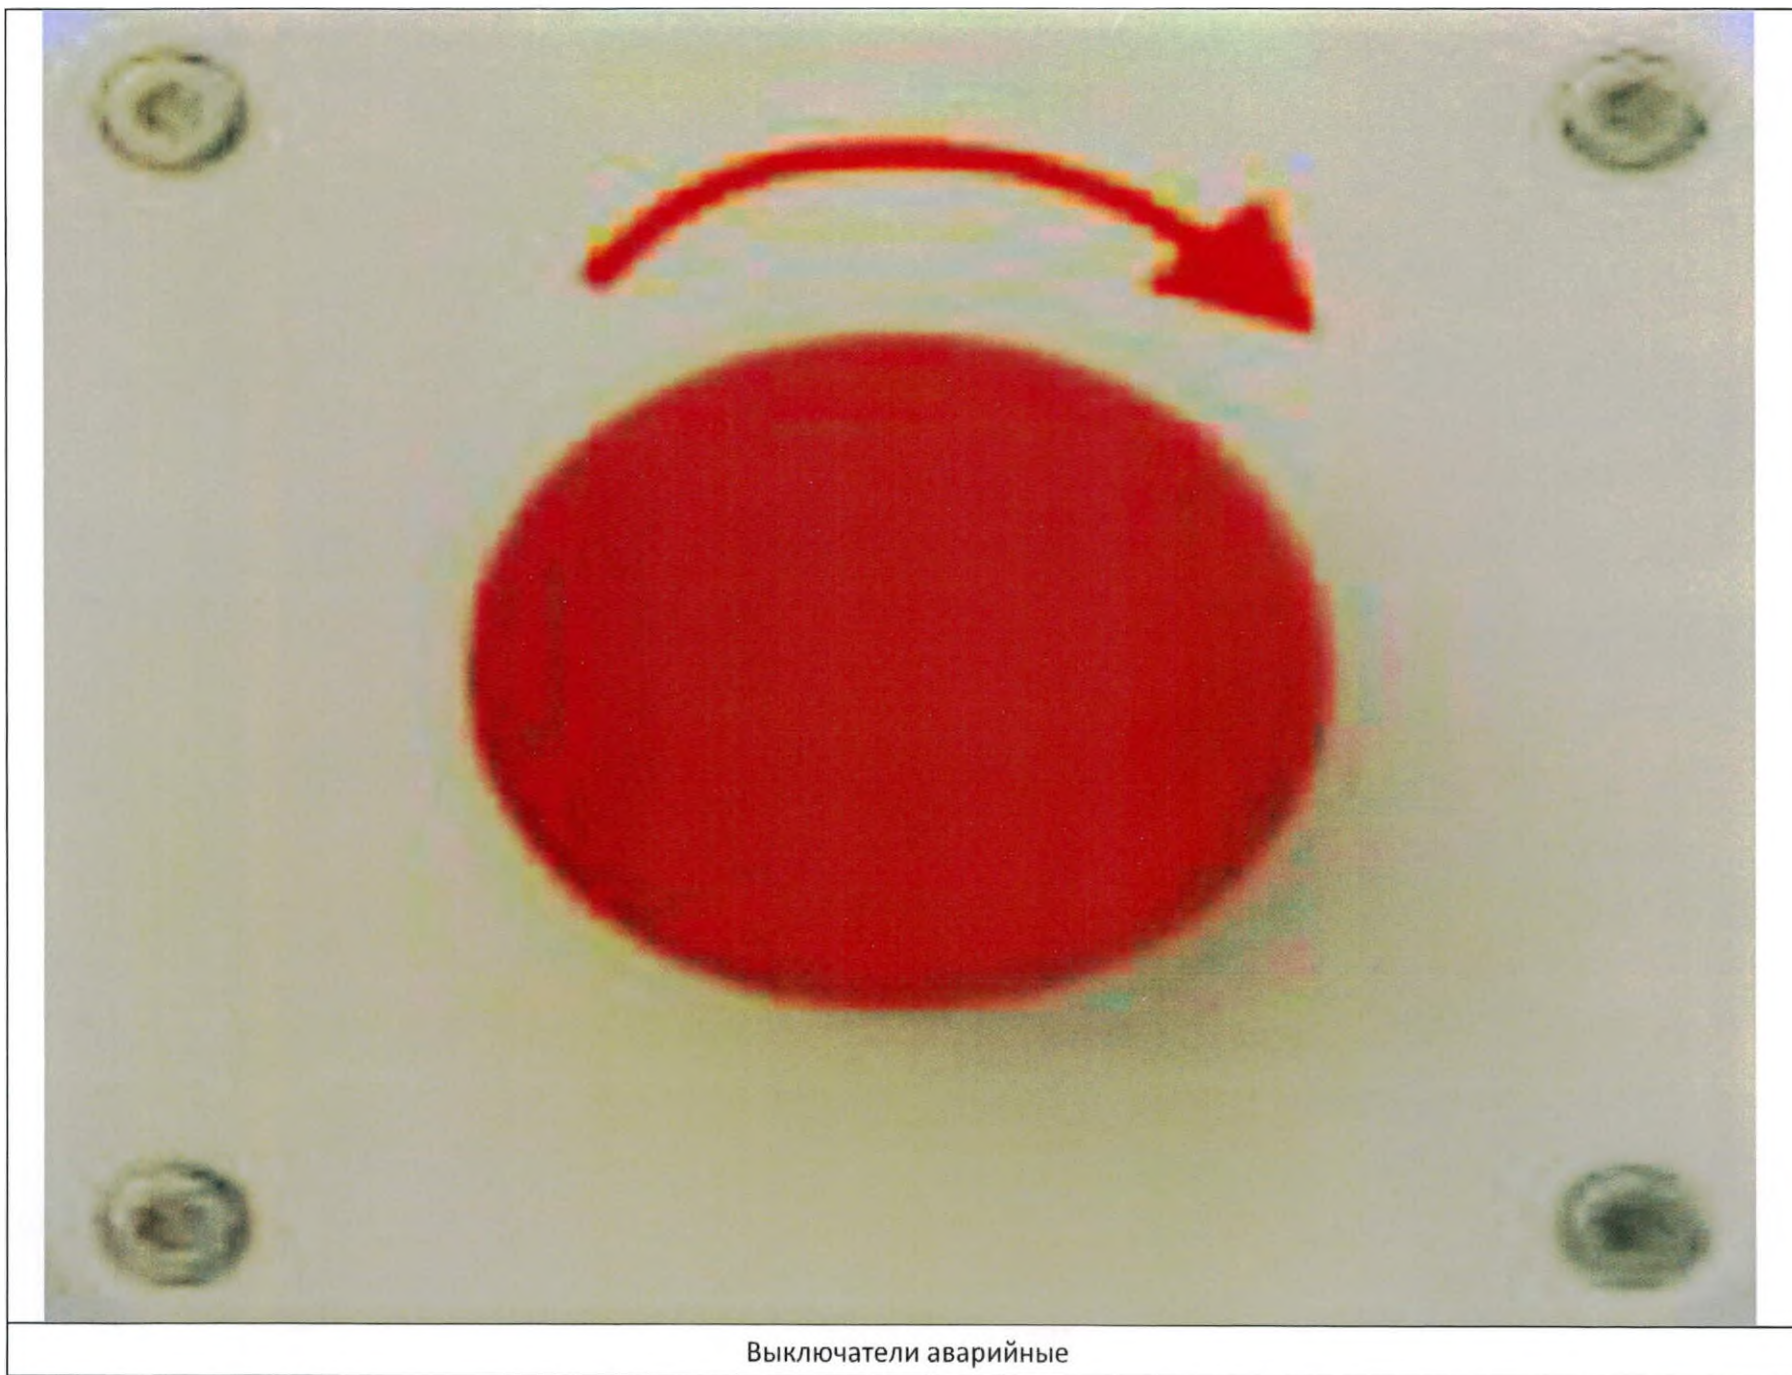

Выключатели аварийные



Выключатели аварийные




Рабочее место оператора и врача, в составе: монитор специализированный или монитор сенсорный специализированный или монитор сенсорный специализированный с кронштейном; переговорное устройство; USB – порт; мышь компьютерная



Рабочее место оператора и врача, в составе: монитор специализированный



Рабочее место оператора и врача, в составе: монитор сенсорный специализированный

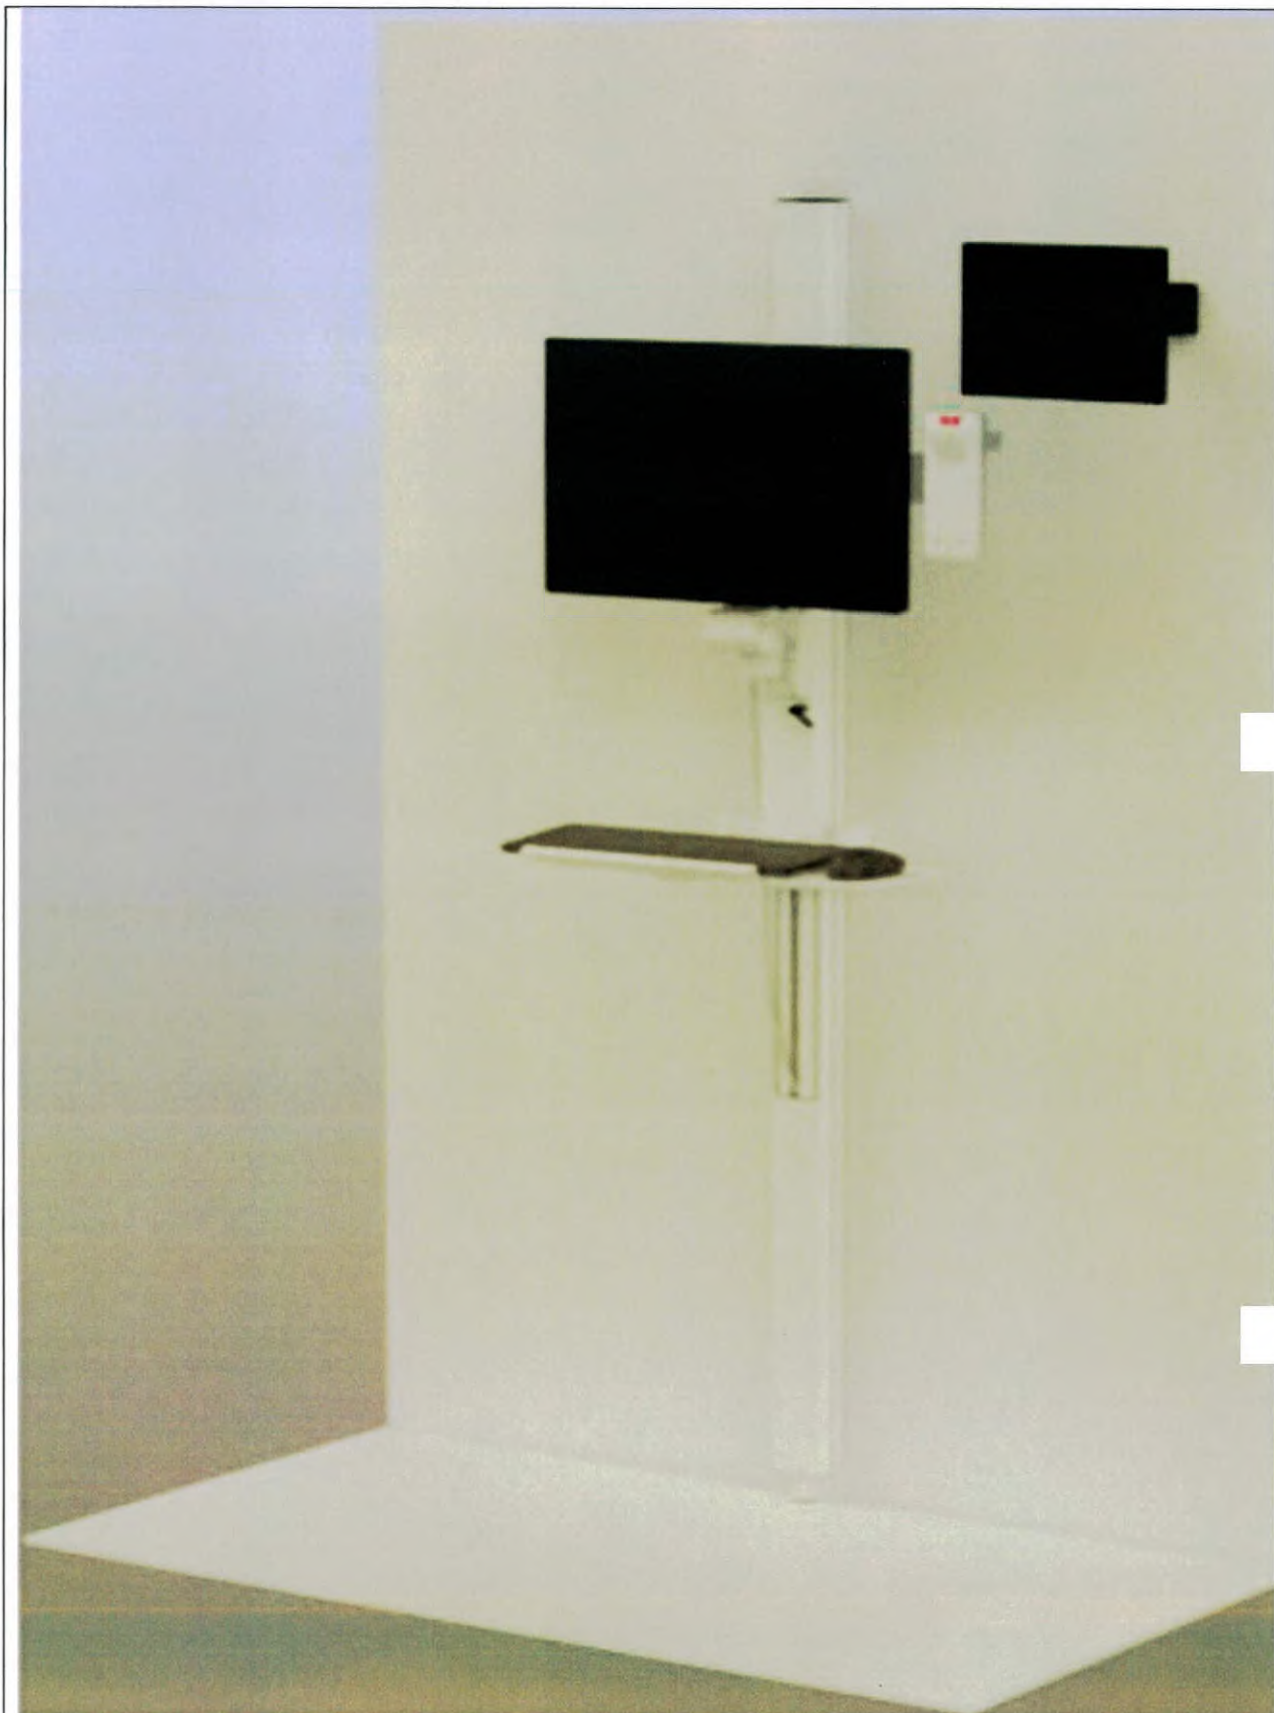

Рабочее место оператора и врача, в составе: монитор сенсорный специализированный с кронштейном



Рабочее место оператора и врача, в составе: мышь компьютерная




Рабочее место оператора и врача, в составе: переговорное устройство



Клавиатура специализированная




Катушка для головы и/или шеи Head/Neck

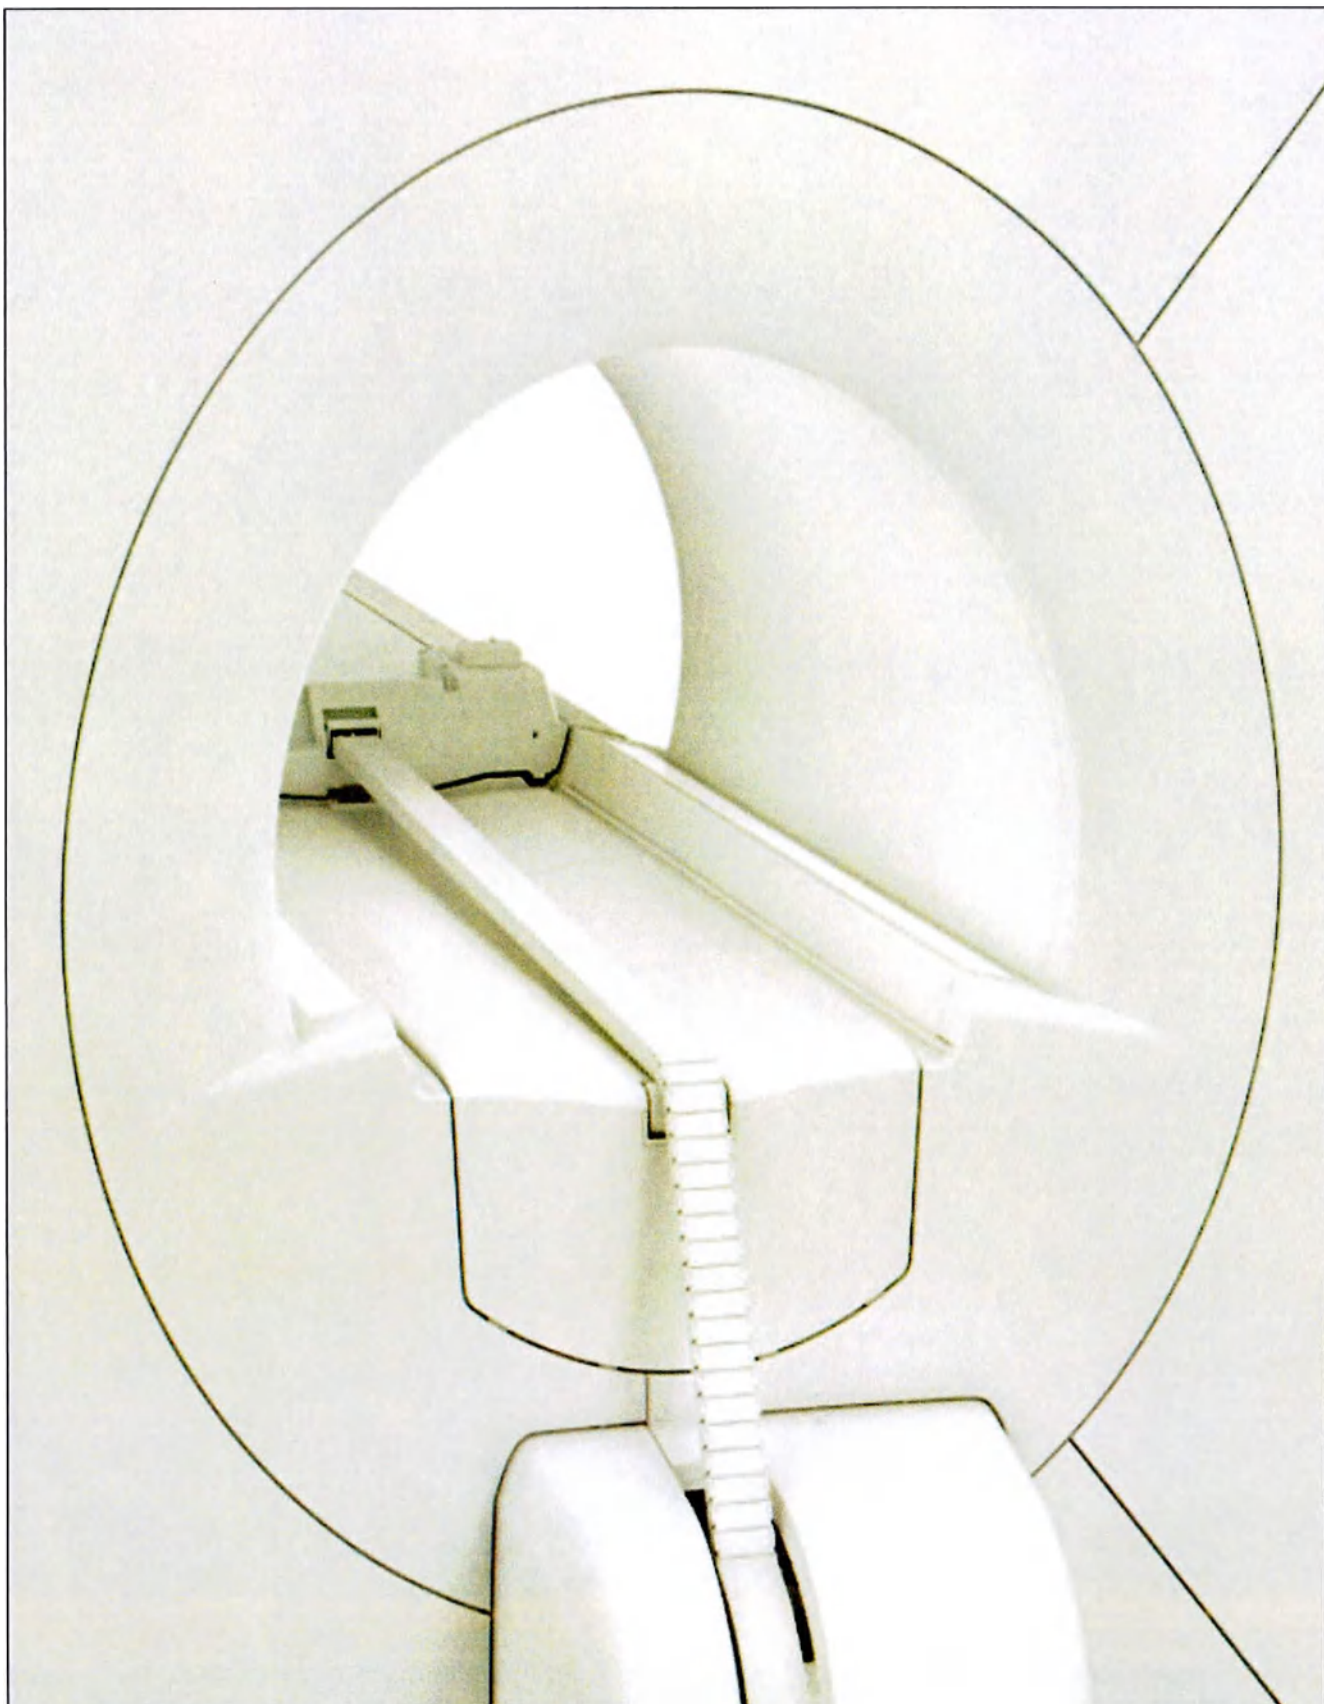

Катушка для отделов позвоночника Spine




Катушка гибкая многофункциональная Contour M или BioMatrix Contour L

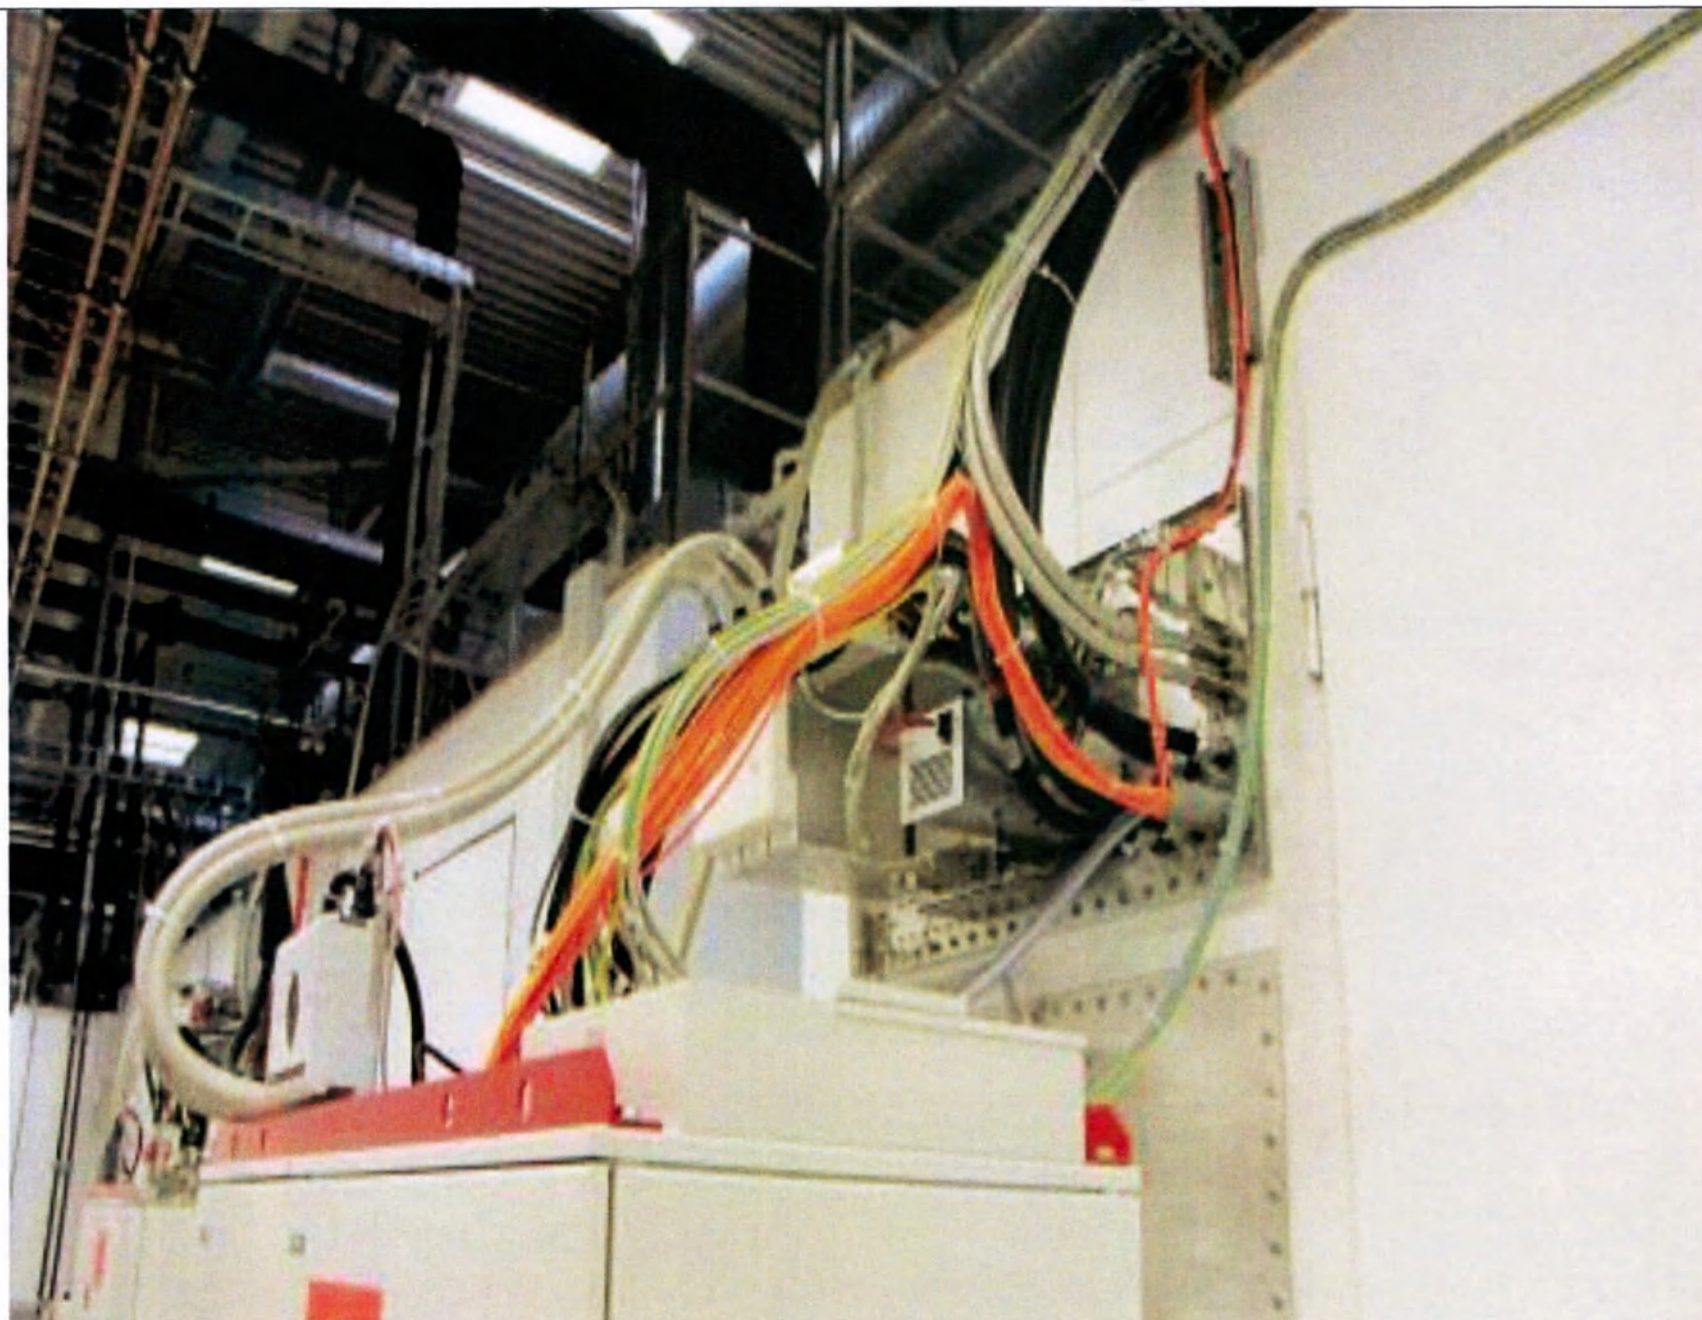


Кабельные соединения системы стационарные




Фантомы

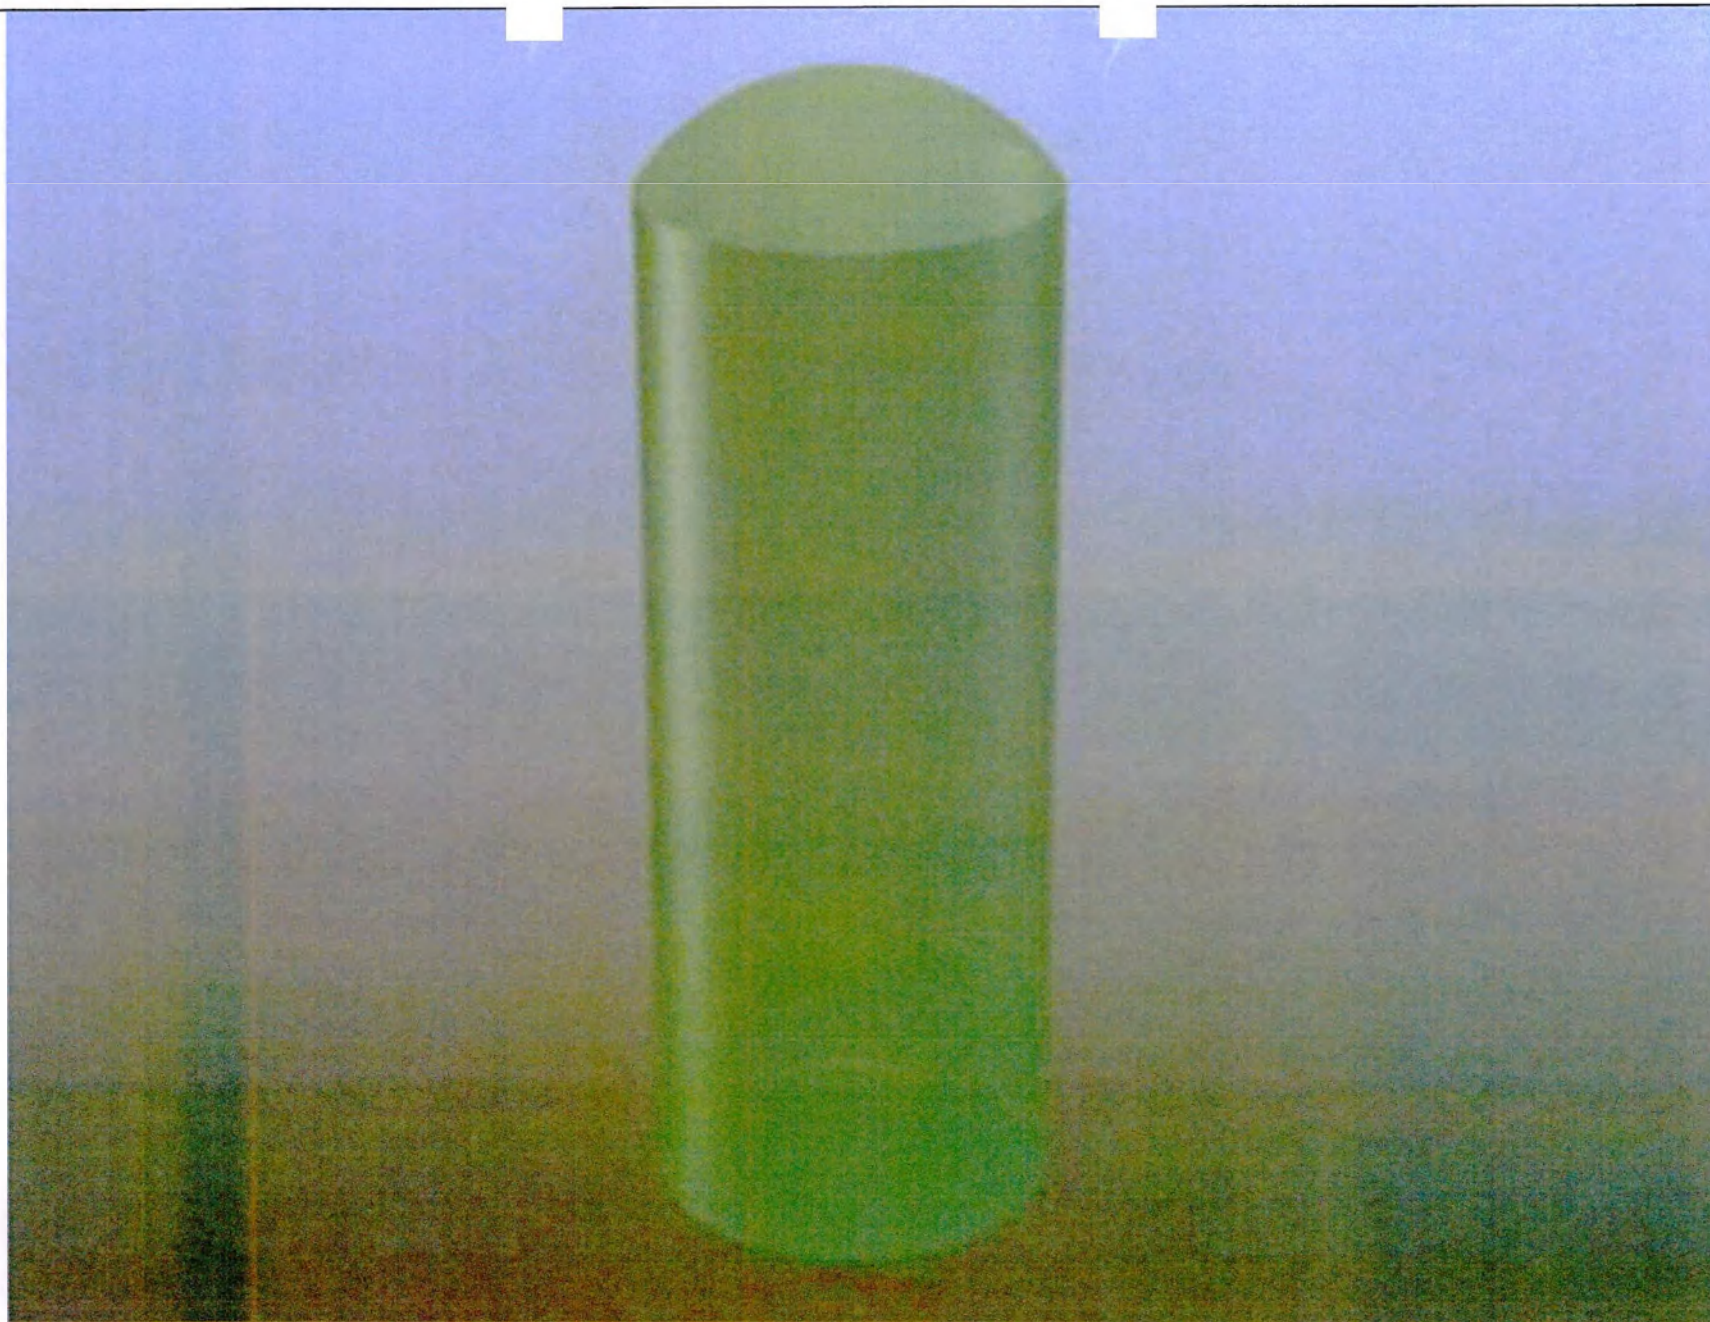


Фантомы

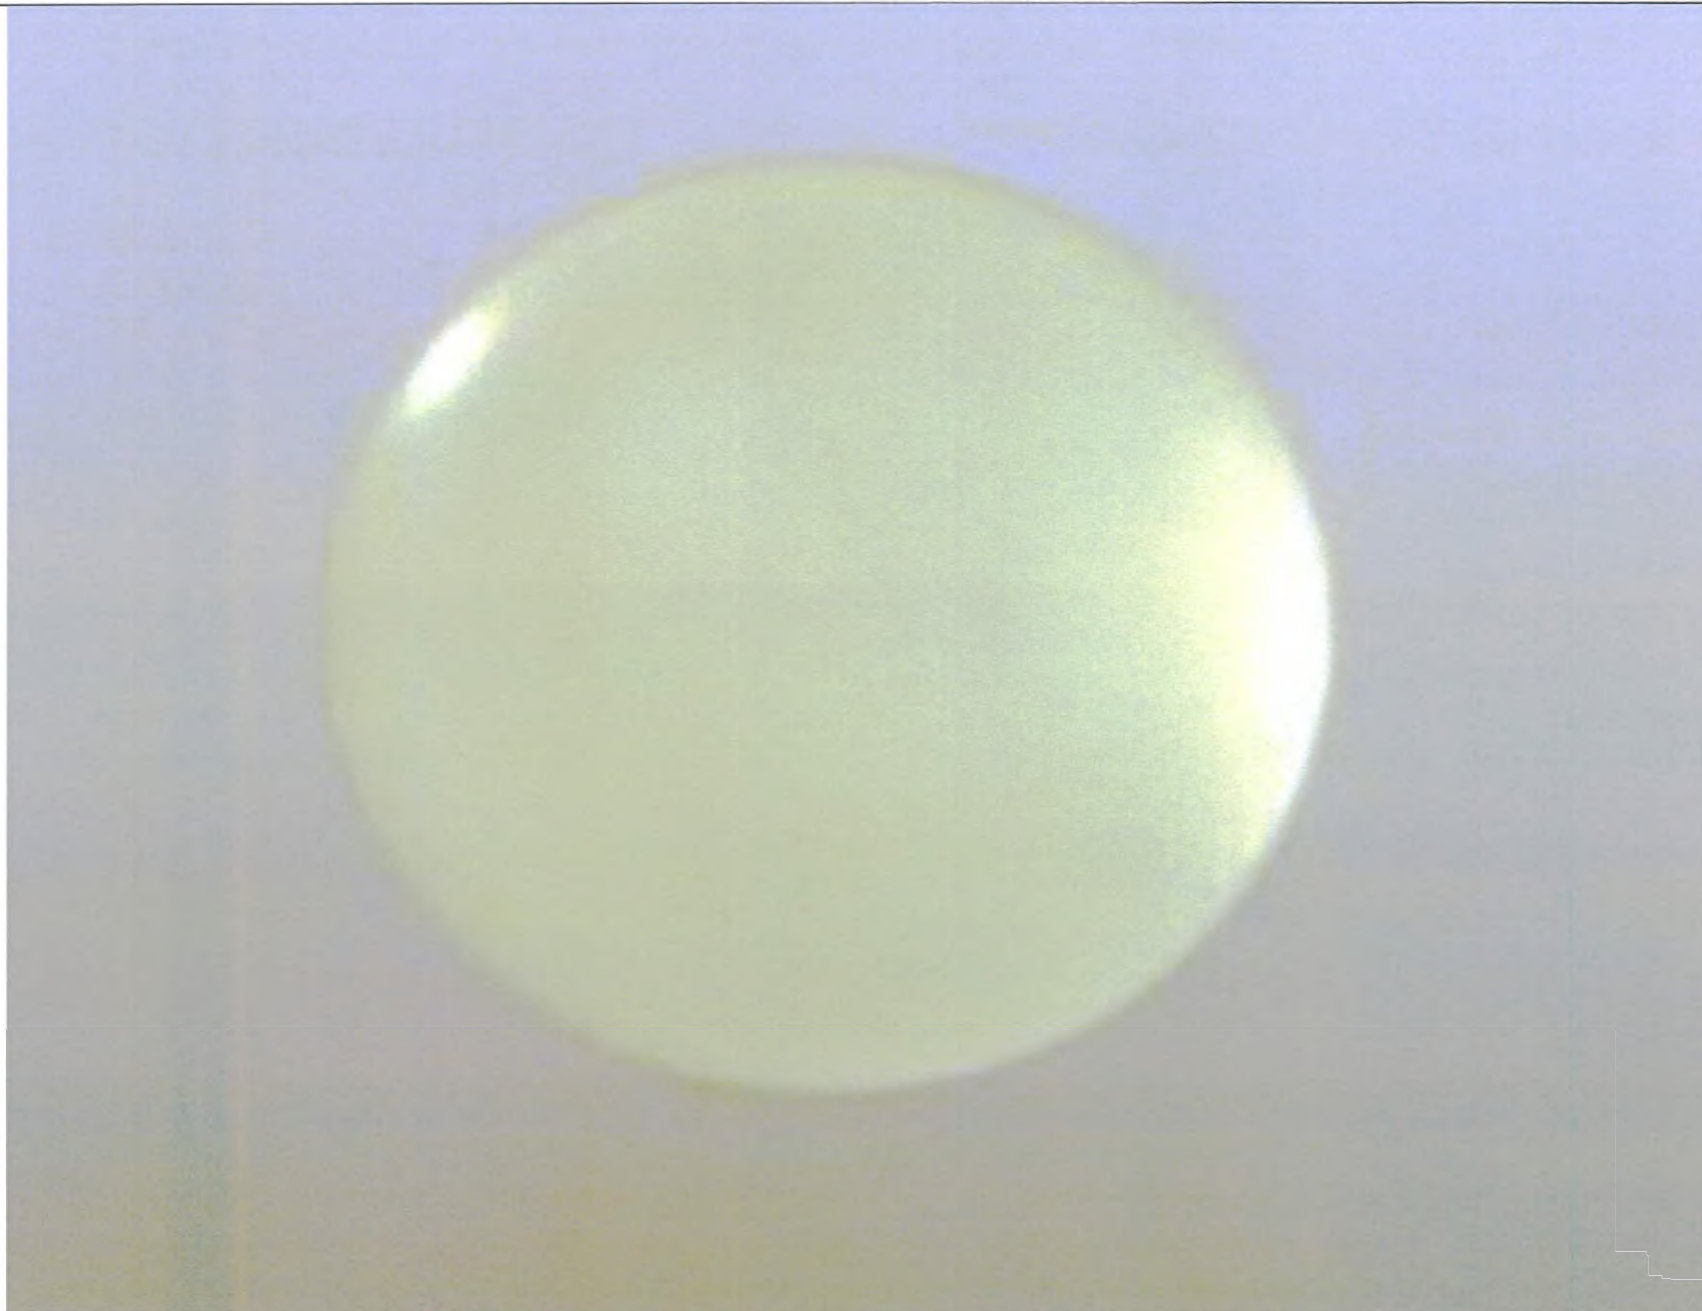


Фантомы

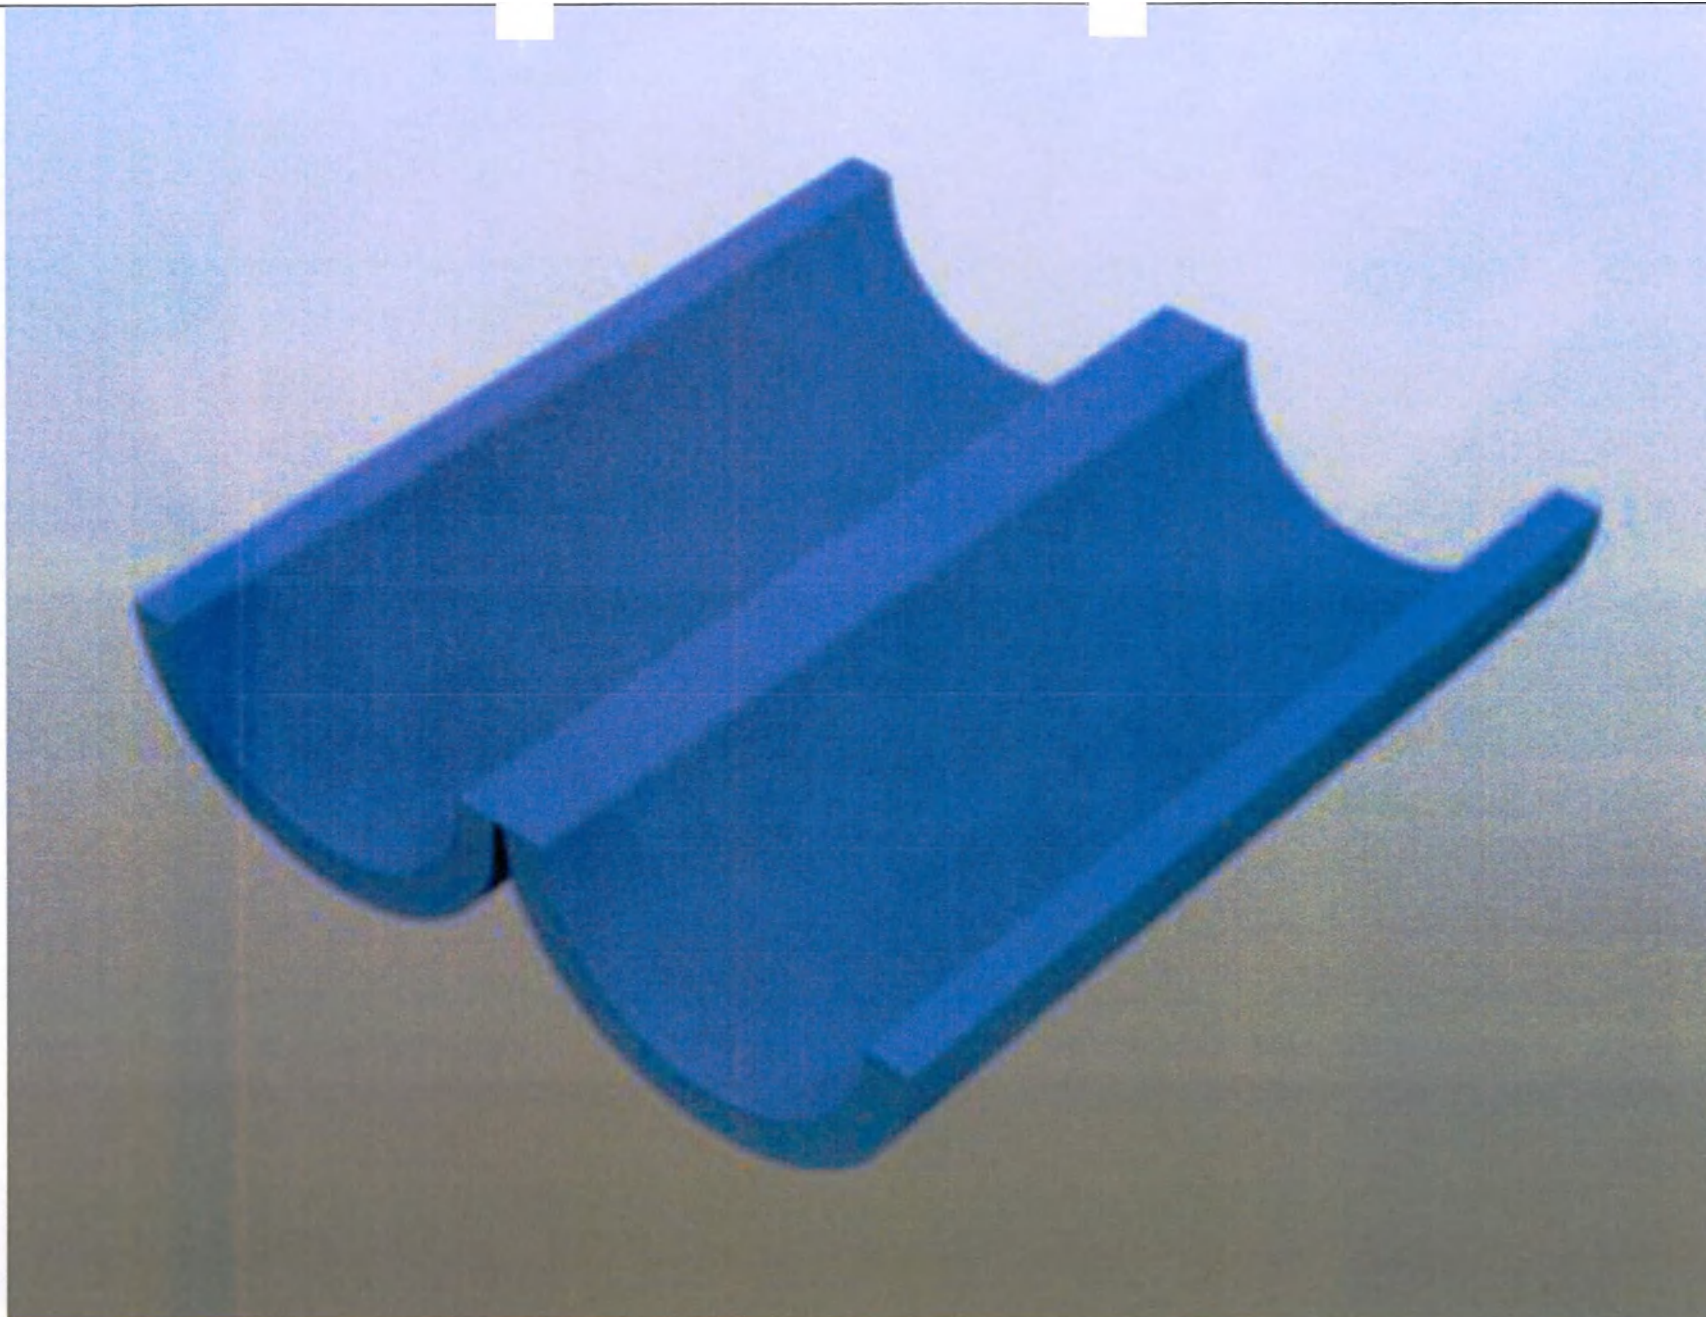


Держатели фантомов

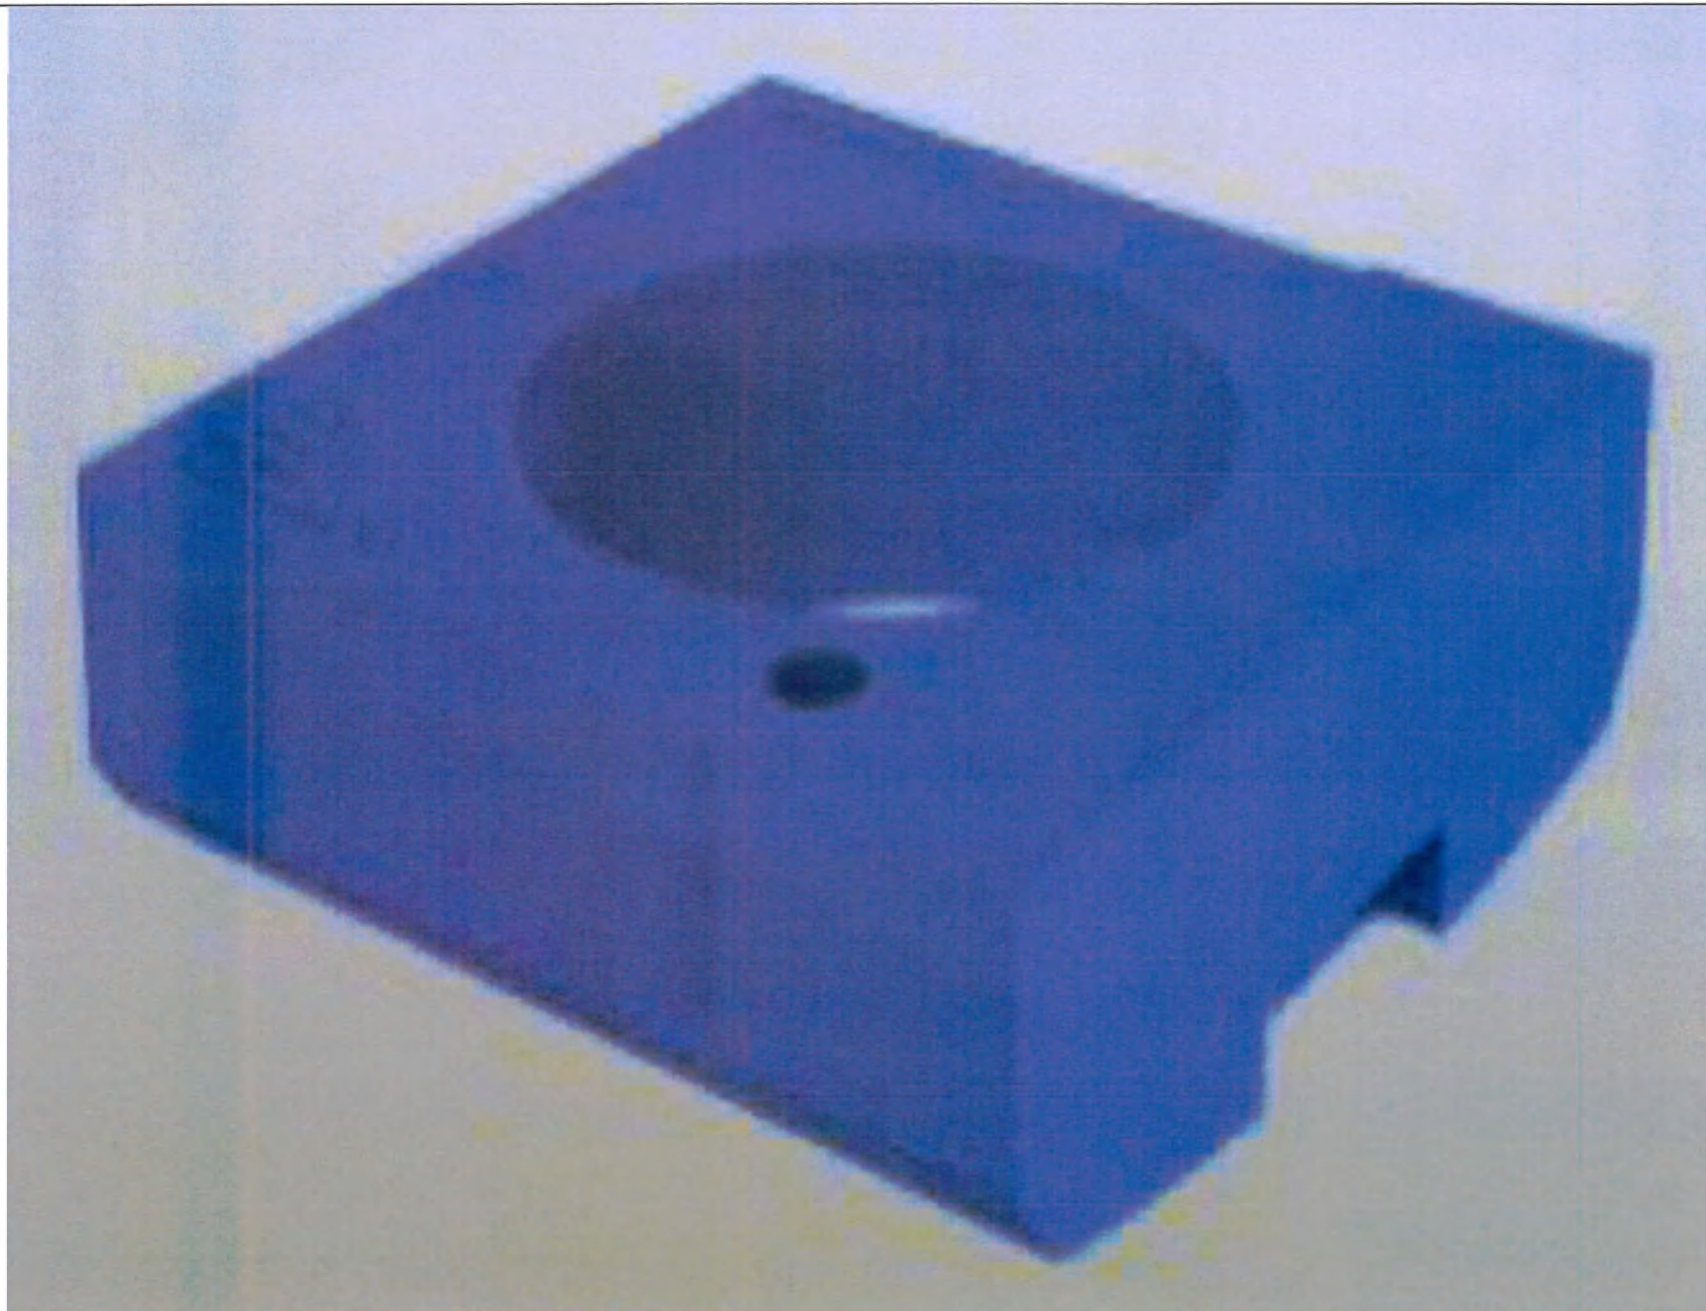


Держатели фантомов

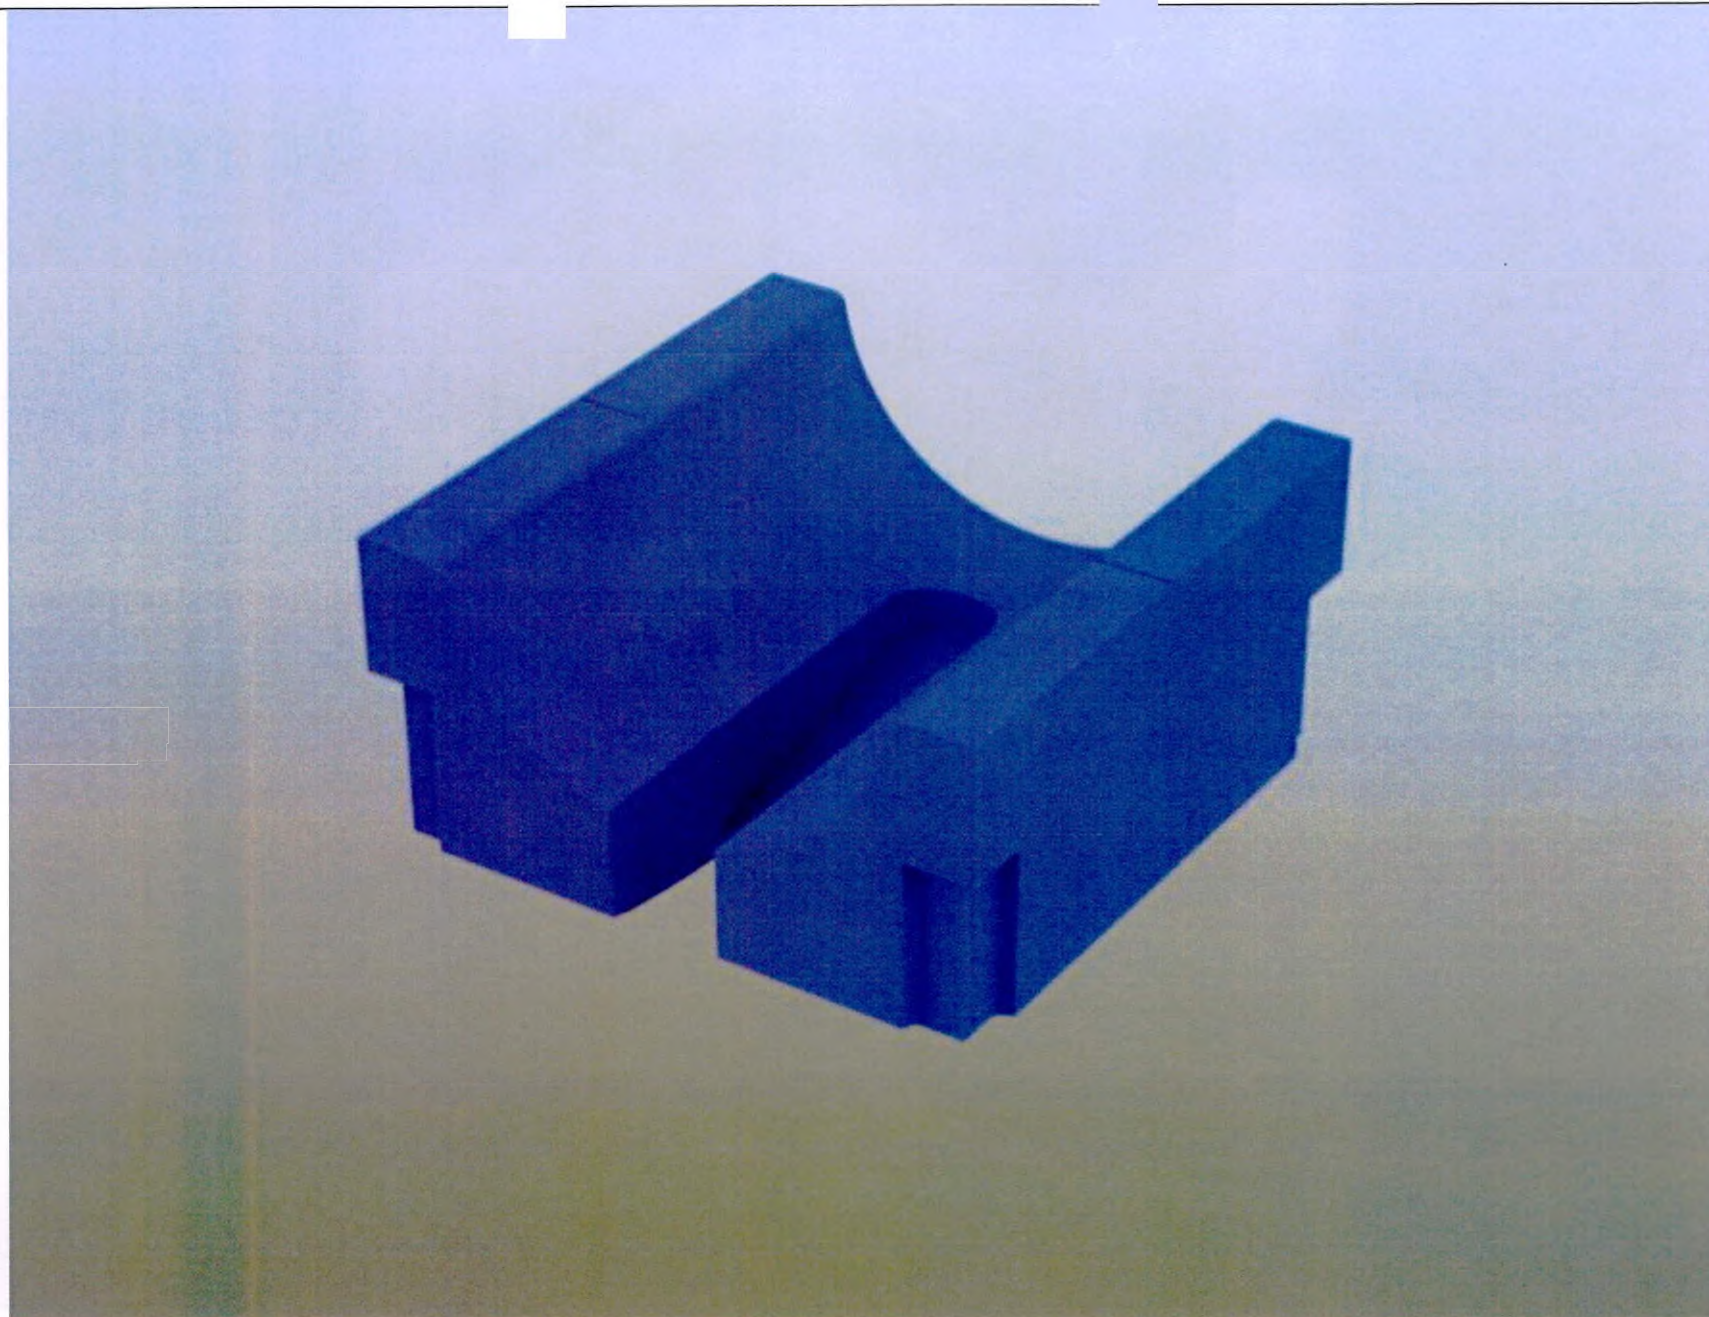


Держатели фантомов

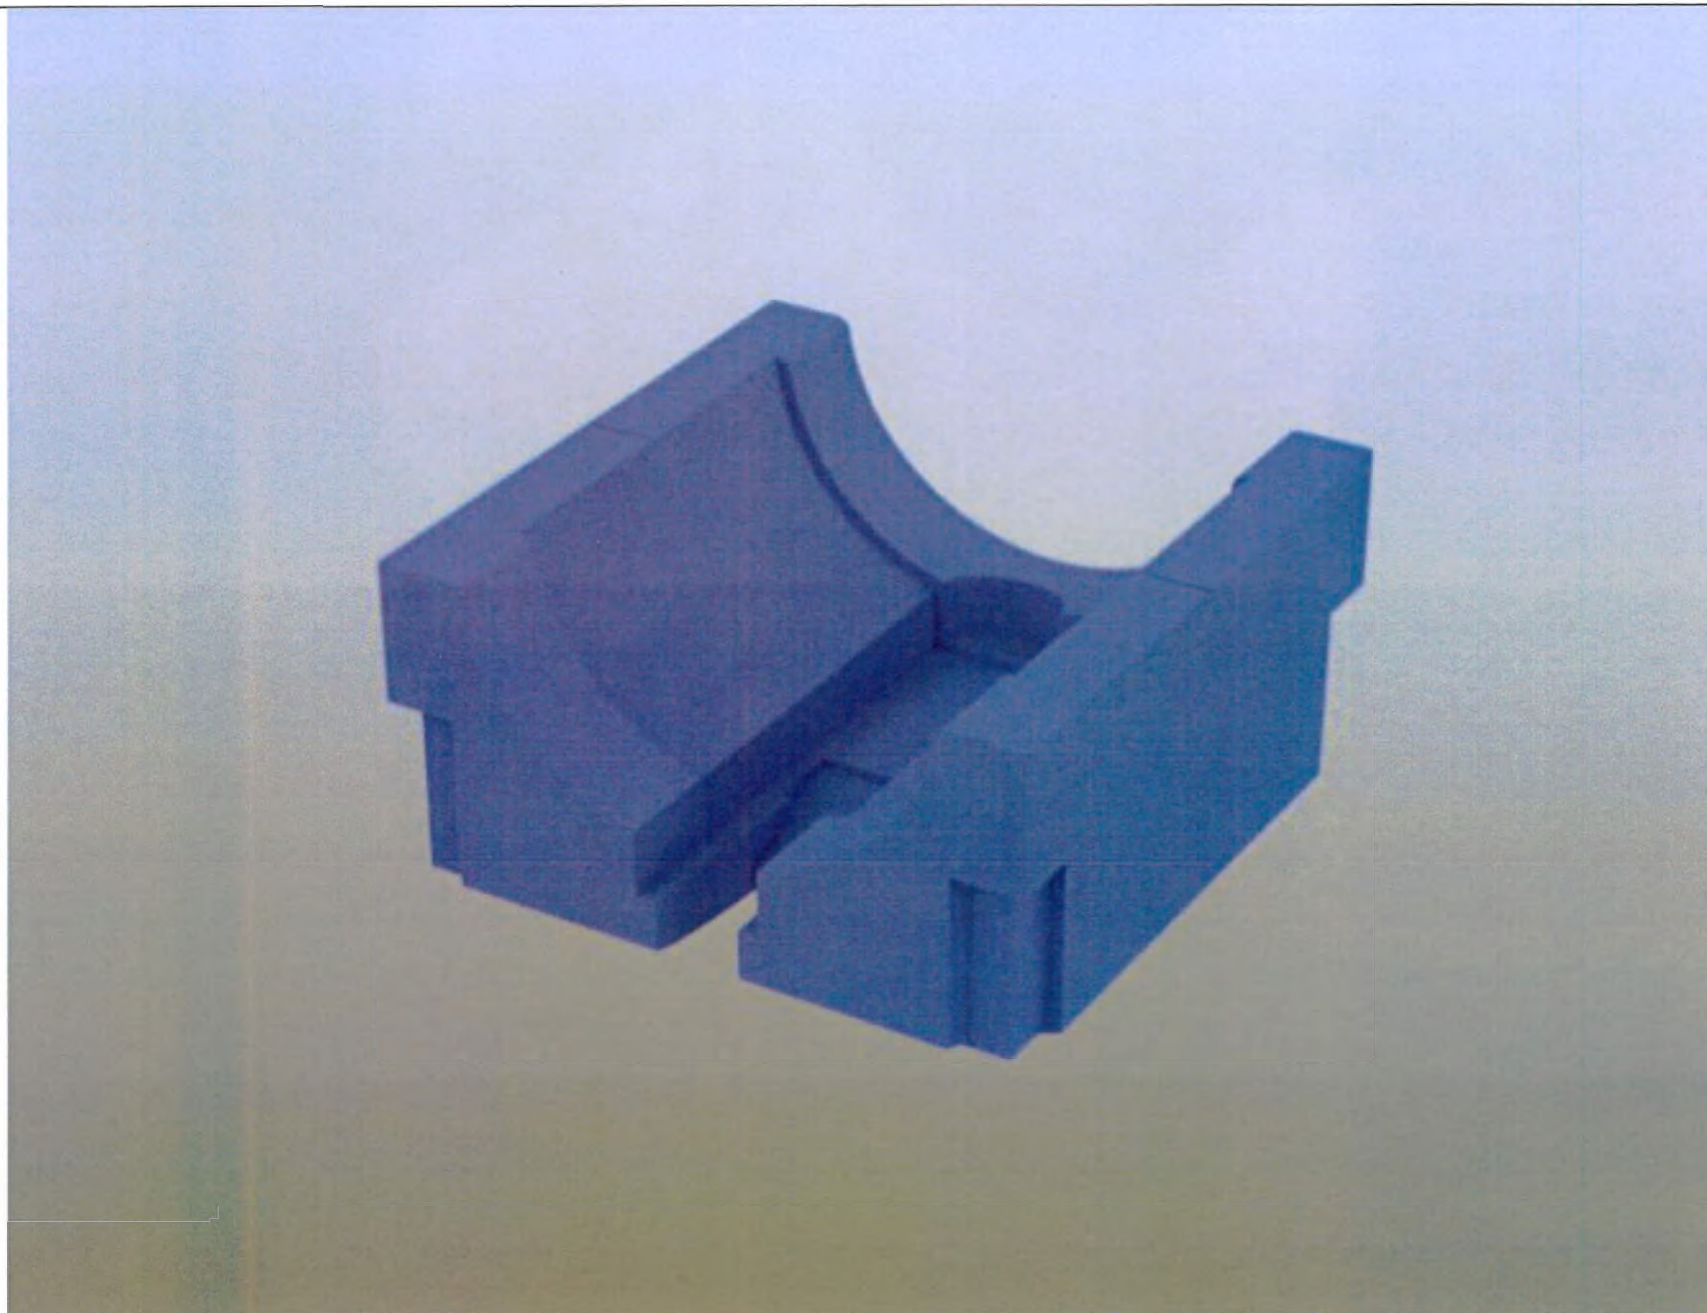

Держатели фантомов

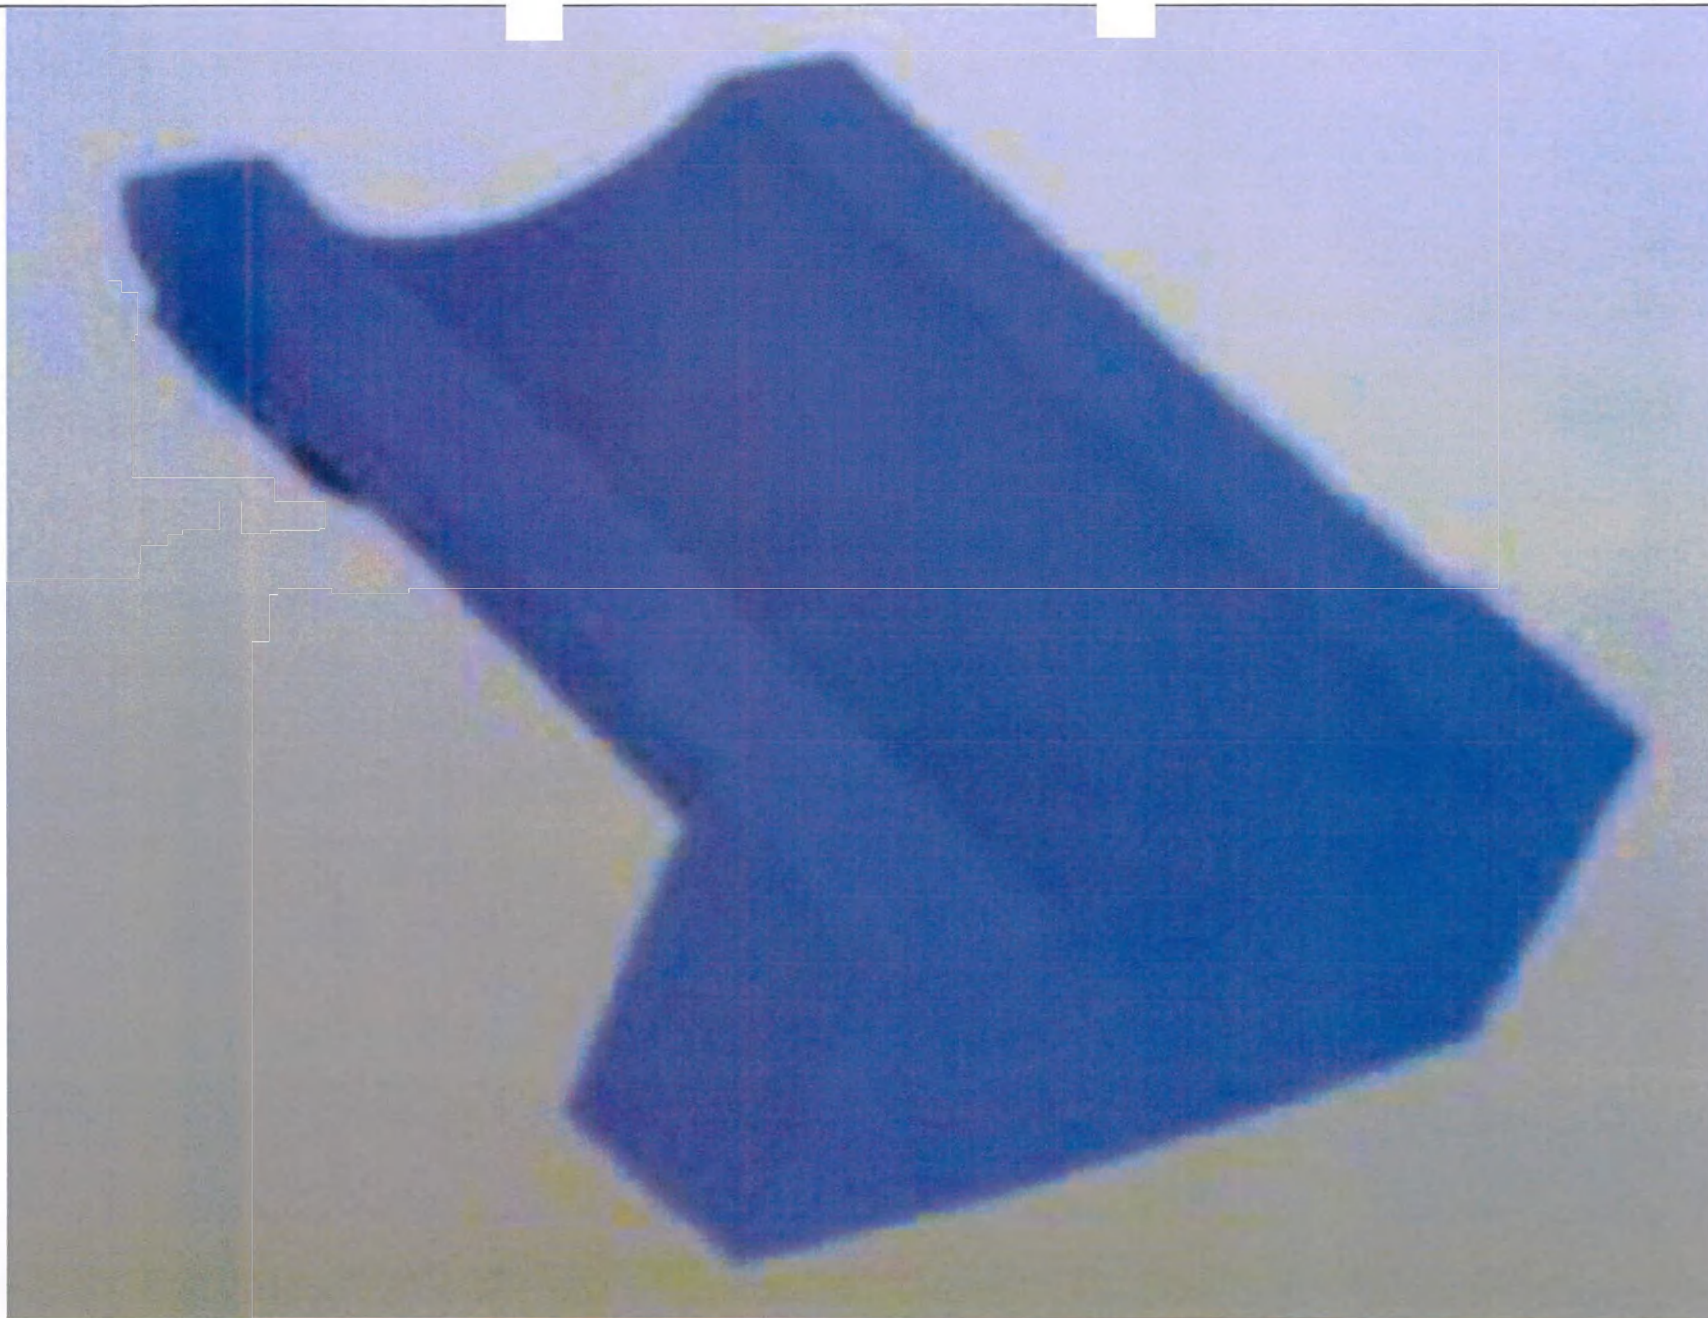

Держатели фантомов

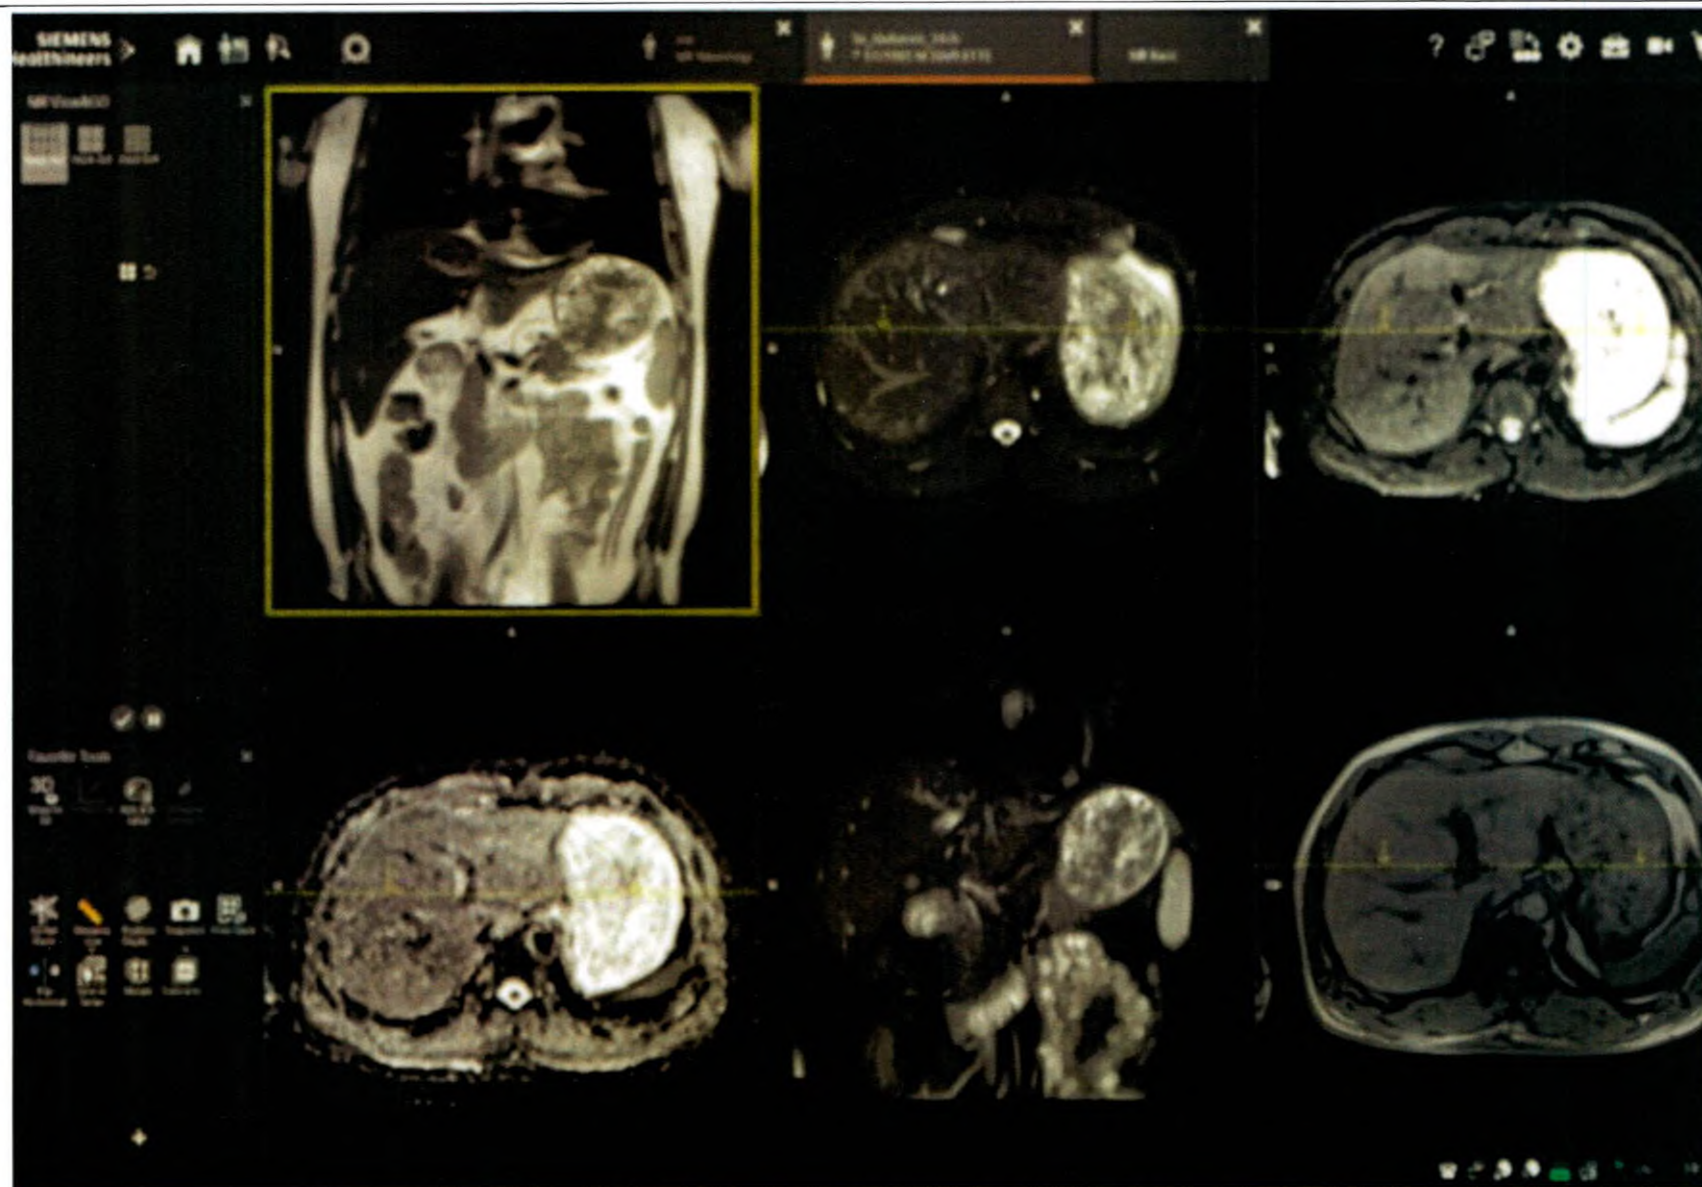

Пакет лицензионных ключей для активации стандартных приложений для сбора и обработки изображений: ключ лицензионный для активации программных режимов для сбора данных; ключ лицензионный для активации программных режимов для сбора и оценки объемных данных; ключ лицензионный для активации программных режимов для просмотра и анализа динамических серий изображений; ключ лицензионный для активации программных режимов для работы в формате DICOM; ключ лицензионный для активации программных режимов для передачи готовых программ сканирования



Пакет лицензионных ключей для активации стандартных приложений для сбора и обработки изображений: ключ лицензионный для активации программных режимов для сбора данных; ключ лицензионный для активации программных режимов для сбора и оценки объемных данных; ключ лицензионный для активации программных режимов для просмотра и анализа динамических серий изображений; ключ лицензионный для активации программных режимов для работы в формате DICOM; ключ лицензионный для активации программных режимов для передачи готовых программ сканирования



Пакет лицензионных ключей для активации стандартных приложений для сбора и обработки изображений: ключ лицензионный для активации программных режимов для сбора данных; ключ лицензионный для активации программных режимов для сбора и оценки объемных данных; ключ лицензионный для активации программных режимов для просмотра и анализа динамических серий изображений; ключ лицензионный для активации программных режимов для работы в формате DICOM; ключ лицензионный для активации программных режимов для передачи готовых программ сканирования

Expert-i Connection Status

? x

Press End Connection to close the remote session.

Current Connection

User ||||| is connected from remote system |||||

Connection Mode

- ☐ View Only
- ☒ Full Access

i Full access enables the remote user to interact directly with the system.

End Connection

Apply

Лицензионные ключи для активации дополнительных программных режимов для
планирования и управления исследованием



MAGNETOM Free. Платформа


Руководство пользователя – МР-система и катушки
syngo MR XA50

siemens-healthineers.com


SIEMENS
Healthineers

Документация пользователя на русском языке, печатная или на CD/USB носителе


ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

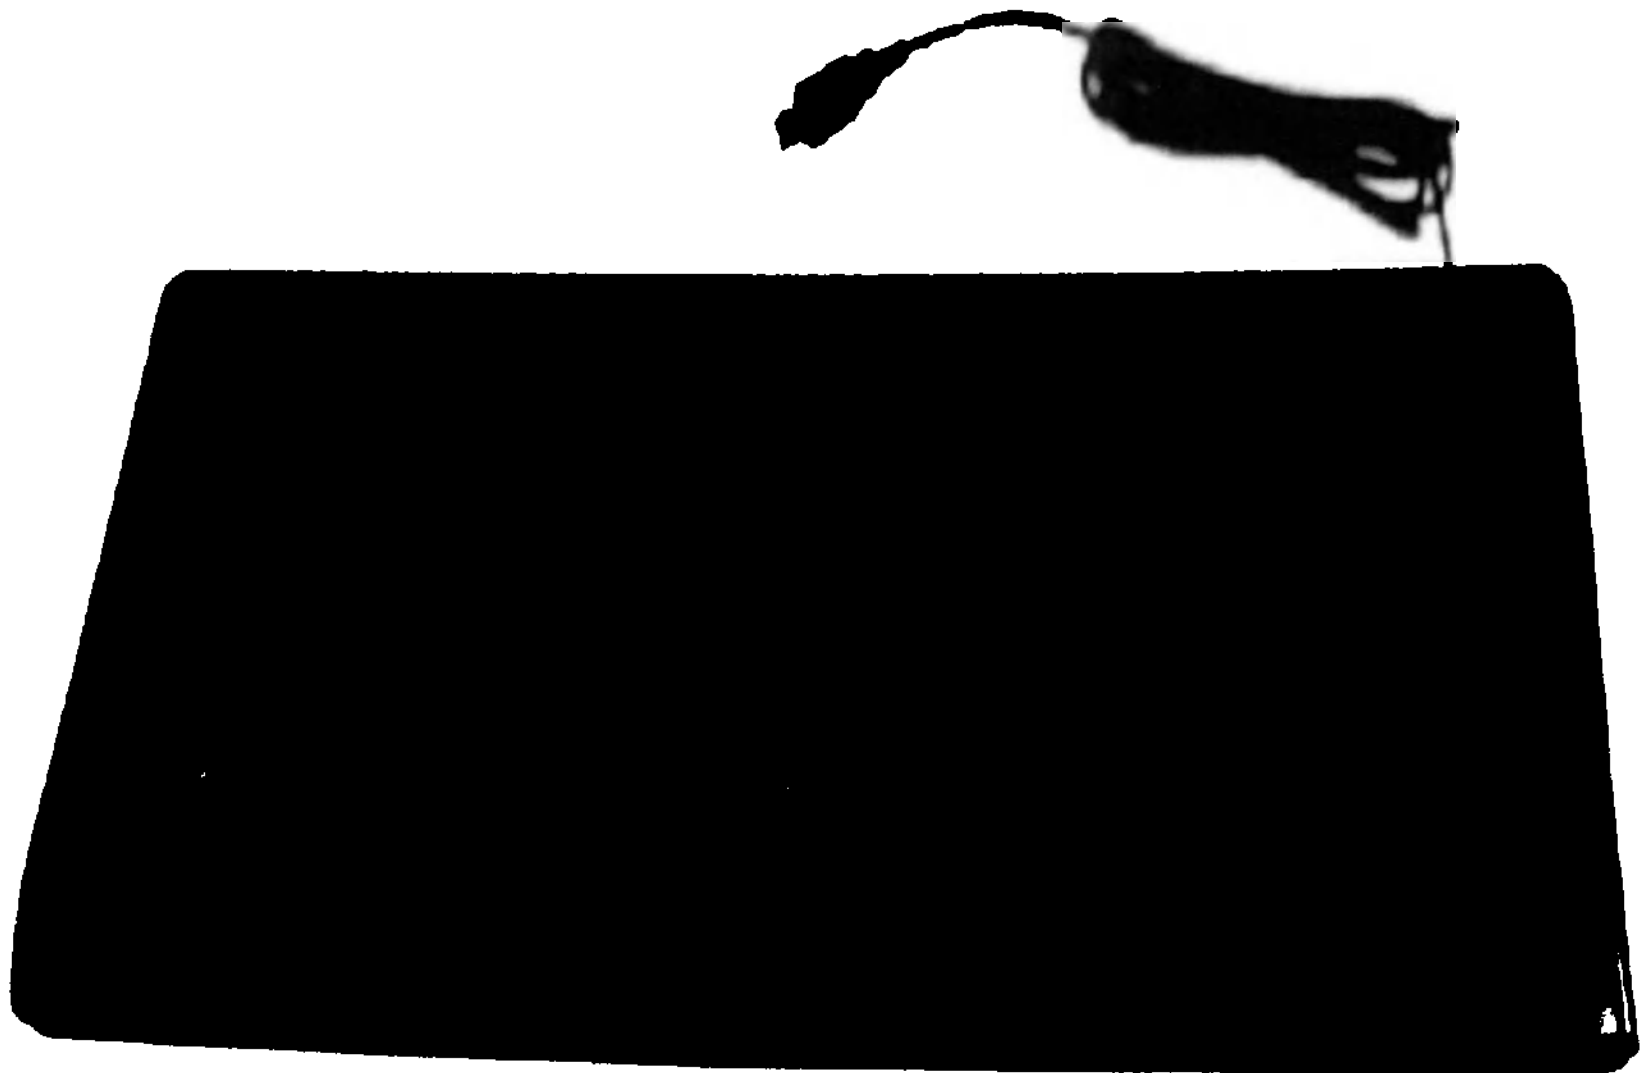


Клавиатуры

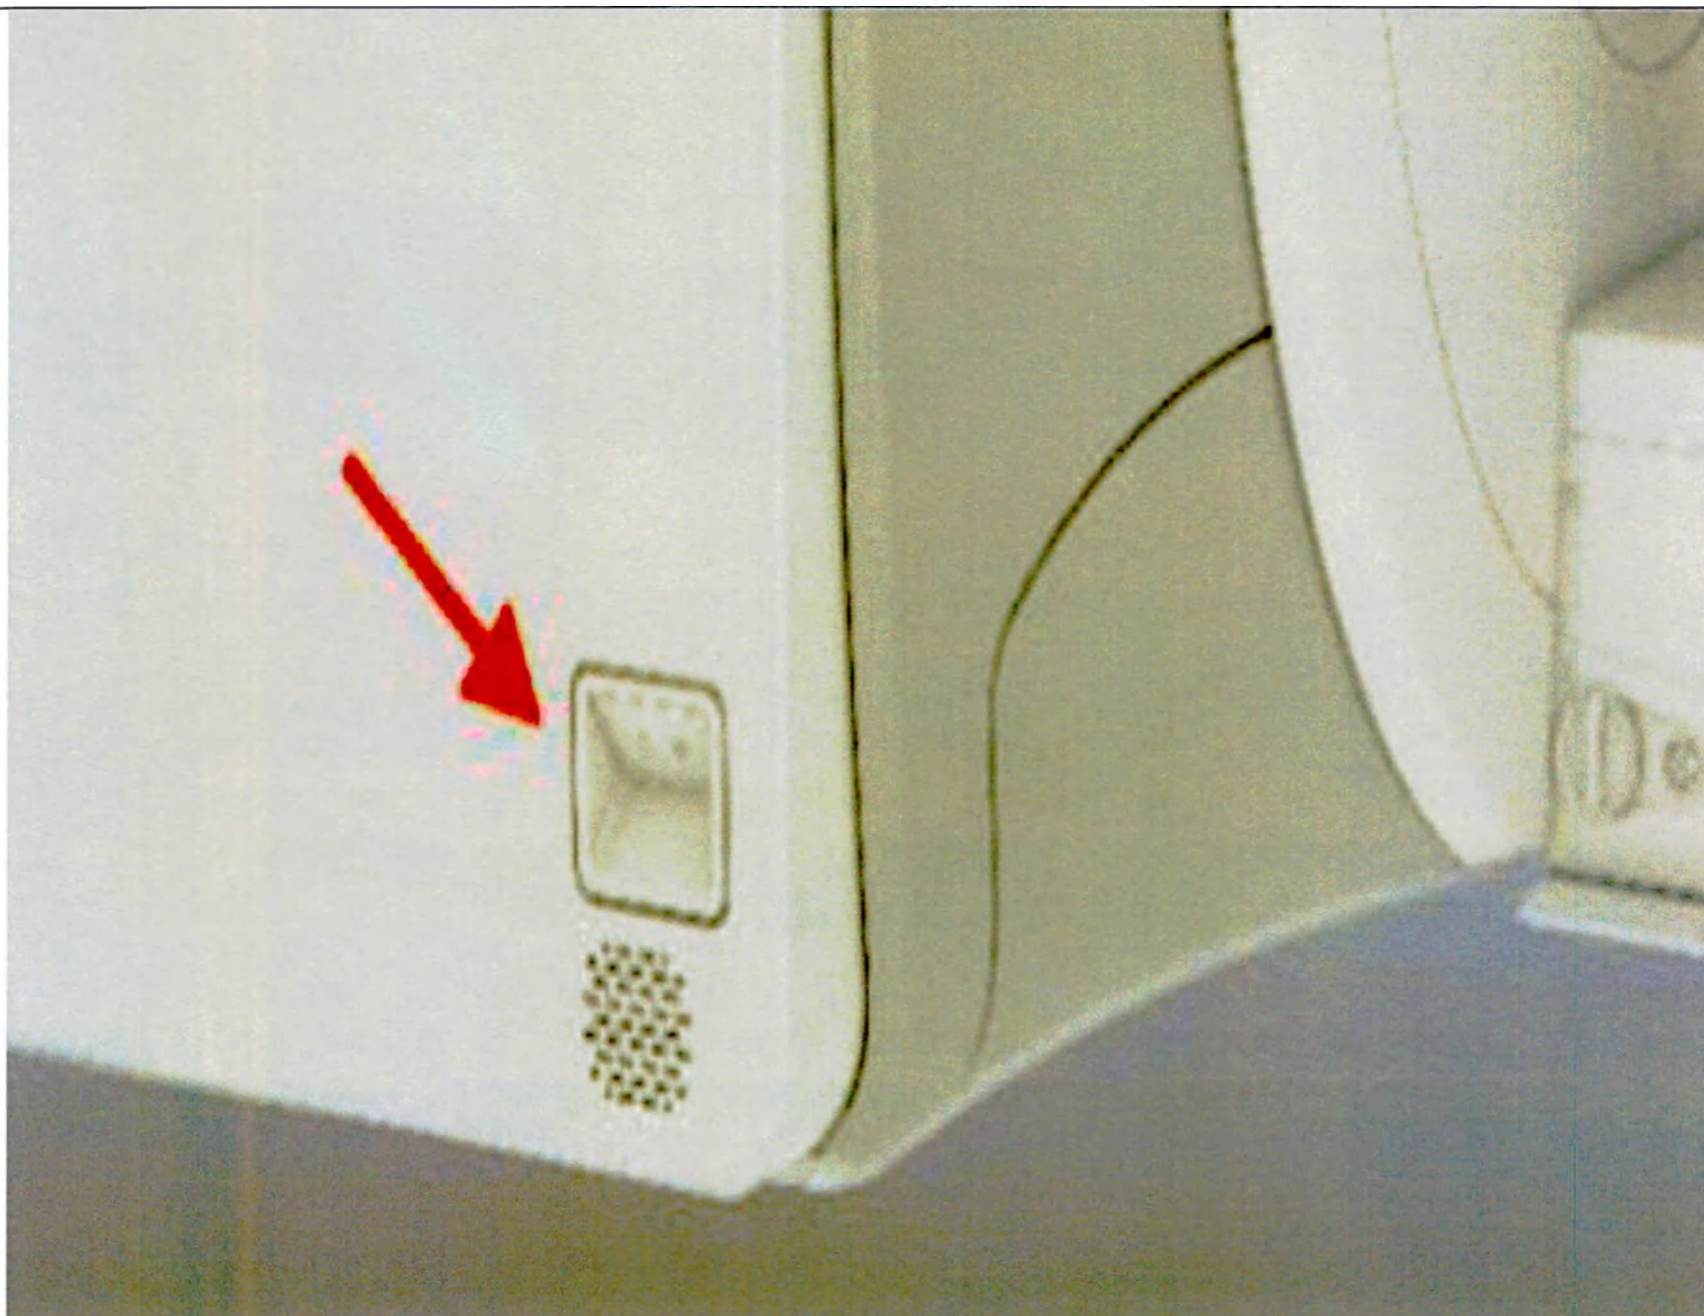

Входы внешнего сигнала запуска

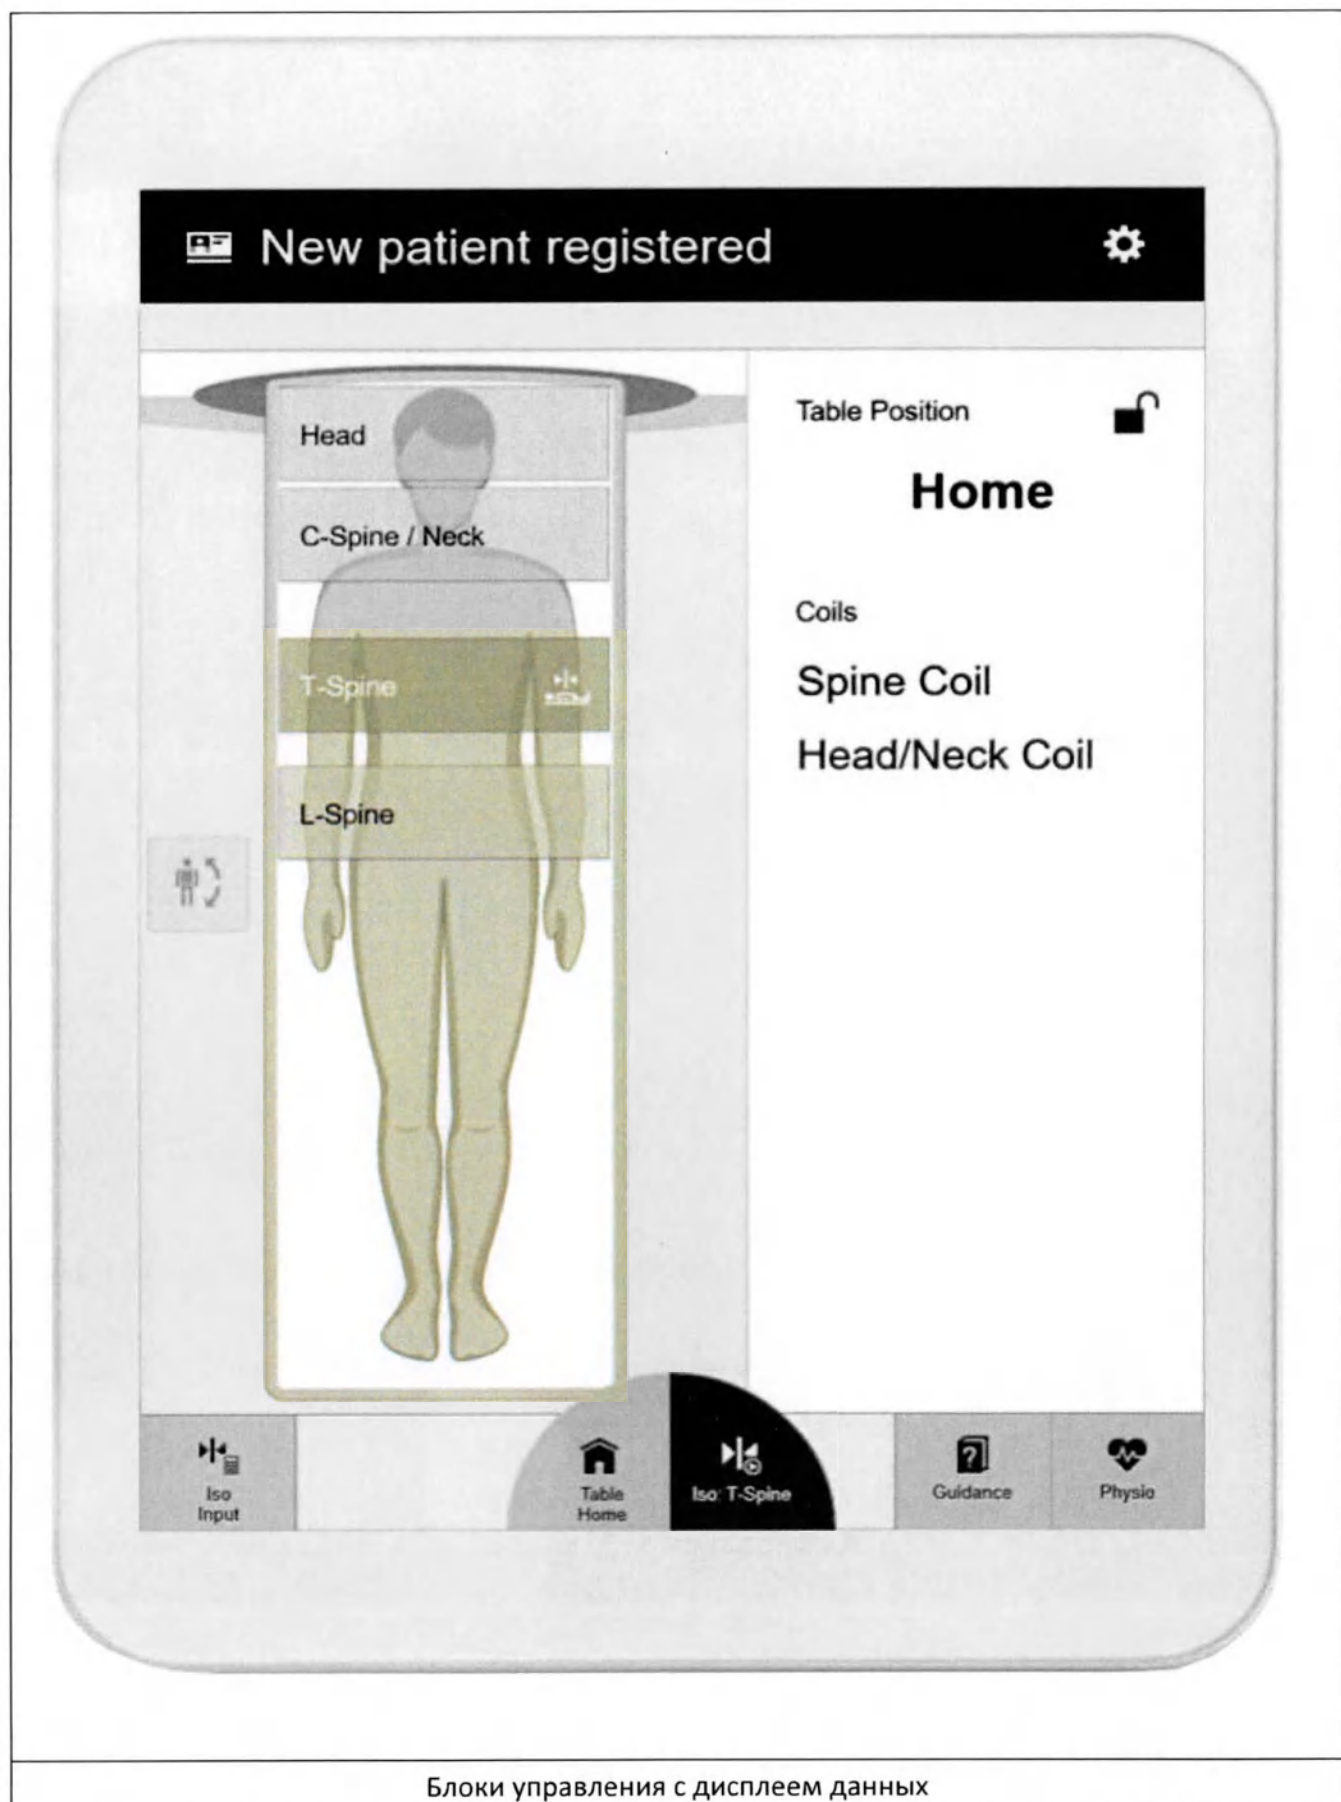


Блоки управления с дисплеем данных

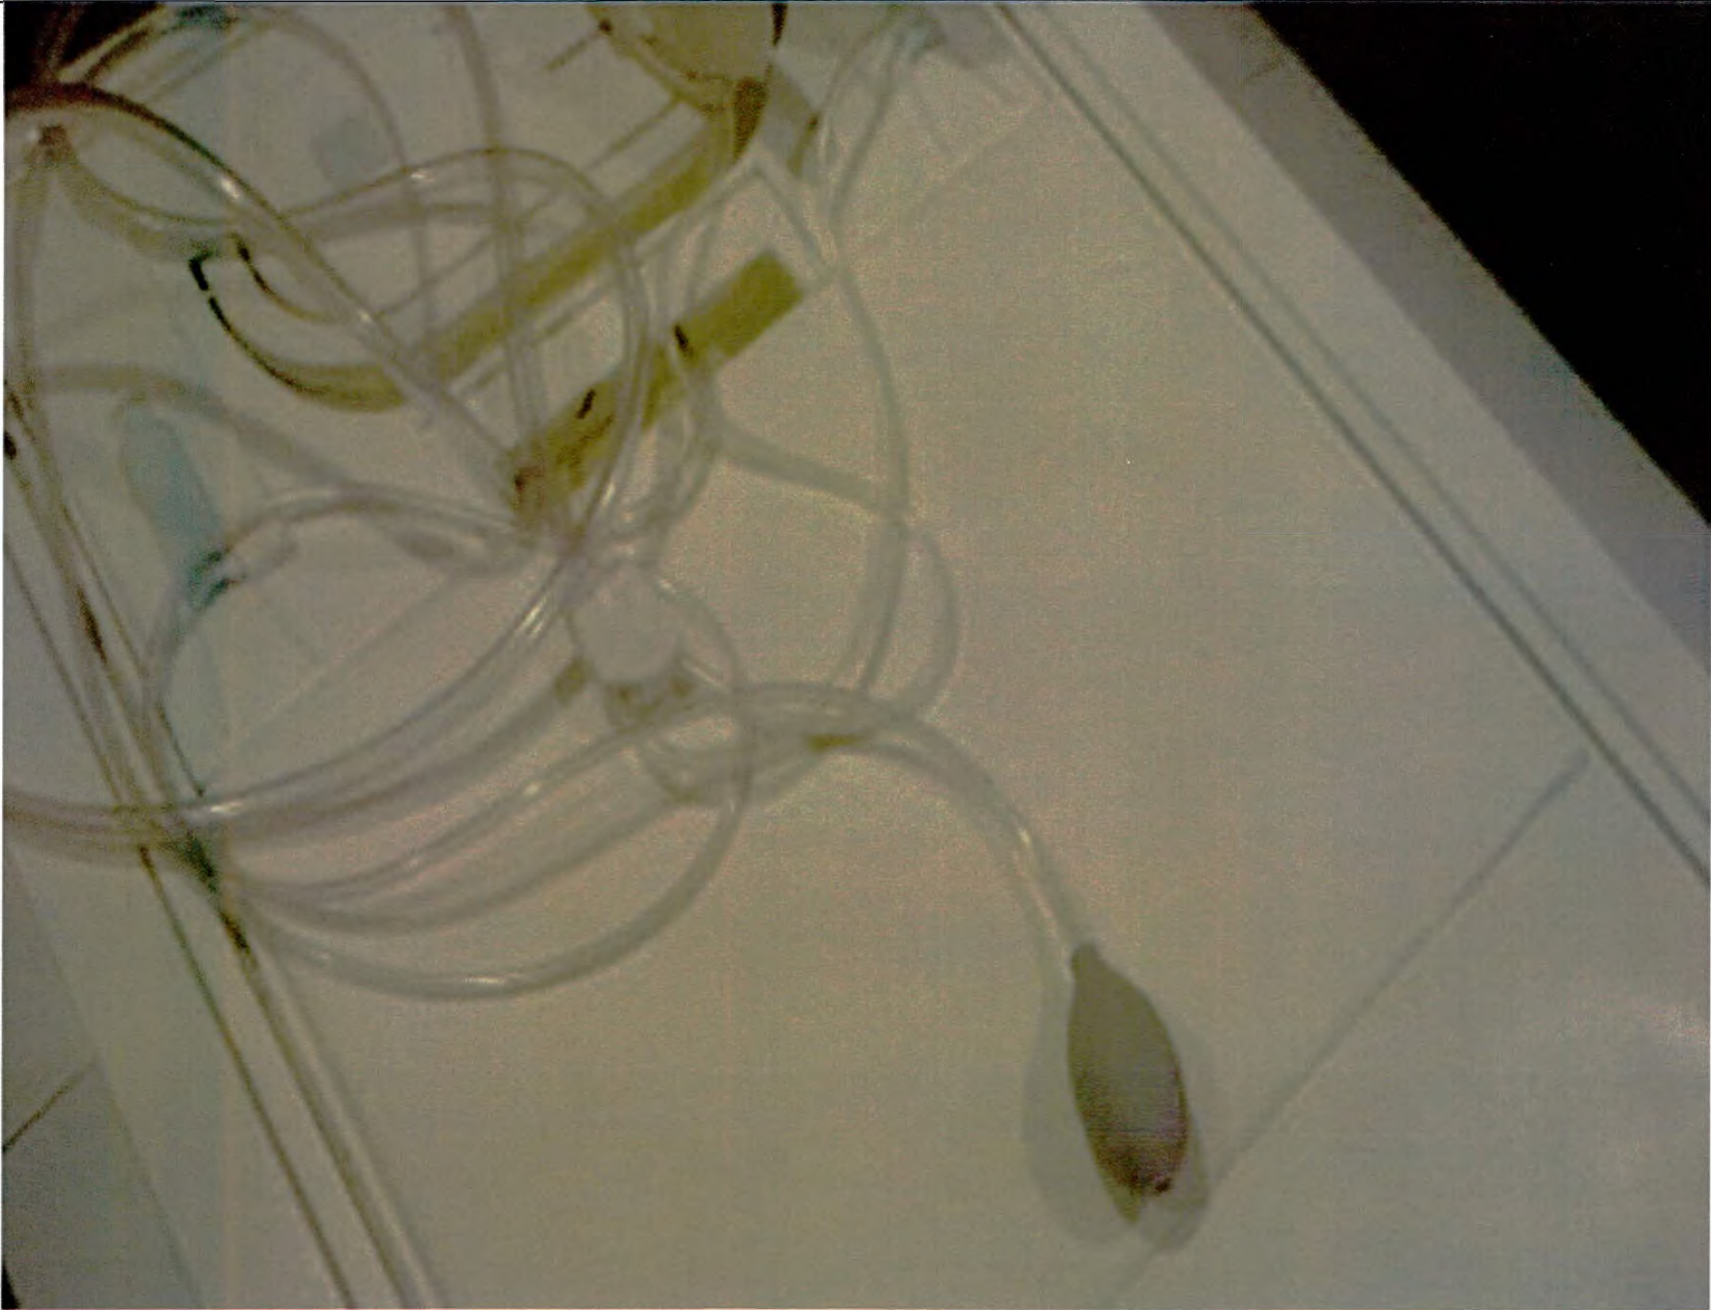


Тангента




Наушники

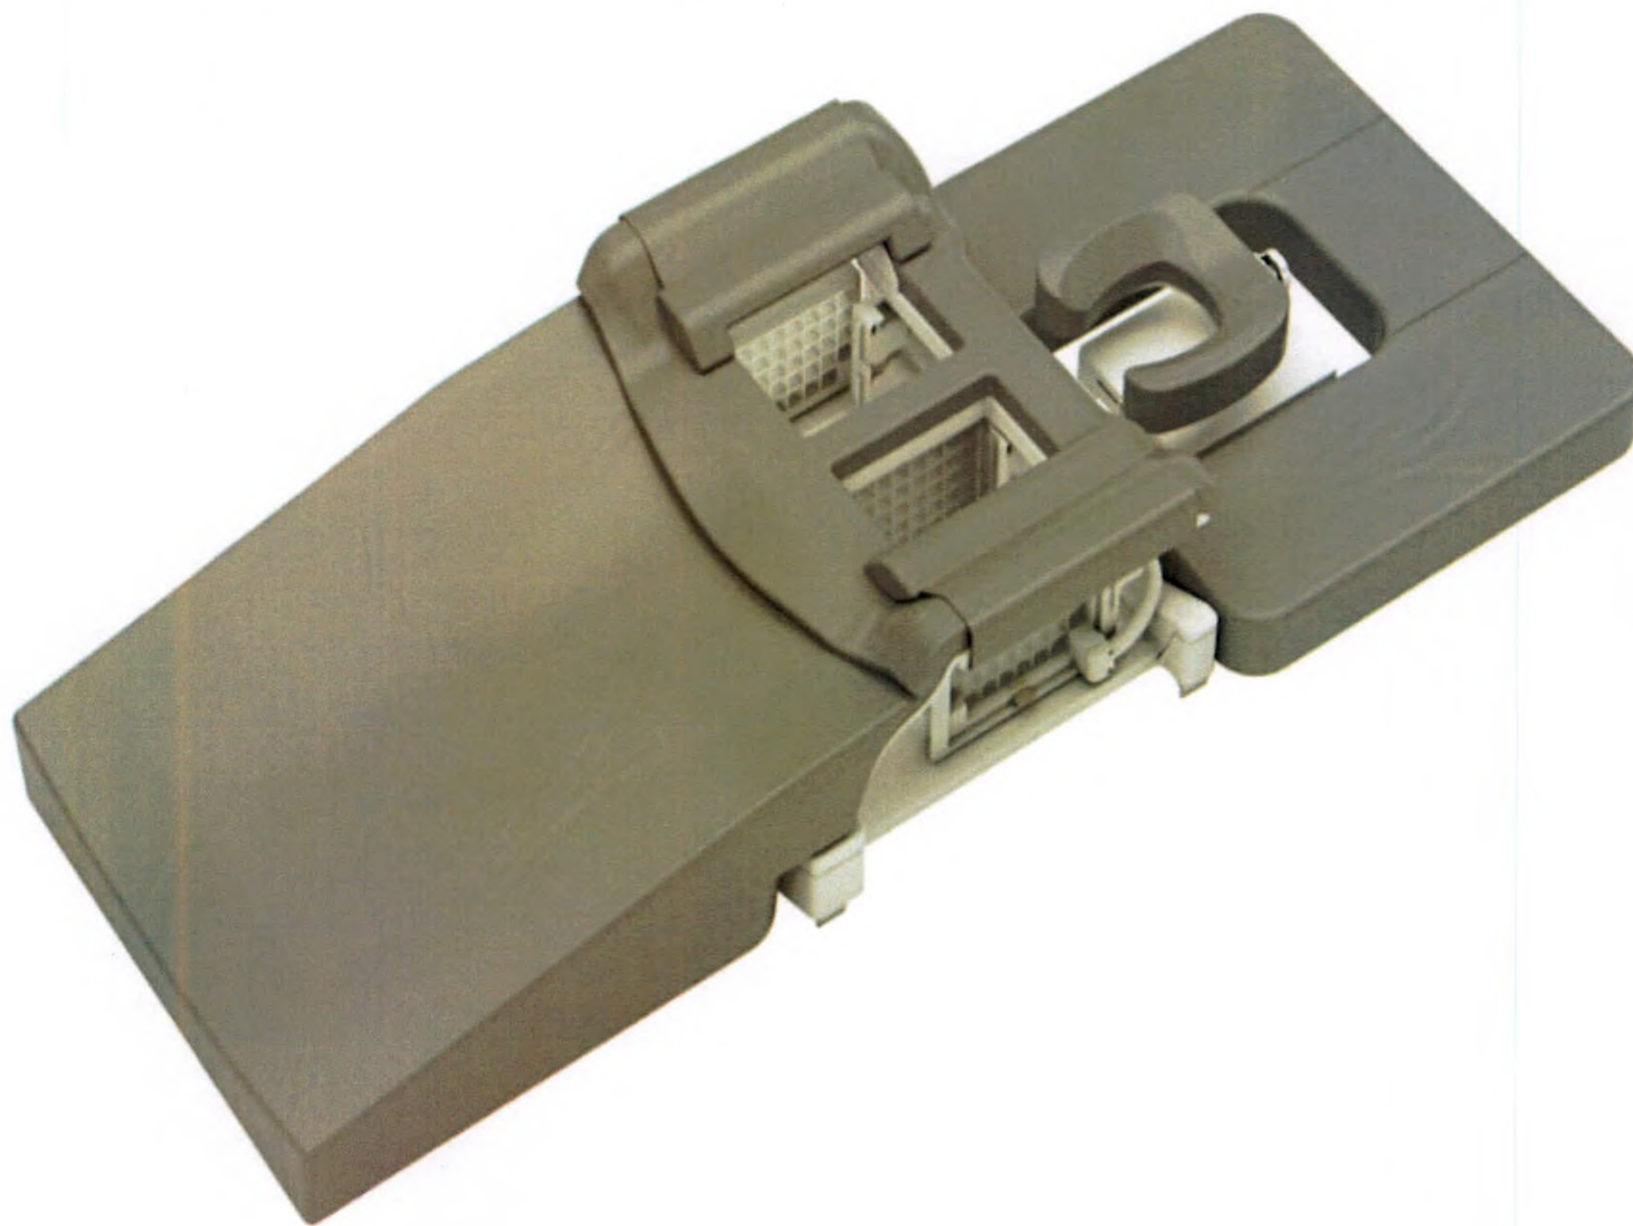


Катушки для биопсии и визуализации молочных желез Breast BI

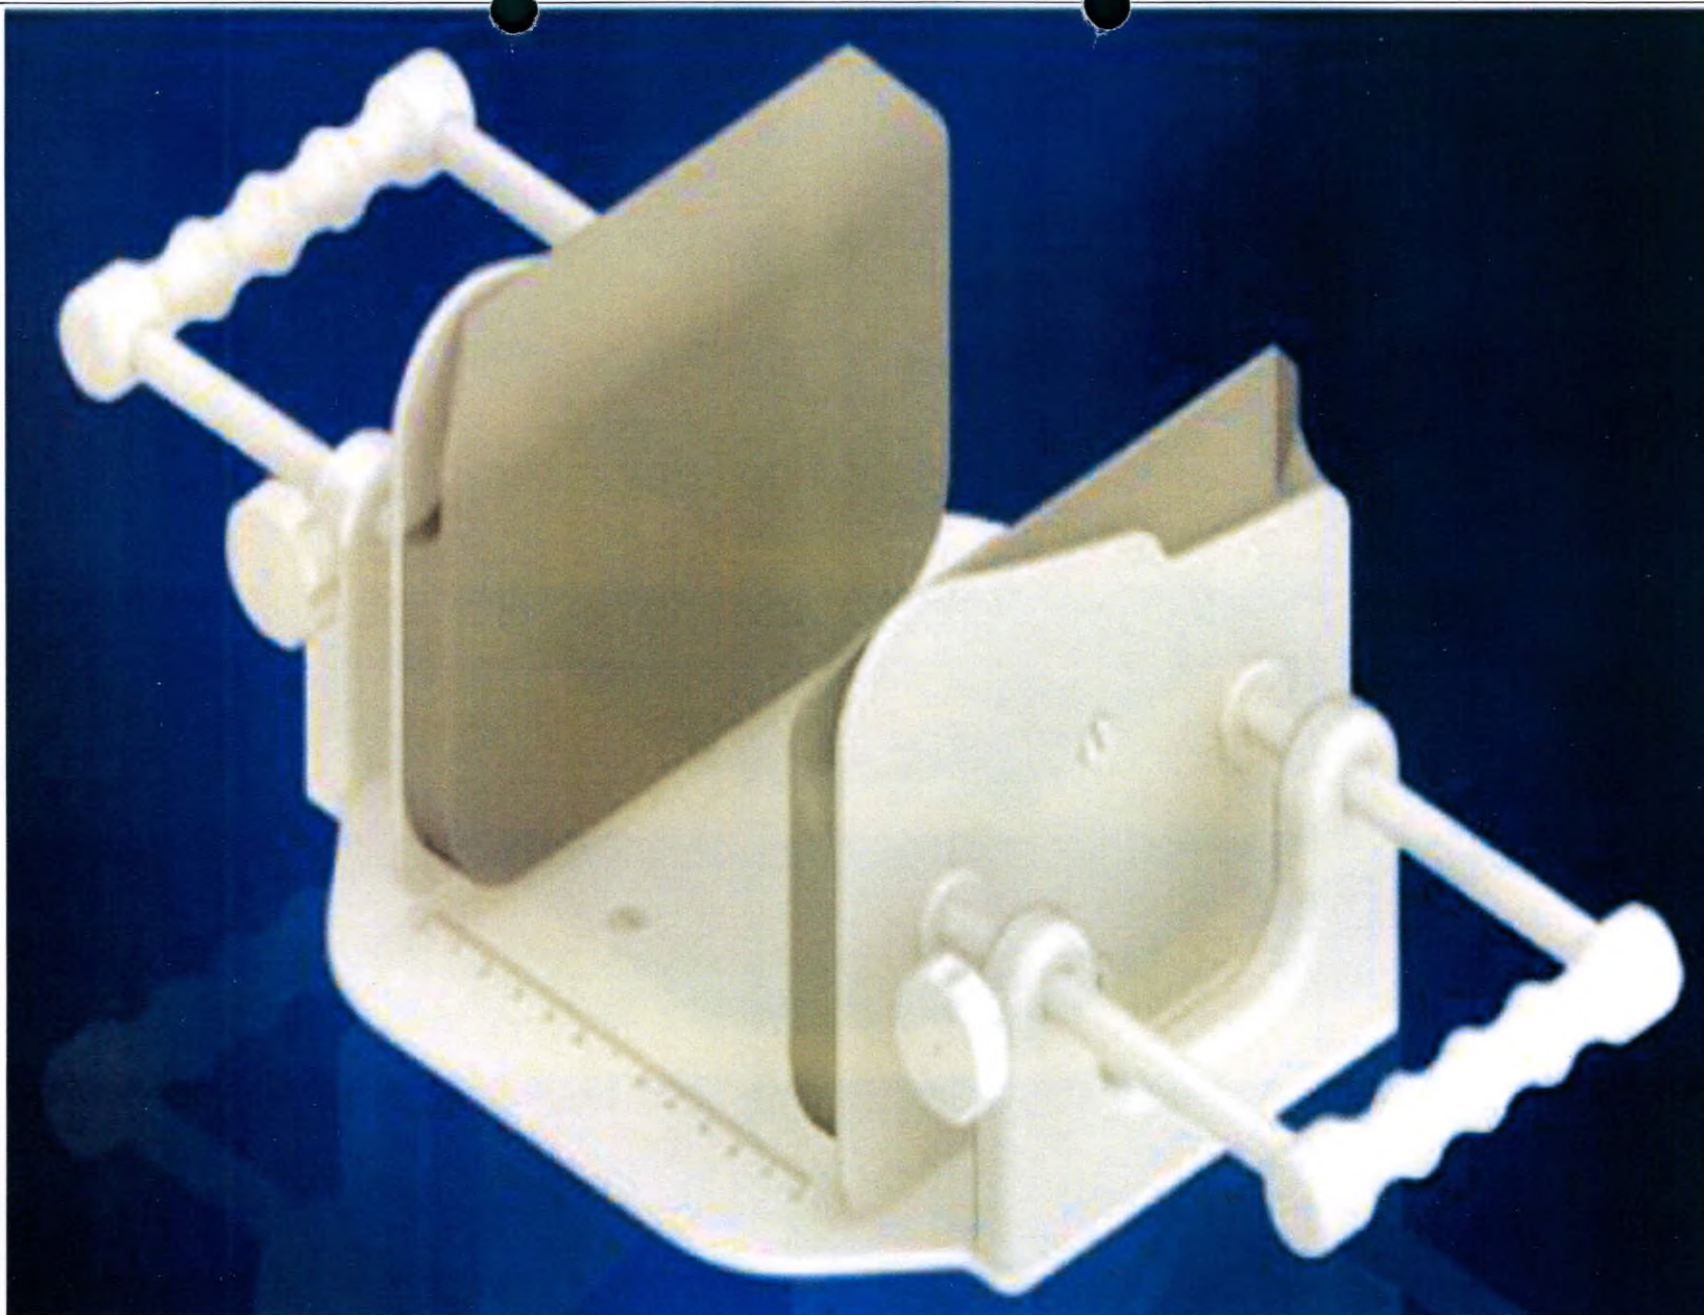


Средства позиционирования катушки для биопсии и визуализации молочных желез Breast BI

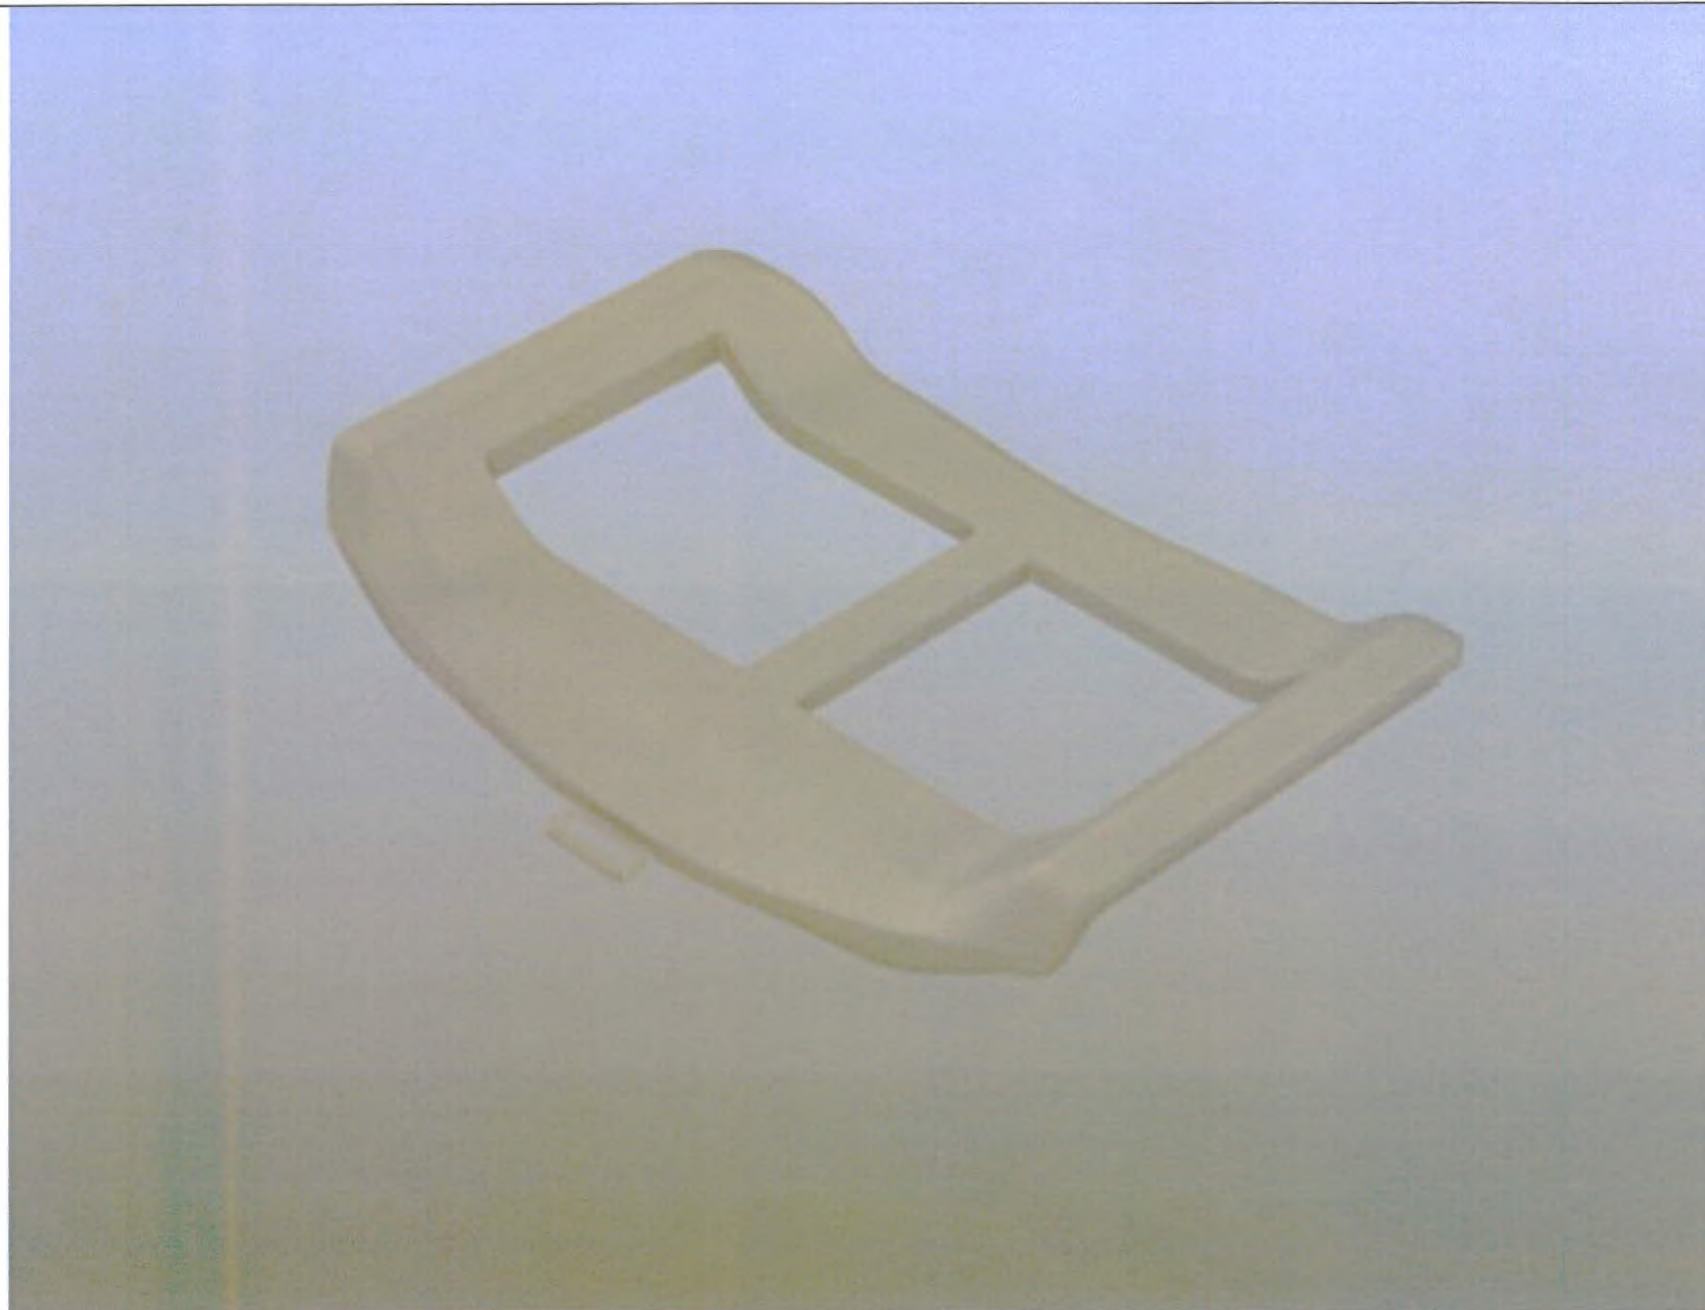


Принадлежности катушки для биопсии и визуализации молочных желез Breast BI: опорная подушка

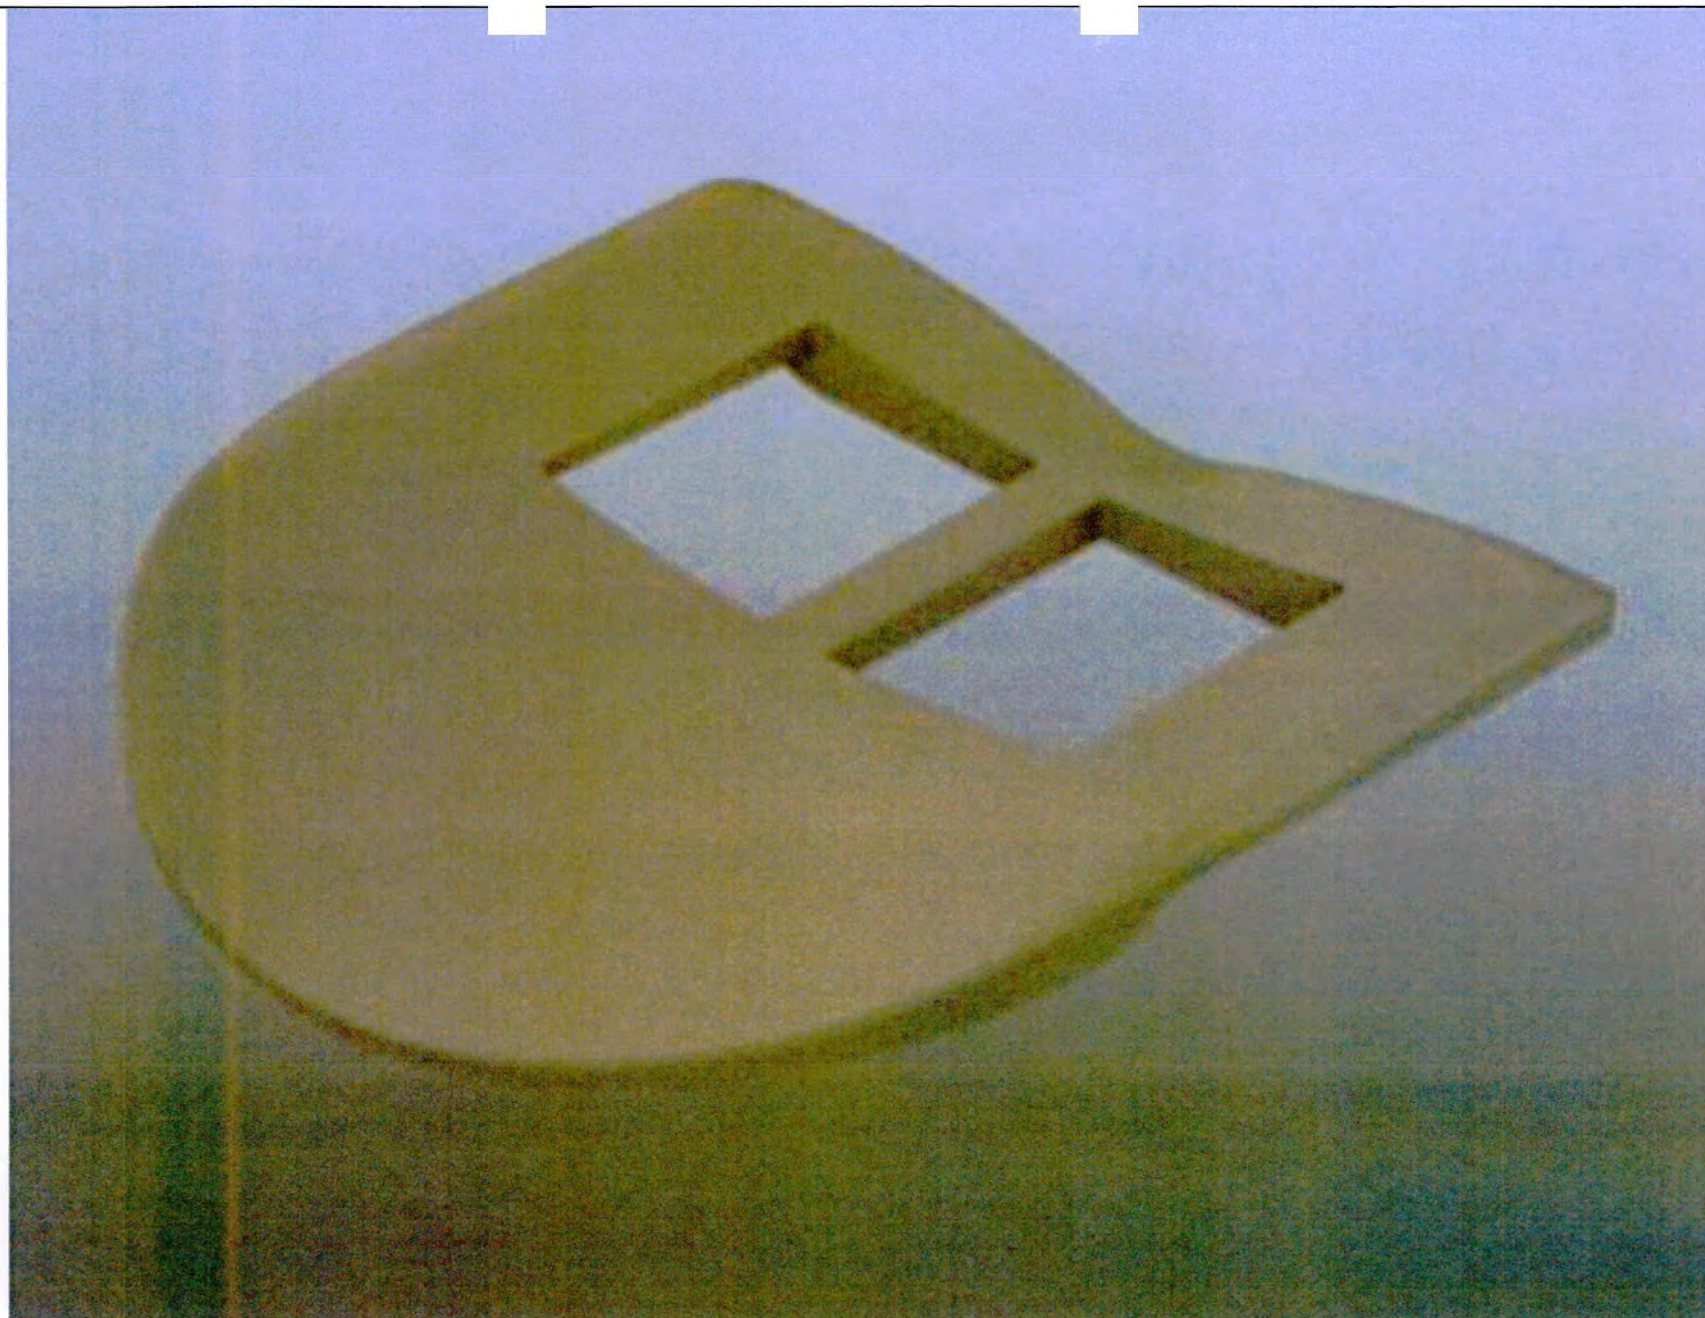


Принадлежности катушки для биопсии и визуализации молочных желез Breast BI: опорная подушка, комфорт

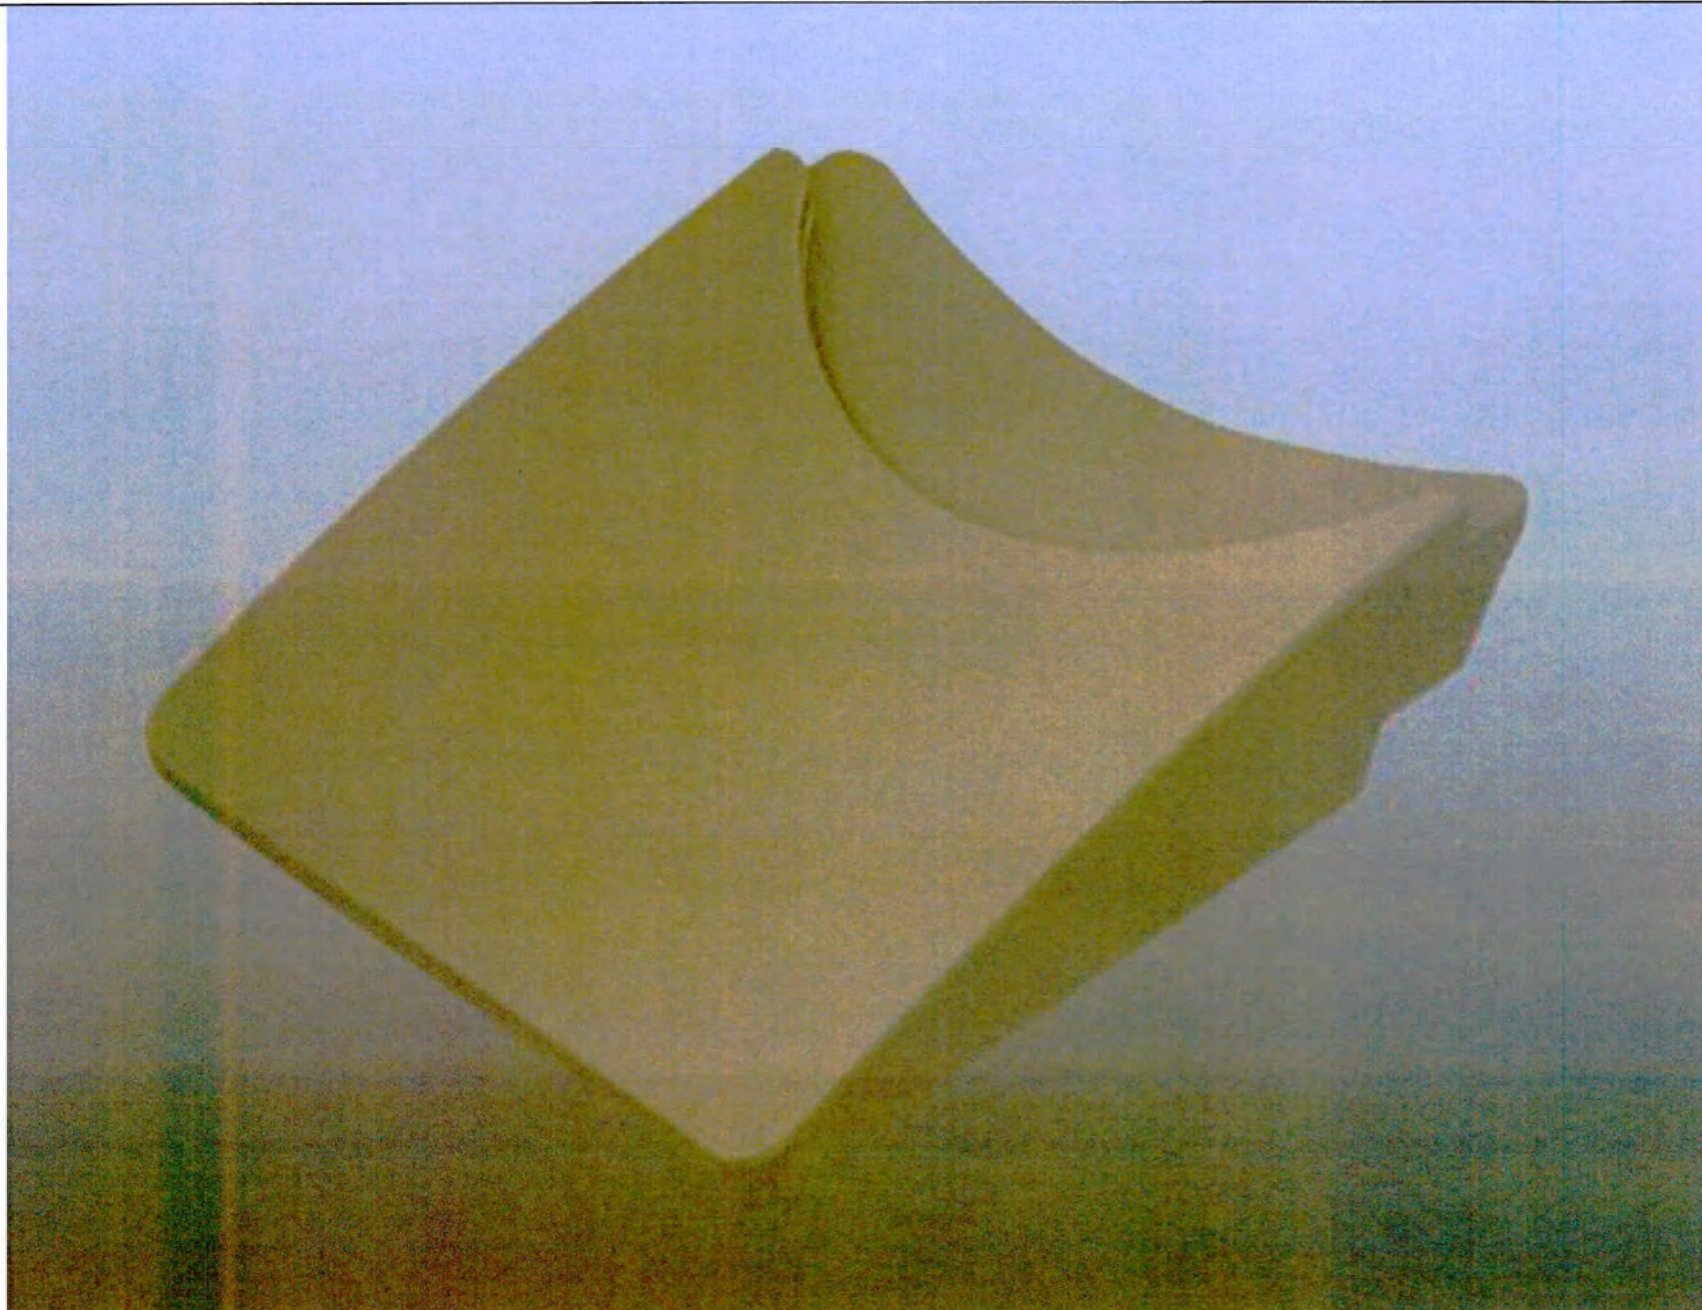


Принадлежности катушки для биопсии и визуализации молочных желез Breast BI: опорная подушка для тазобедренного сустава

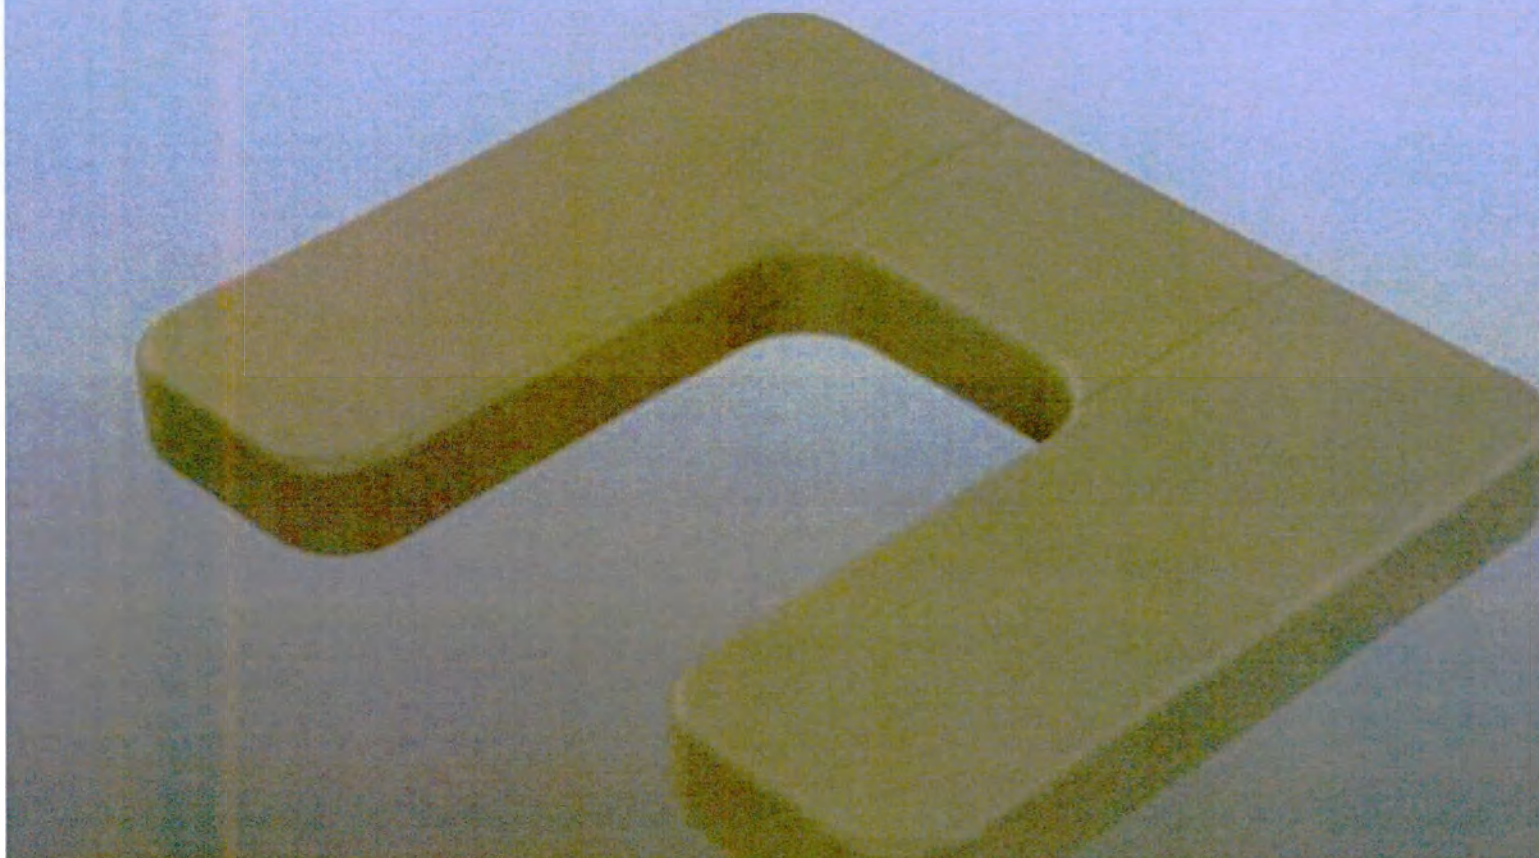


Принадлежности катушки для биопсии и визуализации молочных желез Breast BI: подкладка подлокотника

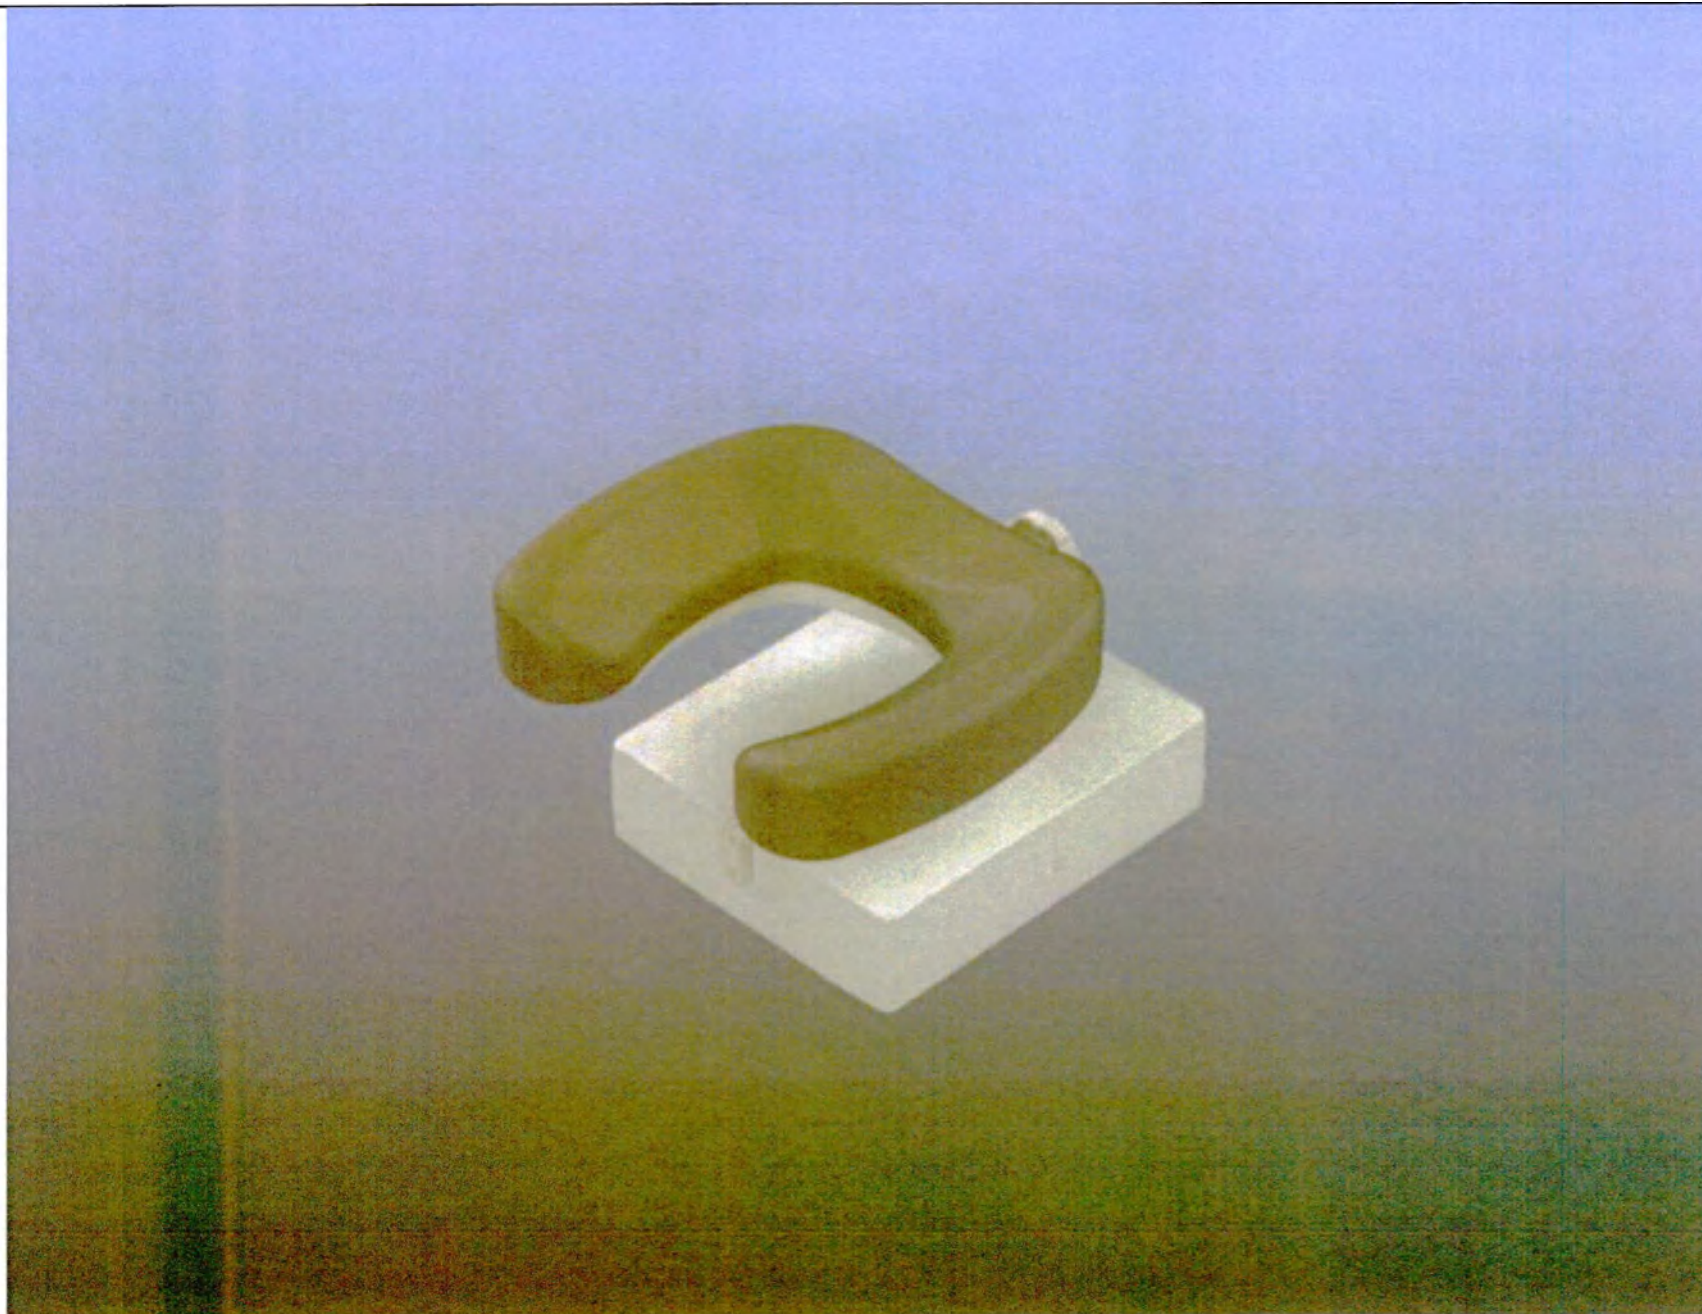


Принадлежности катушки для биопсии и визуализации молочных желез Breast BI: подголовник

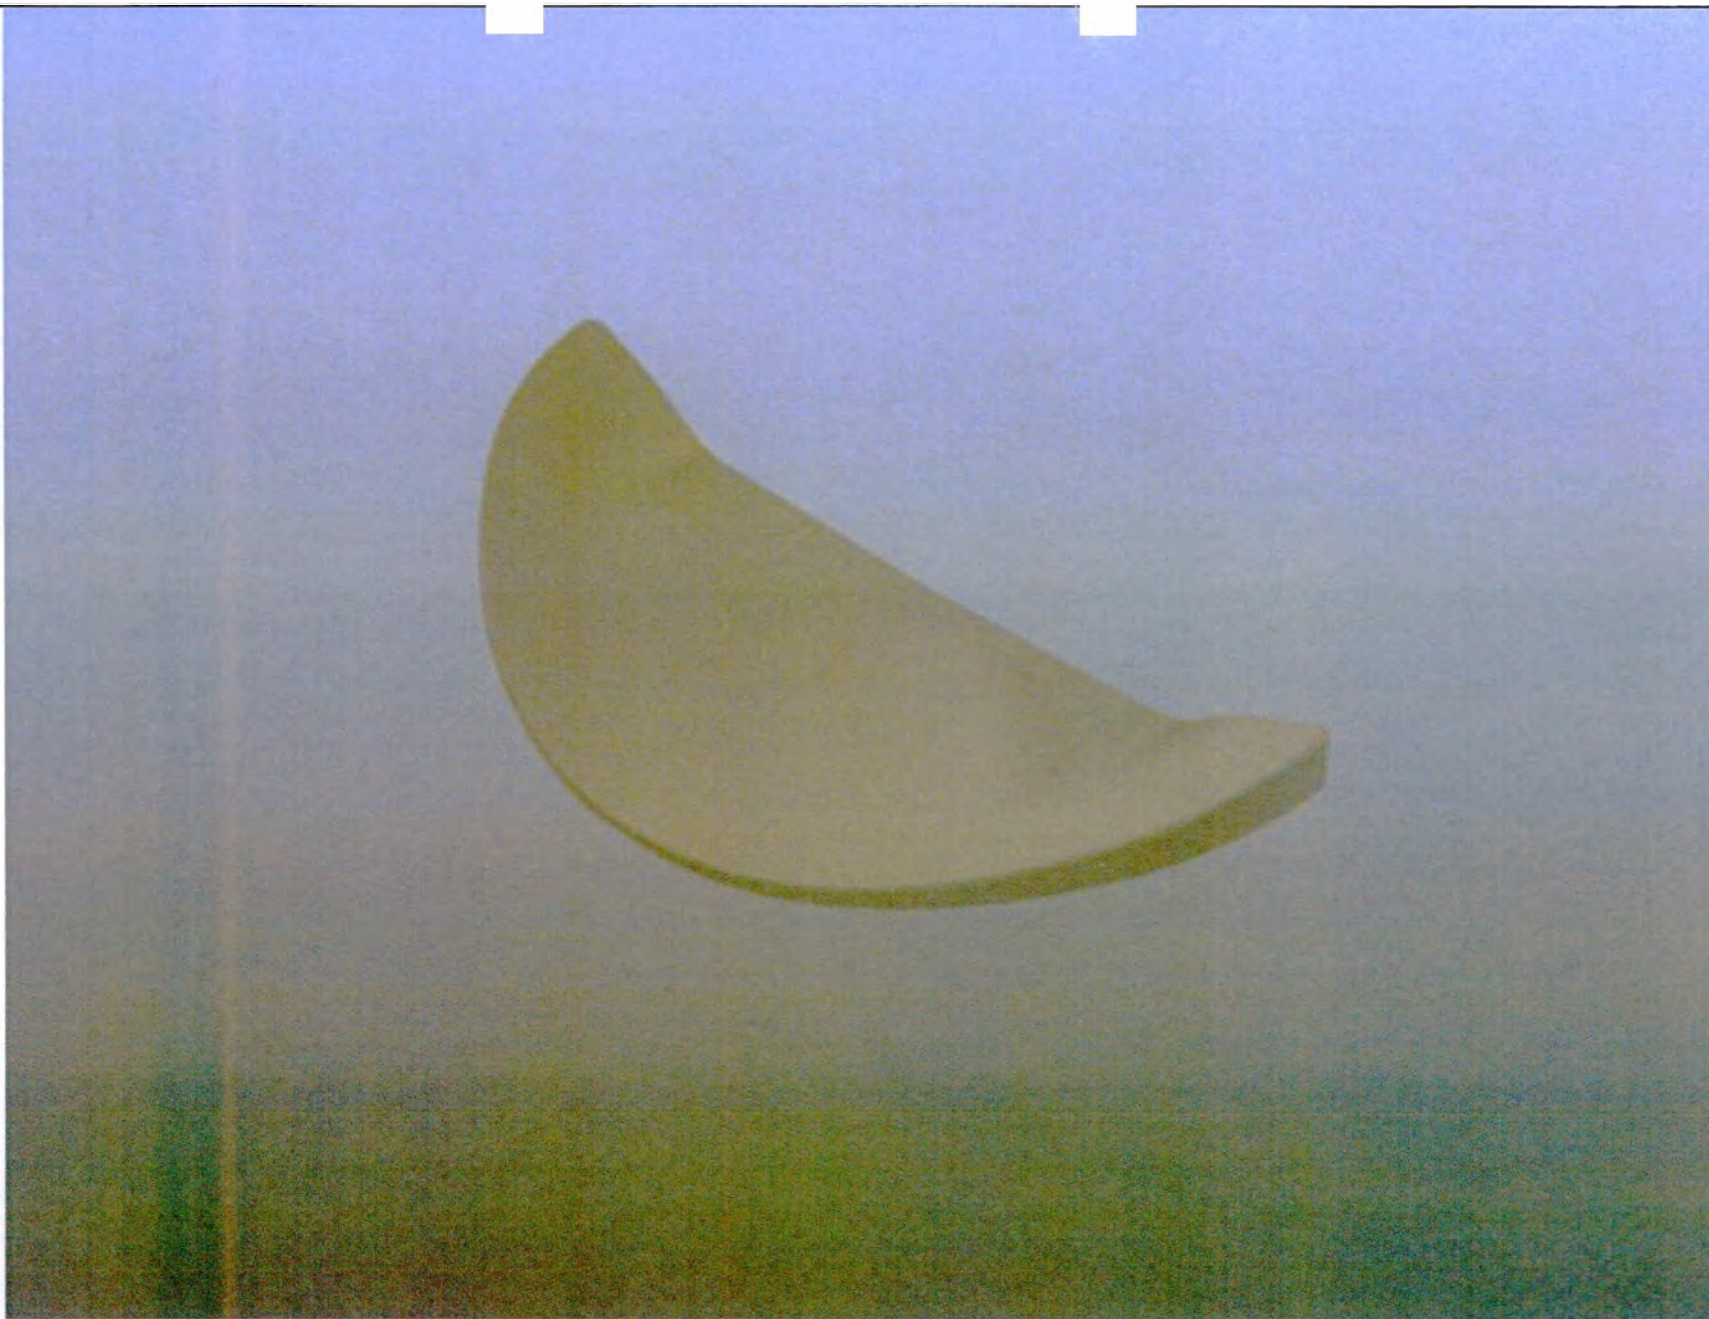


Принадлежности катушки для биопсии и визуализации молочных желез Breast BI: подушка наполнения

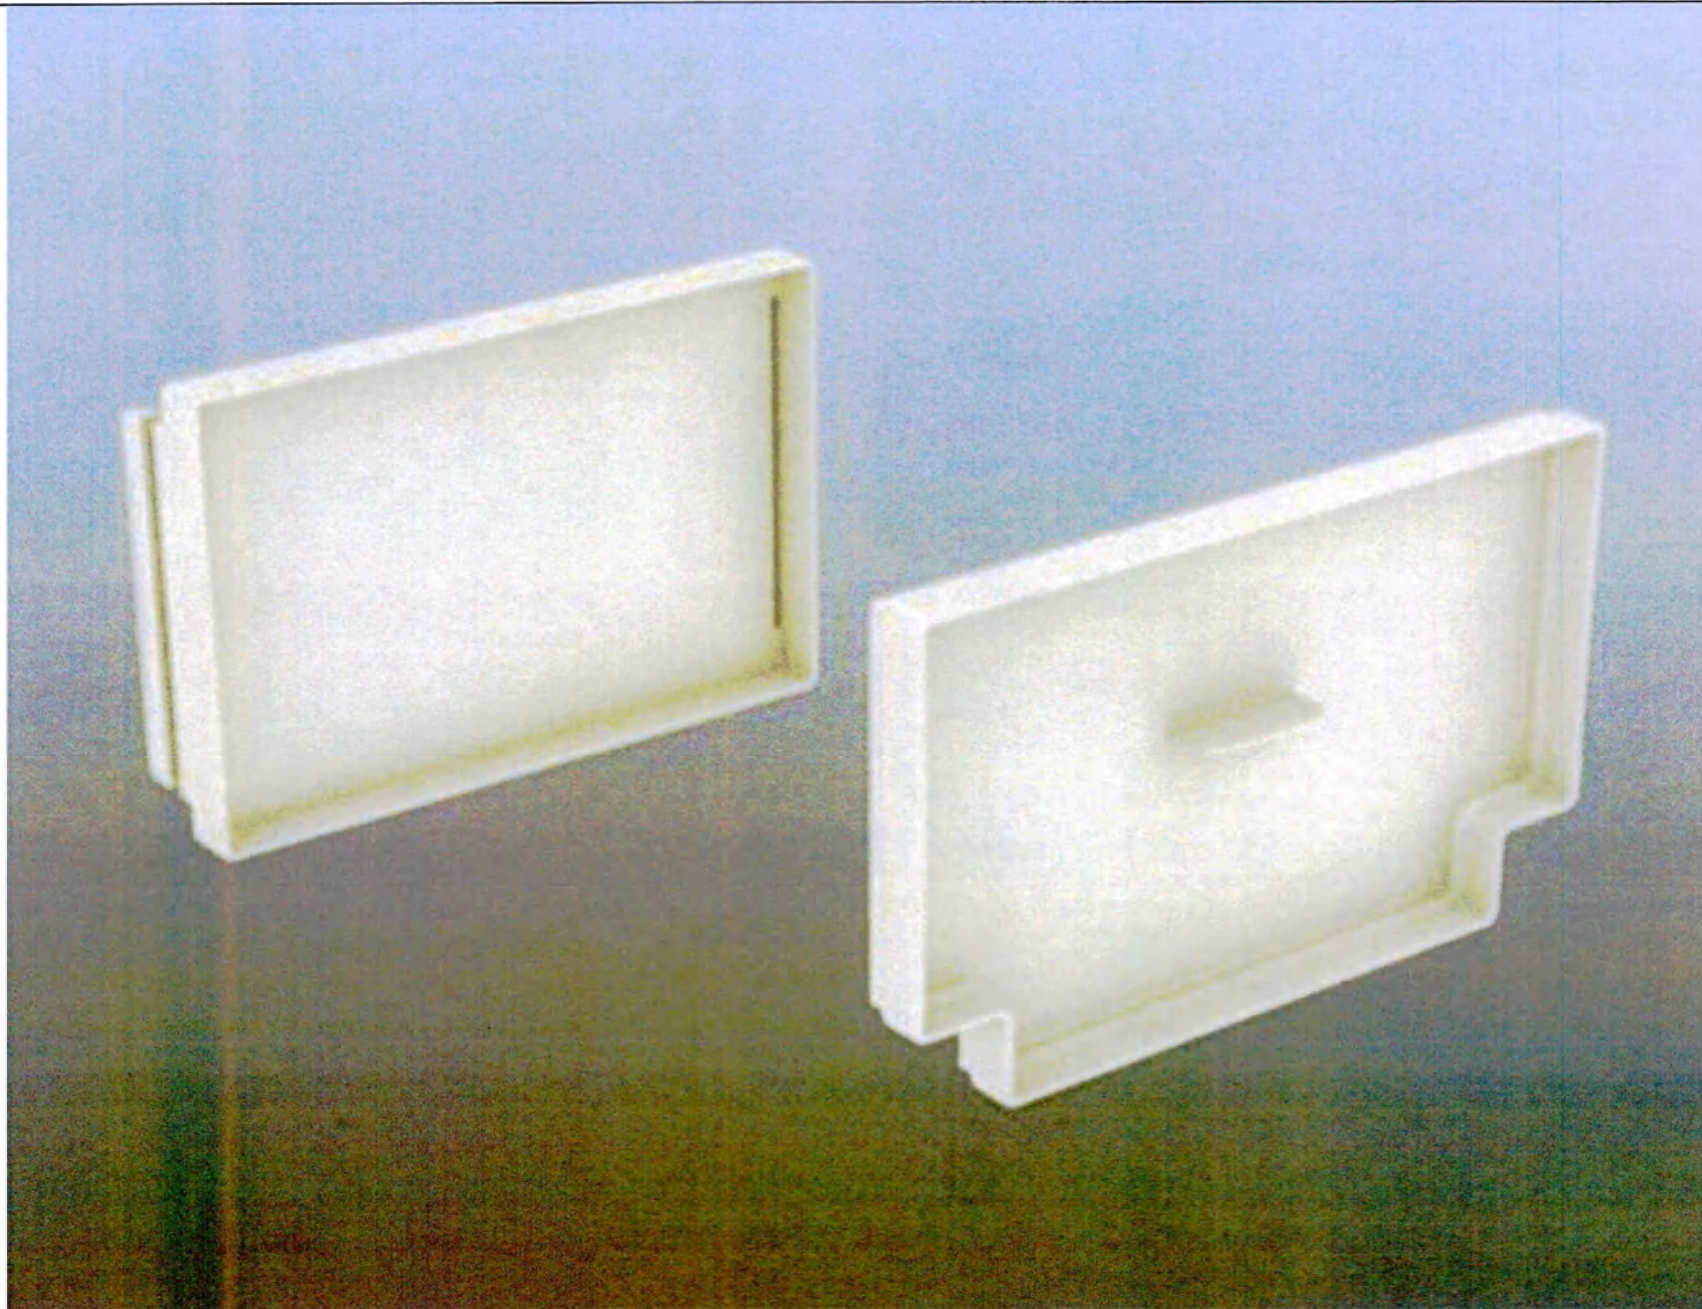


Принадлежности катушки для биопсии и визуализации молочных желез Breast BI: фиксирующие пластины (боковая/срединная)

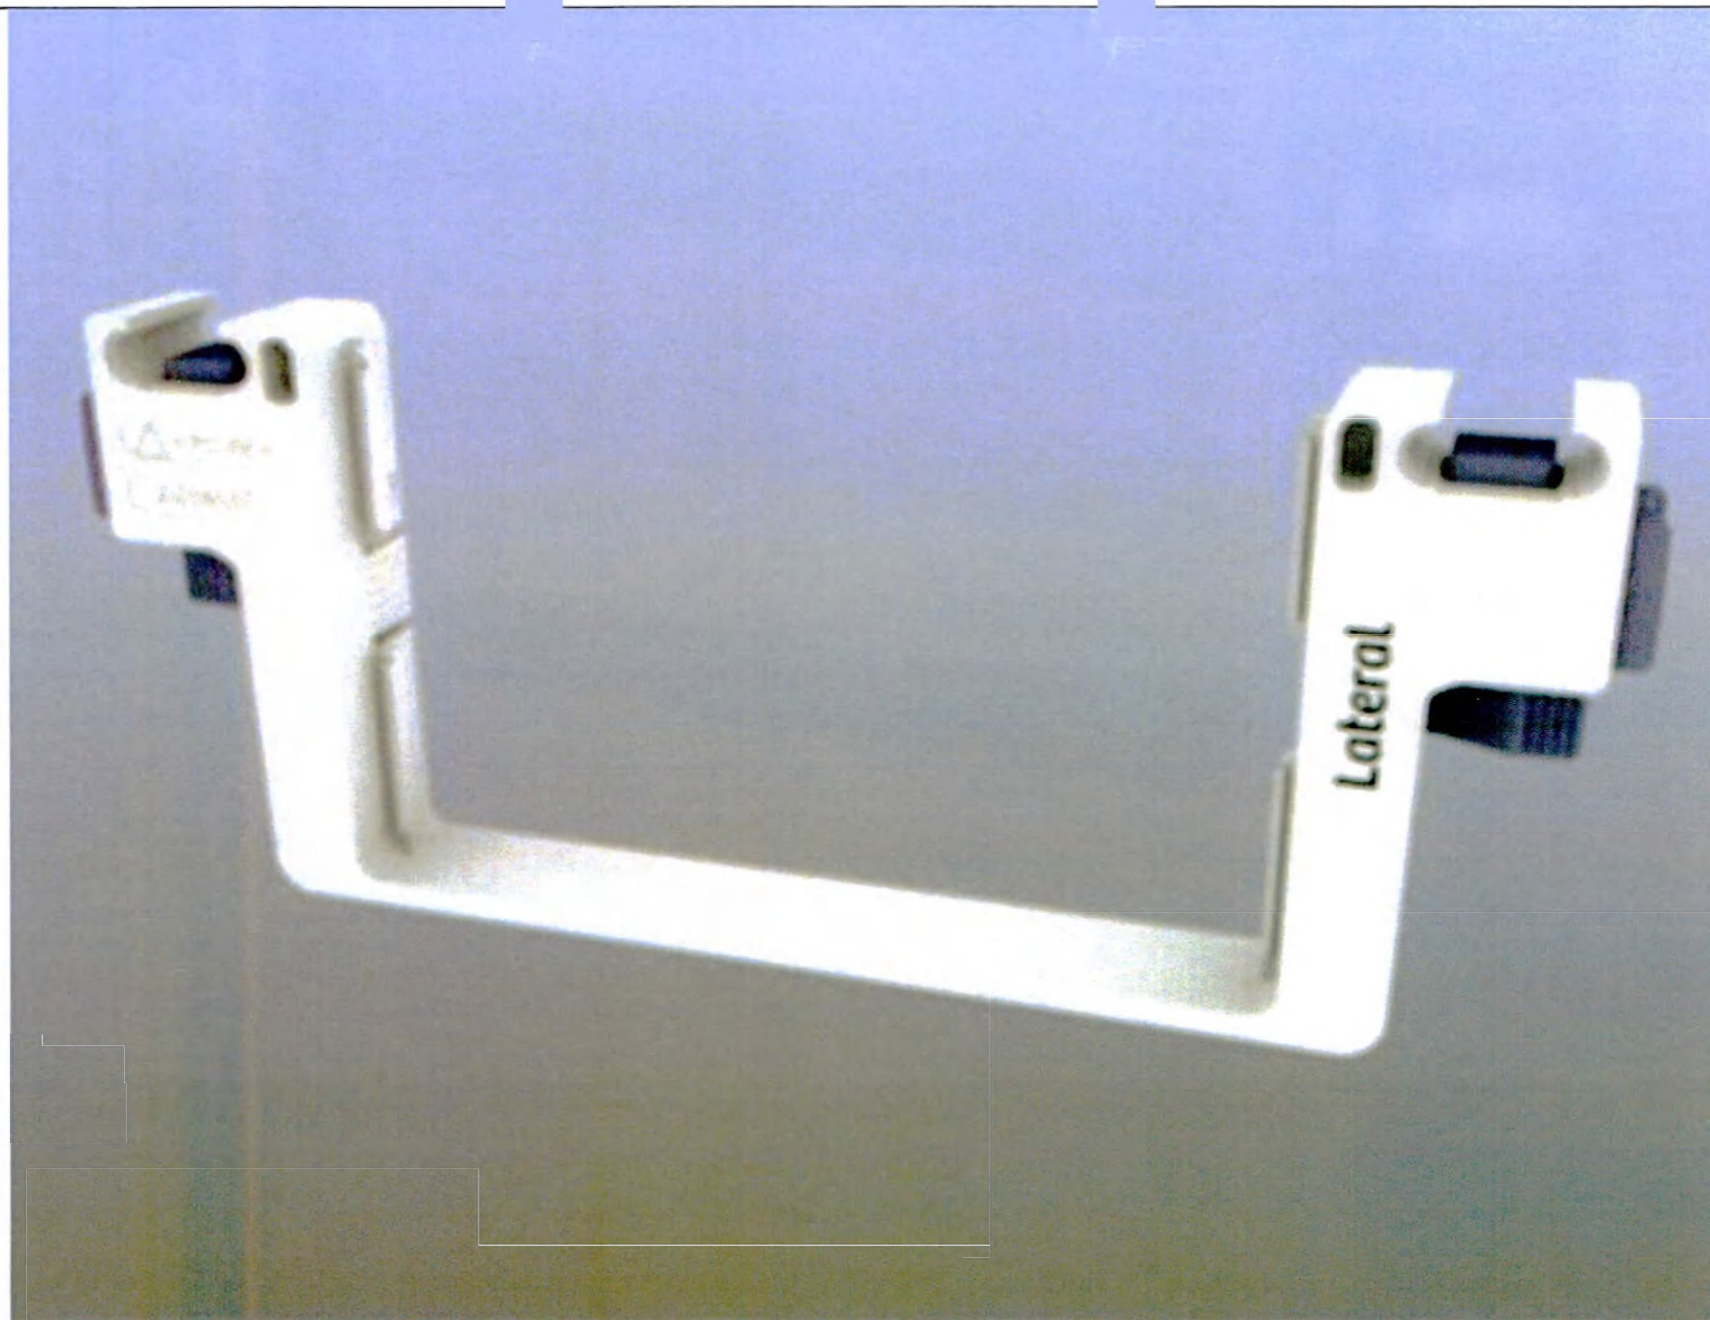


Принадлежности катушки для биопсии и визуализации молочных желез Breast BI: держатель рамы боковой

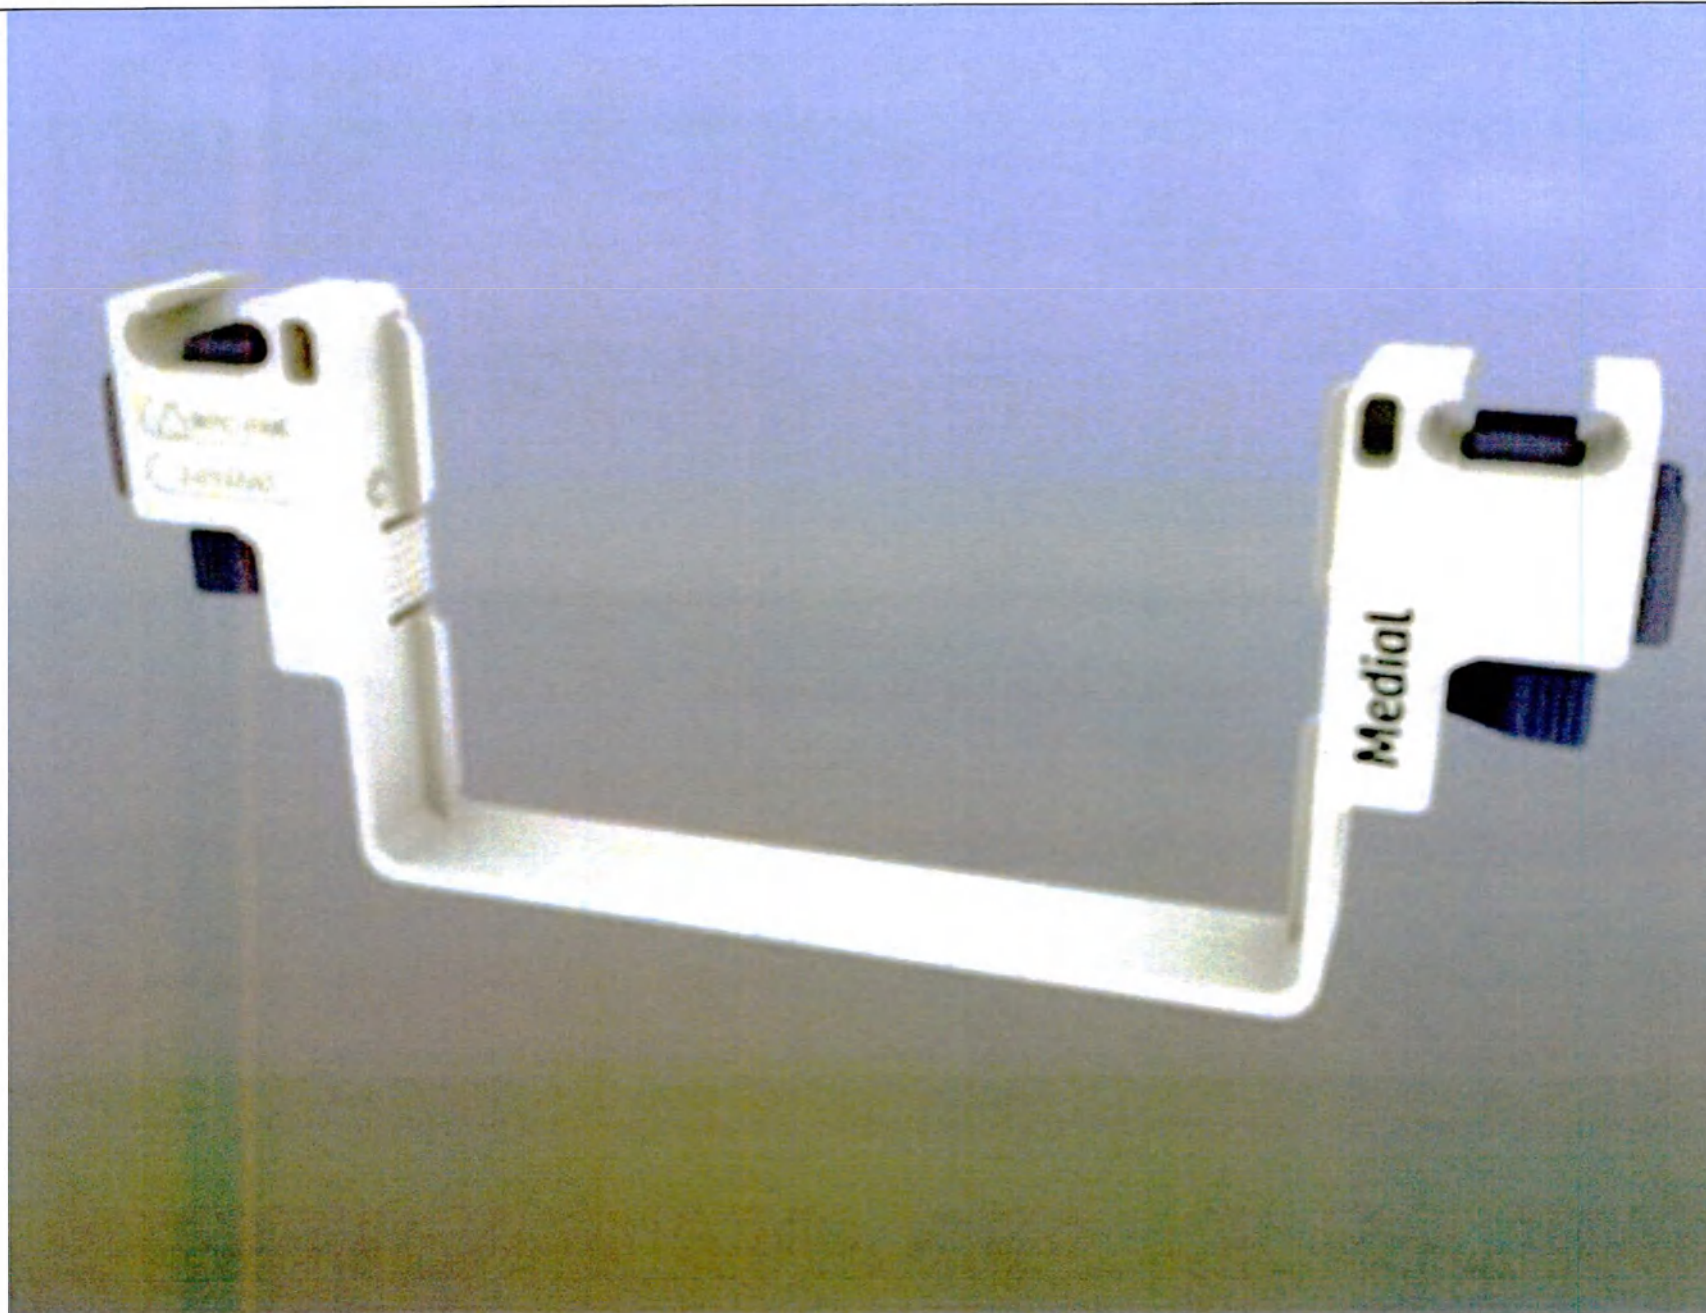

Принадлежности катушки для биопсии и визуализации молочных желез Breast BI: держатель рамы срединный

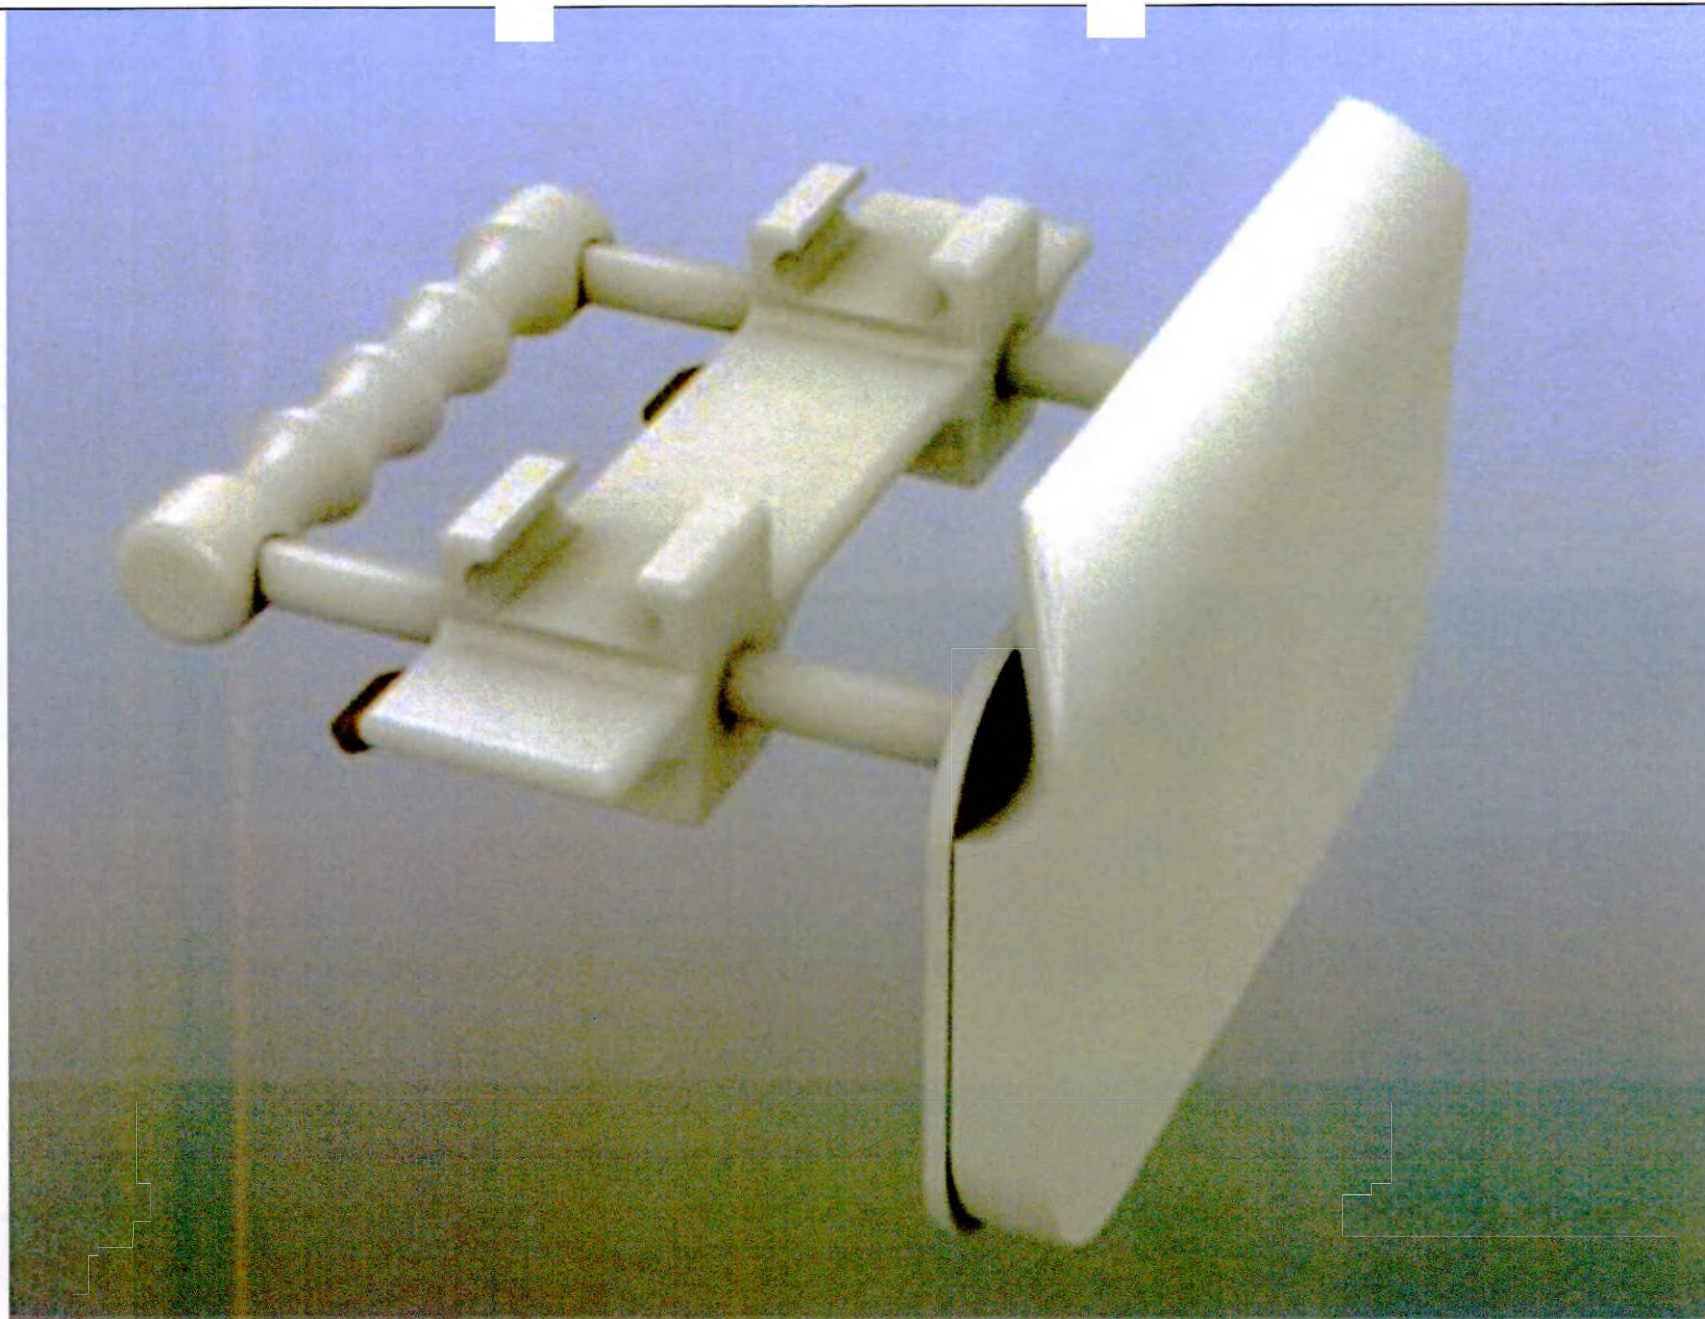

Принадлежности катушки для биопсии и визуализации молочных желез Breast BI: кранио-каудальное устройство фиксации (слитный элемент)

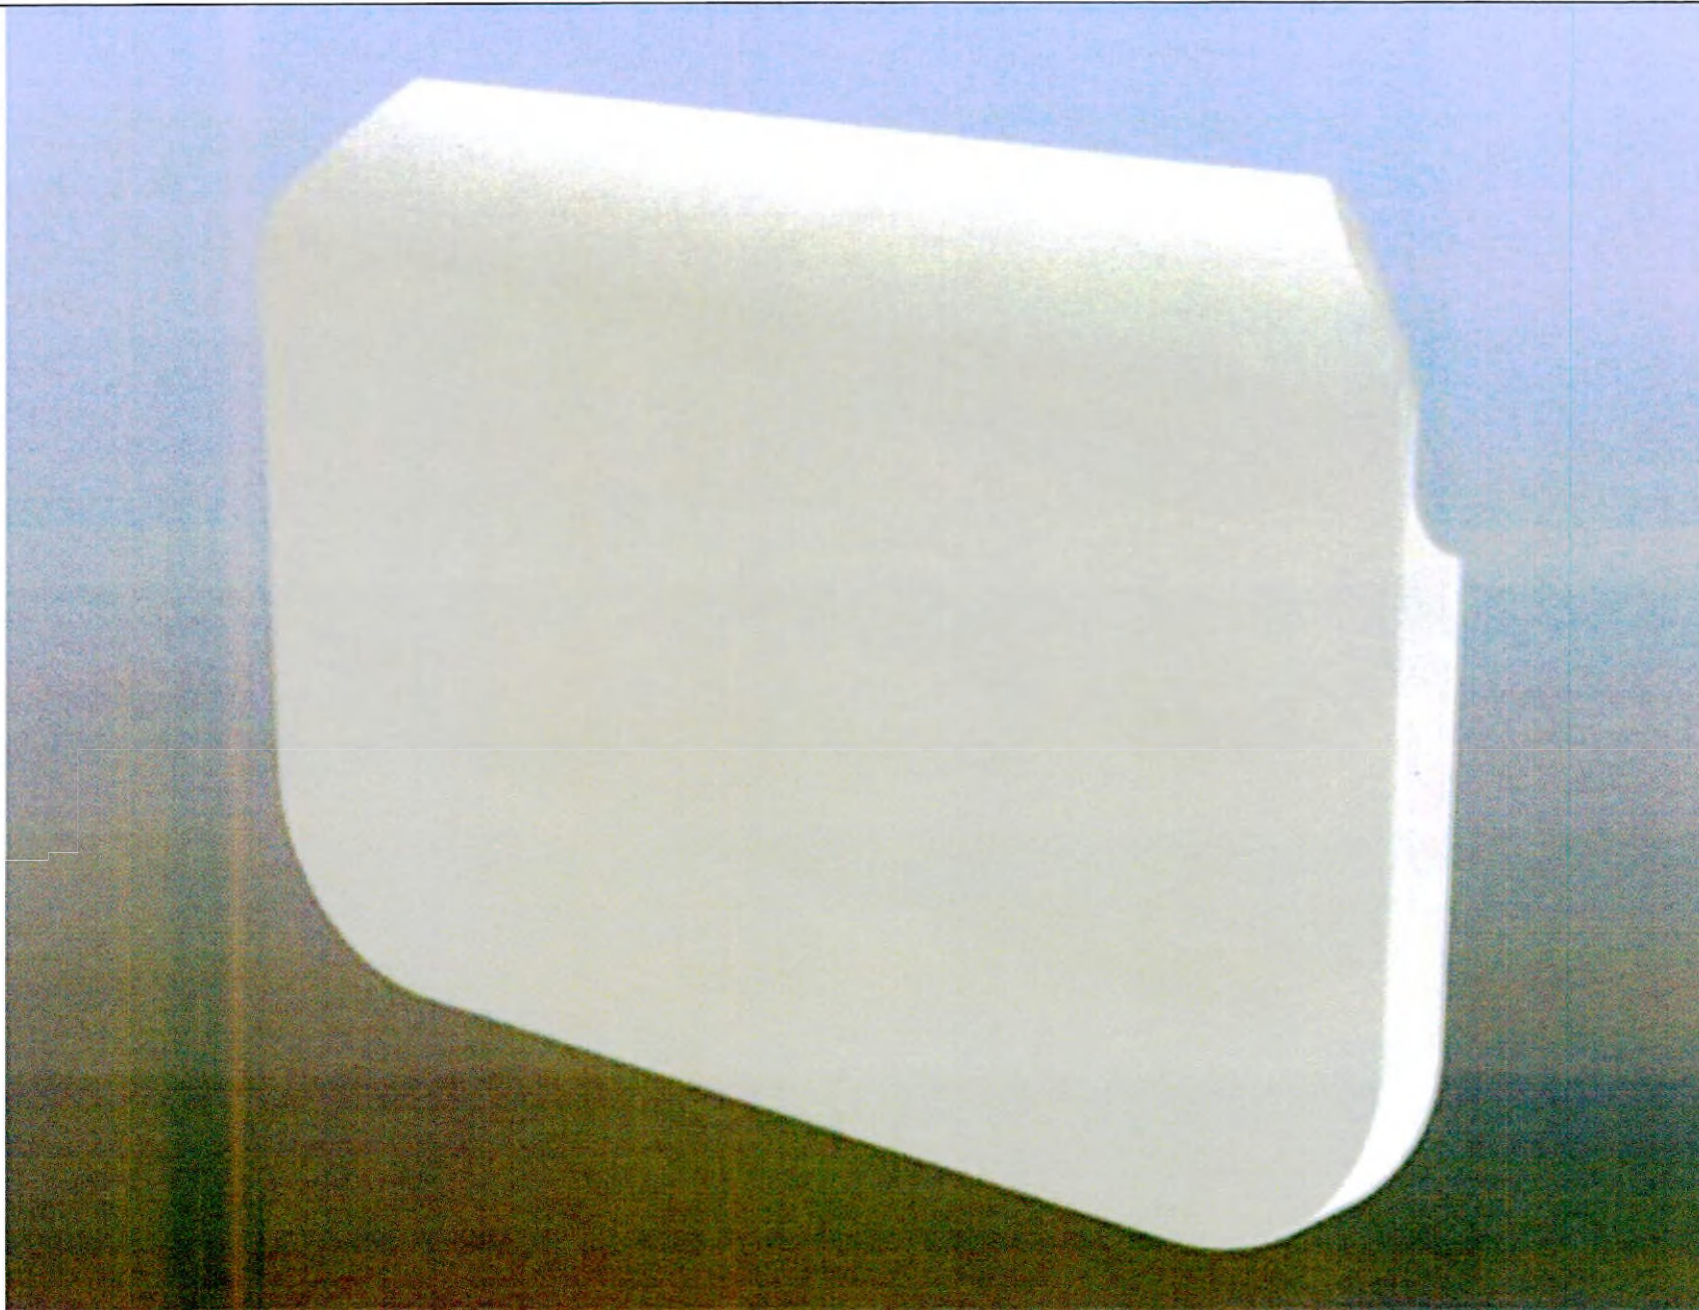

Принадлежности катушки для биопсии и визуализации молочных желез Breast BI: подкладка для кранио-каудального устройства фиксации




Катушки гибкие BioMatrix Contour L



Катушки гибкие Contour M




Катушки гибкие Contour S

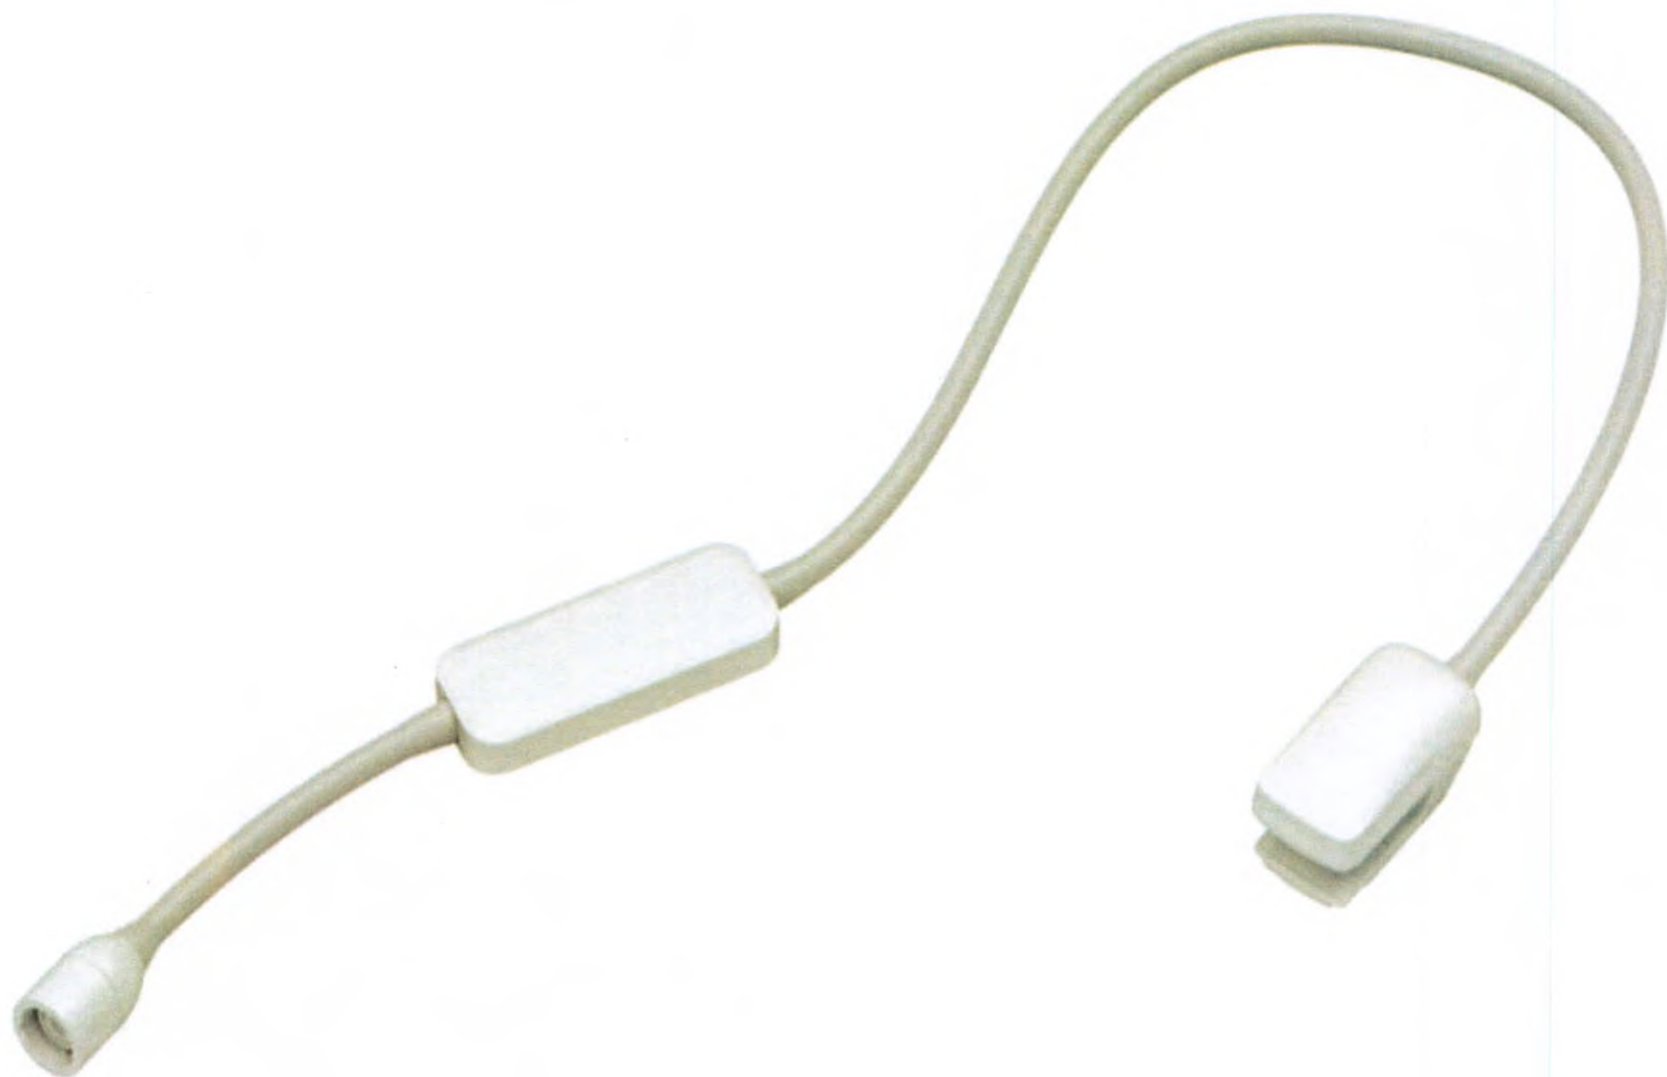

Переходники для подключения гибких катушек




Камеры для видеонаблюдения за пациентом

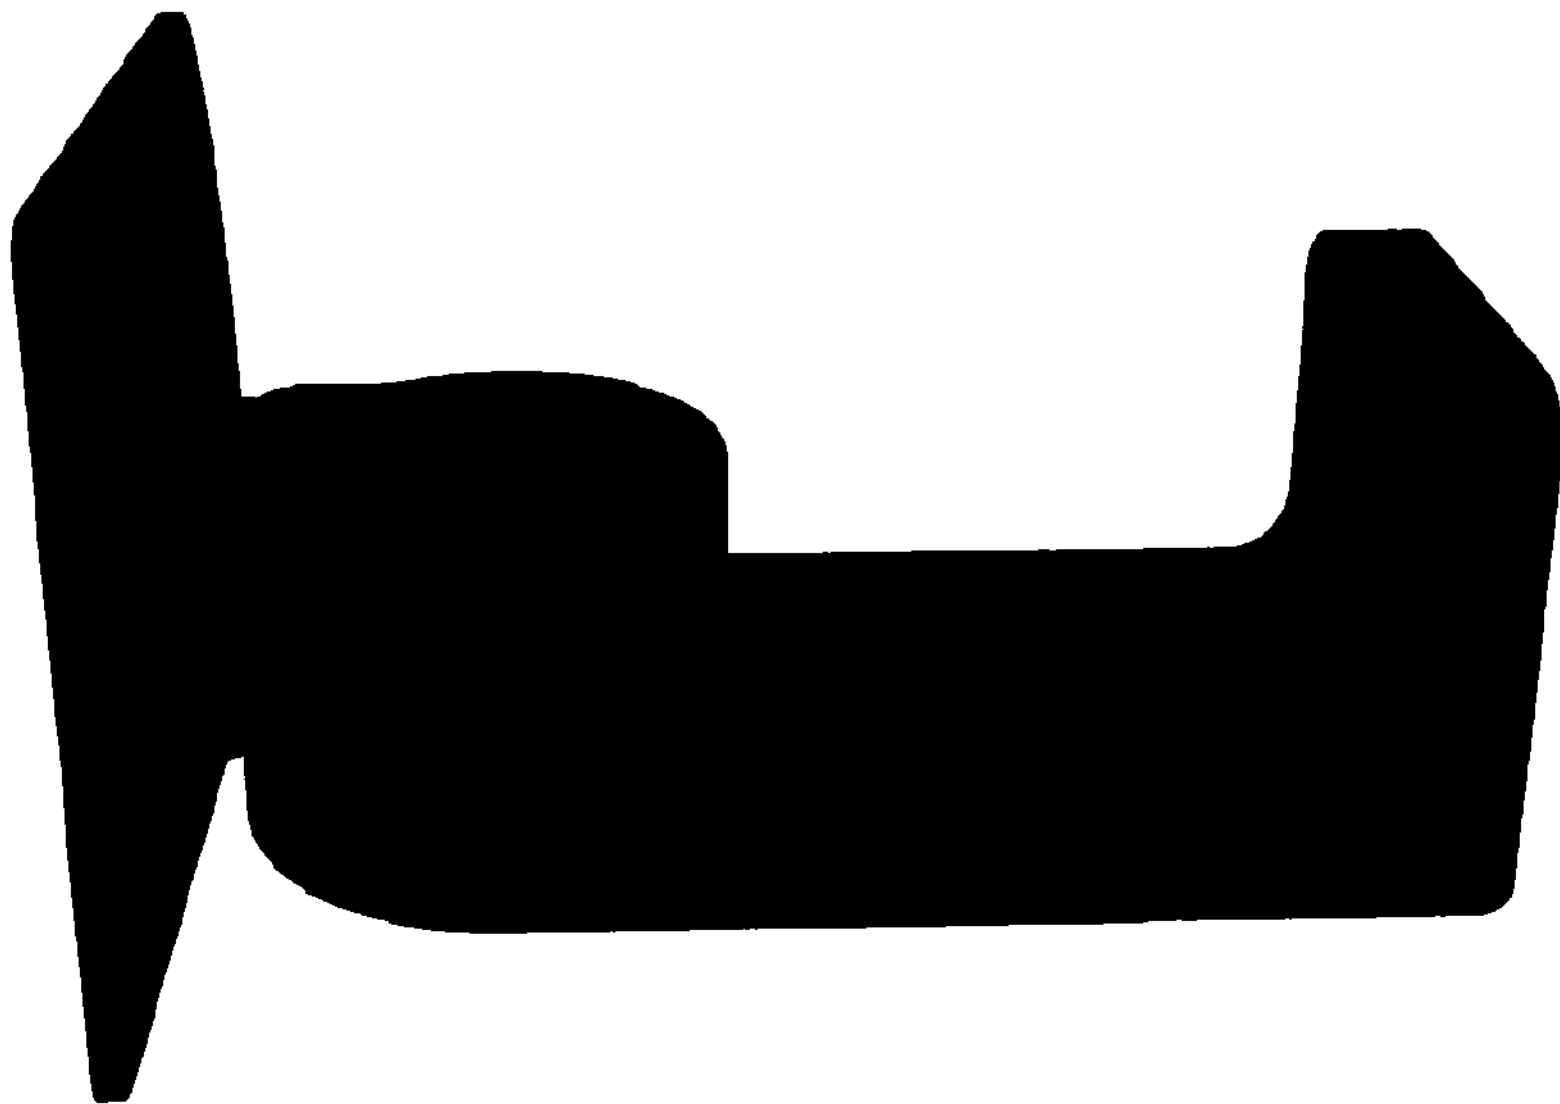


Кронштейны крепления камеры для видеонаблюдения за пациентом или монитора




Мониторы жидкокристаллические для удаленного наблюдения за пациентом

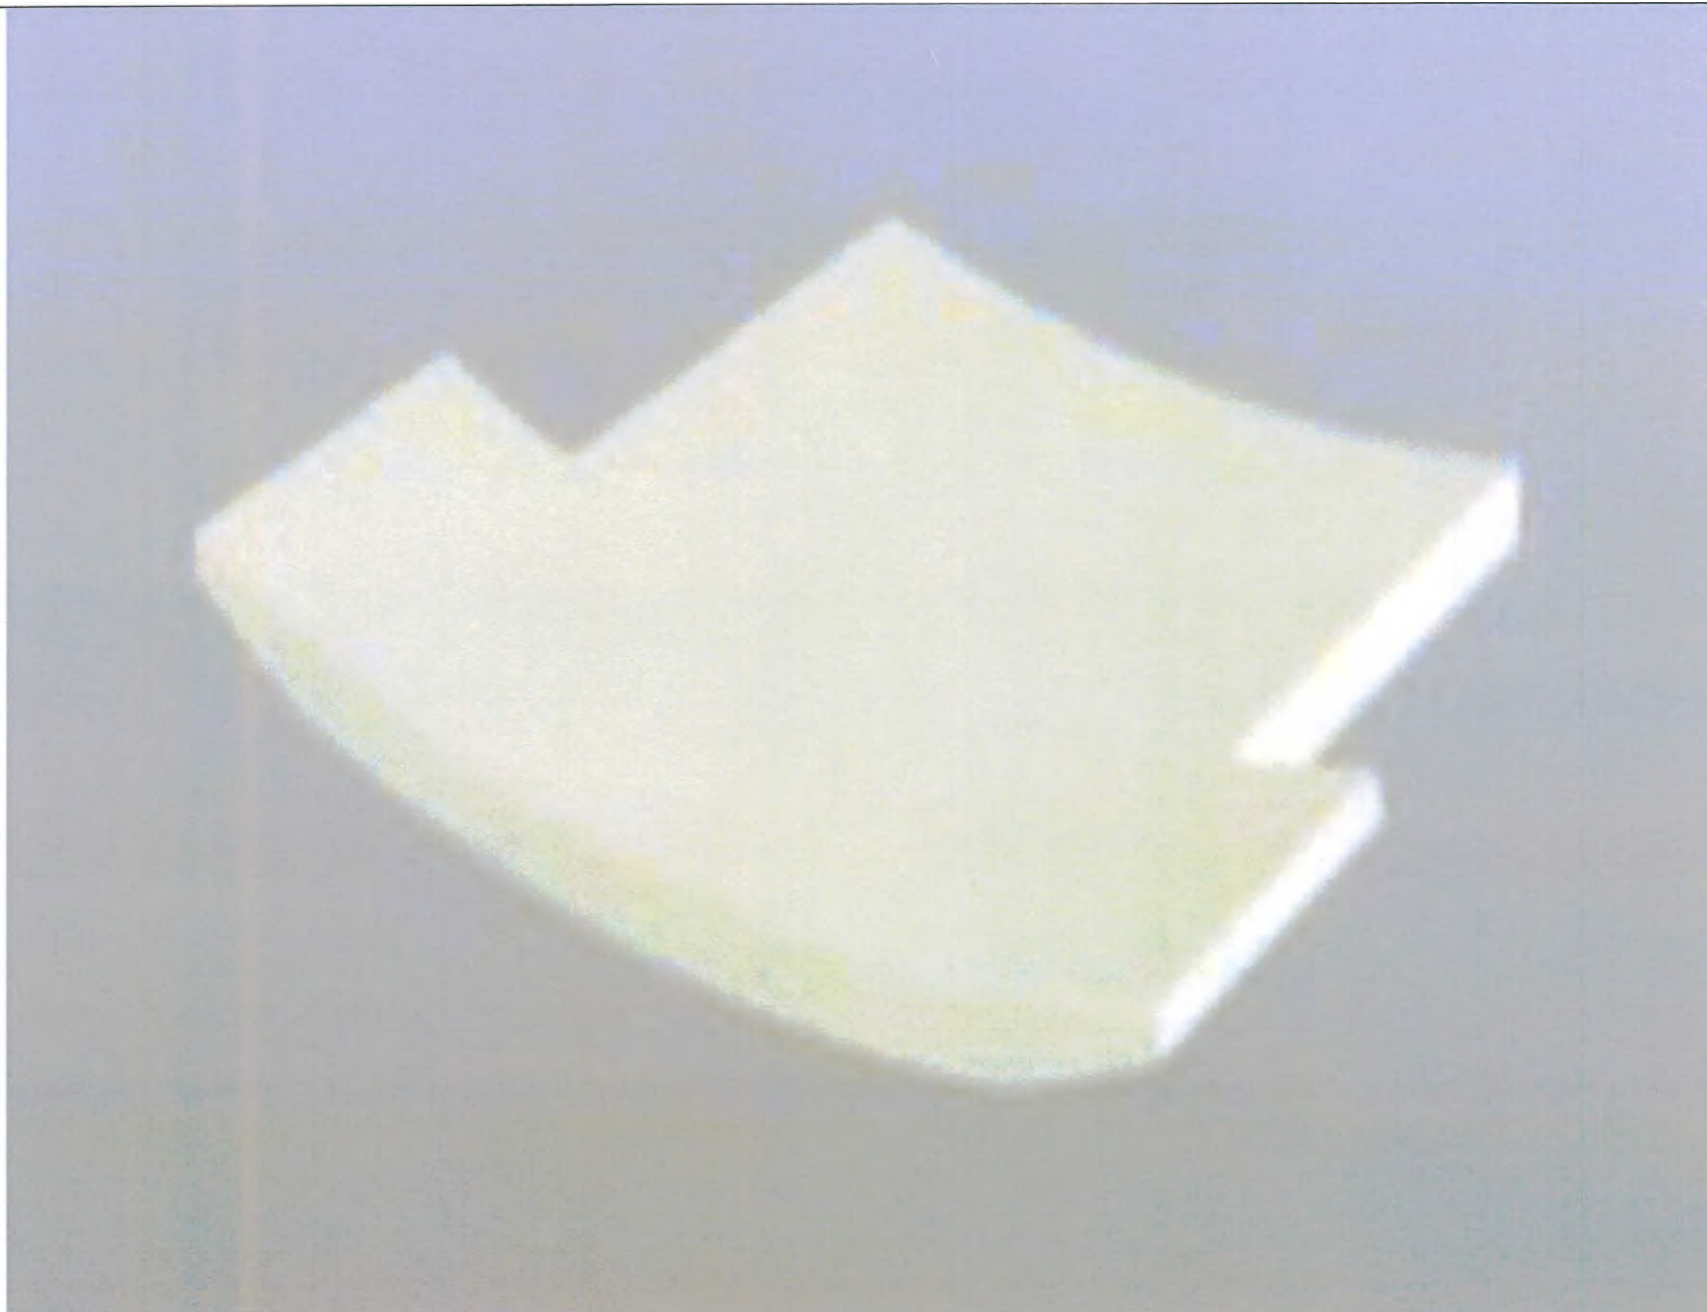


Подушки и средства позиционирования пациента: подкладка для головной части

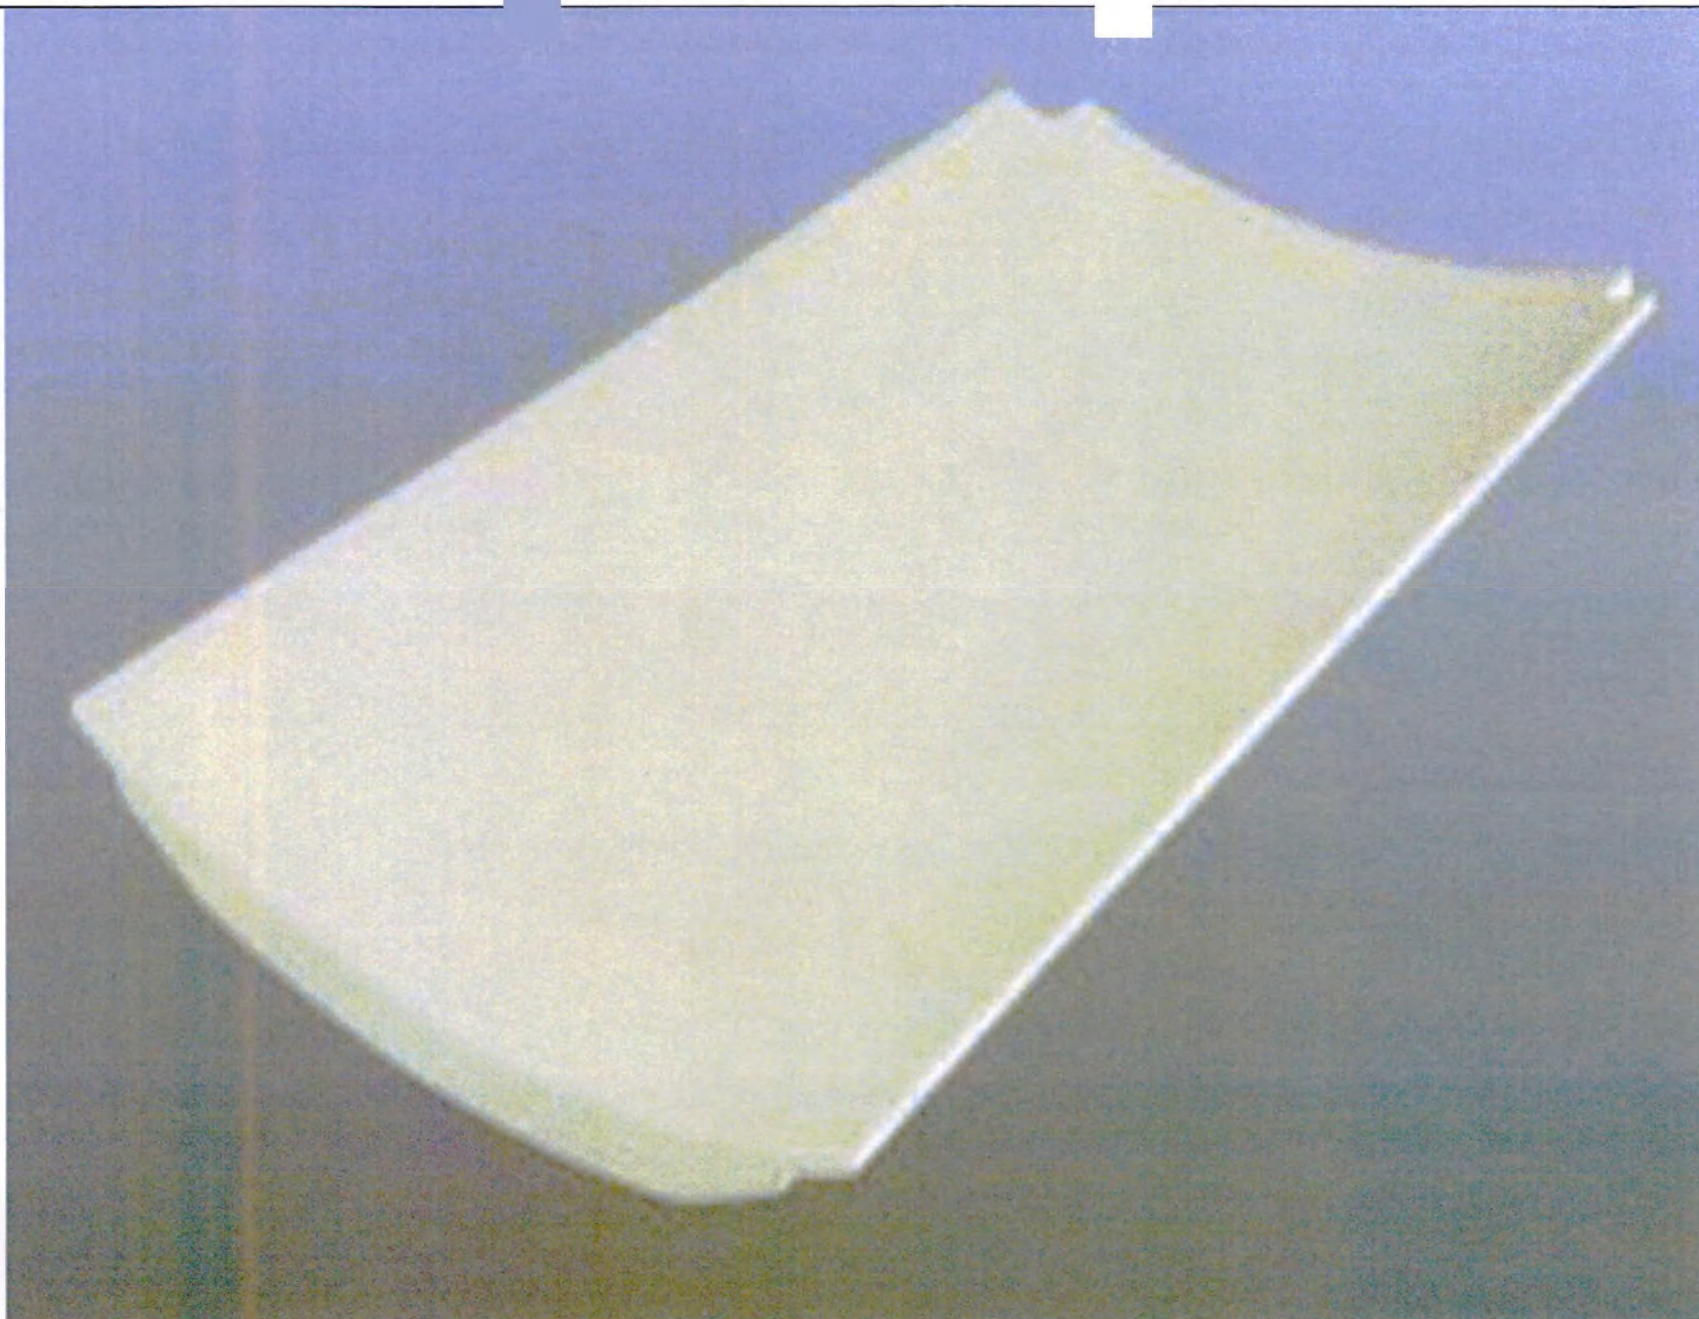

Подушки и средства позиционирования пациента: подкладки для тела

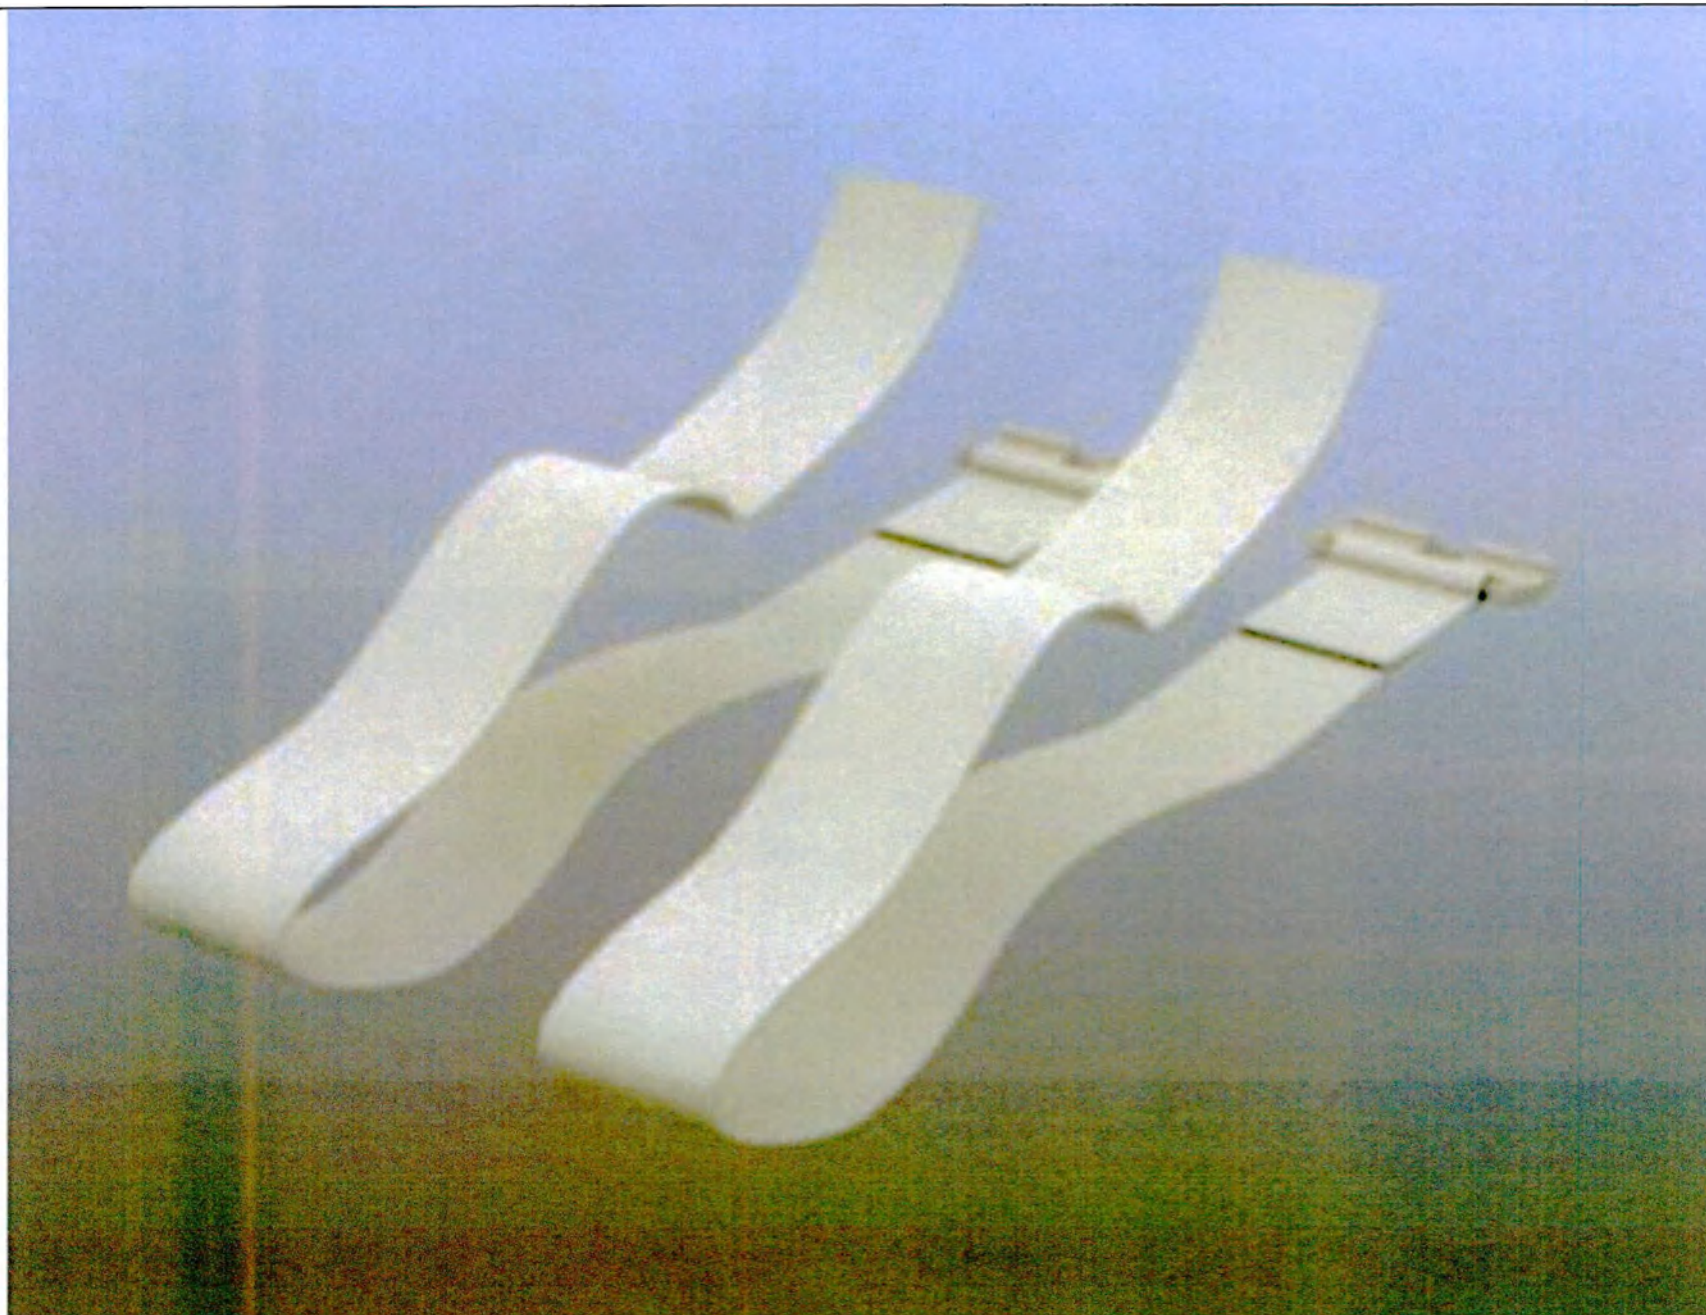


Подушки и средства позиционирования пациента: мягкие ремешки

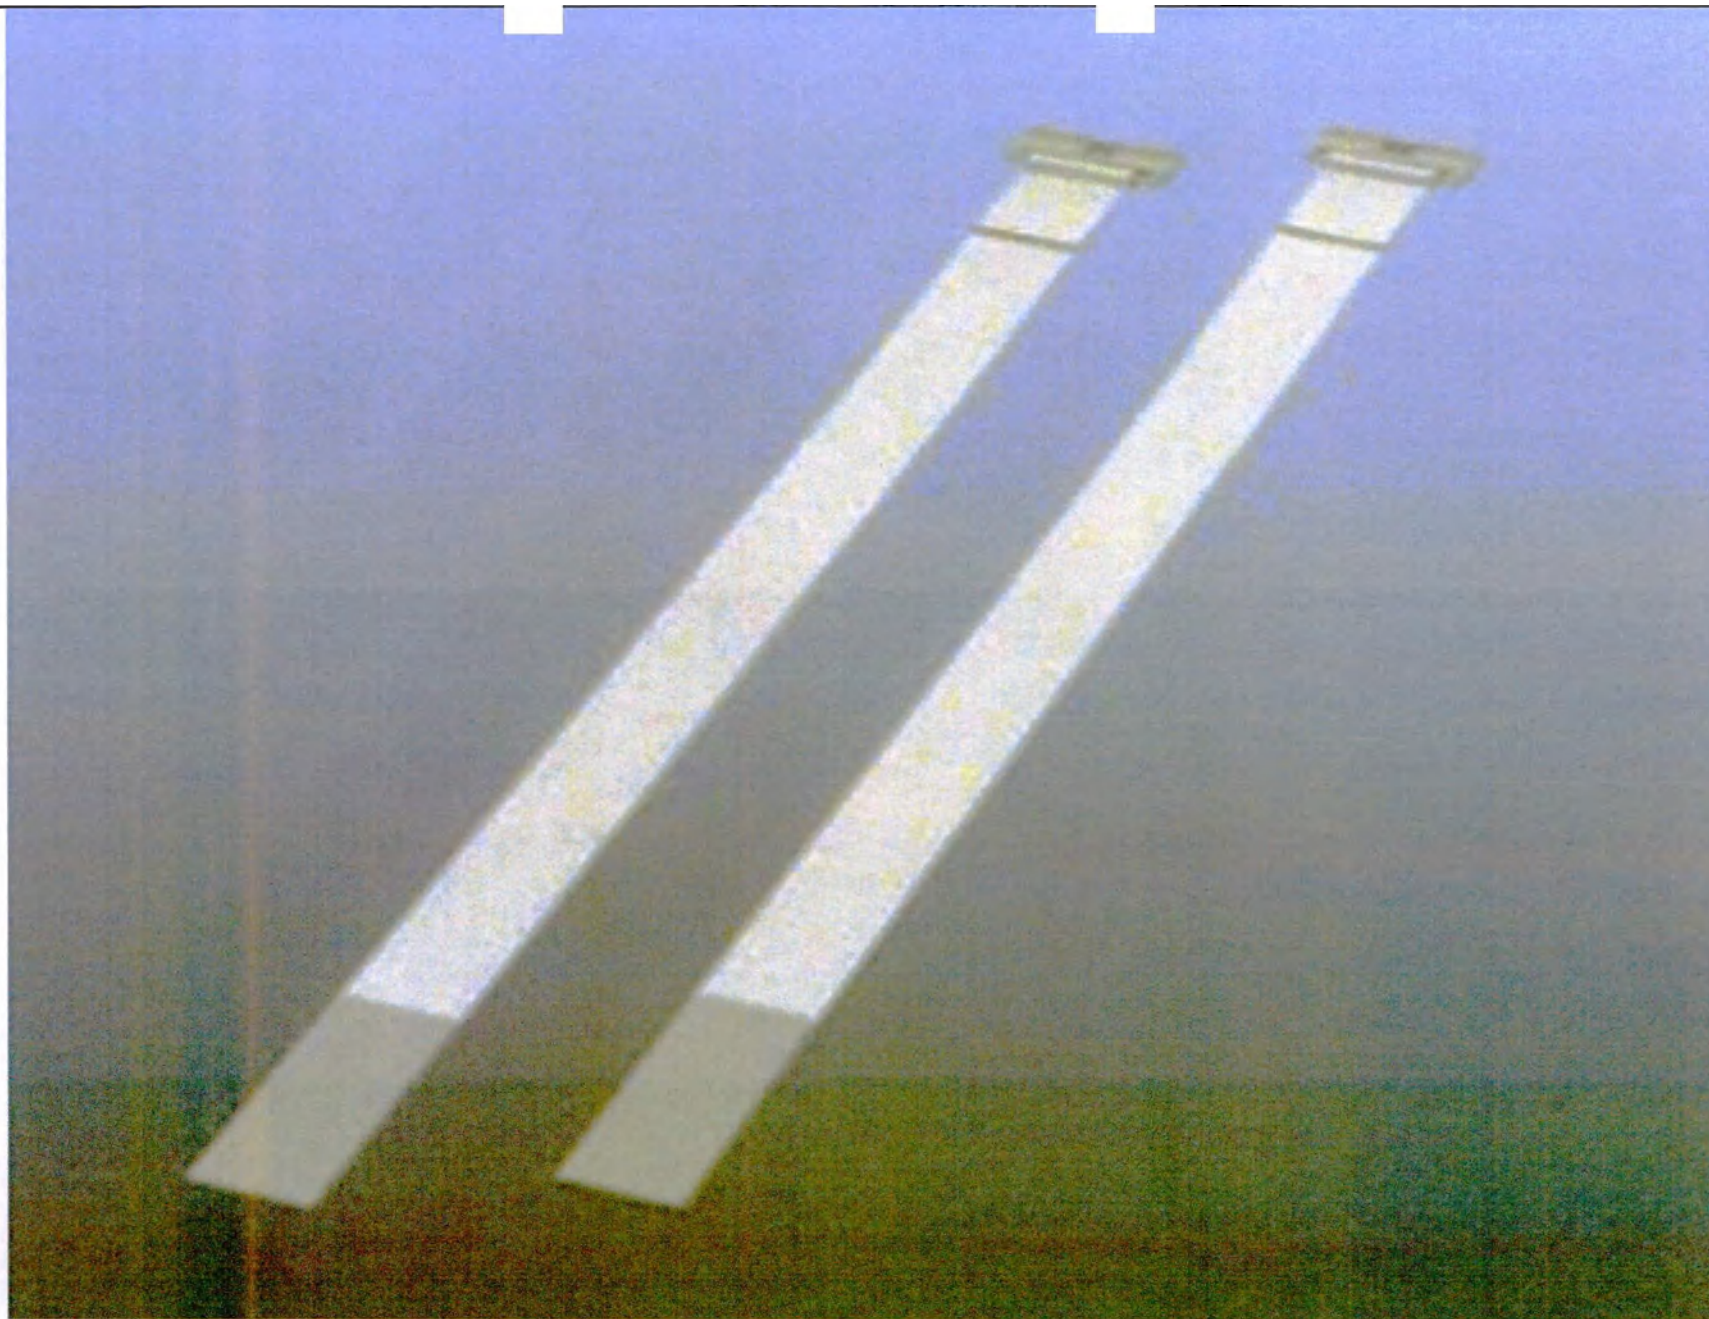


Подушки и средства позиционирования пациента: ремни




Подушки и средства позиционирования пациента: узкополосные пояса

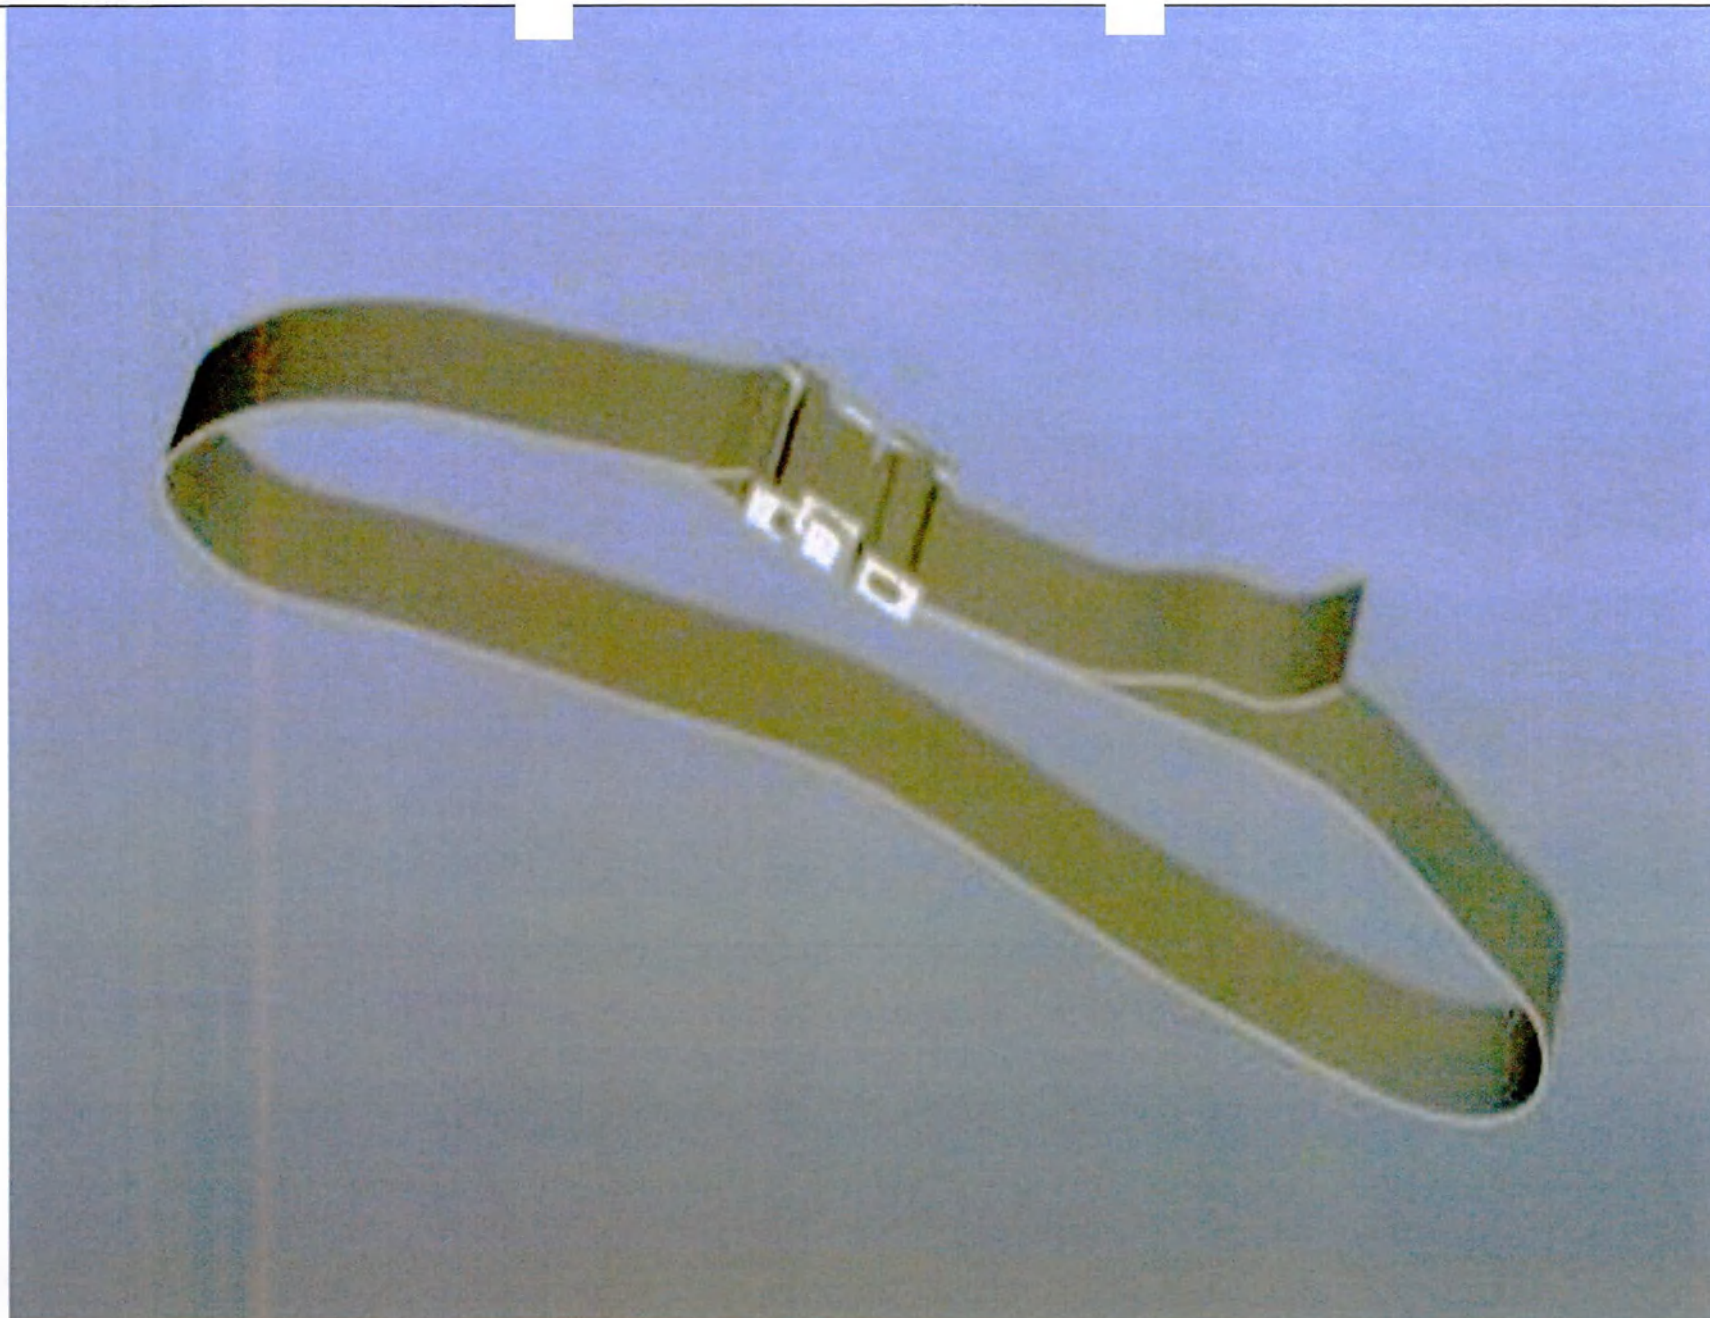


Подушки и средства позиционирования пациента: пояс 1500

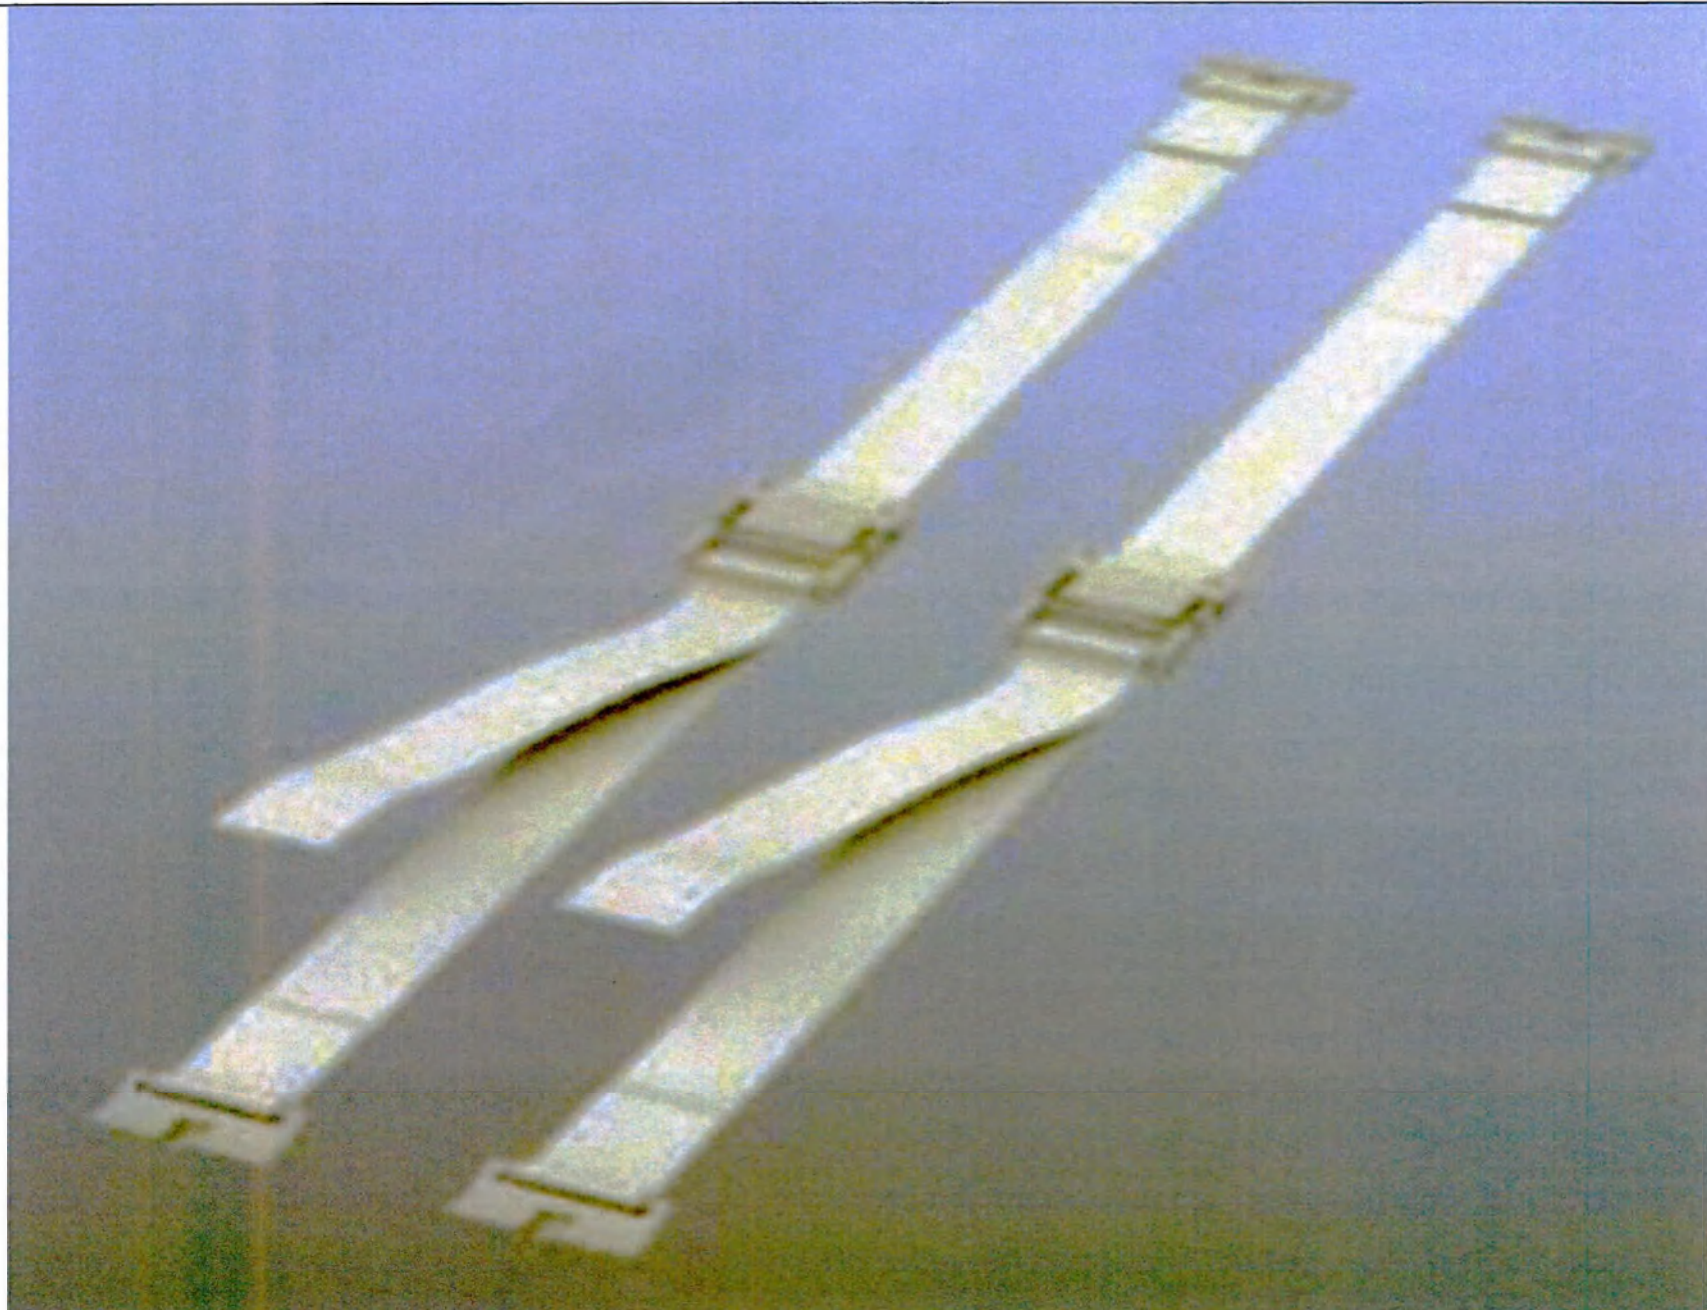


Подушки и средства позиционирования пациента: ремни на пояс

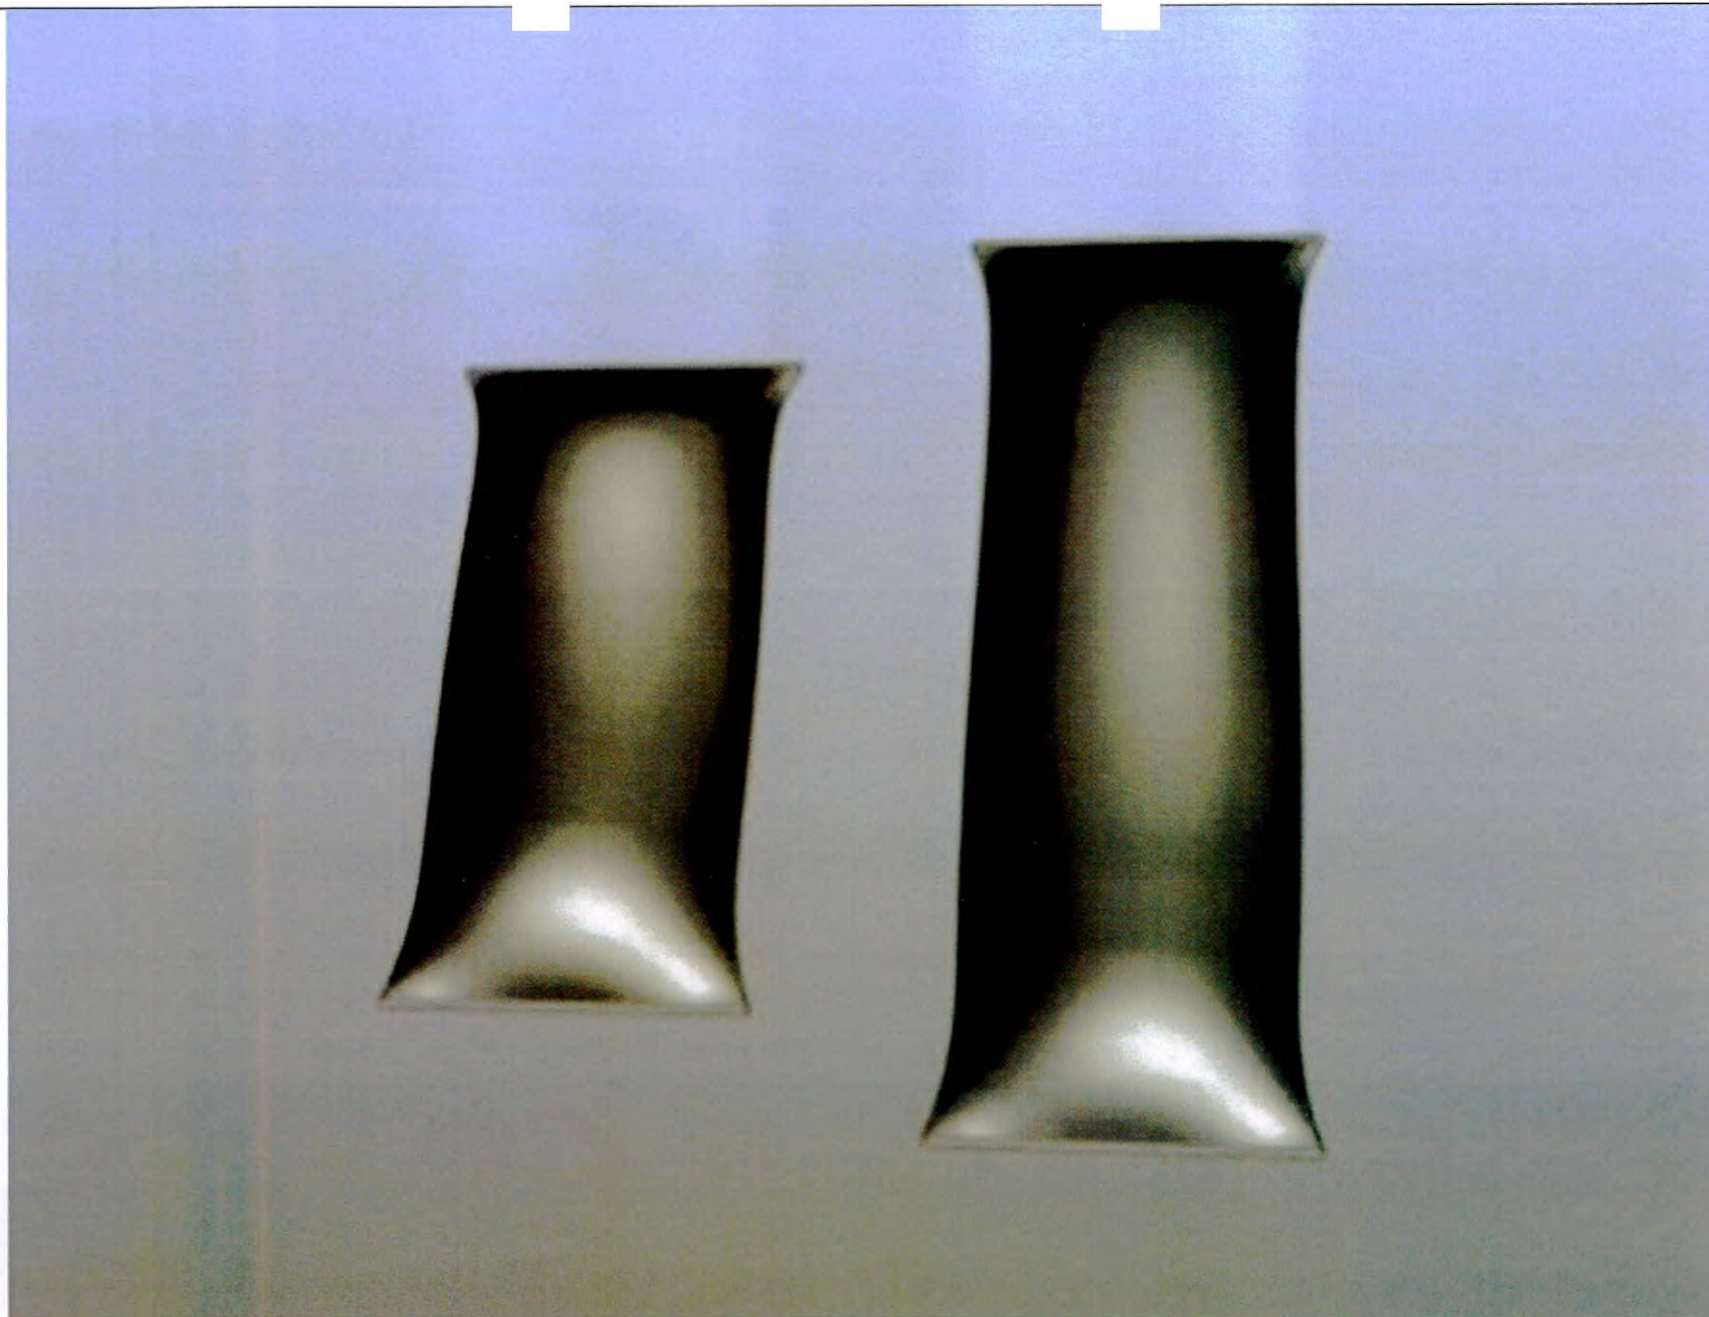


Подушки и средства позиционирования пациента: мешочки с песком

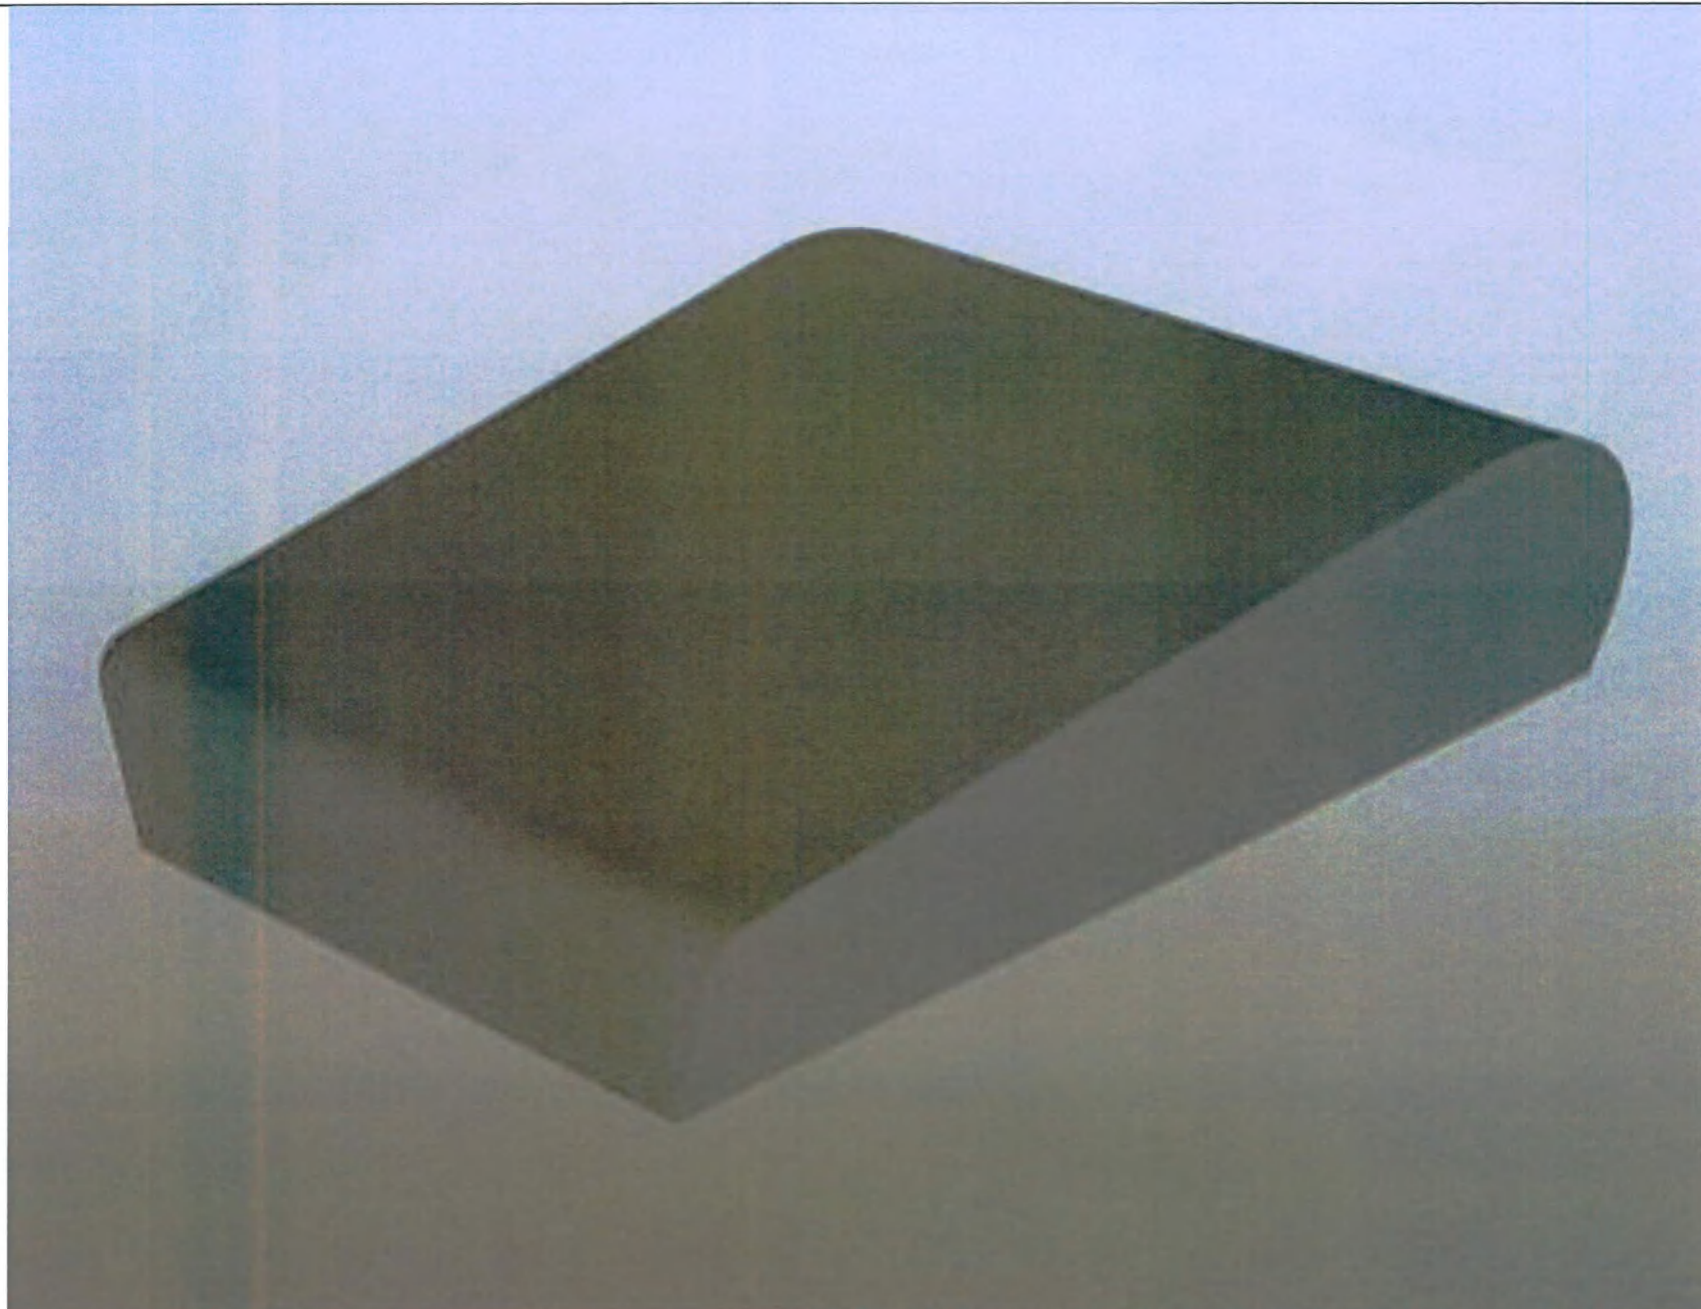


Набор средств позиционирования пациента: клин для колена

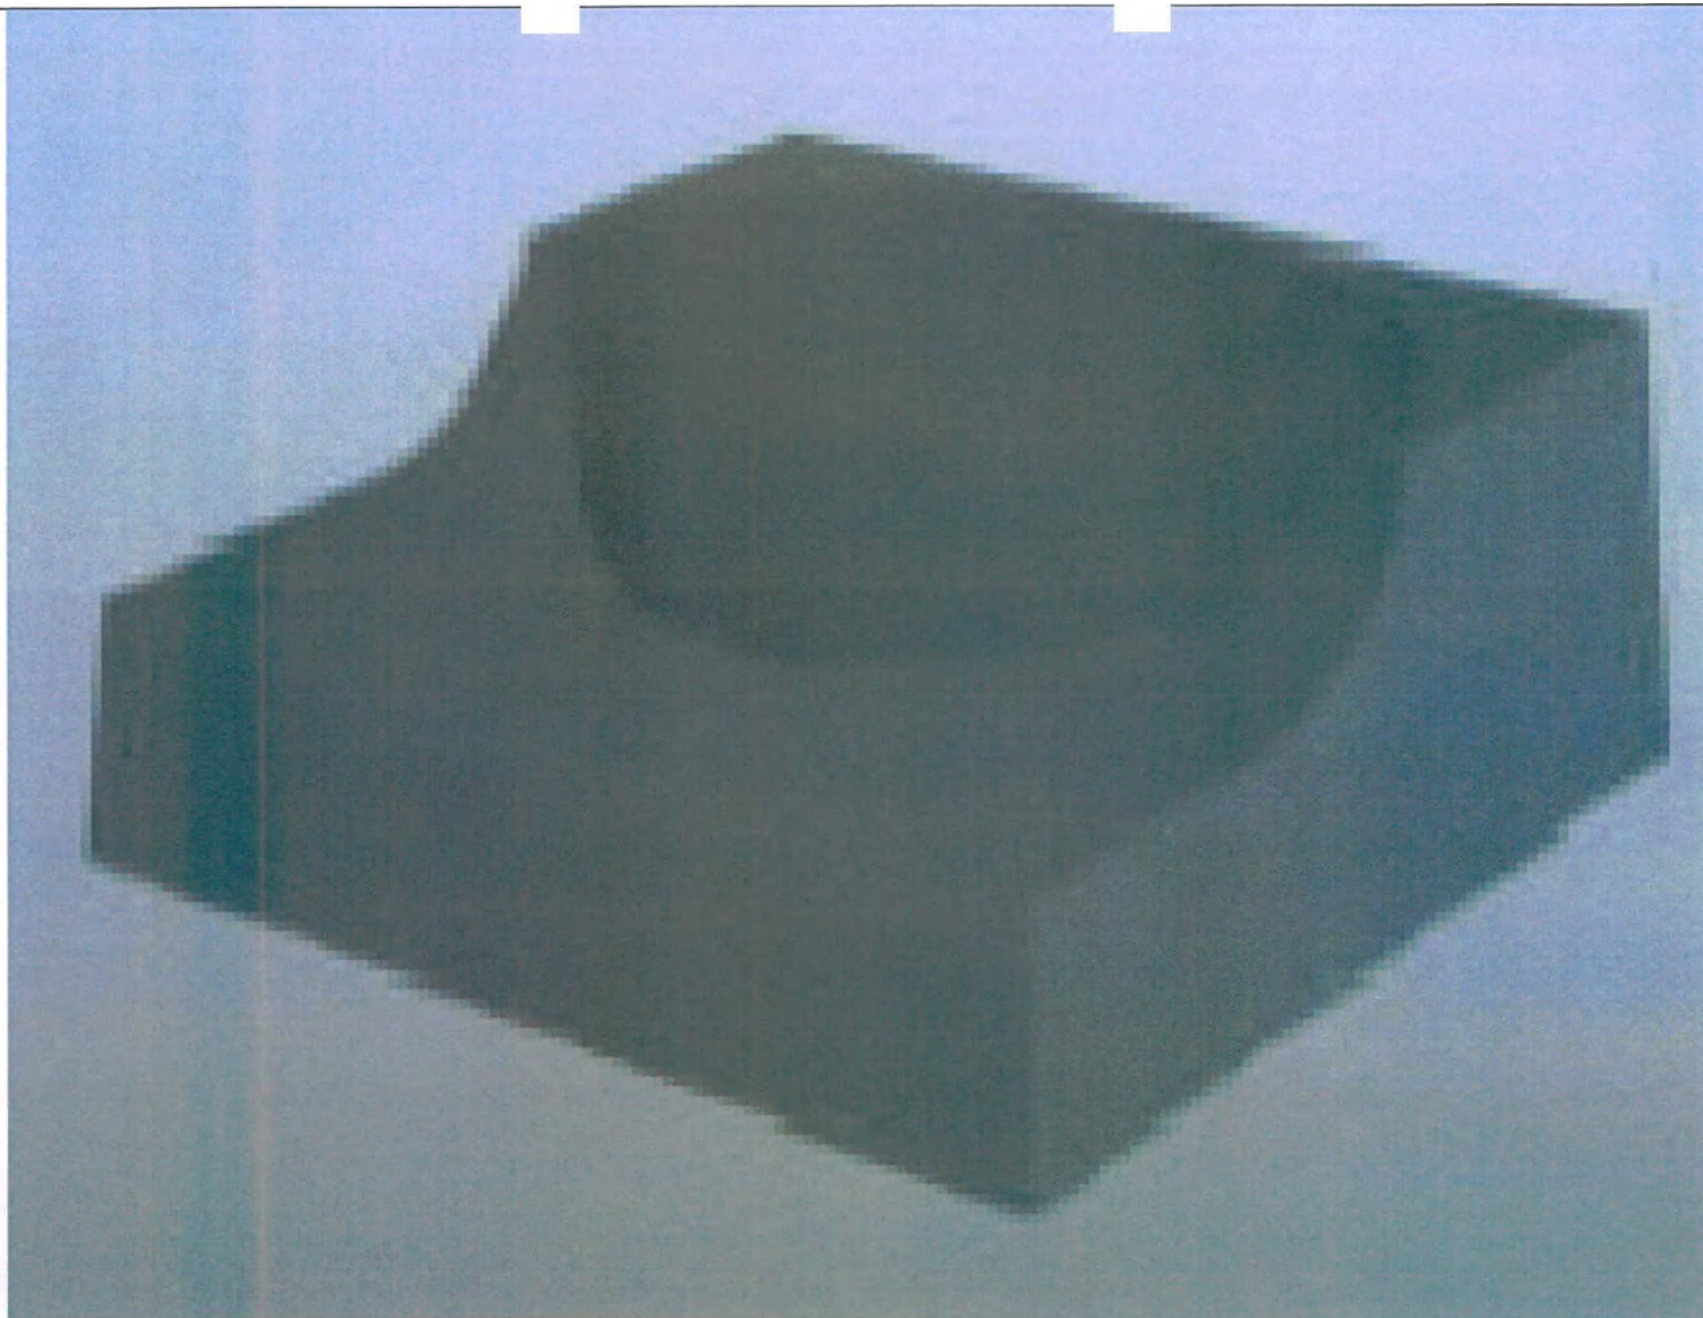


Набор средств позиционирования пациента: затылочный подголовник

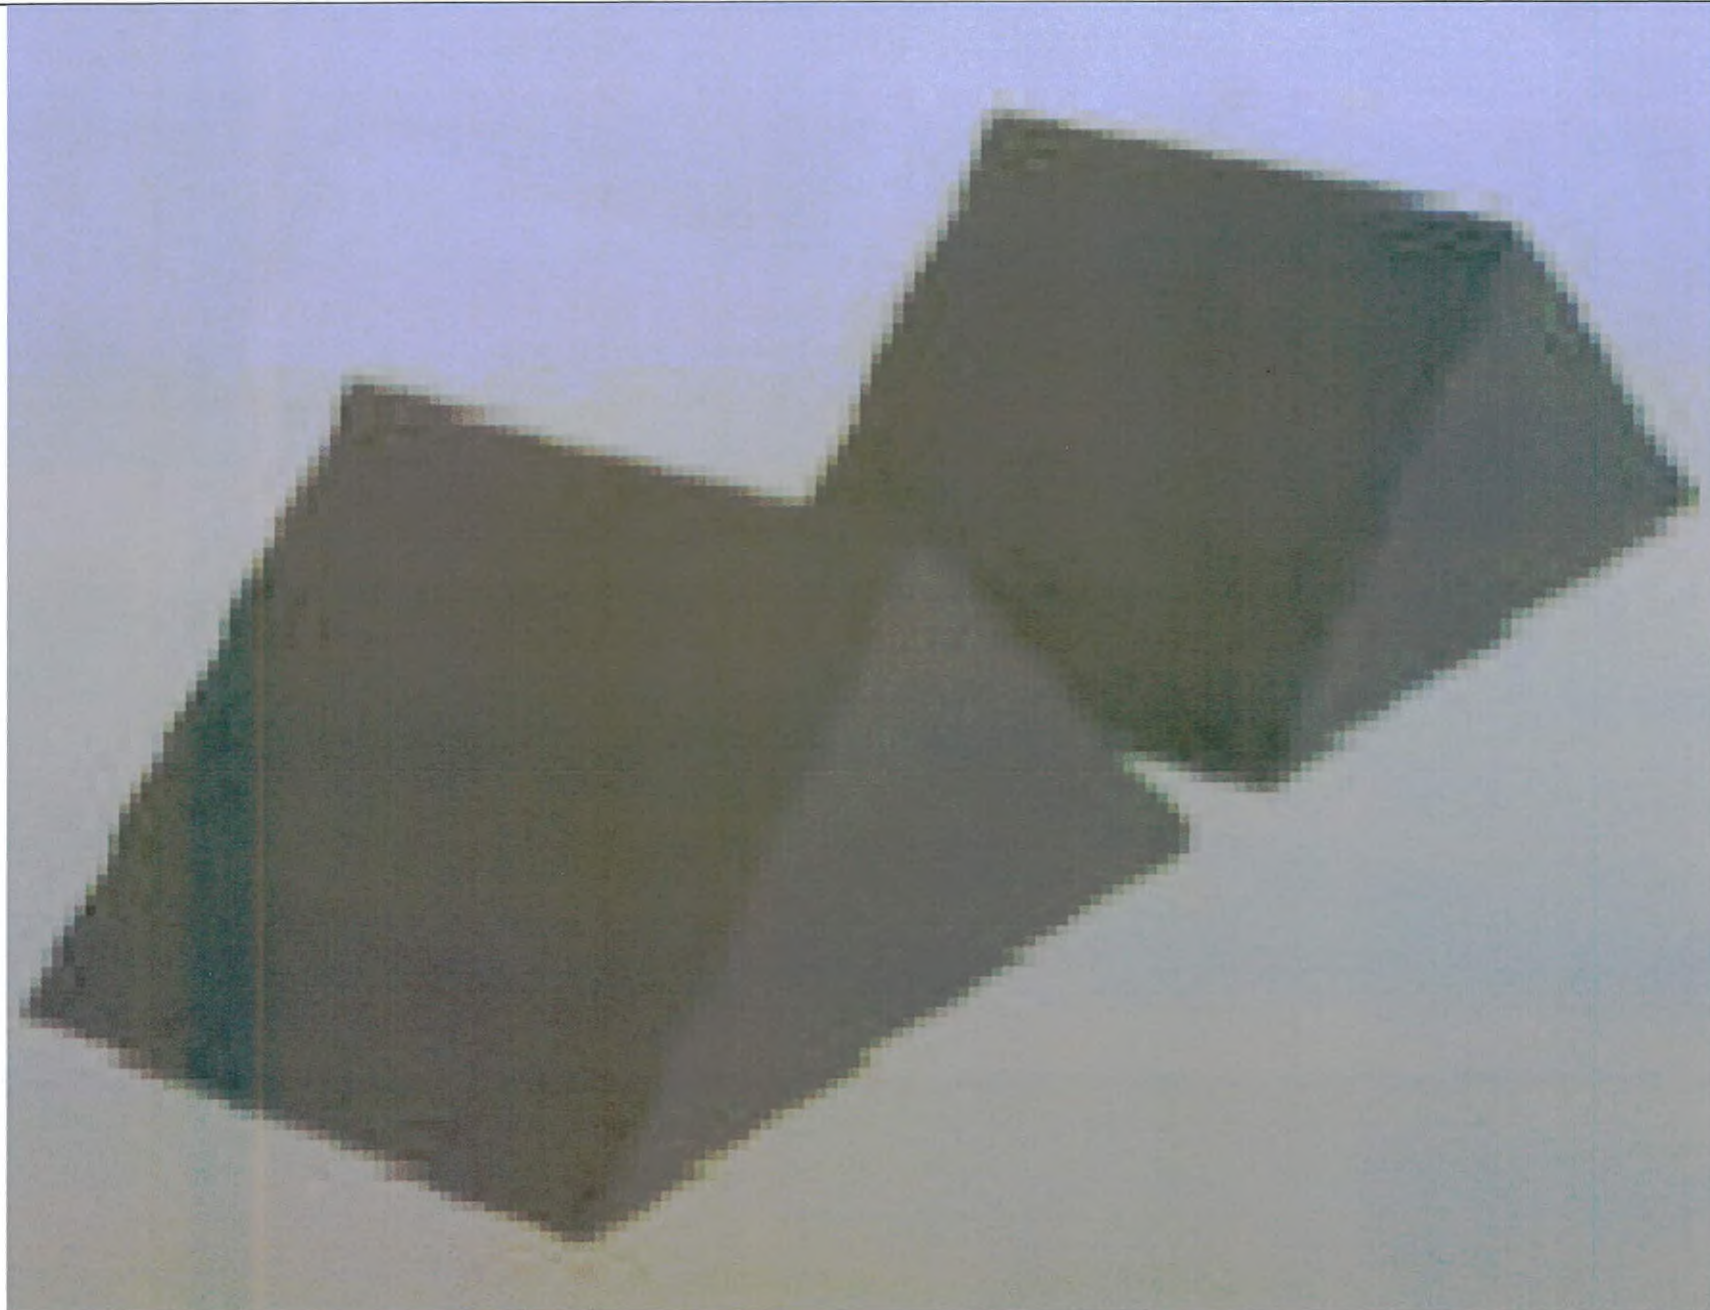


Набор средств позиционирования пациента: треугольники большие

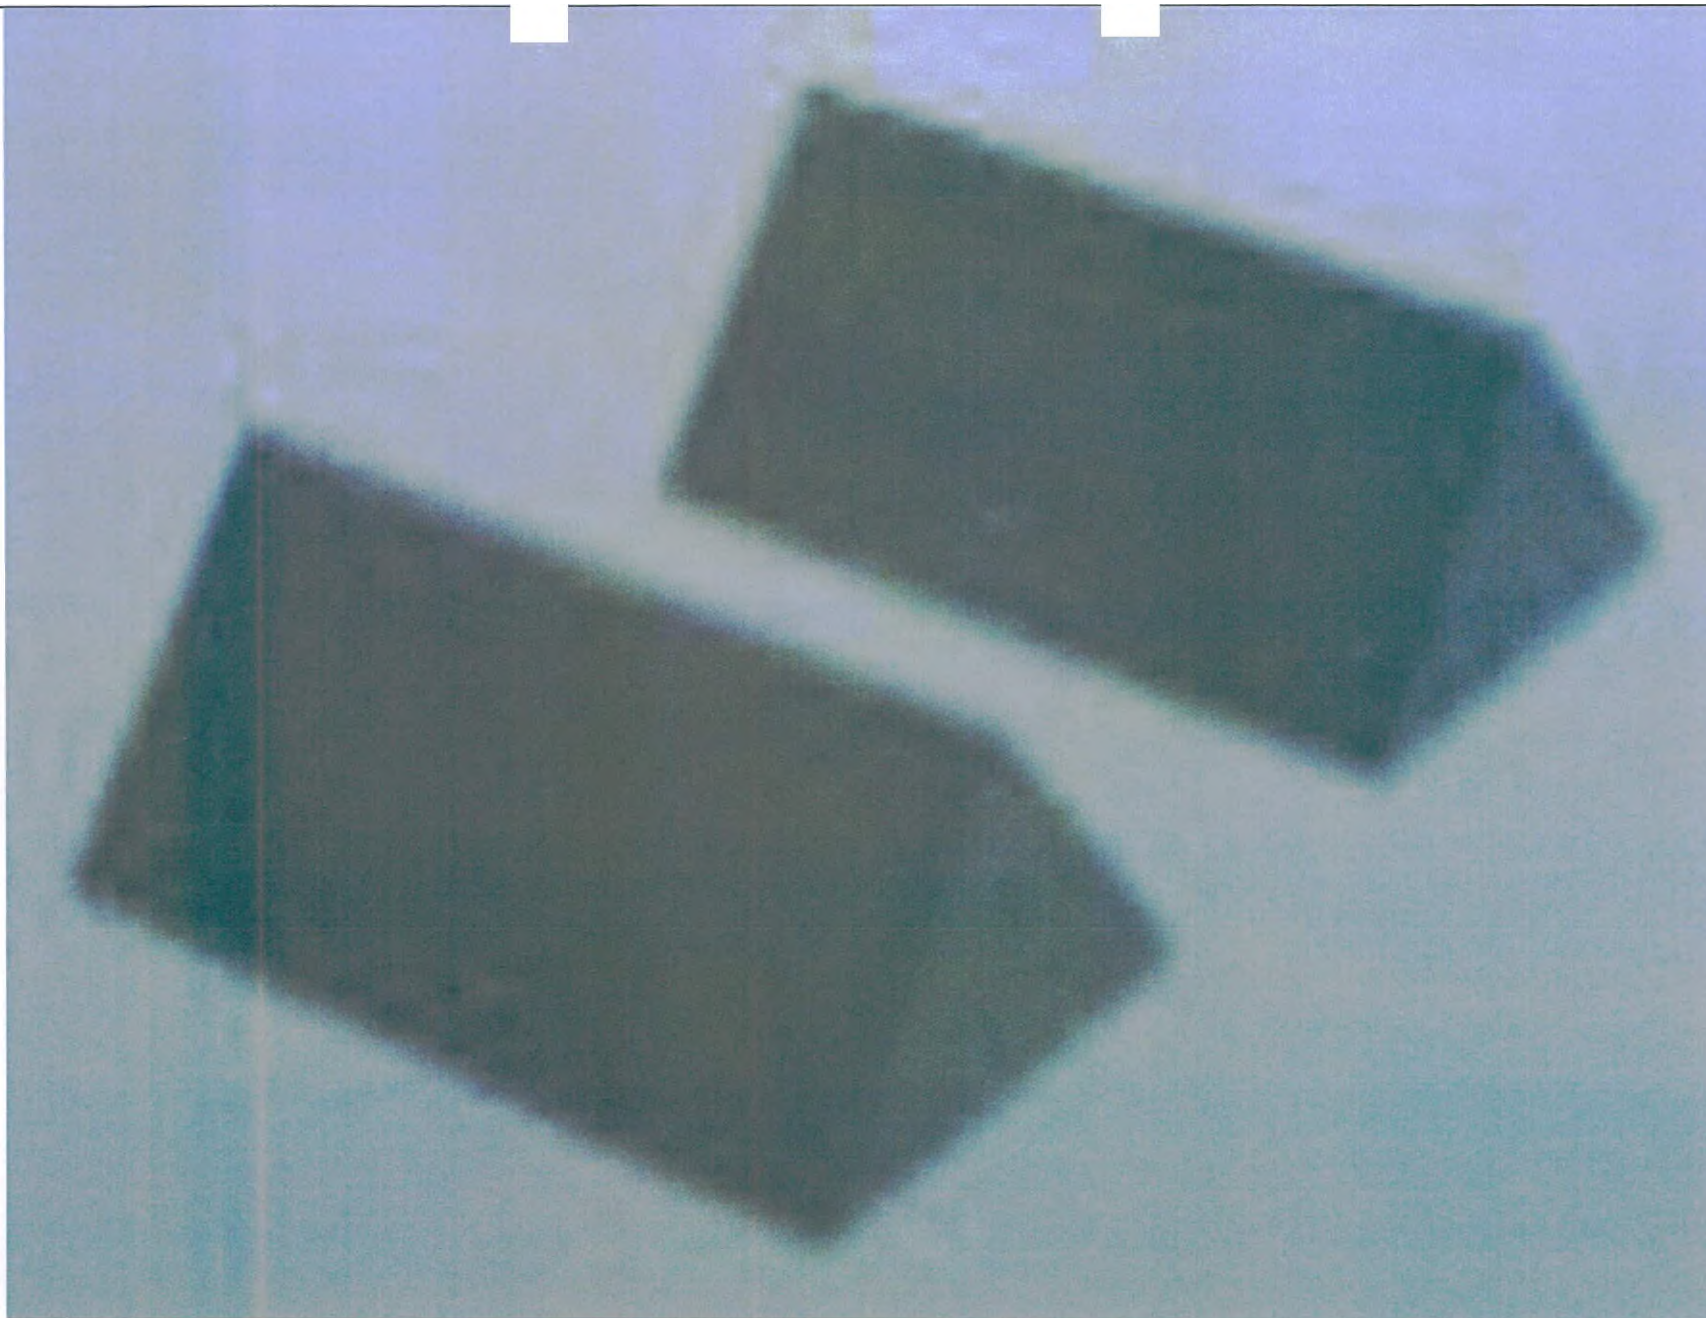

Набор средств позиционирования пациента: треугольники малые

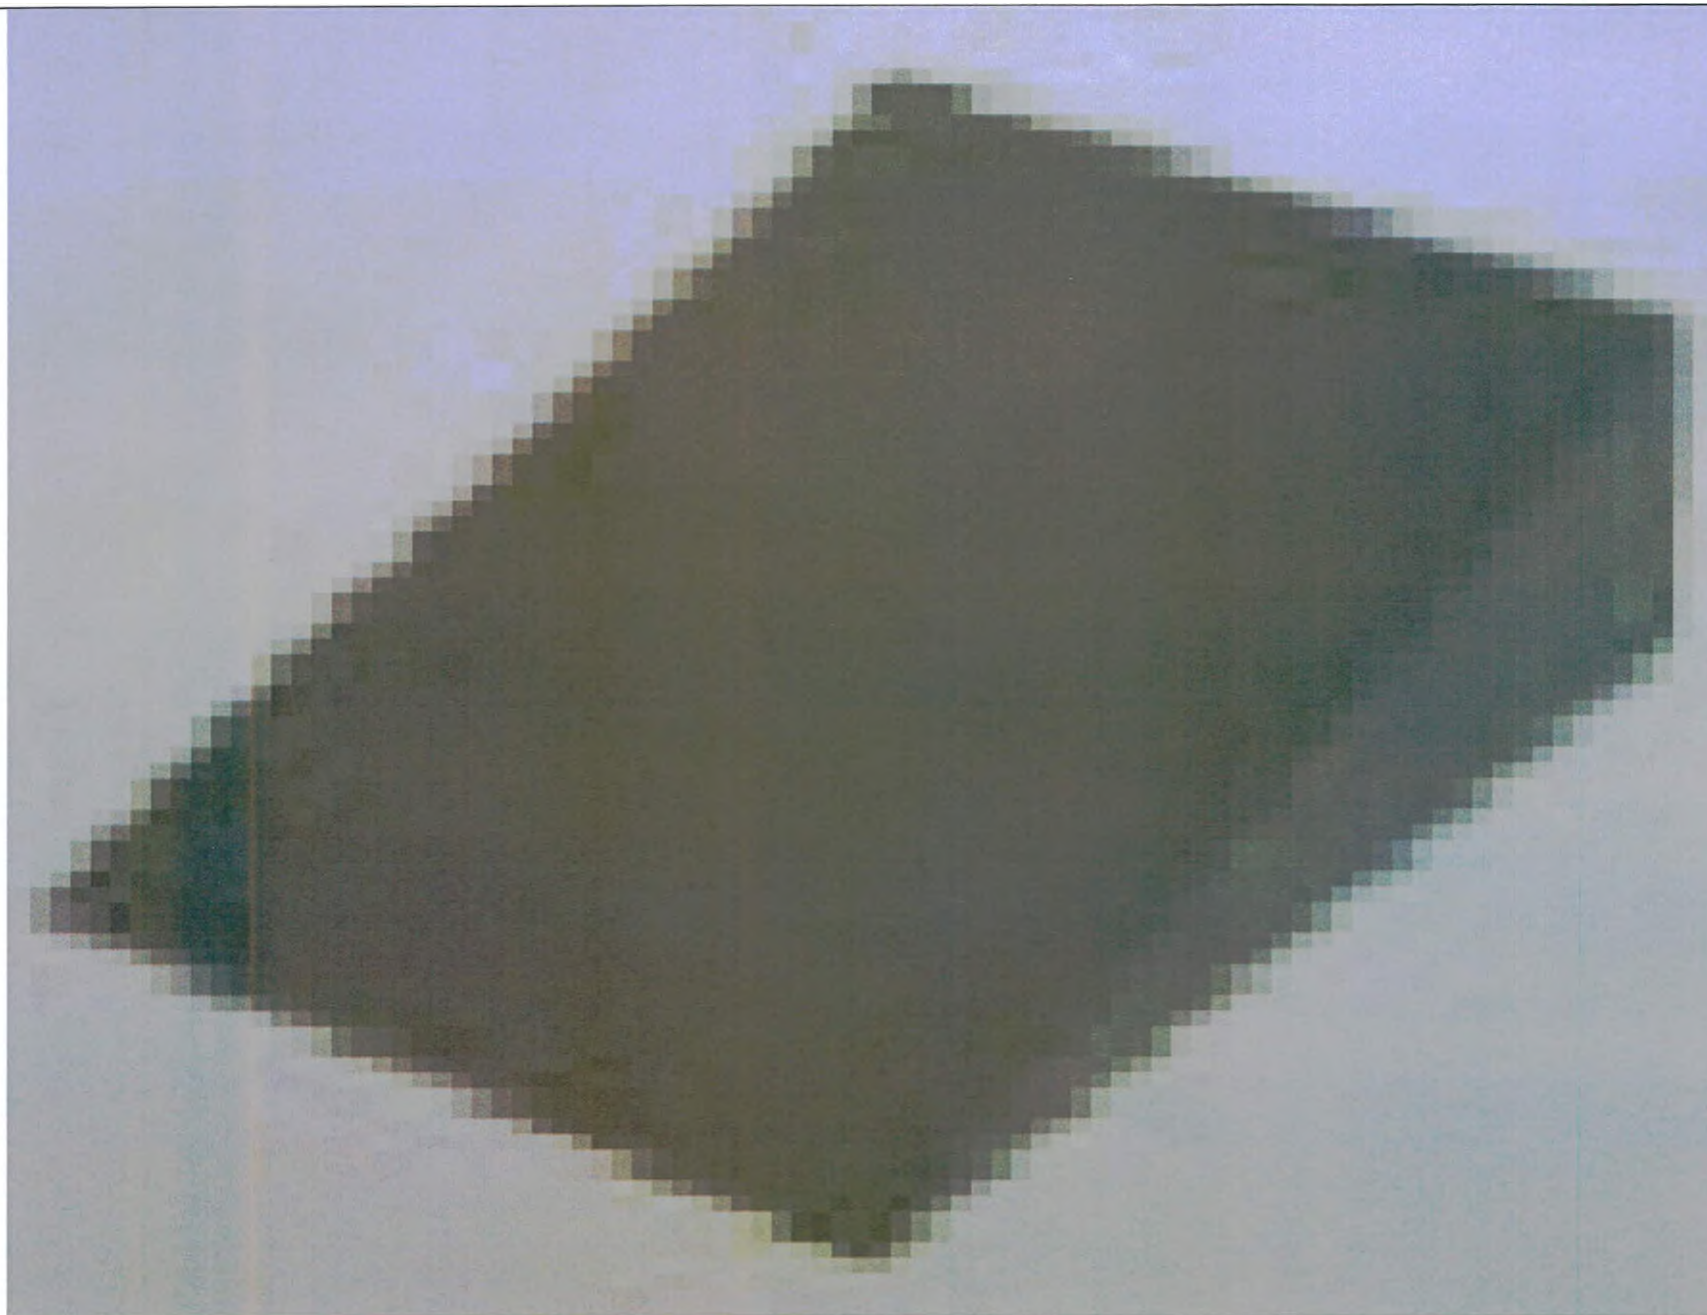


Набор средств позиционирования пациента: клин

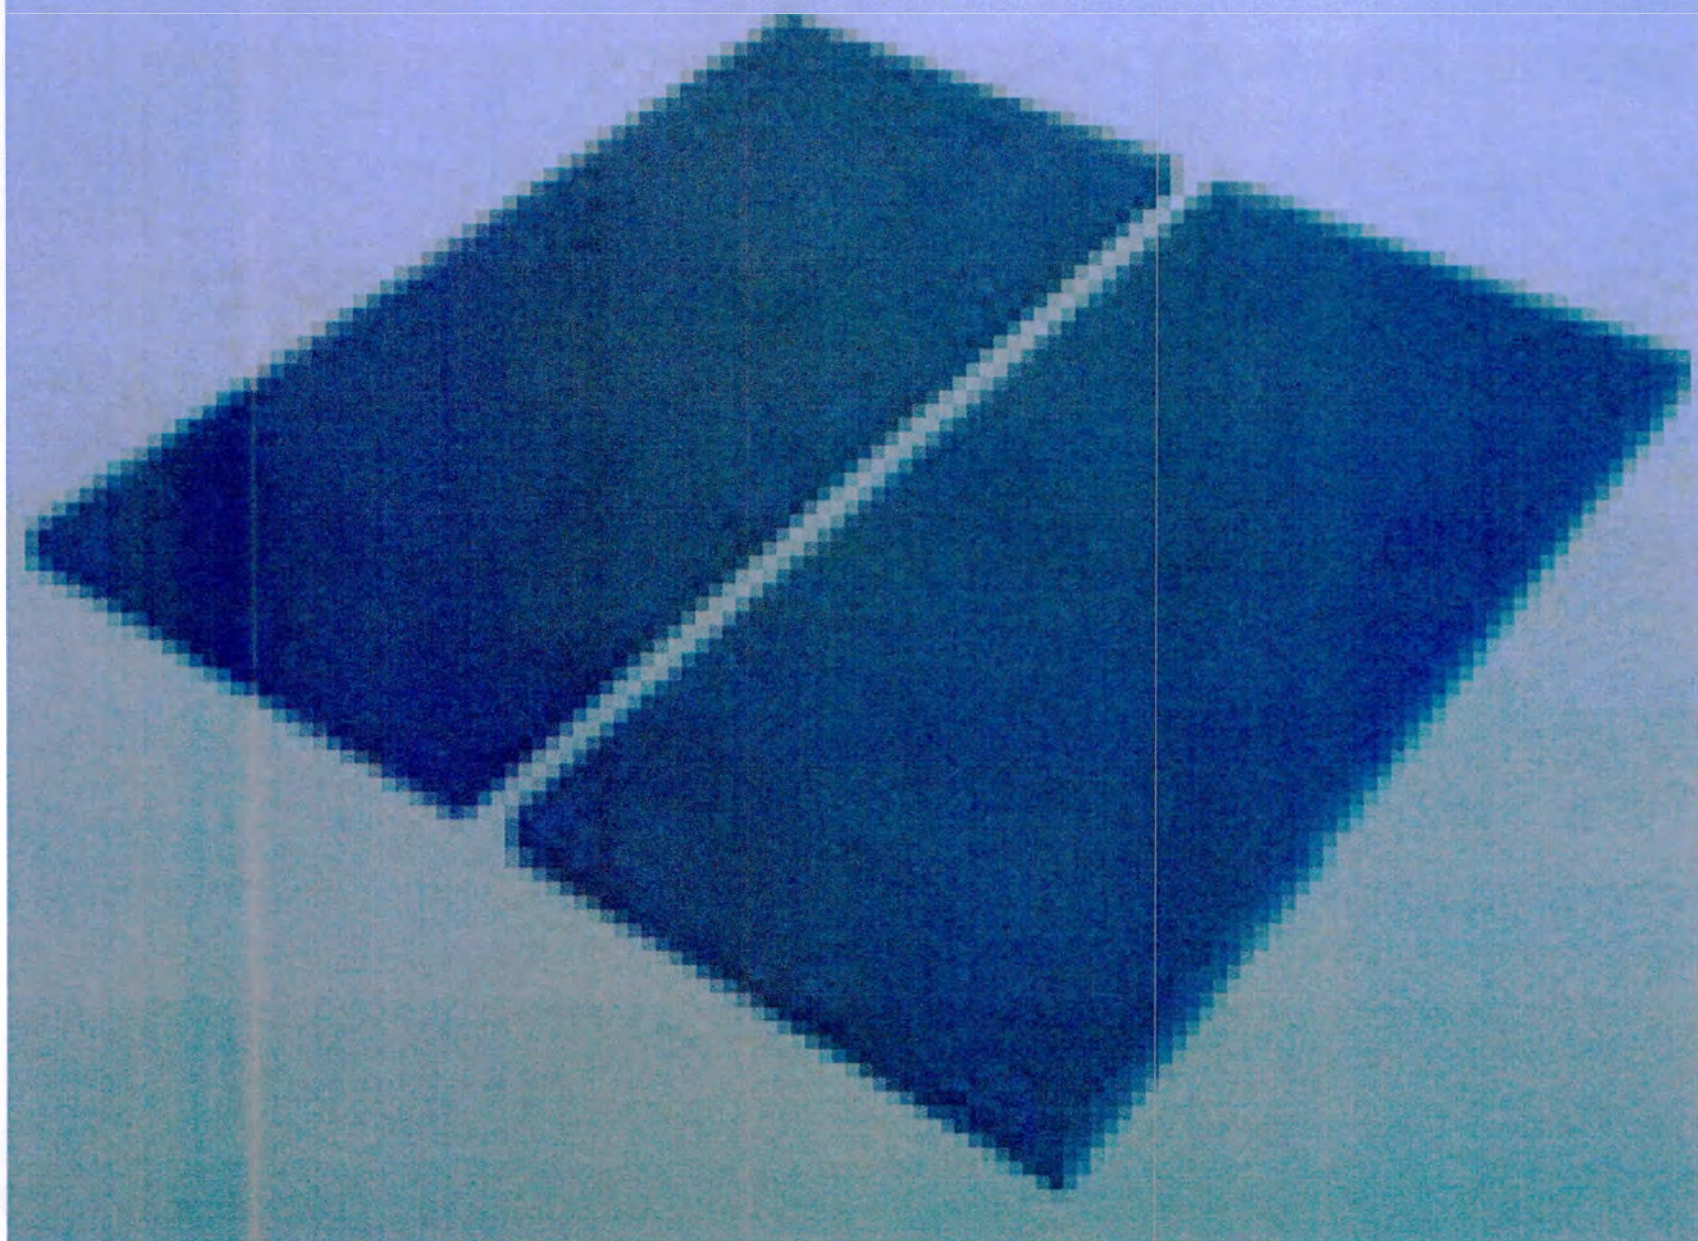


Набор средств позиционирования пациента: набор больших подушек для щелей



Набор средств позиционирования пациента: набор малых подушек для щелей

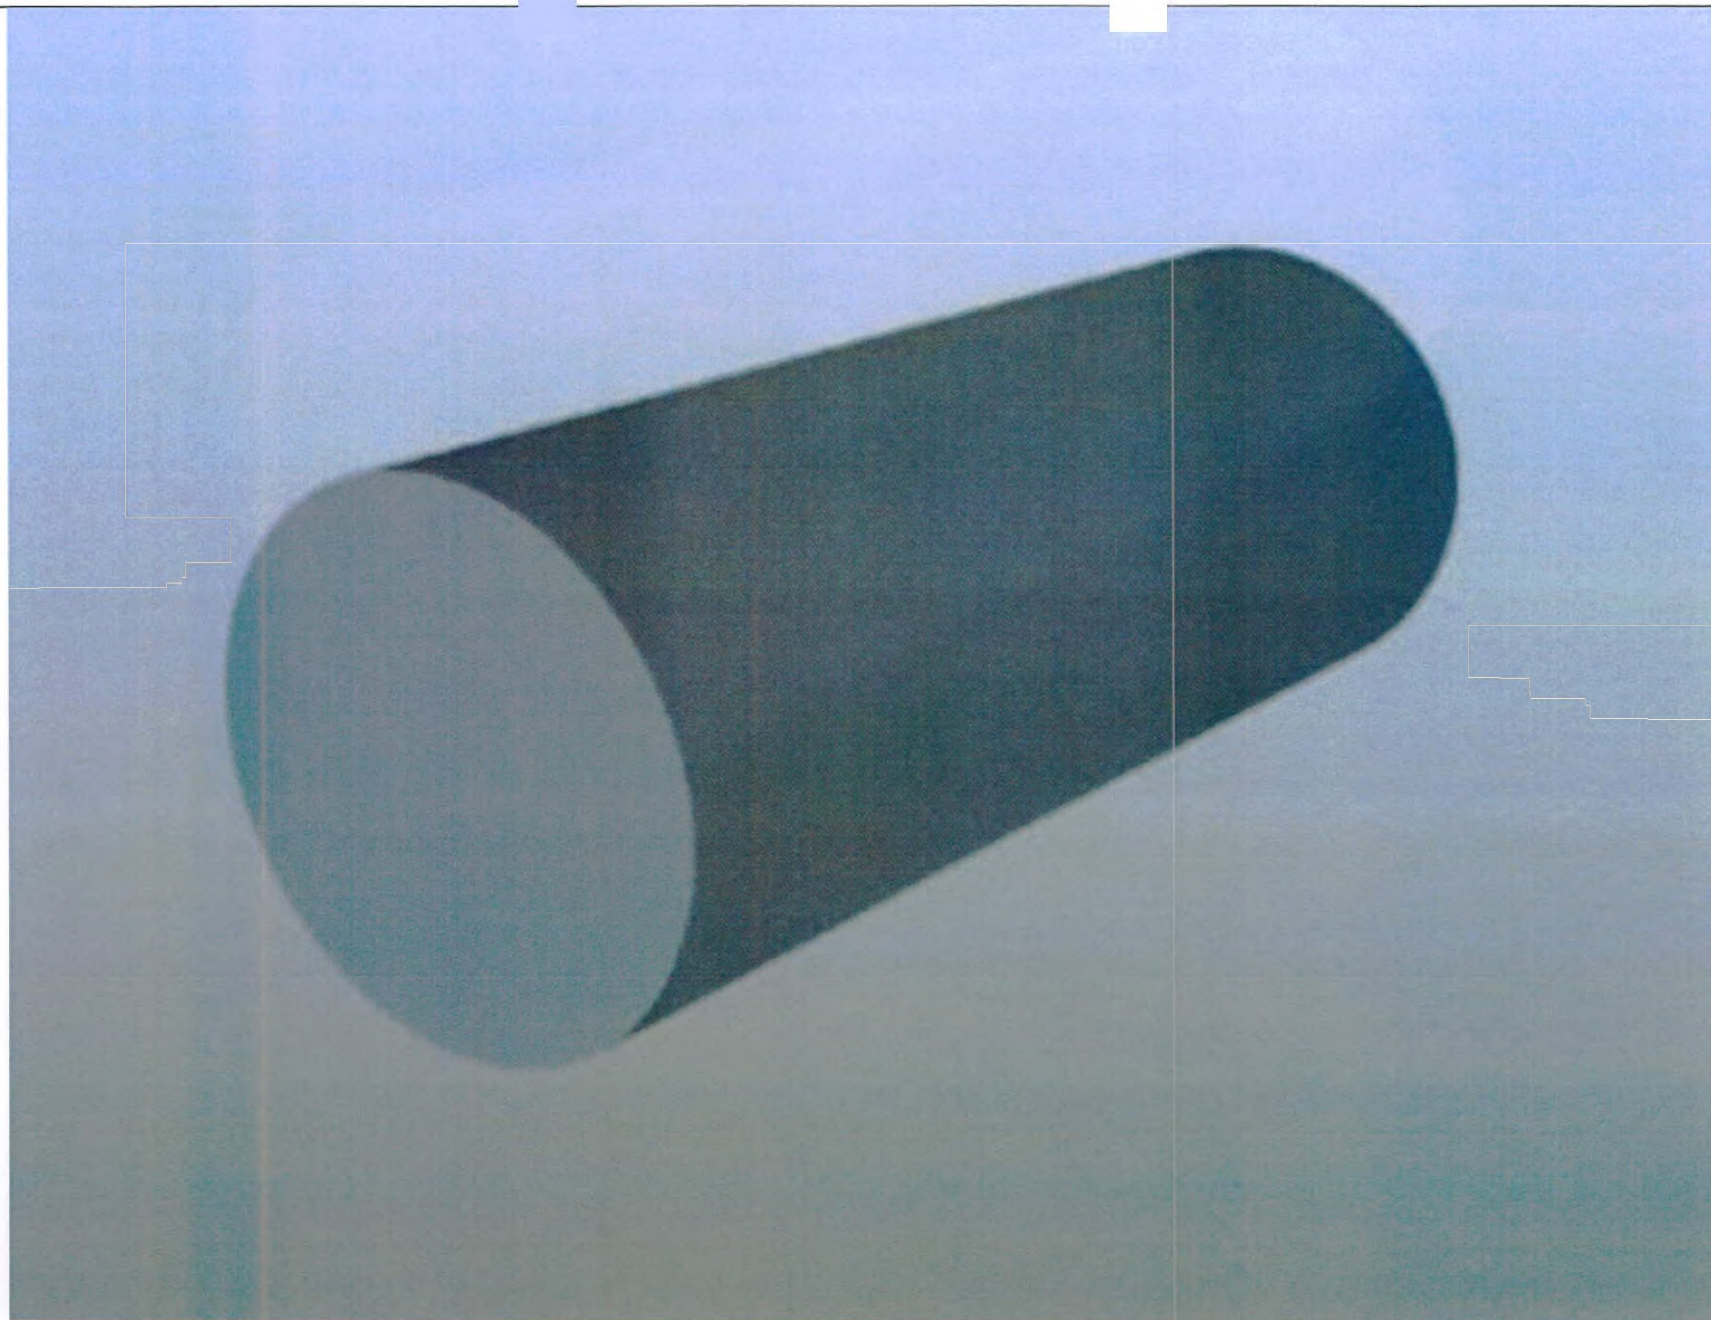

Набор средств позиционирования пациента: позиционирующий валик

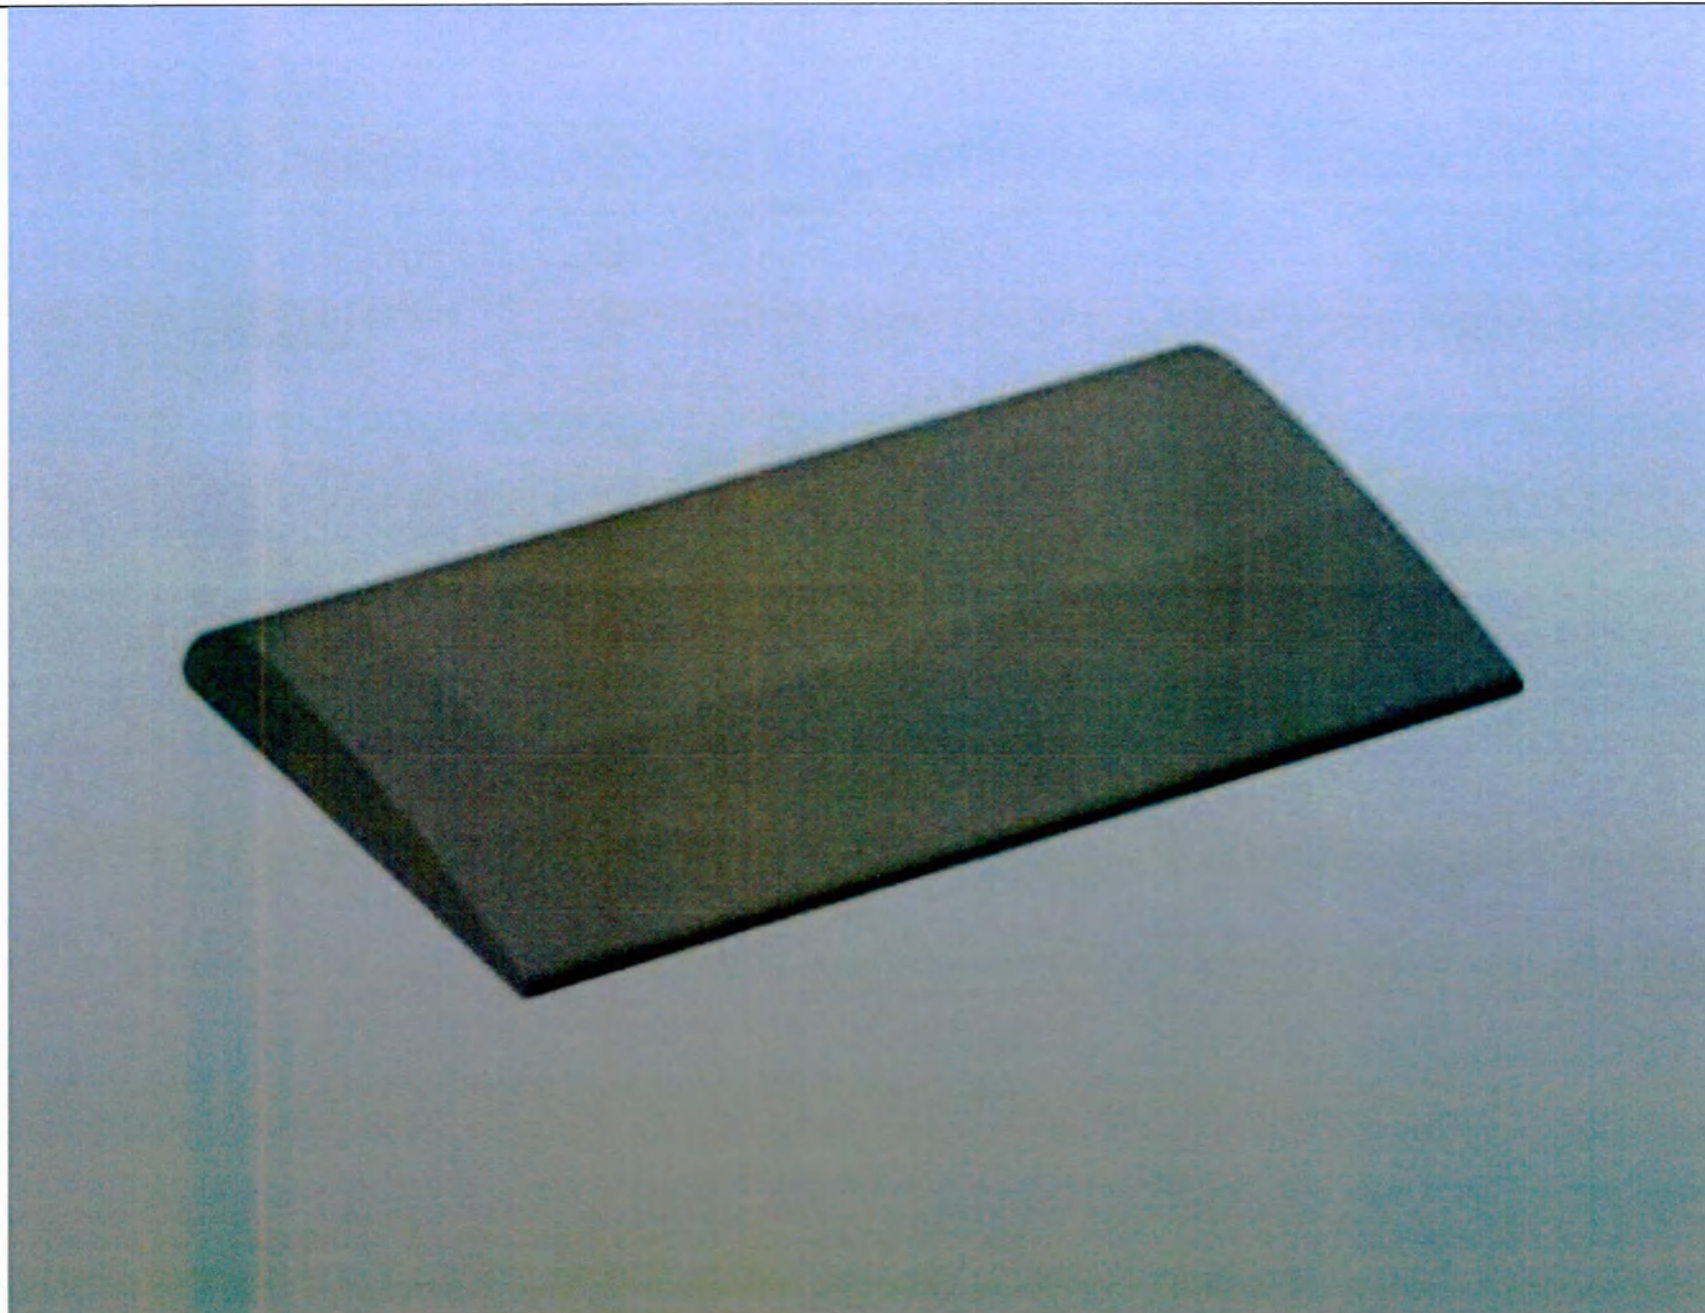


Набор средств позиционирования пациента: лордотическая подушка



Держатель рулона бумаги



Держатель колб для вливаний

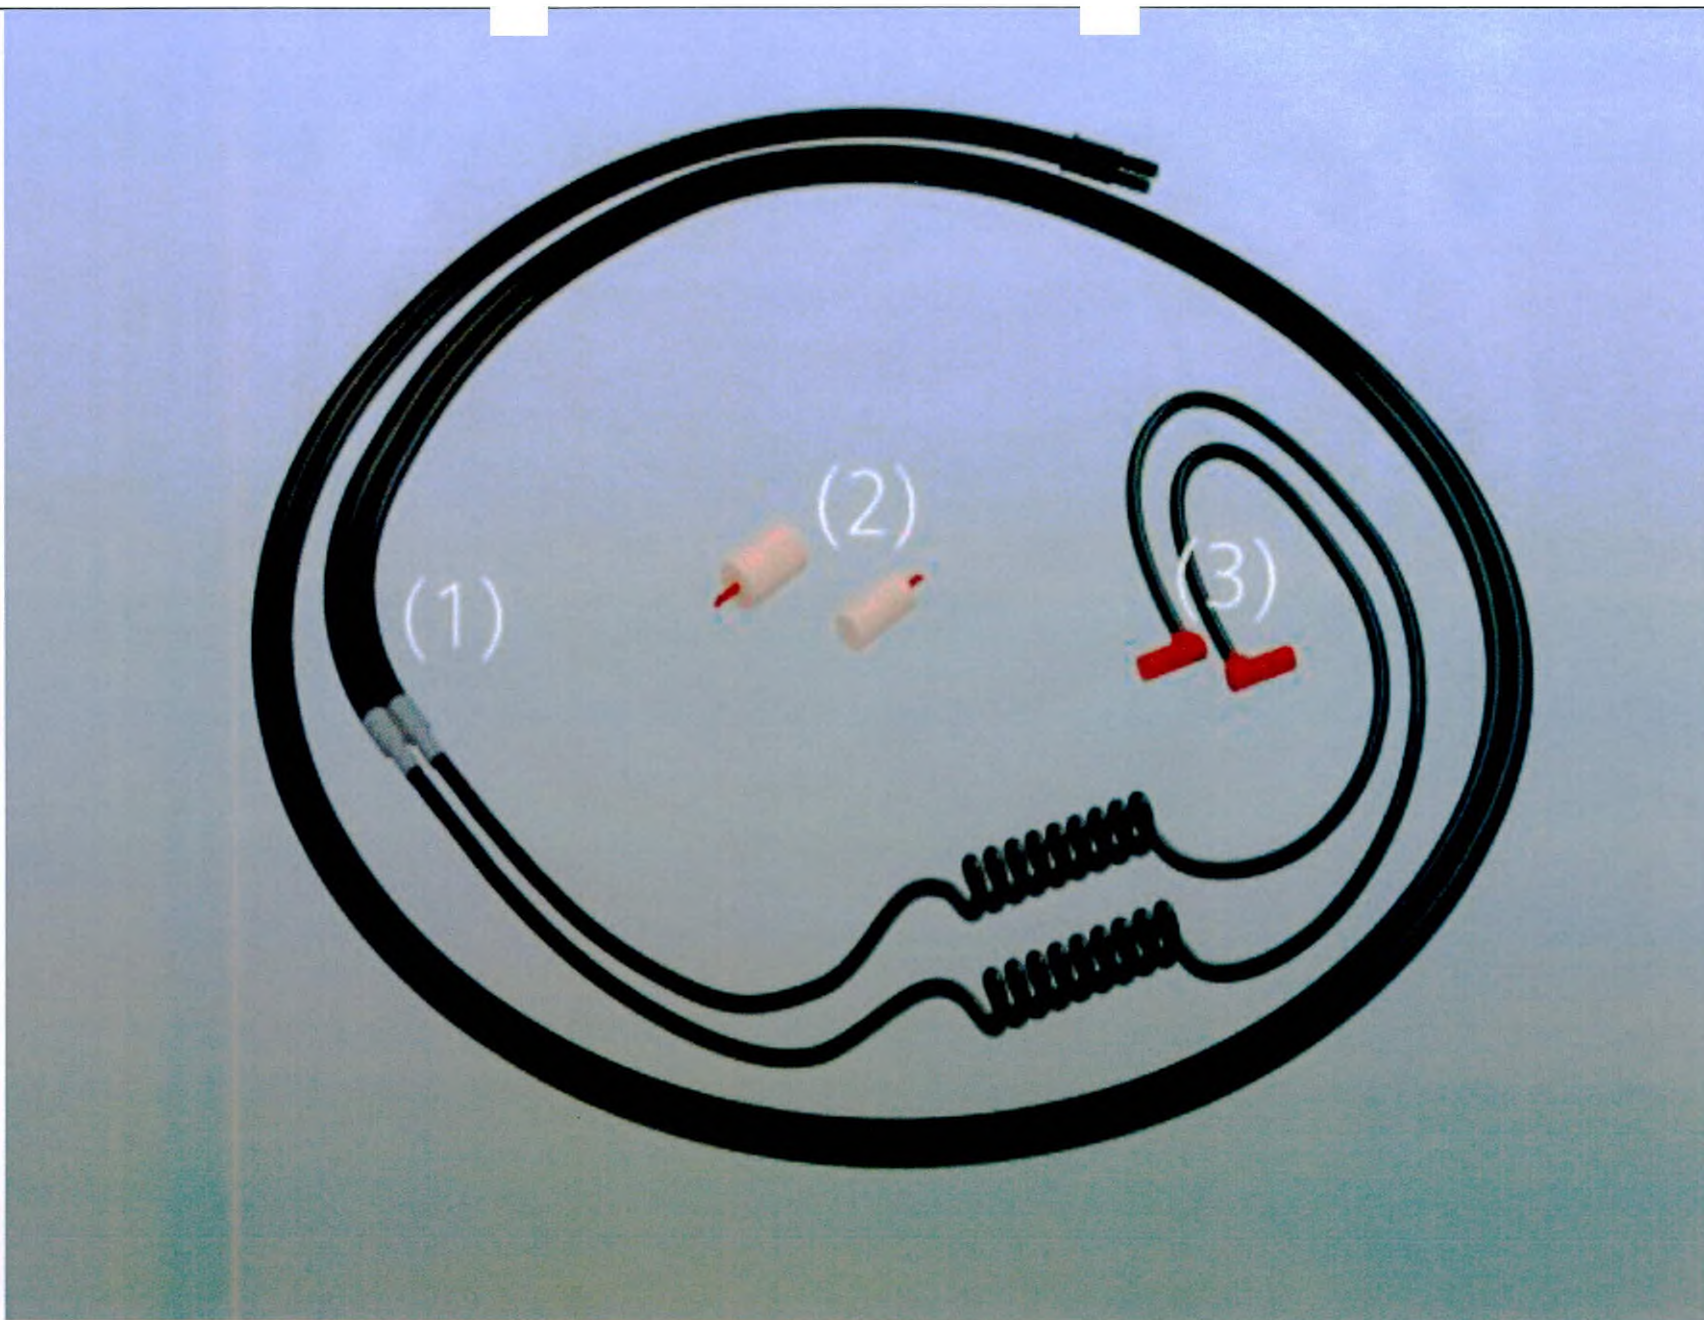

Наушники многофункциональные, немагнитные



Option 1 - (See headshot next)

1. 2000 meters, 67 inches (headset)

1. 4000 meters, 134 inches (cable)

Total Length 2.5 meters, 78.5 inches


Наушники многофункциональные, немагнитные




Роутер для получения изображений в режиме реального времени




Принадлежности катушки для головы и/или шеи Head/Neck: кронштейн зеркала с зеркалом

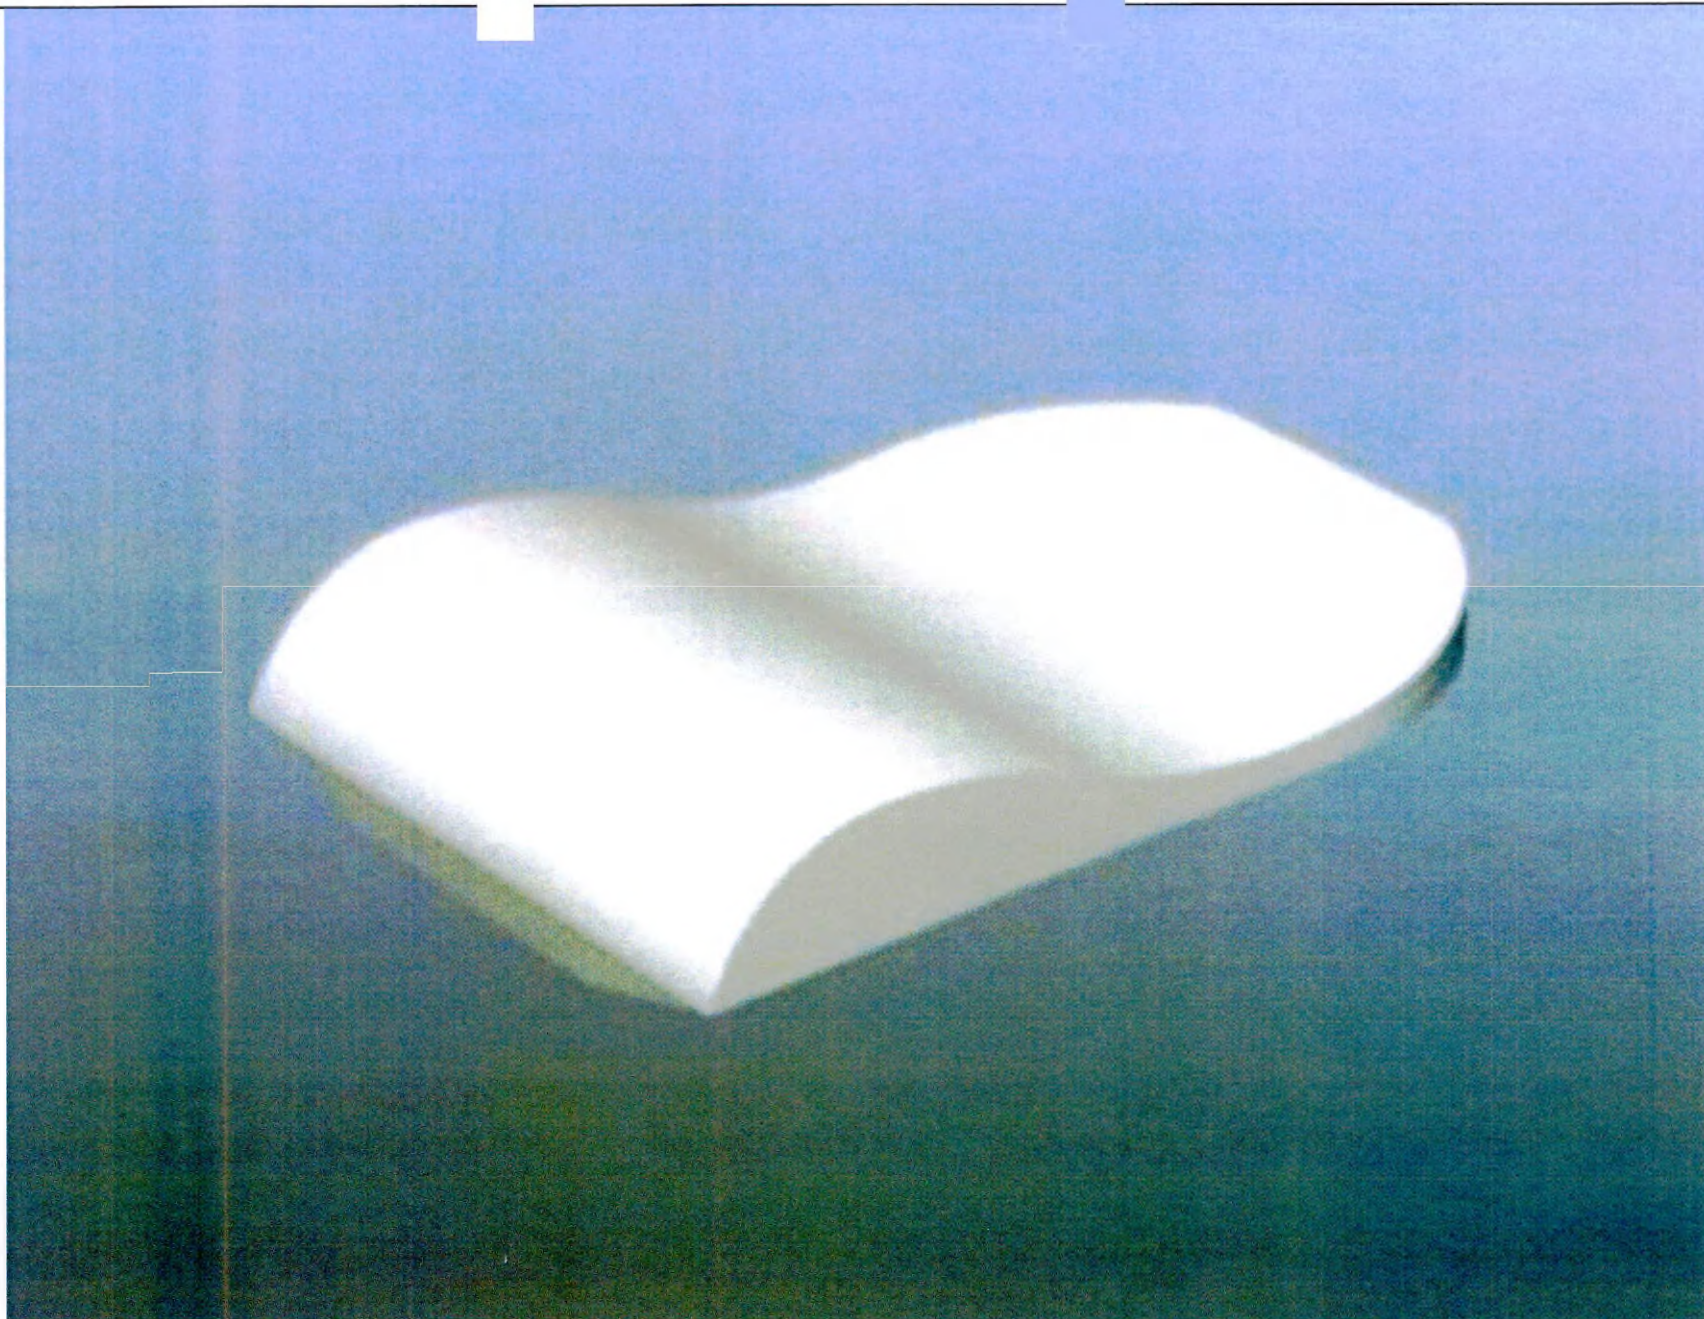


Принадлежности катушки для головы и/или шеи Head/Neck: прокладка 32

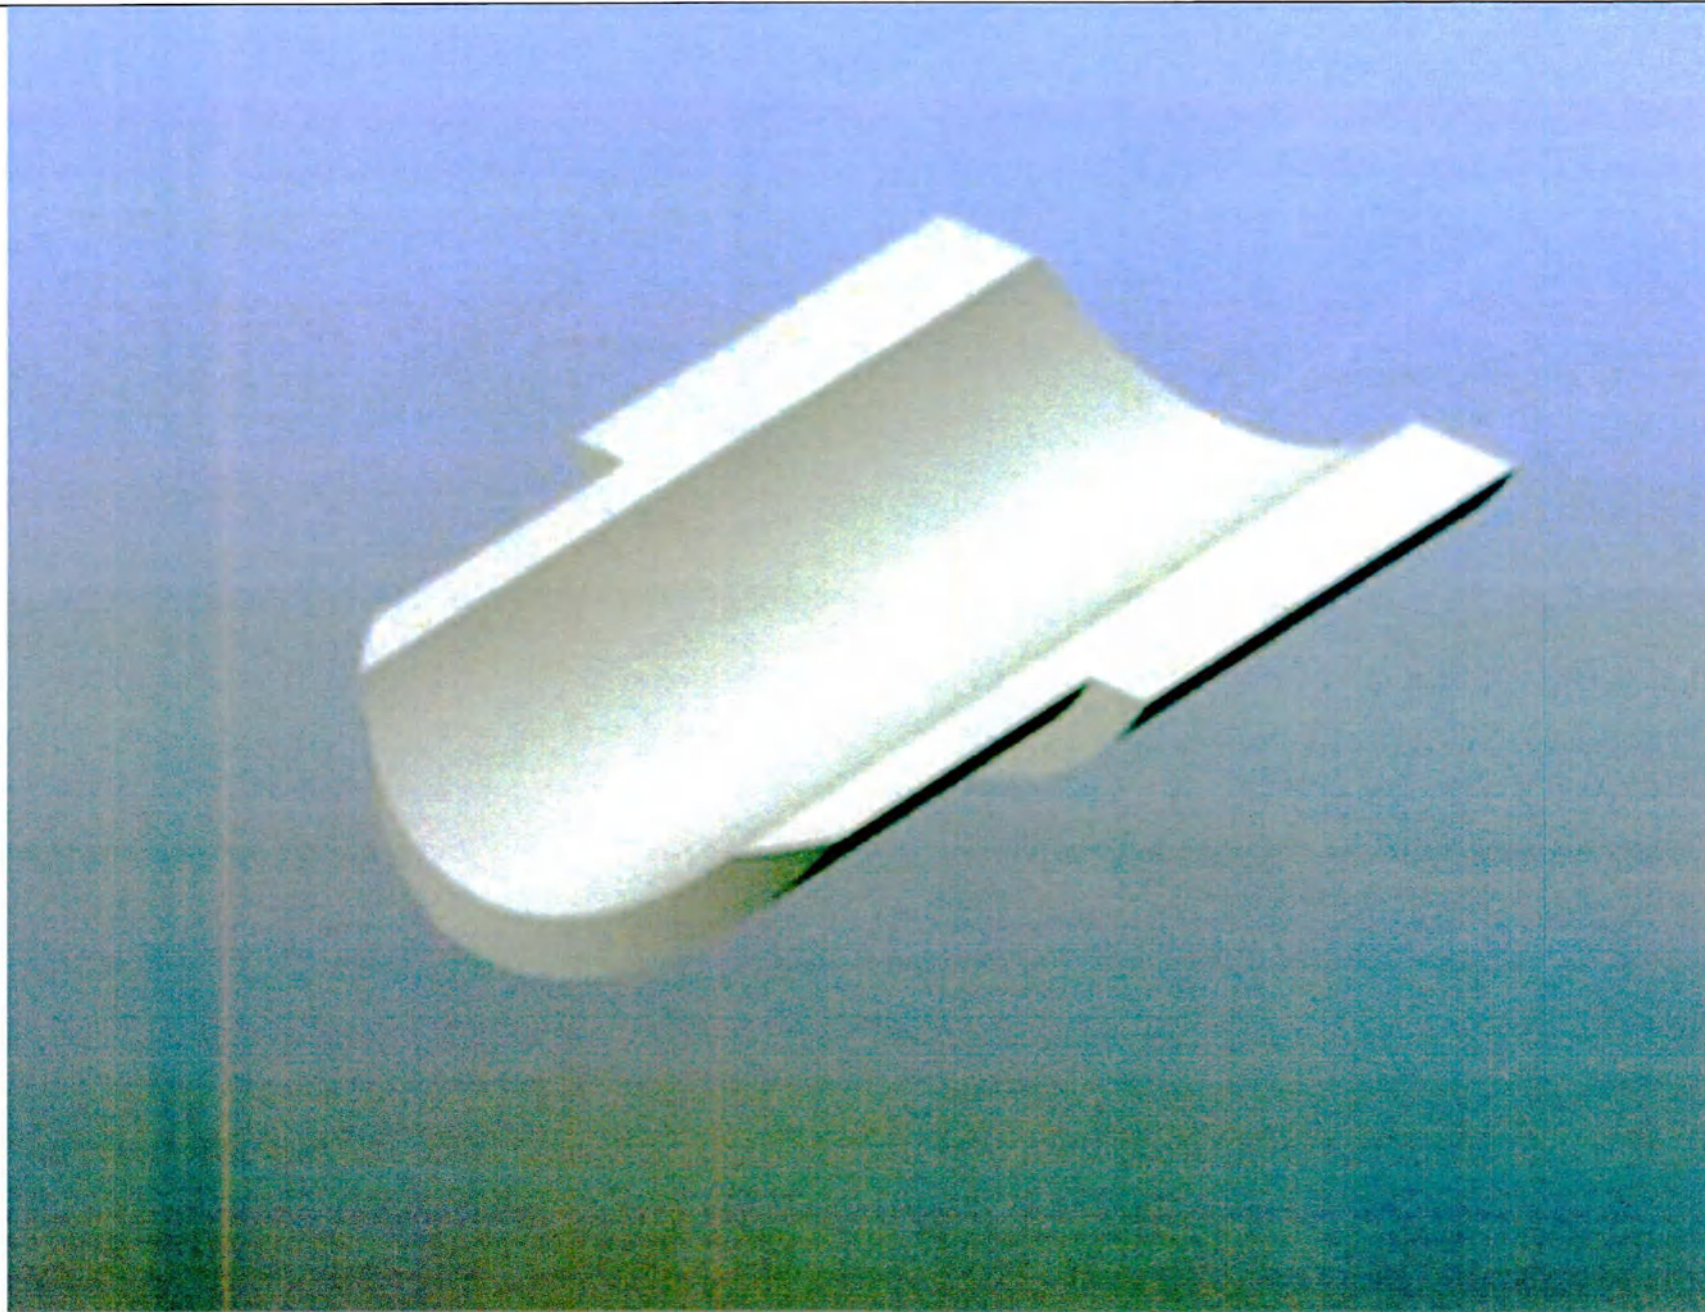


Принадлежности катушки для головы и/или шеи Head/Neck: подушка для шеи

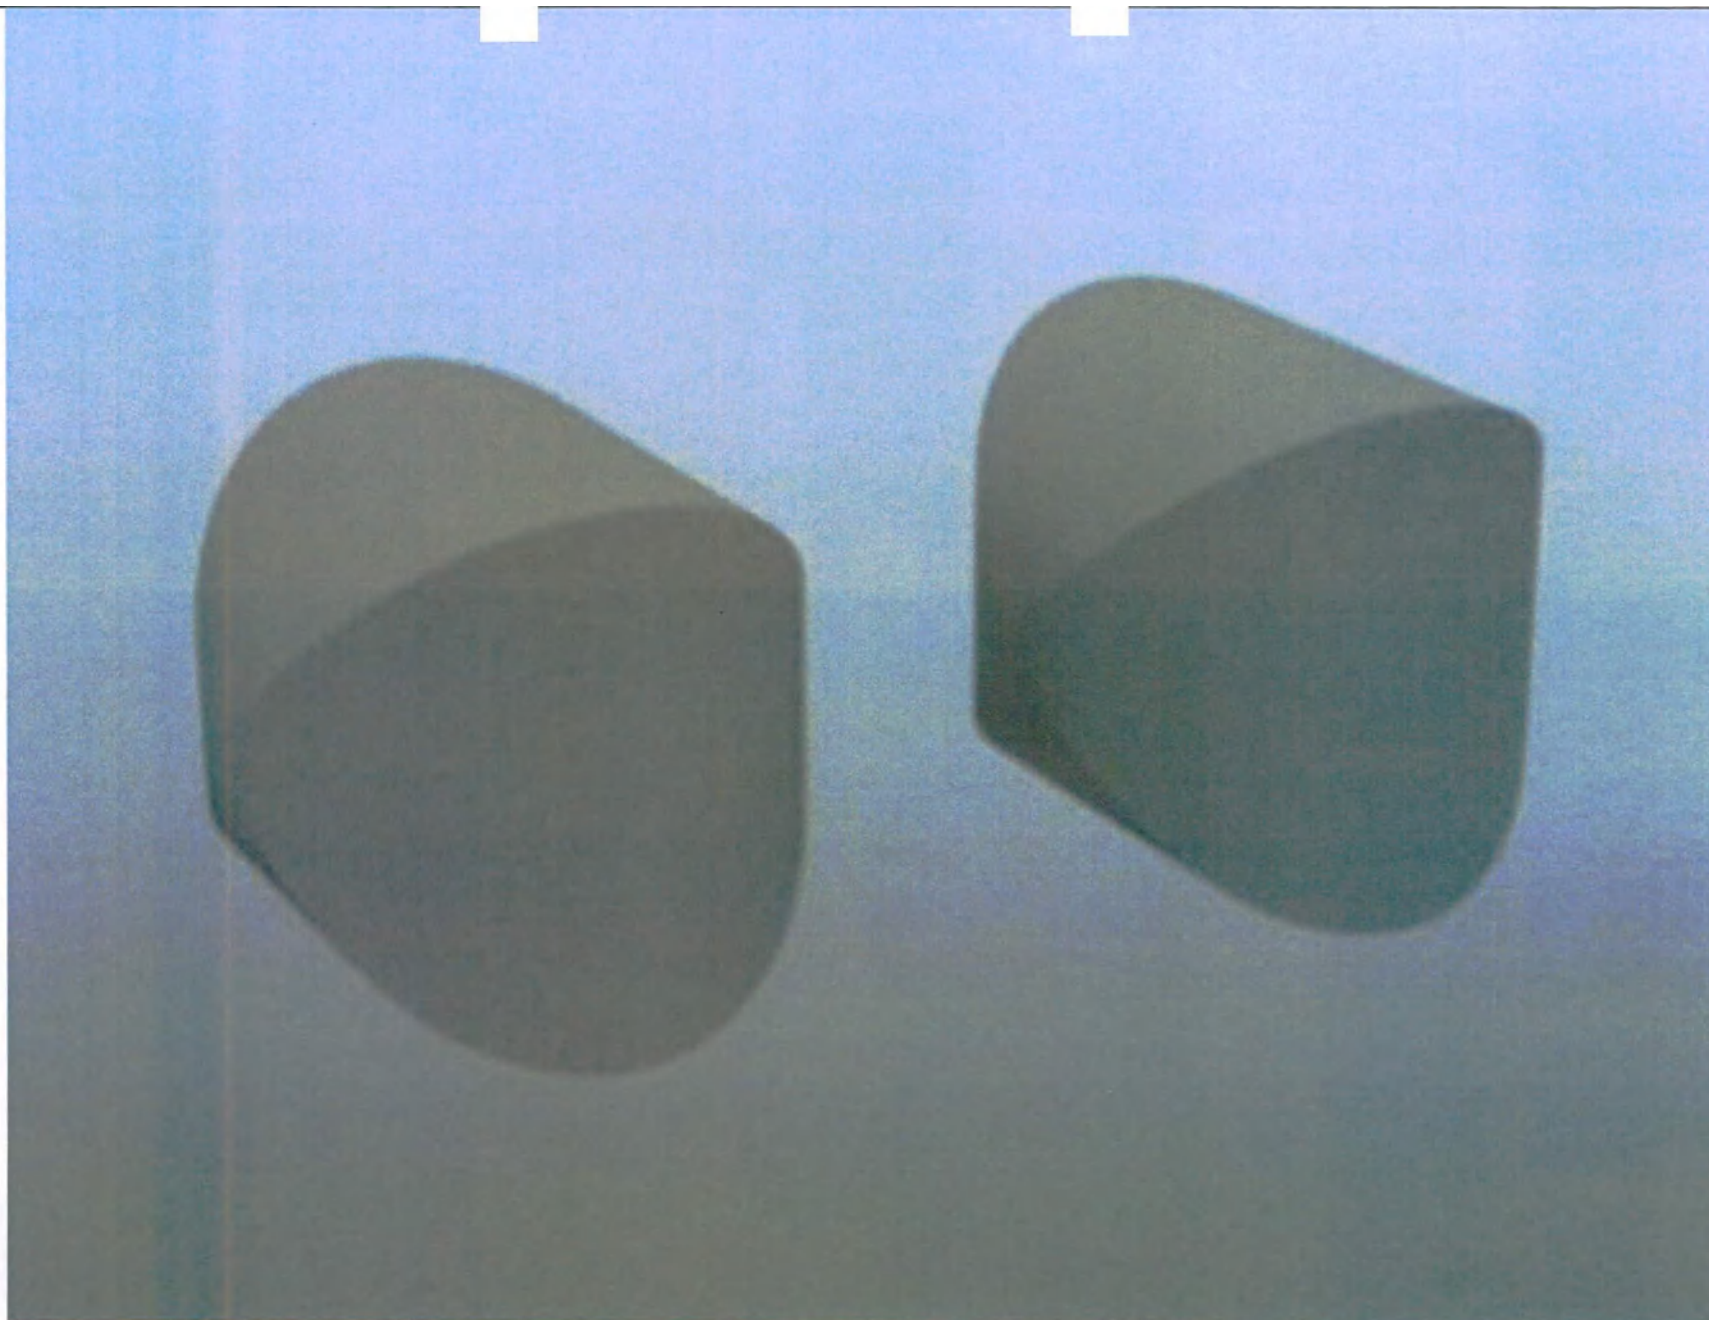


Принадлежности катушки для головы и/или шеи Head/Neck: зажимные подушки

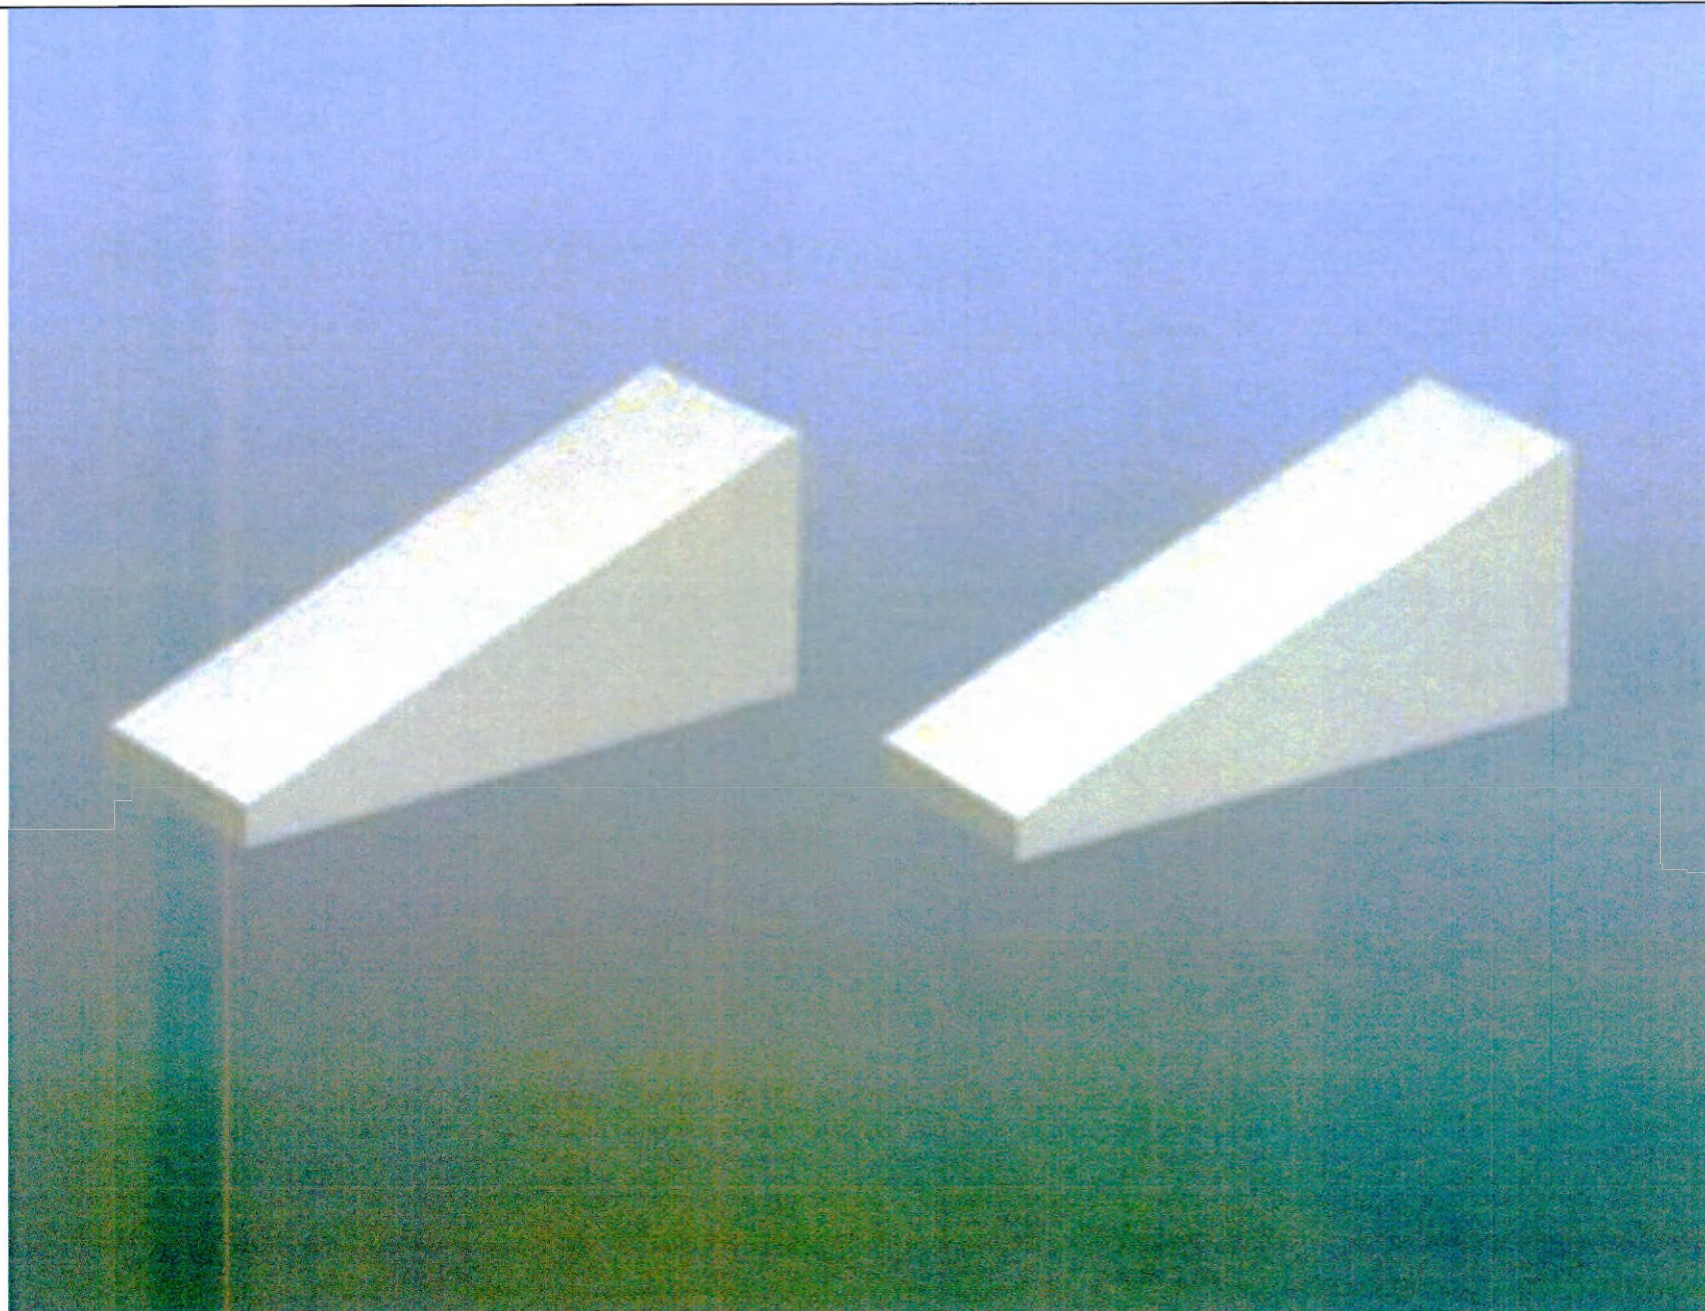


Принадлежности каталки для головы и/или шеи Head/Neck: клинья для позиционирования головы

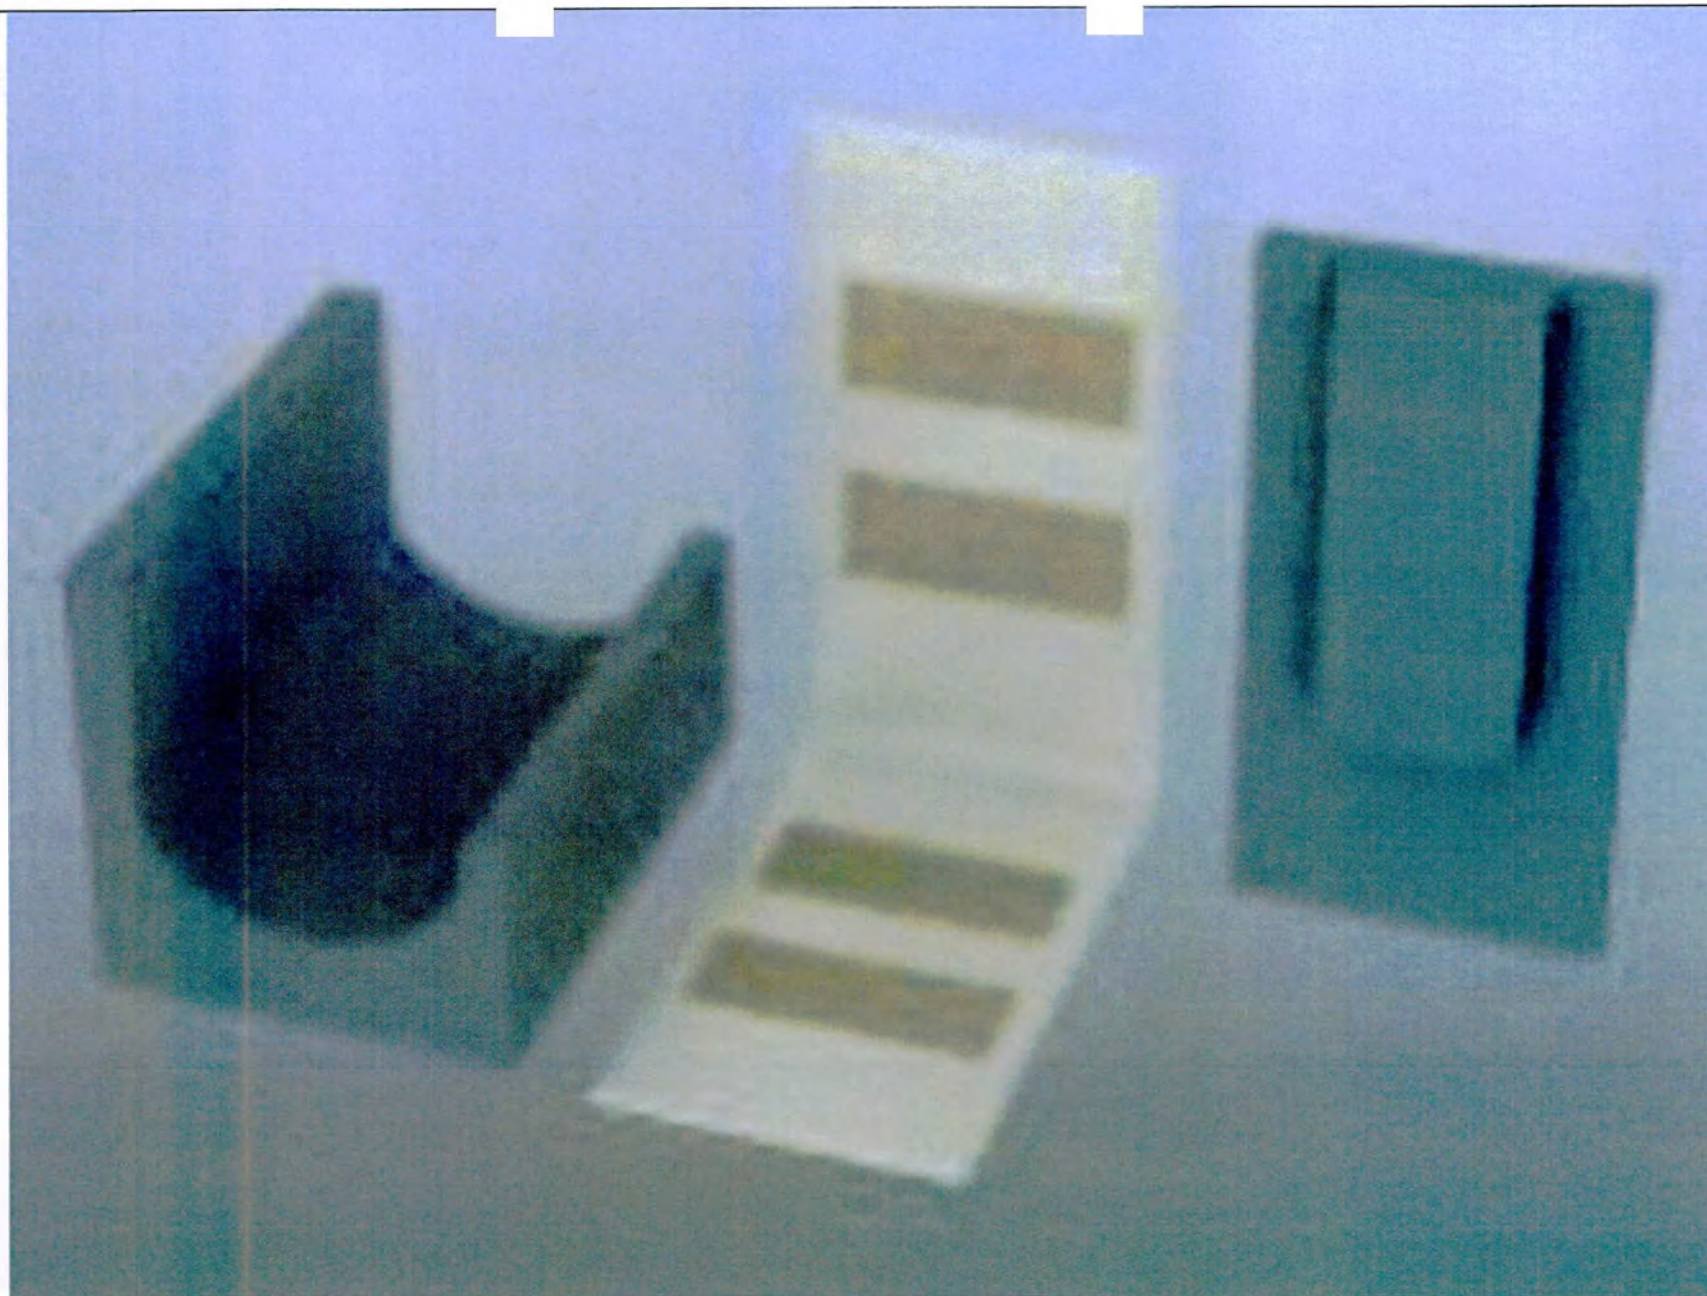

Принадлежности катушки гибкой многофункциональной Contour M или BioMatrix Contour L: позиционирование подкладок для ступни/лодыжки; подушки для обследования конечностей

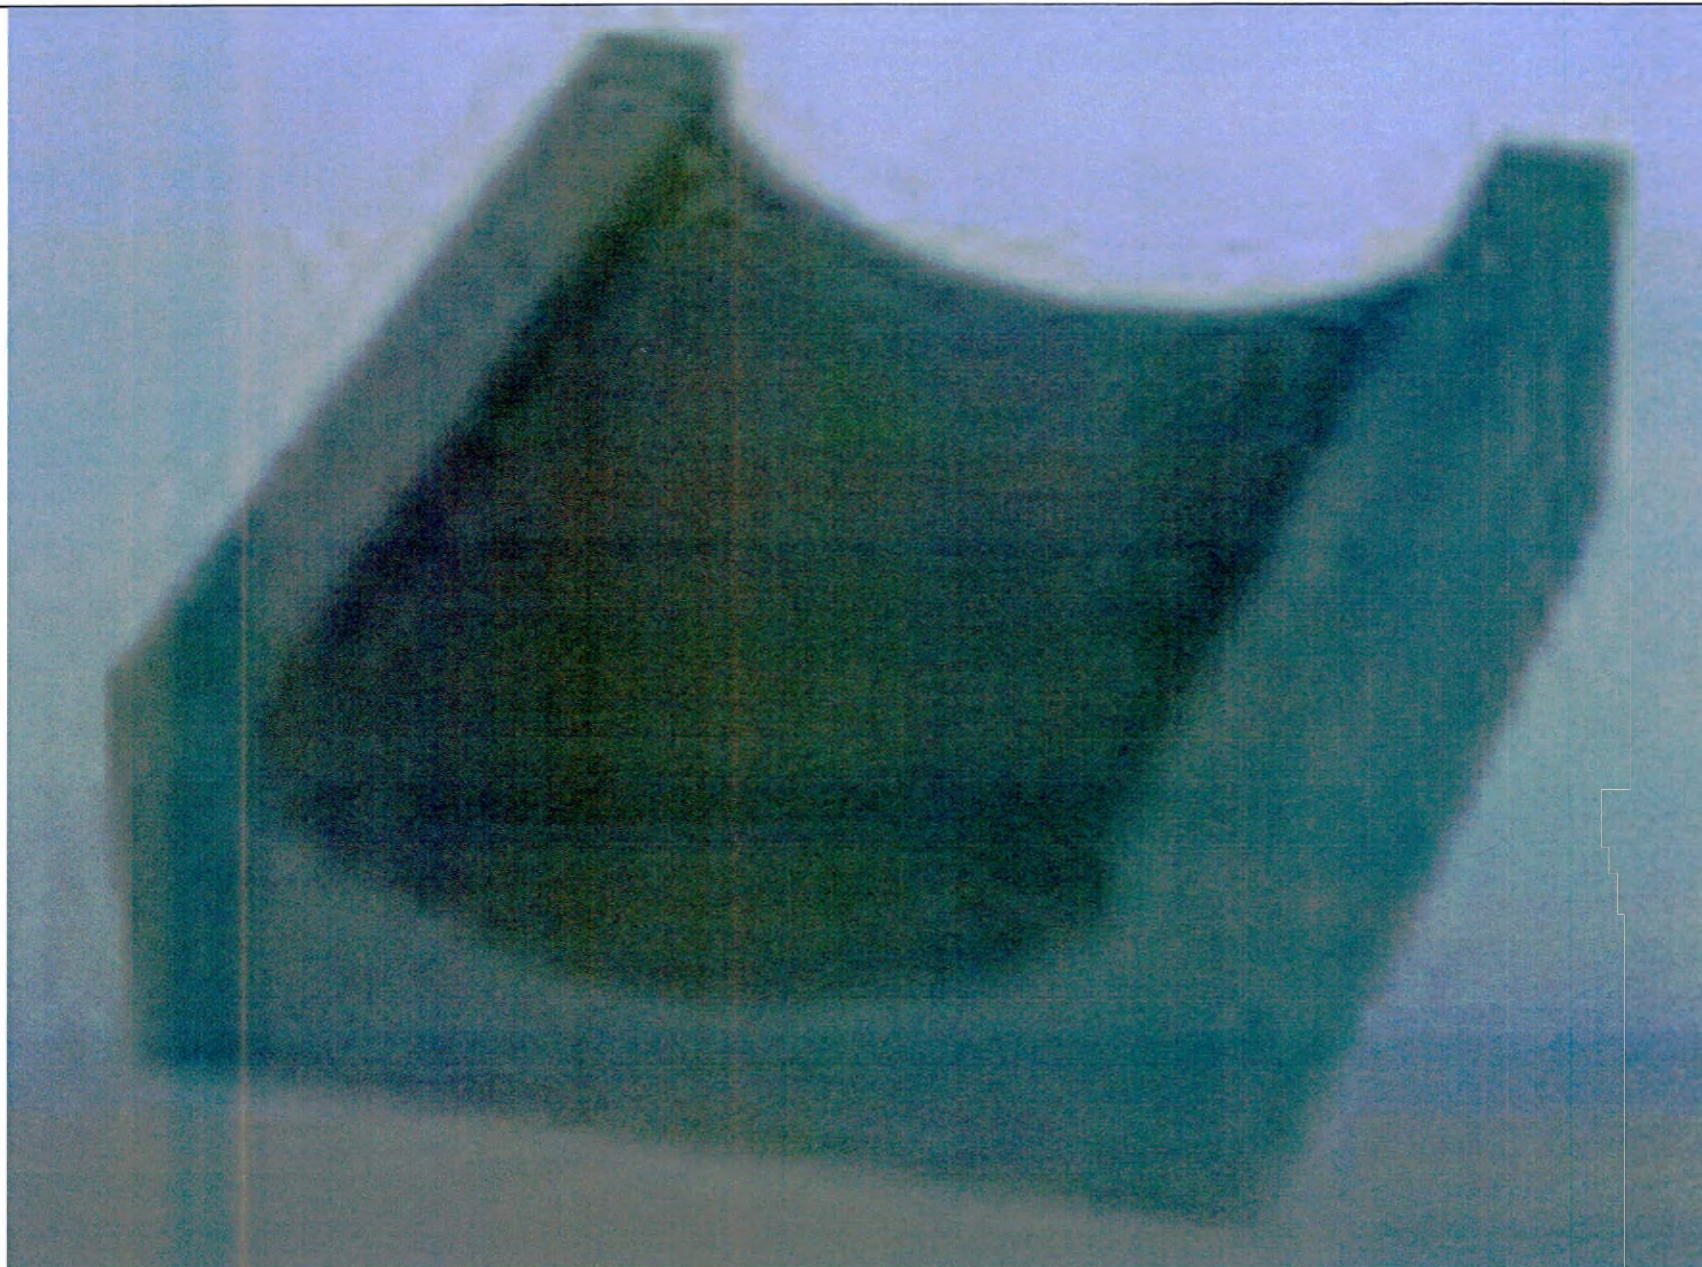

Принадлежности катушки гибкой многофункциональной Contour М или BioMatrix Contour L: позиционирование подкладок для ступни/лодыжки

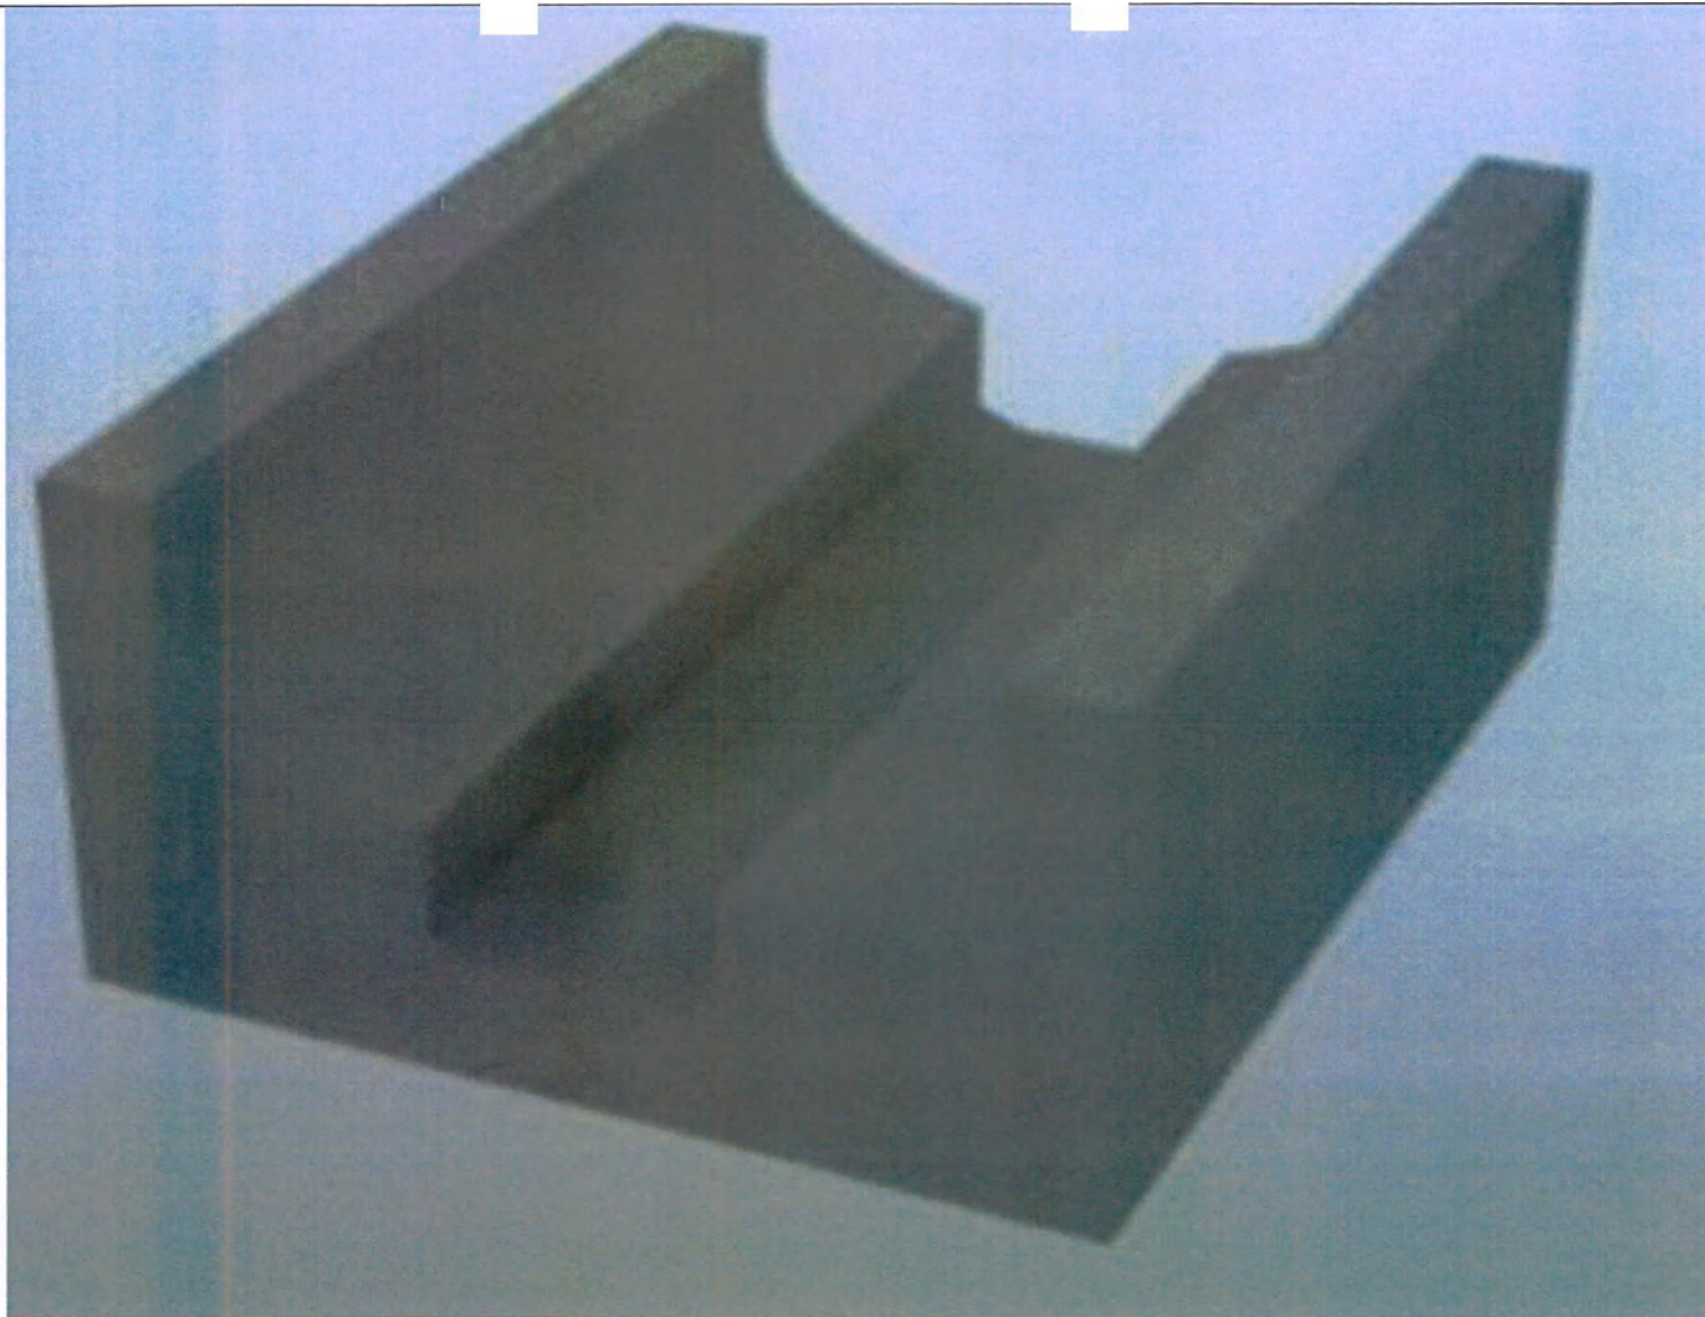


Принадлежности катушки гибкой многофункциональной Contour M или BioMatrix Contour L: подушки для обследования конечностей




Тележки для хранения катушек




Лицензионные ключи для активации программных режимов для автоматизированных исследований

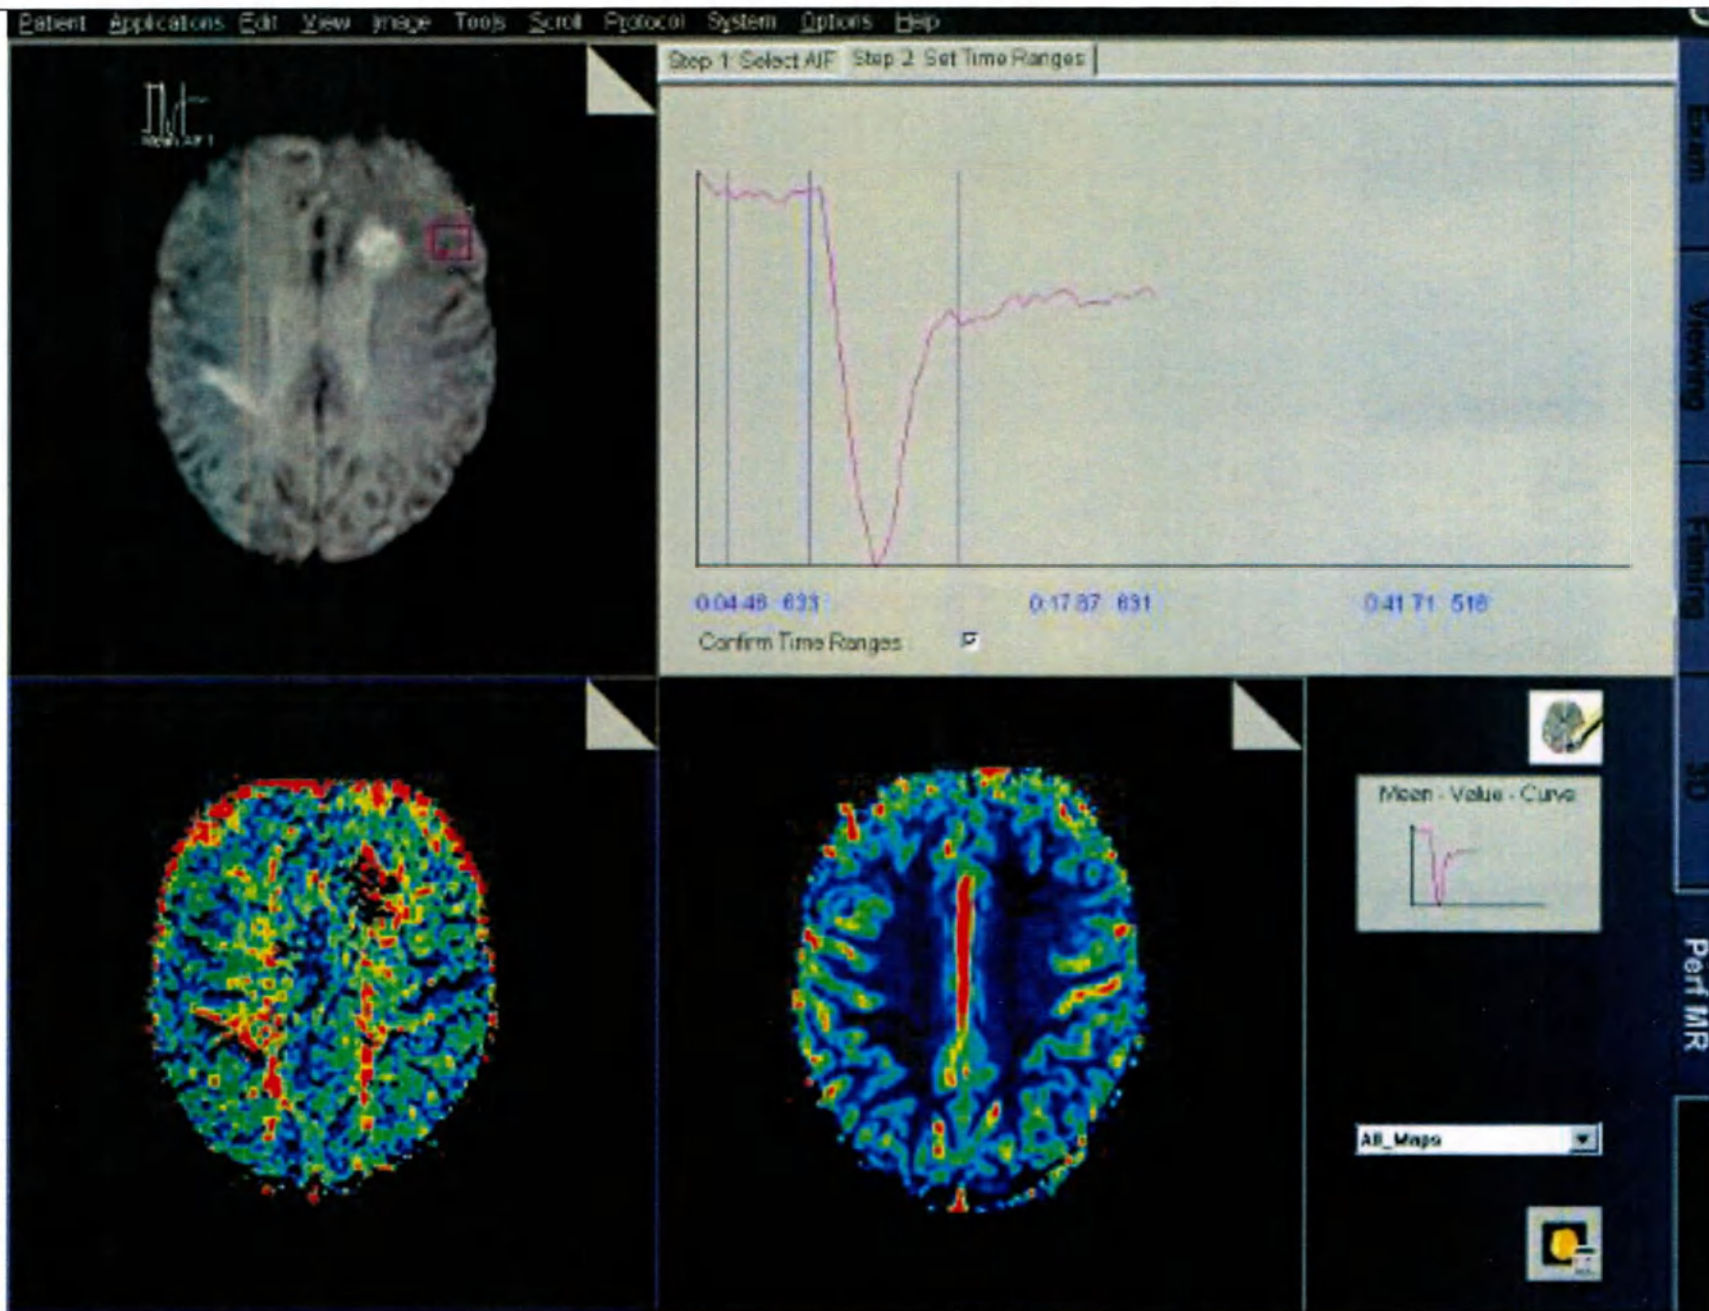


Лицензионные ключи для активации дополнительных программных режимов для экспертного сбора и обработки данных

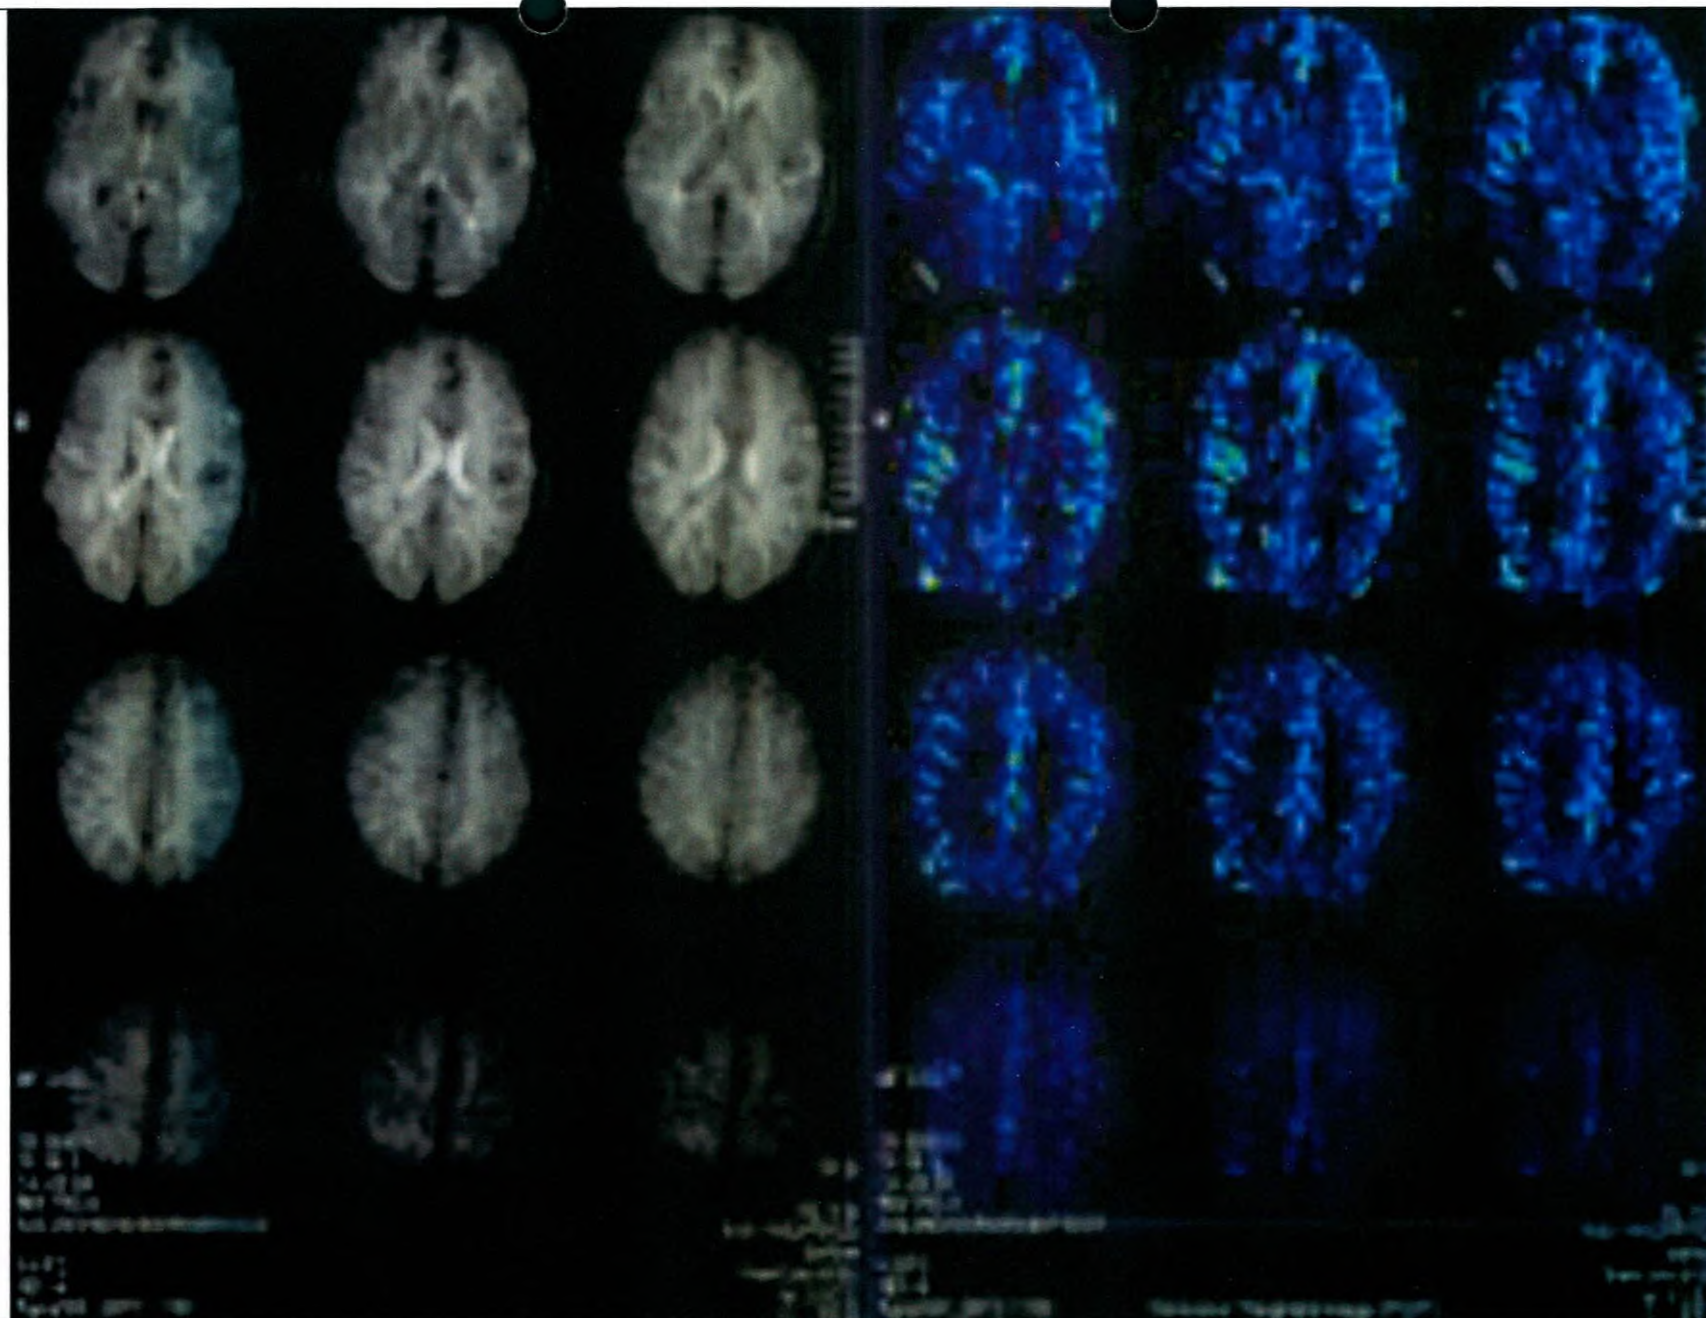

Лицензионные ключи для активации дополнительных программных режимов для экспертного сбора и обработки данных

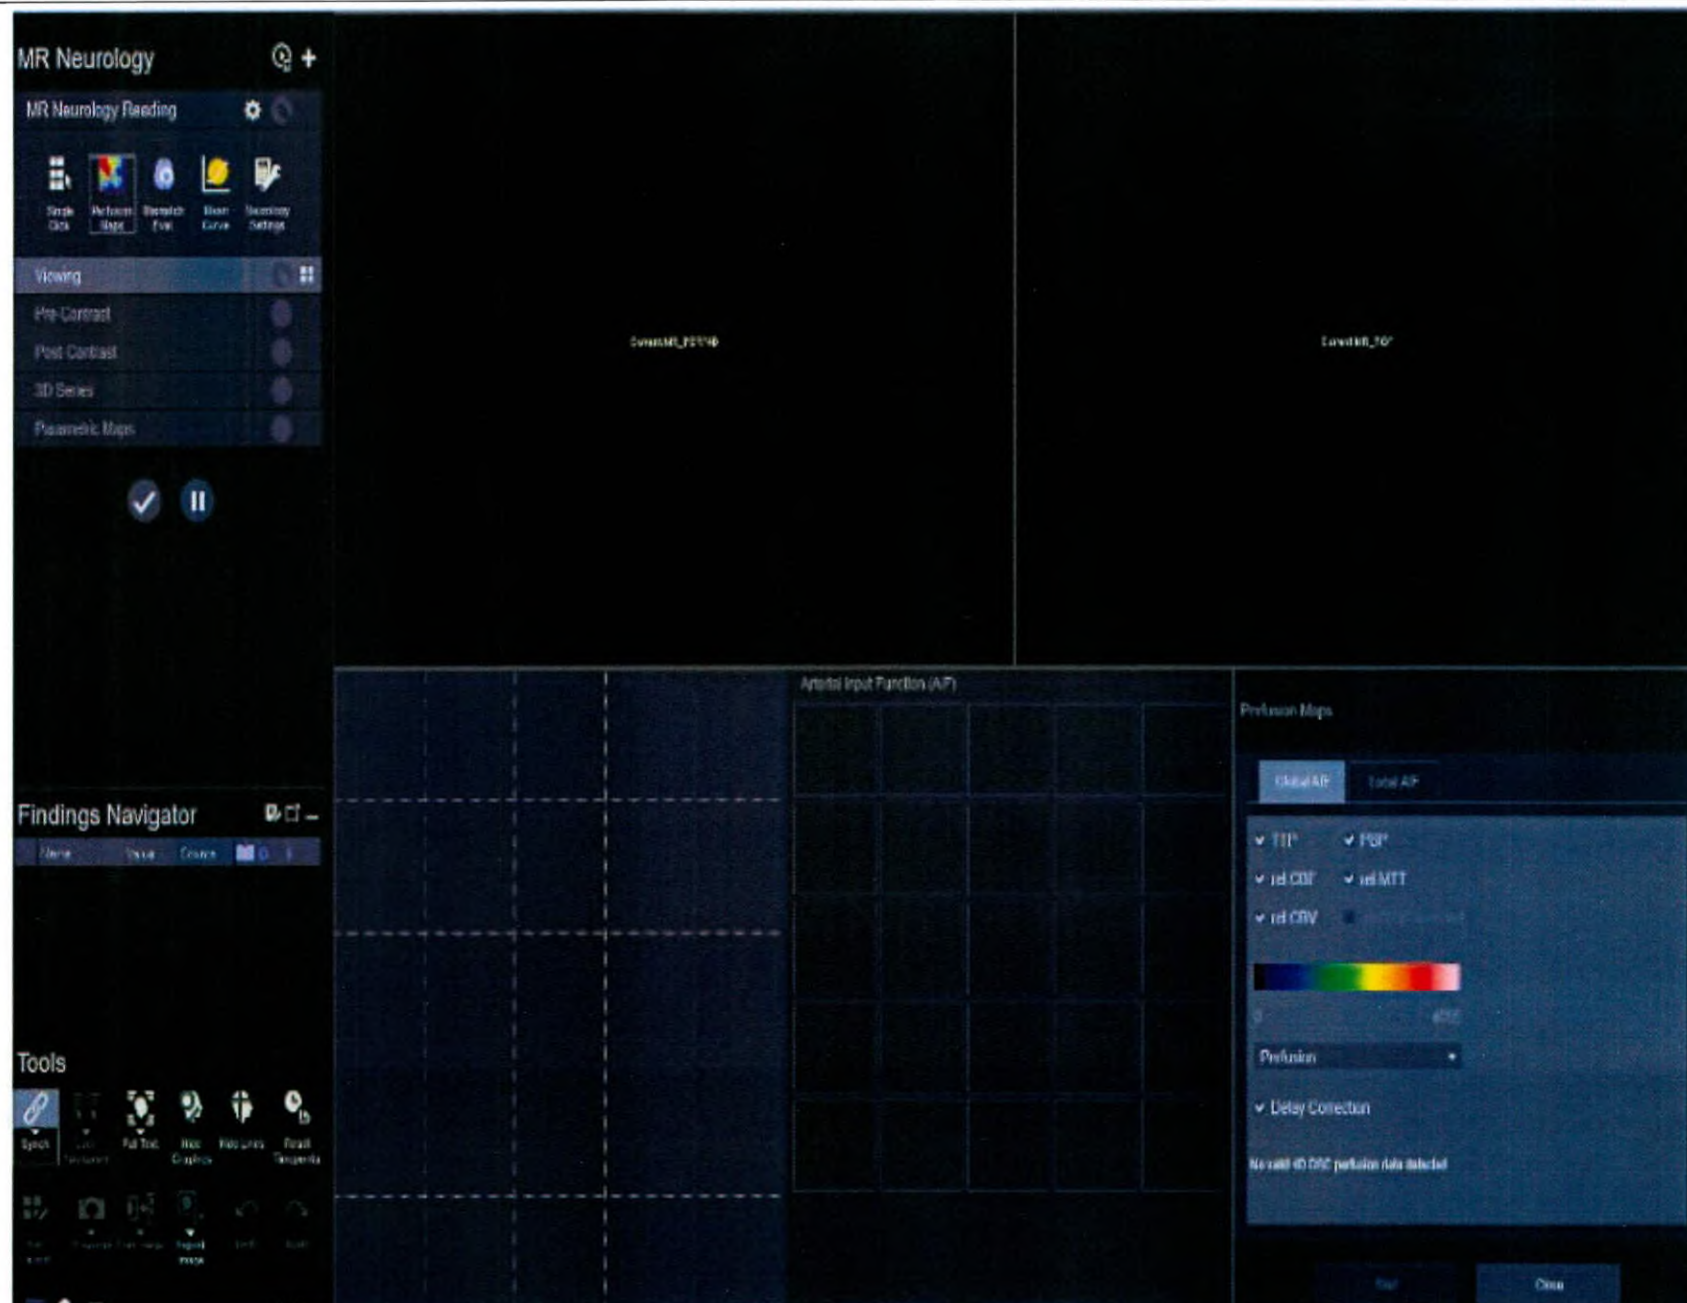


Лицензионные ключи для активации дополнительных программных режимов для экспертной обработки изображений

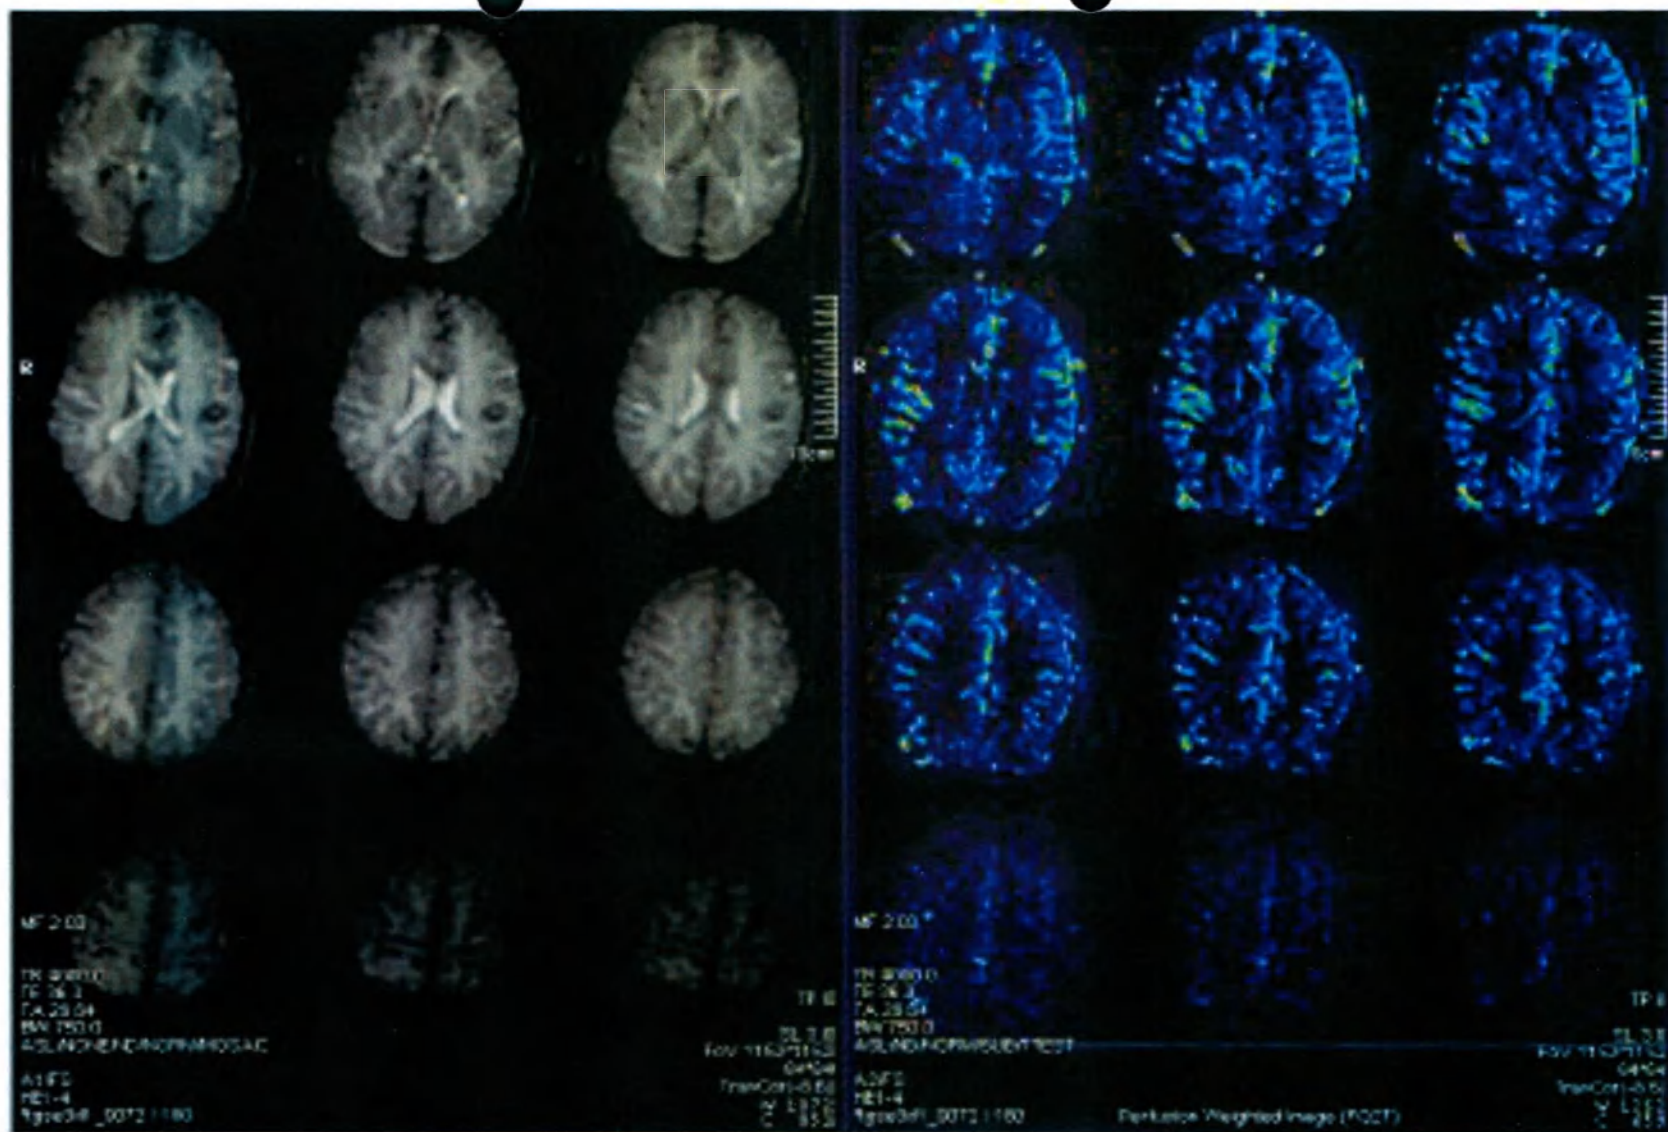


3D ASL acquisition output: (left) Original EPI image series; (right) Perfusion-weighted image.

Лицензионные ключи для активации дополнительных программных режимов сбора данных

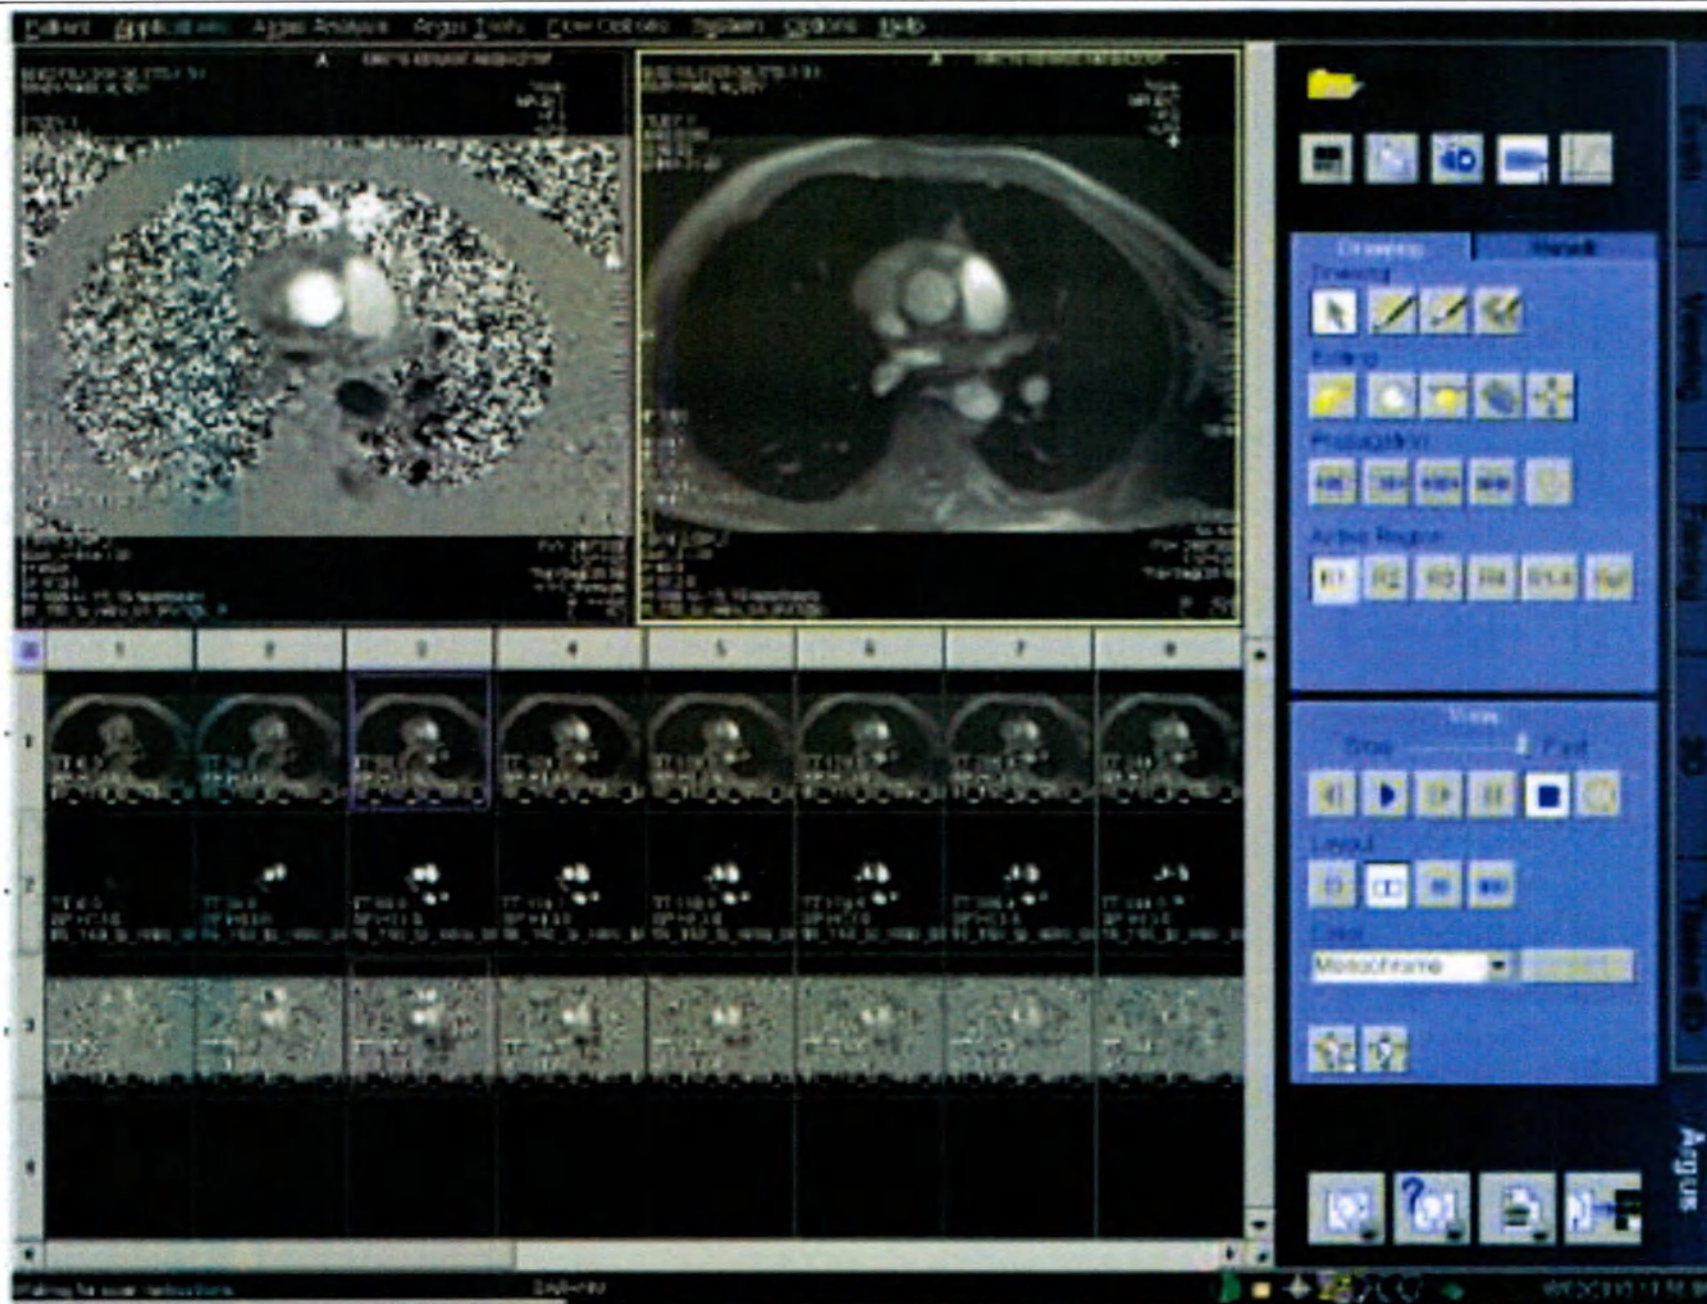

Лицензионные ключи для активации дополнительных программных режимов для просмотра и анализа динамических серий изображений

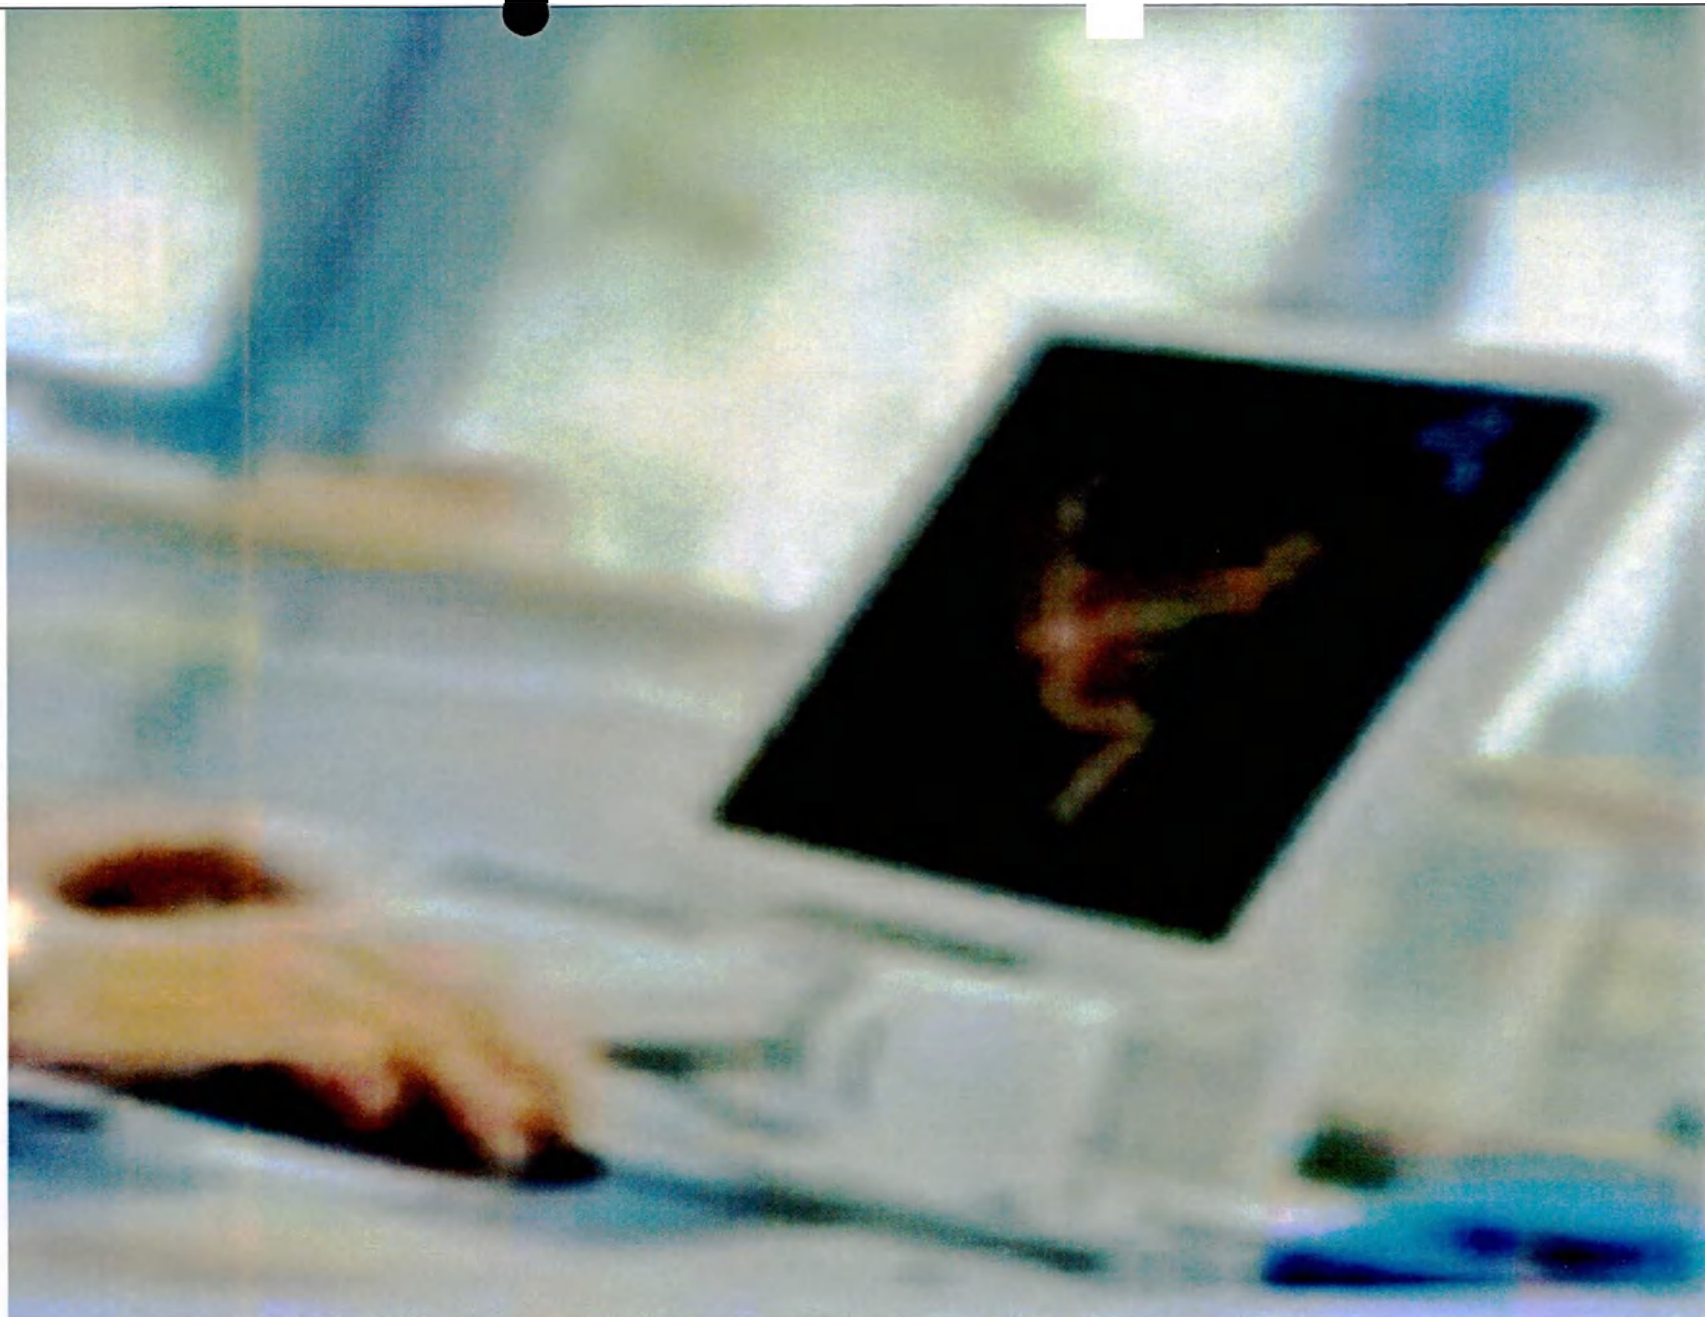


Лицензионные ключи для активации дополнительных программных режимов для планирования и управления исследованием



Источник бесперебойного электроснабжения.




Источник бесперебойного электроснабжения

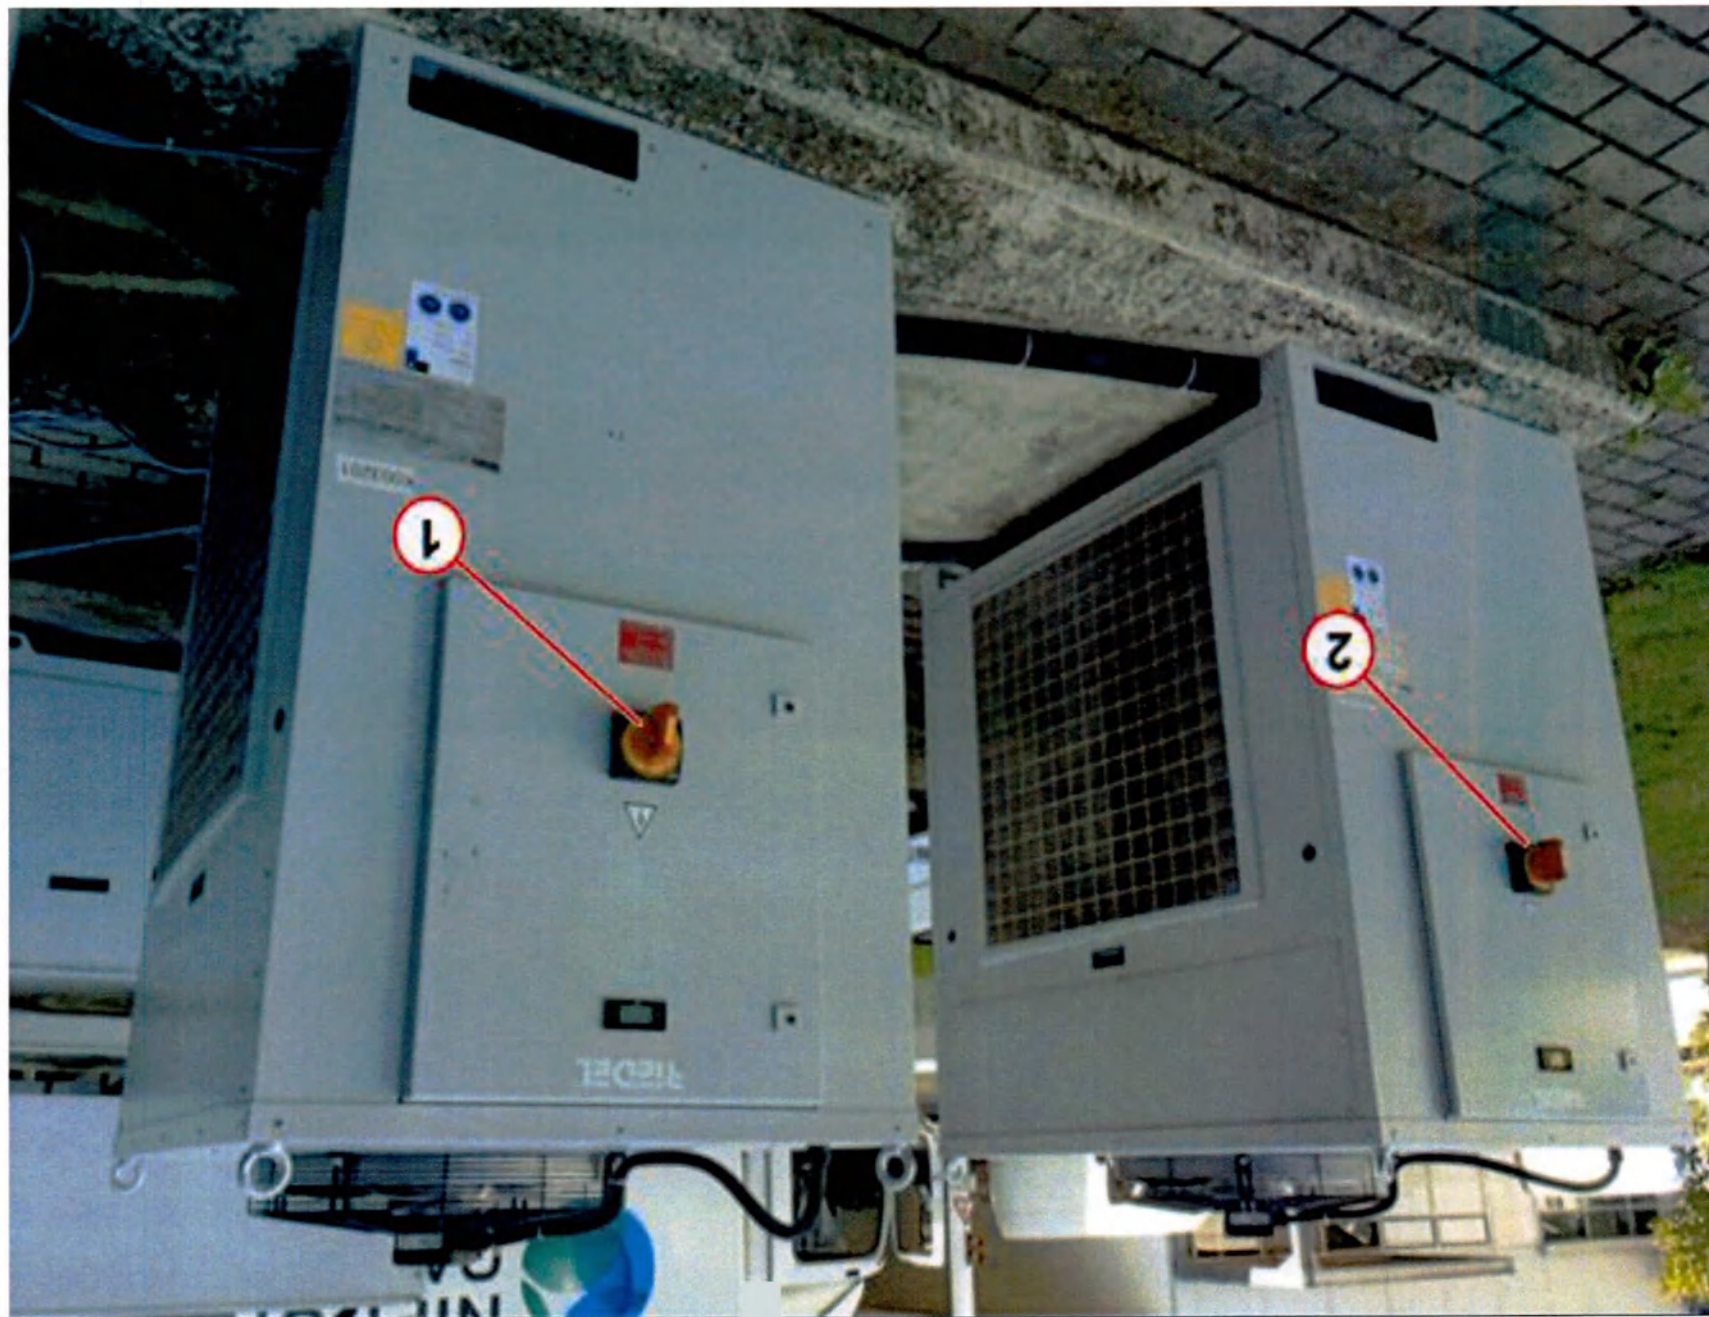





Резервный теплообменник

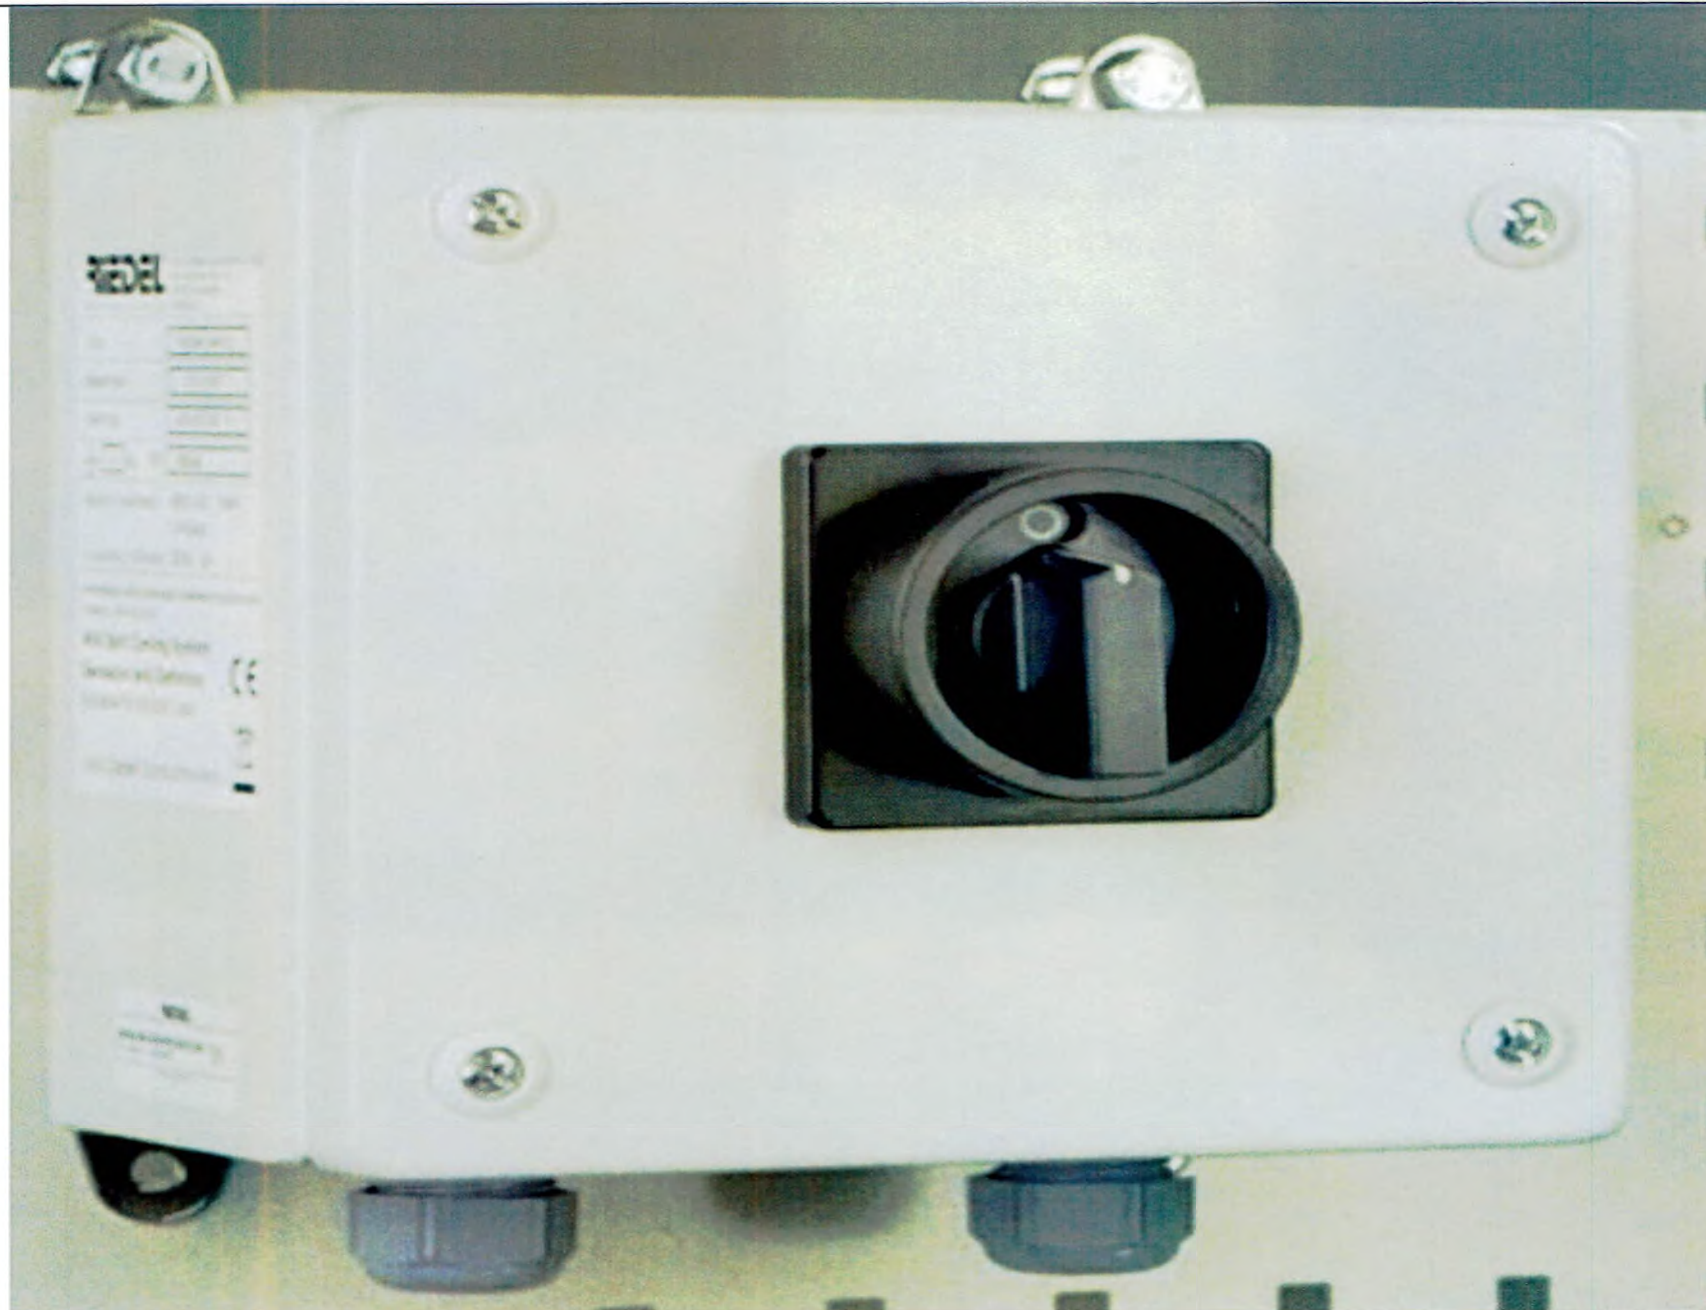

Электрощит распределительный

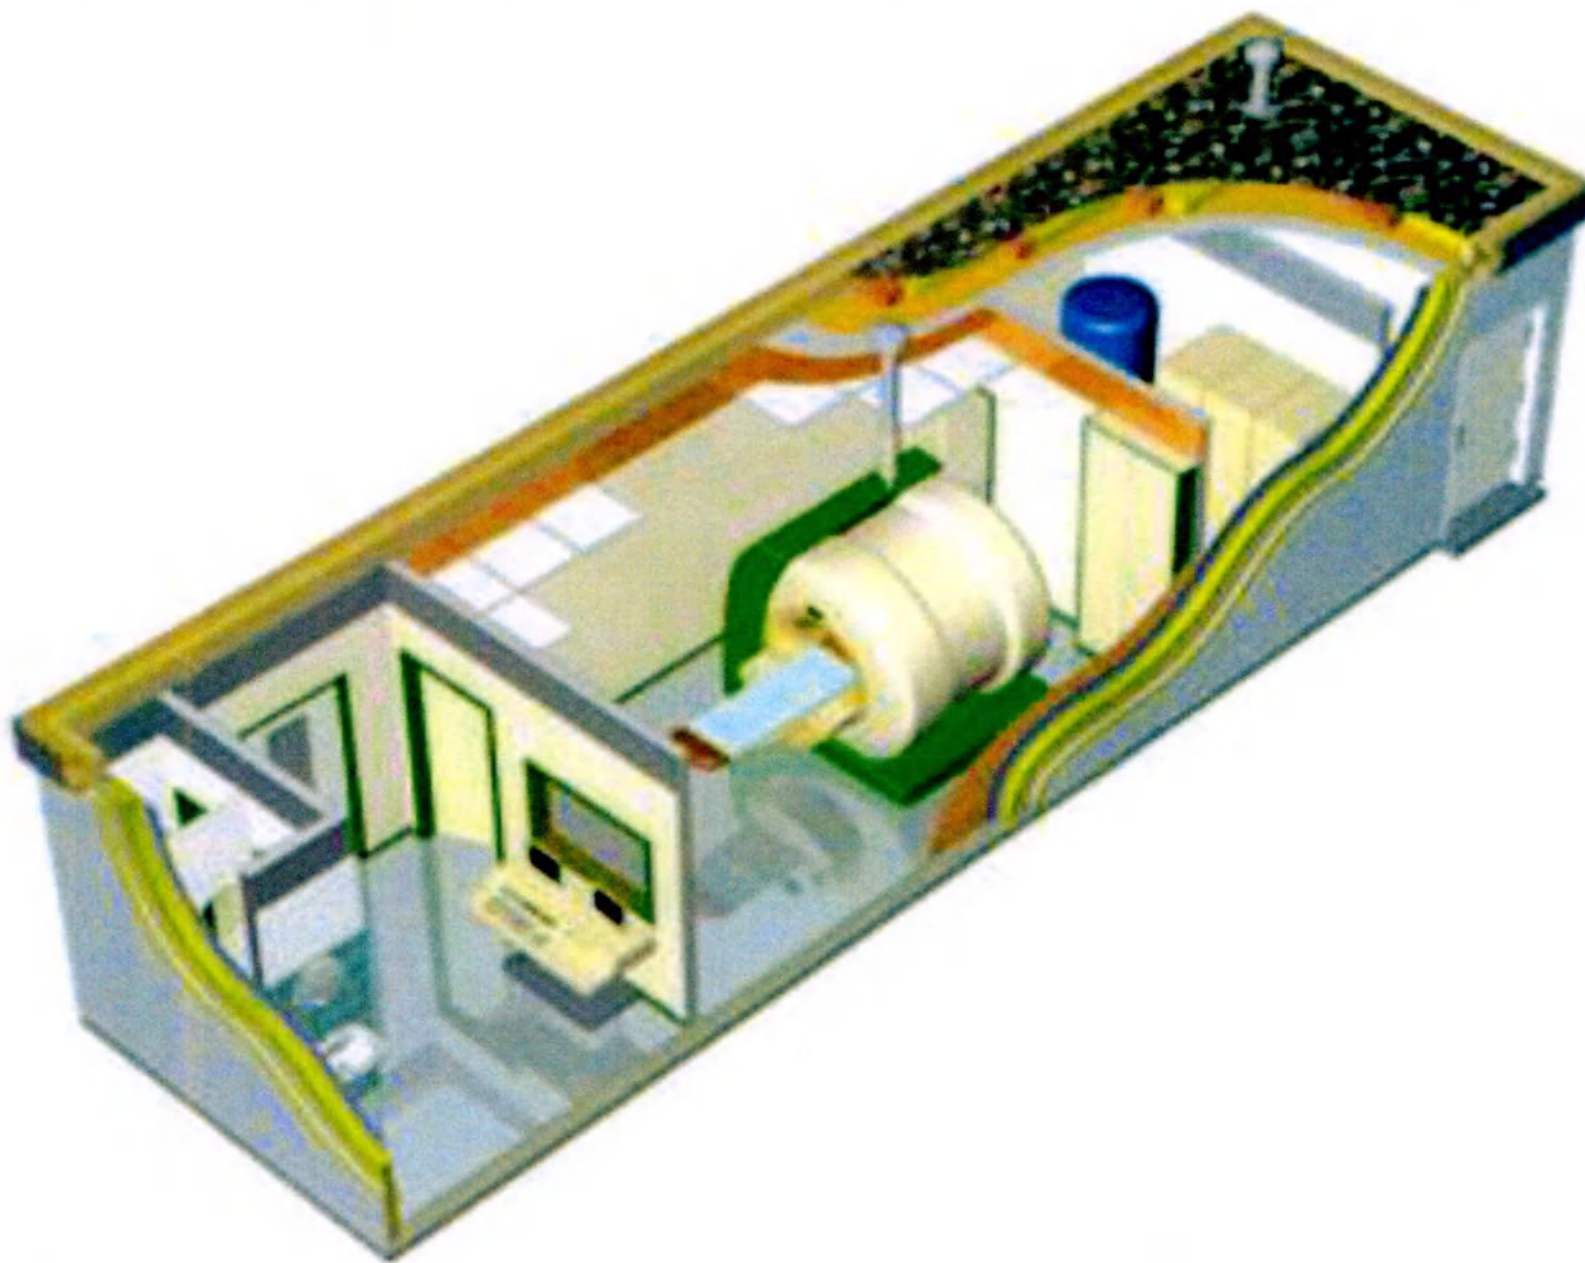

Кабина радиочастотная

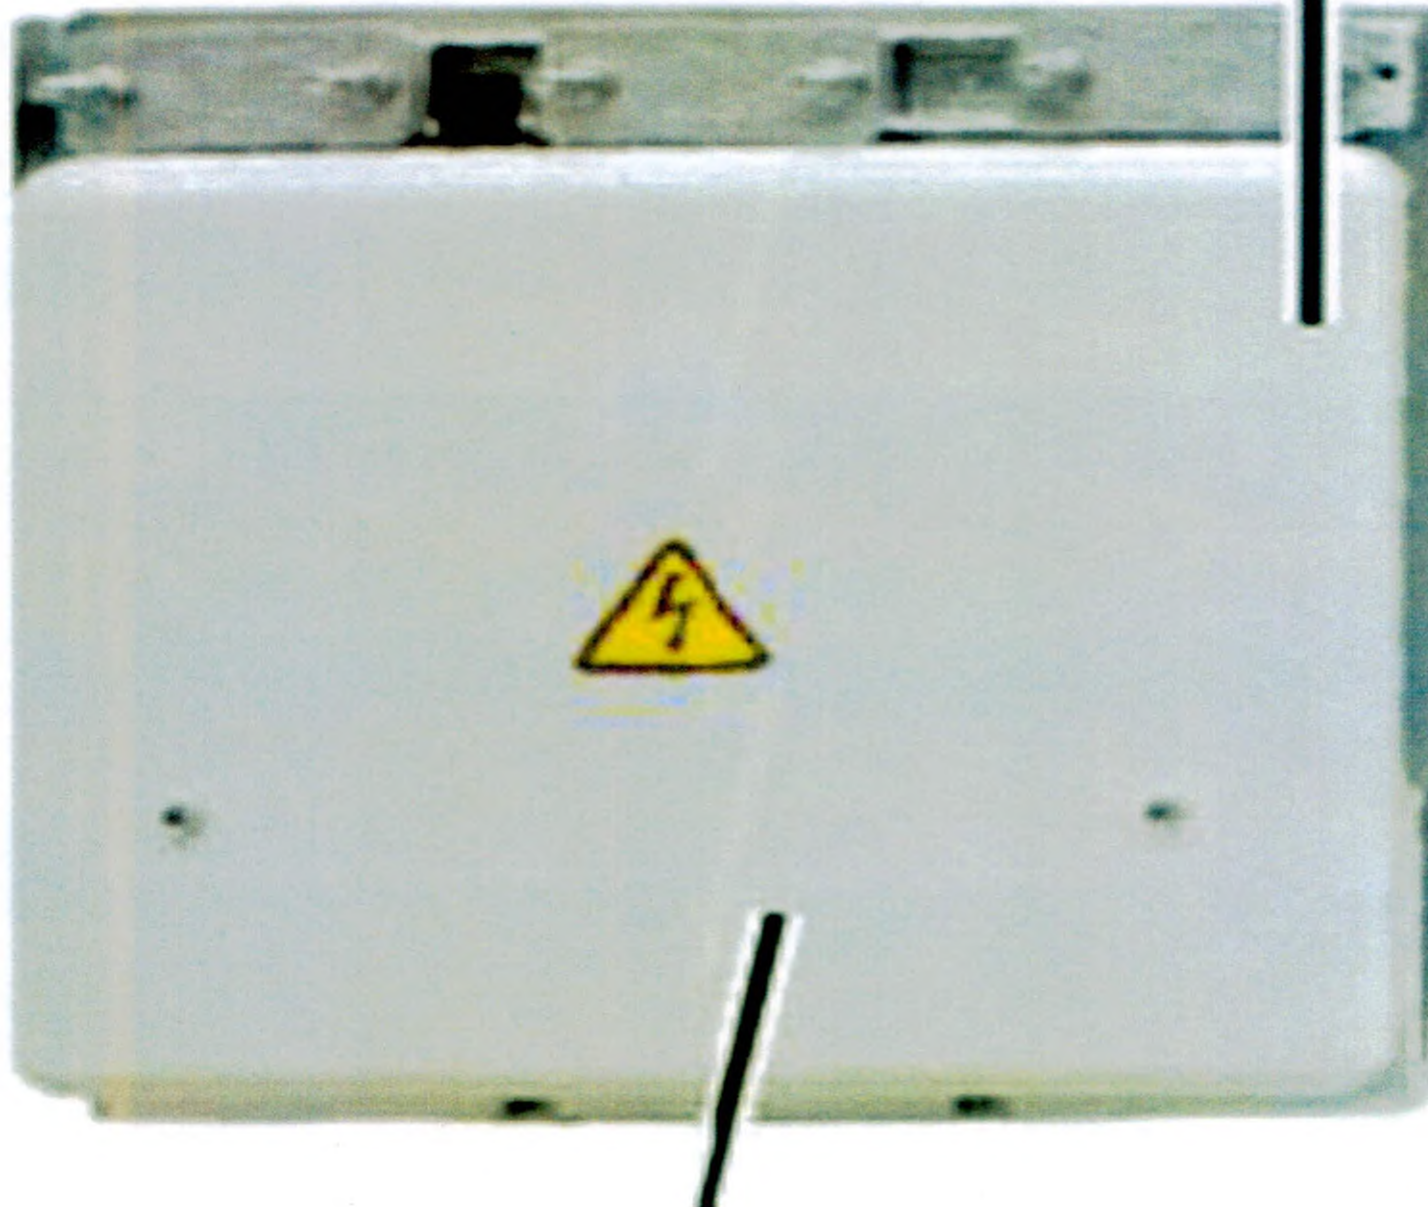


Фильтр радиочастотной кабины



Облицовка радиочастотной кабины



Звукоизоляция радиочастотной кабины

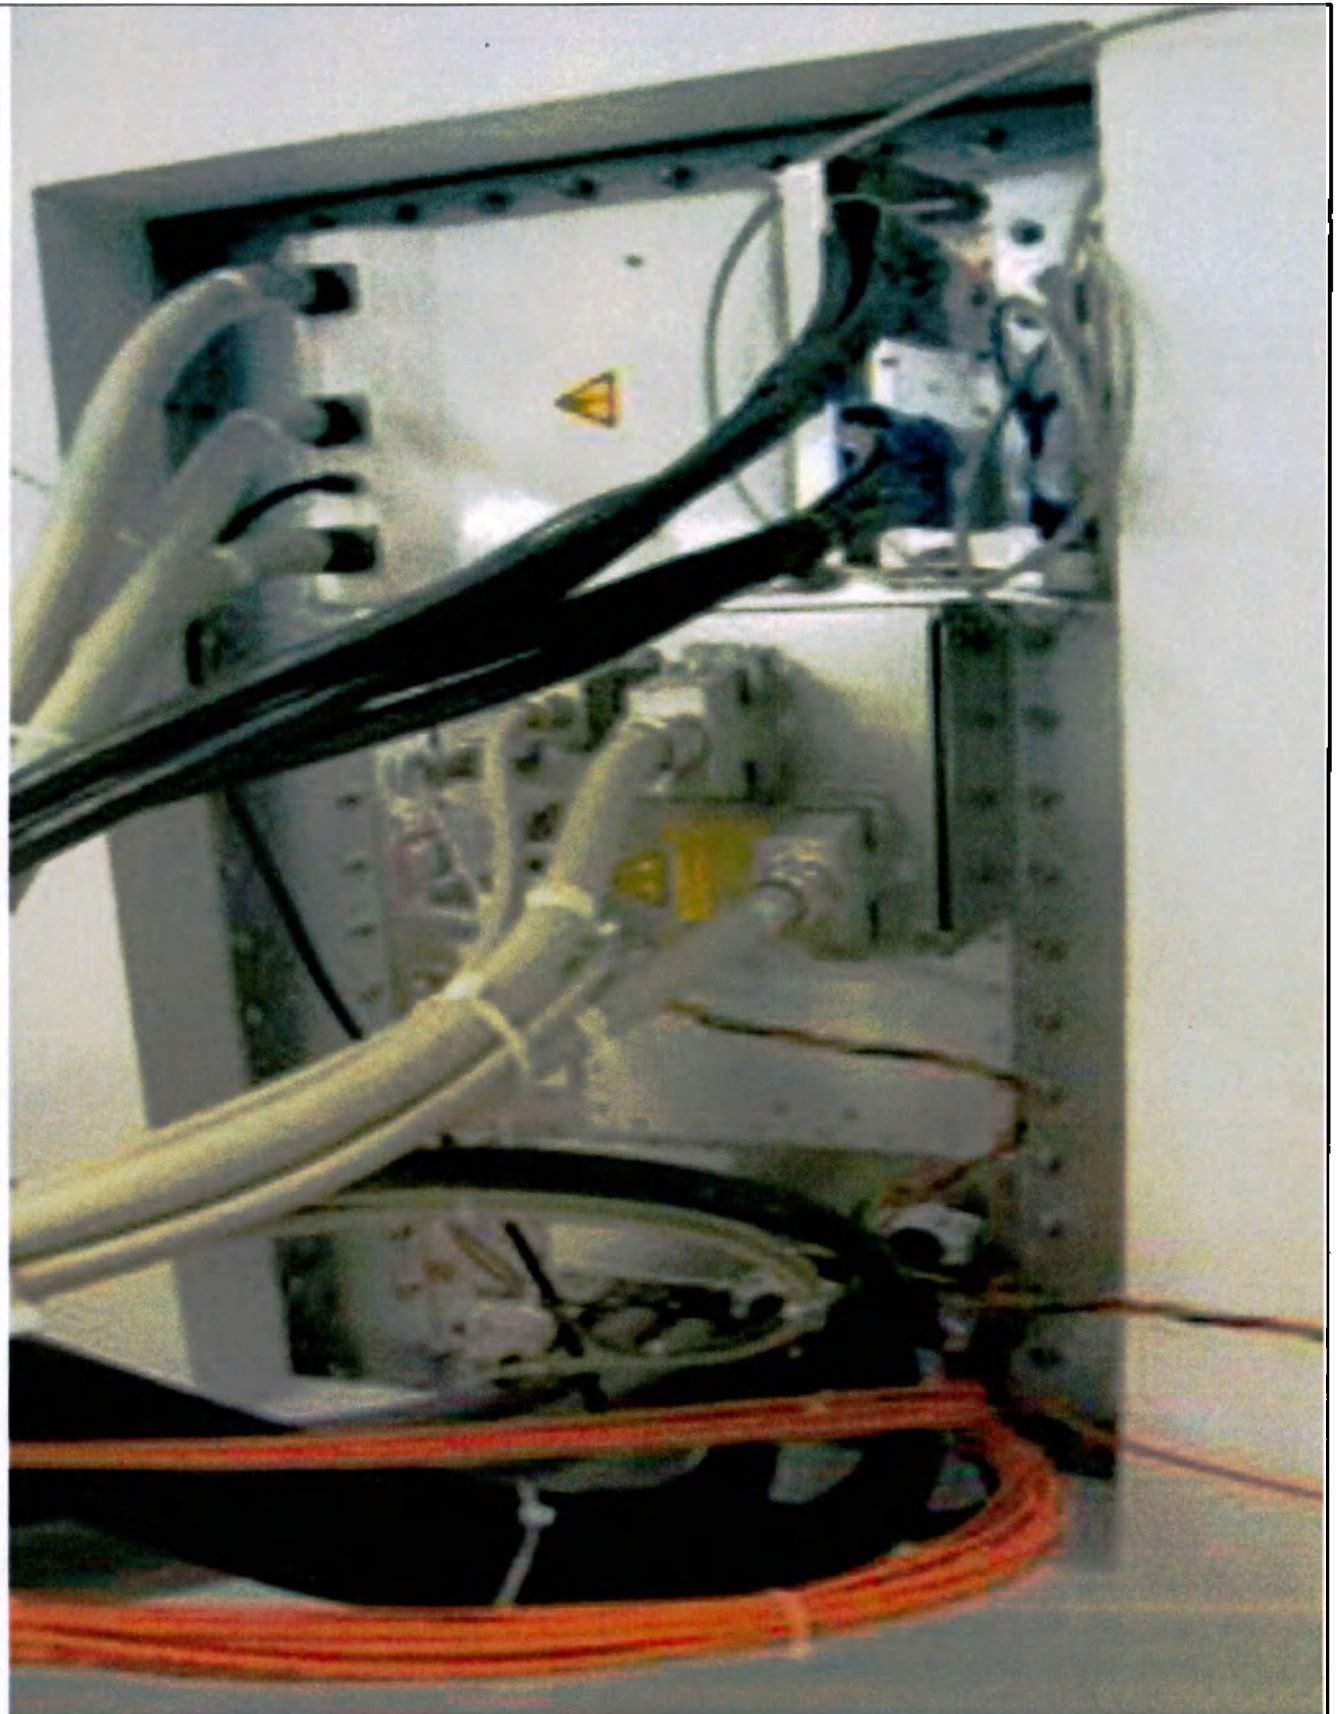

Шкаф с сетевыми фильтрами



Люки аварийные для экстренной эвакуации




Окна для радиочастотной кабины




Двери для радиочастотной кабины




Столы оператора

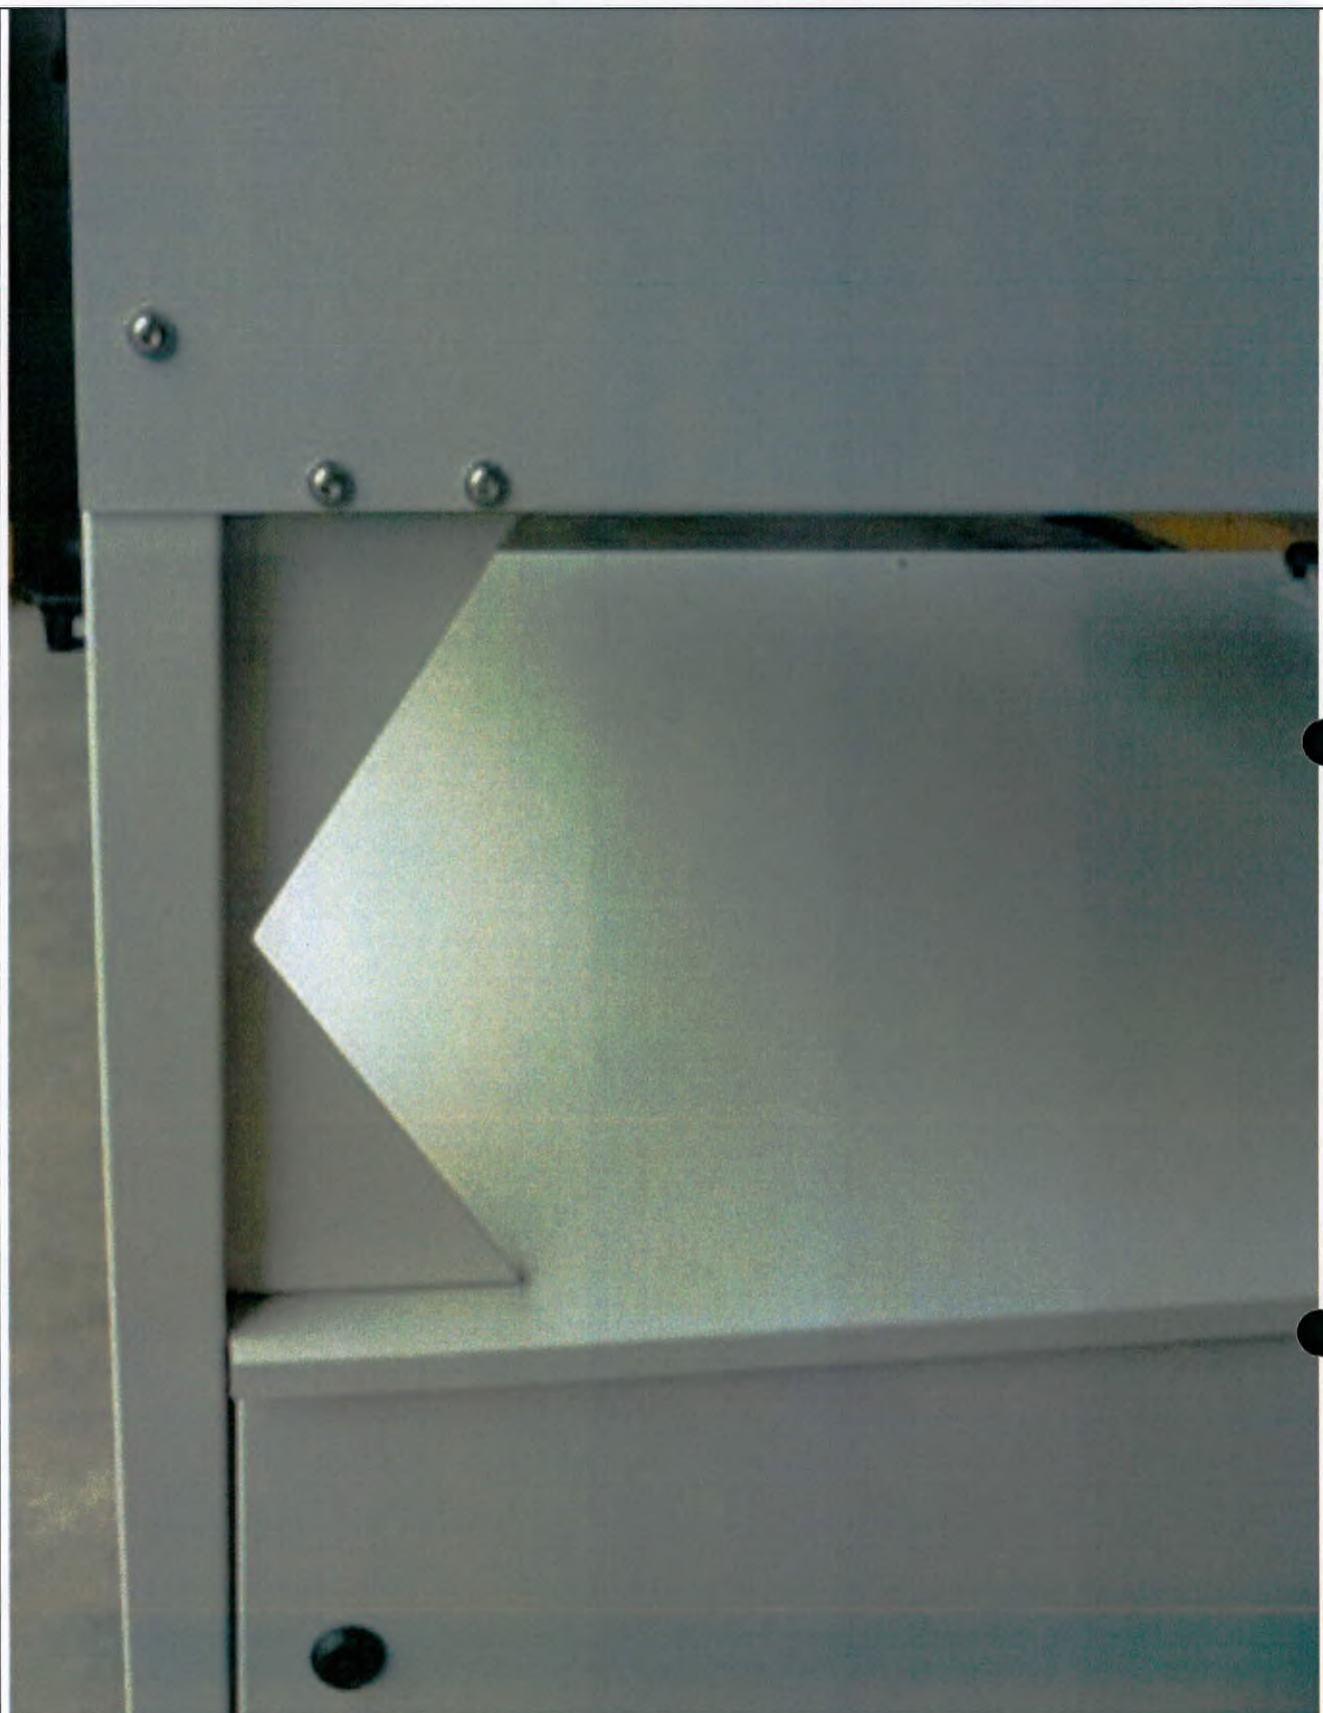


Монтажные фиксаторы для сейсмоопасных зон

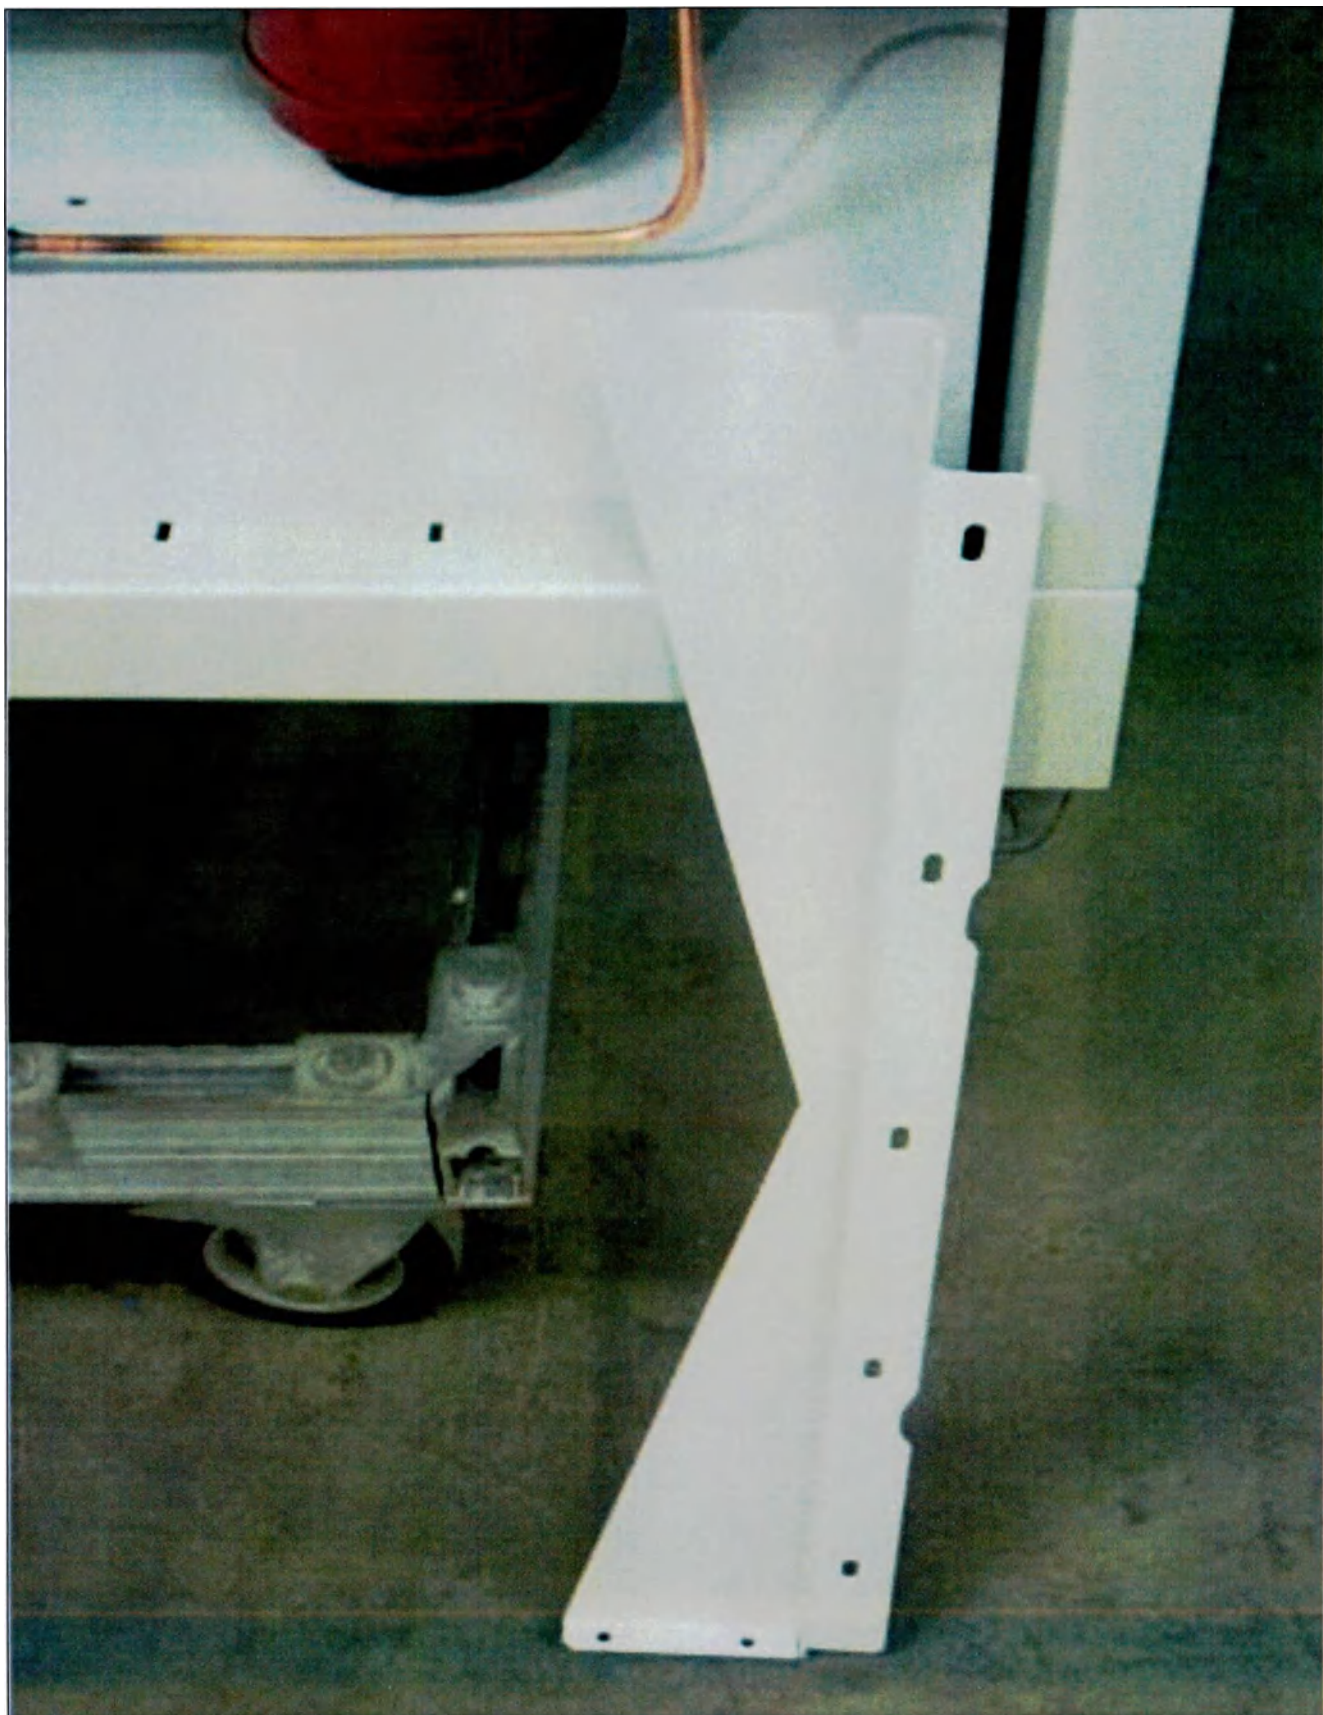

Монтажные фиксаторы для сейсмоопасных зон

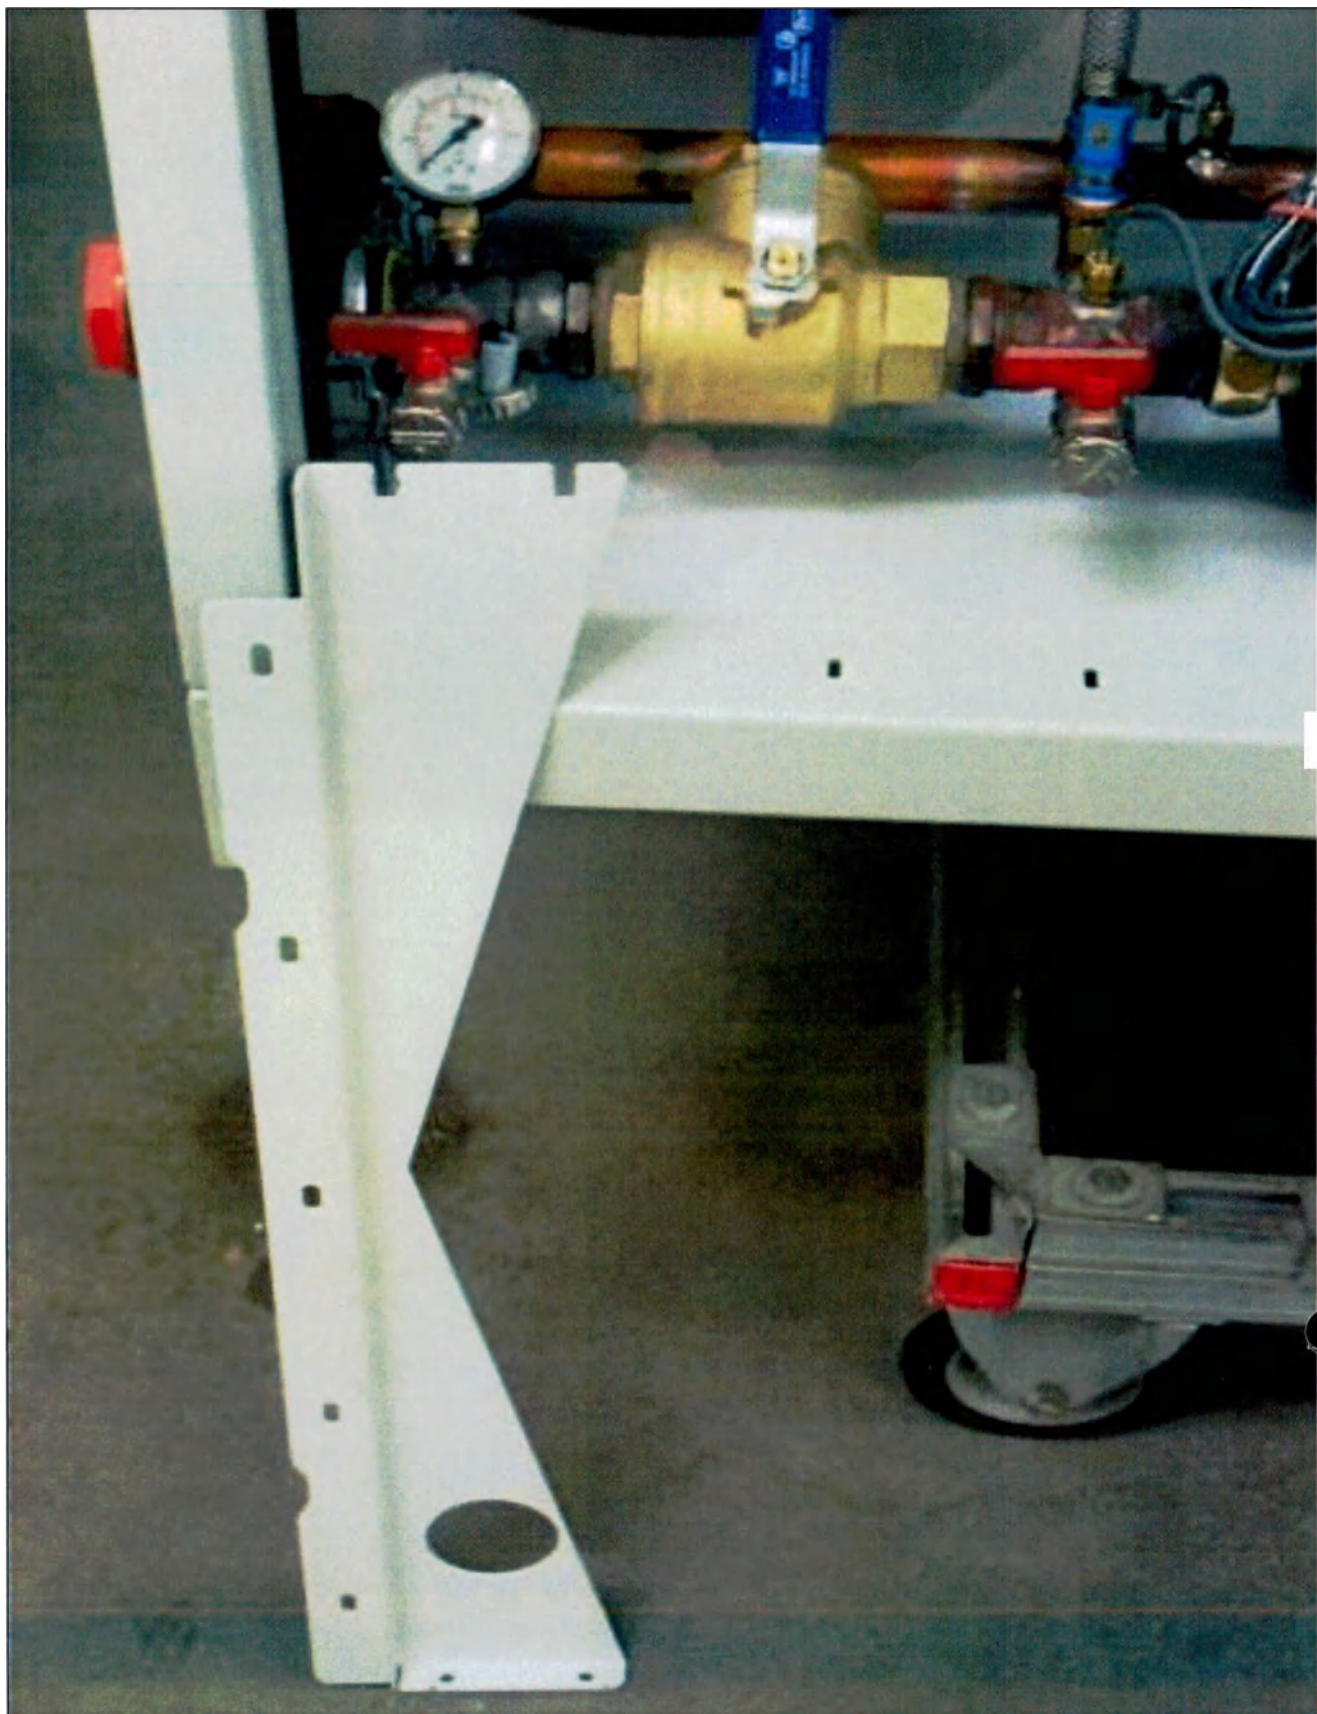

Монтажные фиксаторы для сейсмоопасных зон

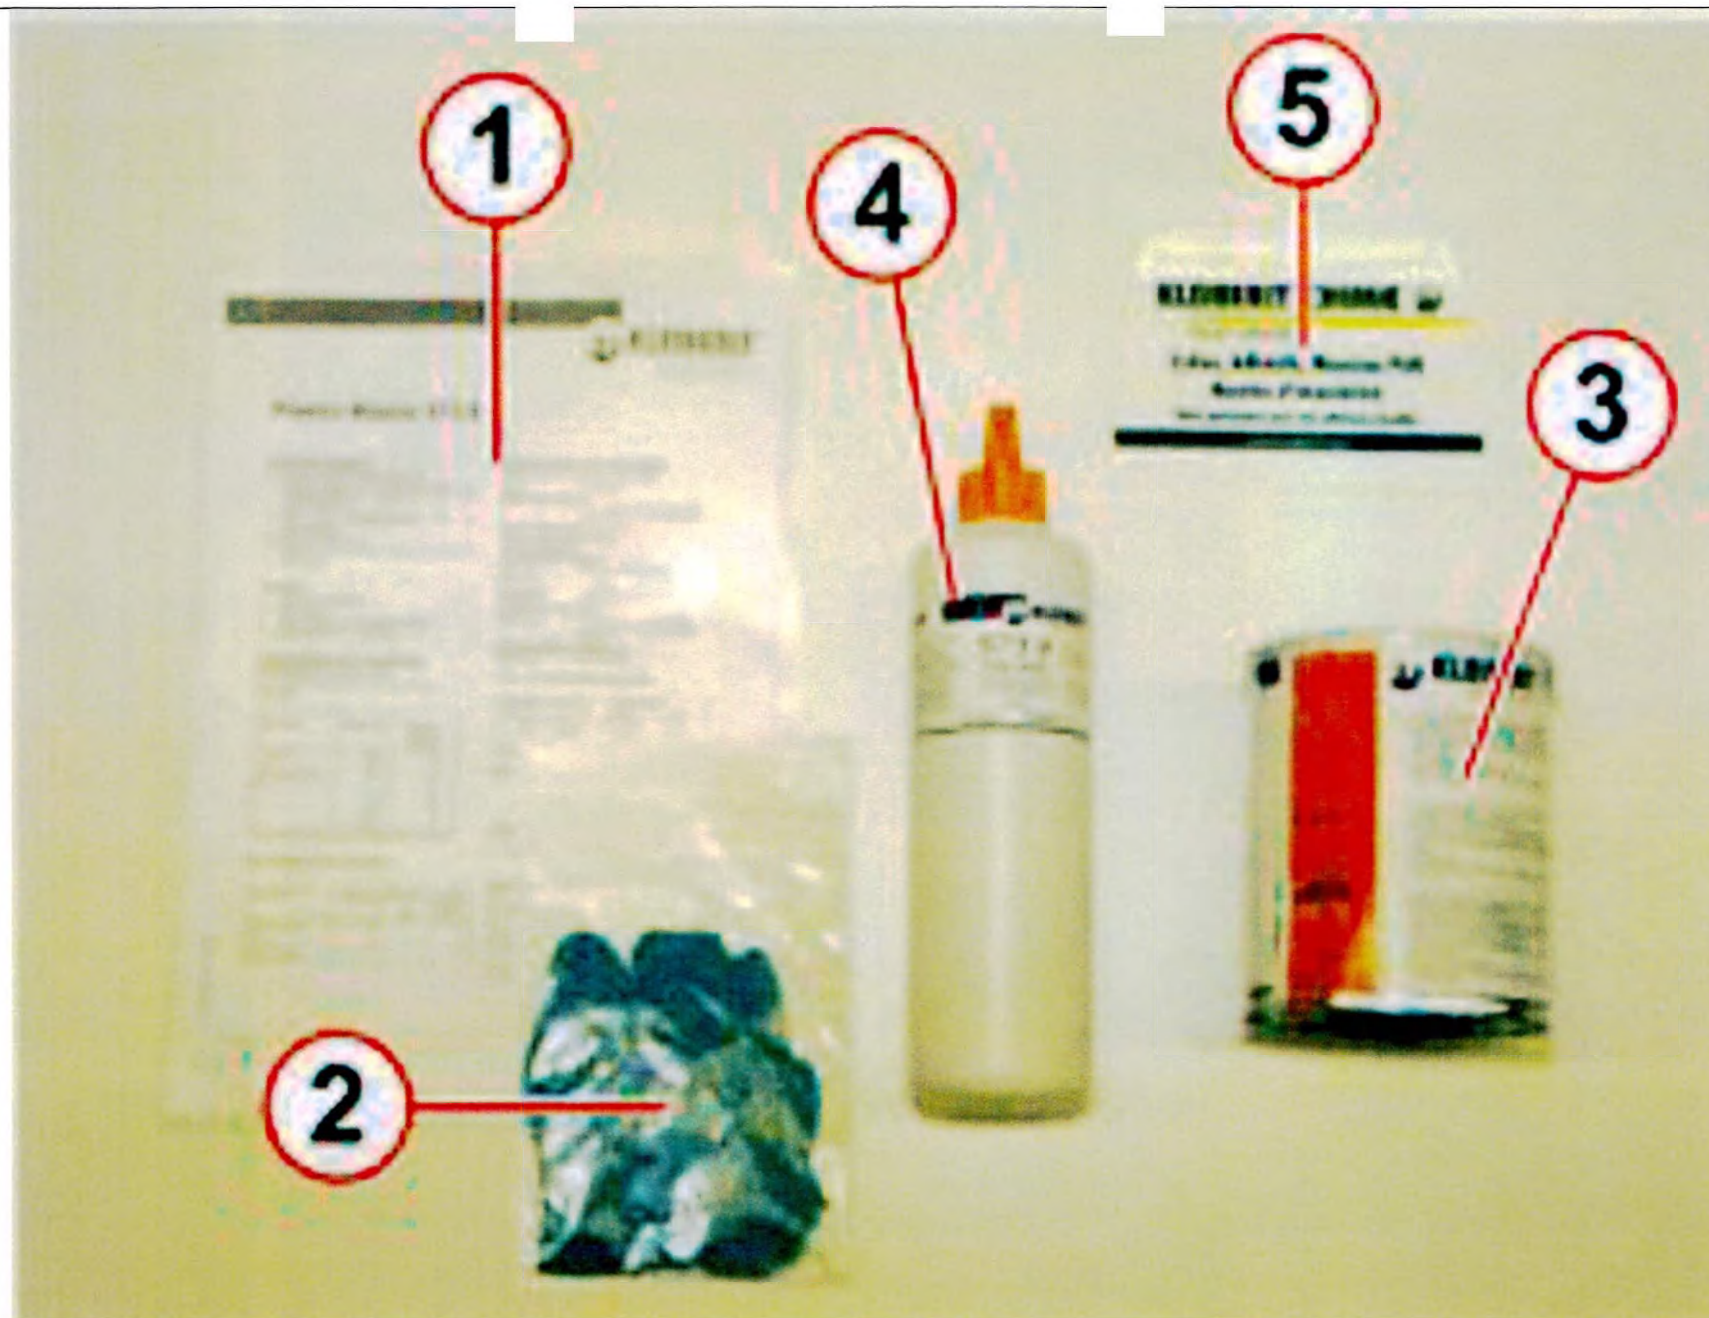

Комплект монтажный для подстройки высоты стола пациента под магнит, установленный на постаменте (Клей, перчатки, линолеум прорезиненный, масло)

Система магнитно – резонансной томографии MAGNETOM Free.Max с принадлежностями

Регистрационное удостоверение: РЗН XXXX/XXXX от дд.мм.гггг

Страна производства: Китай

Дата производства и серийный номер указаны на основной маркировке изделия

Назначение; нормативная документация, требованиям которой соответствует медицинское изделие; массогабаритные характеристики и срок службы изделия указаны в документации пользователя

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д.96

3/PE ~ 380/400/440/480 В;

50/60 Гц

47 кВА / 13 кВА

Макет русскоязычной маркировки (производственная площадка: КНР)

Система магнитно – резонансной томографии MAGNETOM Free.Max с принадлежностями

Регистрационное удостоверение: РЗН XXXX/XXXX от дд.мм.гггг

Страна производства: Германия

Дата производства и серийный номер указаны на основной маркировке изделия

Назначение; нормативная документация, требованиям которой соответствует медицинское изделие; массогабаритные характеристики и срок службы изделия указаны в документации пользователя

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д.96

3/PE ~ 380/400/440/480 В;

50/60 Гц

47 кВА / 13 кВА

Макет русскоязычной маркировки (производственная площадка: Германия)




Упаковка магнита



Упаковка коробки с принадлежностями для заказчика



Упаковка сепаратора системы

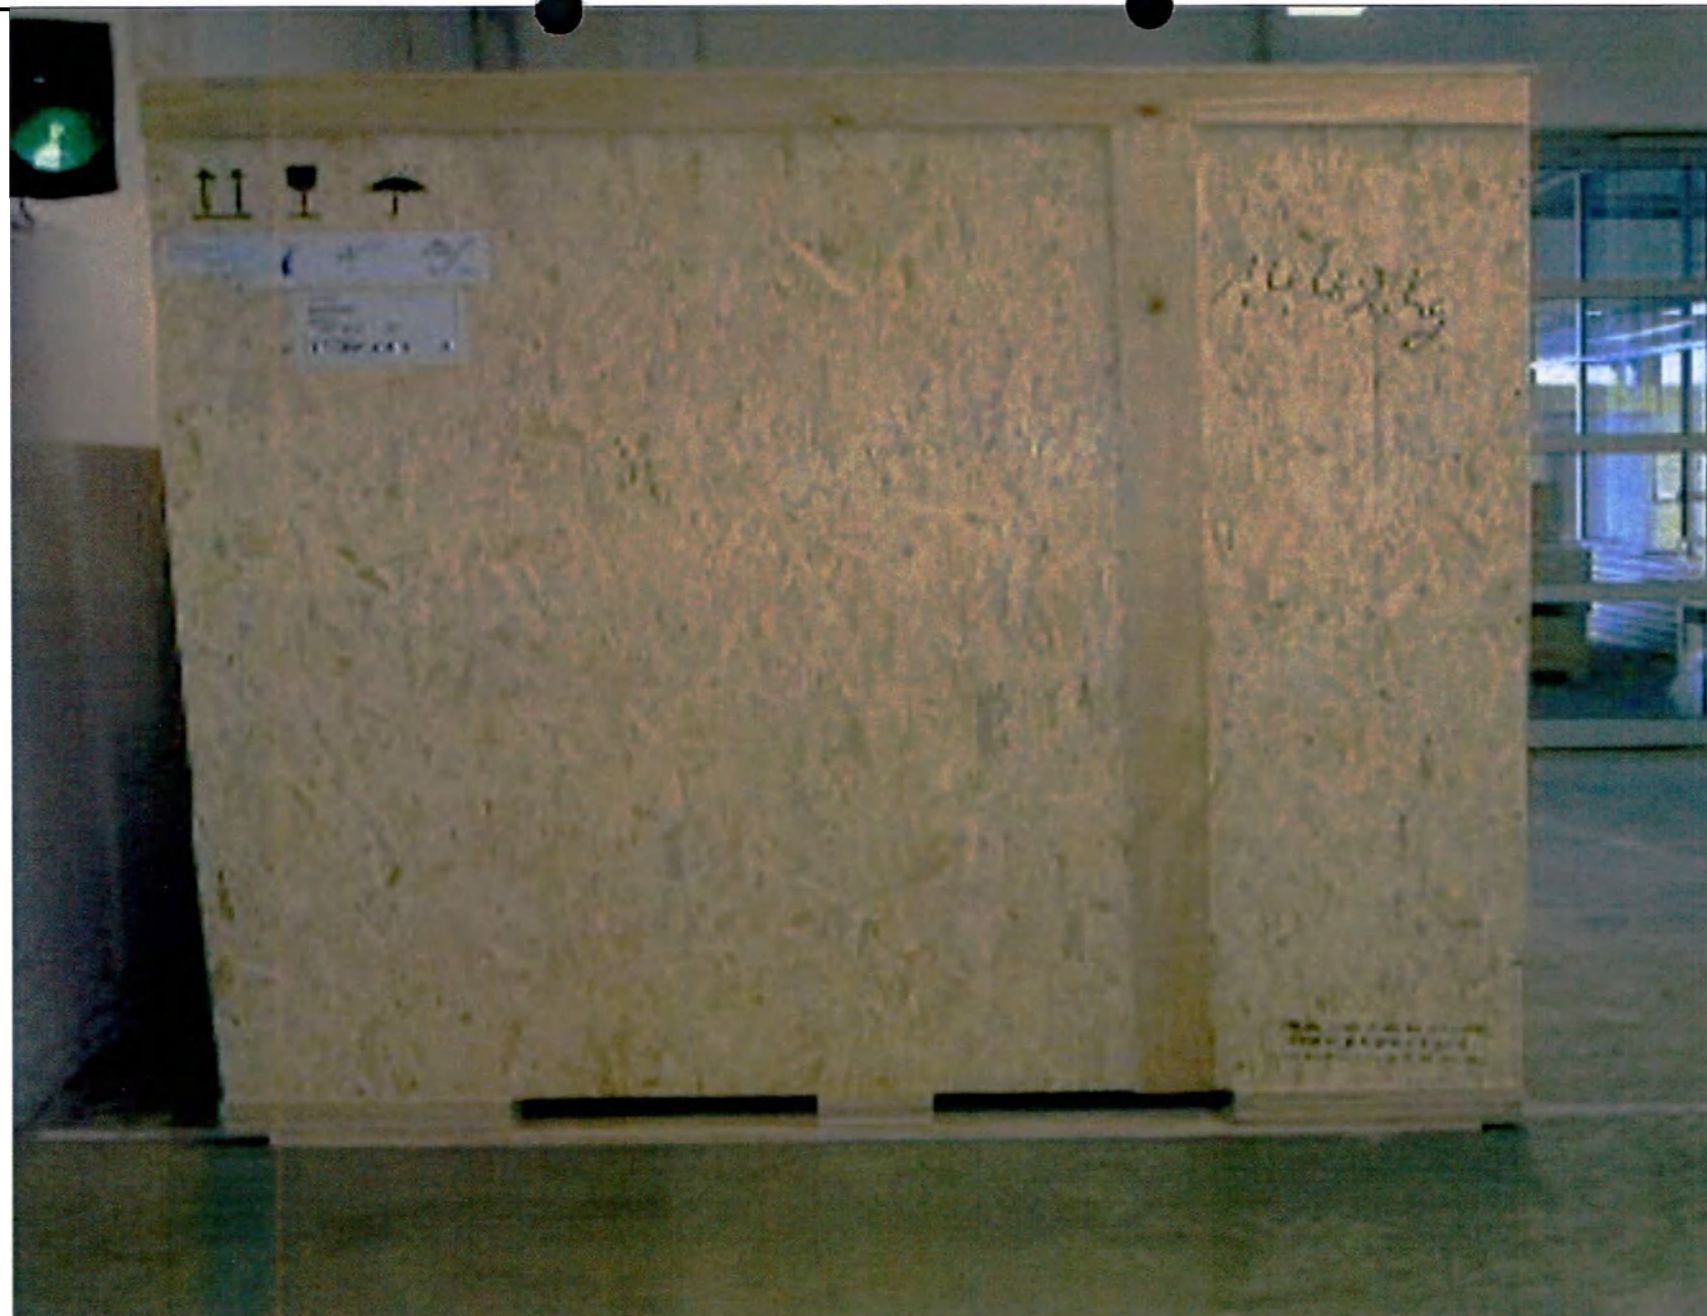

Упаковка шкафа с электронным оборудованием





Упаковка стола пациента



Упаковка кожуха и крышки



Упаковка катушек, принадлежностей, документов

Всего прошито и пронумеровано
66 листа (ов).

ООО «Сименс Здравоохранение»

