


Микроскоп хирургический АМ-2000


Общий вид:



1) Блок оптический микроскопа АМ-2000 – 1 шт. (Optical unit of the microscope АМ-2000 – 1 pc.)

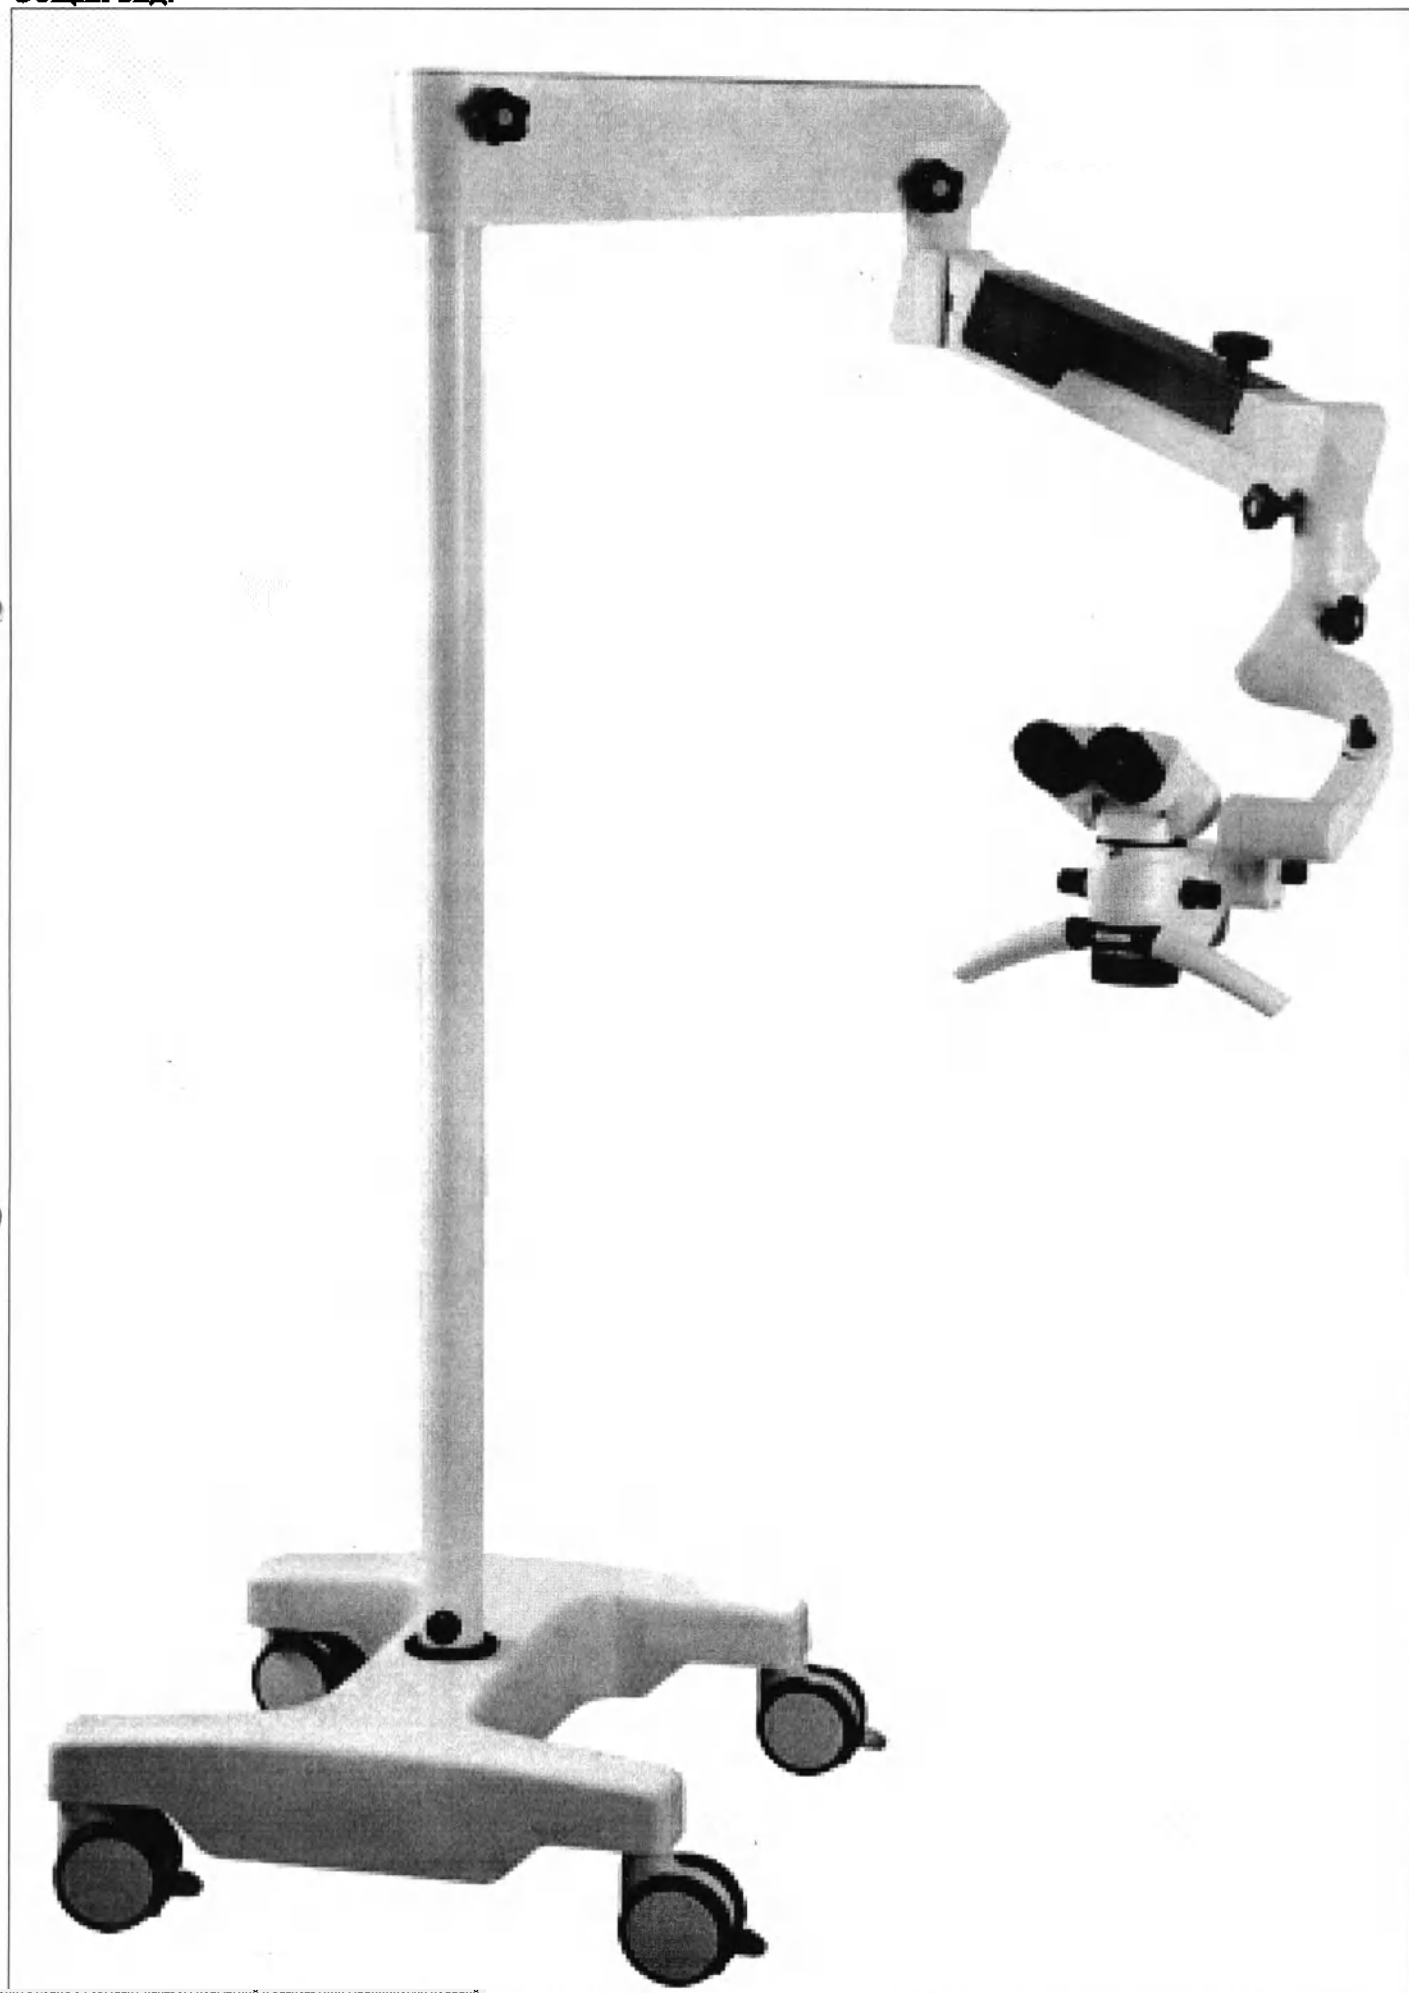

2) Подставка напольная передвижная для АМ-2000 (при необходимости) – 1 шт. (Mobile Floor Stand for AM-2000 (if necessary) – 1 pc.)

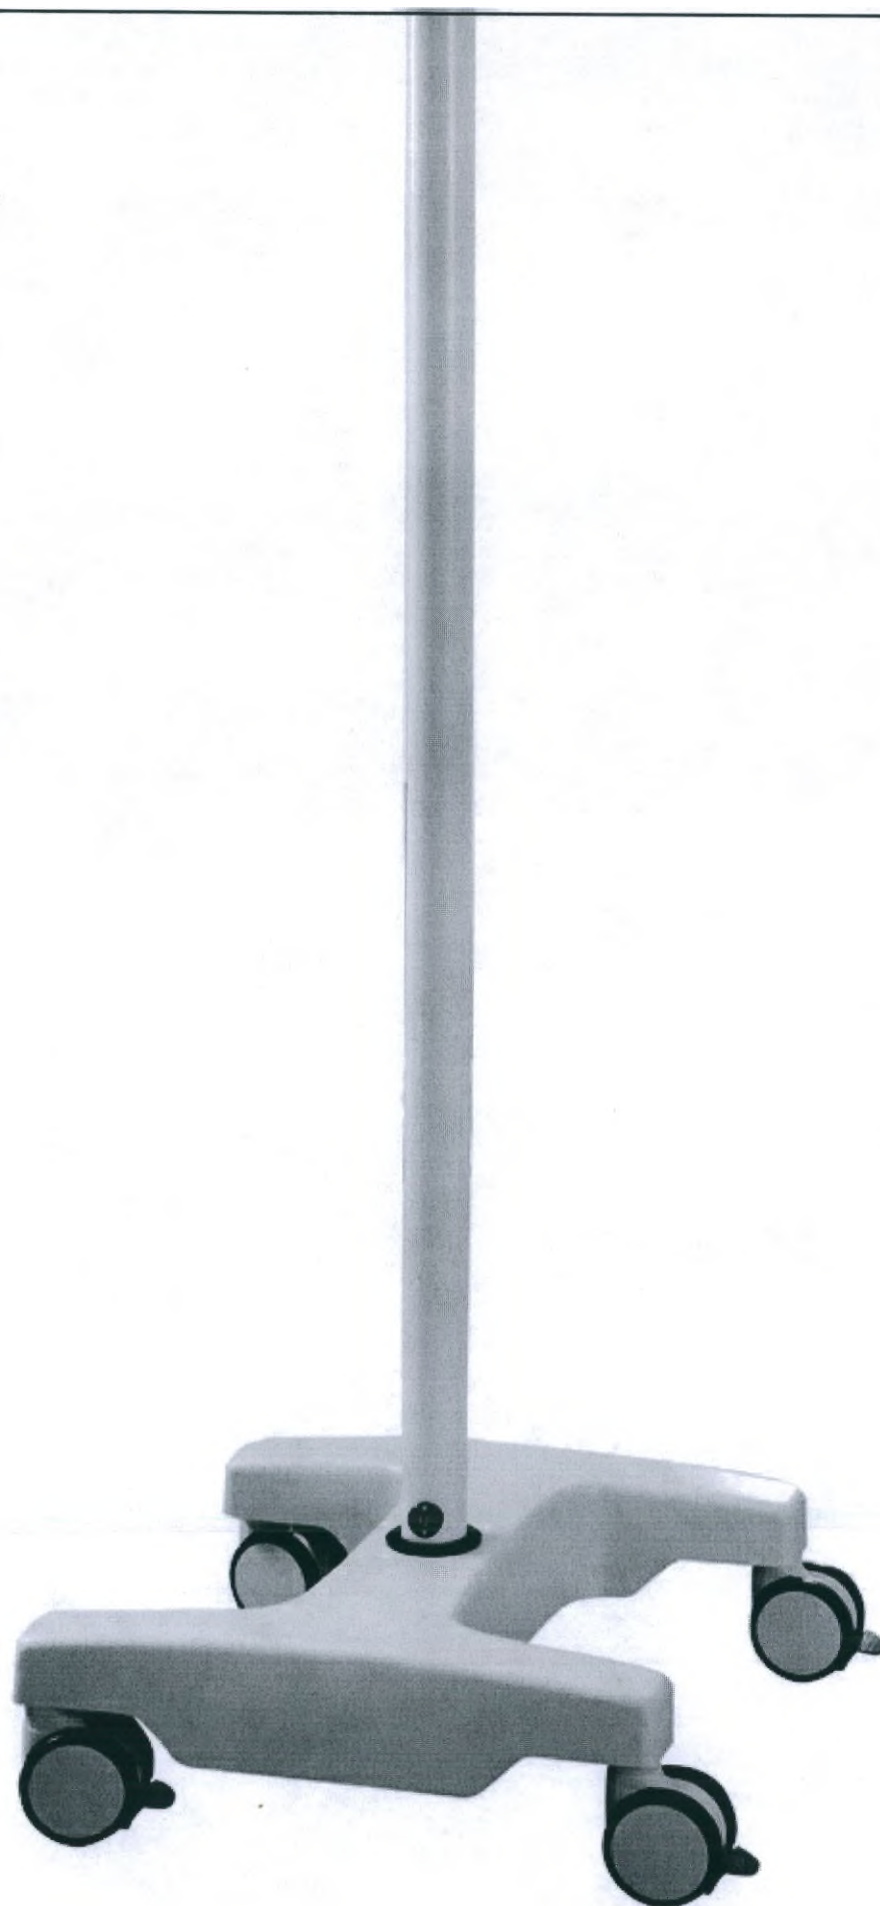


3) Подставка напольная стационарная для АМ-2000 (при необходимости) – 1 шт. (Fixed Stand for AM-2000 (if necessary) – 1 pc.)



4) Крепление потолочное для АМ-2000(при необходимости) – 1 шт. (Ceiling mount for AM-2000 (if necessary) – 1 pc.)



5) Крепление настенное в низком положении для АМ-2000 (при необходимости) – 1 шт. (Low-position Wall Mount for AM-2000 (if necessary)– 1 pc.)

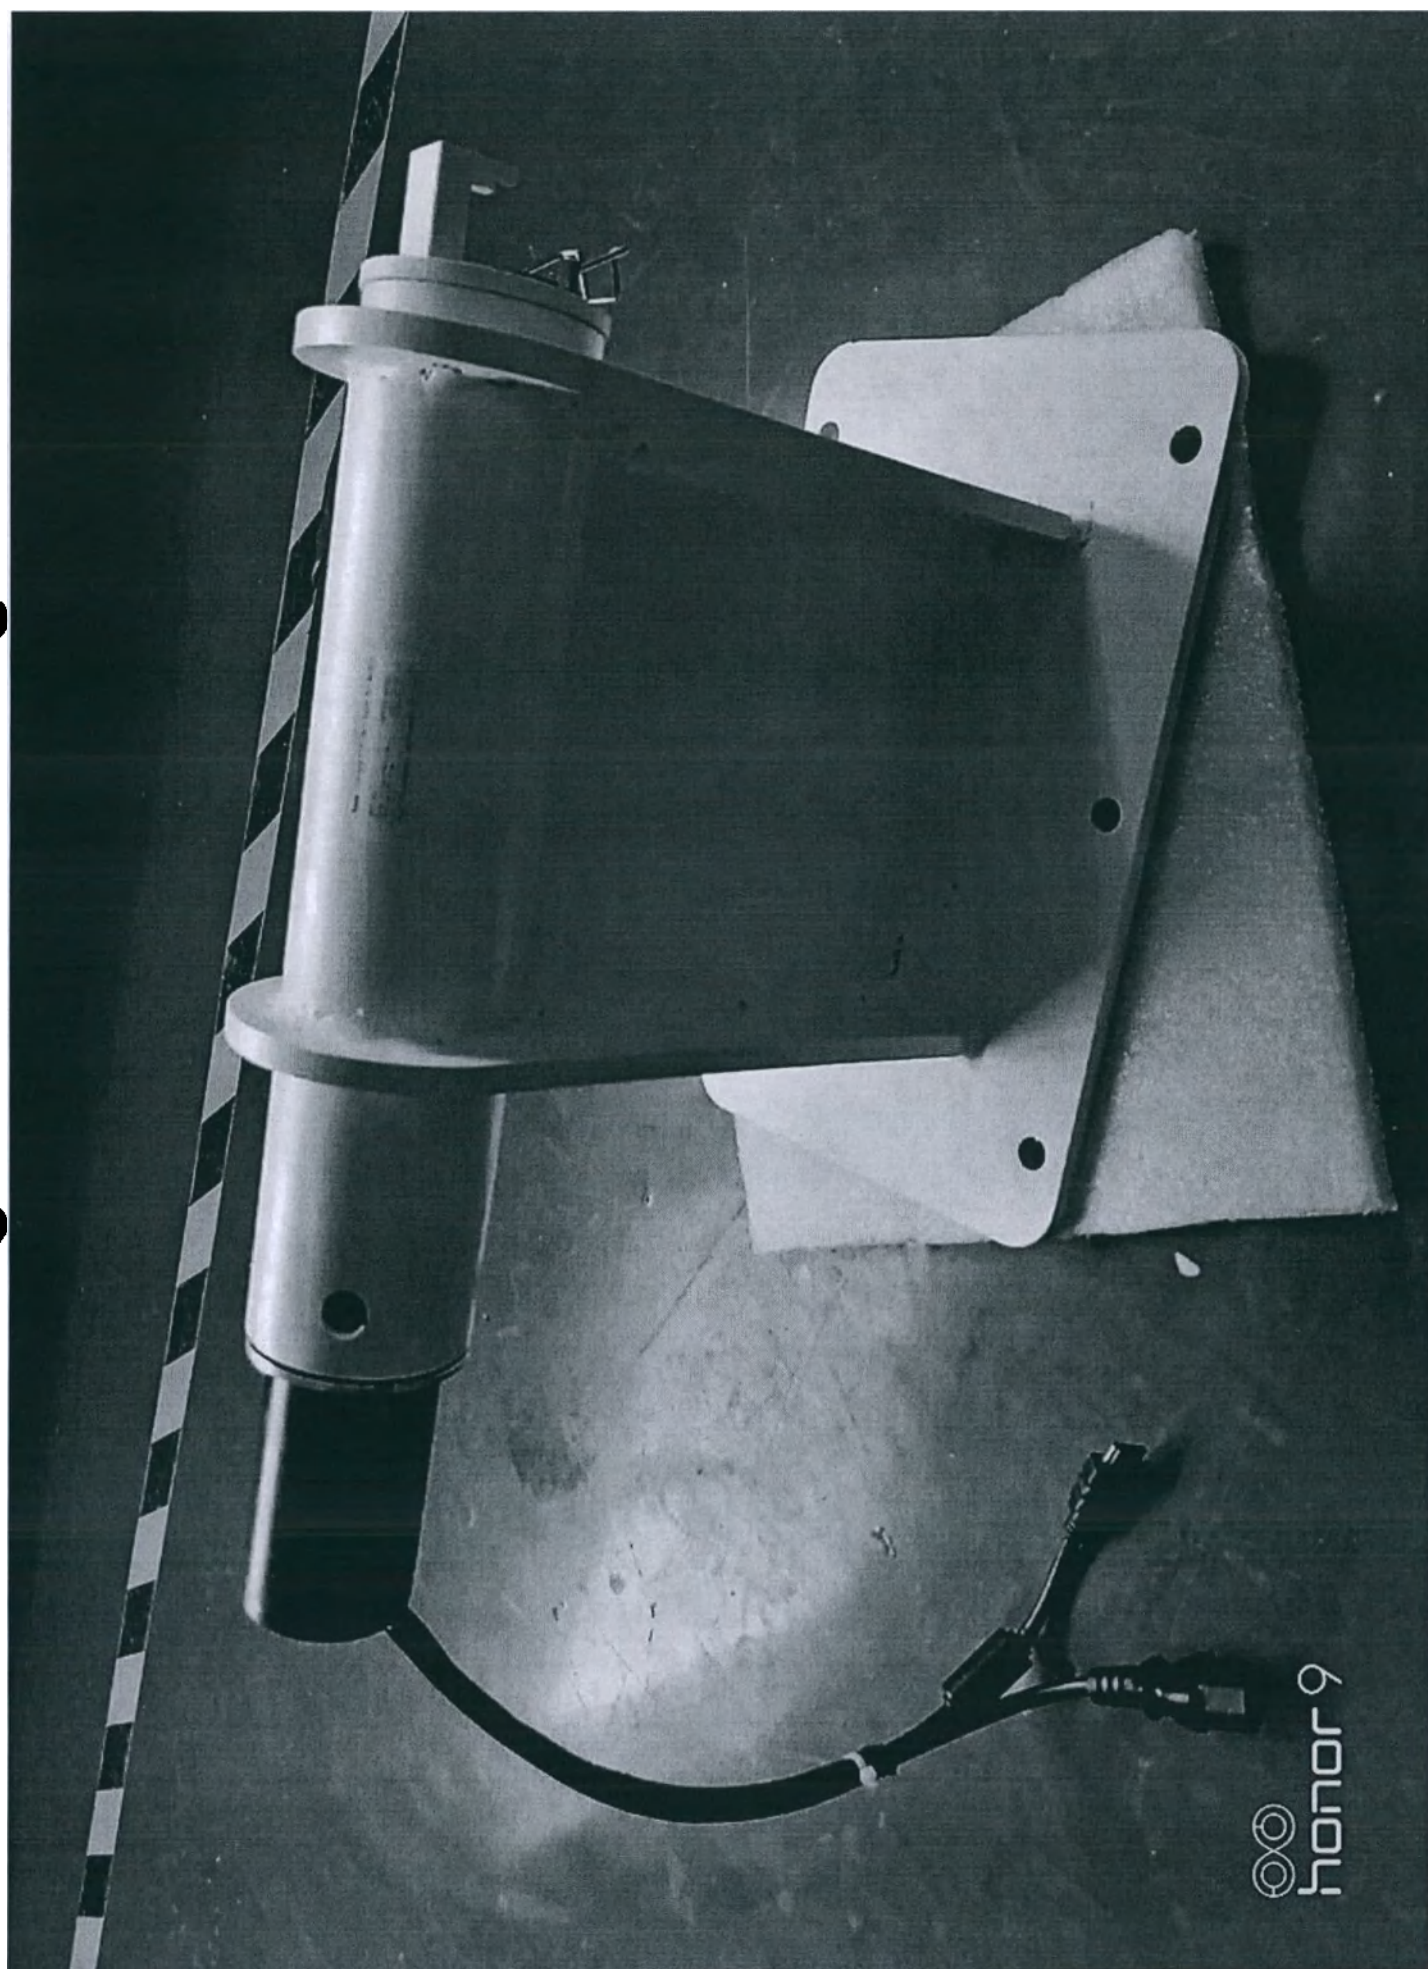

ГОРОД

6) Крепление настенное в высоком положении для АМ-2000 (при необходимости) – 1 шт. (High-position Wall Mount for AM-2000 (if necessary) – 1 pc.)




ГОРОД

7) Крепление настольное для АМ-2000 (при необходимости) – 1 шт. (Table mount for AM-2000 (if necessary) - 1pc)




honor 9

8) Крепление настольное зажимное для АМ-2000 (при необходимости) – 1 шт. (Table clamp mount for AM-2000 (if necessary) - 1pc)

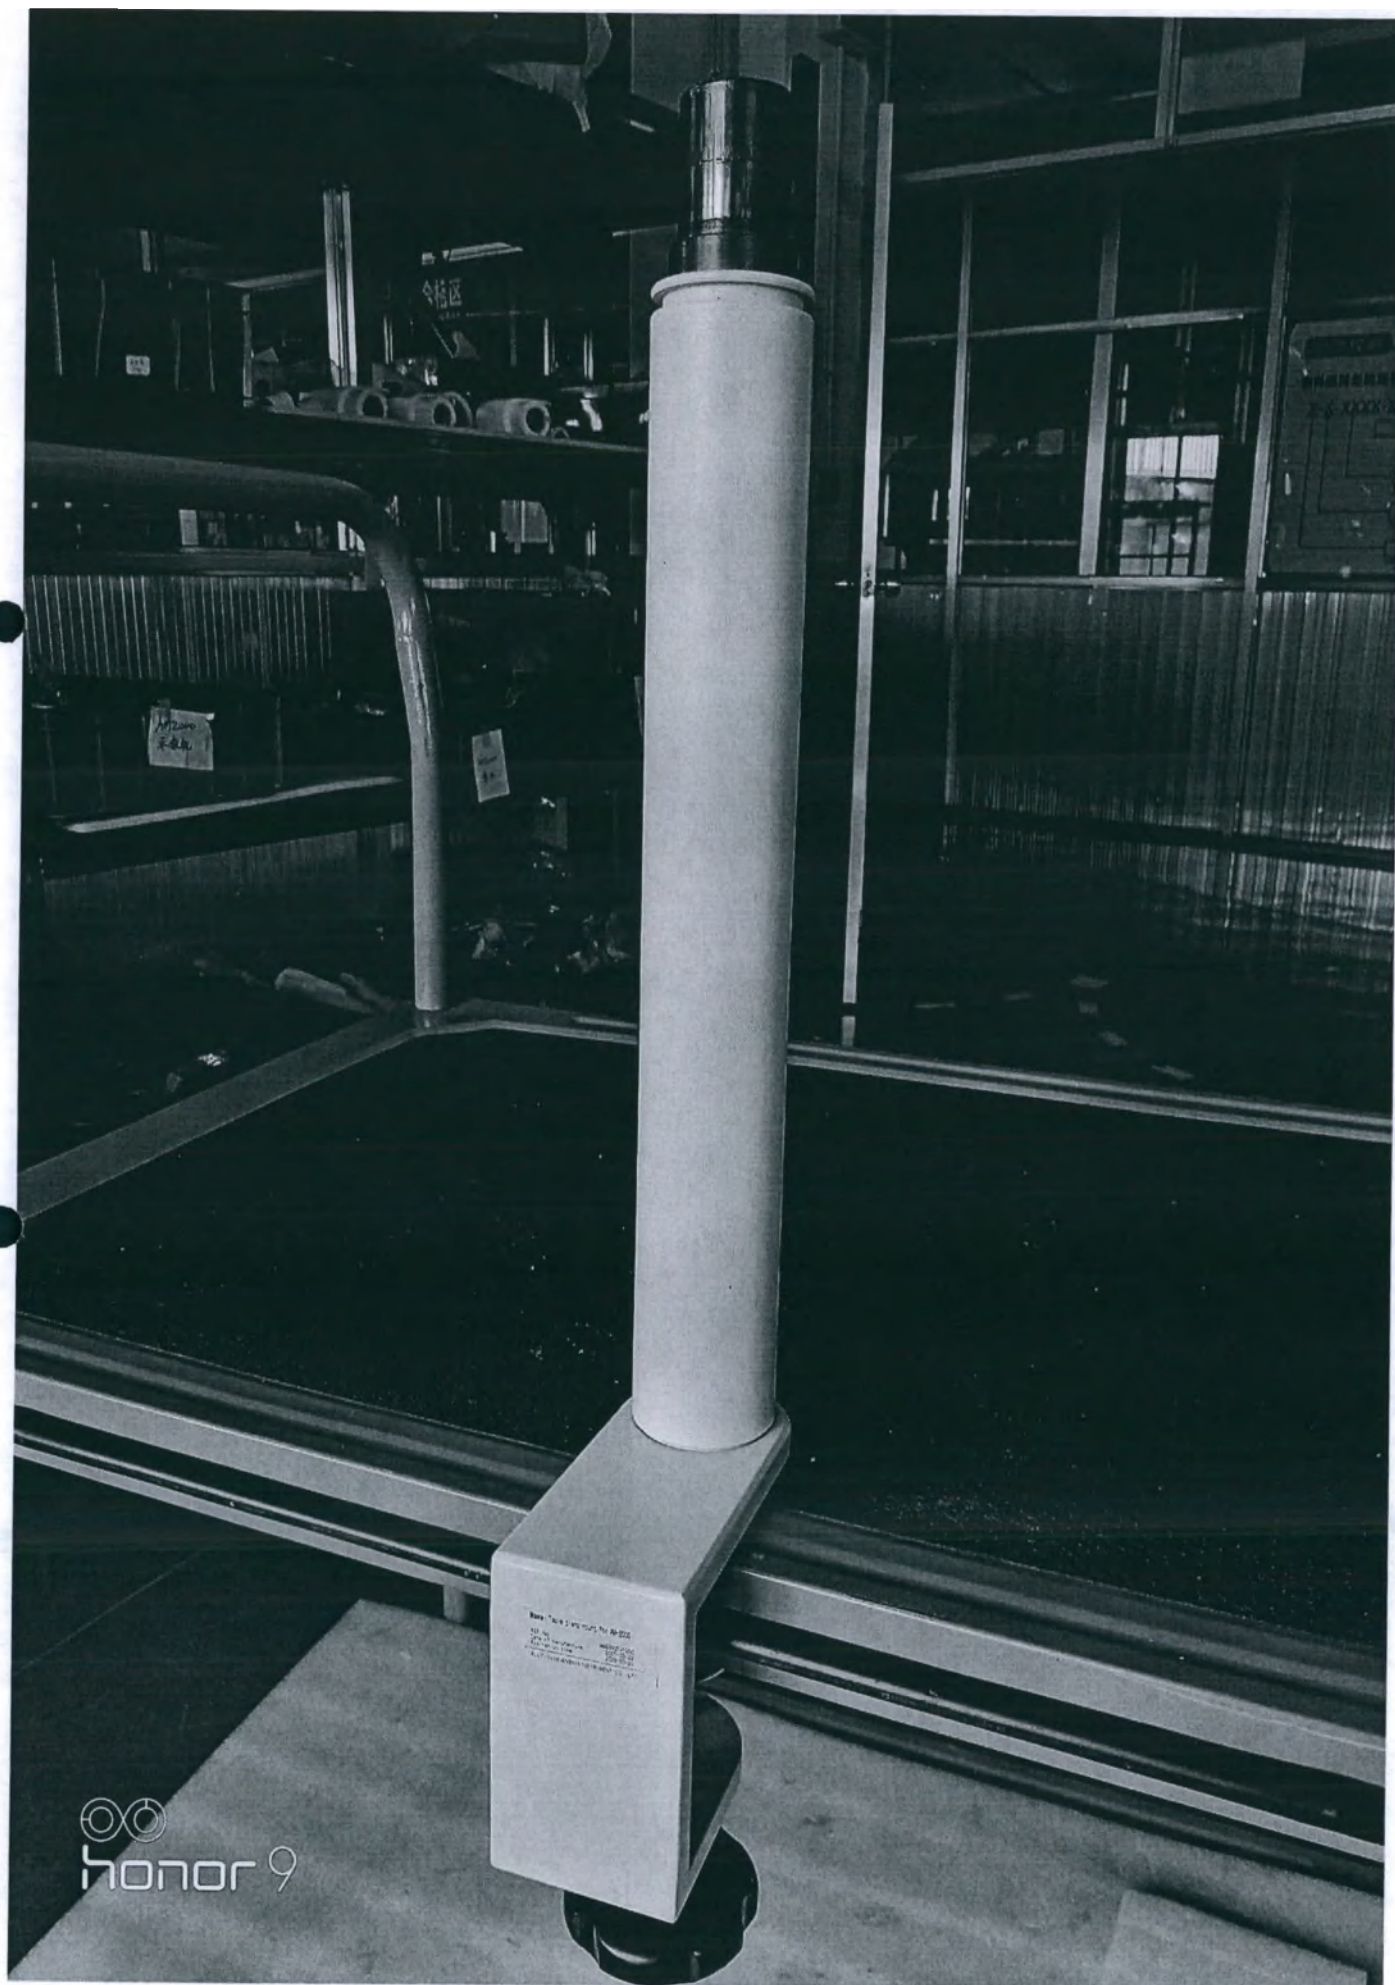


honor 9


9) Рычаг первый нормальный (при необходимости) – 1 шт. (The First Arm (Normal Installation) (if necessary) – 1 pc.)

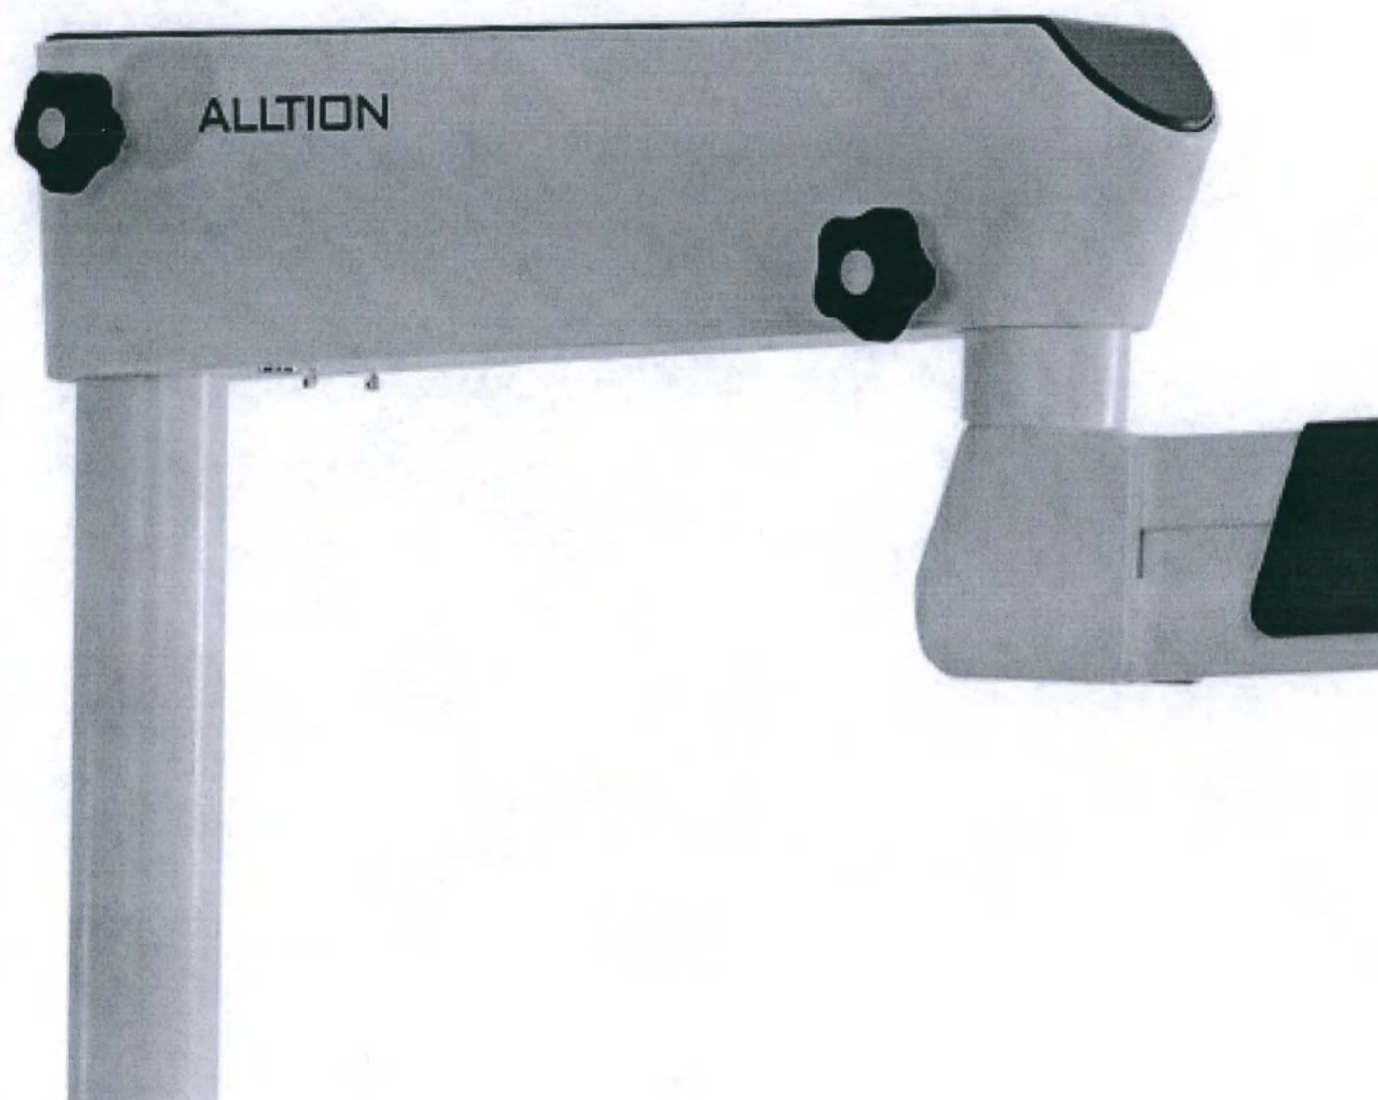


10) Рычаг первый подъемный (при необходимости) – 1 шт. (The First Arm (Hoisting Installation) (if necessary) – 1 pc)

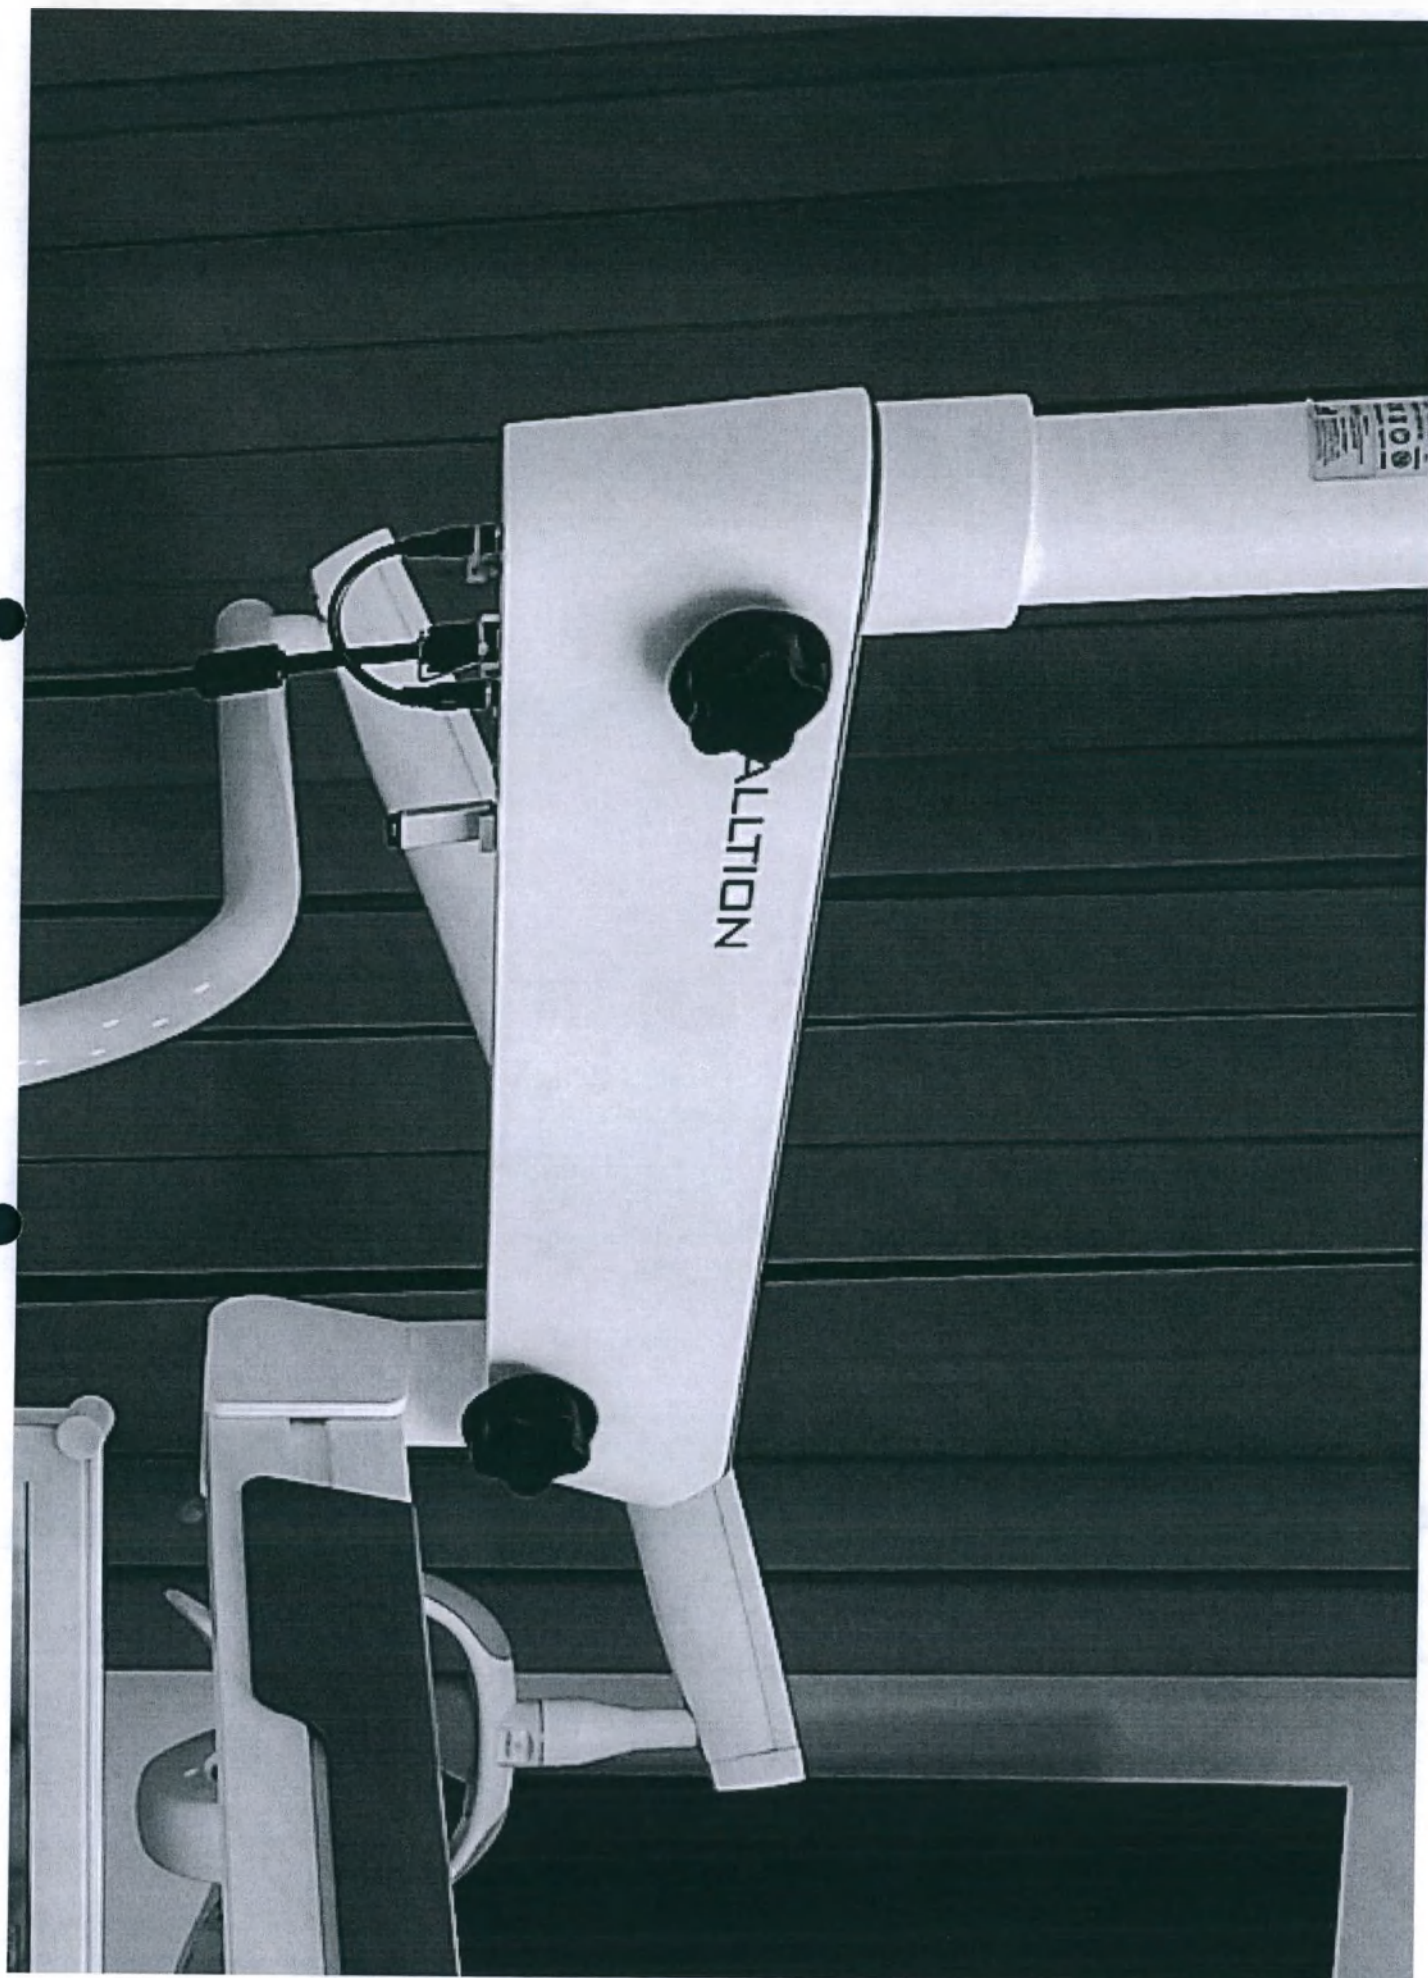


11) Рычаг первый настольный (при необходимости) – 1 шт. (The First Arm (Table Installation) (if necessary) – 1 pc.)

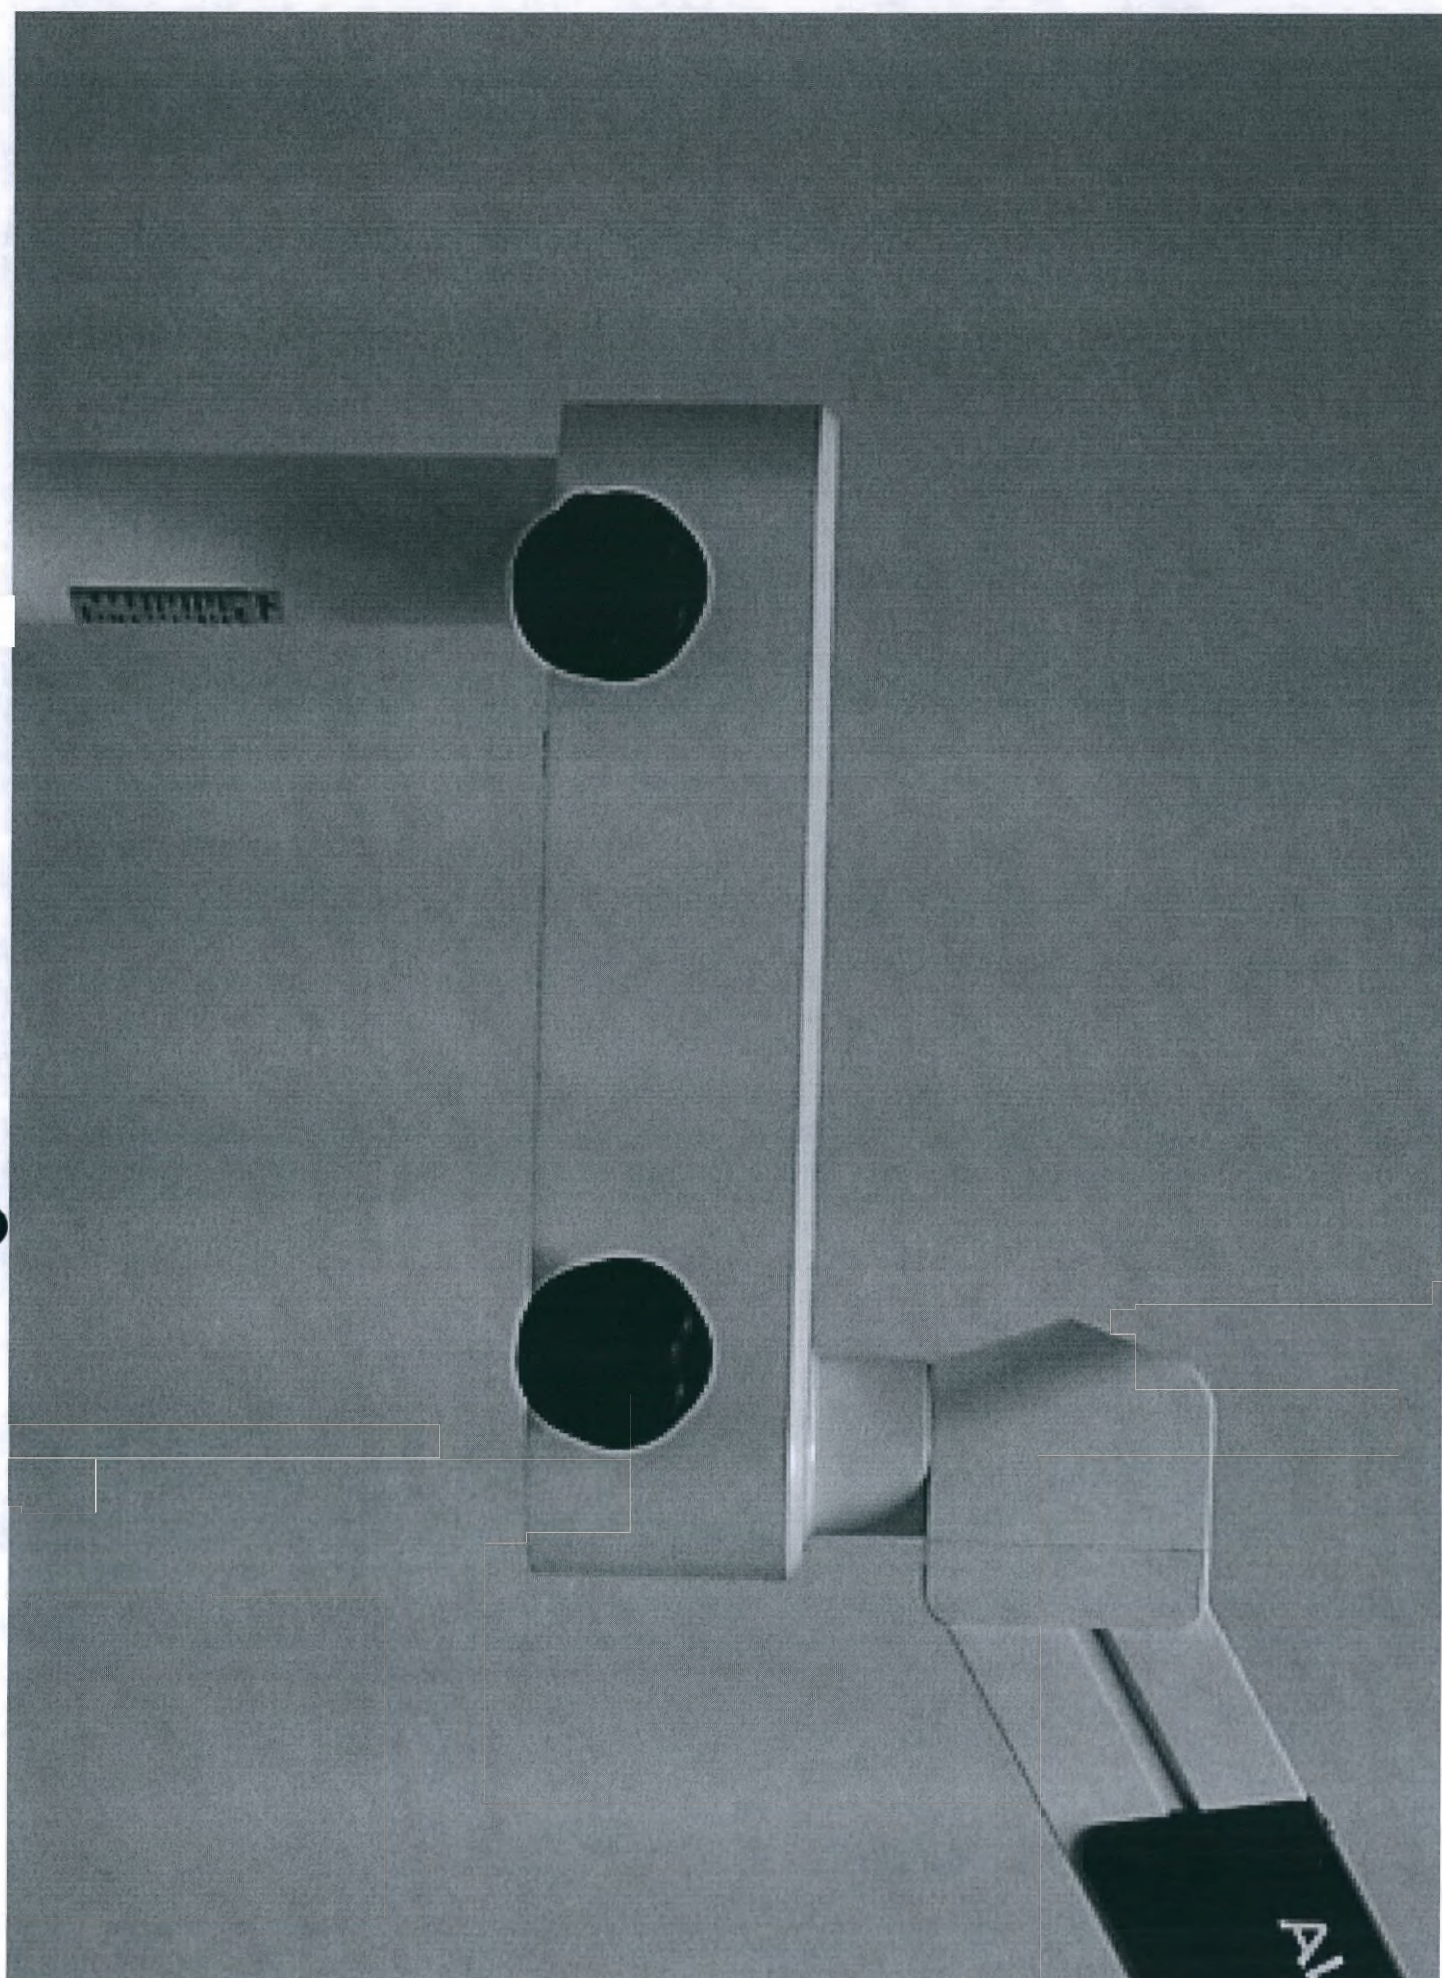

12) Рычаг второй настольный (при необходимости) – 1 шт. (The Second Arm (Table Installation) (if necessary) – 1 pc.)

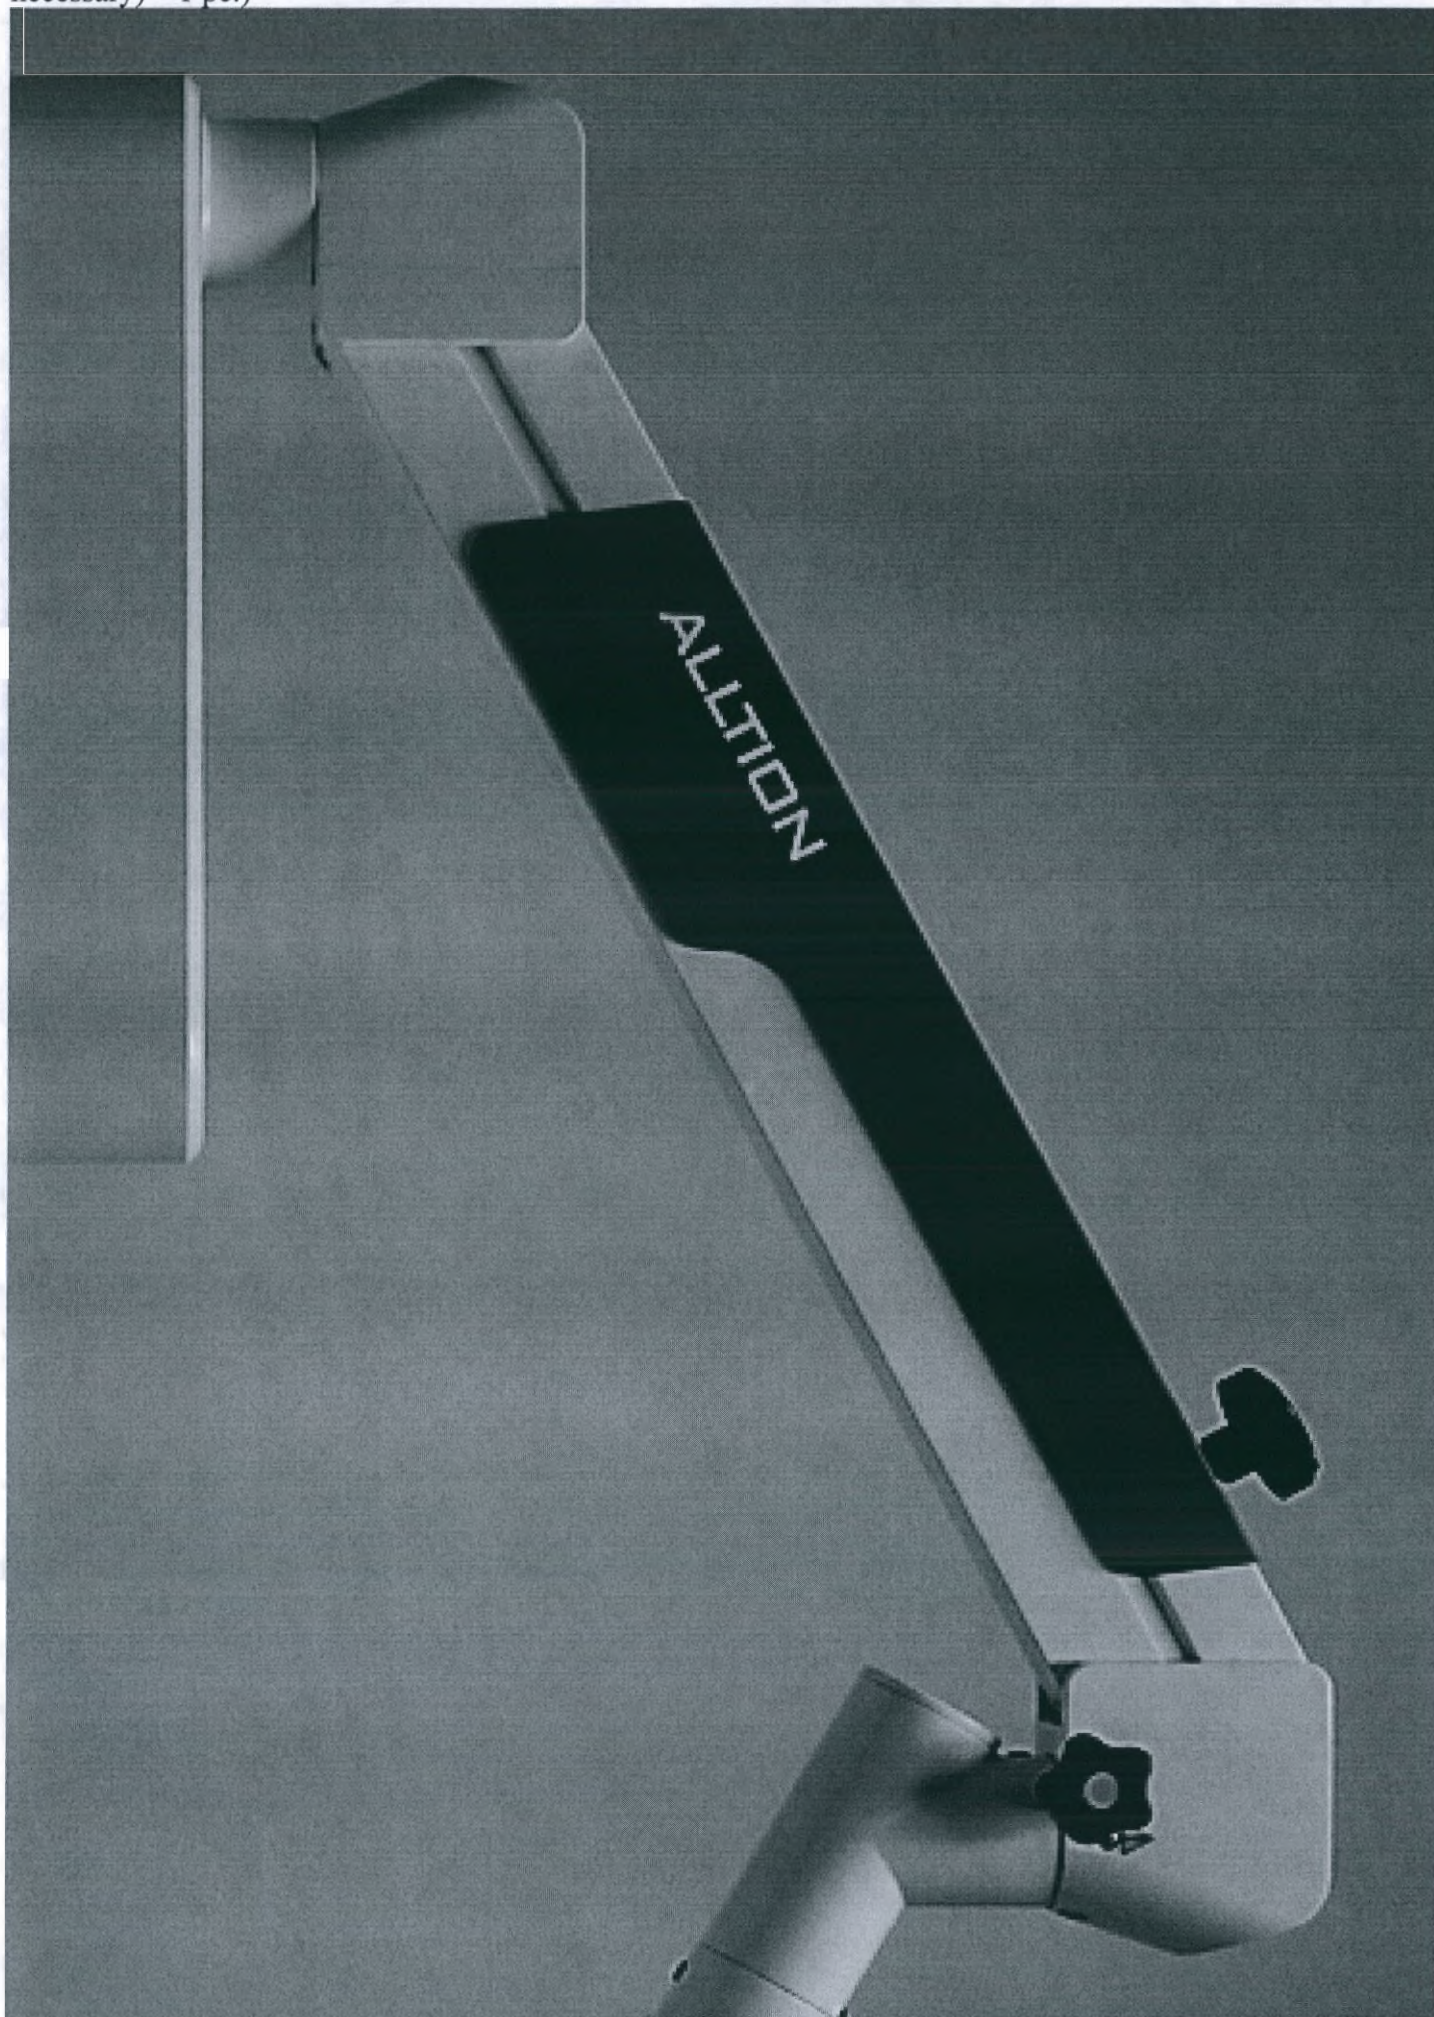


13) Рычаг второй подъемный 650mm (при необходимости) – 1 шт. (The Second Arm 650mm (if necessary) – 1pc.

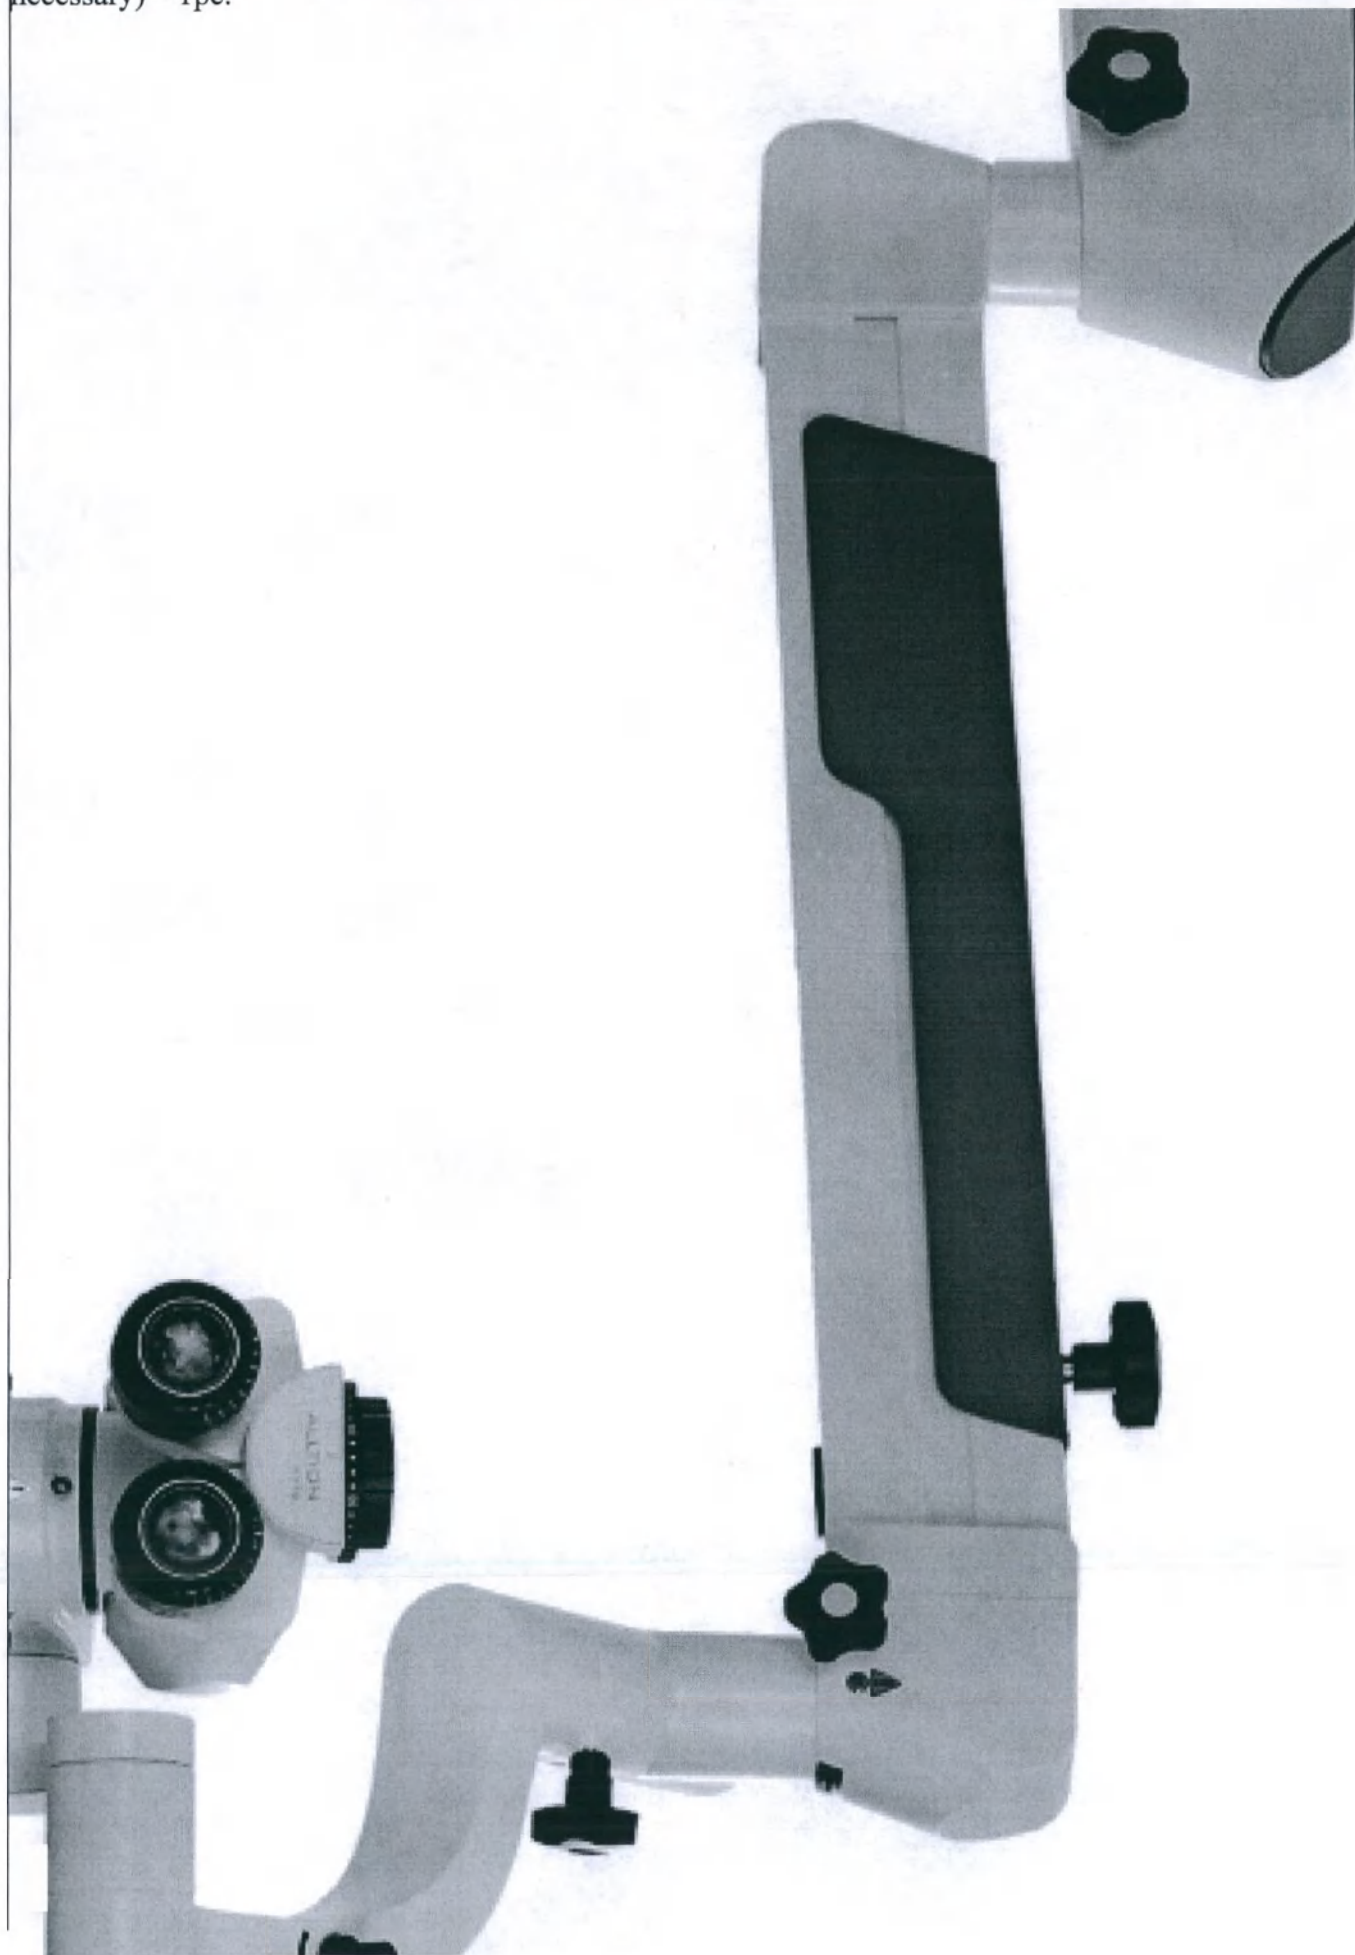


14) Рычаг второй подъемный 950mm (при необходимости) – 1 шт. (The Second Arm 950mm (if necessary)– 1pc.)




15) Рычаг балансирующий для АМ-2000 (при необходимости) – 1 шт. (Balance Arm for AM-2000 (if necessary) – 1 pc.)

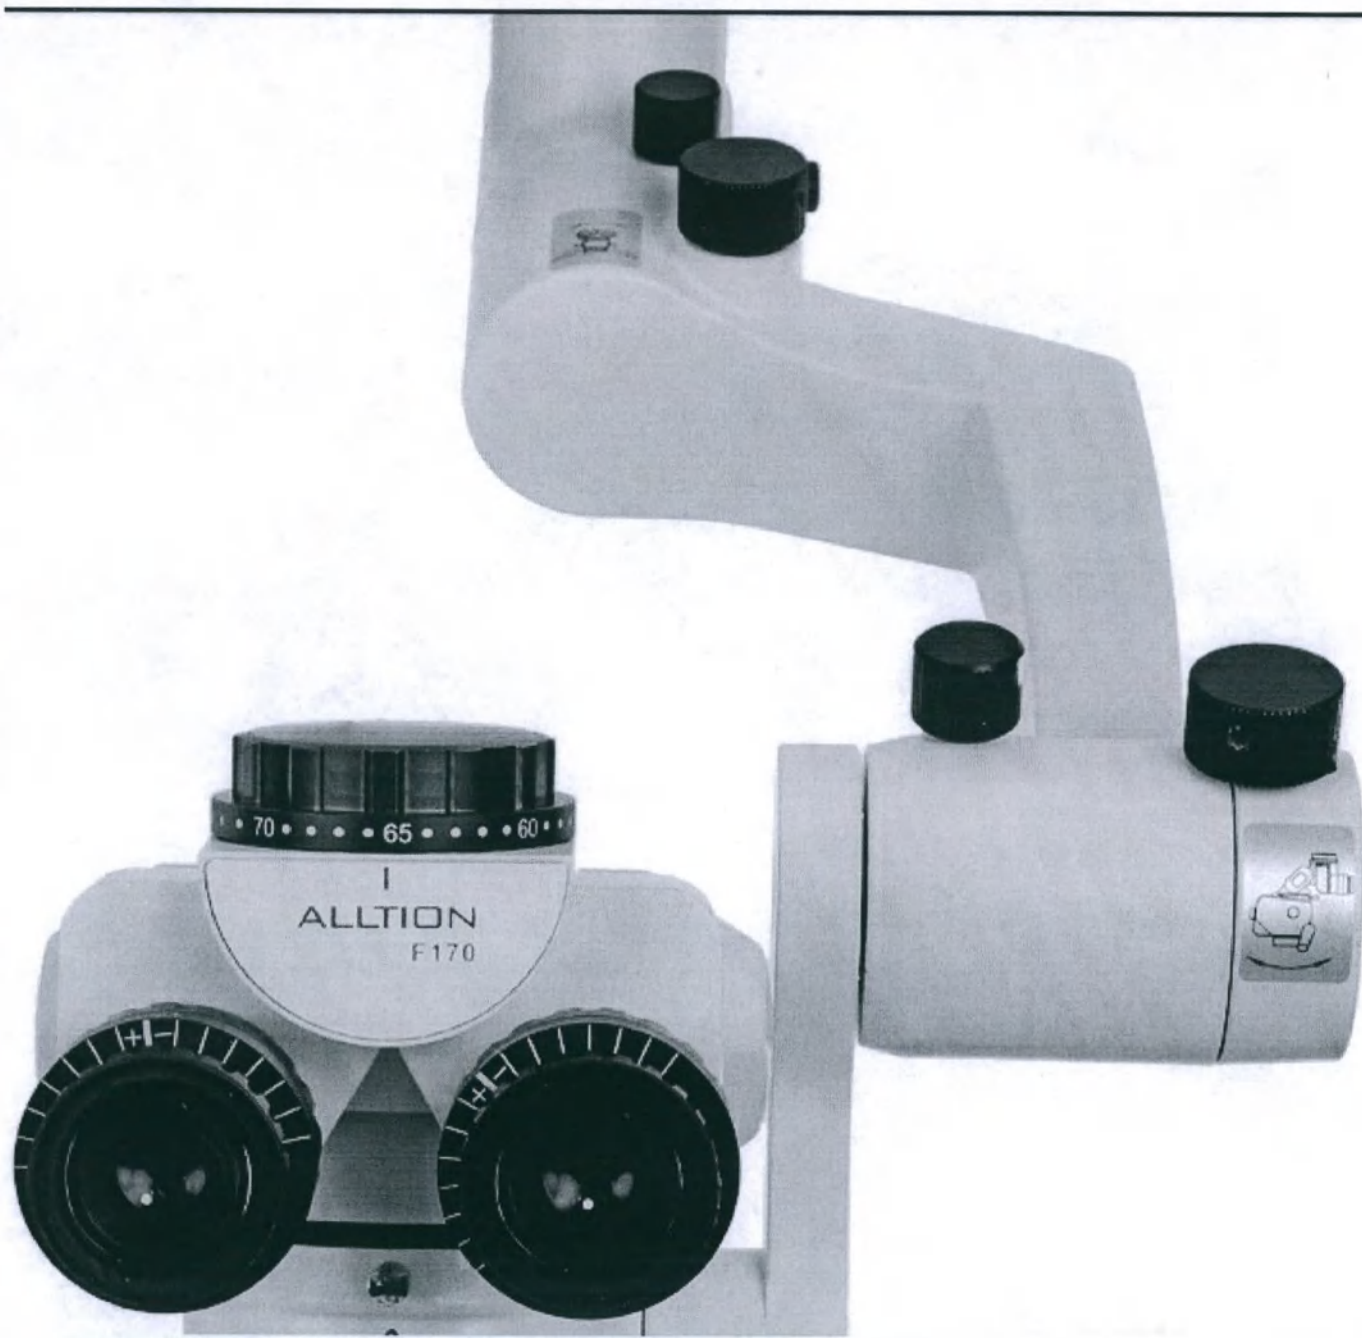


16) Рычаг соединительный под 120° для АМ-2000 (при необходимости) – 1 шт. (120 Degrees Connecting Arm for AM-2000 (if necessary) – 1 pc.)

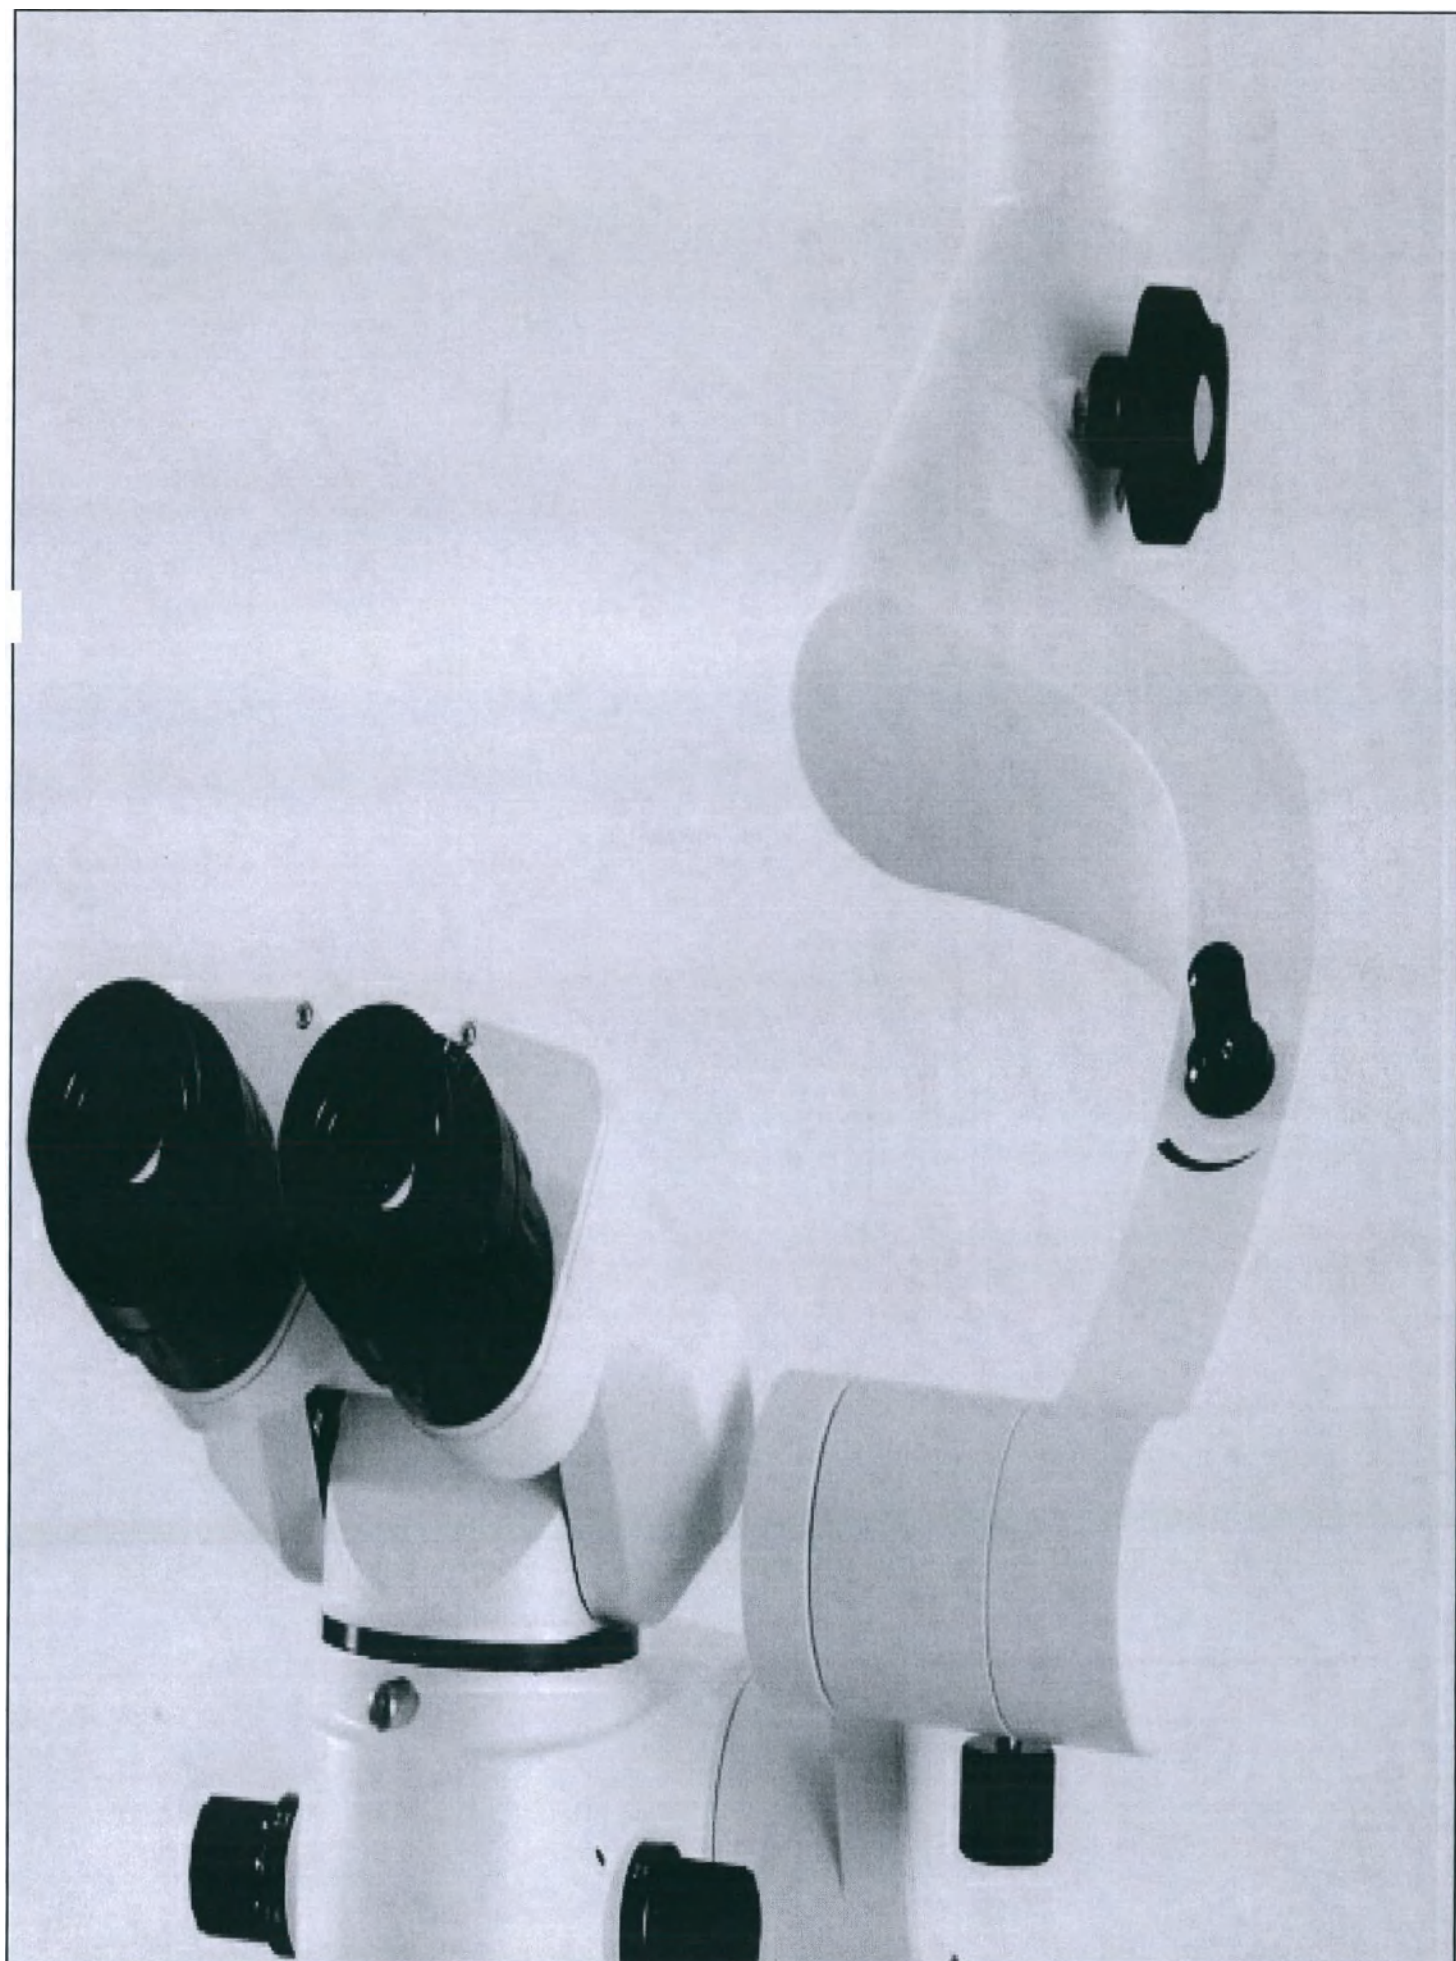


17) Рычаг соединительный для перемещения оптического блока микроскопа АМ-2000 (при необходимости) – 1 шт. (The lever connecting for movement of the optical block of the AM-2000 microscope (if necessary) - 1 pc)

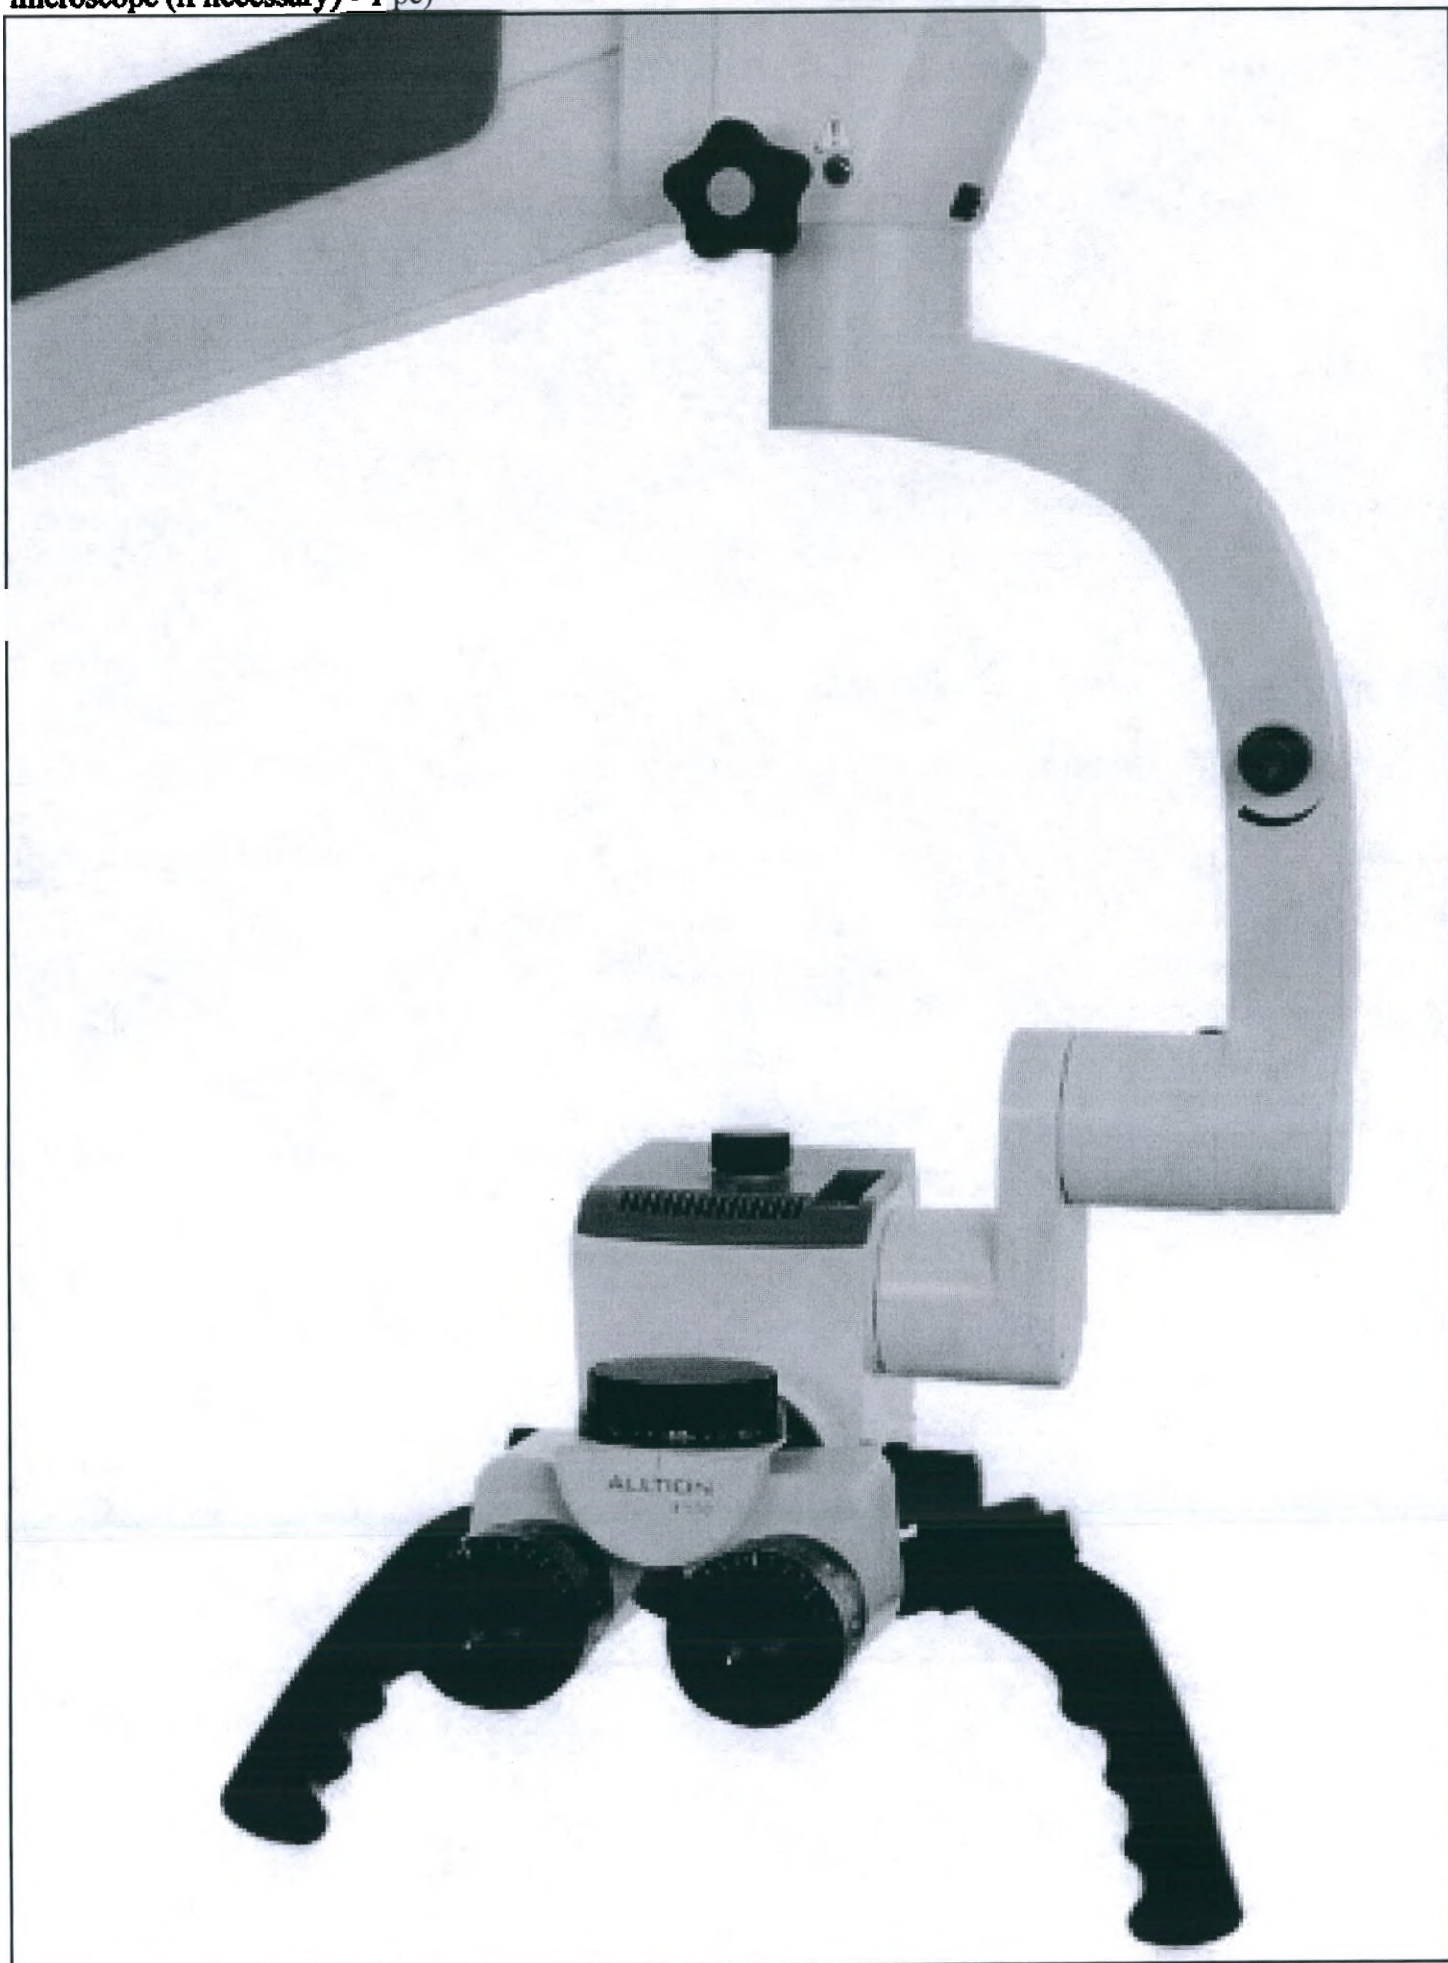

18) Рукоятка для перемещения оптического блока микроскопа АМ-2000 (при необходимости) – 1 шт.
(The handle for movement of the optical block of the AM-2000 microscope (if necessary) - 1 pc)

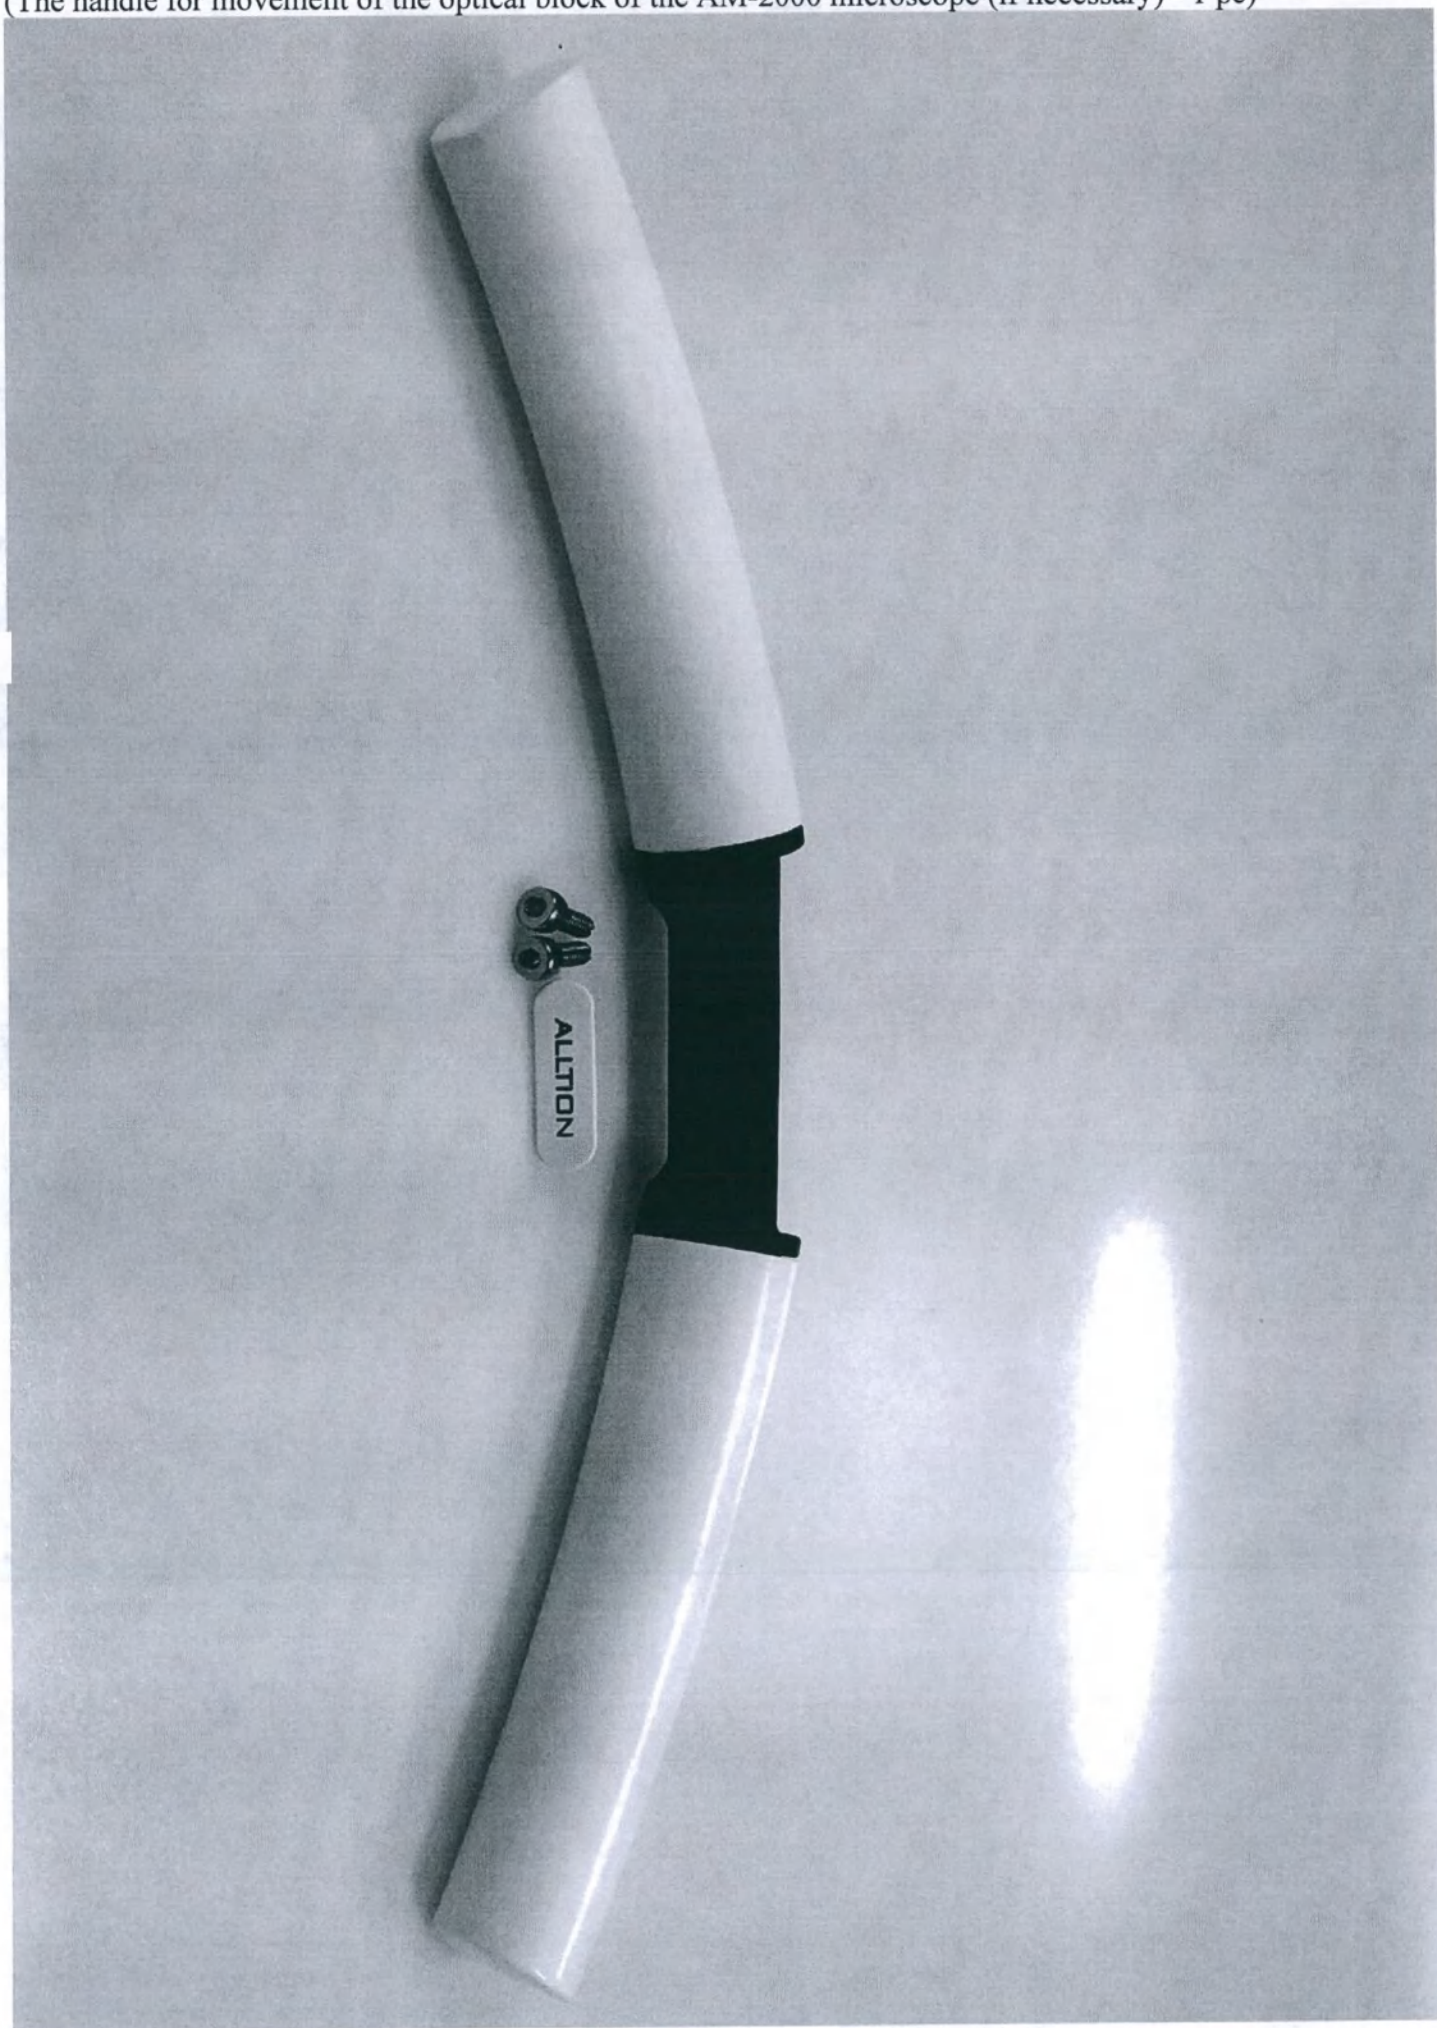


19) Рукоятка поворотная для перемещения оптического блока микроскопа АМ-2000 (при необходимости) – 1 шт. (The rotatable handle for movement of the optical block of the AM-2000 microscope (if necessary) - 1 pc)

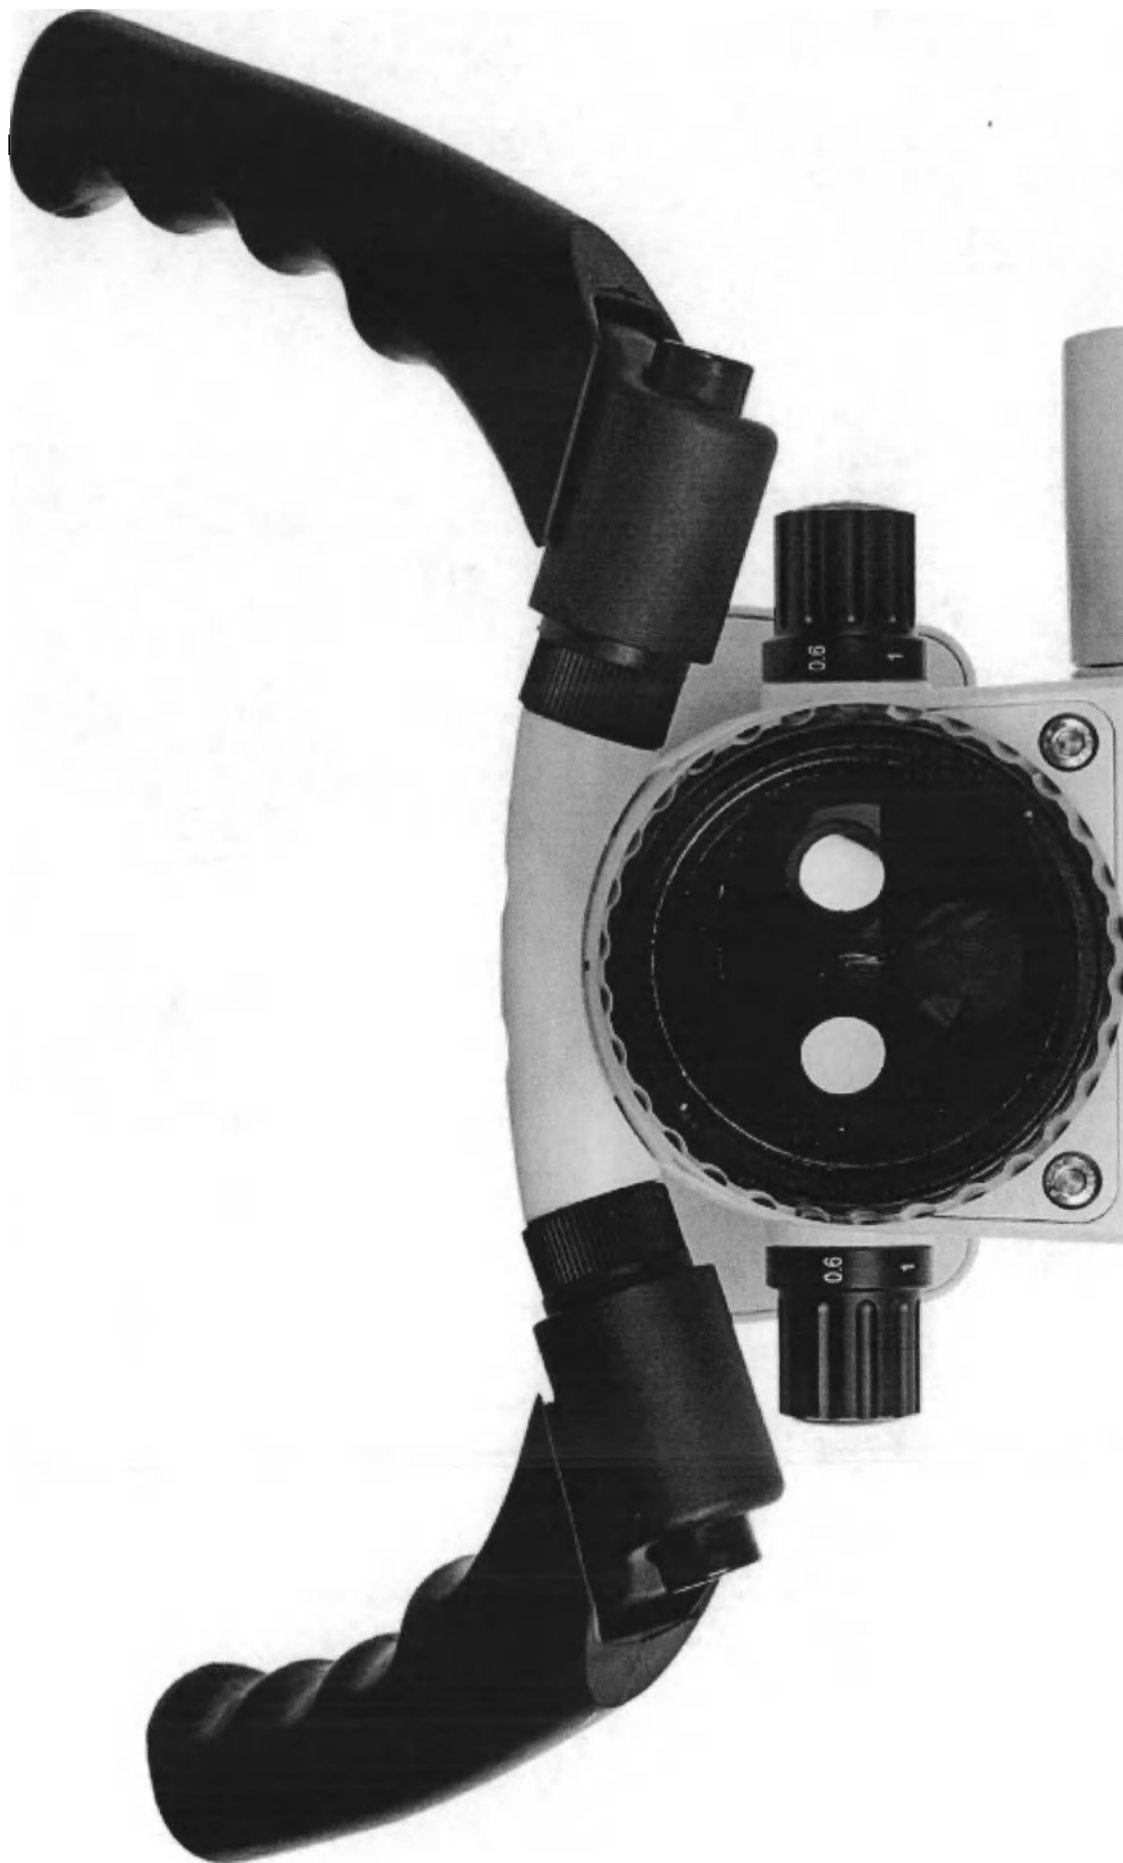


20) Крышка декоративная на рукоятку для перемещения оптического блока микроскопа АМ-2000 (при необходимости) – 1 шт. (Cover decorative on the handle for movement of the optical block of the AM-2000 microscope (if necessary) - 1 pc)




21) Тубус биноклярный АМ-2000 с изменяемым углом наклона 0-180° (при необходимости) – 1 шт.
(0-180 Degrees Inclined Binocular for AM-2000 (if necessary) – 1 pc.)

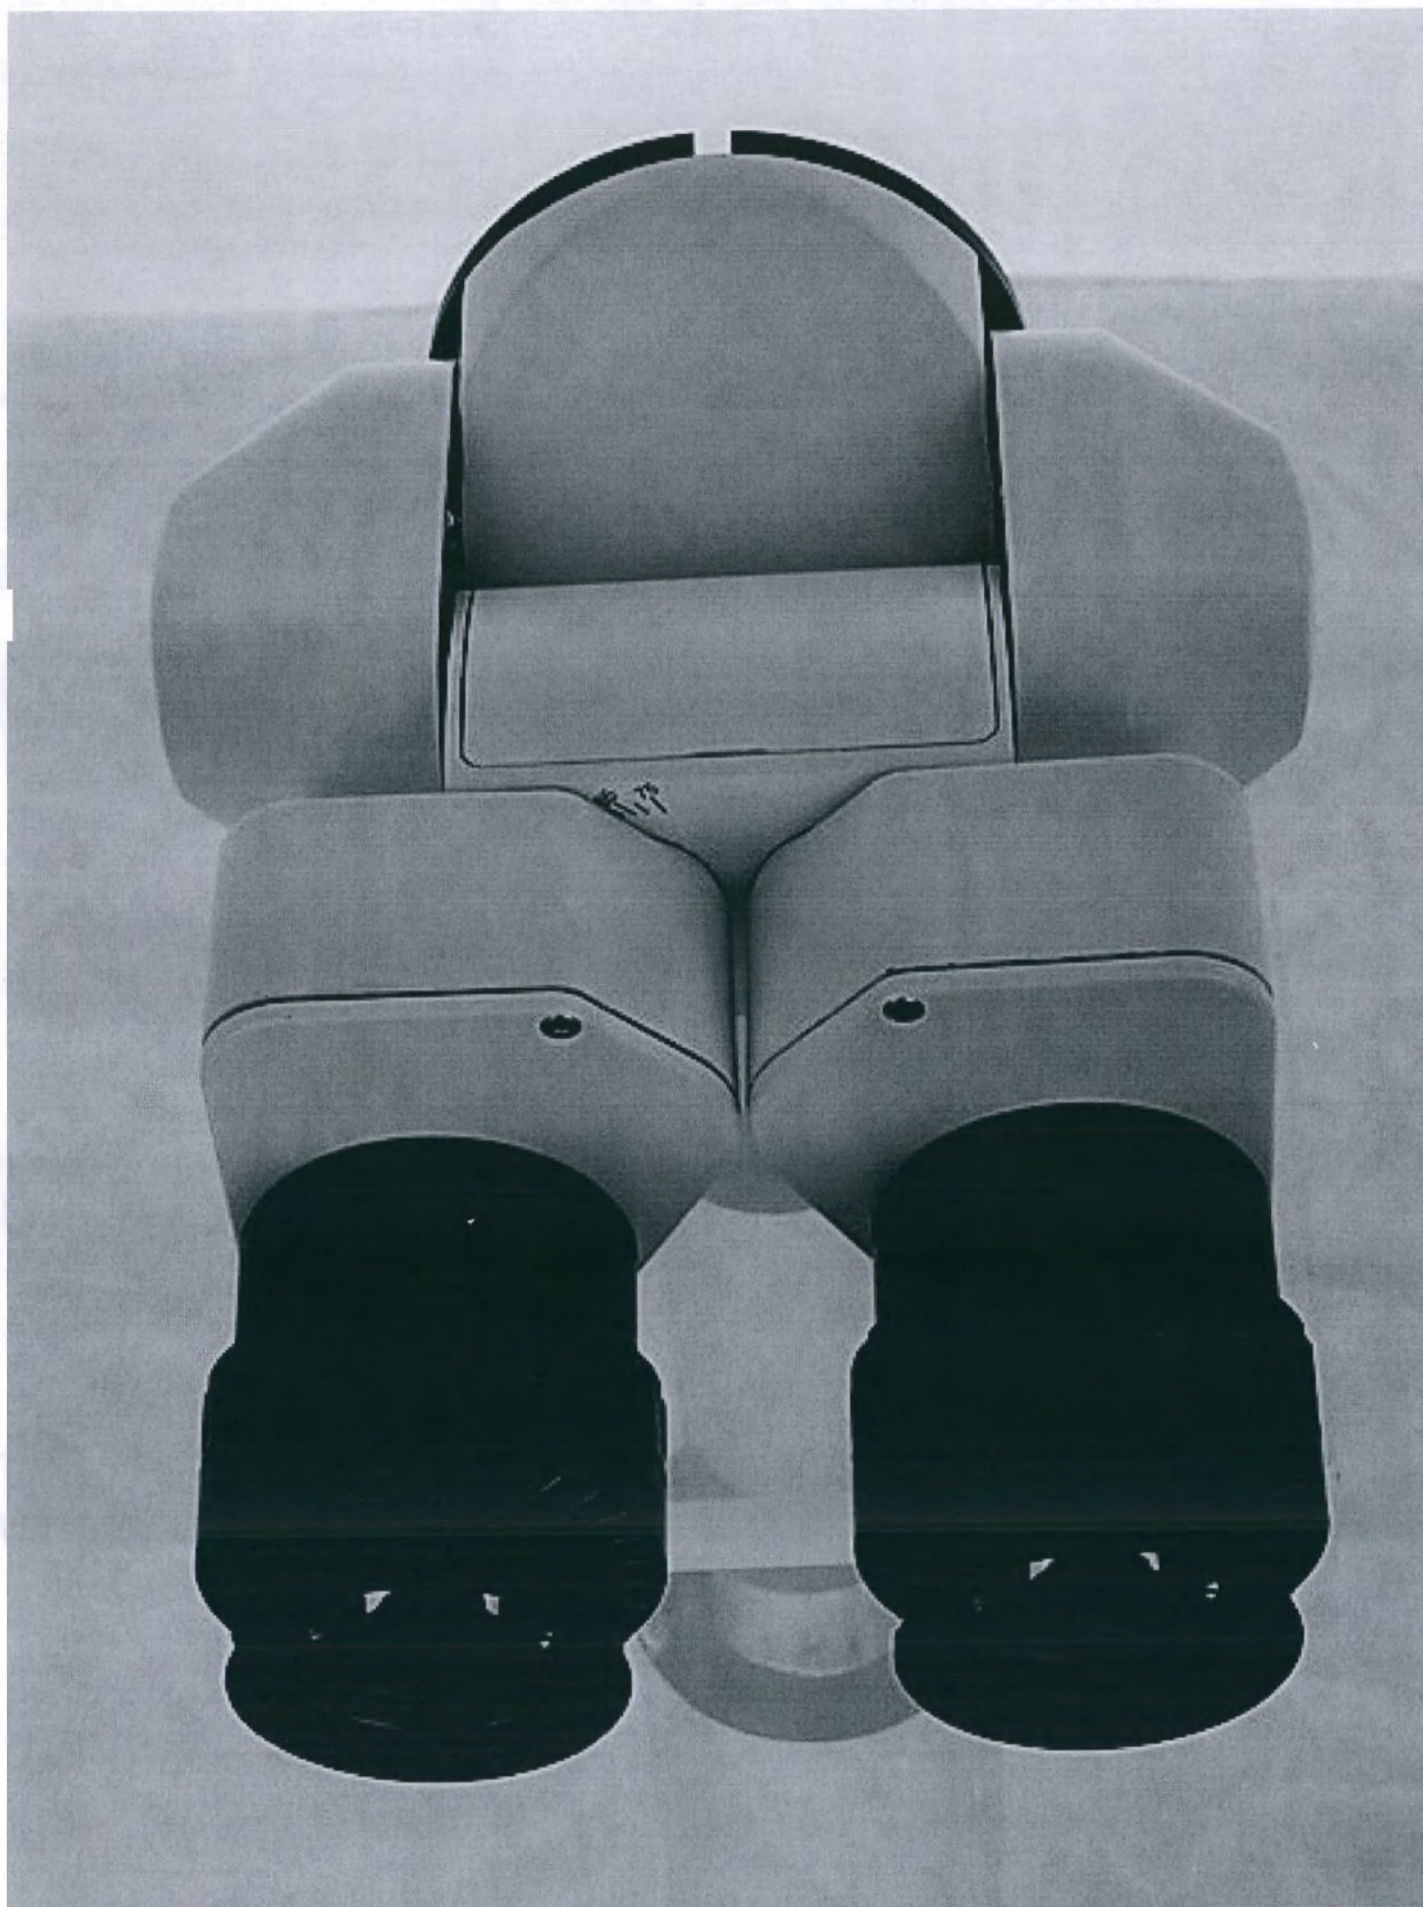

22) Тубус биноклярный АМ-2000 с изменяемым углом наклона 0-180° и регулировкой межзрачкового расстояния (при необходимости) – 1 шт. (0-180 Degrees Inclined Binocular for (with Pupillary Adjustment) AM-2000 (if necessary) – 1 pc.)

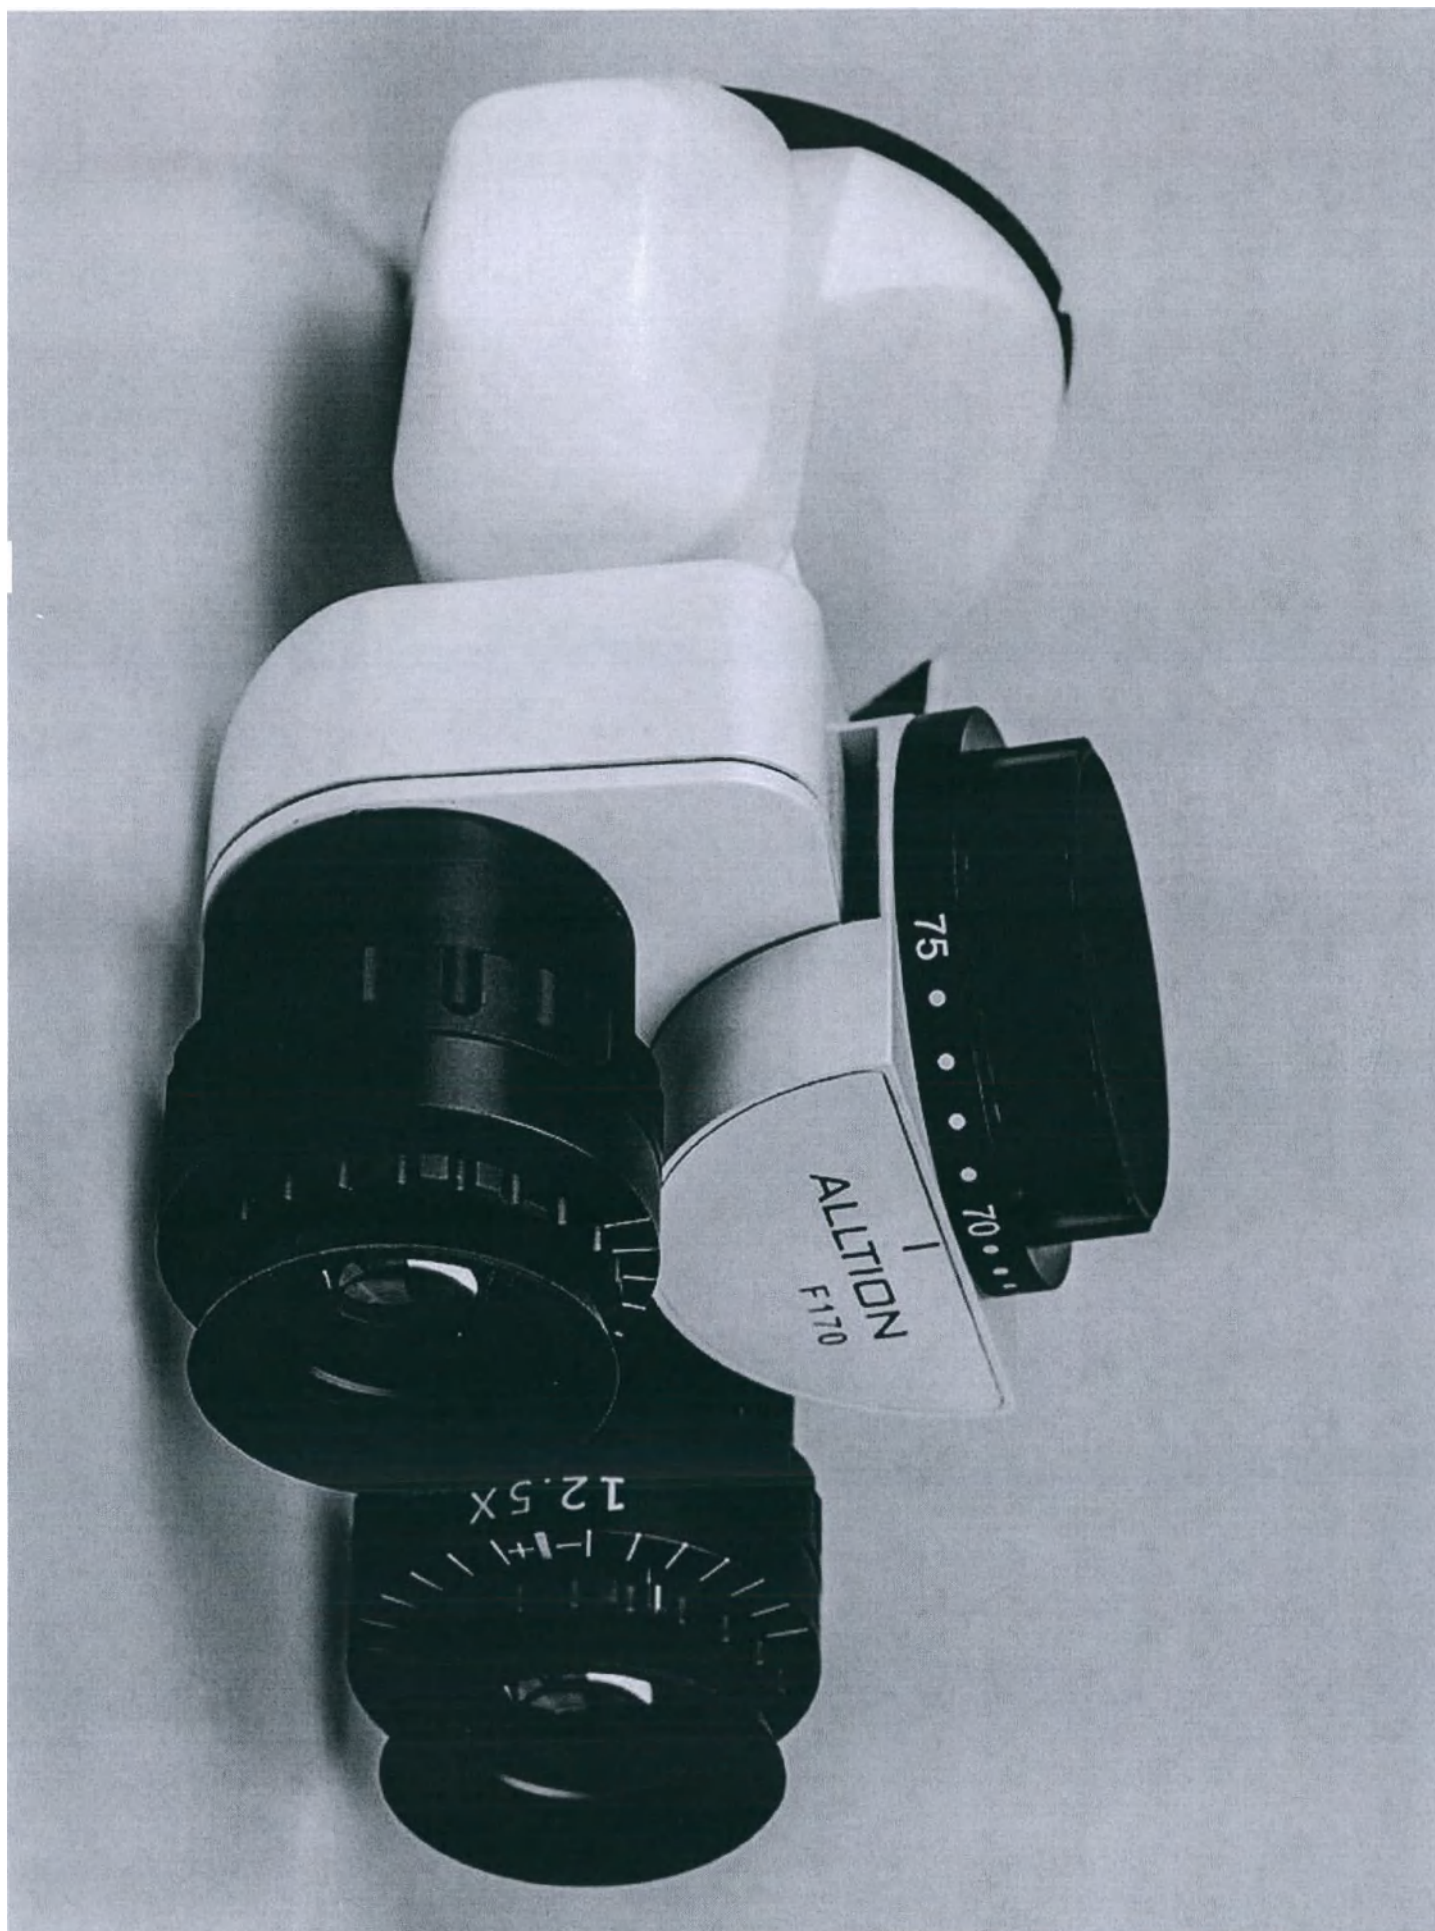


23) Тубус бинокулярный прямой (при необходимости) - 1 шт. (90 Degrees Inclinal Binocular (if necessary) - 1 pc.)

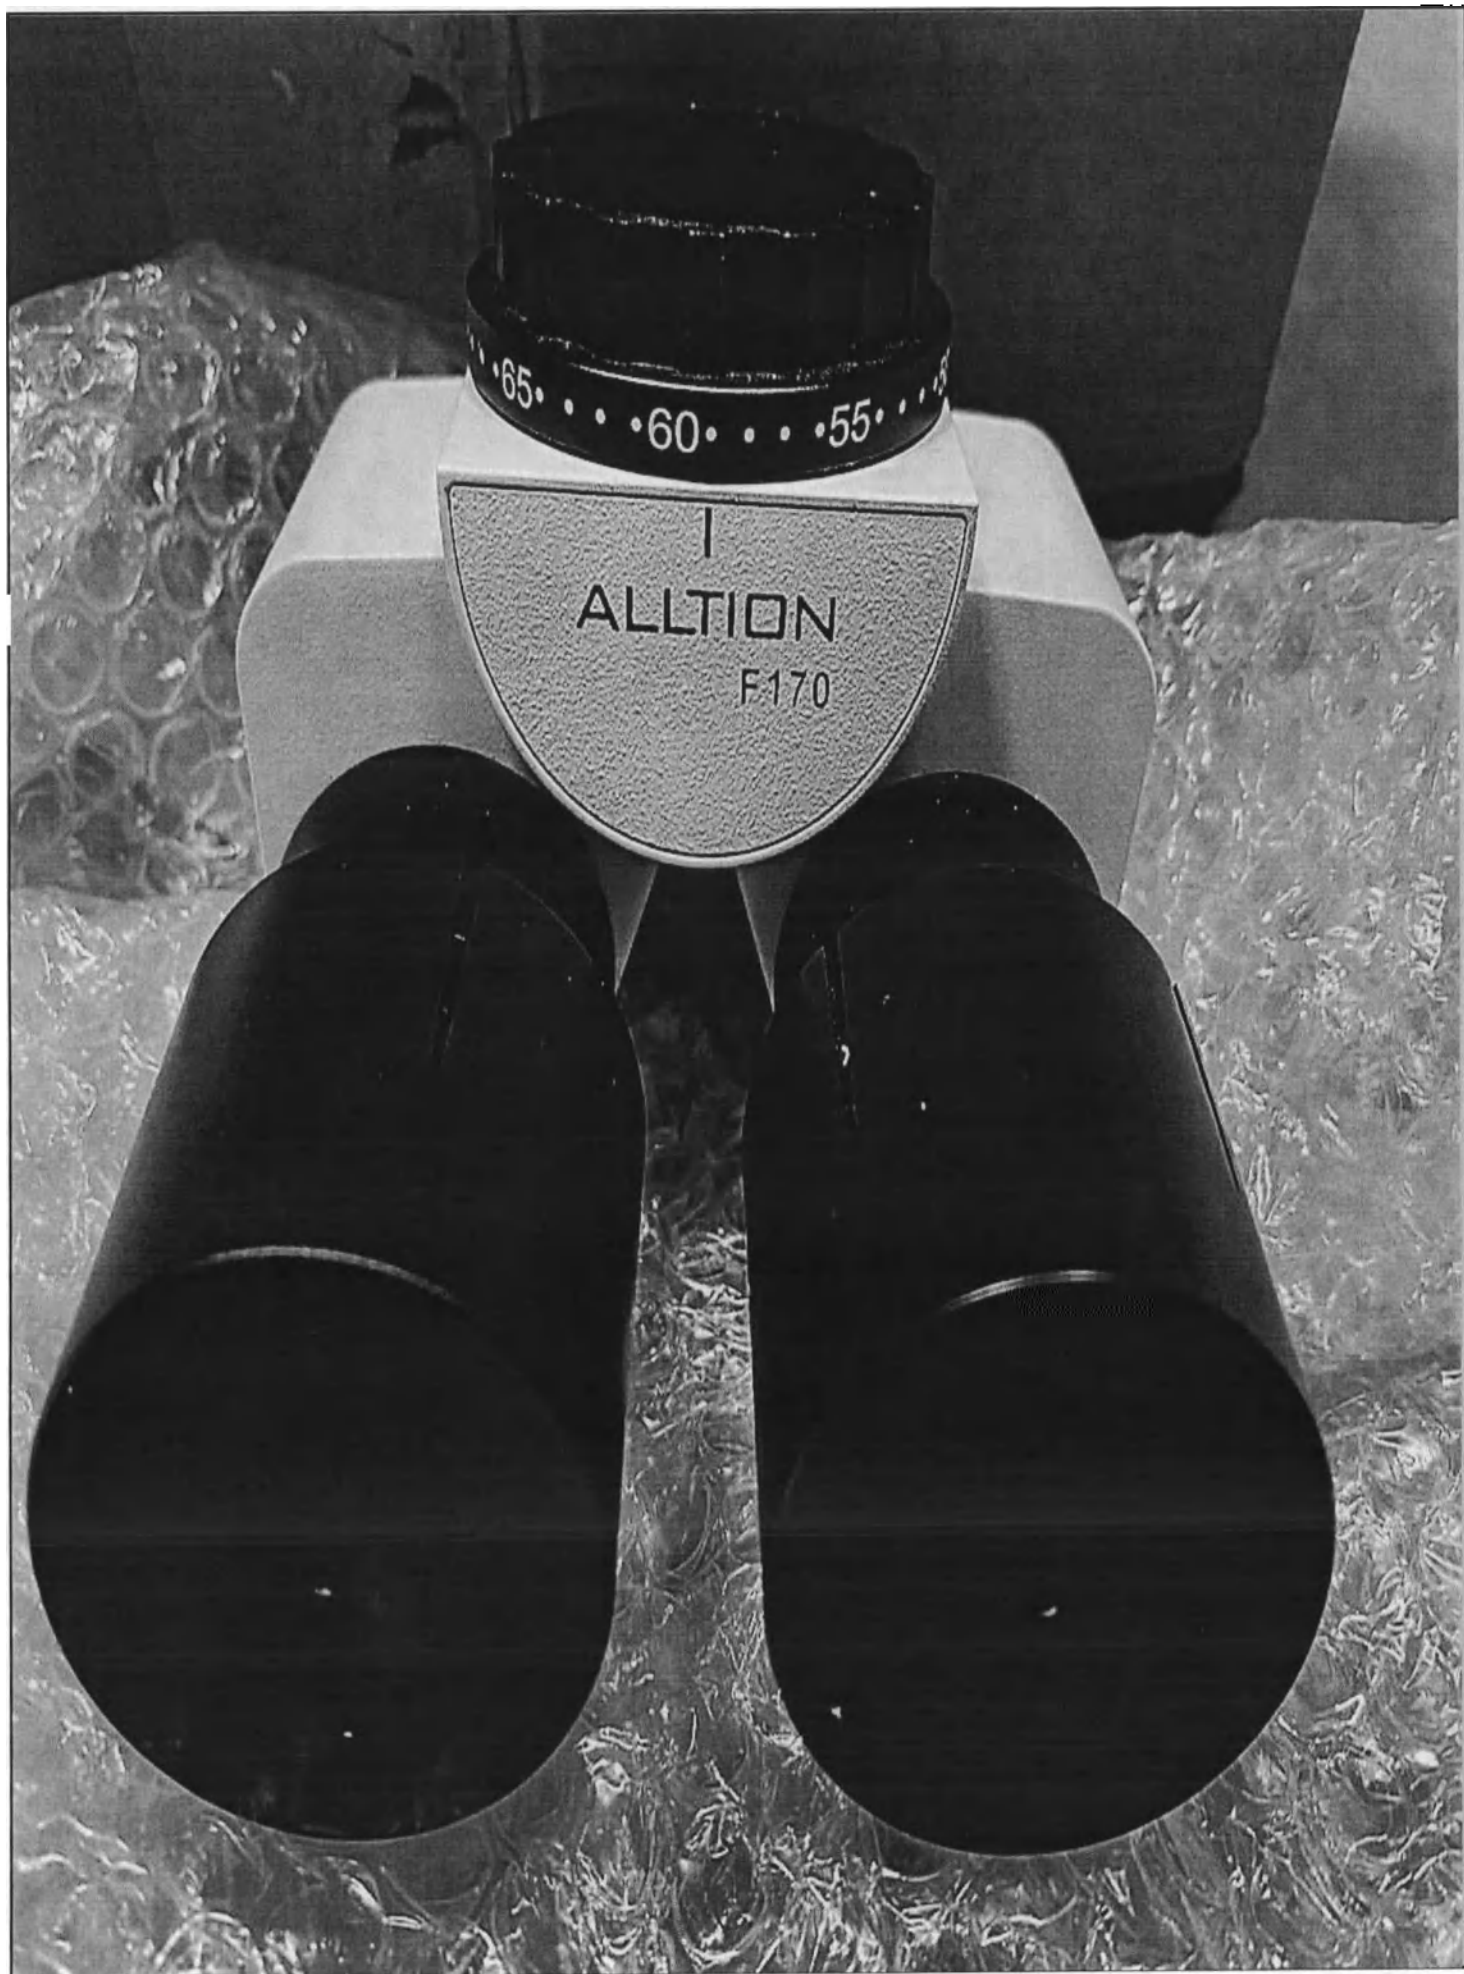

24) Тубус бинокулярный с углом наклона 45°(при необходимости) – 1 шт. (45 Degrees Inclined Binocular (if necessary) – 1 pc.)



25) Светоделитель – 1 шт. (Beam splitter (if necessary) – 1 pc.)

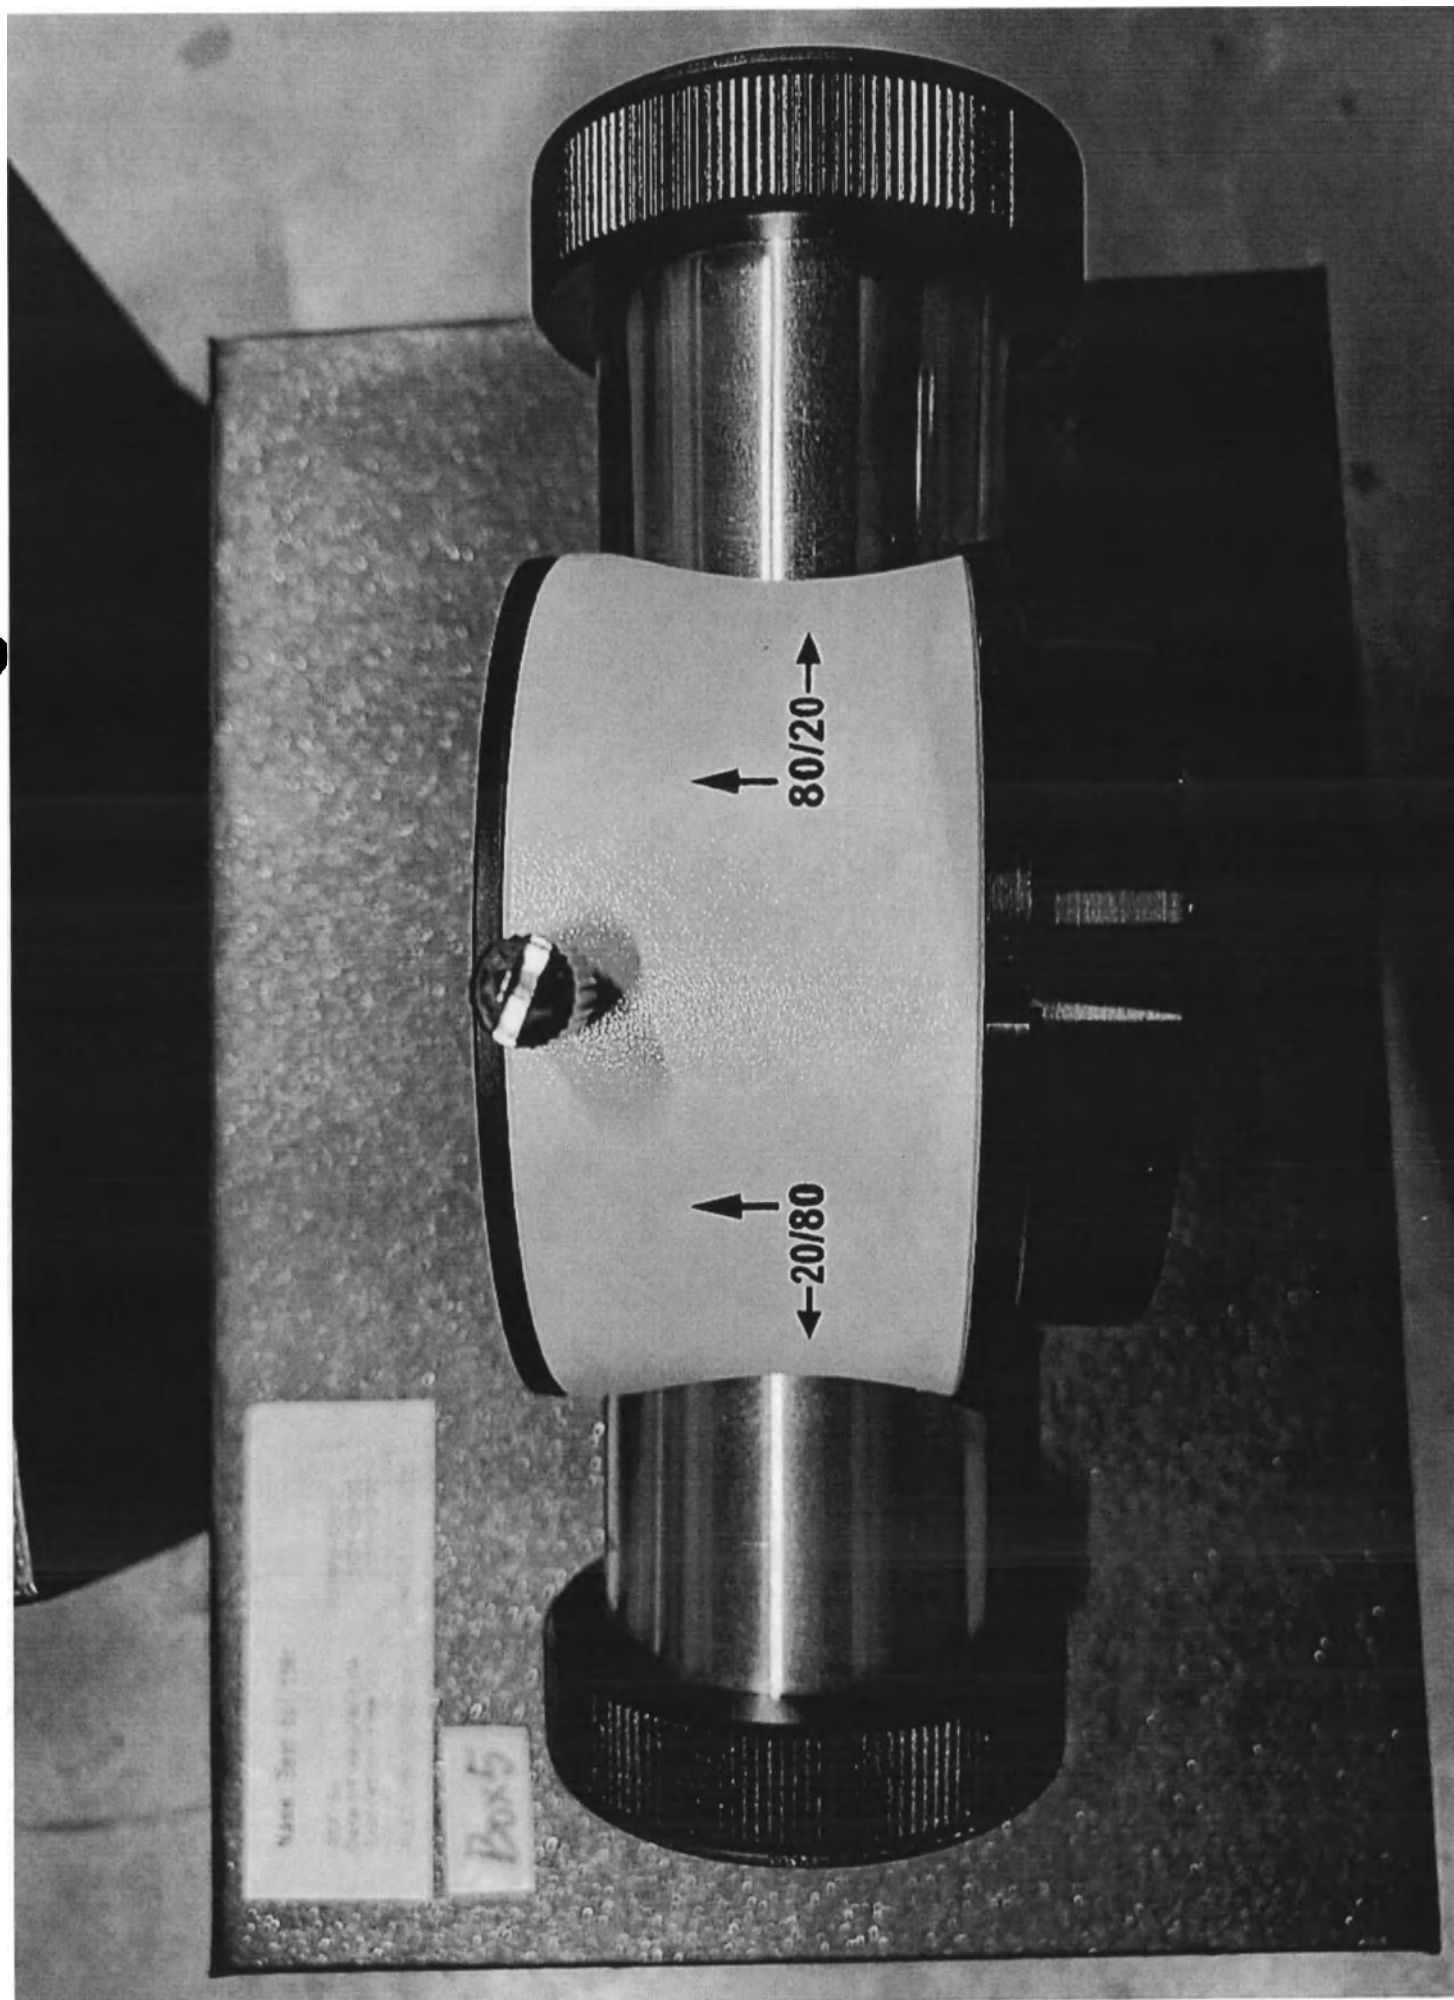

26) Устройство для углового поворота (при необходимости) – 1 шт. (Angle Rotation Device (if necessary) – 1 pc.)




27) Удлинитель биноклярный под 30° с светоделителем и устройством для углового поворота (при необходимости) – 1 шт. (Binocular Extender (30°) with Beam Splitter with Angle Rotation Device (if necessary) – 1 pc.)



28) Удлинитель биноклярный под 30° с устройством для углового поворота (при необходимости) – 1 шт. (Binocular Extender (30°) with Angle Rotation Device (if necessary) – 1 pc.)




29) Удлинитель биноклярный под 90° с устройством углового поворота (при необходимости) – 1 шт.
(Binocular Extender (90°) with Angle Rotation Device (if necessary) – 1 pc)

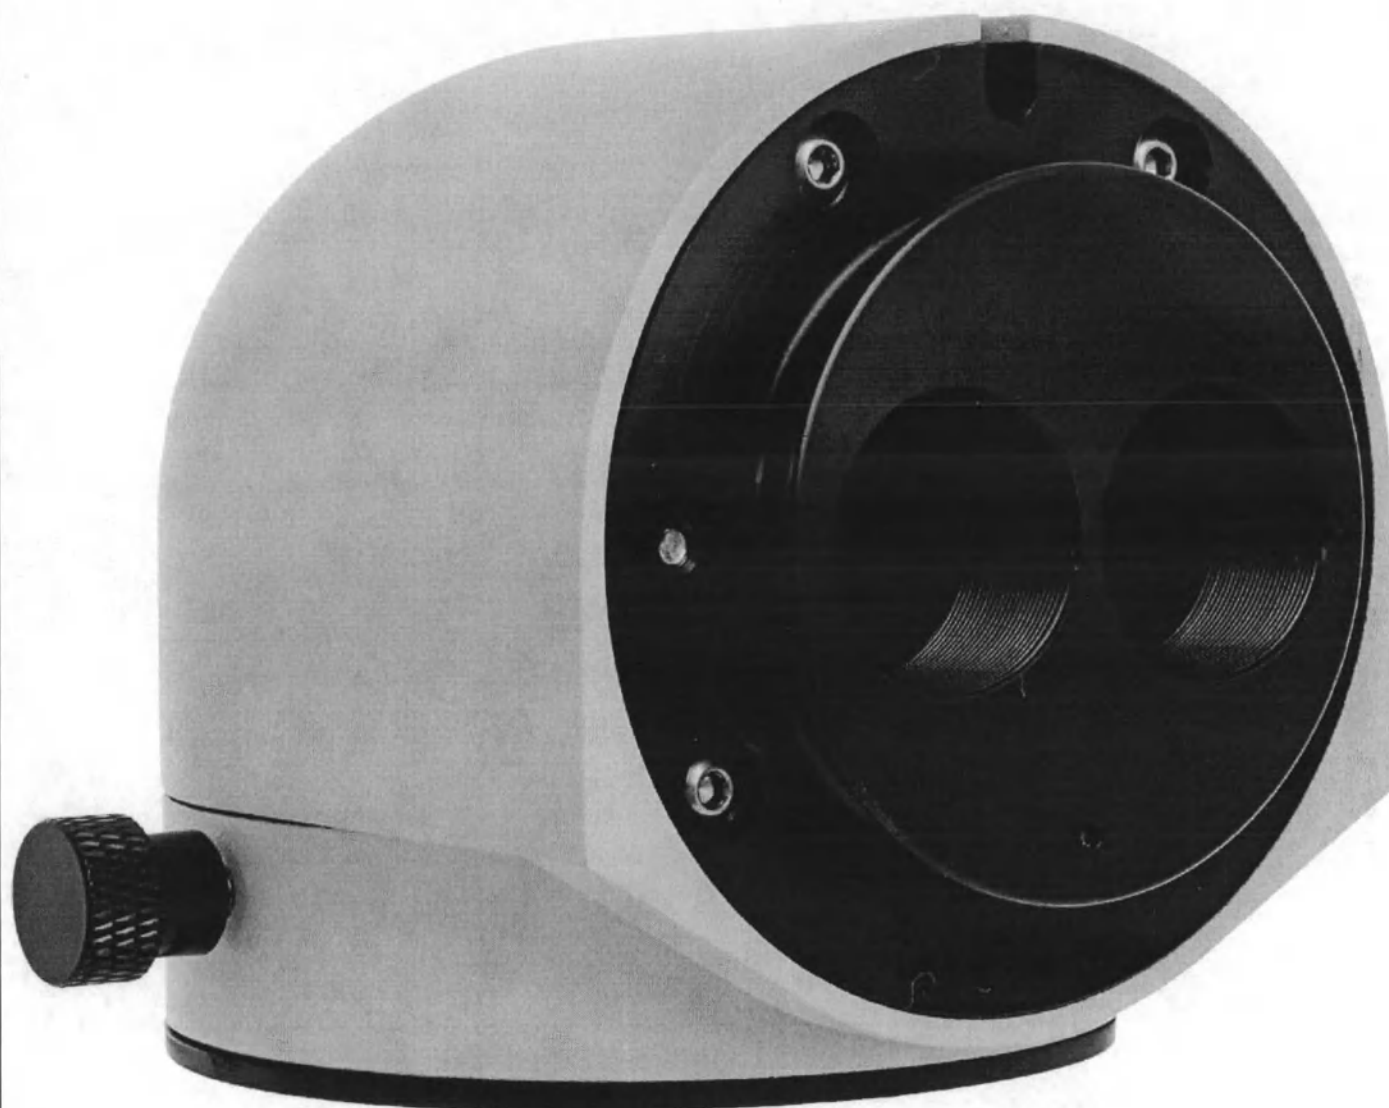

30) Удлинитель биноклярный под 90° со светоделителем с устройством углового поворота (при необходимости) – 1 шт. (Binocular Extender (90°) with Beam Splitter with Angle Rotation Device (if necessary)– 1 pc.)



31) Удлинитель бинокулярный под 45° (при необходимости) – 1 шт. (Binocular Extender (45°) (if necessary) – 1 pc.)

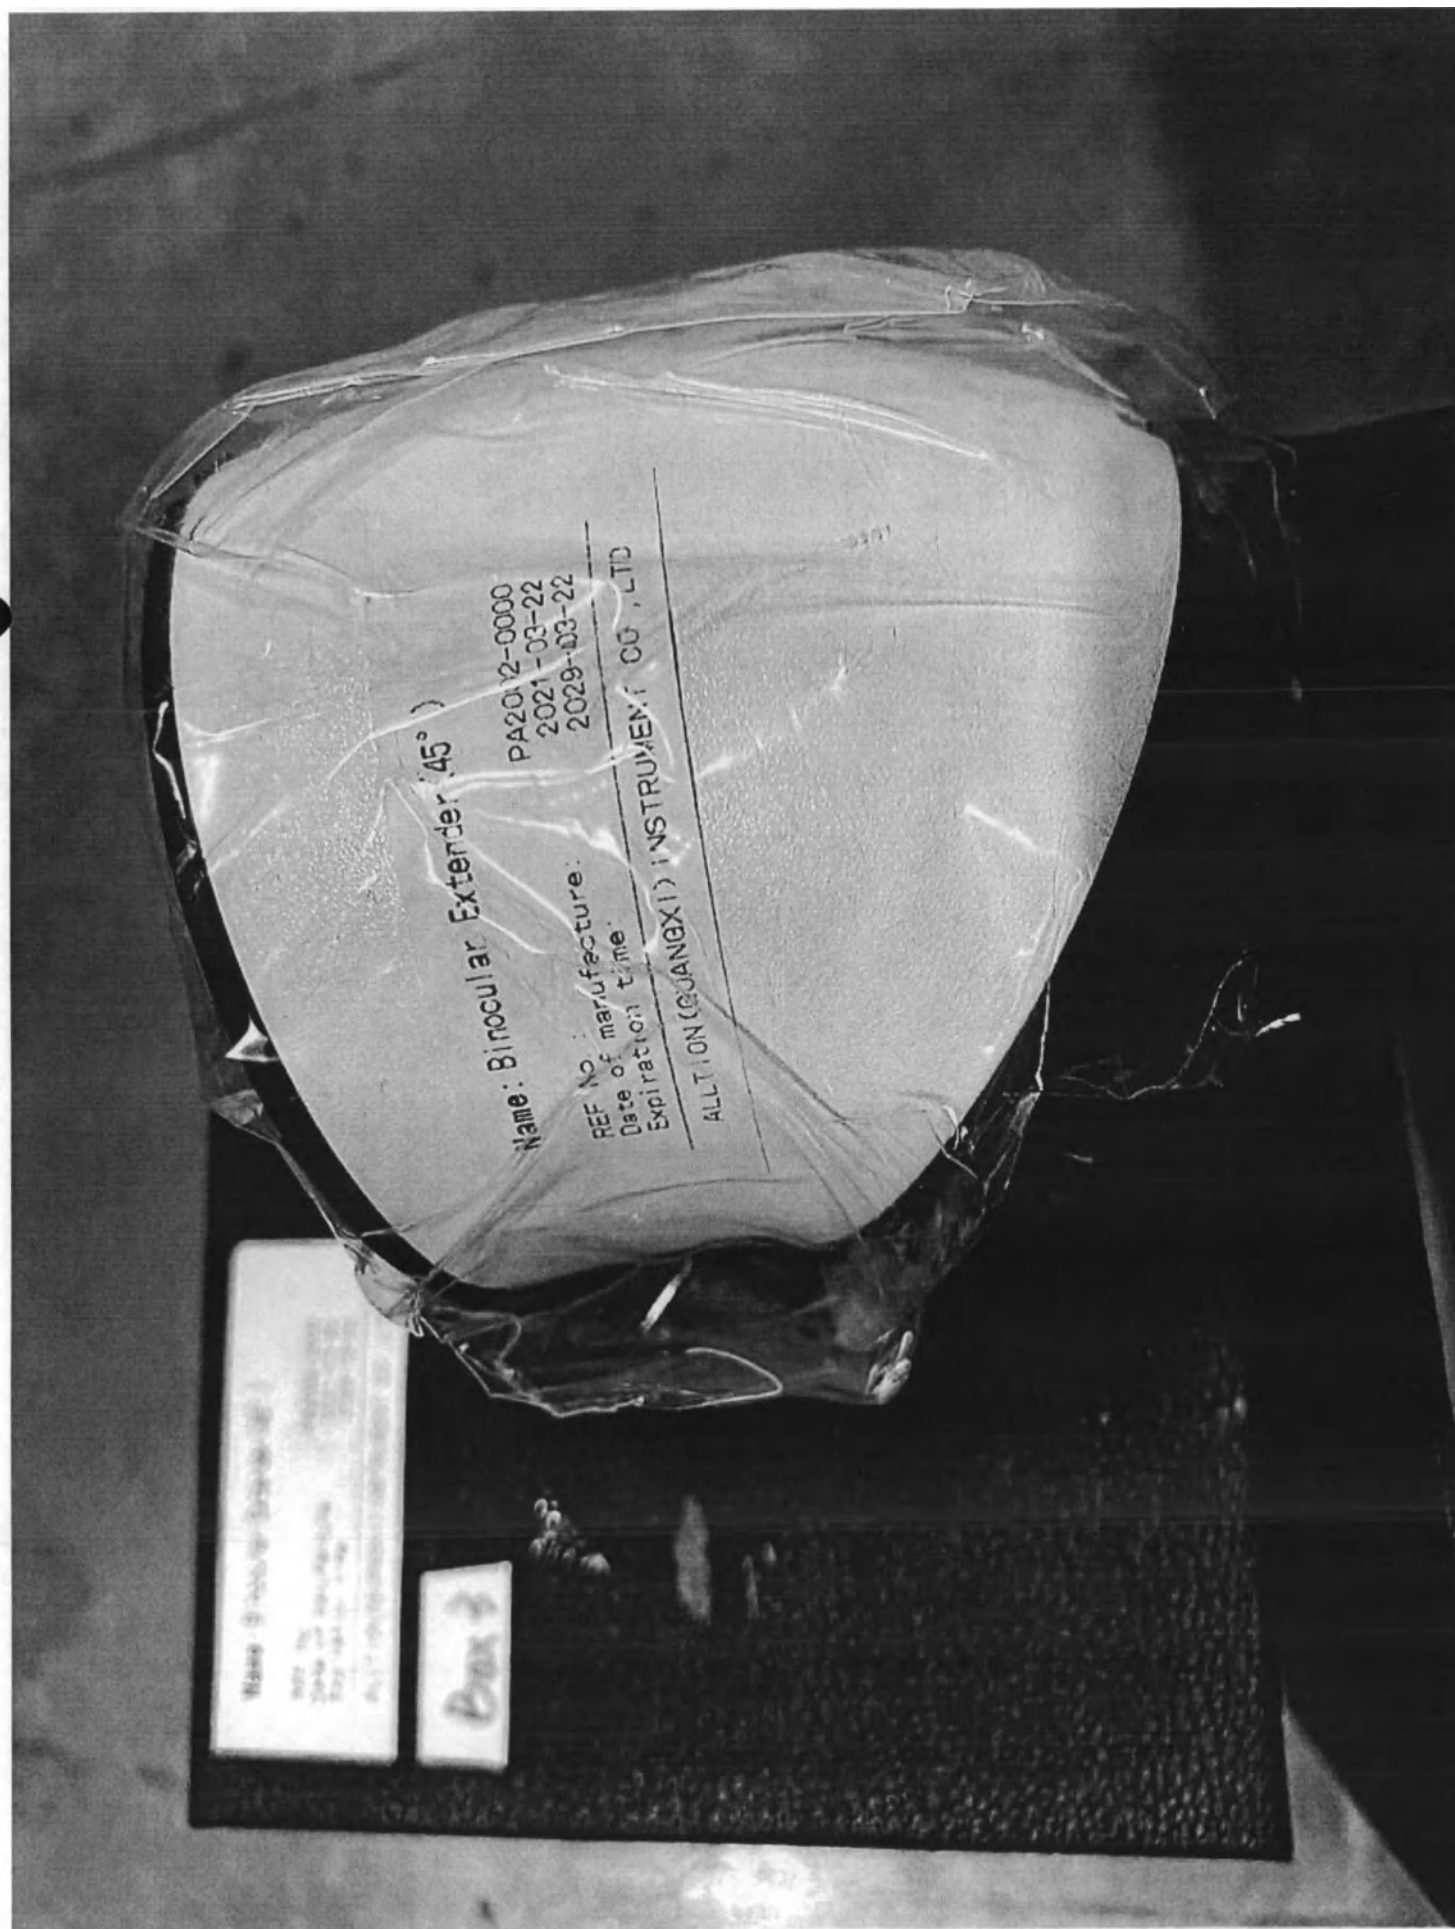

32) Муфта для двухмерного вращения бинокулярного тубуса ассистента (при необходимости) – 1 шт.
(2-D Rotation Binocular Assistant Scope Connector (if necessary) – 1 pc.)



33) Муфта для трехмерного вращения бинокулярного тубуса ассистента (при необходимости) – 1 шт.
(3-D Rotation Binocular Assistant Scope Connector (if necessary) – 1 pc.)




34) Окуляр 12.5X (при необходимости) – 2 шт. (12.5X Eyepiece (if necessary) – 2 pcs.)




35) Поршень пневматический для АМ-2000 (при необходимости) – 1 шт. (Gas Spring for AM-2000 (if necessary) – 1 pc.)




36) Модуль светодиодный (при необходимости) – 1 шт. (LED Module (if necessary) – 1 pc.)

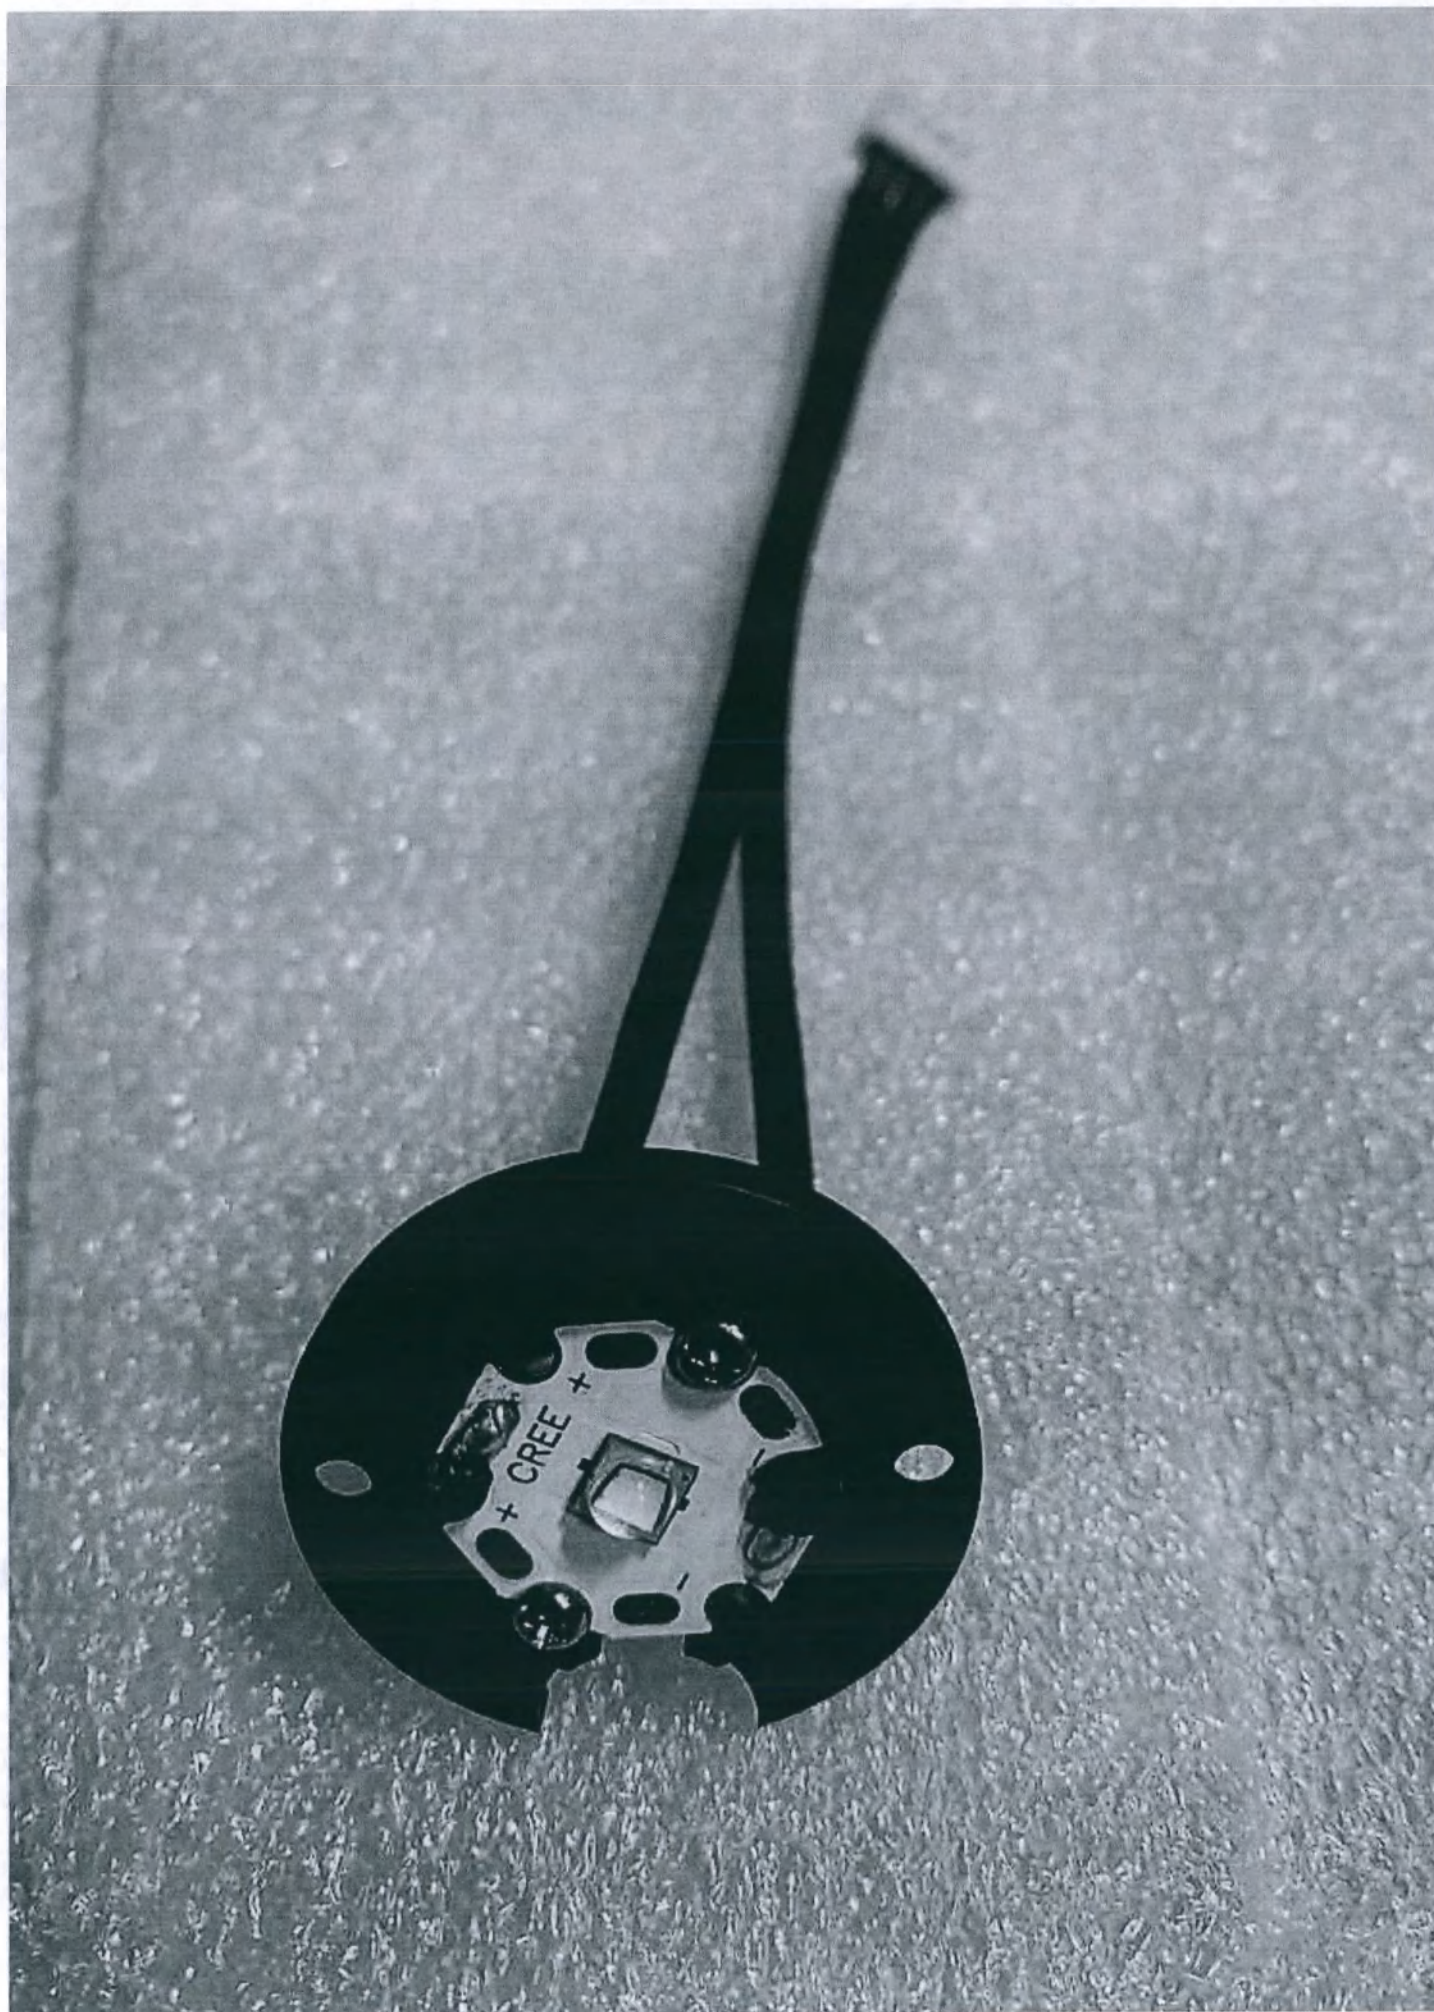


37) Кулер (при необходимости) – 1 шт. (Cooling Fan (if necessary) – 1 pc.)

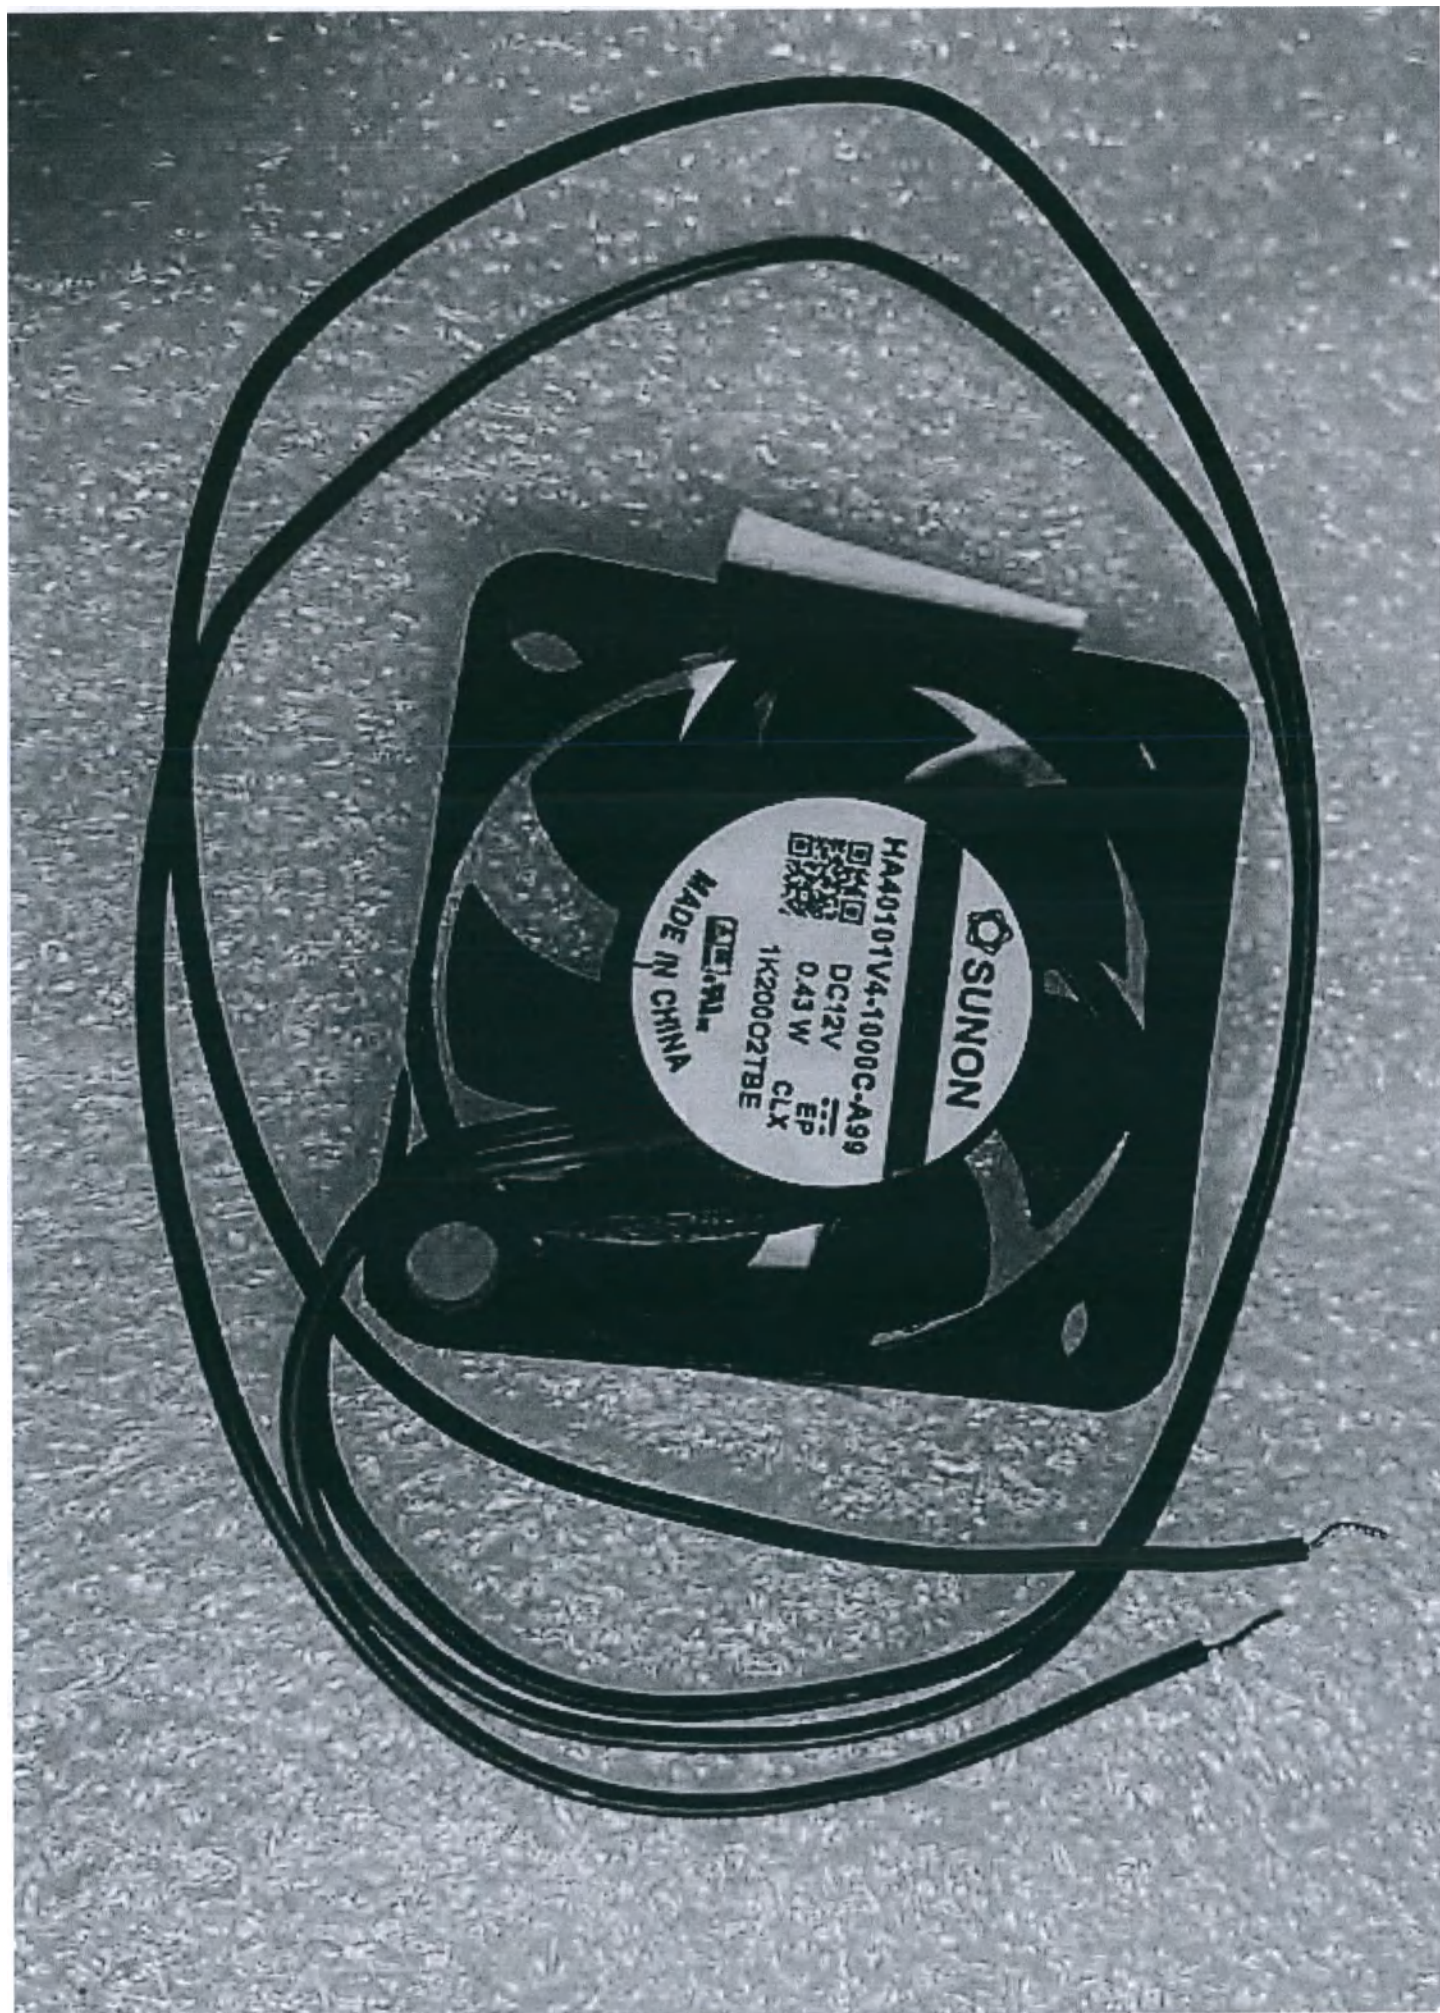


38) Комплект крышек стерилизуемых АМ-2000 – 1 шт. (Set of AM-2000 sterilization lids – 1 pc.)

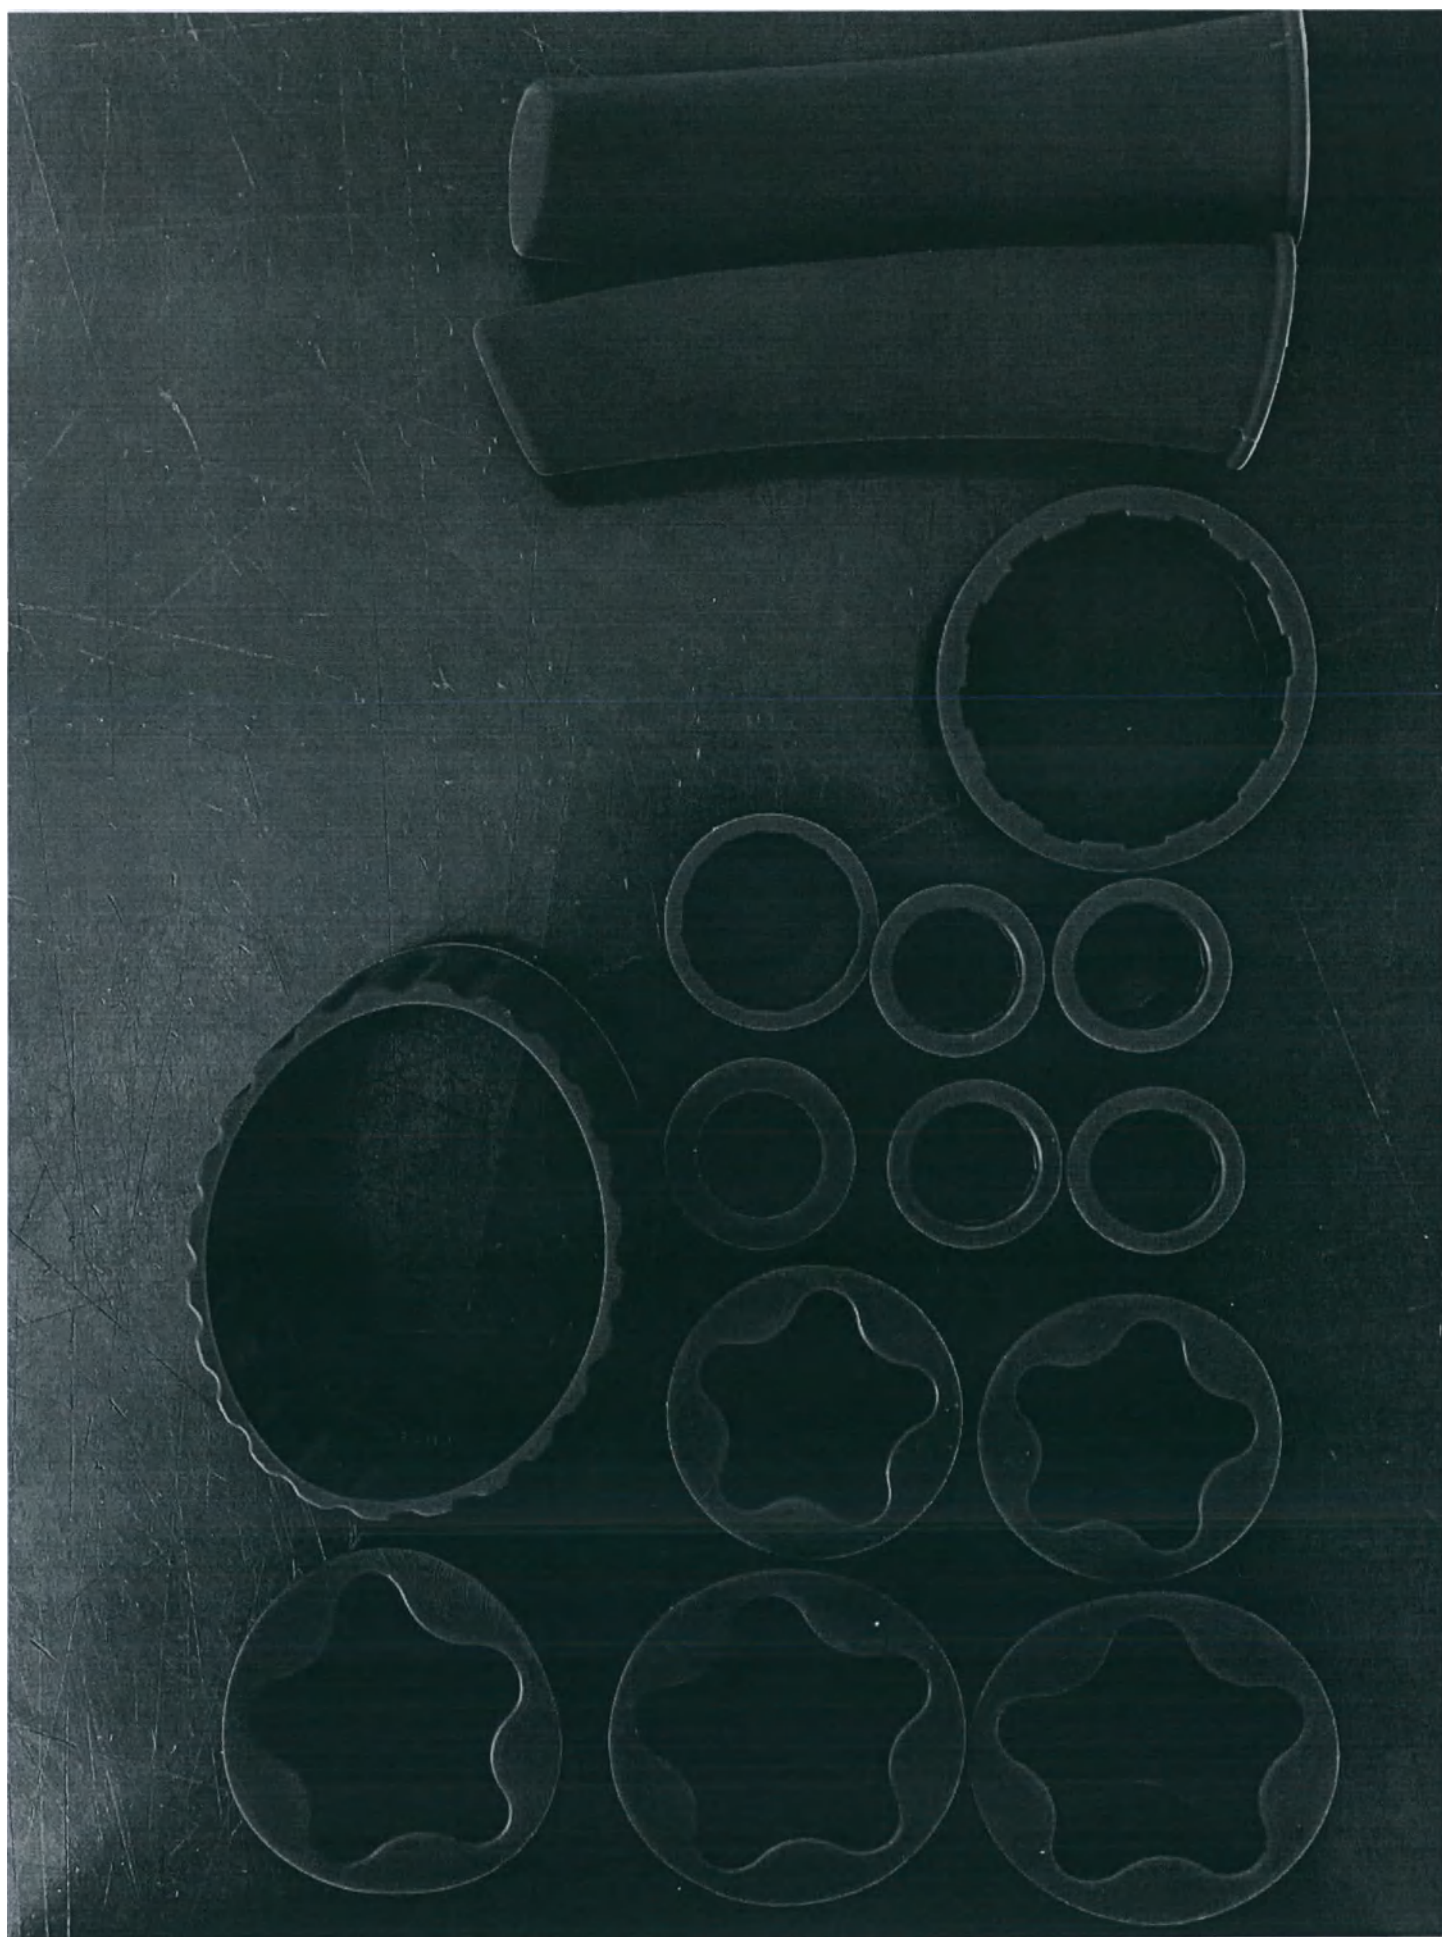

39) Крышка для защиты объектива – 1 шт. (Objective Protective Cap – 1 pc.)

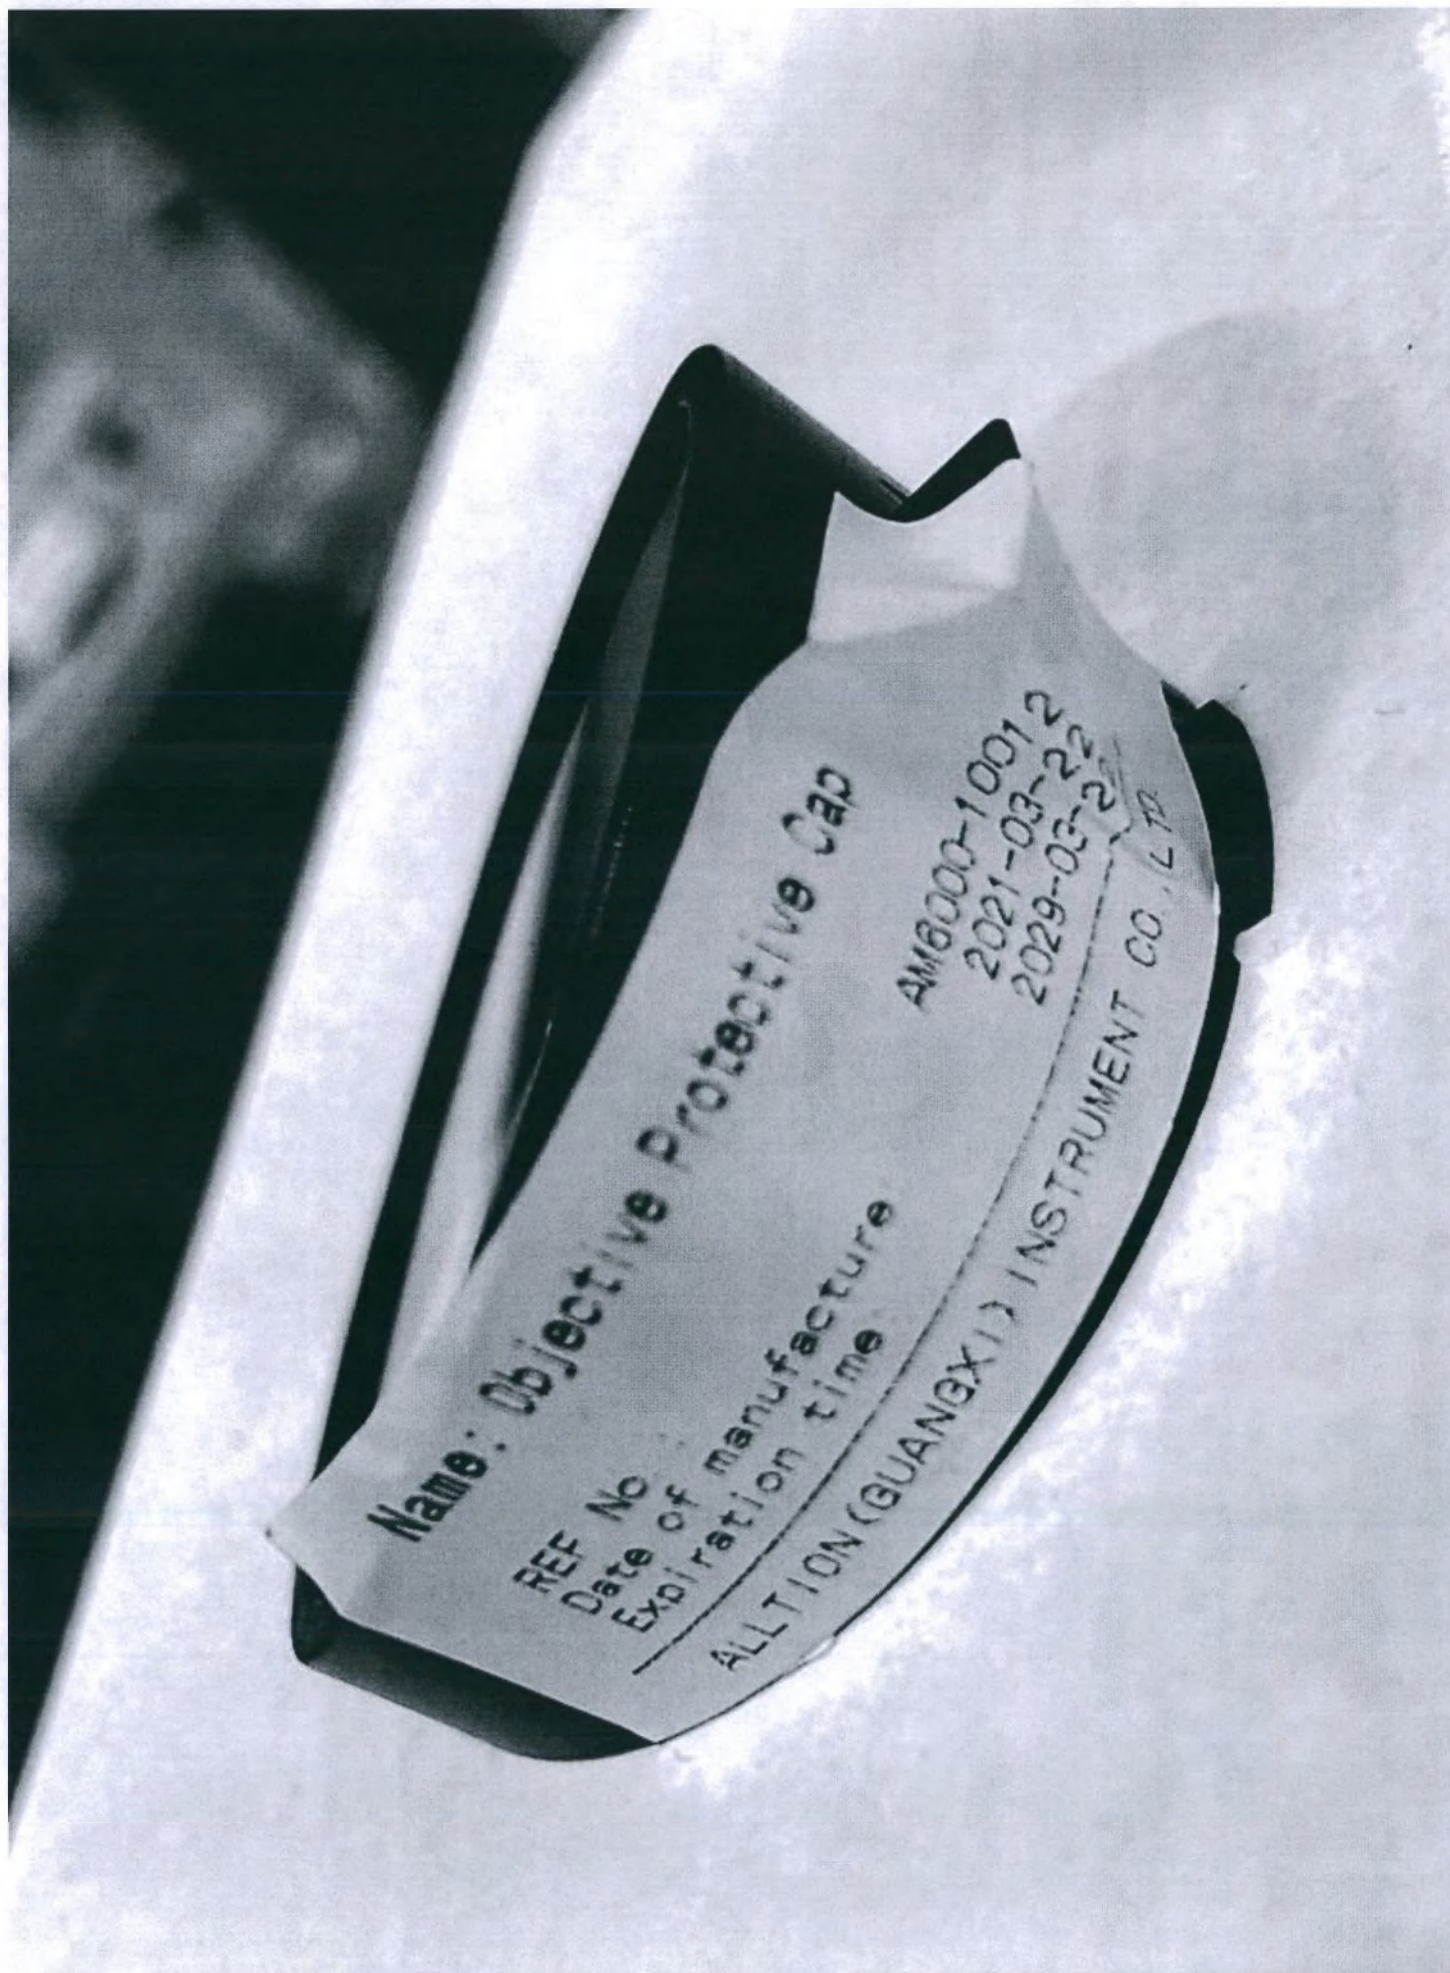

40) Комплект ручек регулировки для АМ-2000 (при необходимости) – 1 шт. (Set of adjustment knobs for AM-2000(if necessary) – 1 pc.)

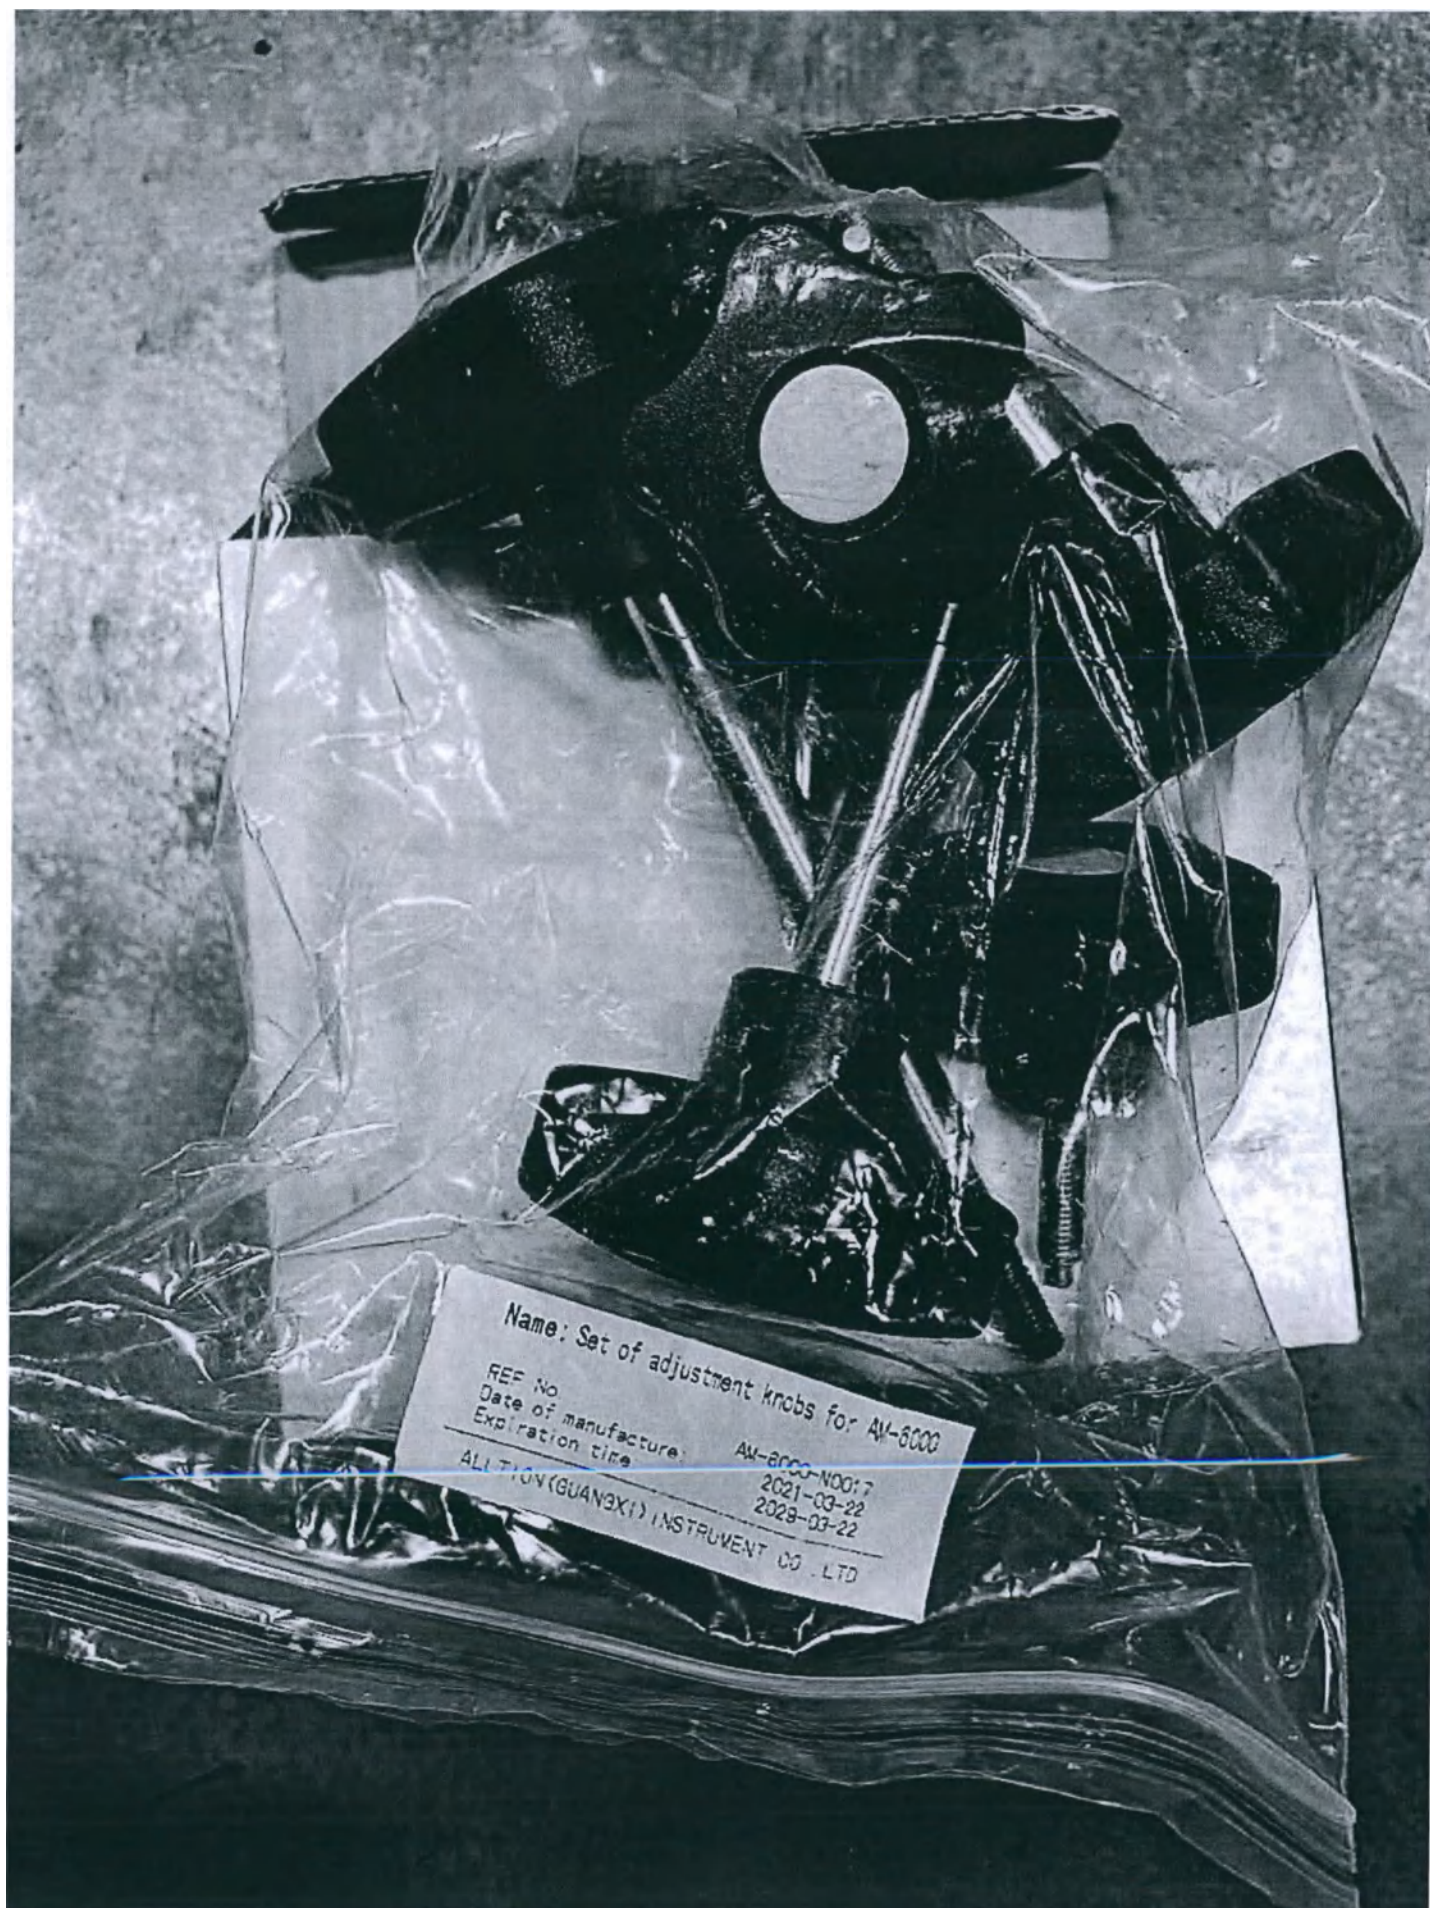

41) Кронштейн для монитора (при необходимости) – 1 шт. (Monitor Bracket (if necessary) – 1 pc.)



42) Объектив с переменным фокусным расстоянием $F=200-300$ мм для АМ-2000 (при необходимости)
– 1 шт. (F200-300mm Variable Objective Lens for AM-2000 (if necessary) – 1 pc.)



43) Объектив F250 для АМ-2000 (при необходимости) – 1 шт. (F250mm Objective Lens for AM-2000 (if necessary) – 1 pc.)




44) Объектив F300 для АМ-2000 (при необходимости) – 1 шт. (F300mm Objective Lens for AM-2000 (if necessary) – 1 pc.)



Объектив F400 для АМ-2000 (при необходимости) – 1 шт. (F400mm Objective Lens for AM-2000 (if necessary) – 1 pc.)



45) Печатная плата для АМ-2000 (при необходимости) – 1 шт. (Dimming Circuit Board for AM-2000 (if necessary) – 1 pc.)

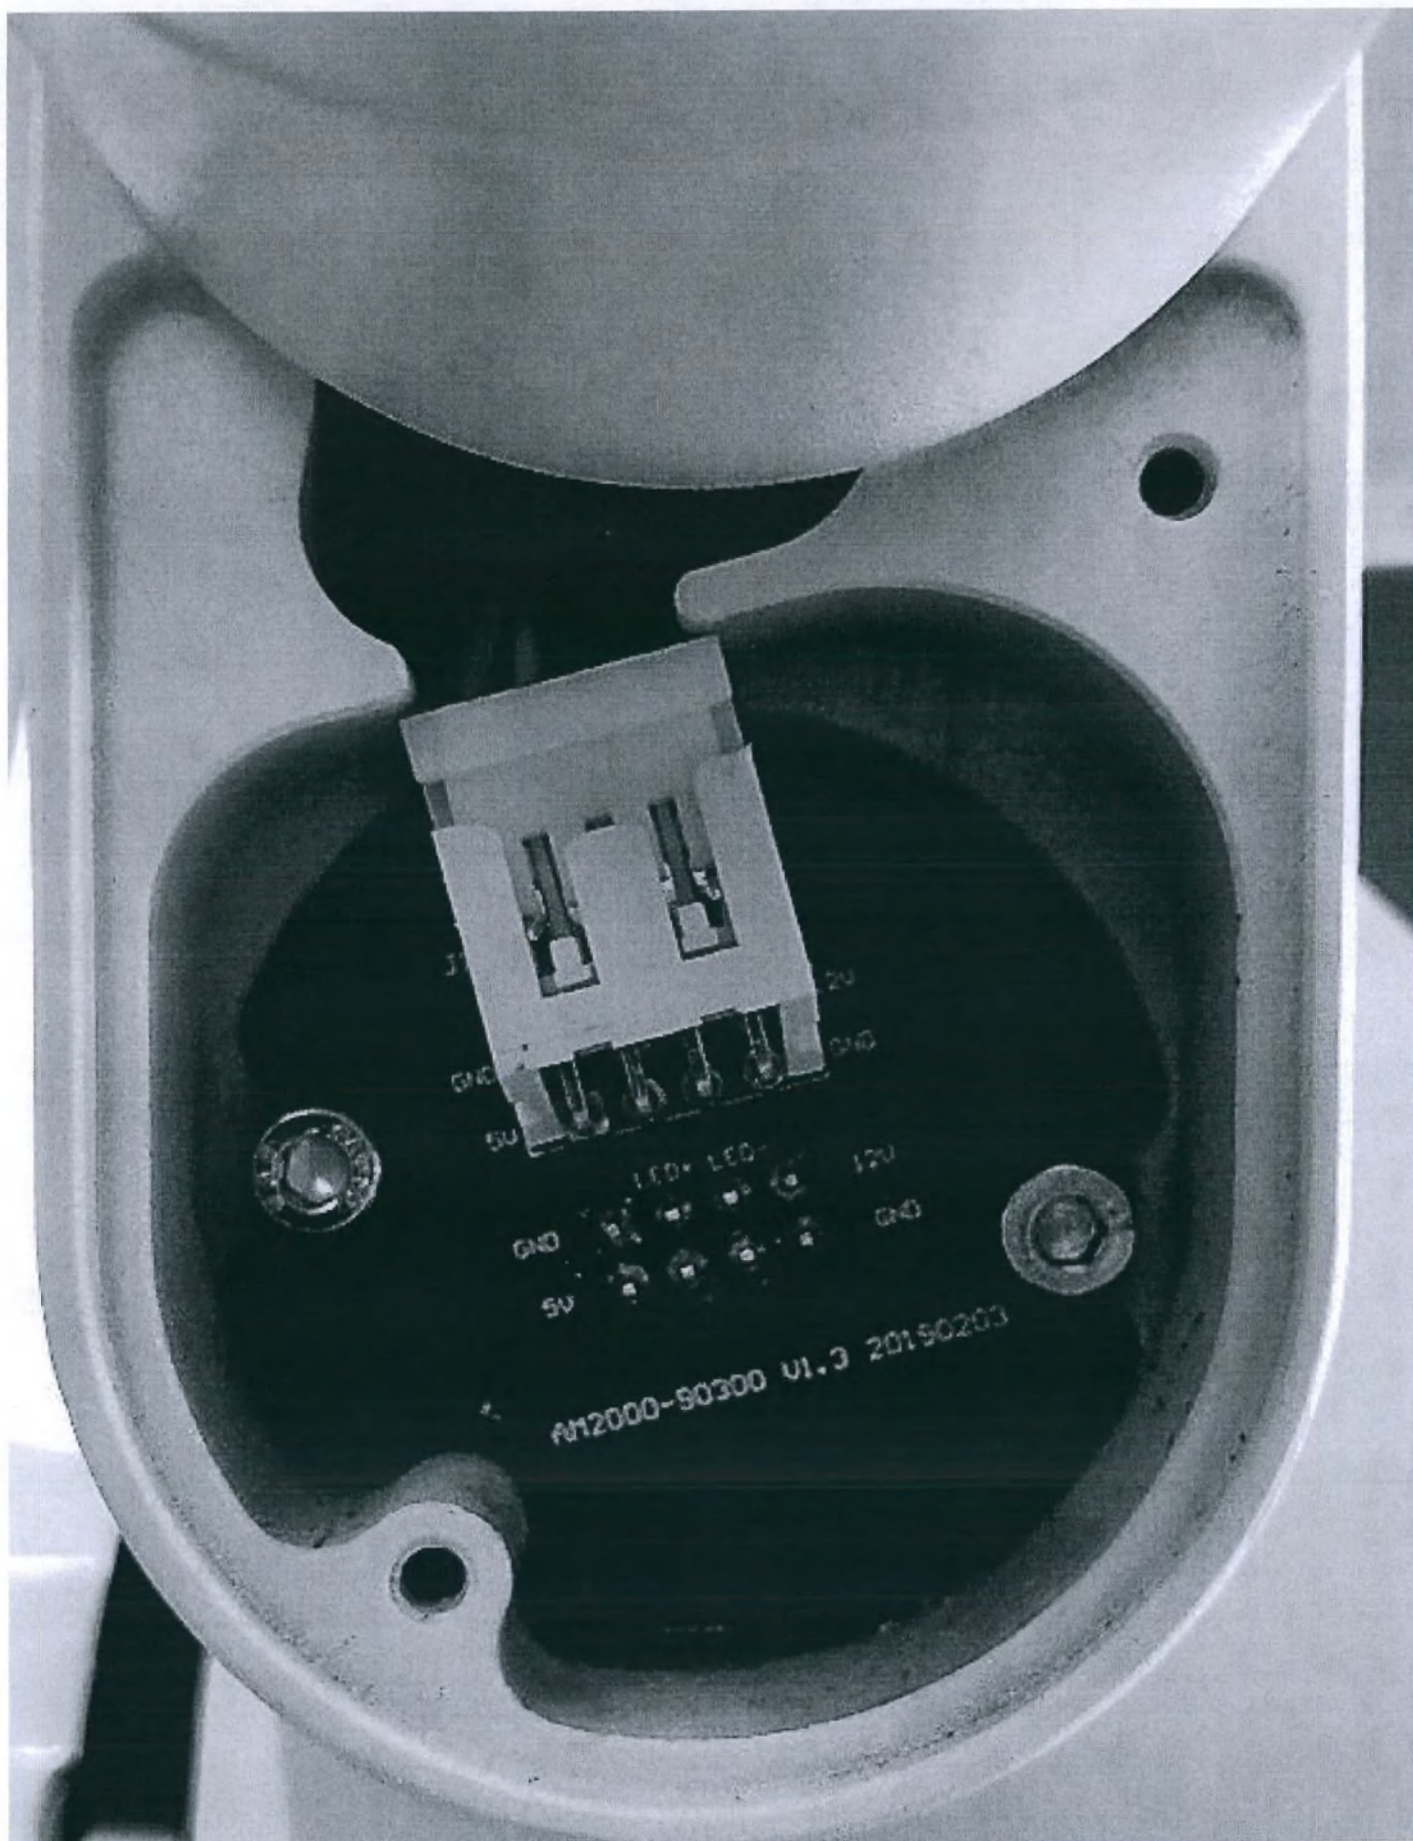


46) Чехол пылезащитный – 1 шт. (Dust Cover – 1 pc.)



honor 9

47) Колесо запасное – не более 10 шт. (Caster (if necessary) – no more than 10 pcs.)

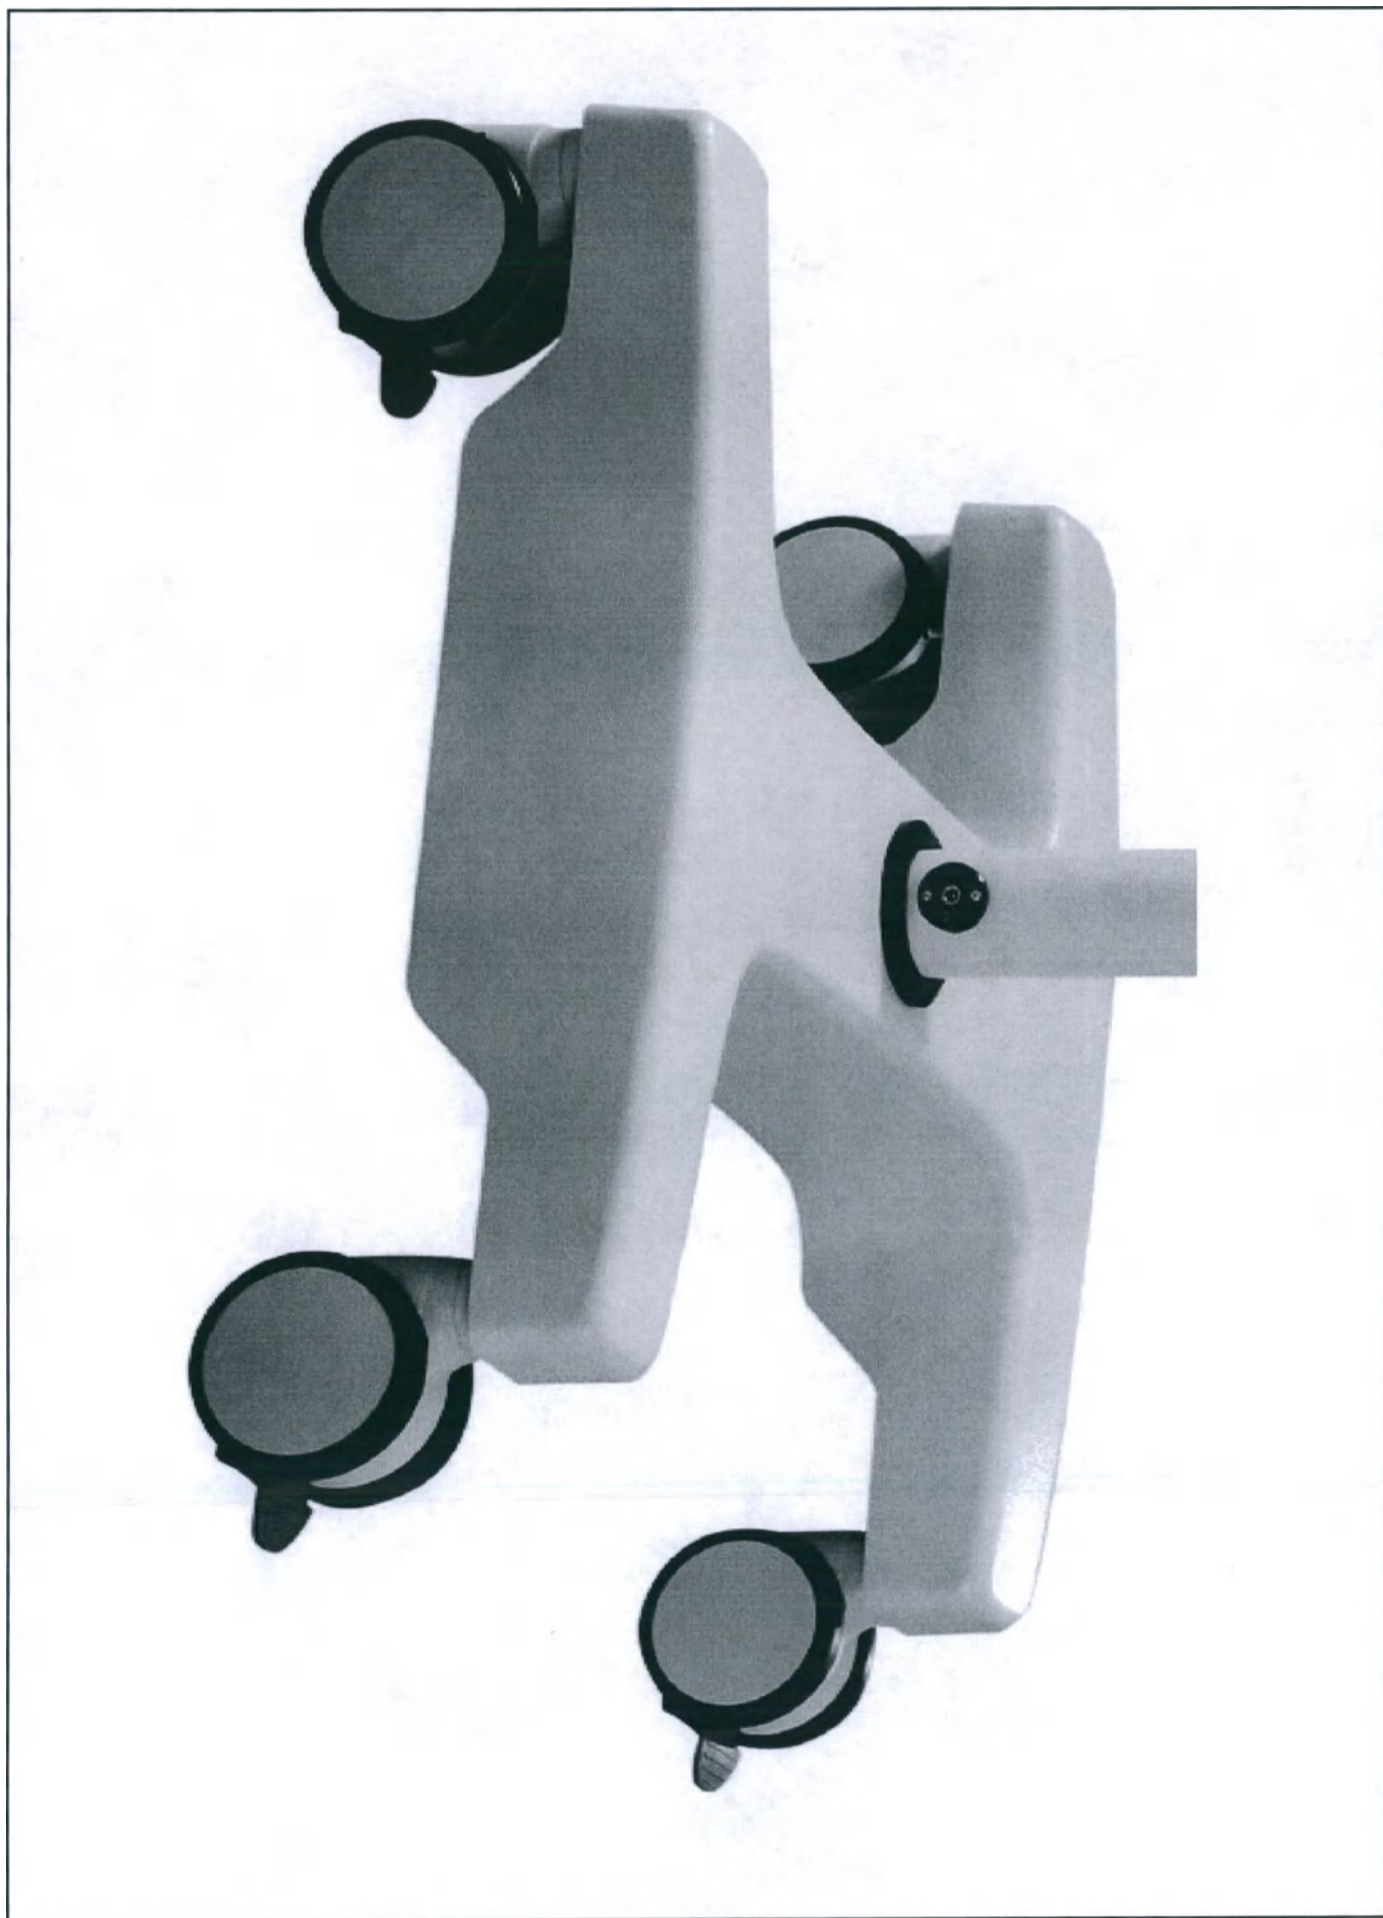


48) Потенциометр – 1 шт. (F300mm Objective Lens for AM-2000 (if necessary) – 1 pc.)





50) Адаптер цифровой камеры F180 – 1 шт. (F180 Digital Camera Adapter (if necessary) – 1 pc.)

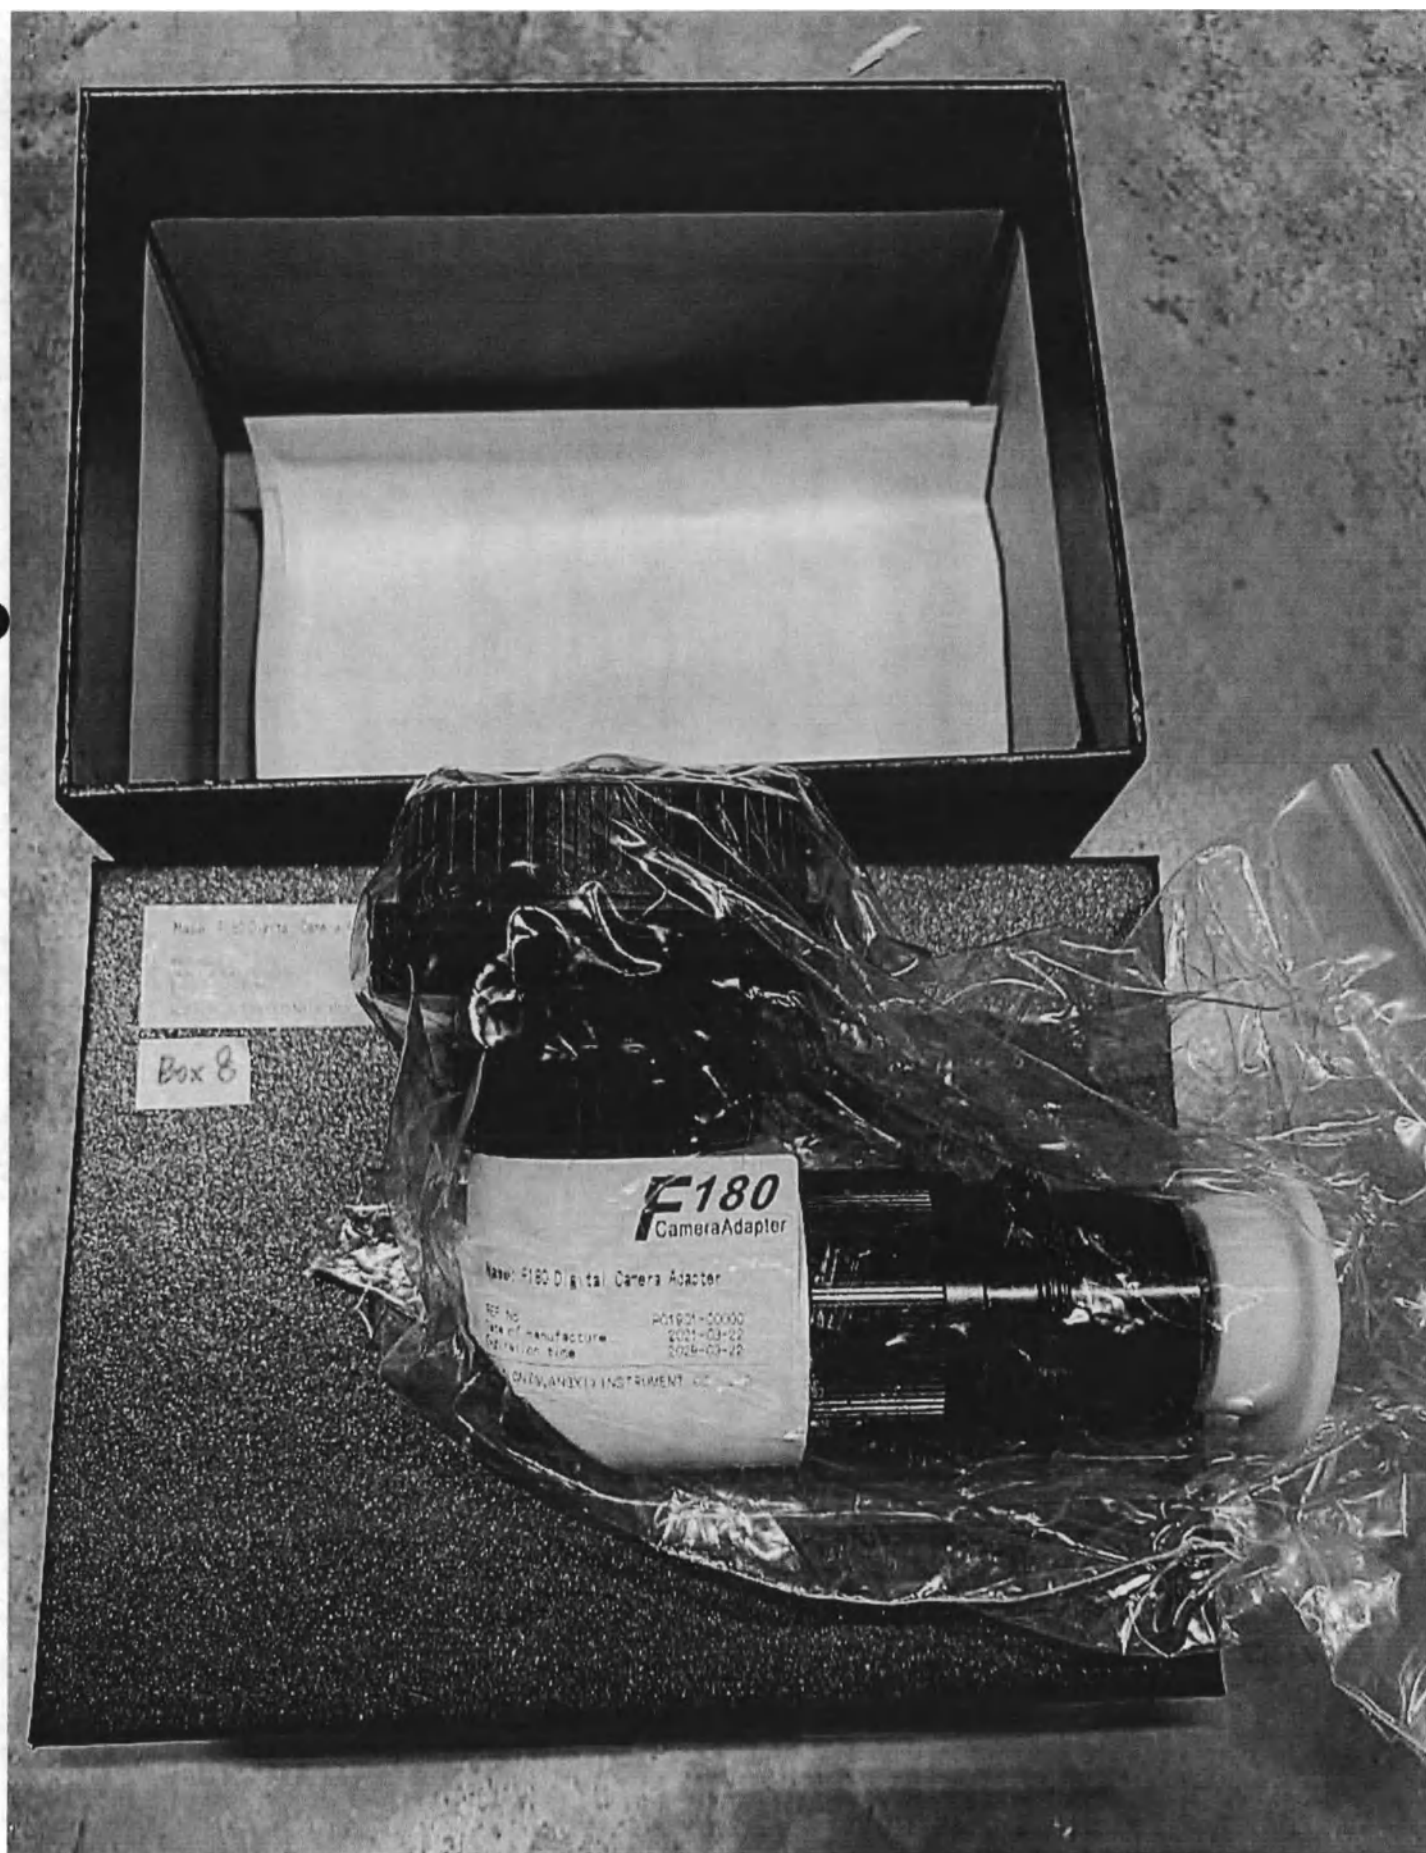


51) Адаптер цифровой камеры F340 – 1 шт. (F340 Digital Camera Adapter (if necessary) – 1 pc.)




52) Адаптер для мобильного телефона (при необходимости) – 1 шт. (Mobile Phone Adapter (if necessary) – 1 pc)



54) Муфта противоположного тубуса (при необходимости) - 1 шт. (Opposite scope connector (if necessary) - 1 pc)

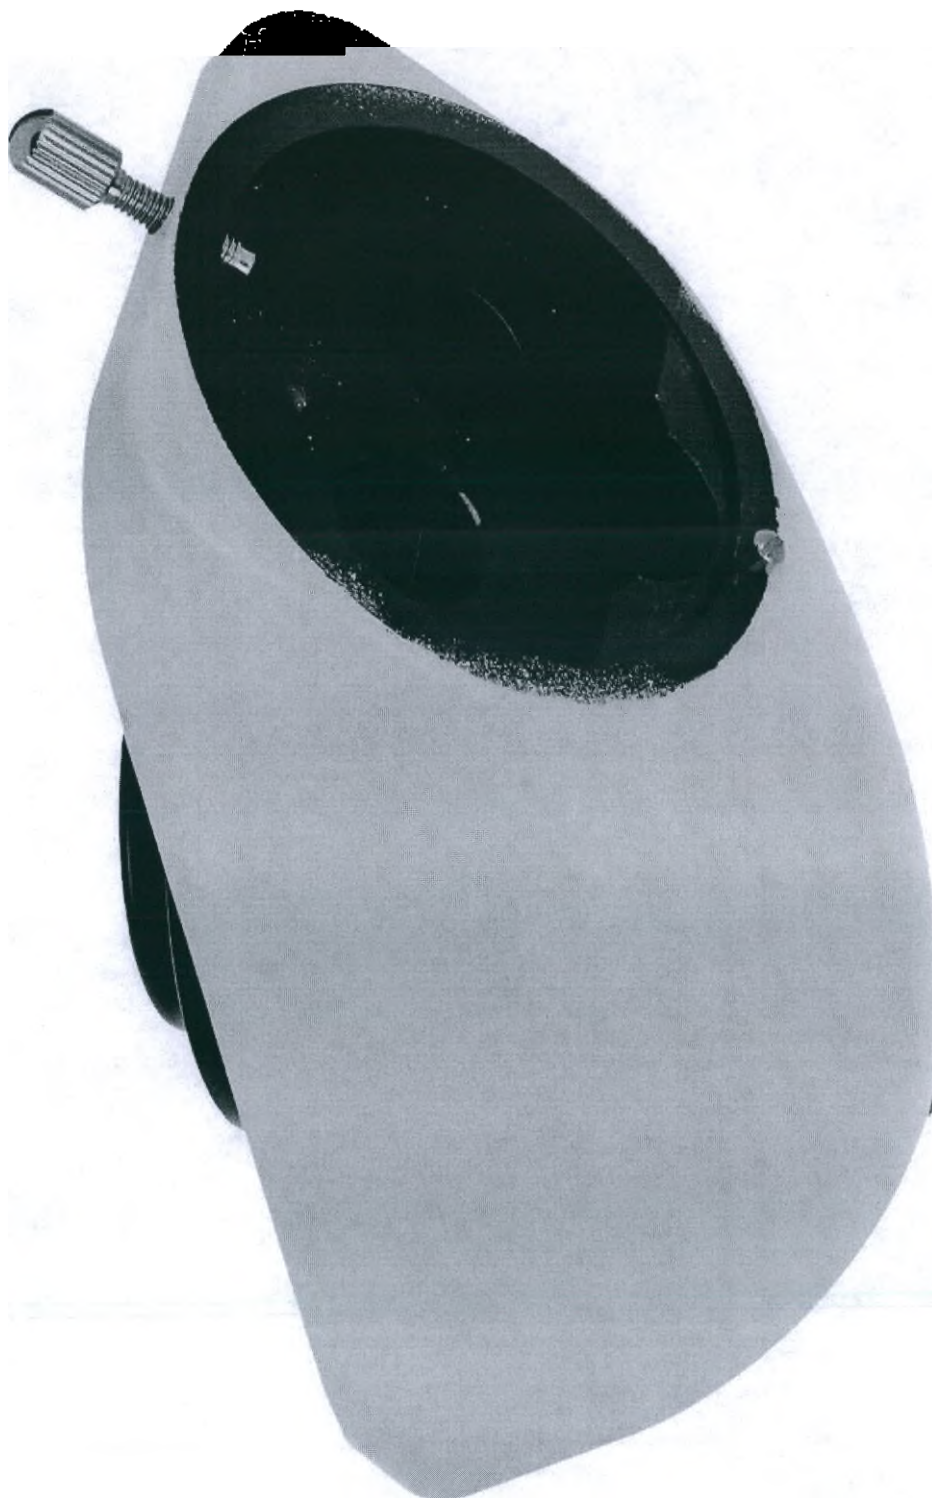

55) Камера полнофункциональная ALL-CAM2 – 1 шт. (Full Function Camera ALL-CAM2 (if necessary) – 1 pc.)

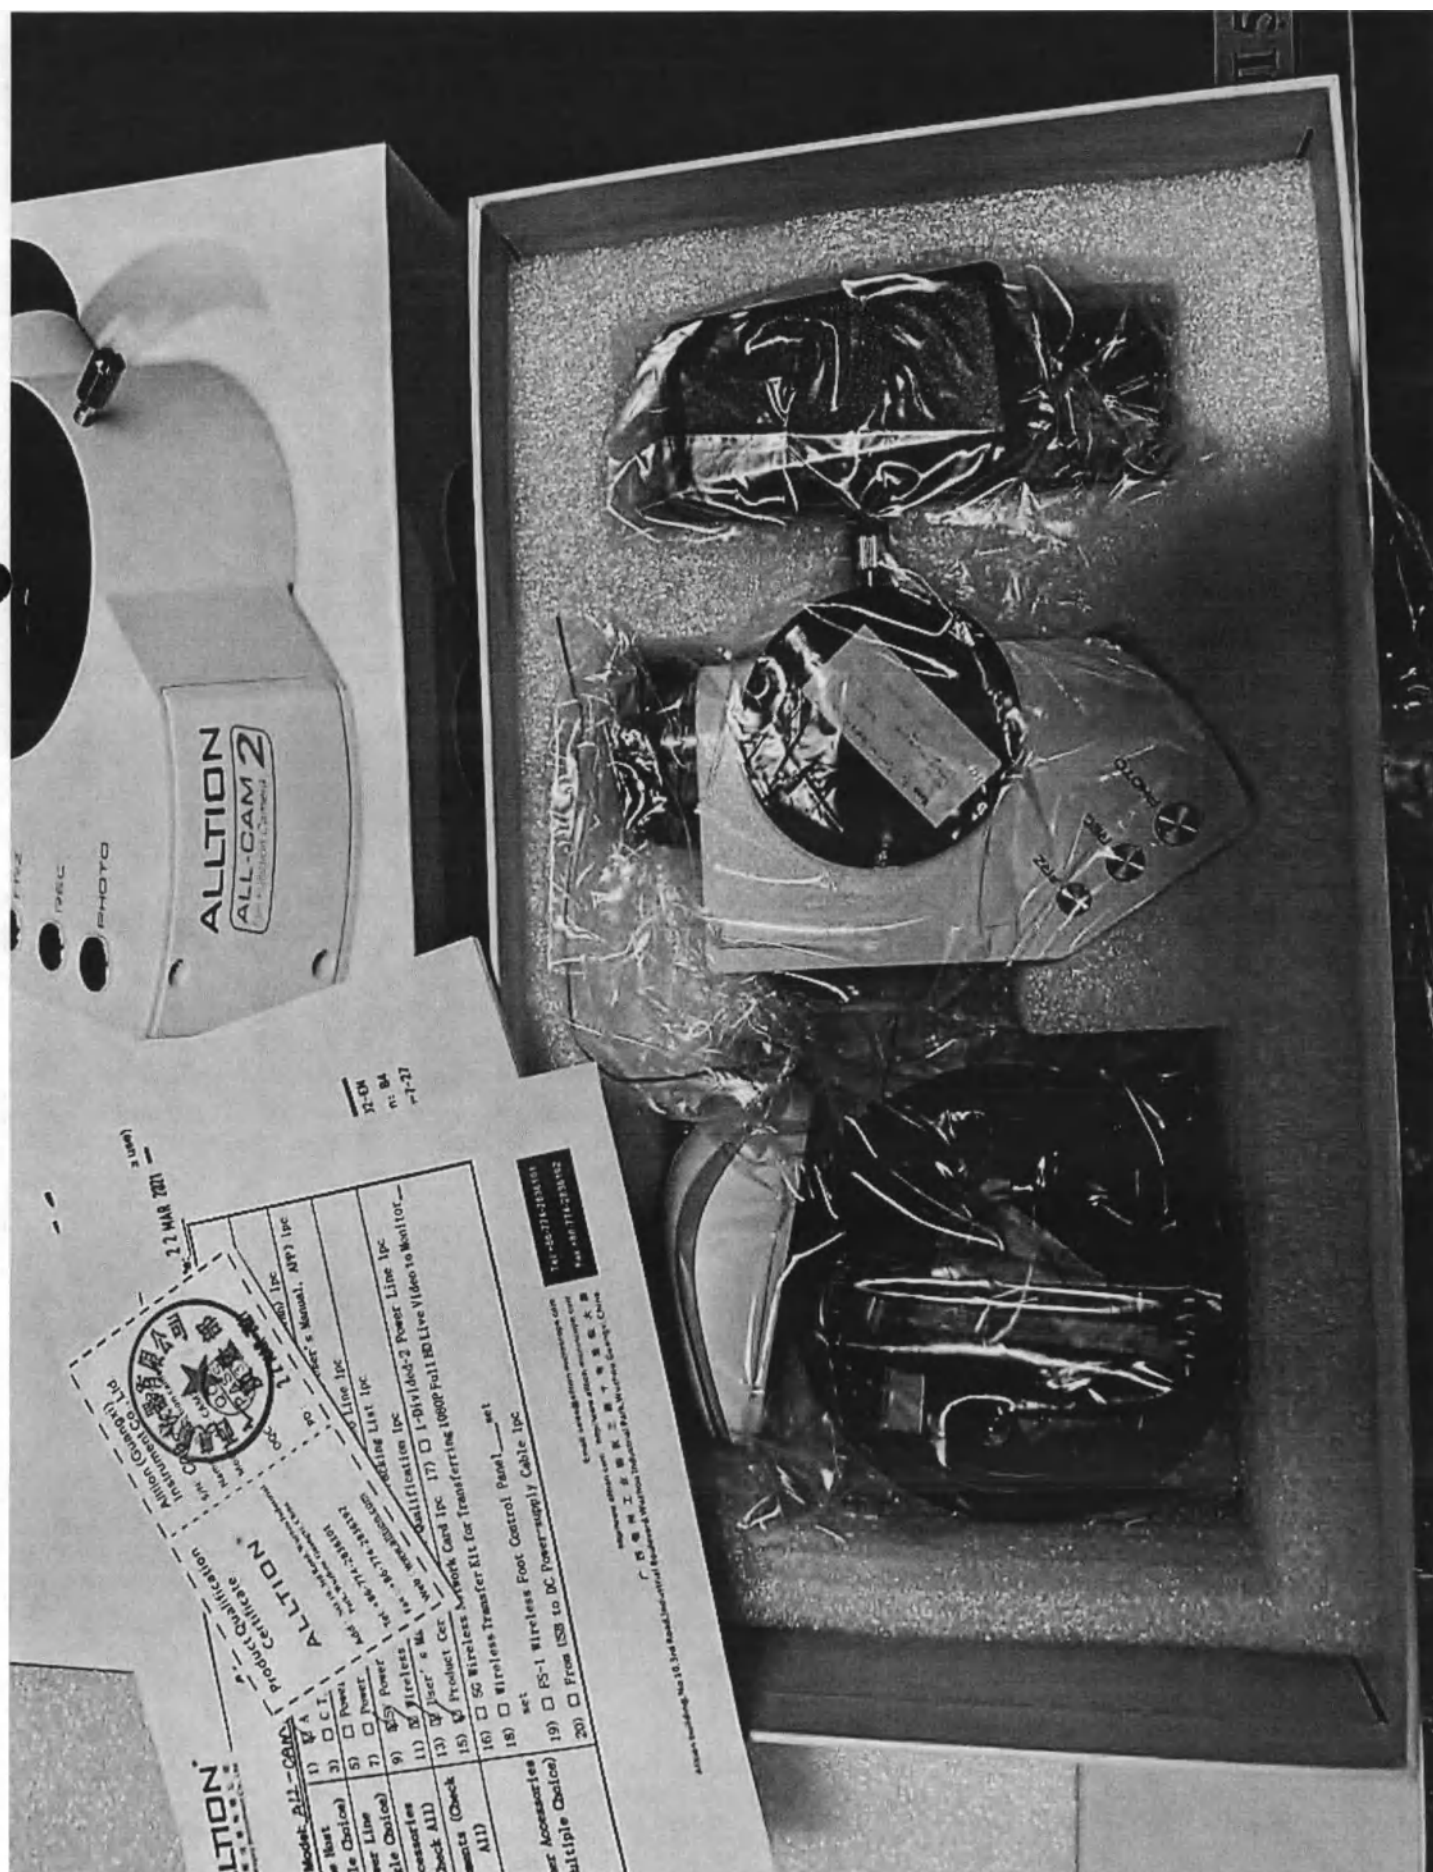


AM-2000 Surgical Microscope



User's Manual

(Please read the instruction carefully before using it)

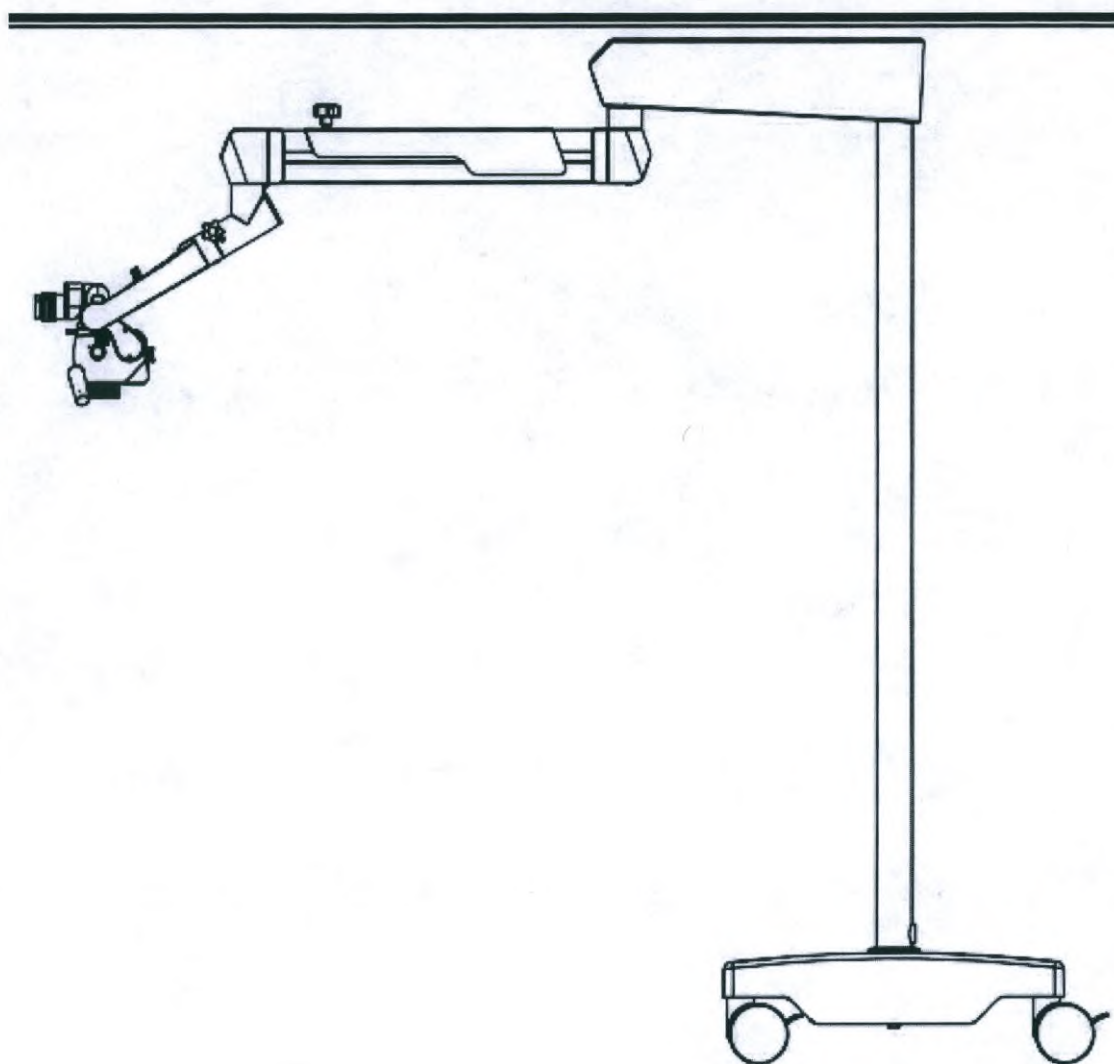

PA1805-UM01-EN

Version: B0


2022-08-01

Alltion (Guangxi) Instrument Co., Ltd.

Общий вид: Микроскоп хирургический АМ-5000




1) Оптический блок микроскопа АМ-5000 – 1 шт. (Optical unit of the microscope AM-5000 – 1 pc.)

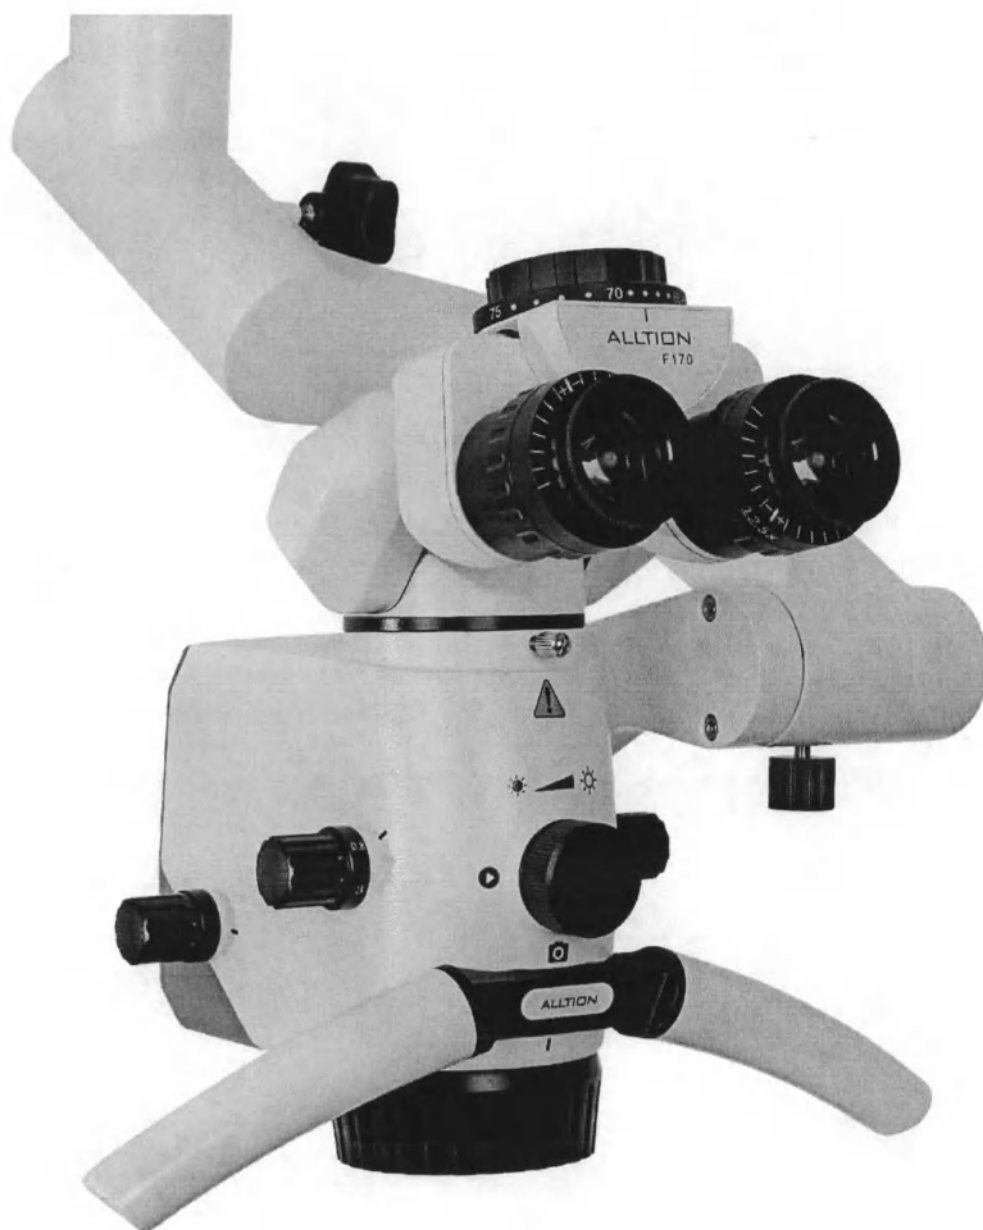

2) Подставка напольная передвижная для АМ-5000 (при необходимости) – 1 шт. (Mobile Floor Stand for AM-5000 (if necessary) – 1 pc.)



3) Подставка напольная стационарная для АМ-5000 (при необходимости) – 1 шт. (Fixed Stand for AM-5000 (if necessary) – 1 pc.)

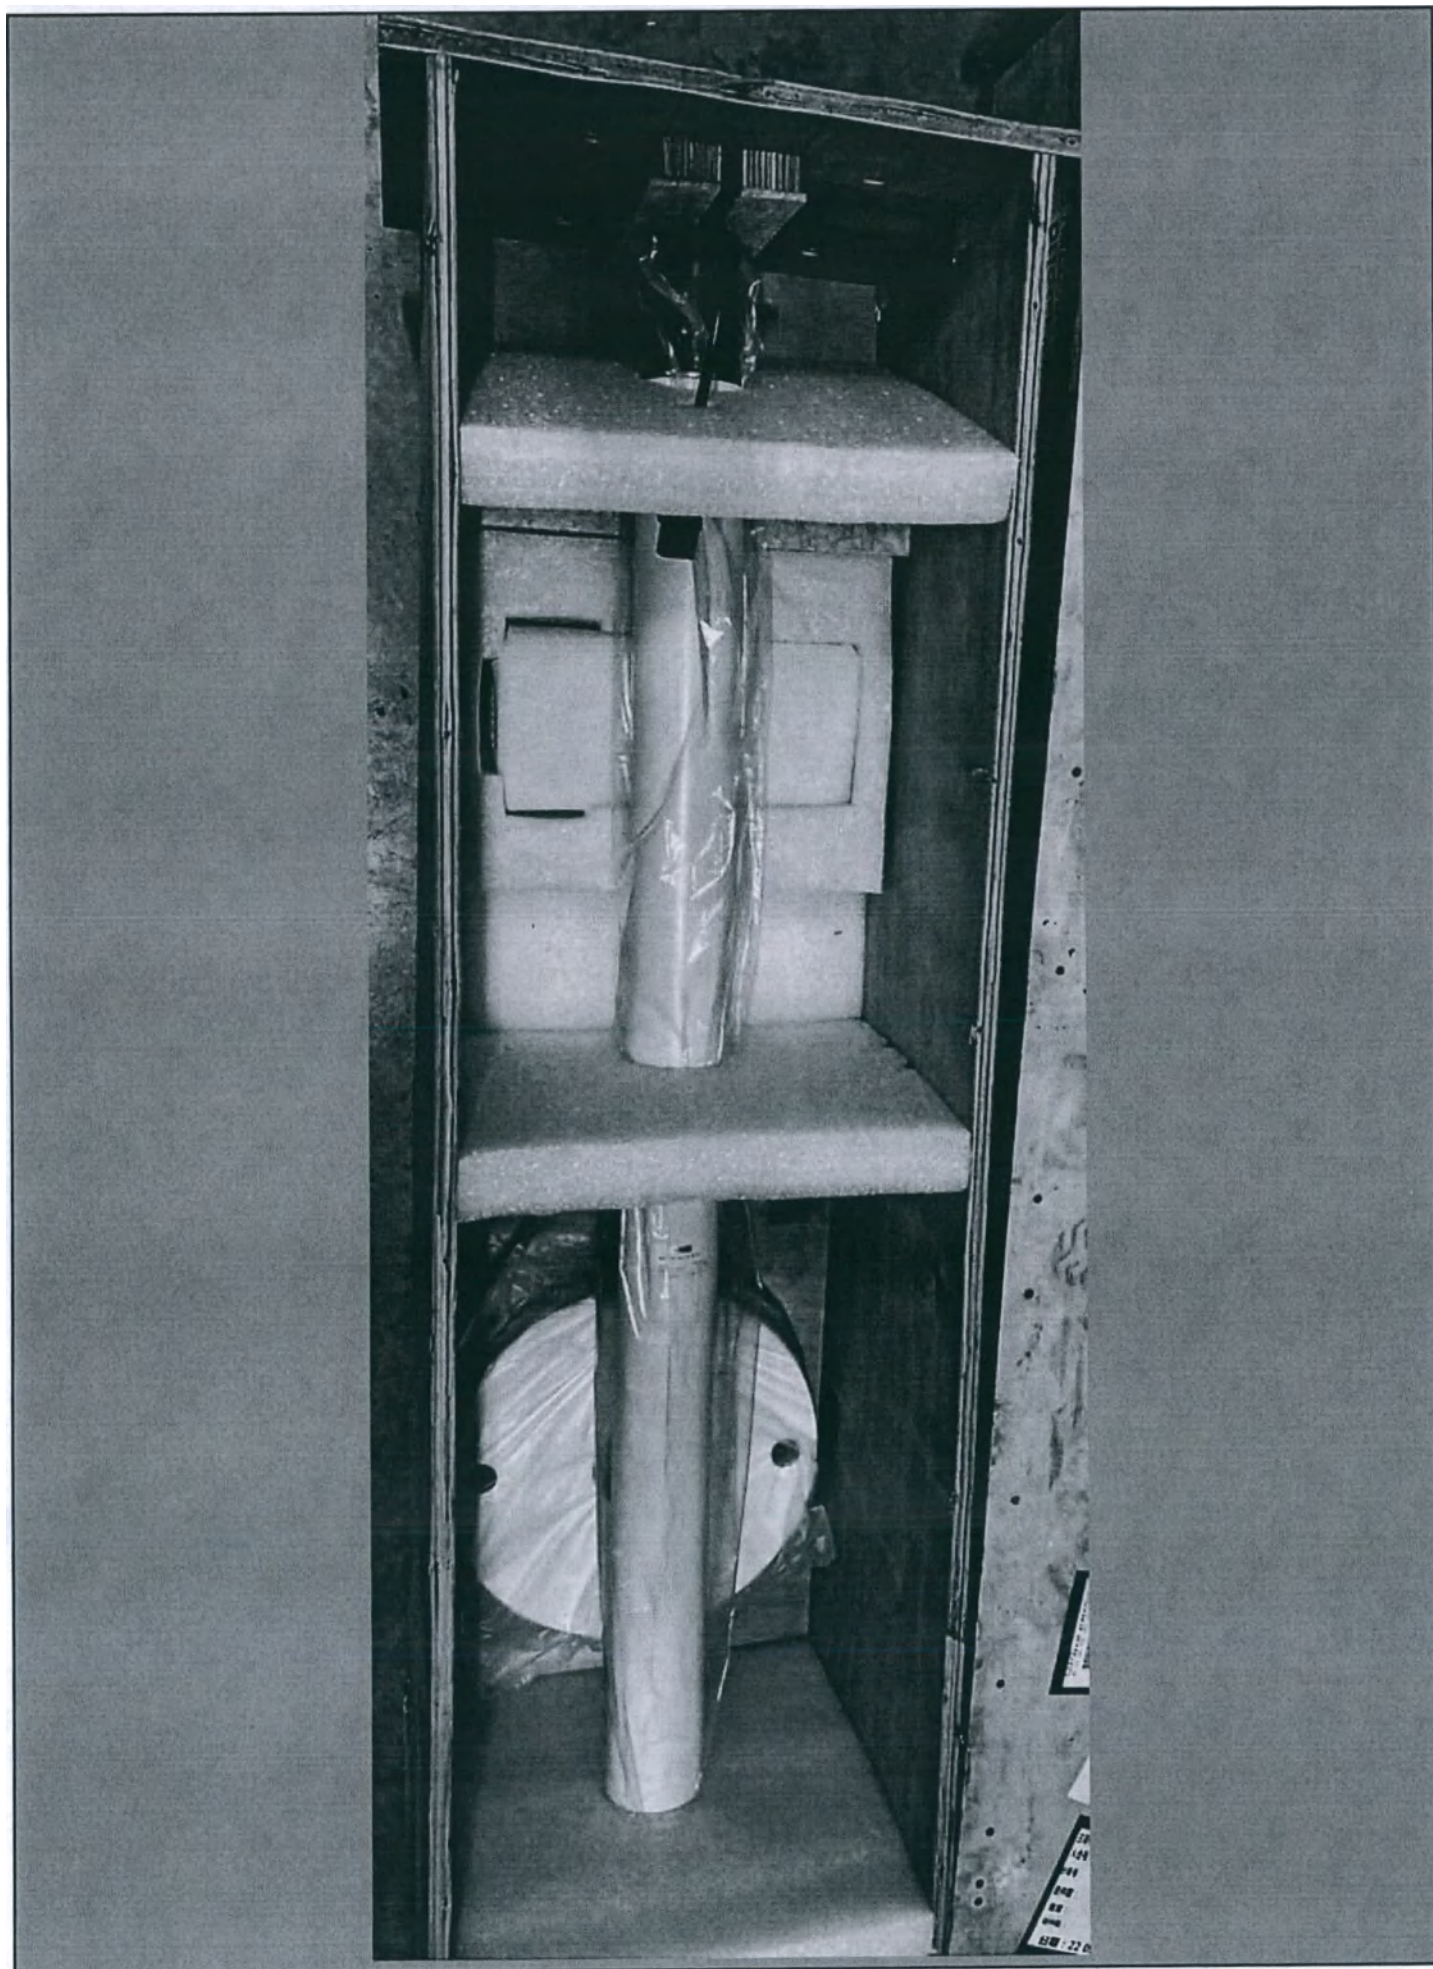


3) Крепление потолочное для АМ-5000 (при необходимости) – 1 шт. (Ceiling mount for AM-5000 (if necessary) – 1 pc.)




4) Крепление настенное в низком положении для АМ-5000 (при необходимости) – 1 шт. (Low-position Wall Mount for AM-5000 (if necessary) – 1 pc.)

5)

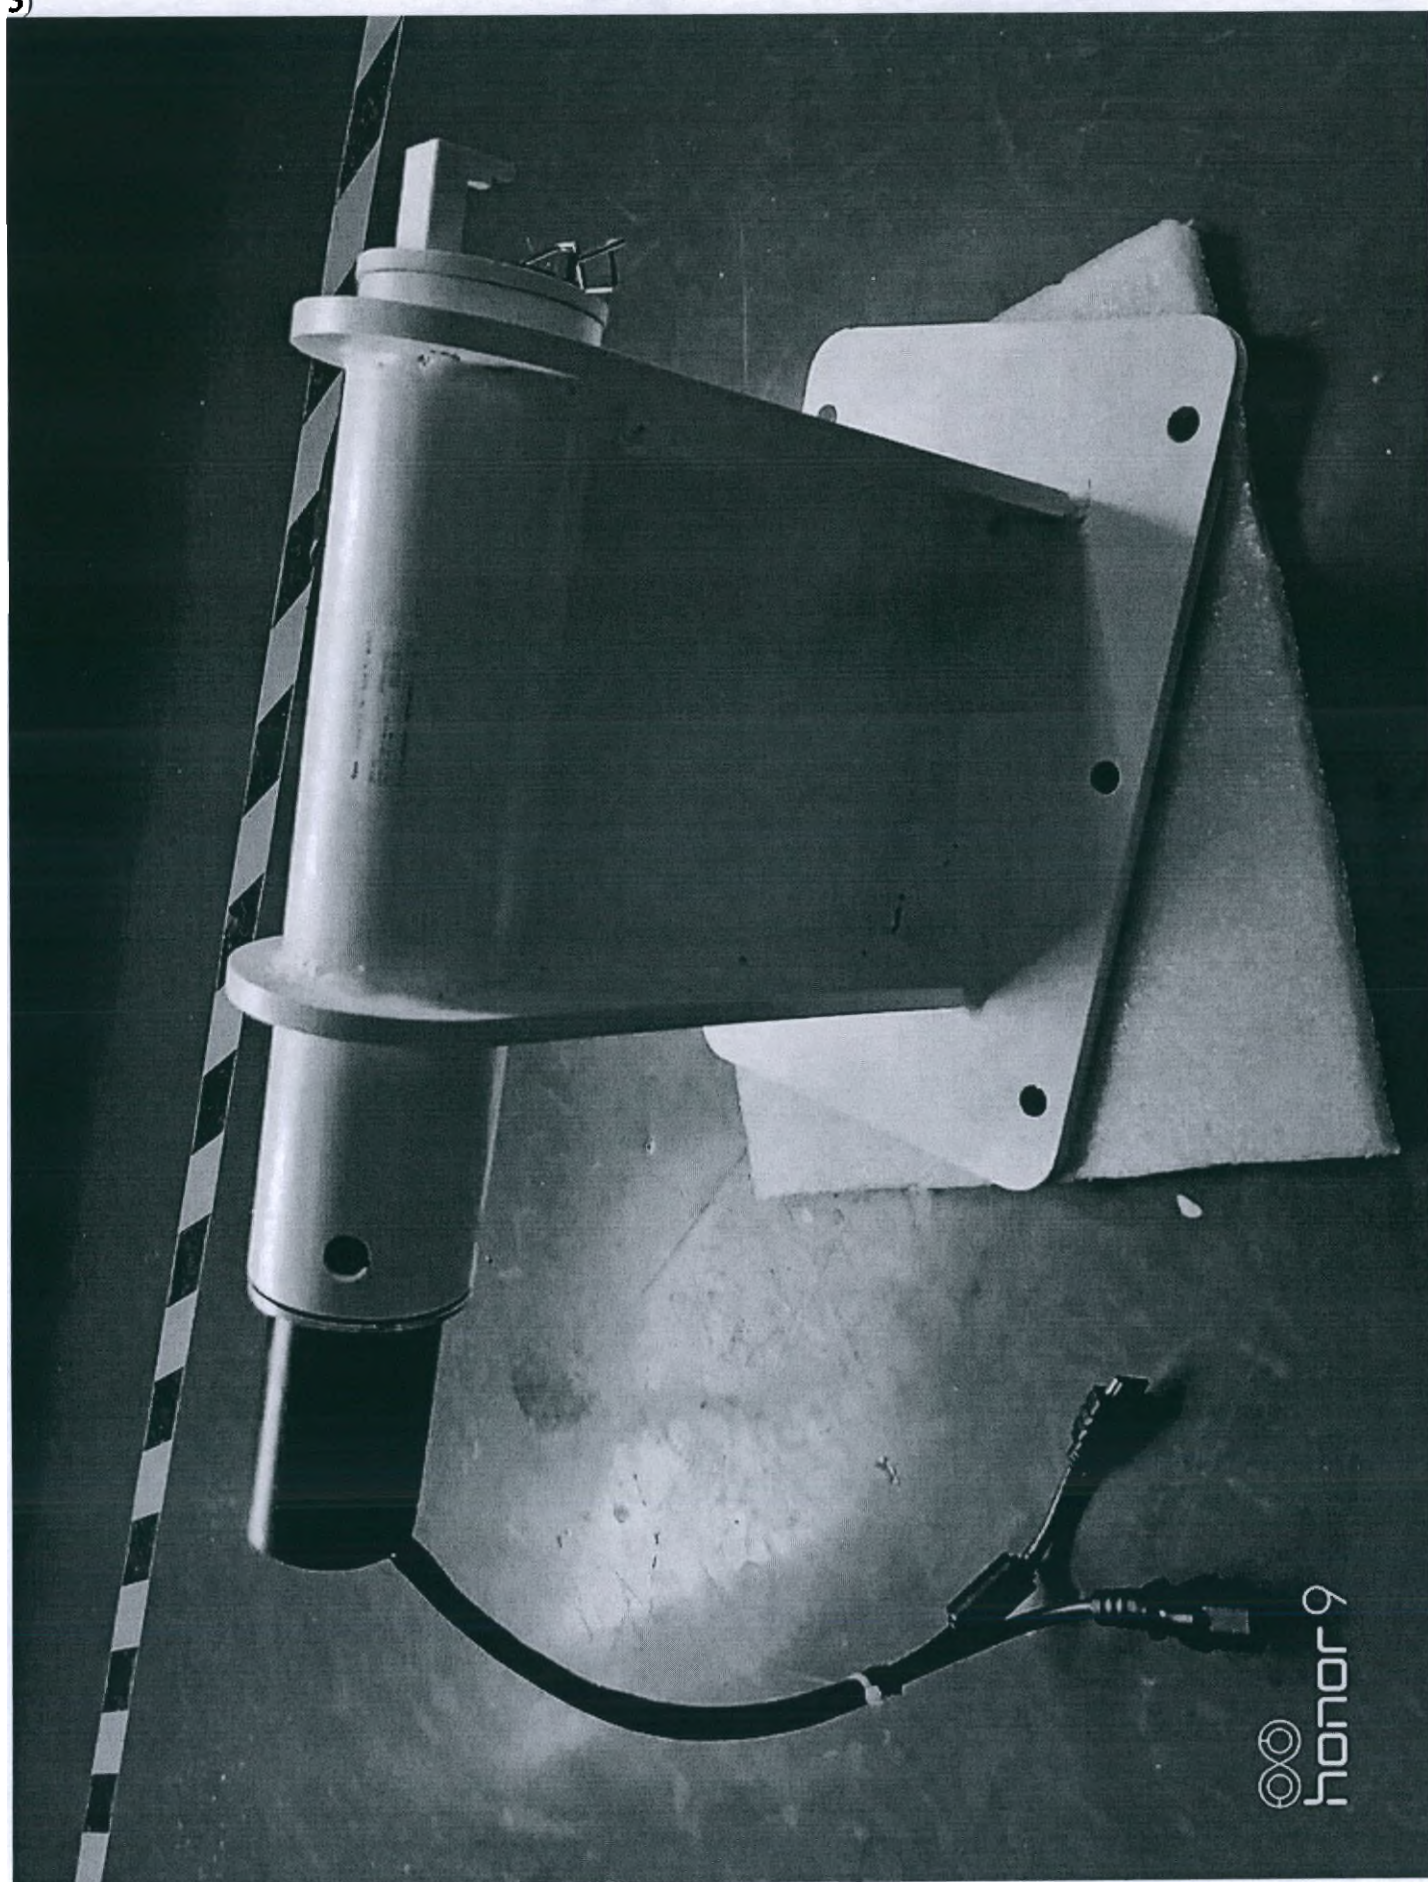

6) Крепление настенное в высоком положении для АМ-5000 (при необходимости) – 1 шт. (High-position Wall Mount for AM-5000 (if necessary) – 1 pc.)

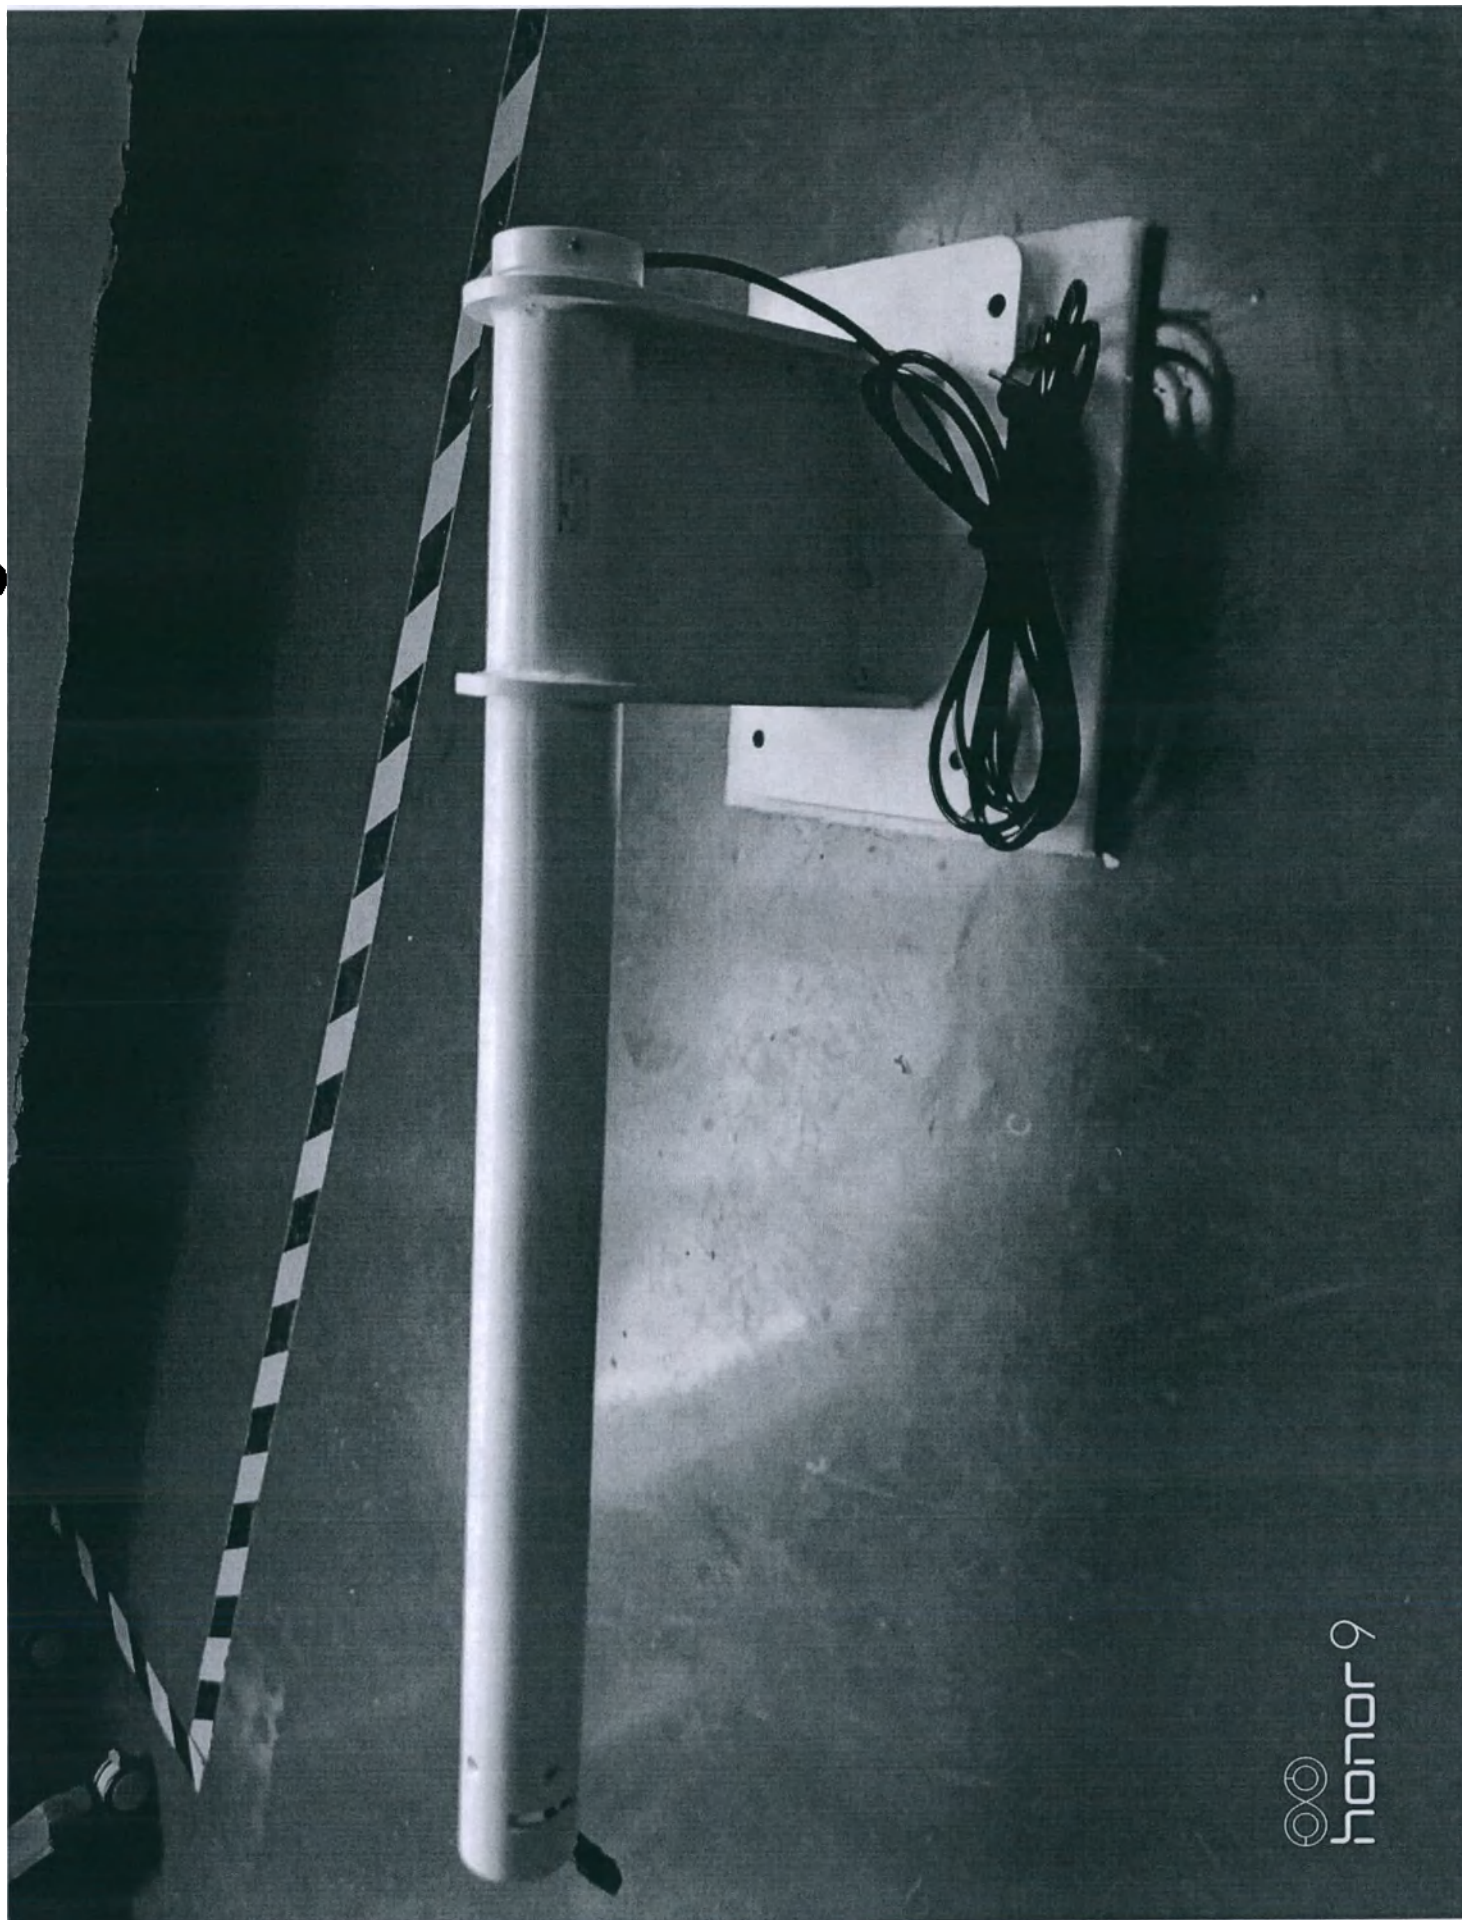


ГОСТ 9


7) Рычаг первый нормальный (при необходимости) – 1 шт. (The First Arm (Normal Installation) (if necessary) – 1 pc.)




7) Рычаг первый подъемный (при необходимости) – 1 шт. (The First Arm (Hoisting Installation) (if necessary) – 1 pc)

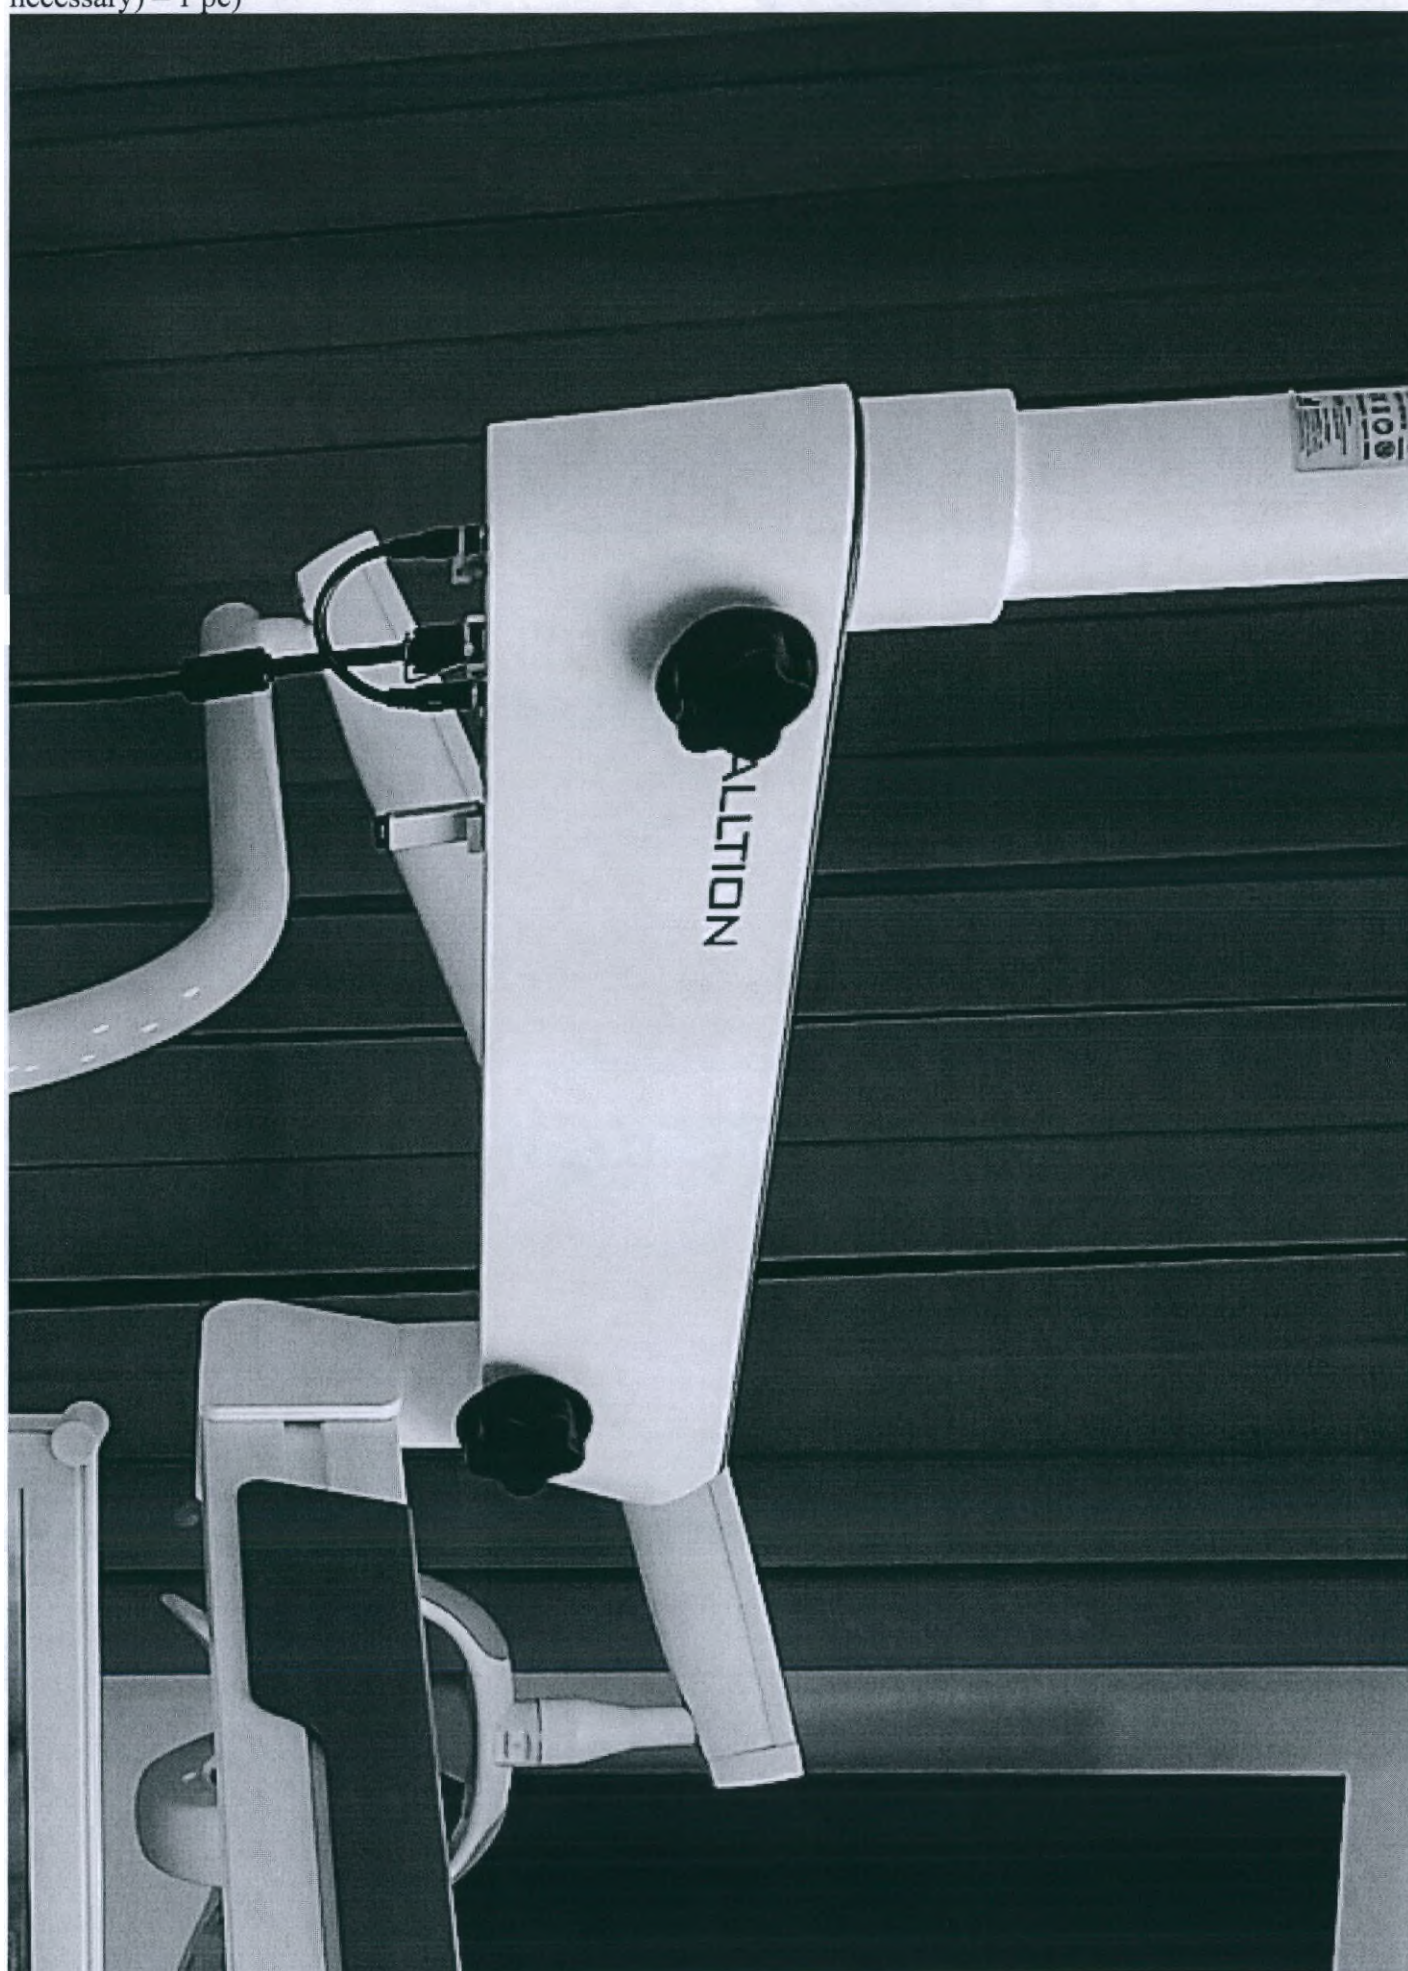


8) Рычаг балансирующий (при необходимости) – 1 шт. (Balance Arm (if necessary) – 1 pc)

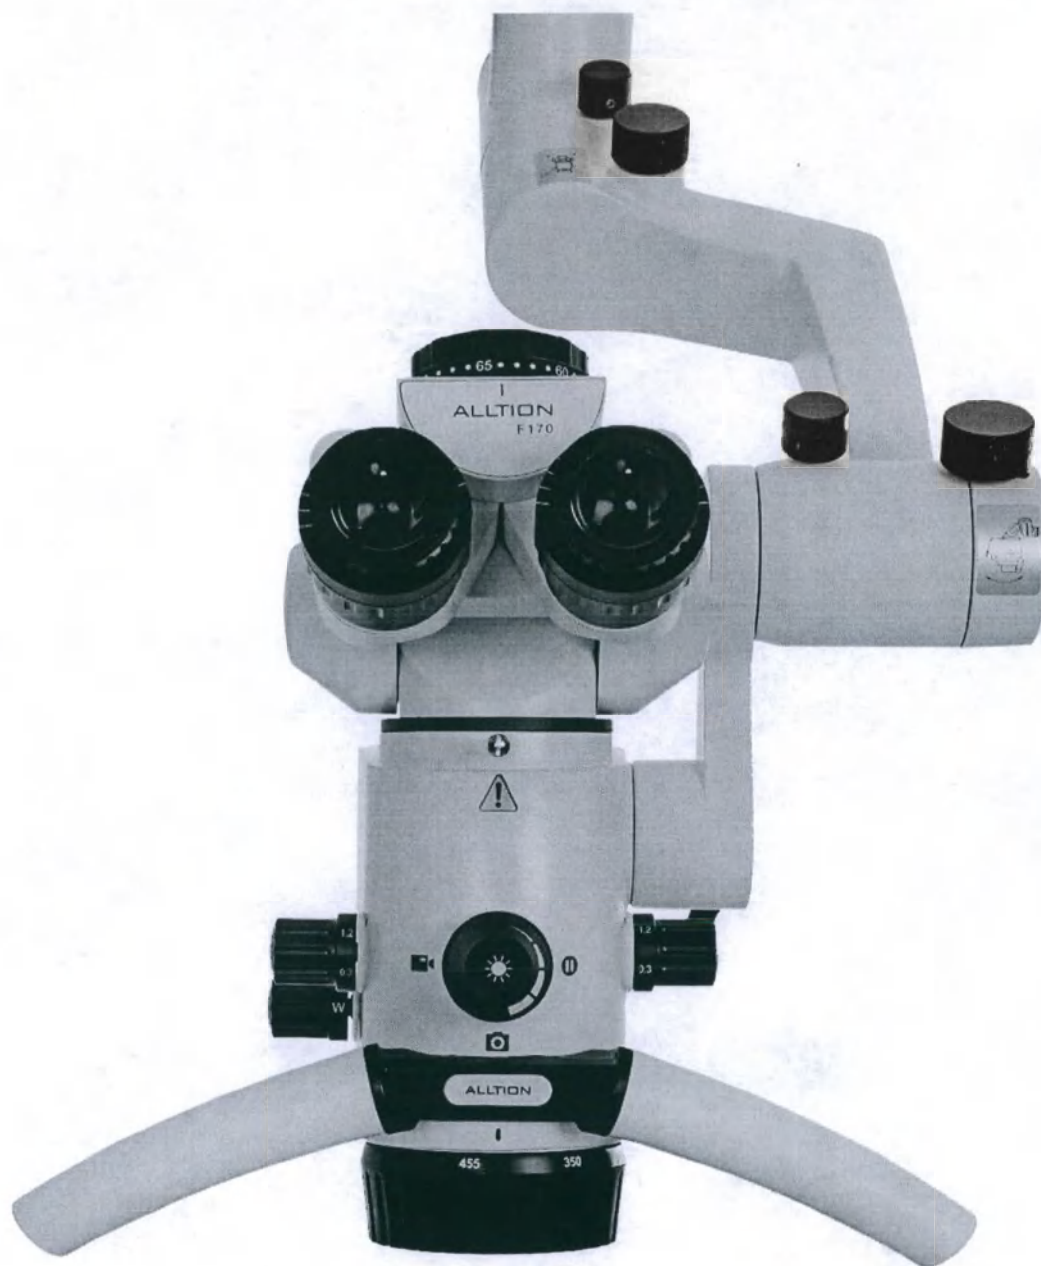

9) Рычаг второй (950mm) (при необходимости) – 1 шт. (The Second Arm (950mm) (if necessary) – 1 pc.)

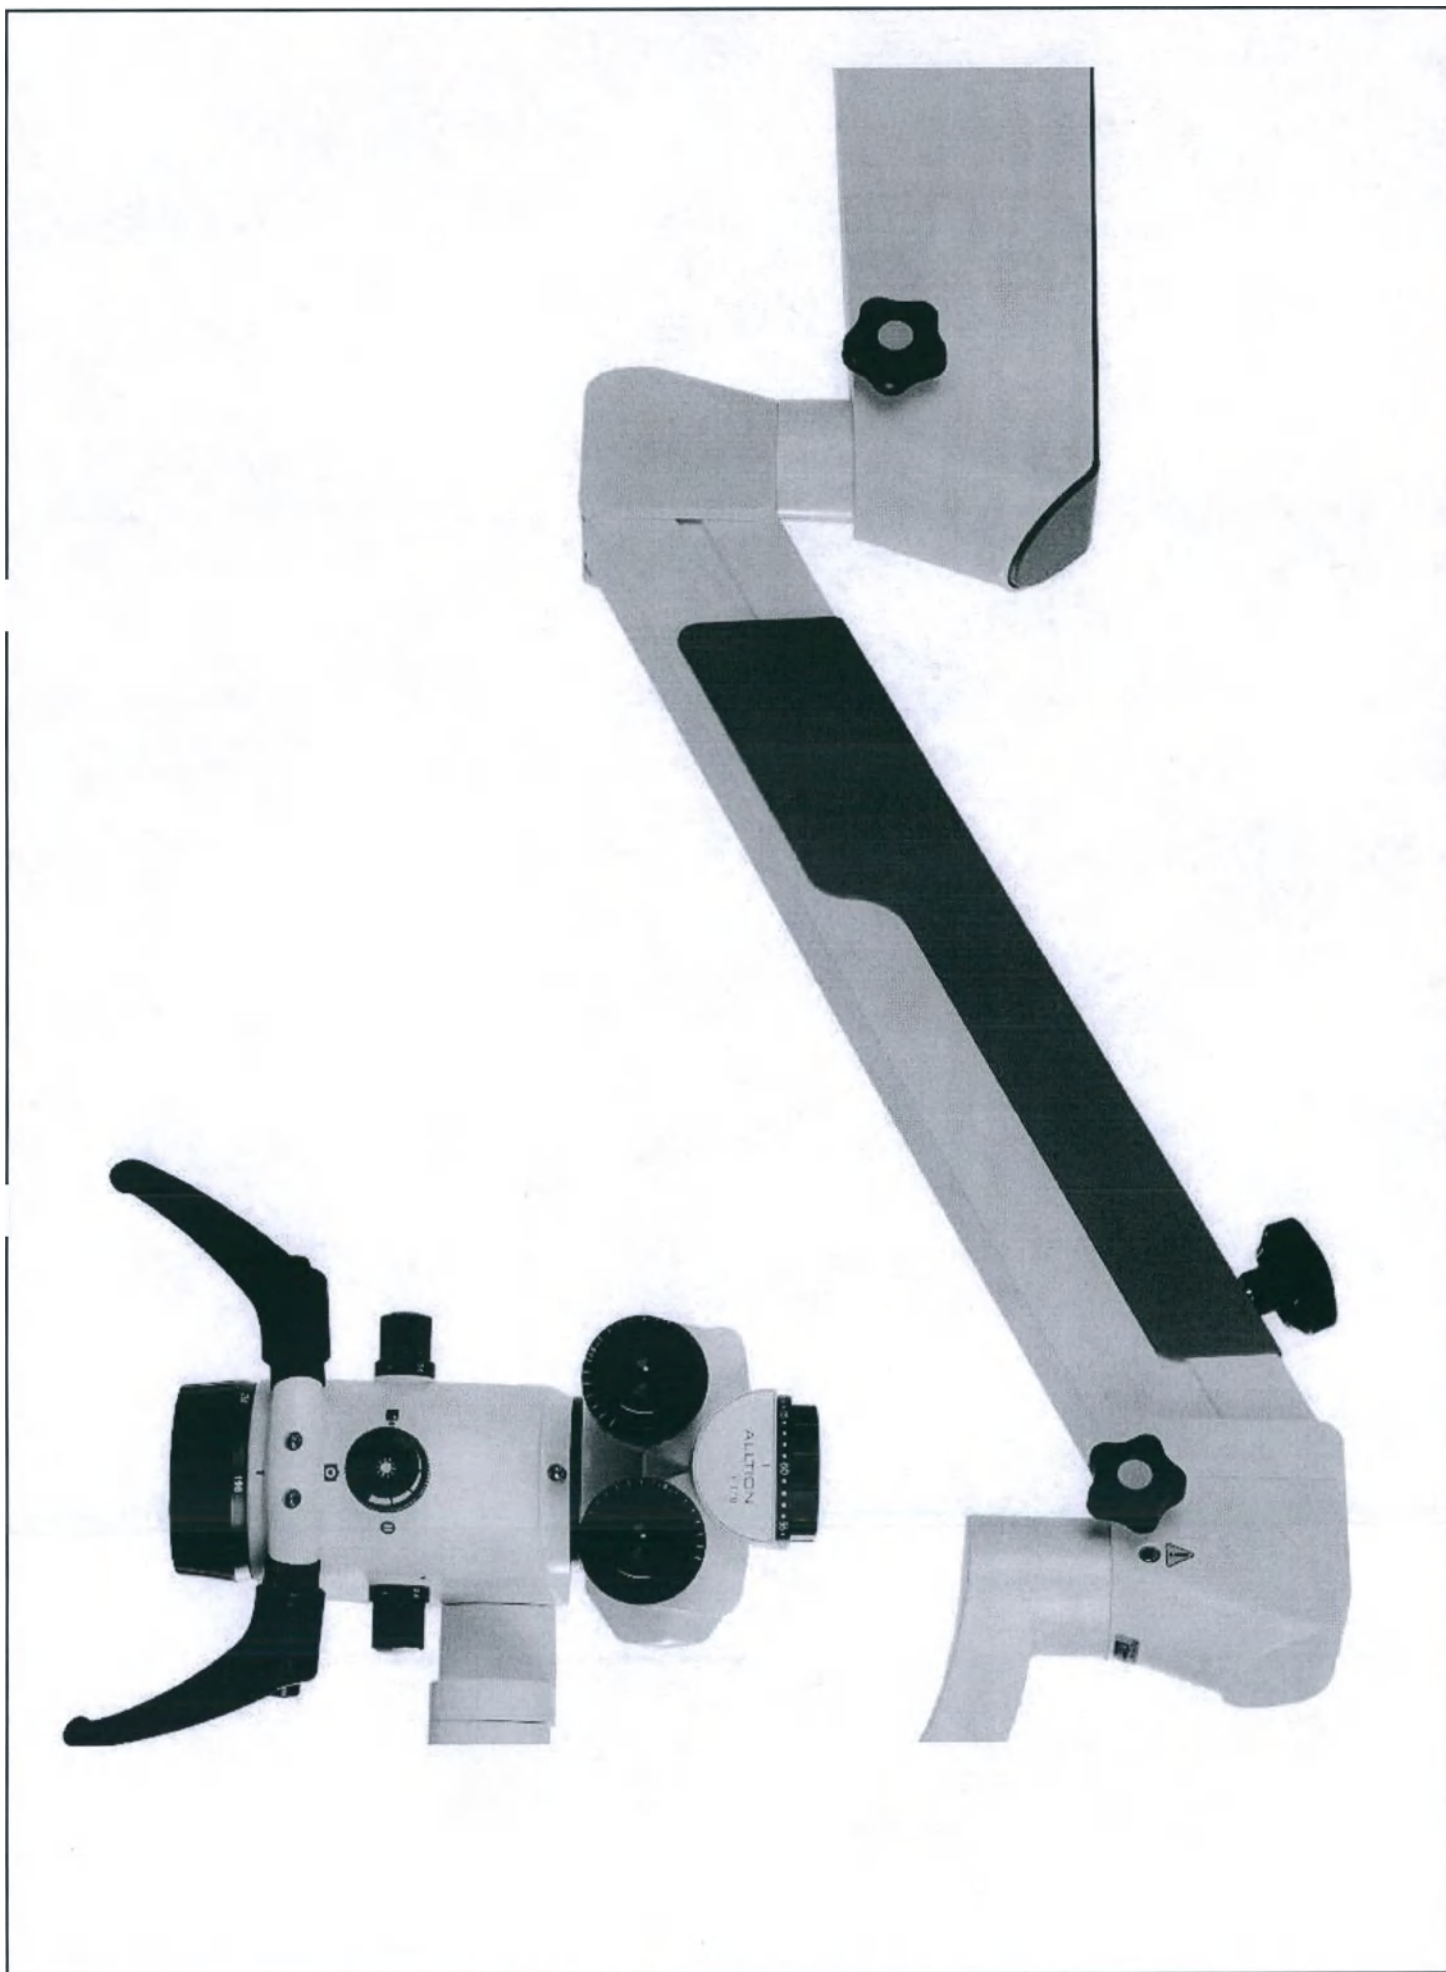


10) Рычаг второй нормальный (при необходимости) – 1 шт. (The Second Arm (Normal Installation) (if necessary) – 1 pc.)

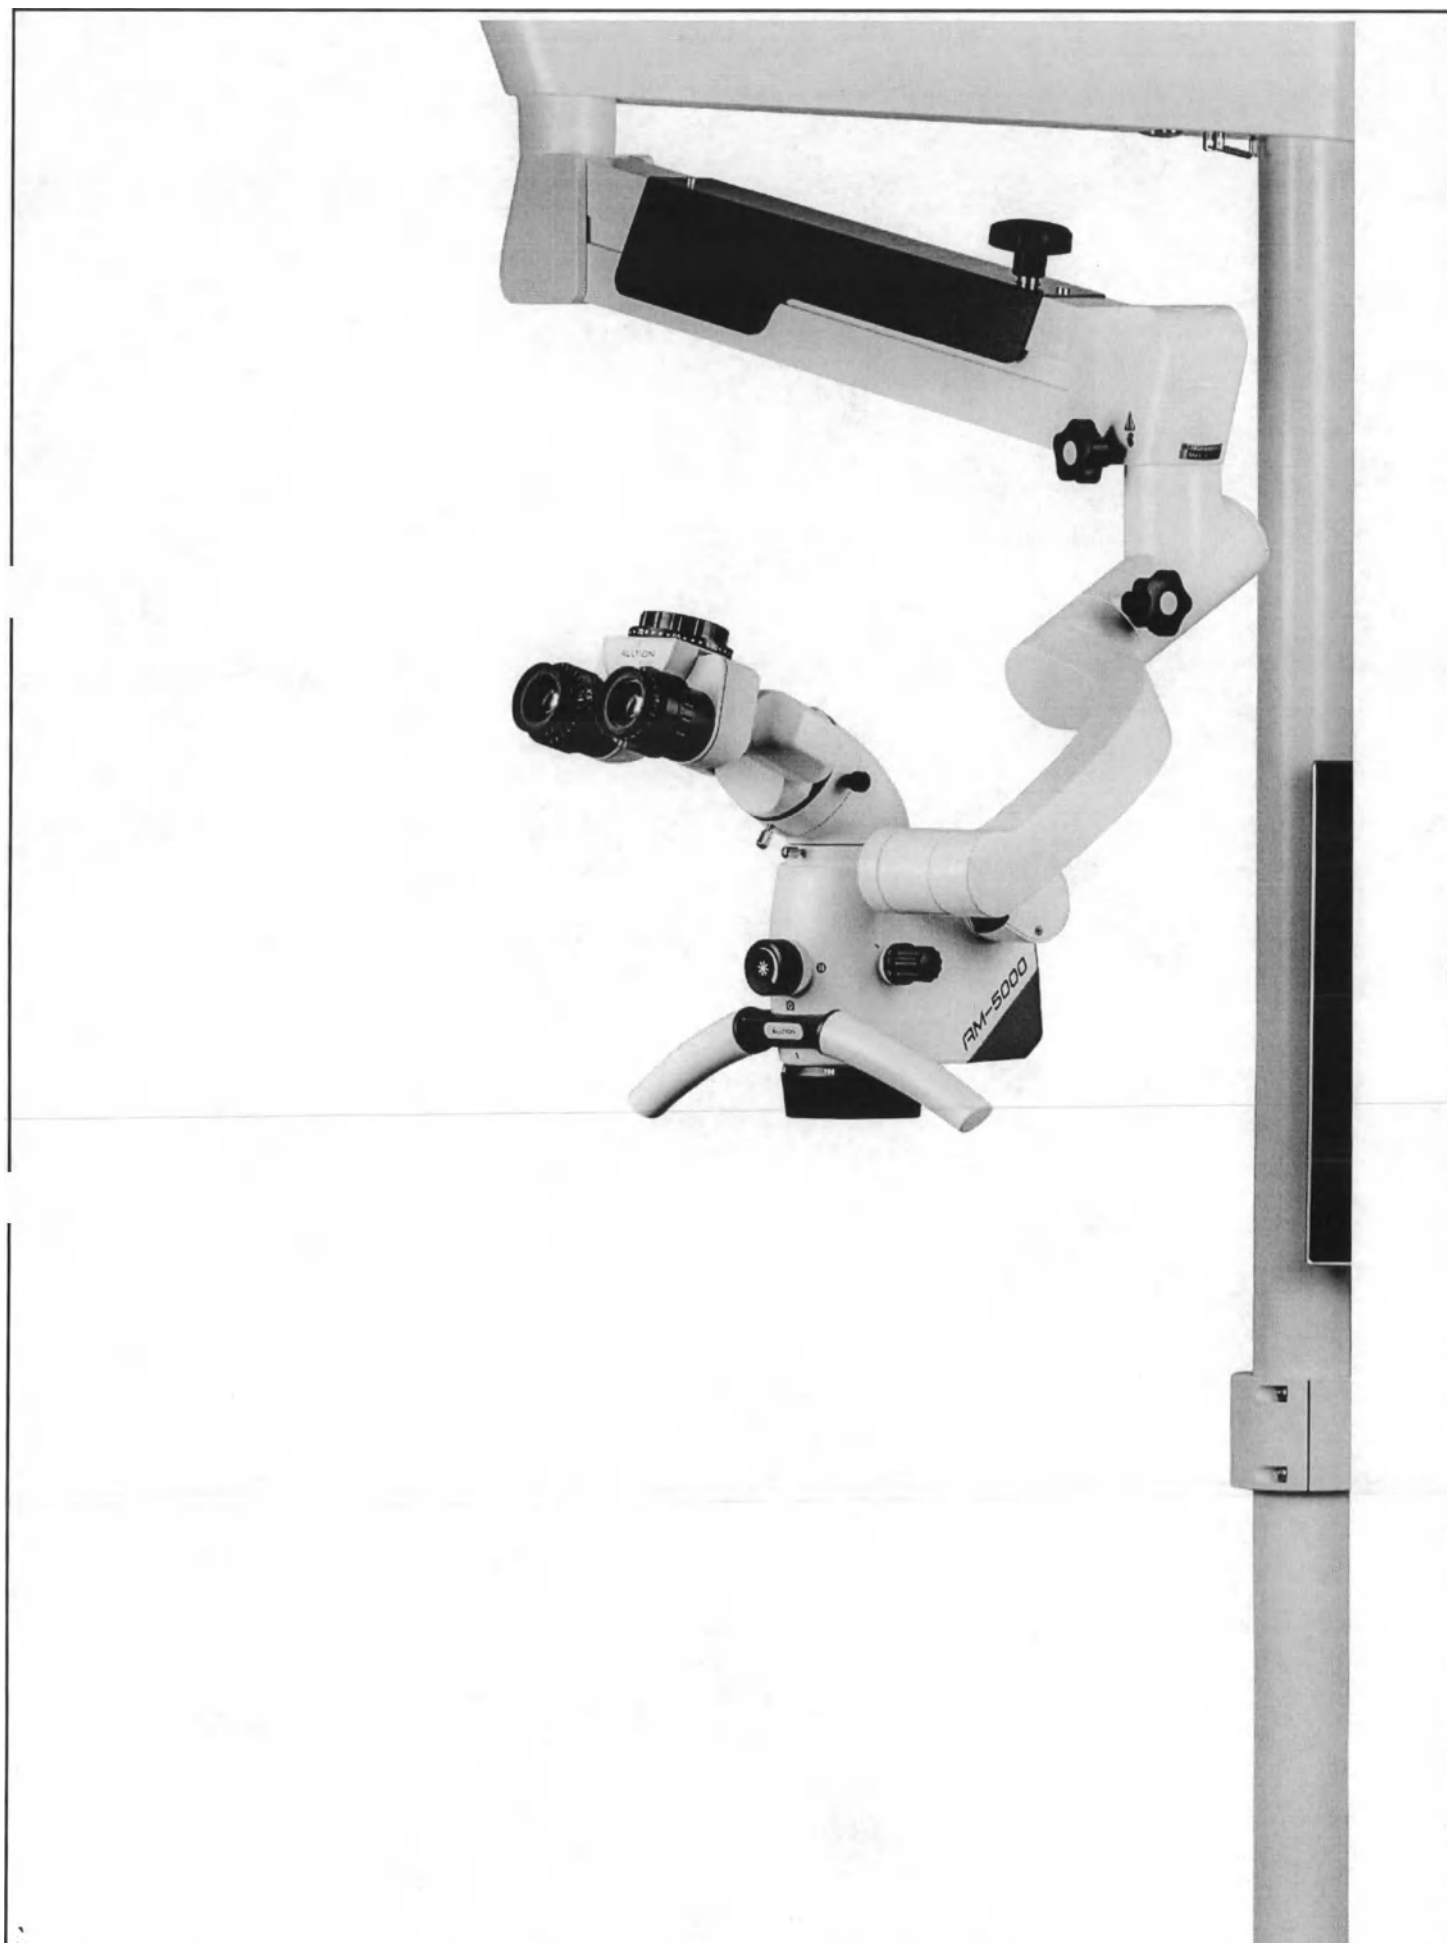

11) Рычаг соединительный под 120° для AM-5000 (при необходимости) – 1 шт. (120 Degrees Connecting Arm for AM-5000 (if necessary) – 1 pc.)




12) Рукоятки для перемещения оптического блока микроскопа АМ-5000 (при необходимости) – 1 шт.
(Handles for moving the optical unit of the AM-5000 microscope (if necessary) – 1 pc.)

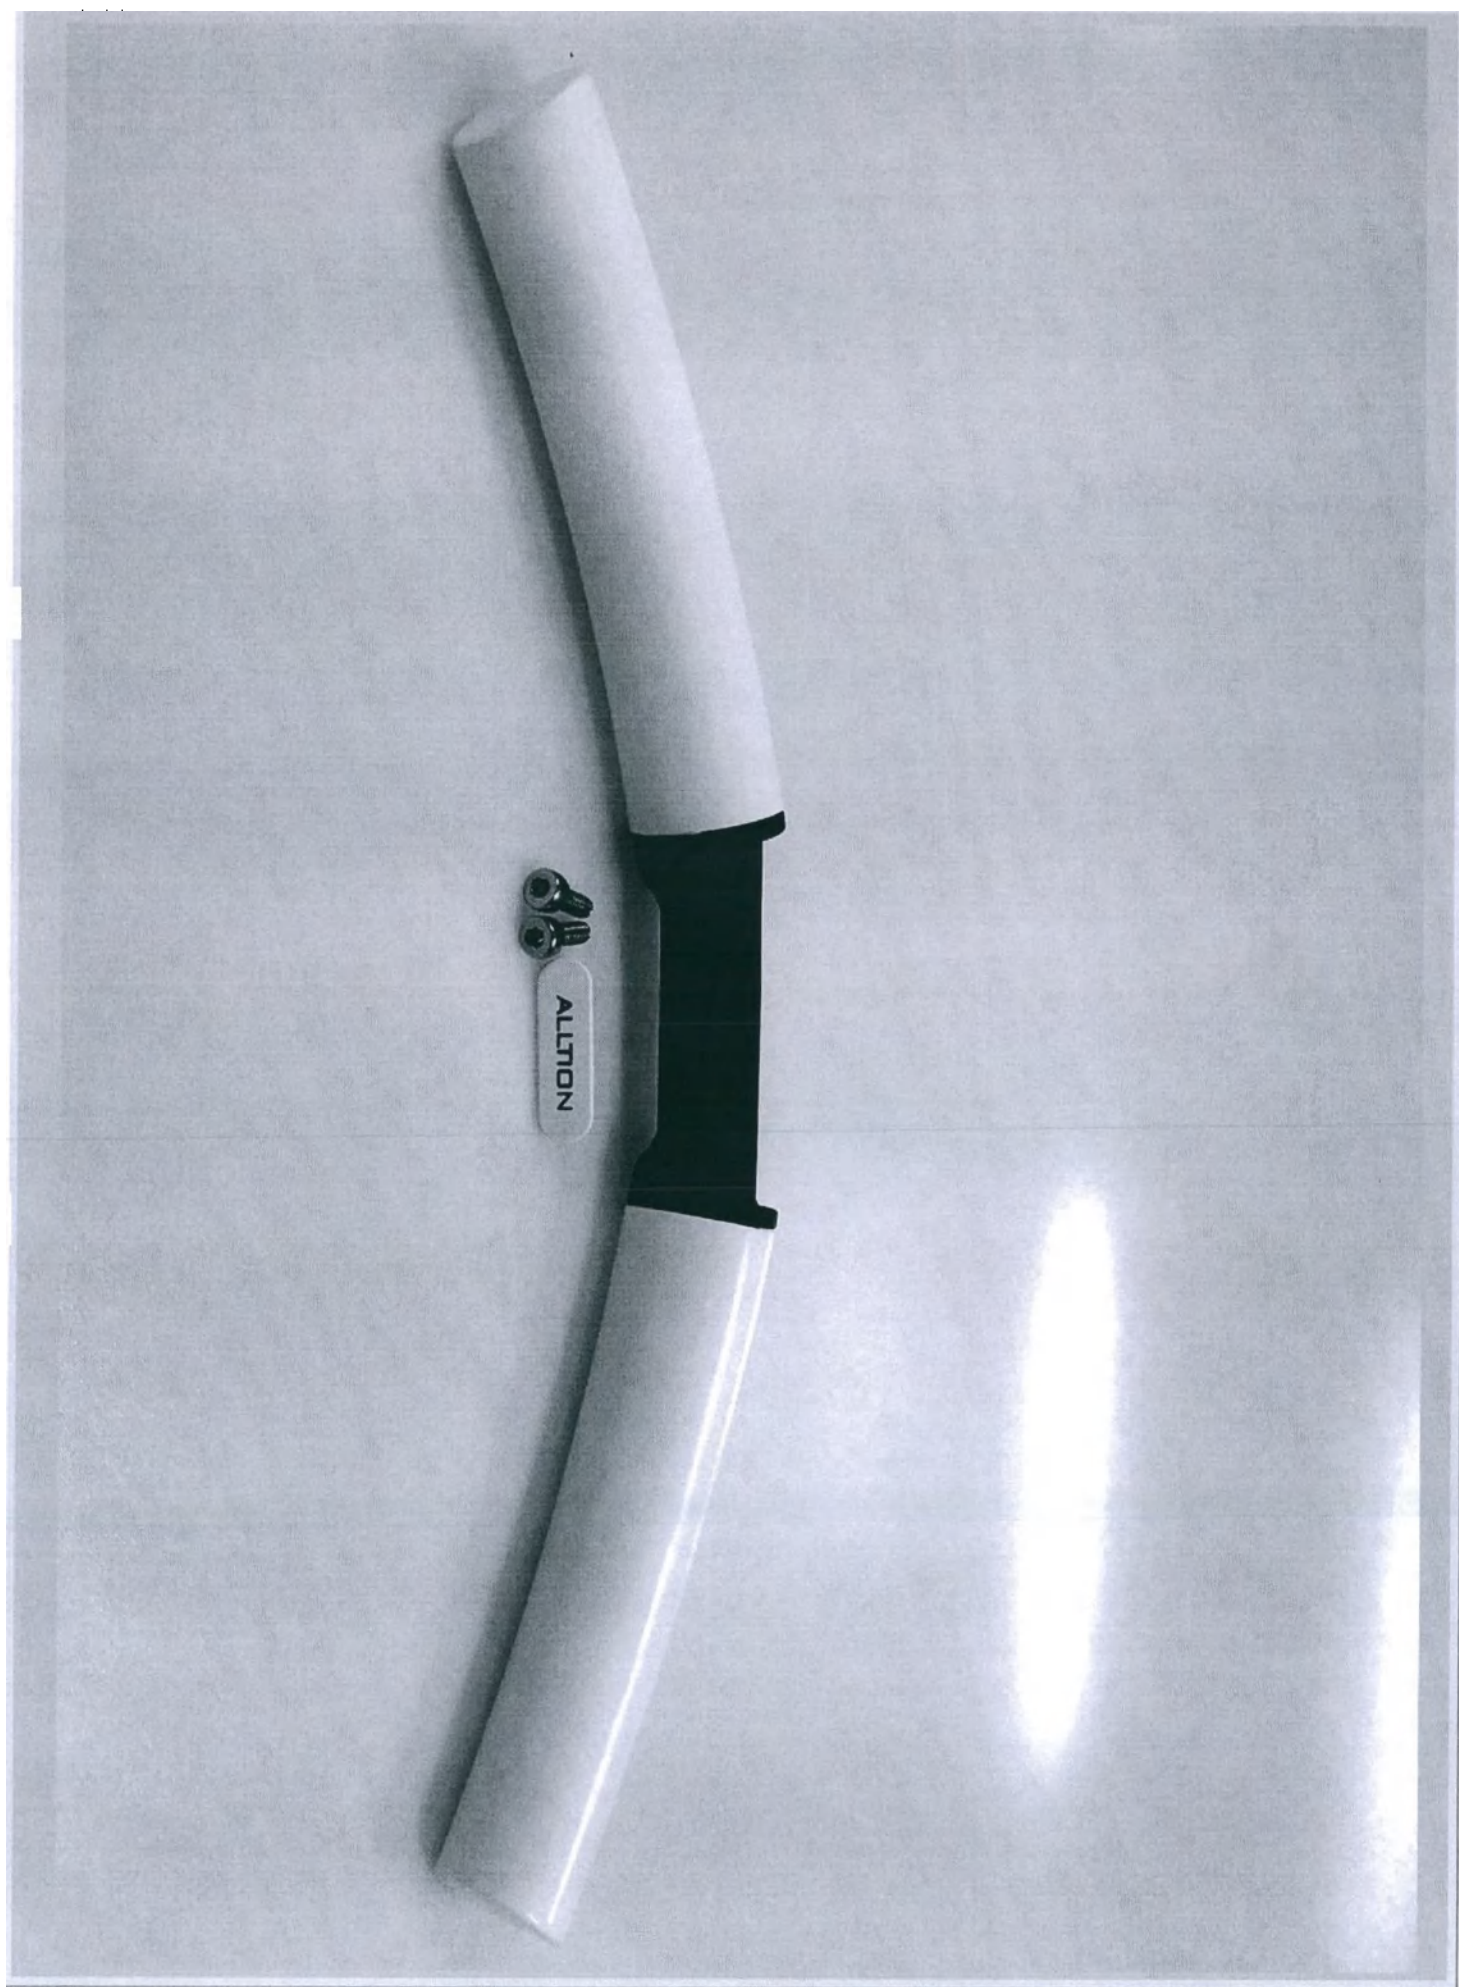

13) Тубус бинокулярный АМ-5000 с изменяемым углом наклона 0-180° (при необходимости) – 1 шт.
(0-180 Degrees Inclined Binocular for AM-5000 (if necessary) – 1 pc.)



14) Светоделитель (при необходимости) – 1 шт. (Beam splitter (if necessary) – 1 pc.)

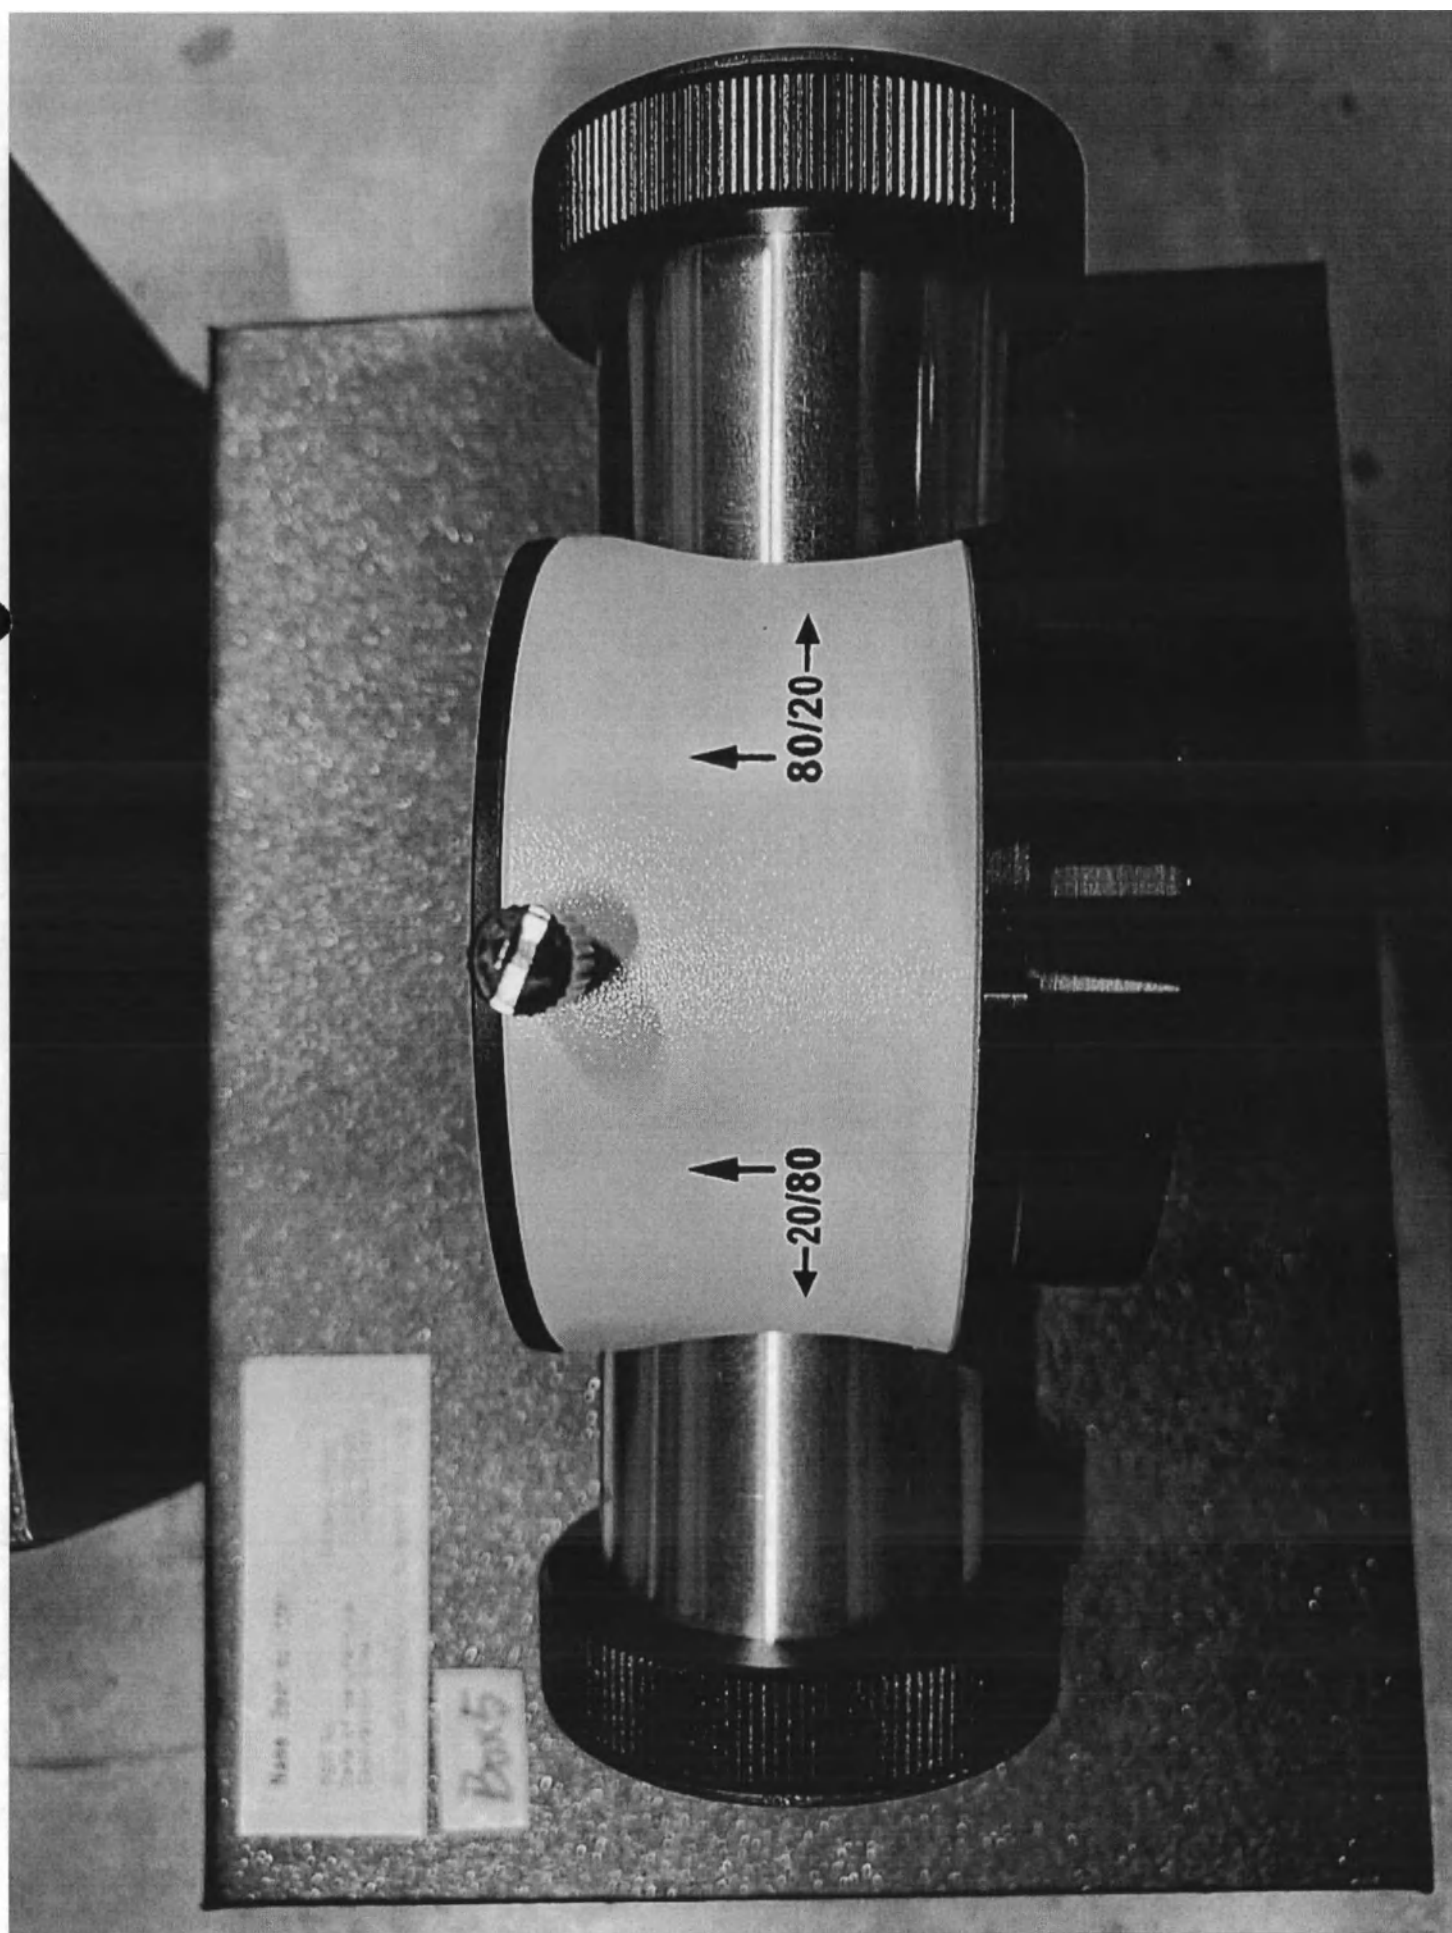


Устройство для углового поворота (при необходимости) – 1 шт. (Angle Rotation Device (if necessary) – 1 pc.)



Удлинитель бинокулярный под 30° с светоделителем и устройством для углового поворота (при необходимости) – 1 шт. (Binocular Extender (30°) with Beam Splitter with Angle Rotation Device (if necessary) – 1 pc.)




Удлинитель биноклярный под 30° с устройством для углового поворота (при необходимости) – 1 шт.
(Binocular Extender (30°) with Angle Rotation Device (if necessary) – 1 pc.)

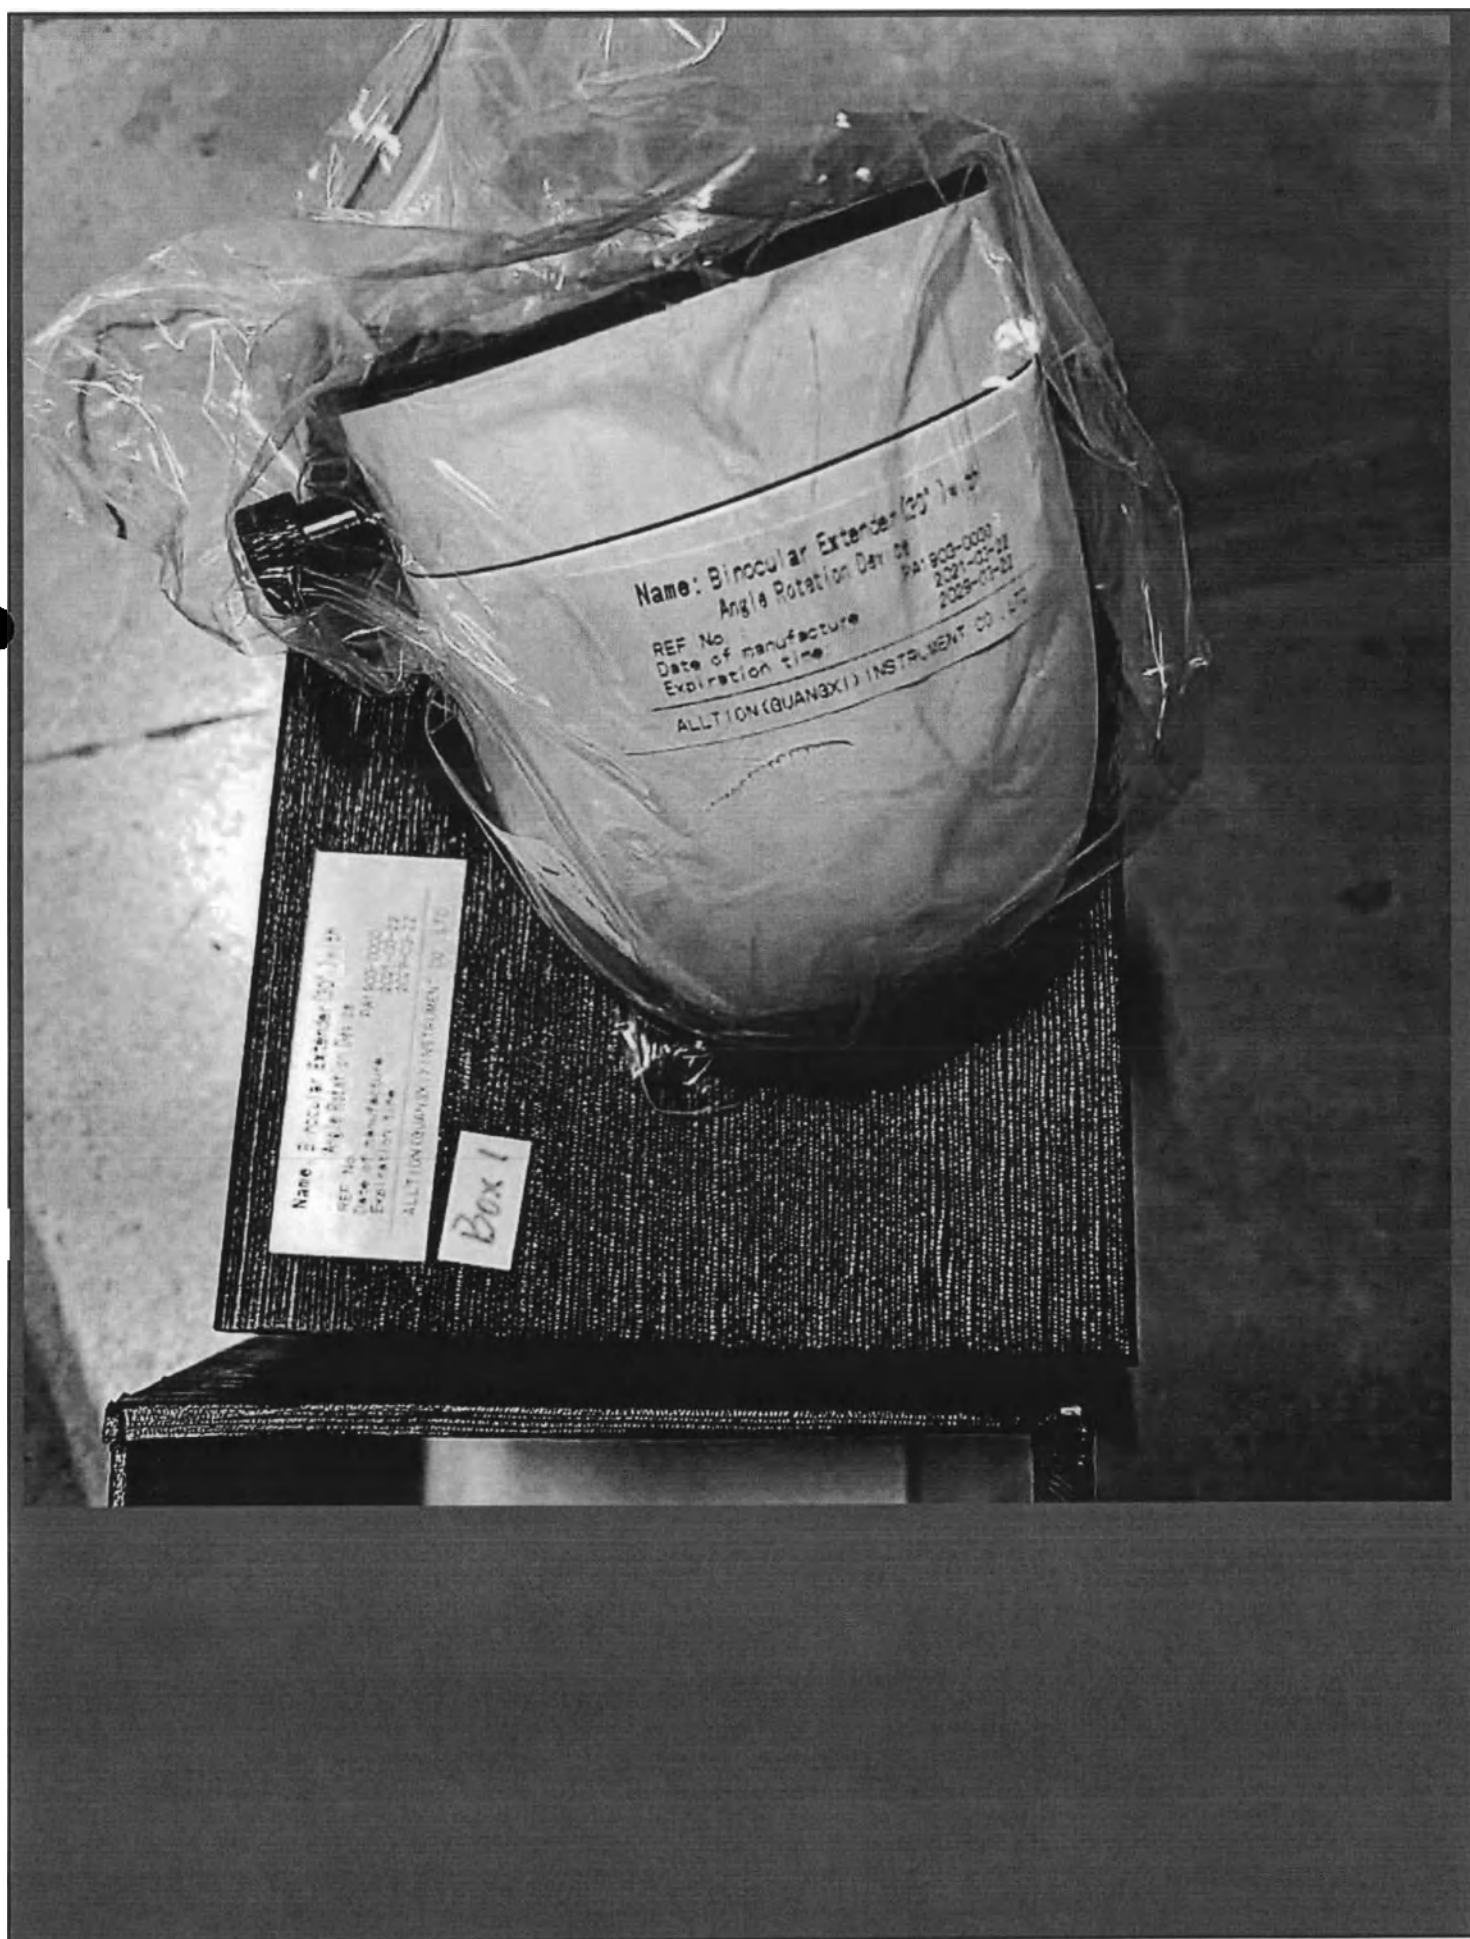

Удлинитель биноклярный под 90° с устройством для углового поворота (при необходимости) – 1 шт.
(Binocular Extender (90°) with Angle Rotation Device (if necessary) – 1 pc.)



Удлинитель бинокулярный под 90° со светоделителем с устройством для углового поворота (при необходимости) – 1 шт. (Binocular Extender (90°) with Beam Splitter with Angle Rotation Device (if necessary) – 1 pc.)

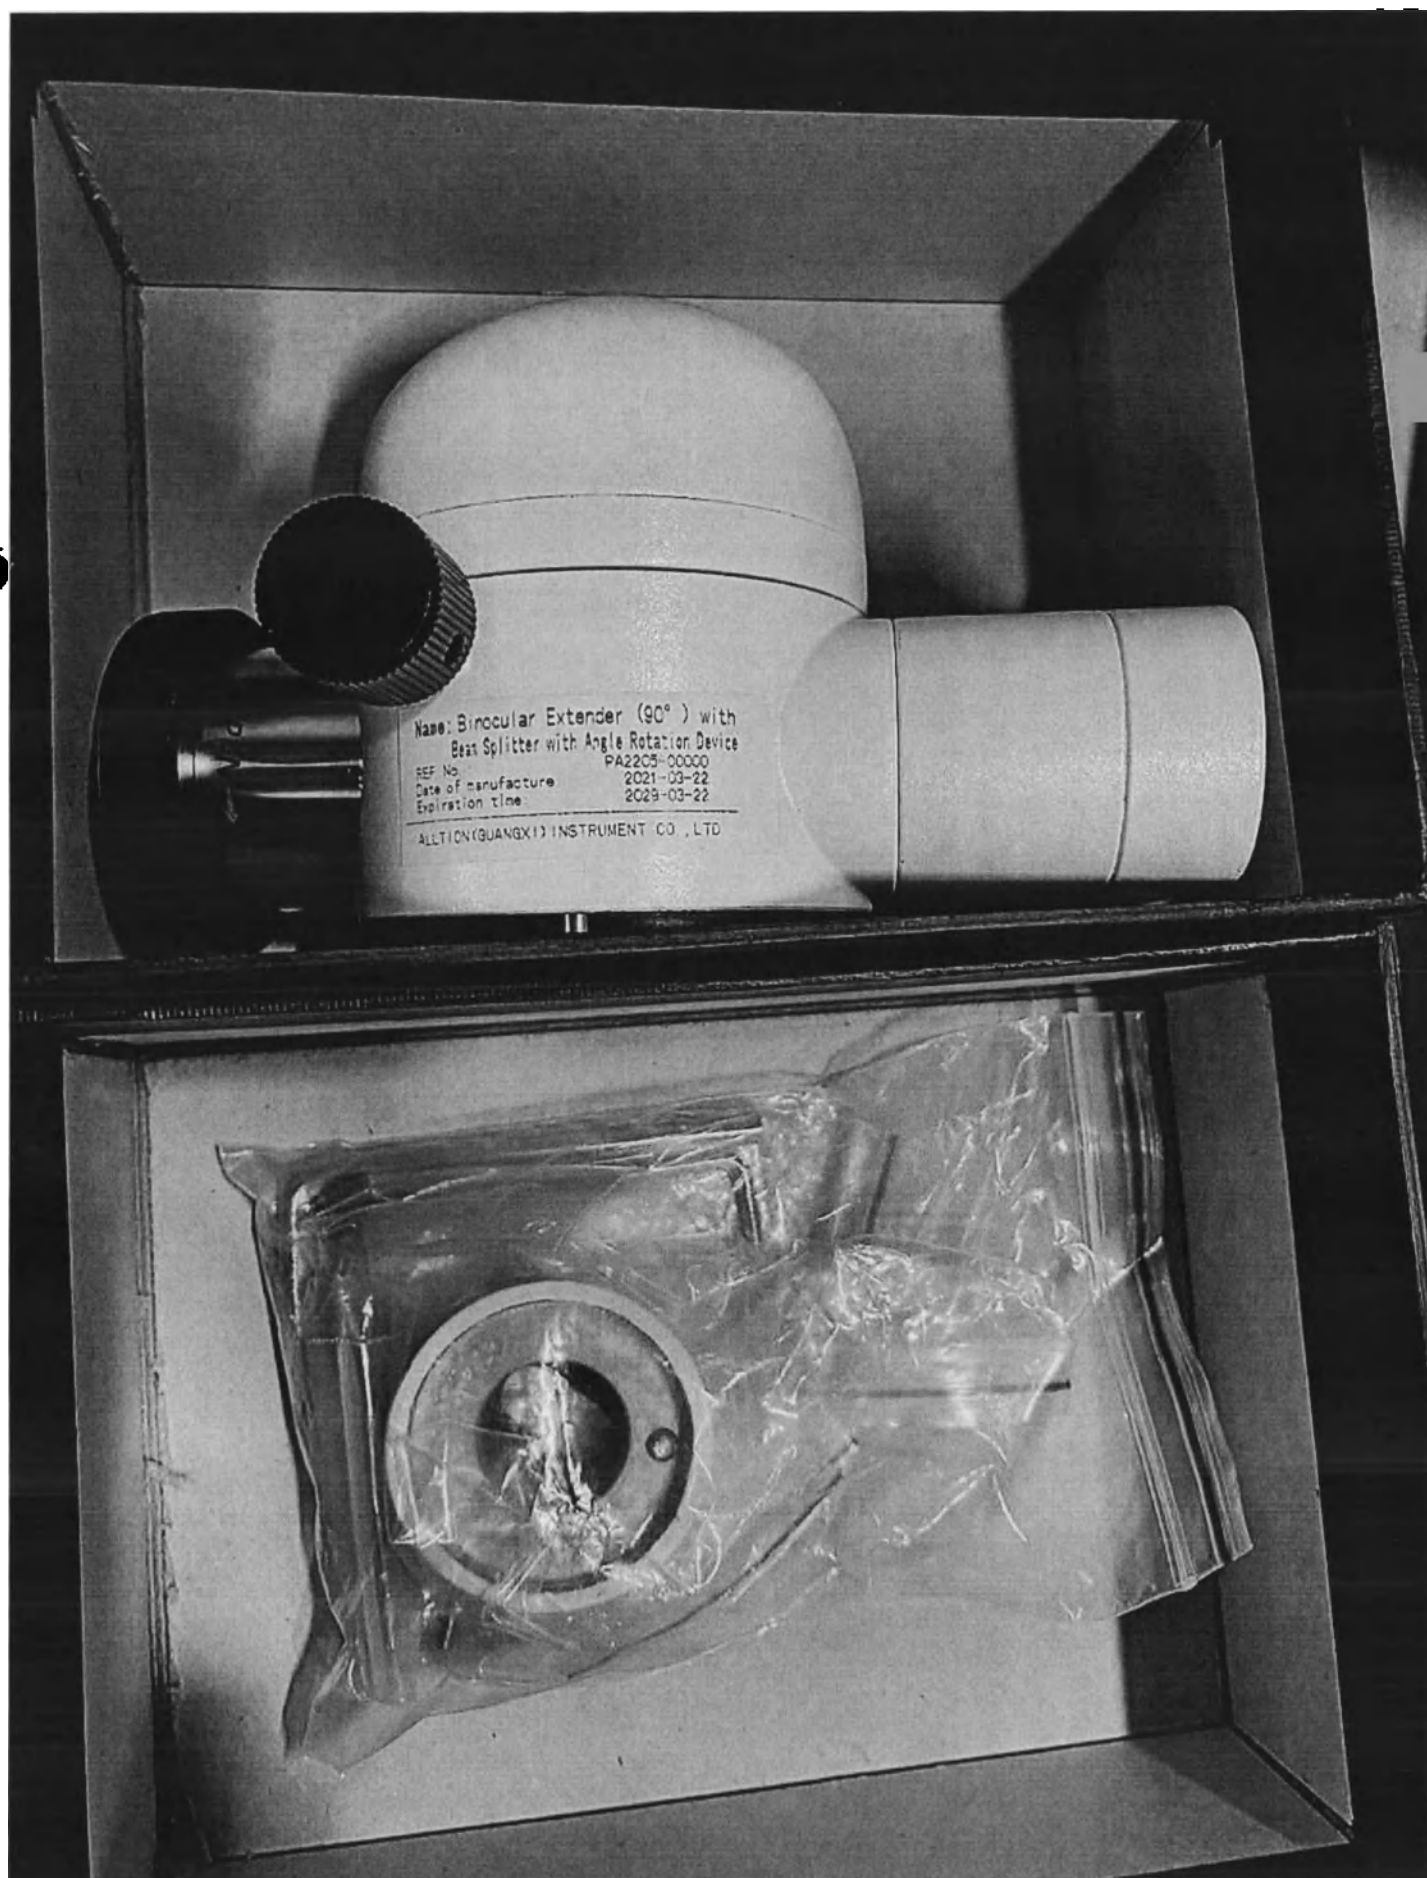

Удлинитель биноклярный под 45° (при необходимости) – 1 шт. (Binocular Extender (45°) (if necessary) – 1 pc.)



15) Муфта для двухмерного вращения бинокулярного тубуса ассистента (при необходимости) – 1 шт.
(2-D Rotation Binocular Assistant Scope Connector (if necessary) – 1 pc.)



16) Муфта для трехмерного вращения бинокулярного тубуса ассистента (при необходимости) – 1 шт.
(3-D Rotation Binocular Assistant Scope Connector (if necessary) – 1 pc.)

17)



18) Муфта противоположного тубуса (при необходимости) – шт. (Opposite Scope Connector (if necessary) – pc.)




19) Окуляр 10X (при необходимости) – 2 шт. (10X Eyepiece (if necessary) – 2 pcs.)



20) Окуляр 12.5X (при необходимости) – 2 шт. (12.5X Eyepiece (if necessary) – 2 pcs.)




21) Модуль камеры (при необходимости) – 1 шт. (Camera Module (if necessary) – 1 pc.)

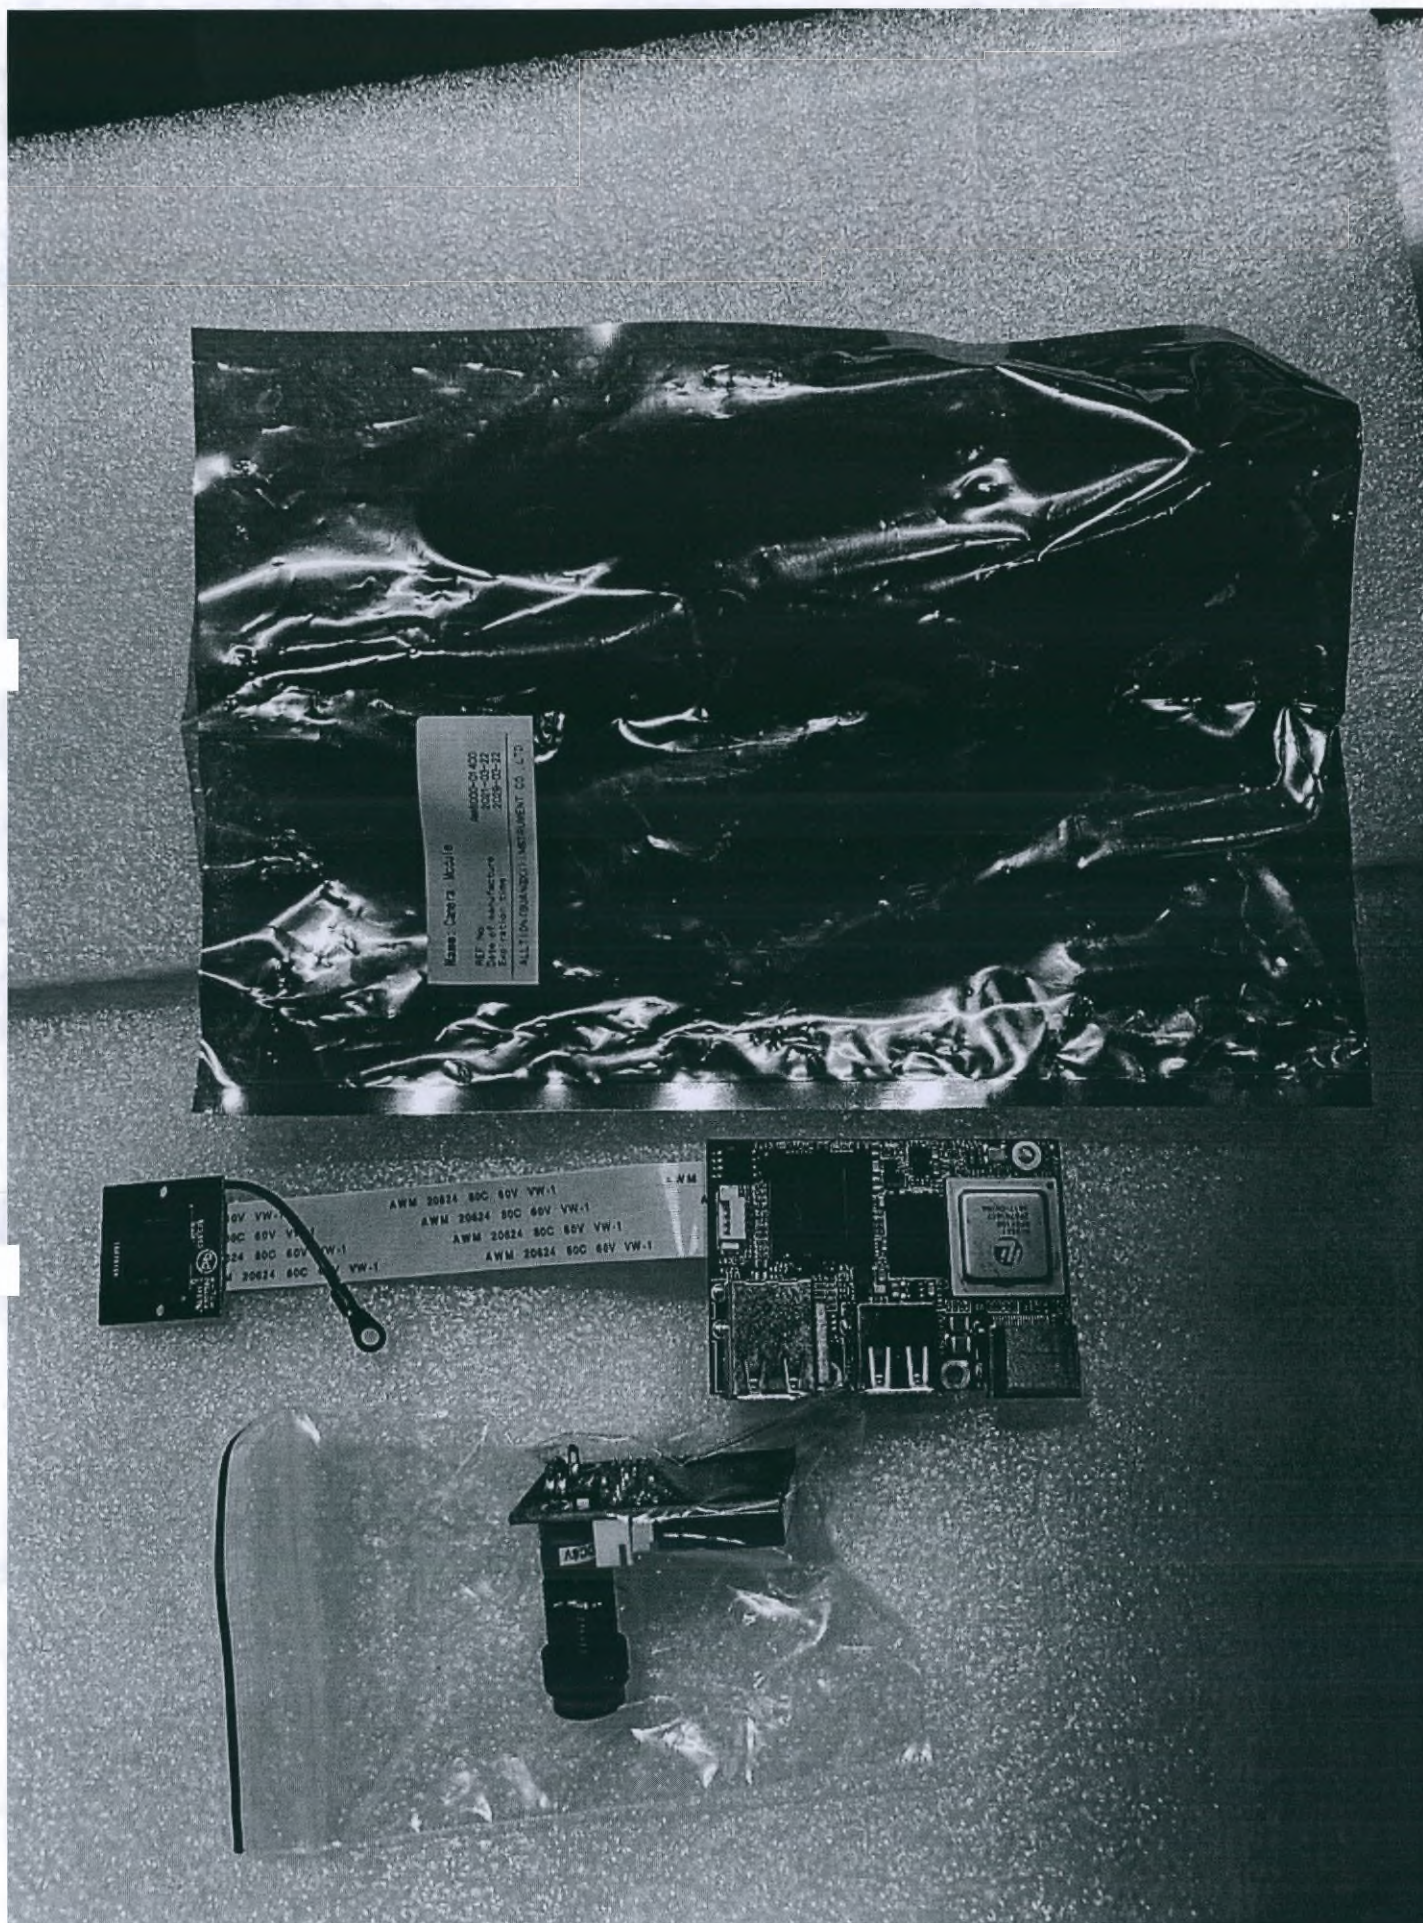

22) Поршень пневматический для АМ-5000 (при необходимости) – 1 шт. (Gas Spring for AM-5000 (if necessary) – 1 pc.)



23) Модуль светодиодный (при необходимости) – 1 шт. (LED Module (if necessary) – 1 pc.)

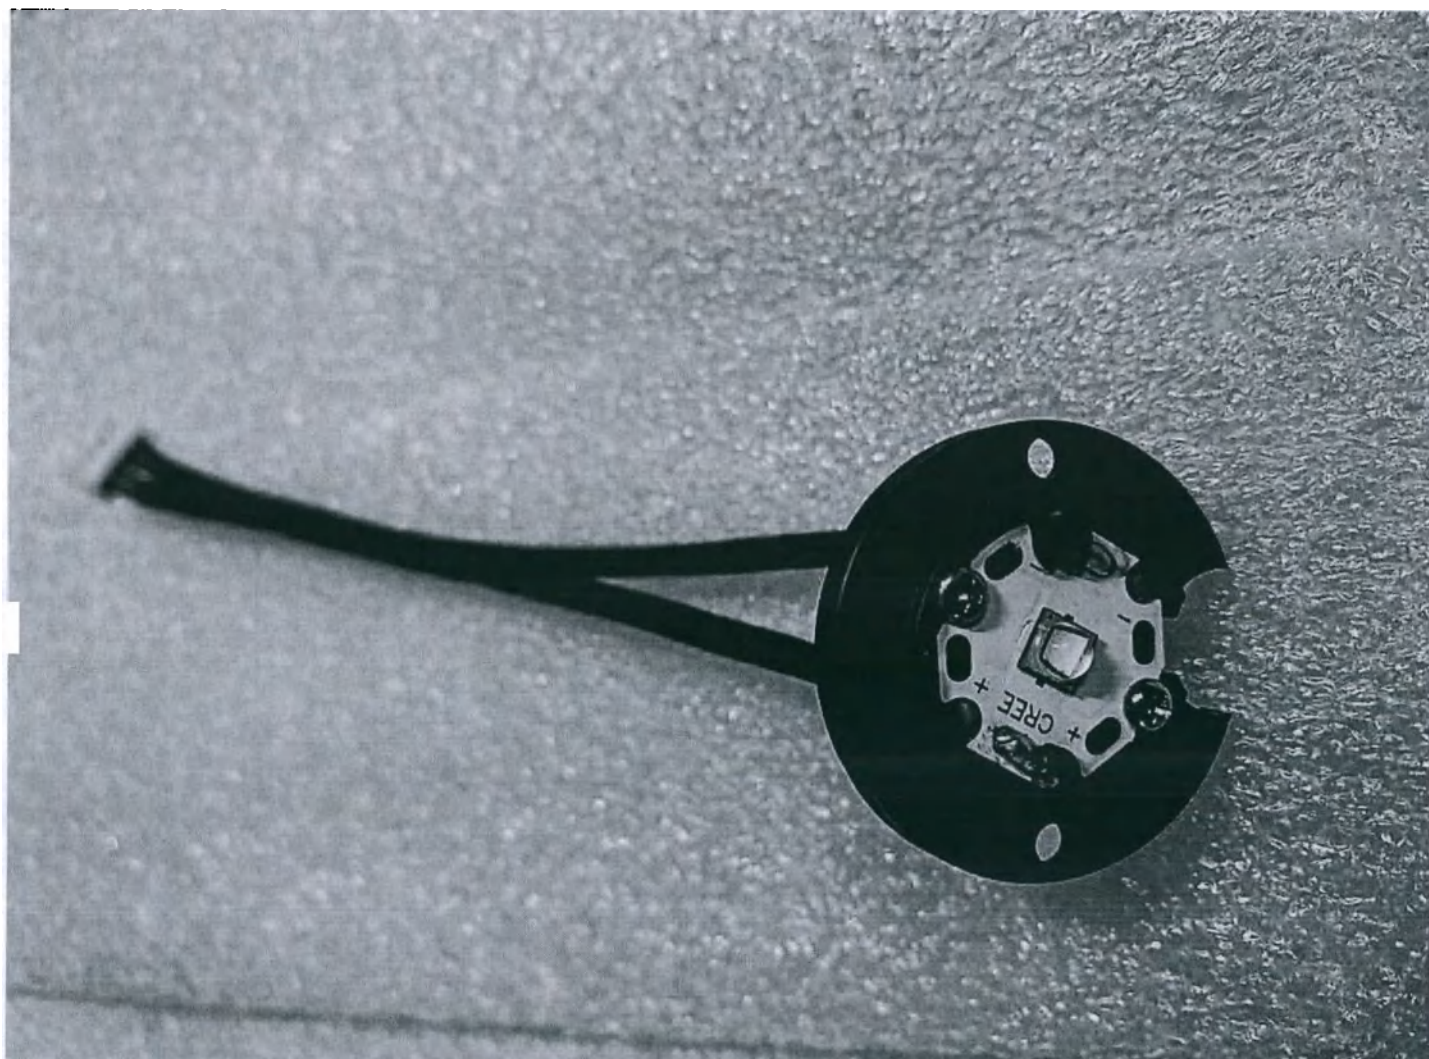

24) Кулер (при необходимости) – 1 шт. (Cooling Fan (if necessary) – 1 pc.)




25) Кабель HDMI (при необходимости) – 1 шт. (HDMI Video Cable (if necessary) – 1 pc.)




6 JONOL


26) Комплект крышек стерилизуемых АМ-5000 – 1 шт. (Set of AM-5000 sterilizable lids – 1 pc.)

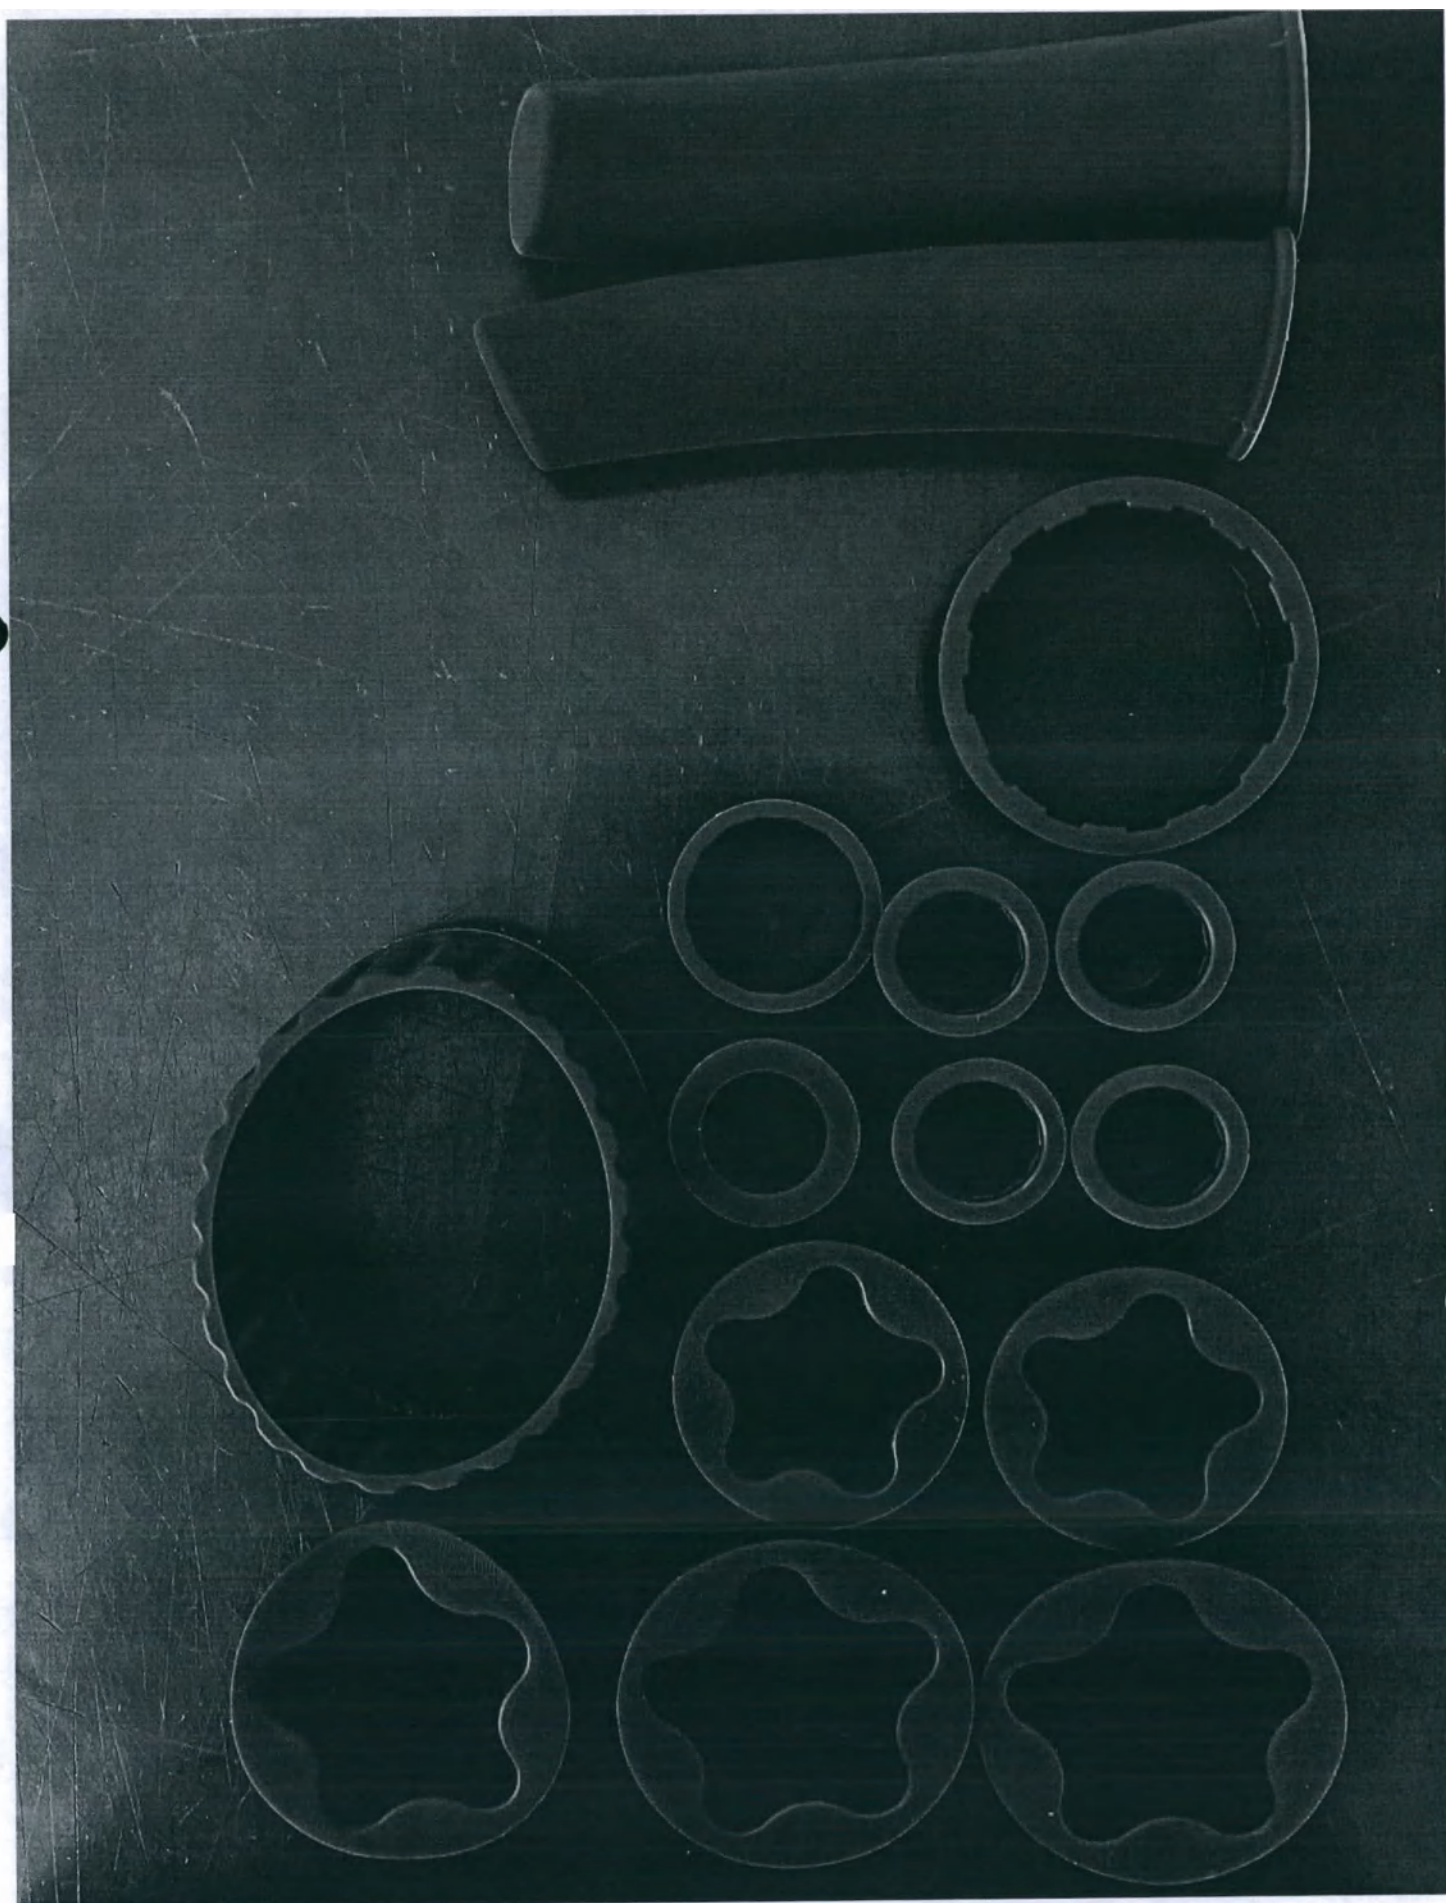


27) Крышка для защиты объектива – 1 шт. (Objective Protective Cap – 1 pc)

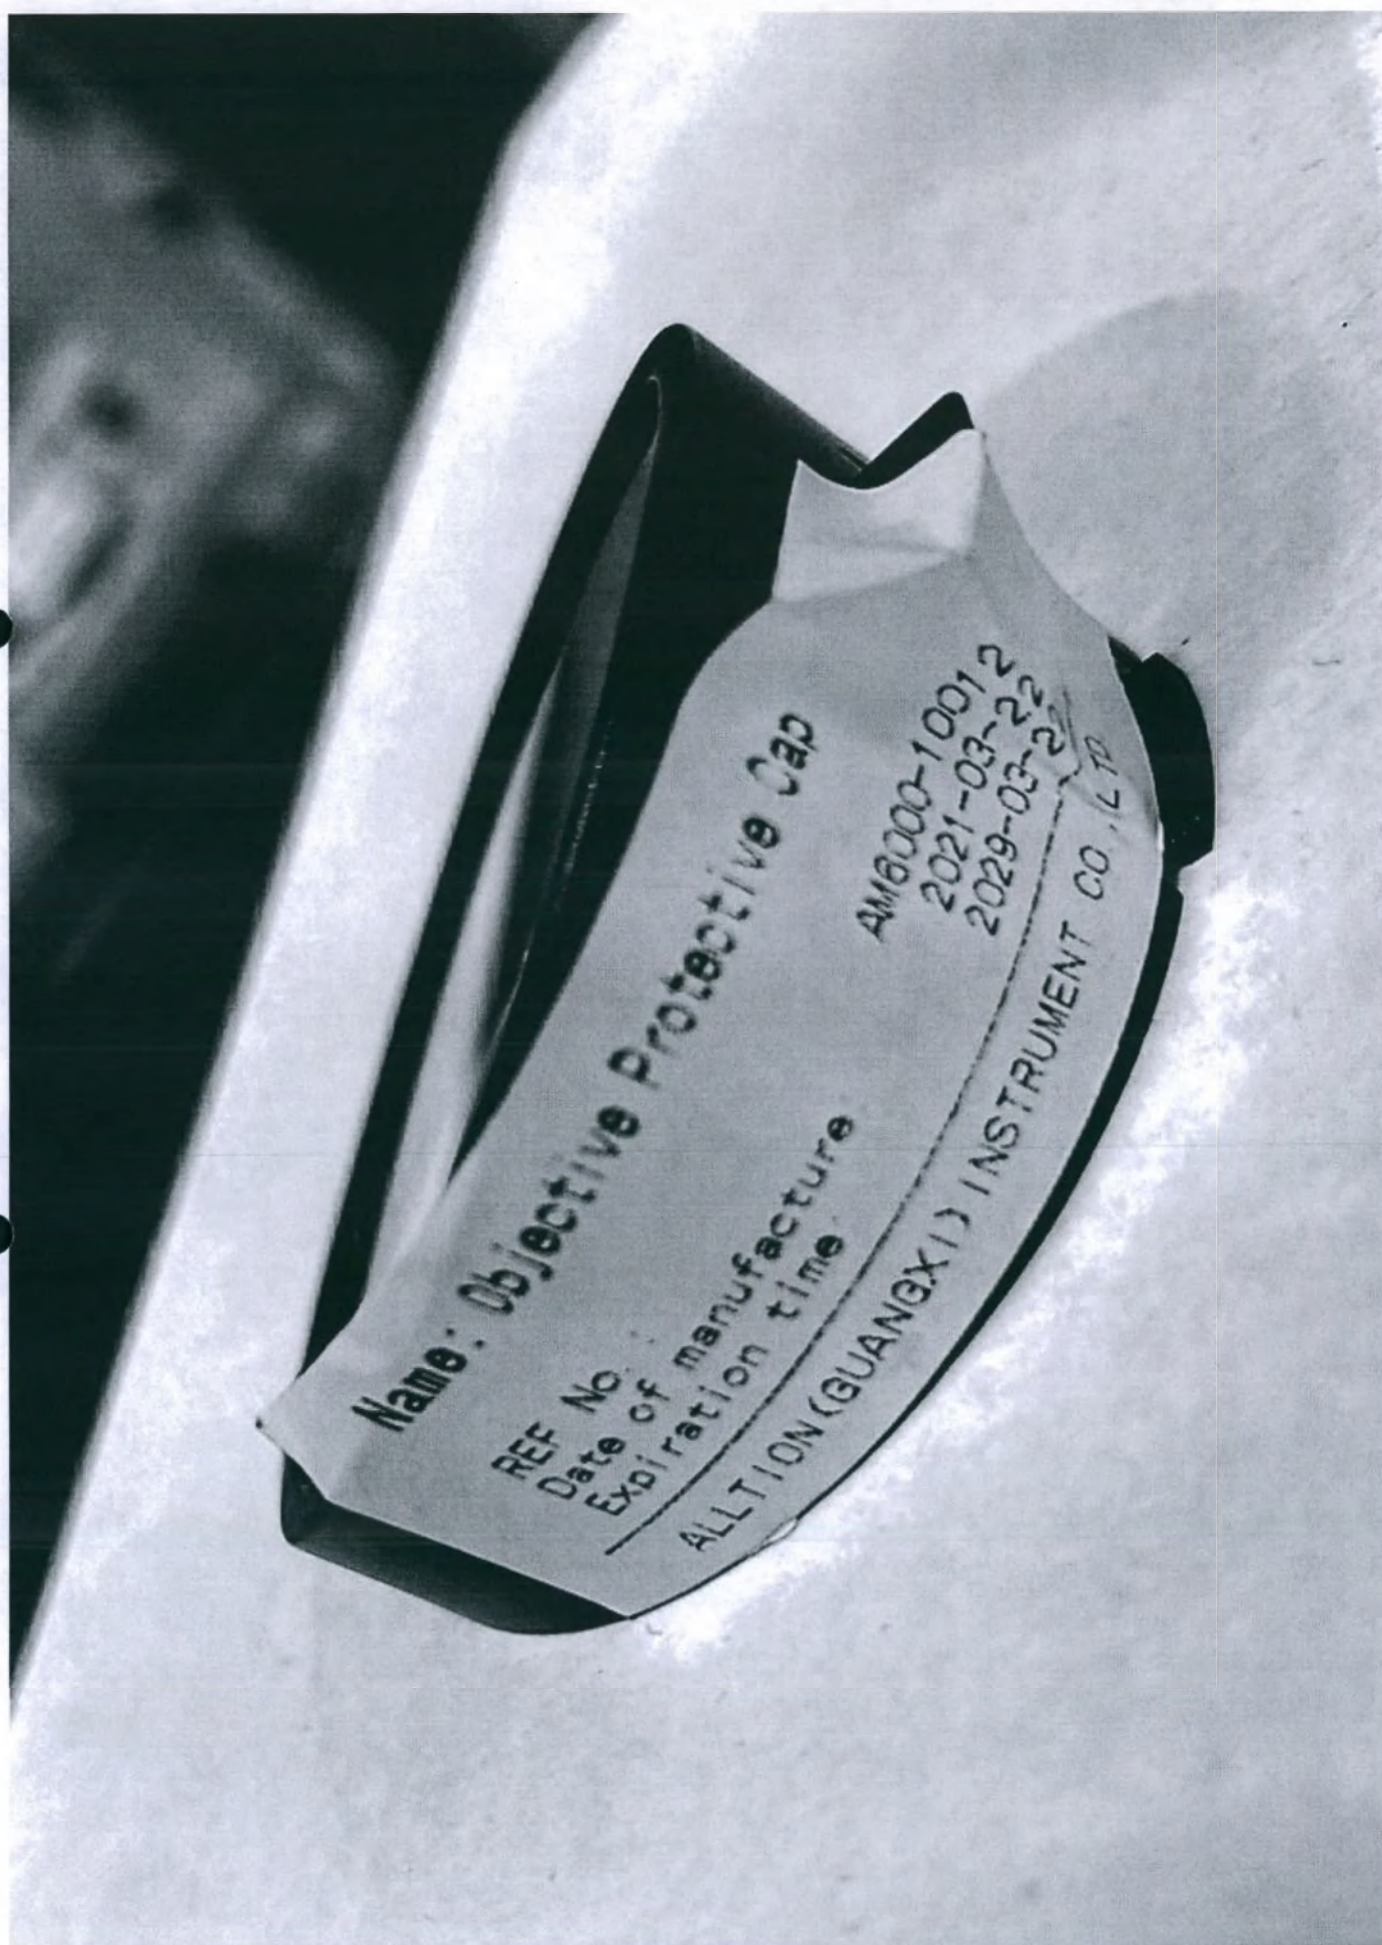

28) USB-накопитель (при необходимости) – 1 шт. (USB drive (if necessary) – 1 pc.)

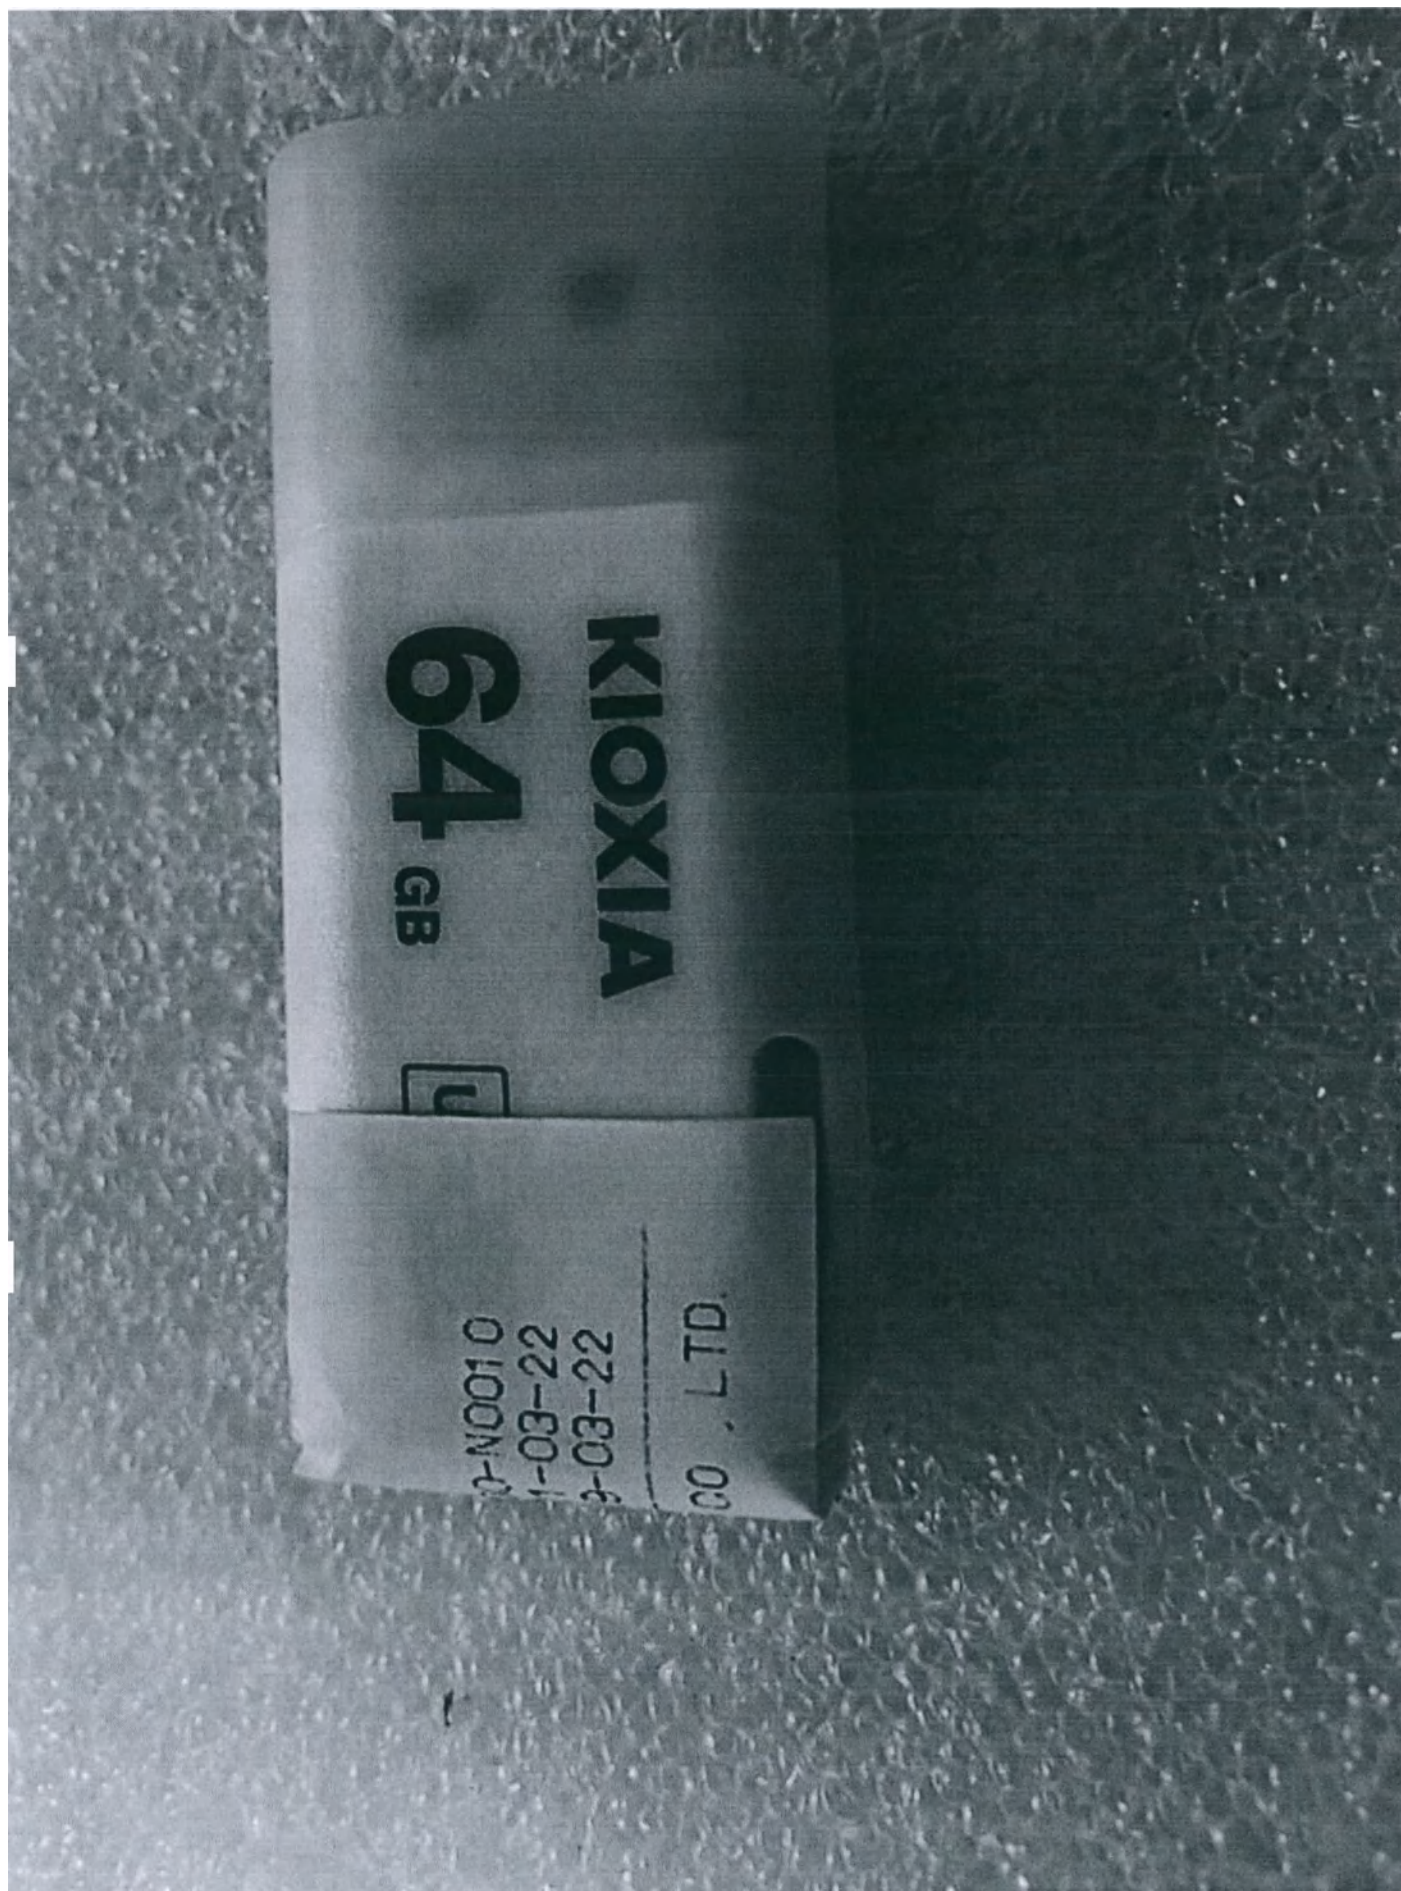

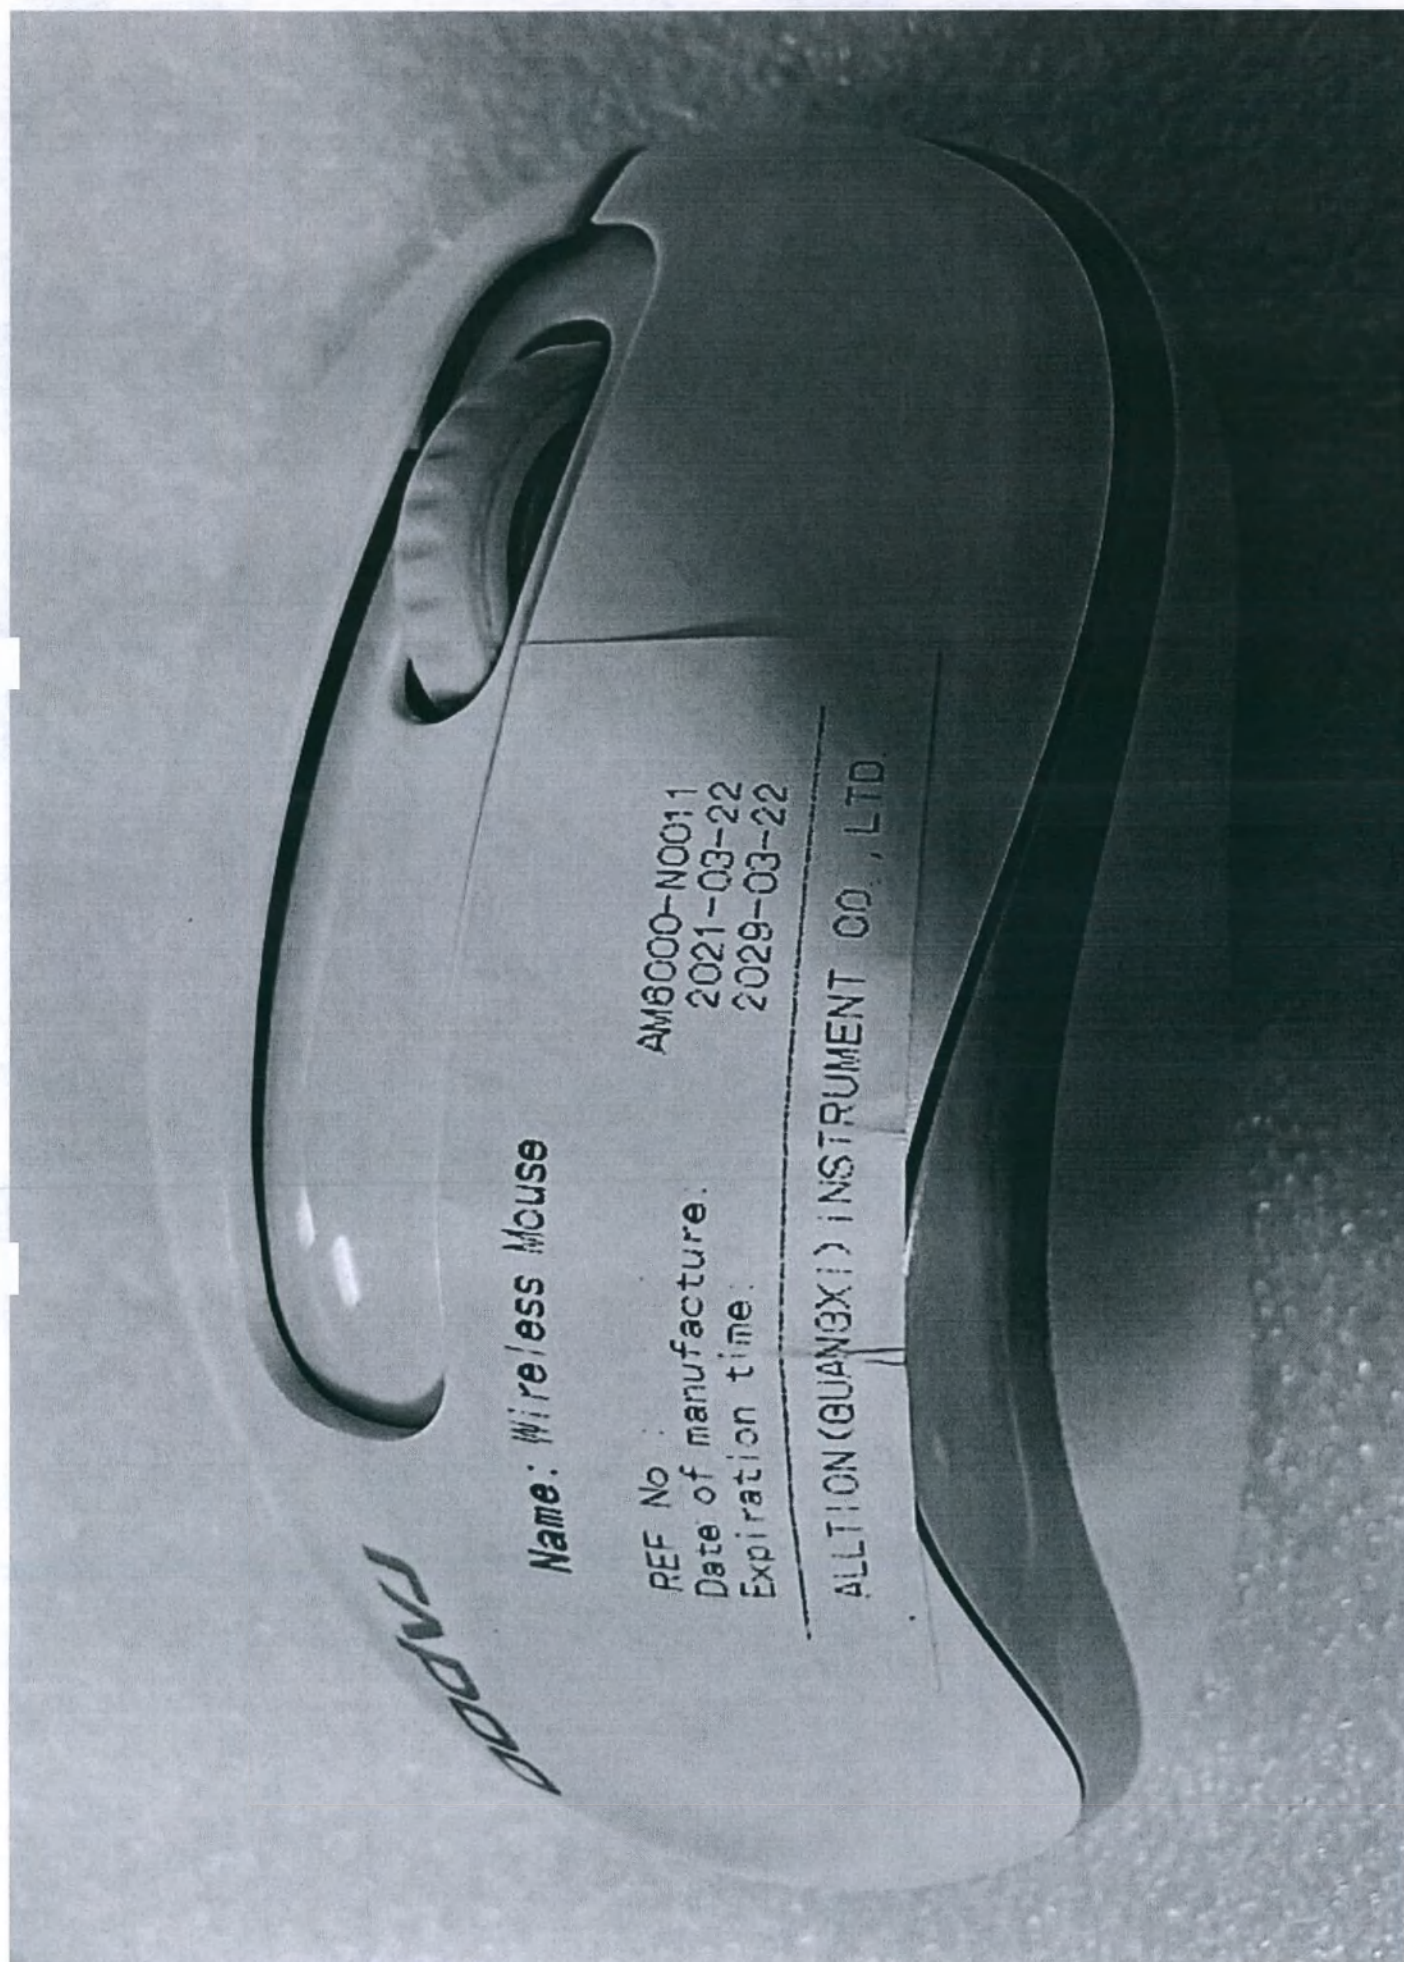

29) Комплект ручек регулировки для АМ-5000 (при необходимости) – 1 шт. (Set of adjustment knobs for AM-5000 (if necessary) – 1 pc.)



30) Подставка для телефона/планшета (при необходимости) – 1 шт. (Phone/Pad Holder (if necessary) – 1 pc.)




31) Кронштейн для монитора (при необходимости) – 1 шт. (Monitor Bracket (if necessary) – 1 pc.)



32) Адаптер для мобильного телефона (при необходимости) – 1 шт. (Mobile phone adapter (if necessary) – 1 pc.)




33) Объектив с переменным фокусным расстоянием F=198-455 мм для АМ-6000 (при необходимости)
– 1 шт. (F198-455 mm Variable Objective Lens for AM-6000 (if necessary) – 1 pc)

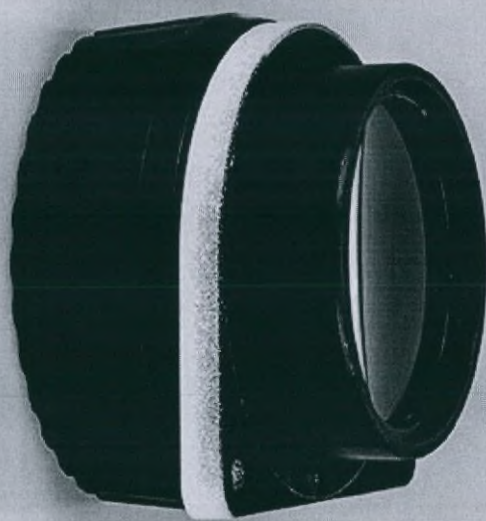

34) Объектив F250 для АМ-5000 (при необходимости) – 1 шт. (F250mm Objective Lens for AM-5000 (if necessary) – 1 pc.)



42) Печатная плата для AM-5000 (при необходимости) – 1 шт. (Dimming Circuit Board for AM-5000 (if necessary) – 1 pc.)

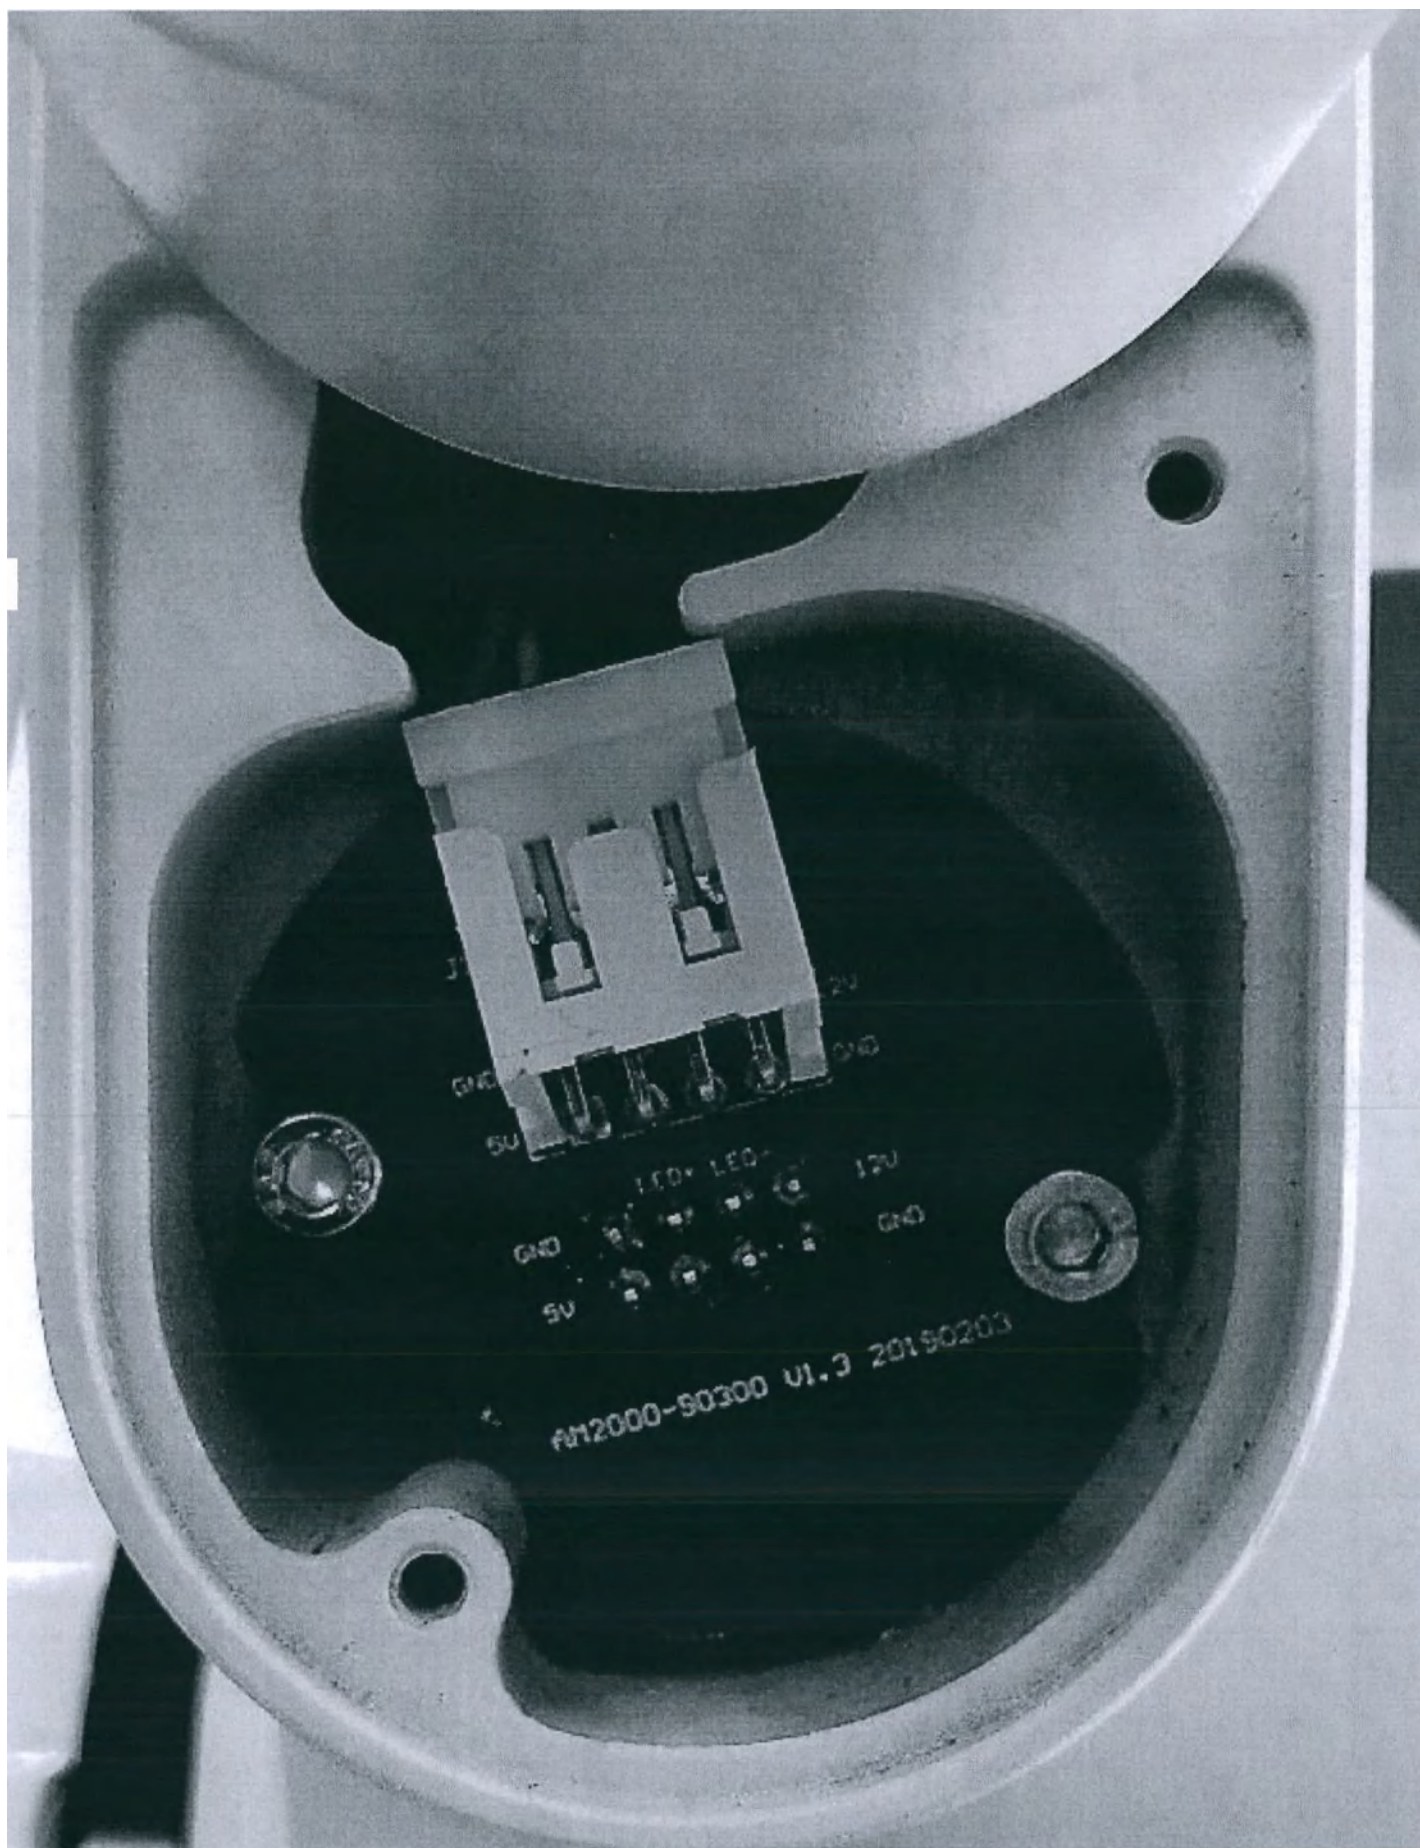


43) Переключатель педальный беспроводной FS-2 (при необходимости) – 1 шт. (Wireless footswitch FS-2 (if necessary) – 1 pc.)




44) Чехол пылезащитный – 1 шт. (Dust Cover – 1 pc.)



45) Колесо запасное (при необходимости) – не более 10 шт. (Caster (if necessary) – no more than 10 pcs.)

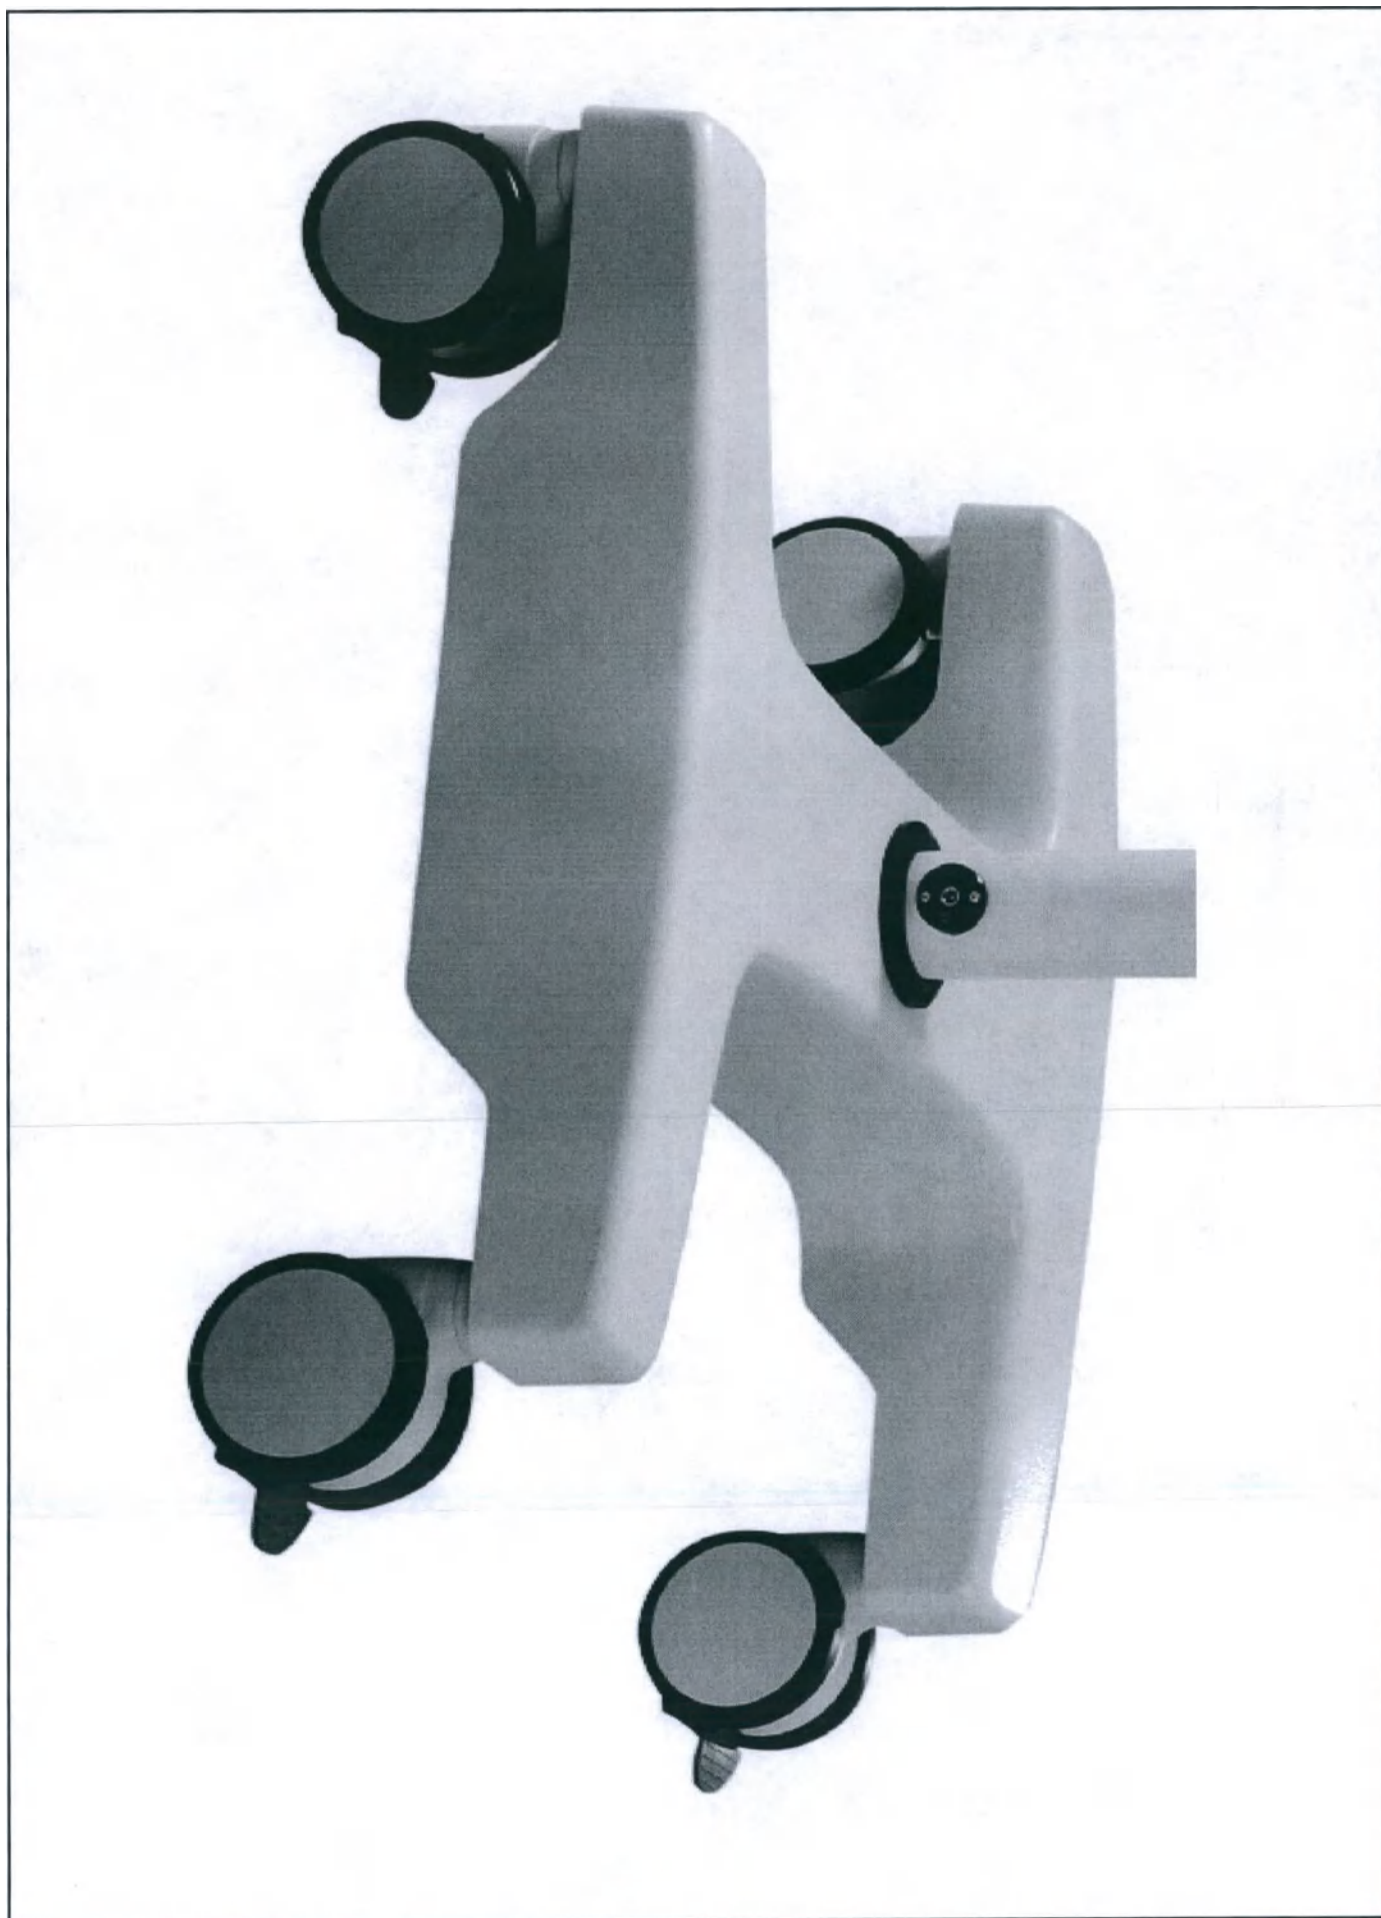


46) Потенциометр (при необходимости) – 1 шт. (Potentiometer (if necessary) – 1 pc.)

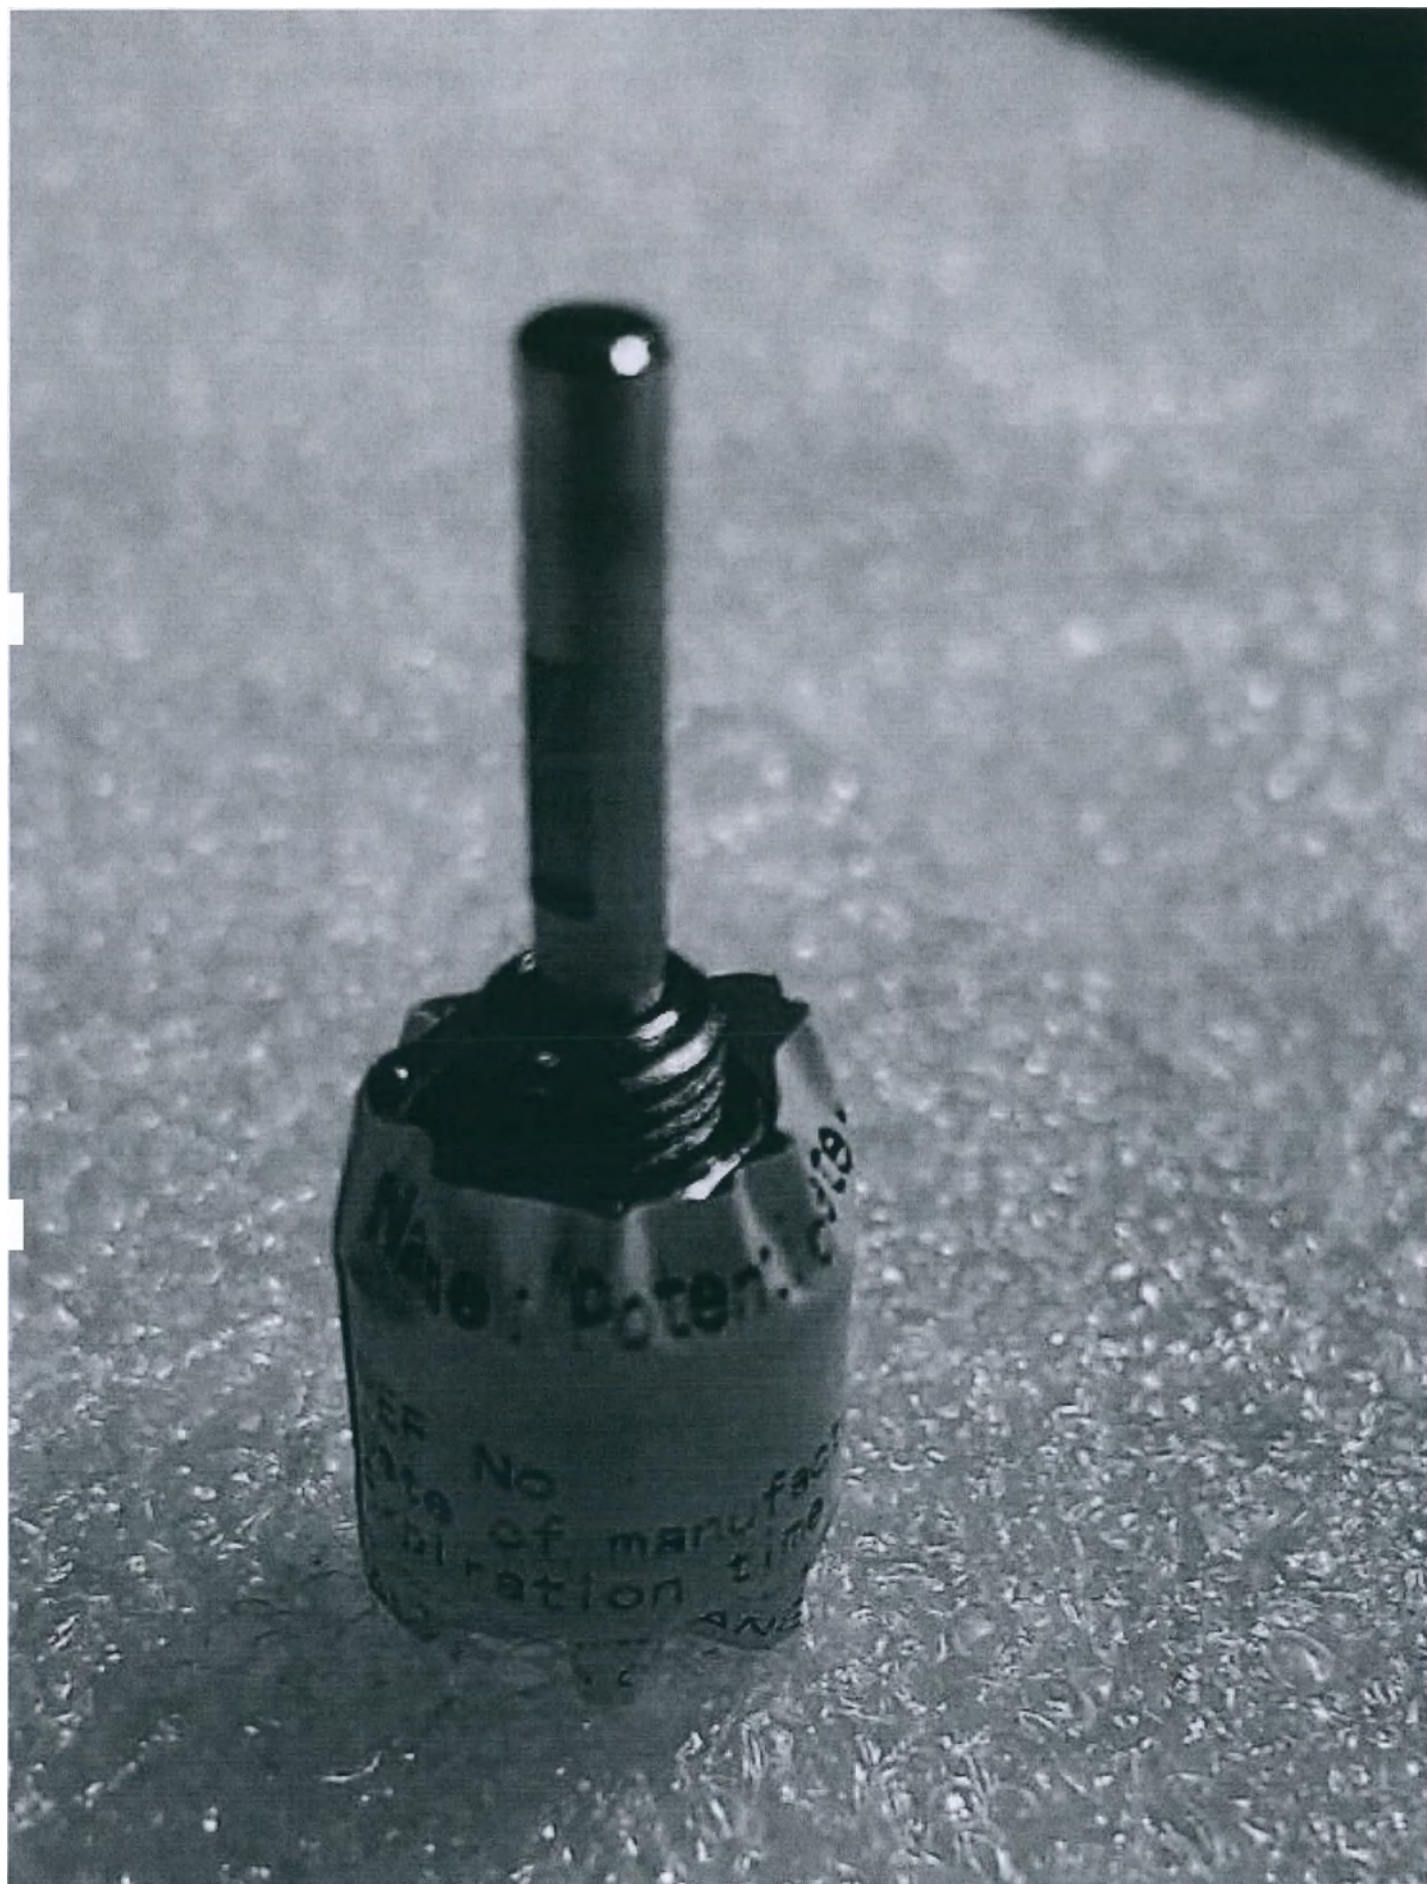


47) Адаптер питания (при необходимости) – 1 шт. (Power adapter (if necessary) – 1 pc.)




48) Адаптер цифровой камеры F180 (при необходимости) – 1 шт. (F180 Digital Camera Adapter (if necessary) – 1 pc.)

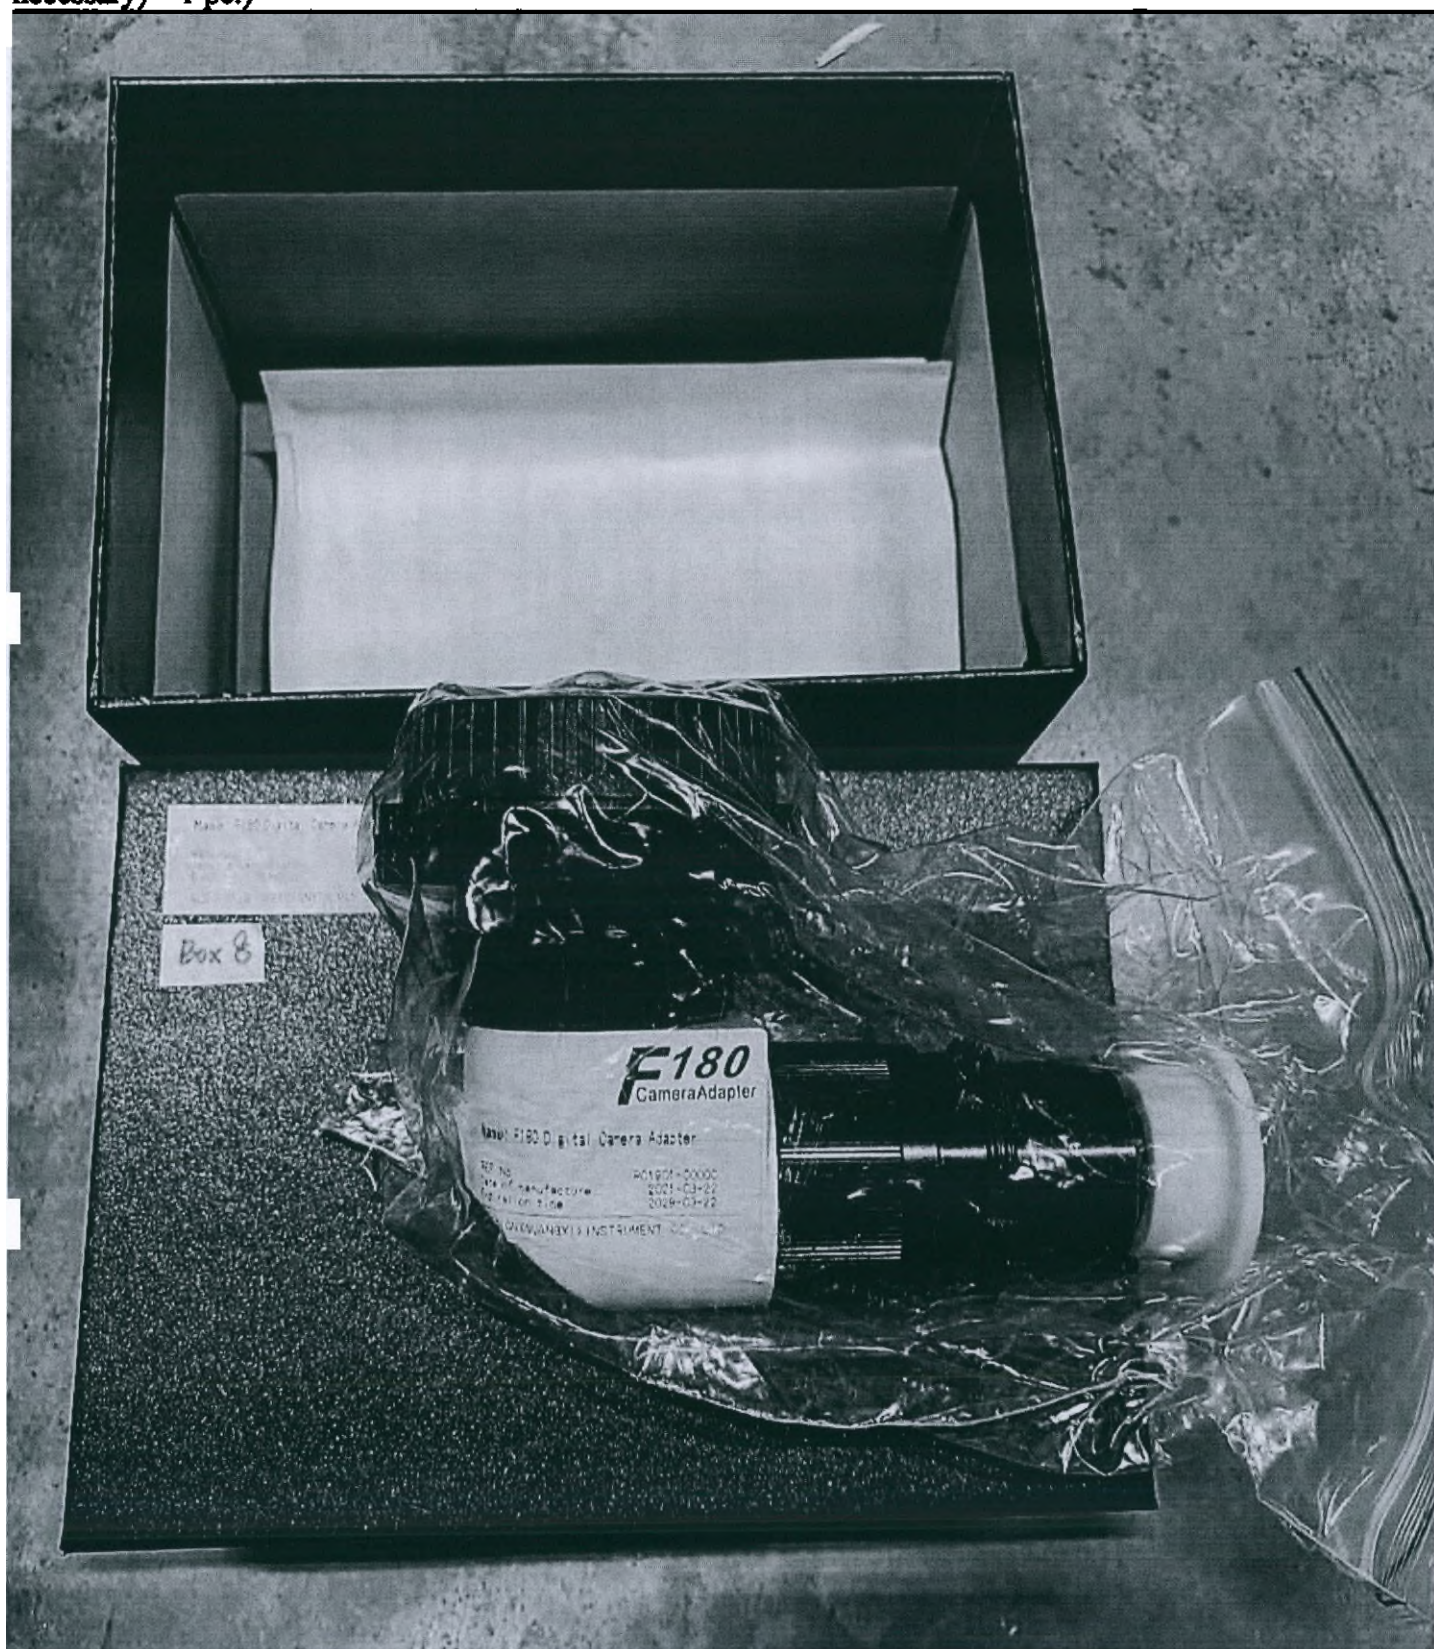


49) Адаптер цифровой камеры F340 (при необходимости) – 1 шт. (F340 Digital Camera Adapter (if necessary) – 1 pc.)

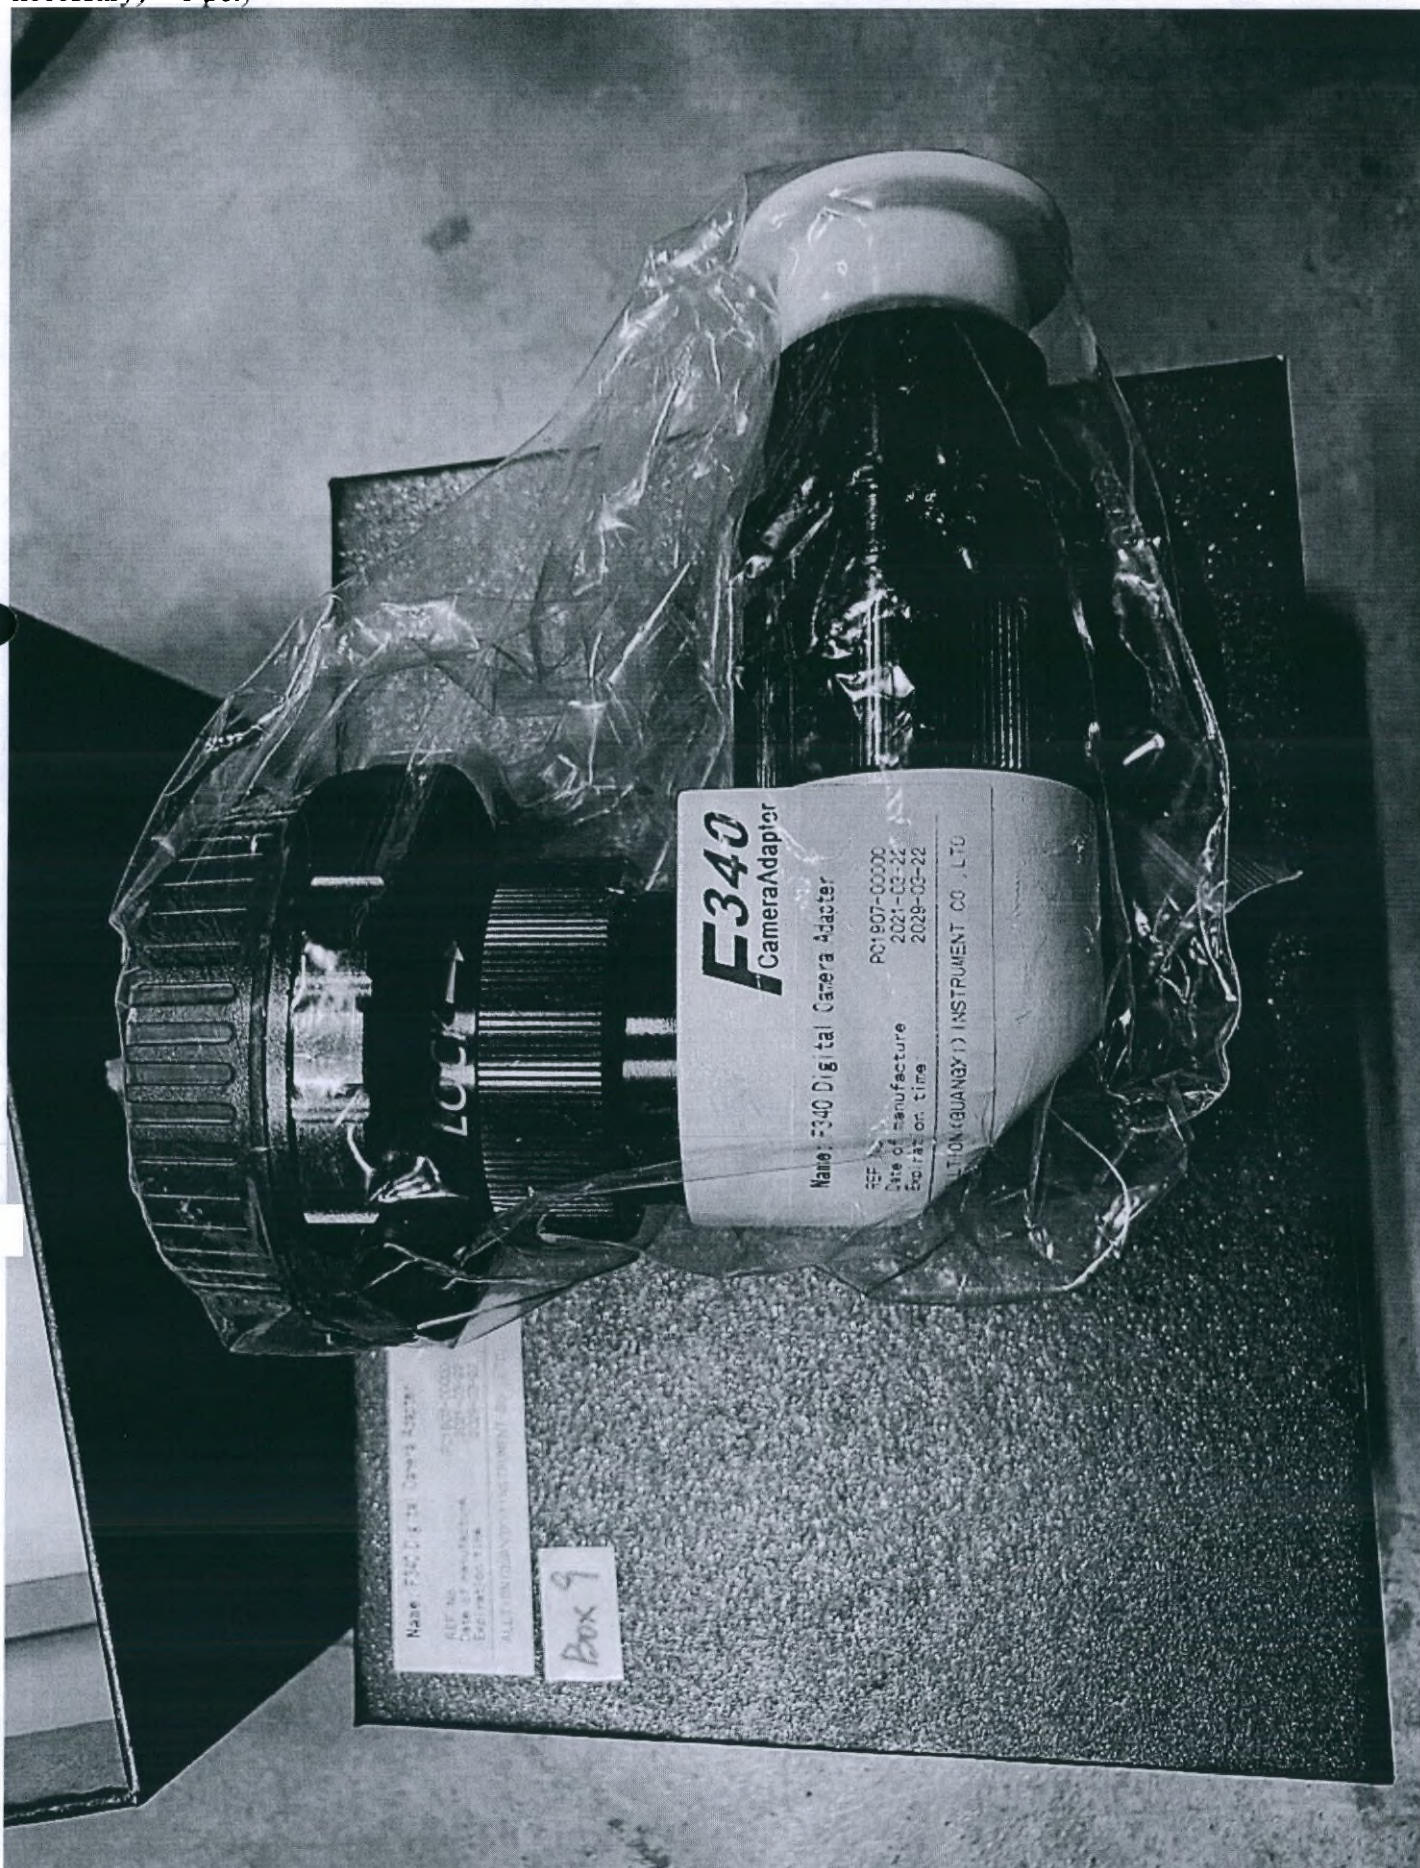


49) Камера полнофункциональная ALL-CAM4 (при необходимости) – 1 шт. (Full Function Camera ALL-CAM4 (if necessary) – 1 pc.)

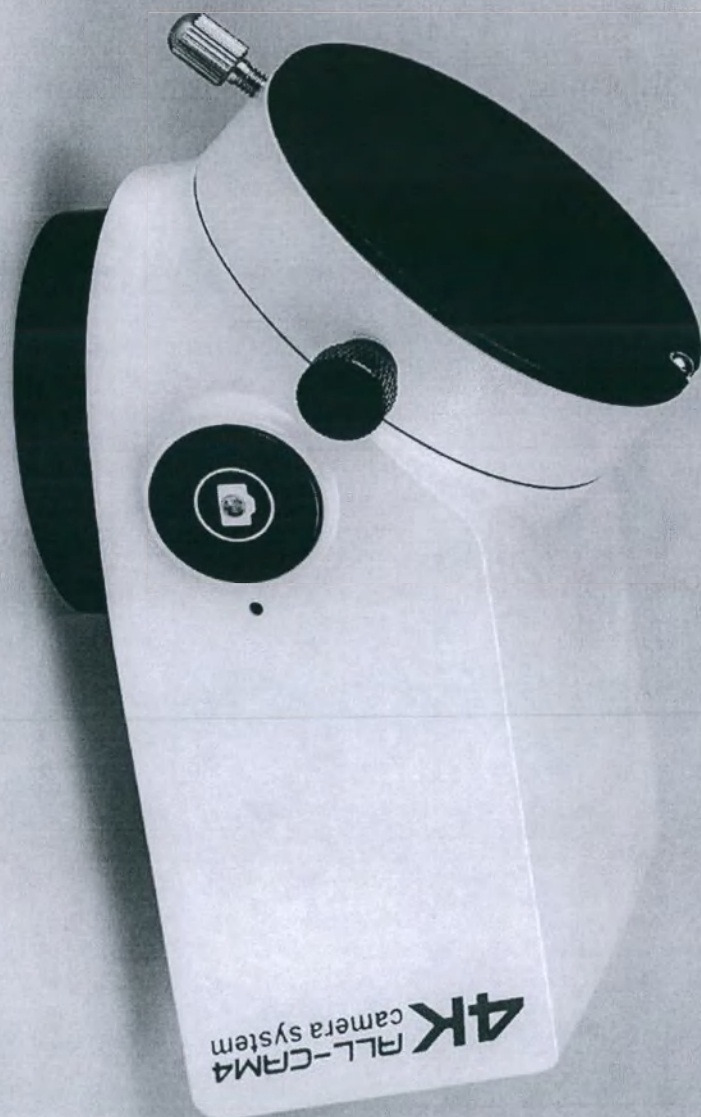


50) Муфта противоположного тубуса (при необходимости) - 1 шт. (Opposite scope connector (if necessary) - 1 pc)

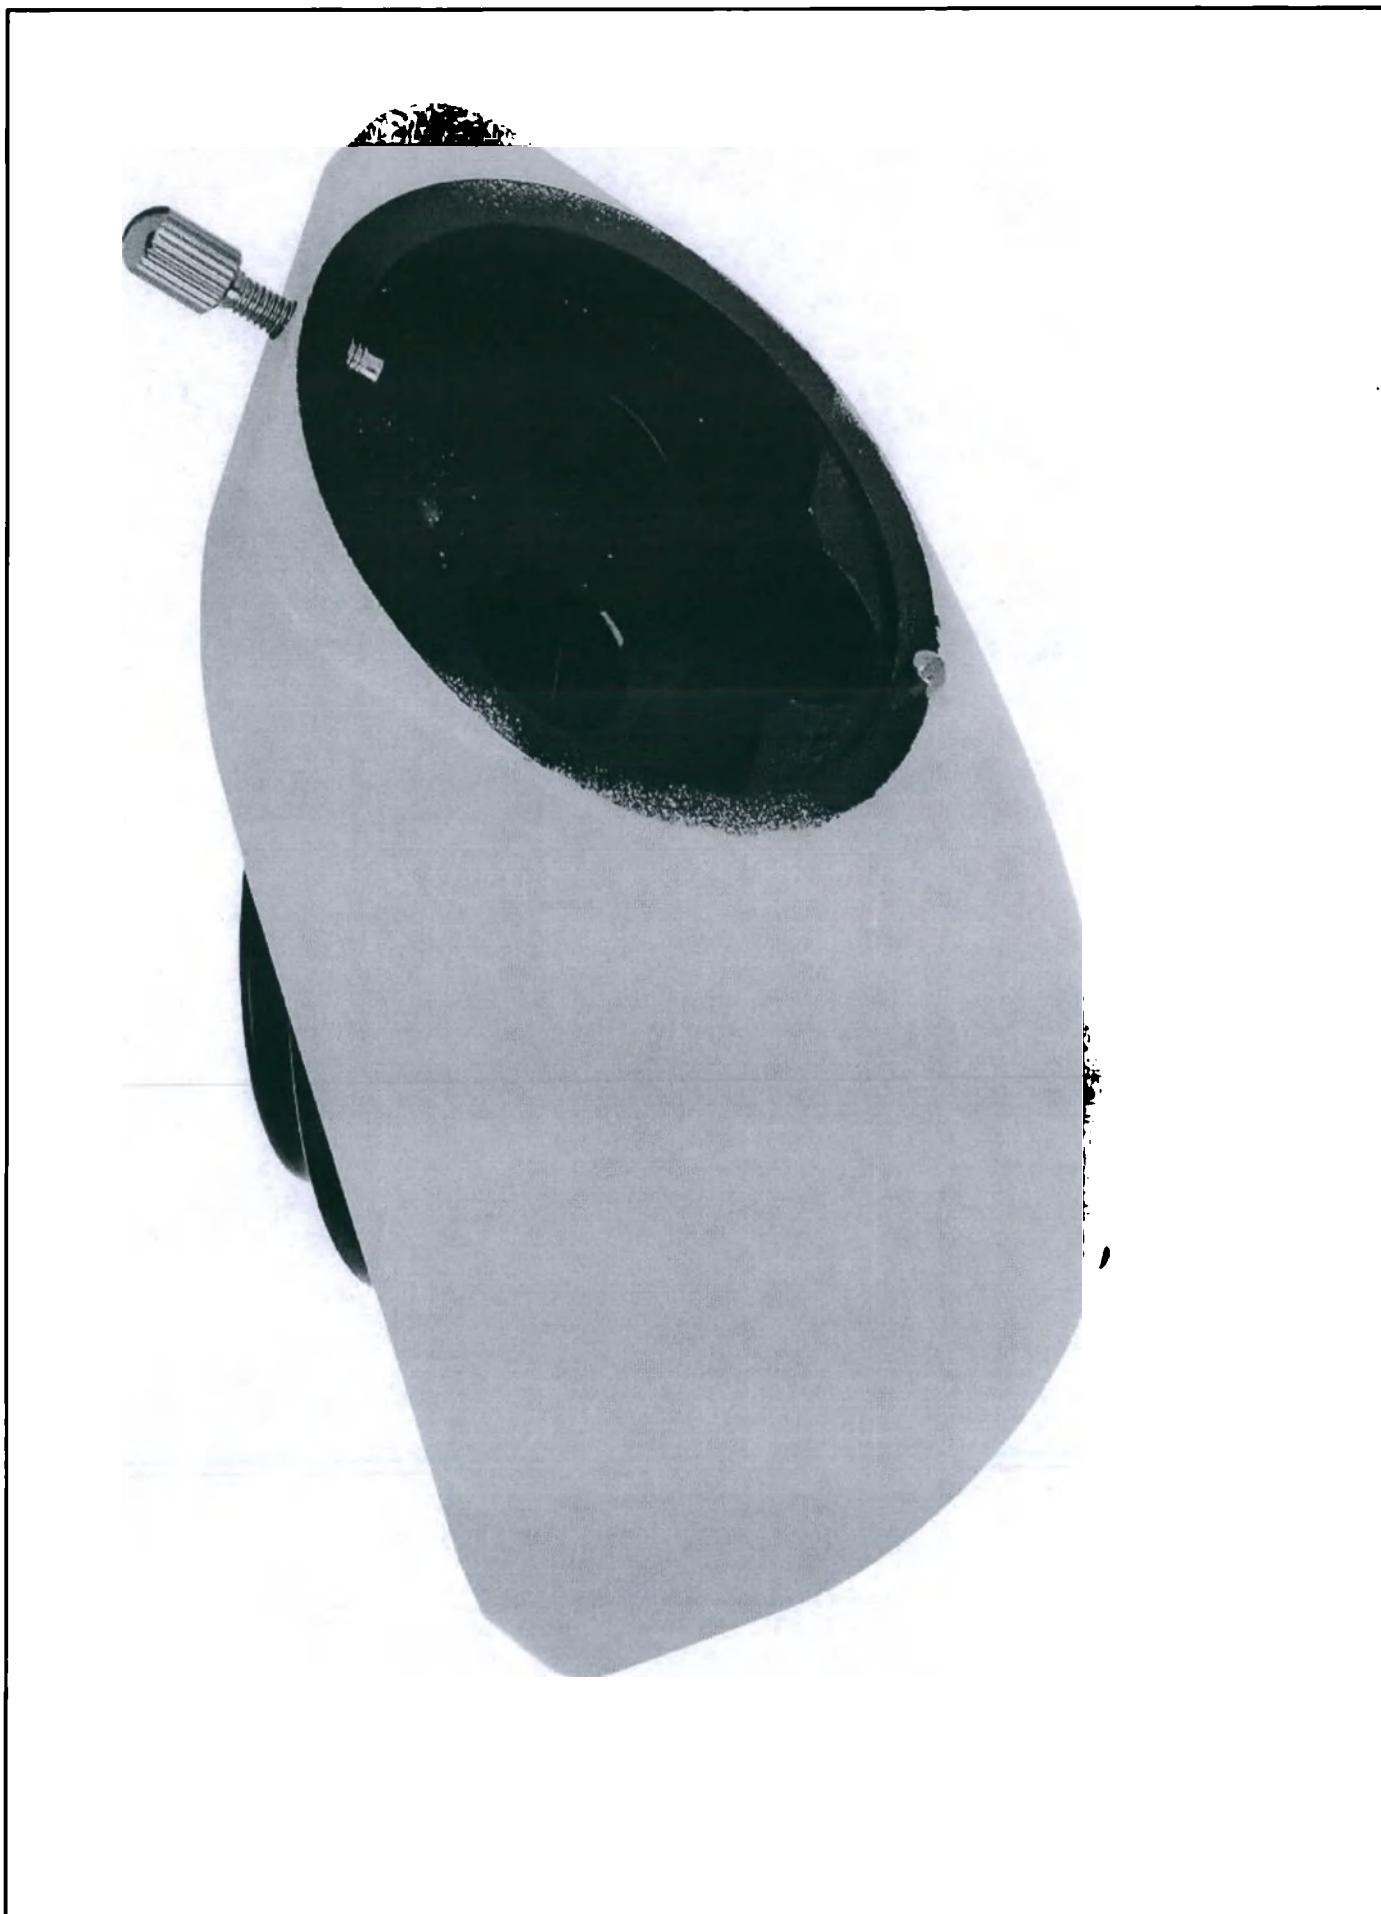

51) Двойная ирисовая диафрагма (при необходимости) – 1 шт. (Dual Iris diaphragm (if necessary) – 1 pc.)

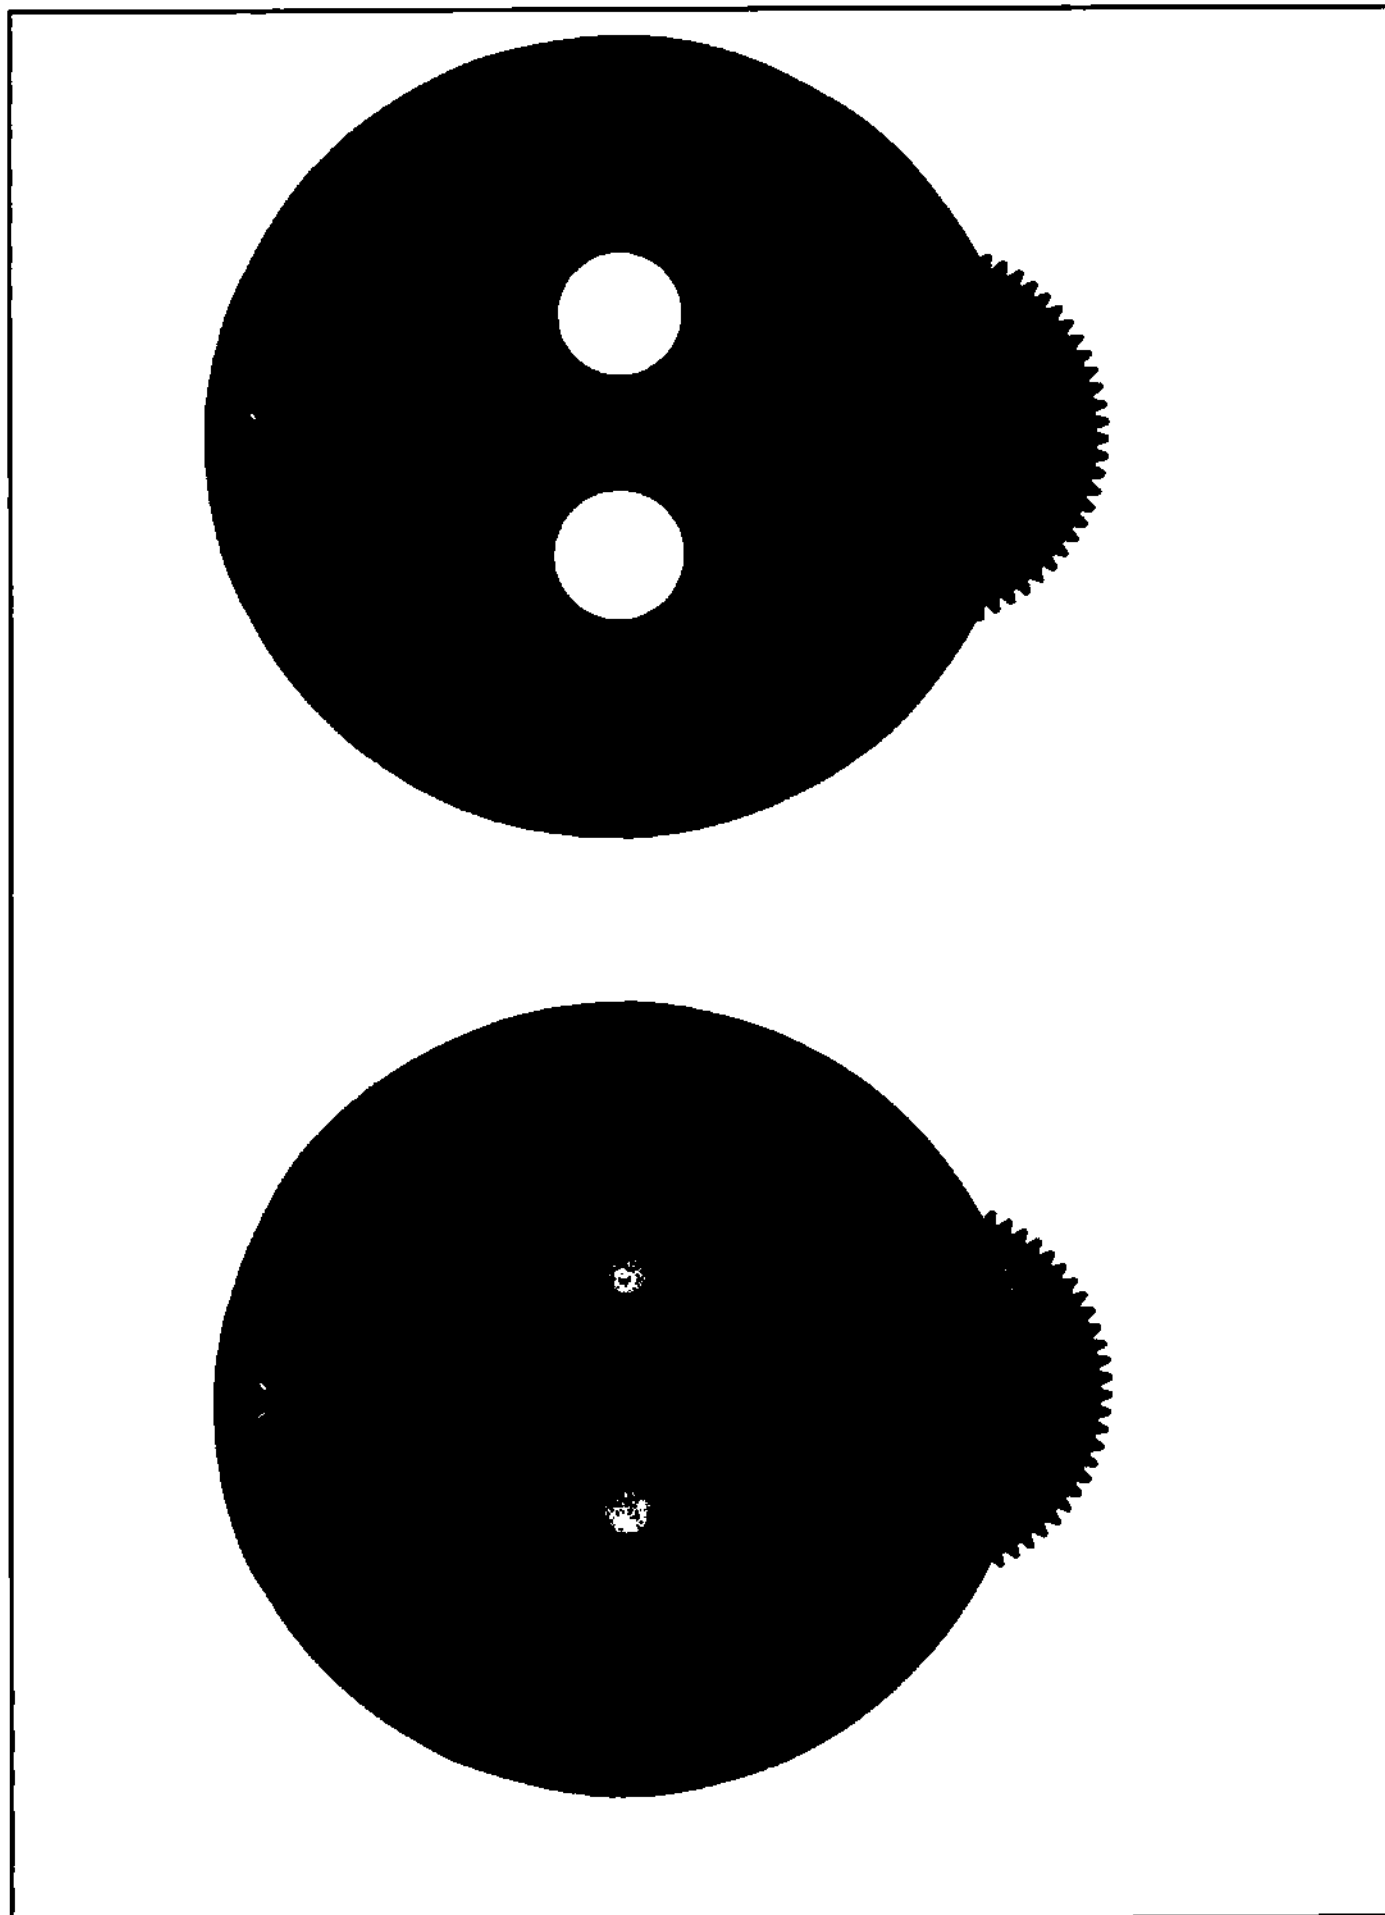

53) Лазерное защитное устройство (при необходимости) – 1 шт. (Laser protective device (if necessary) – 1 pc.)

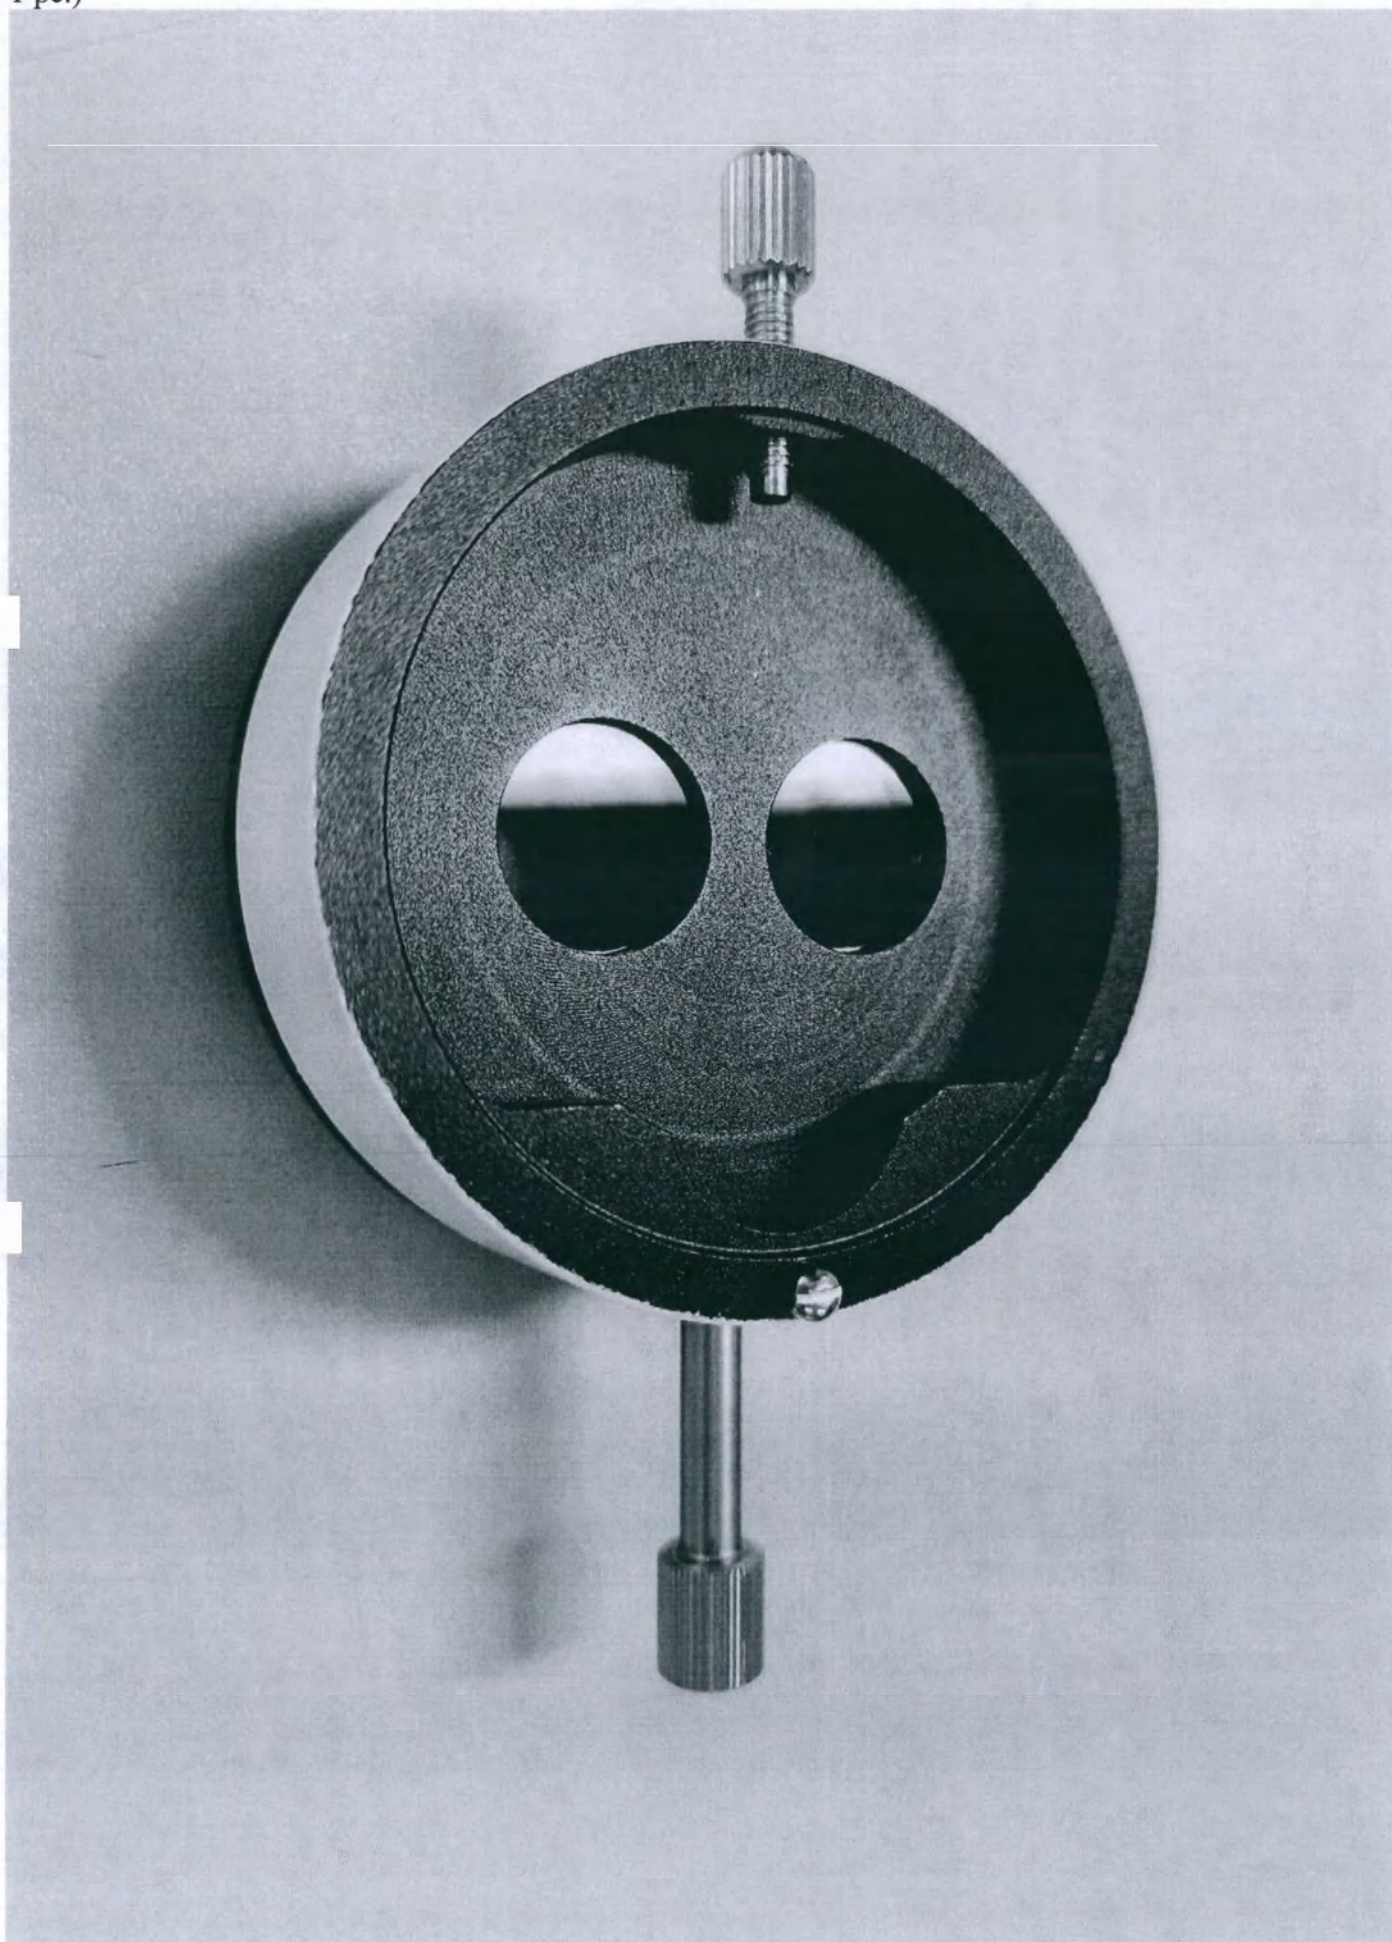


AM-5000 Surgical Microscope



User's Manual

(Please read the instruction carefully before using it)

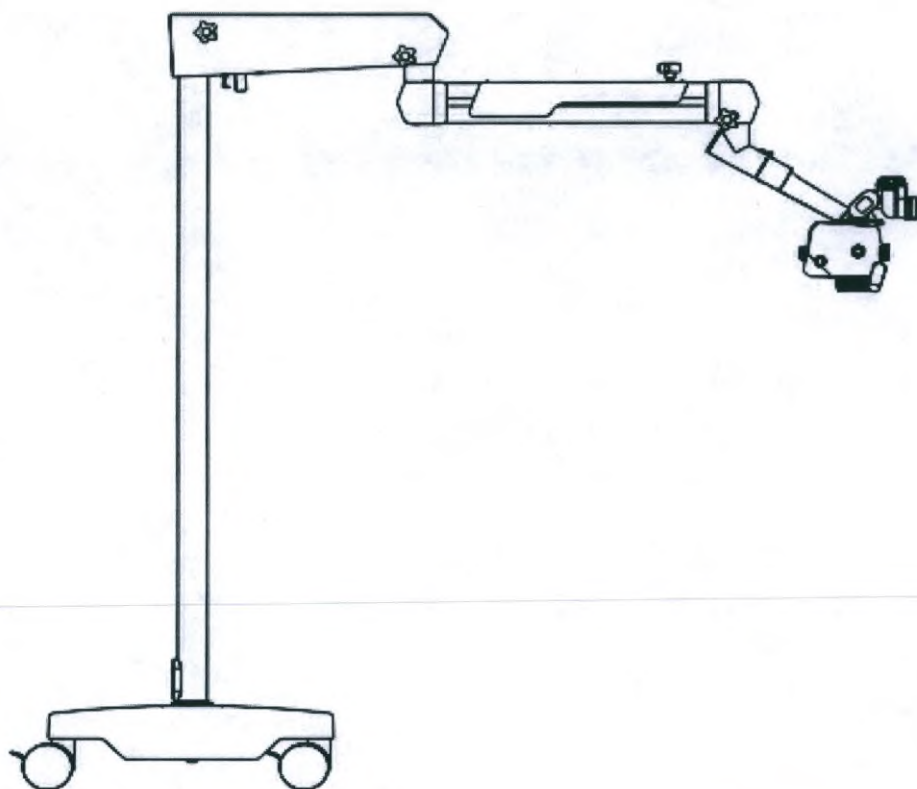

PA1910-UM01-EN

Version: A4


2023-01-13

Alltion (Guangxi) Instrument Co., Ltd.


Общий вид: Микроскоп хирургический АМ-6000



1) Оптический блок микроскопа AM-6000 – 1 шт. (Optical unit of the microscope AM-6000 – 1 pc.)

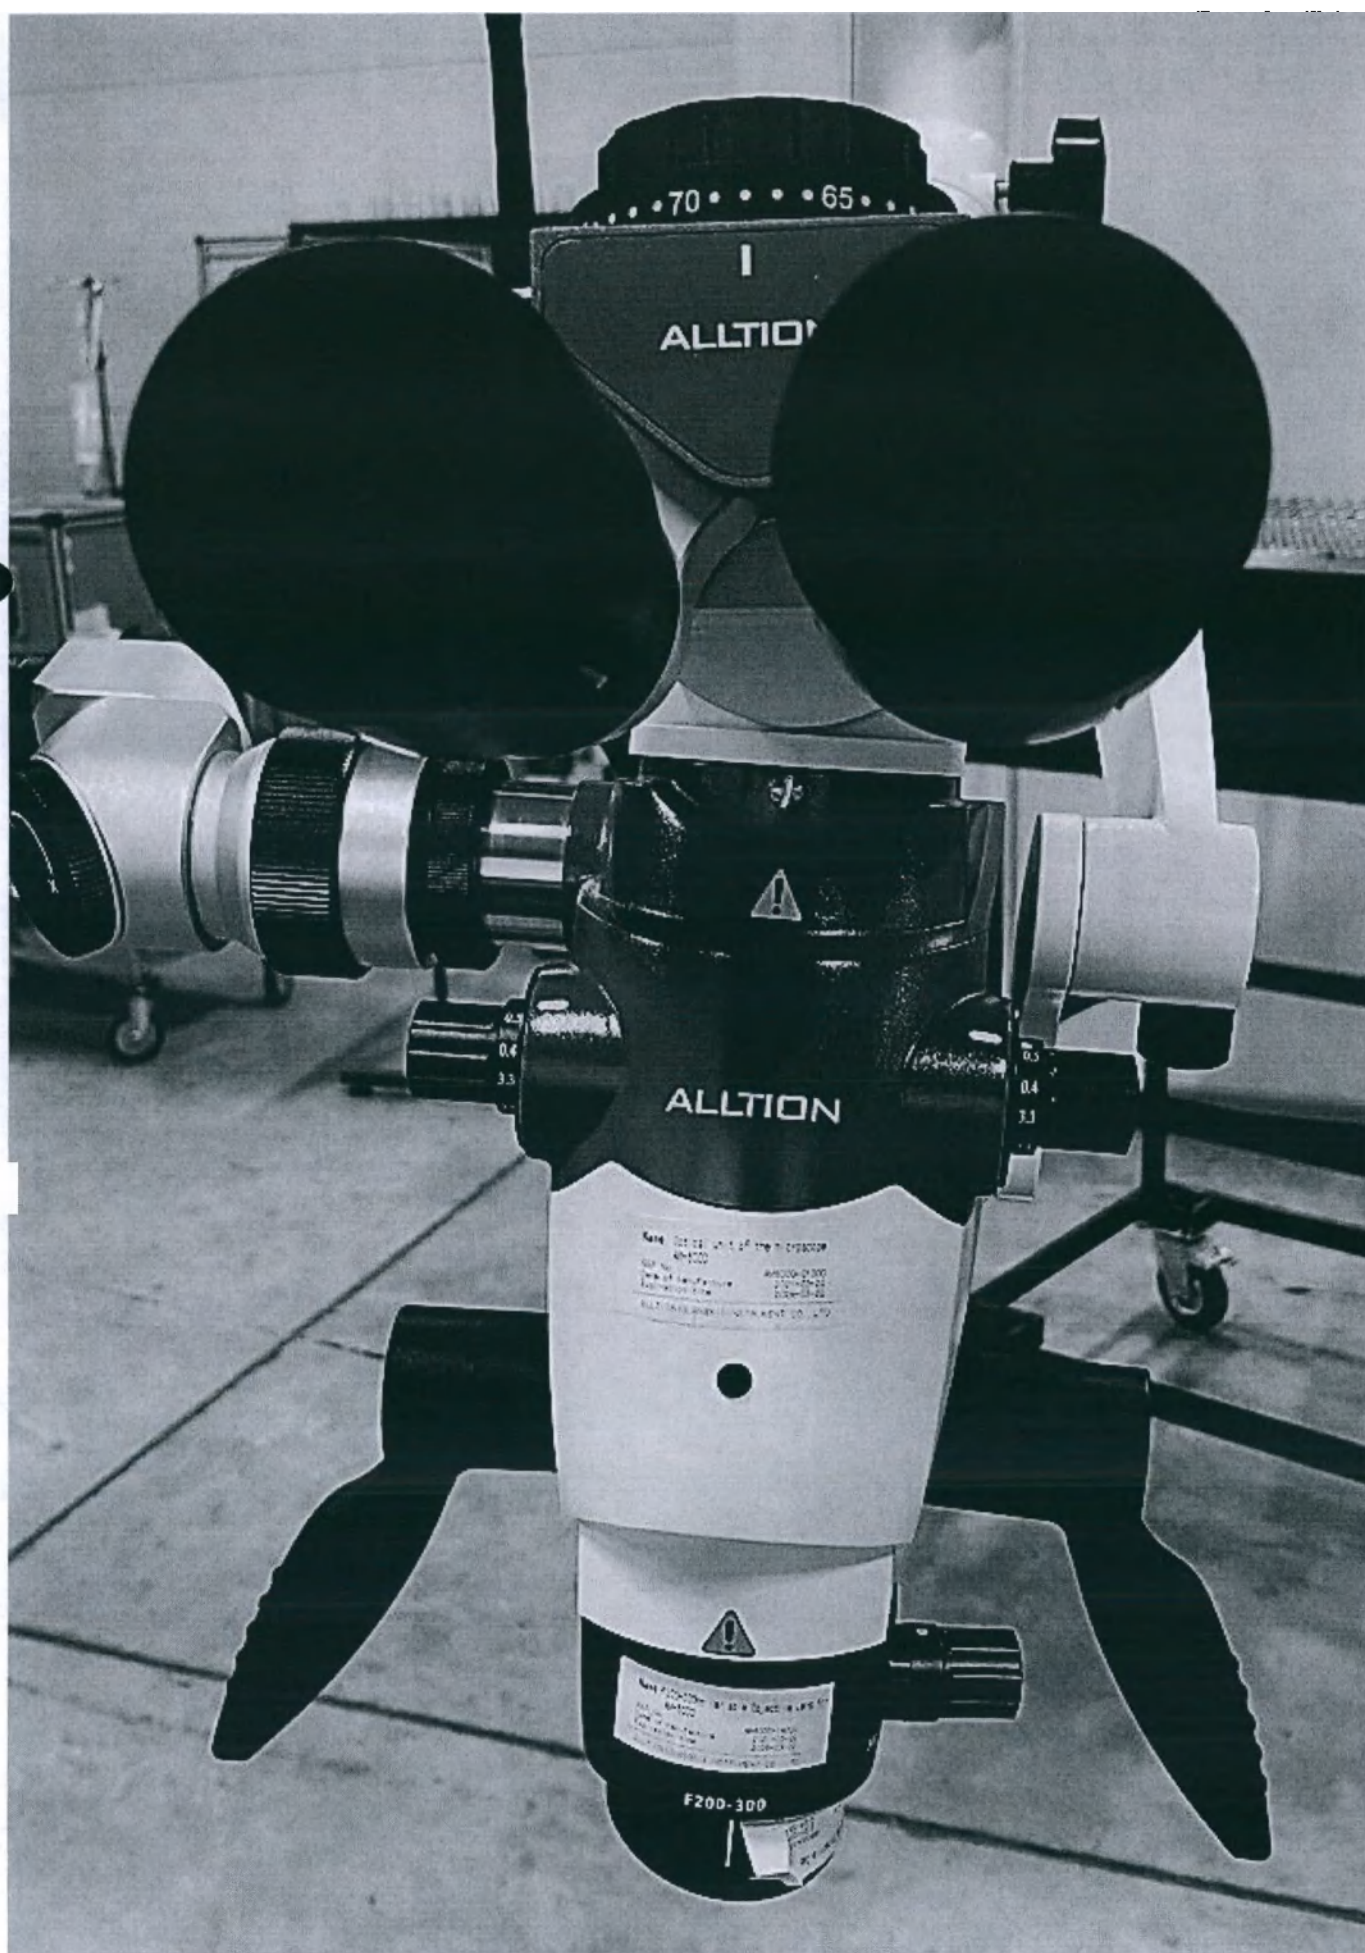

2) Подставка напольная передвижная для АМ-6000 (при необходимости) – 1 шт. (Mobile Floor Stand for AM-6000 (if necessary) – 1 pc.)

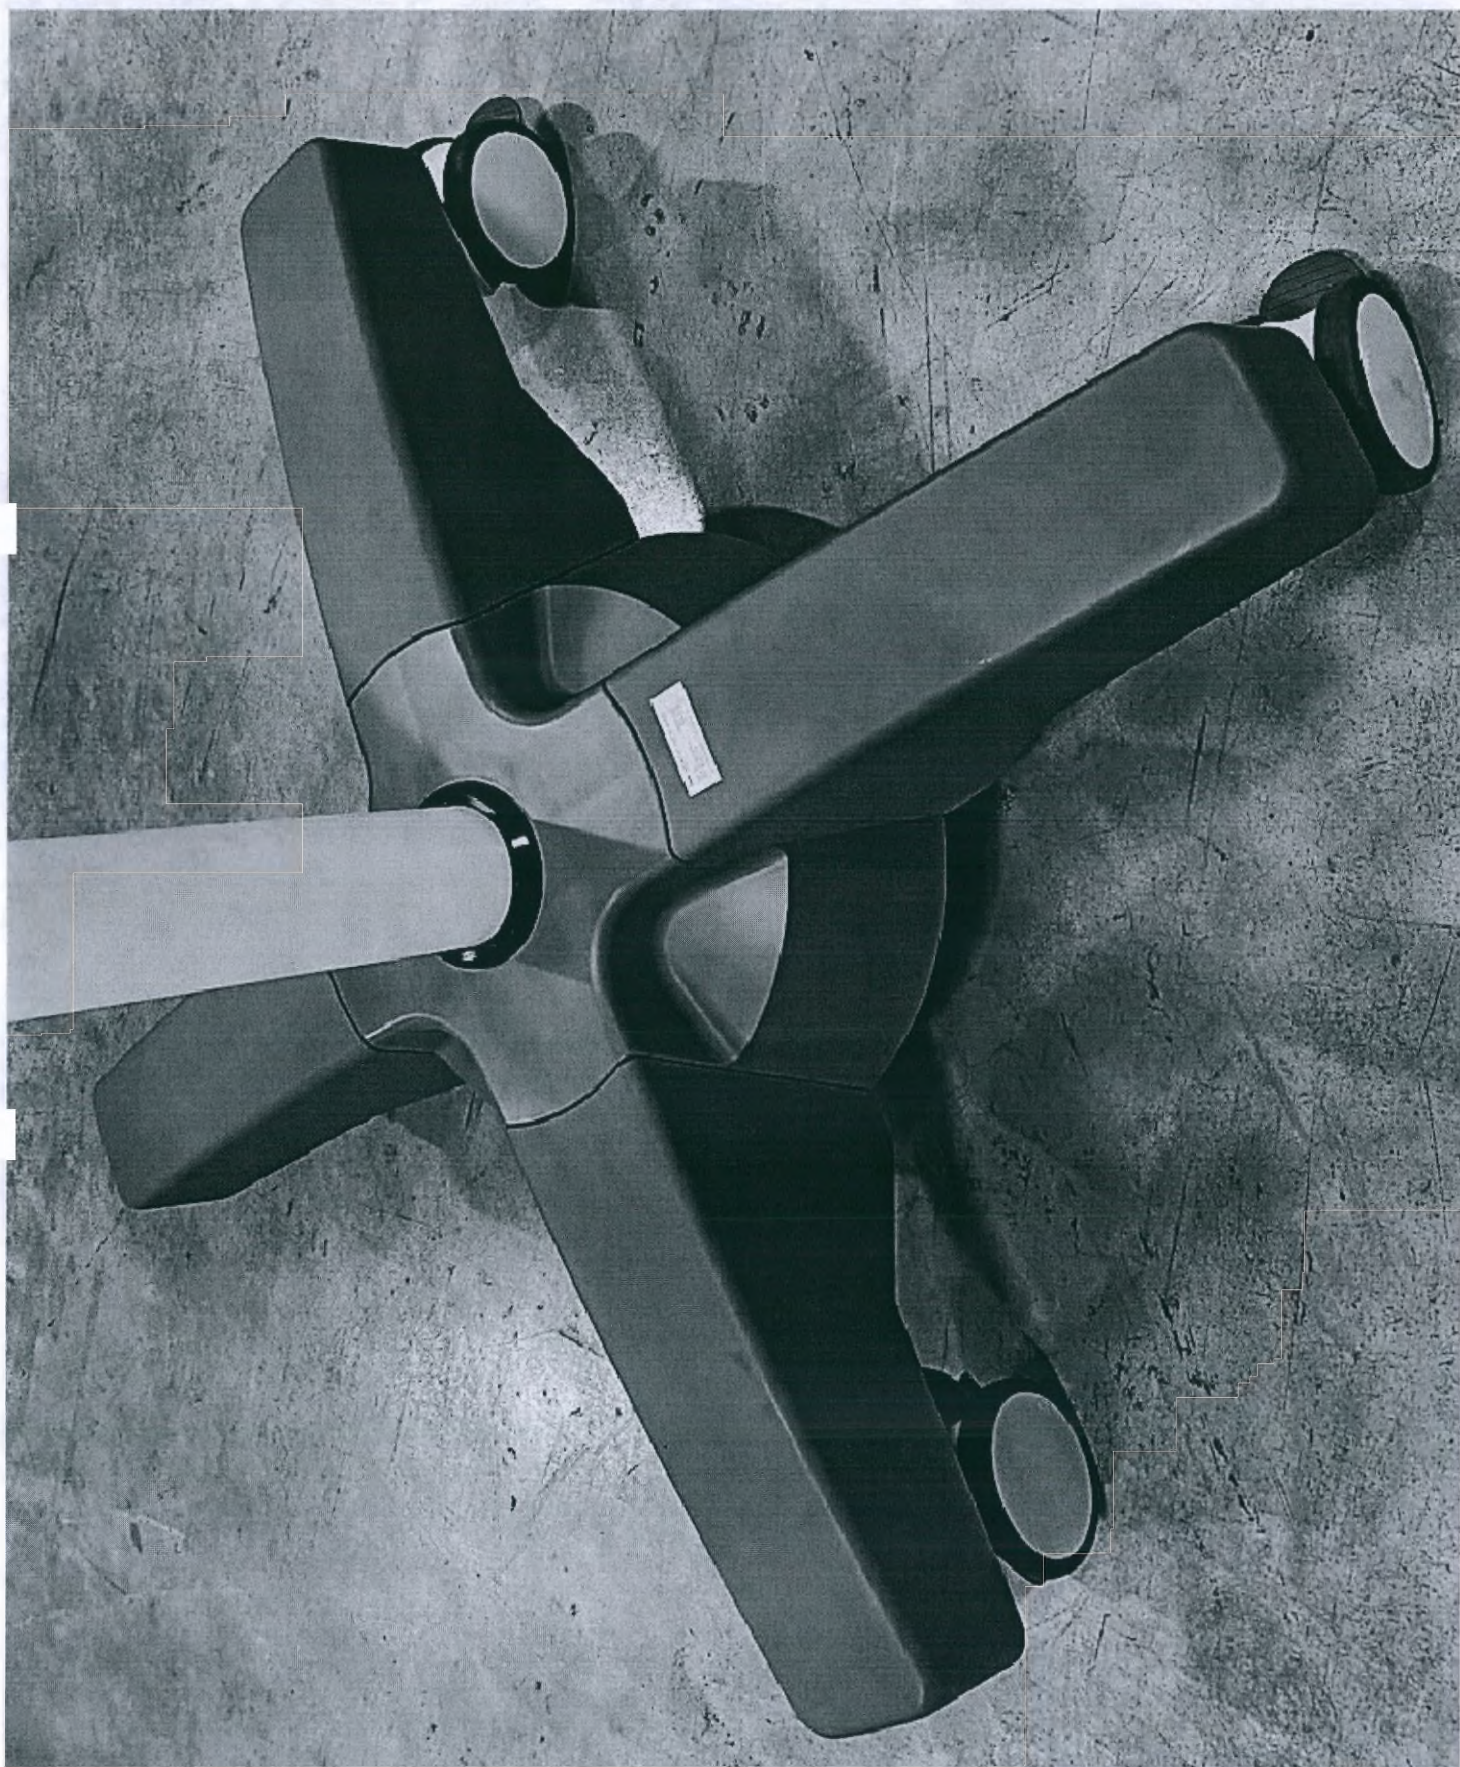


3) Подставка напольная стационарная для АМ-6000 (при необходимости) – 1 шт. (Fixed Stand for AM-6000 (if necessary) – 1 pc.)



4) Крепление потолочное для АМ-6000 (при необходимости) – 1 шт. (Ceiling mount for AM-6000 (if necessary) – 1 pc.)




5) Крепление настенное в низком положении для АМ-6000 (при необходимости) – 1 шт. (Low-position Wall Mount for AM-6000 (if necessary) – 1 pc.)

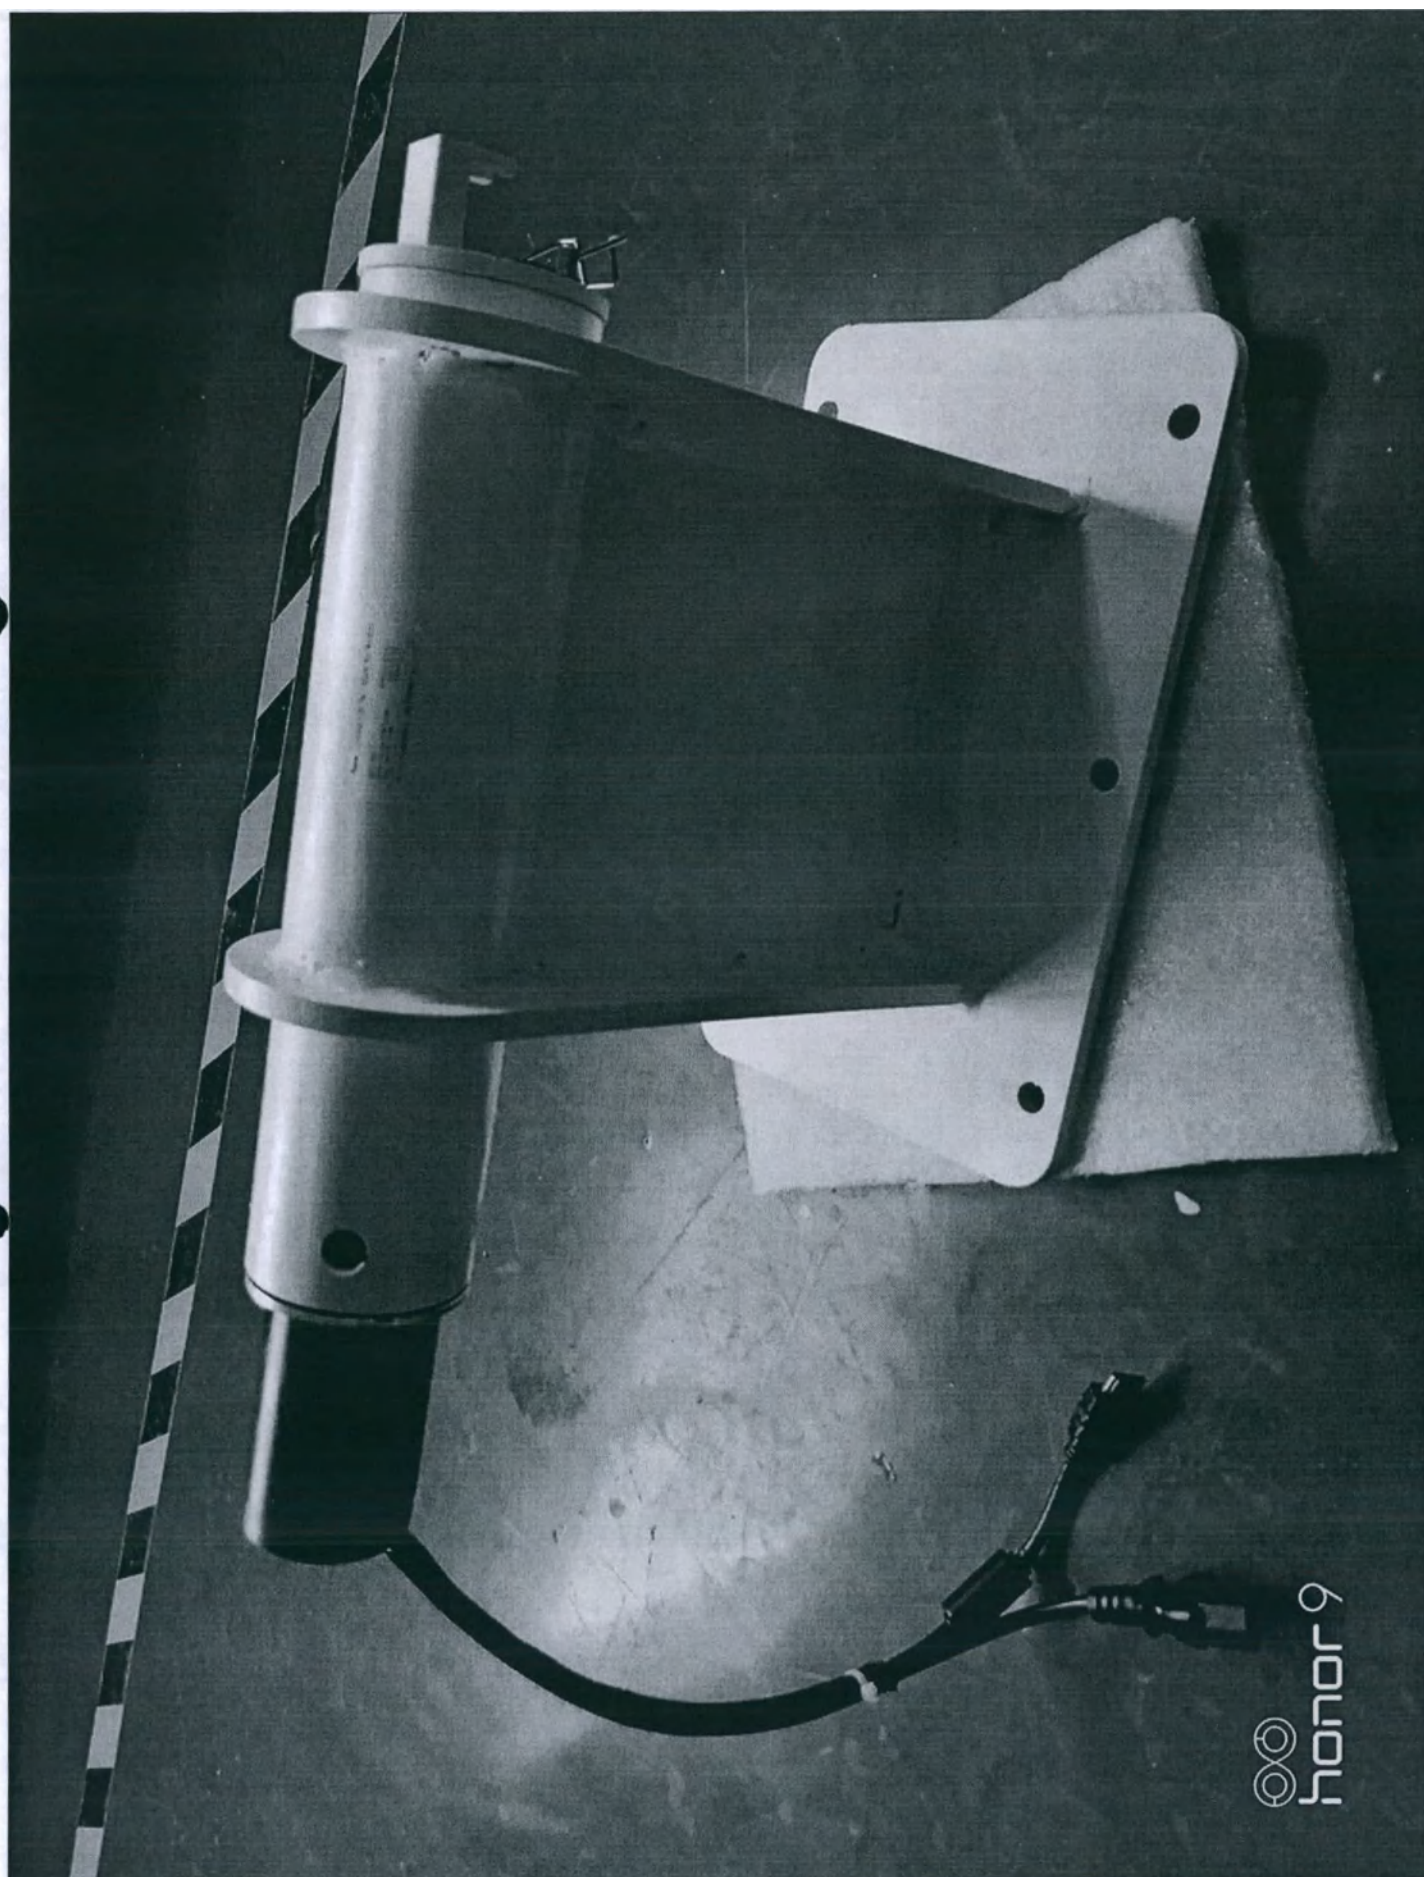

honor 9

6) Крепление настенное в высоком положении для АМ-6000 (при необходимости) – 1 шт. (High-position Wall Mount for AM-6000 (if necessary) – 1 pc.)

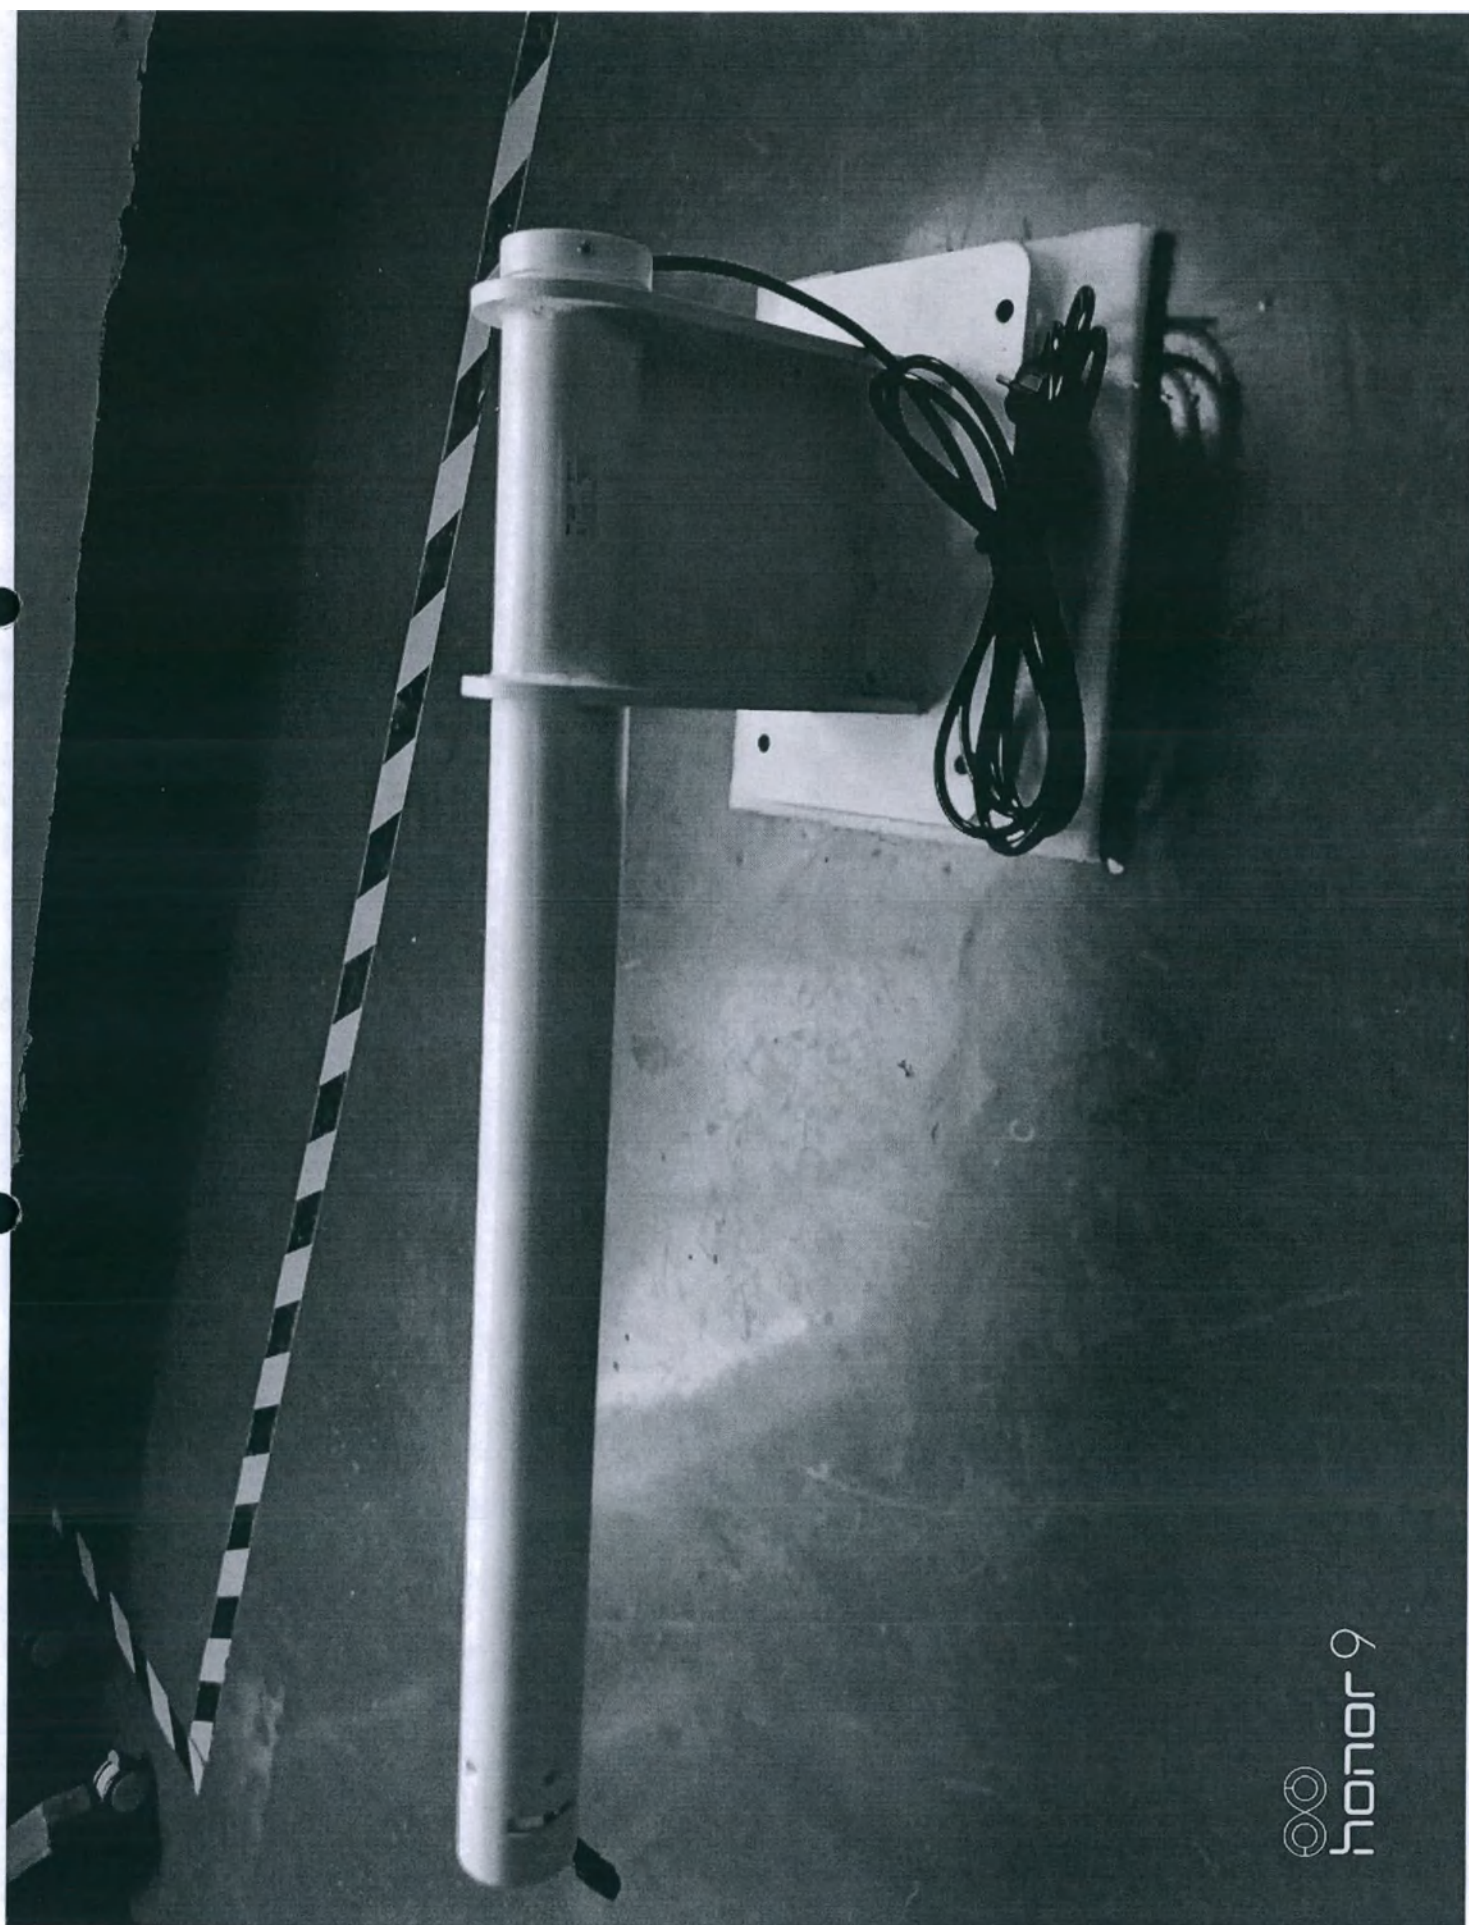


ГОРОД

7) Крепление настольное для АМ-6000 (при необходимости) – 1 шт. (Table mount for AM-6000 (if necessary) – 1 pc)




honor 9

8) Крепление настольное зажимное для АМ-6000 (при необходимости) – 1 шт. (Table clamp mount for AM-6000 (if necessary) – 1 pc)

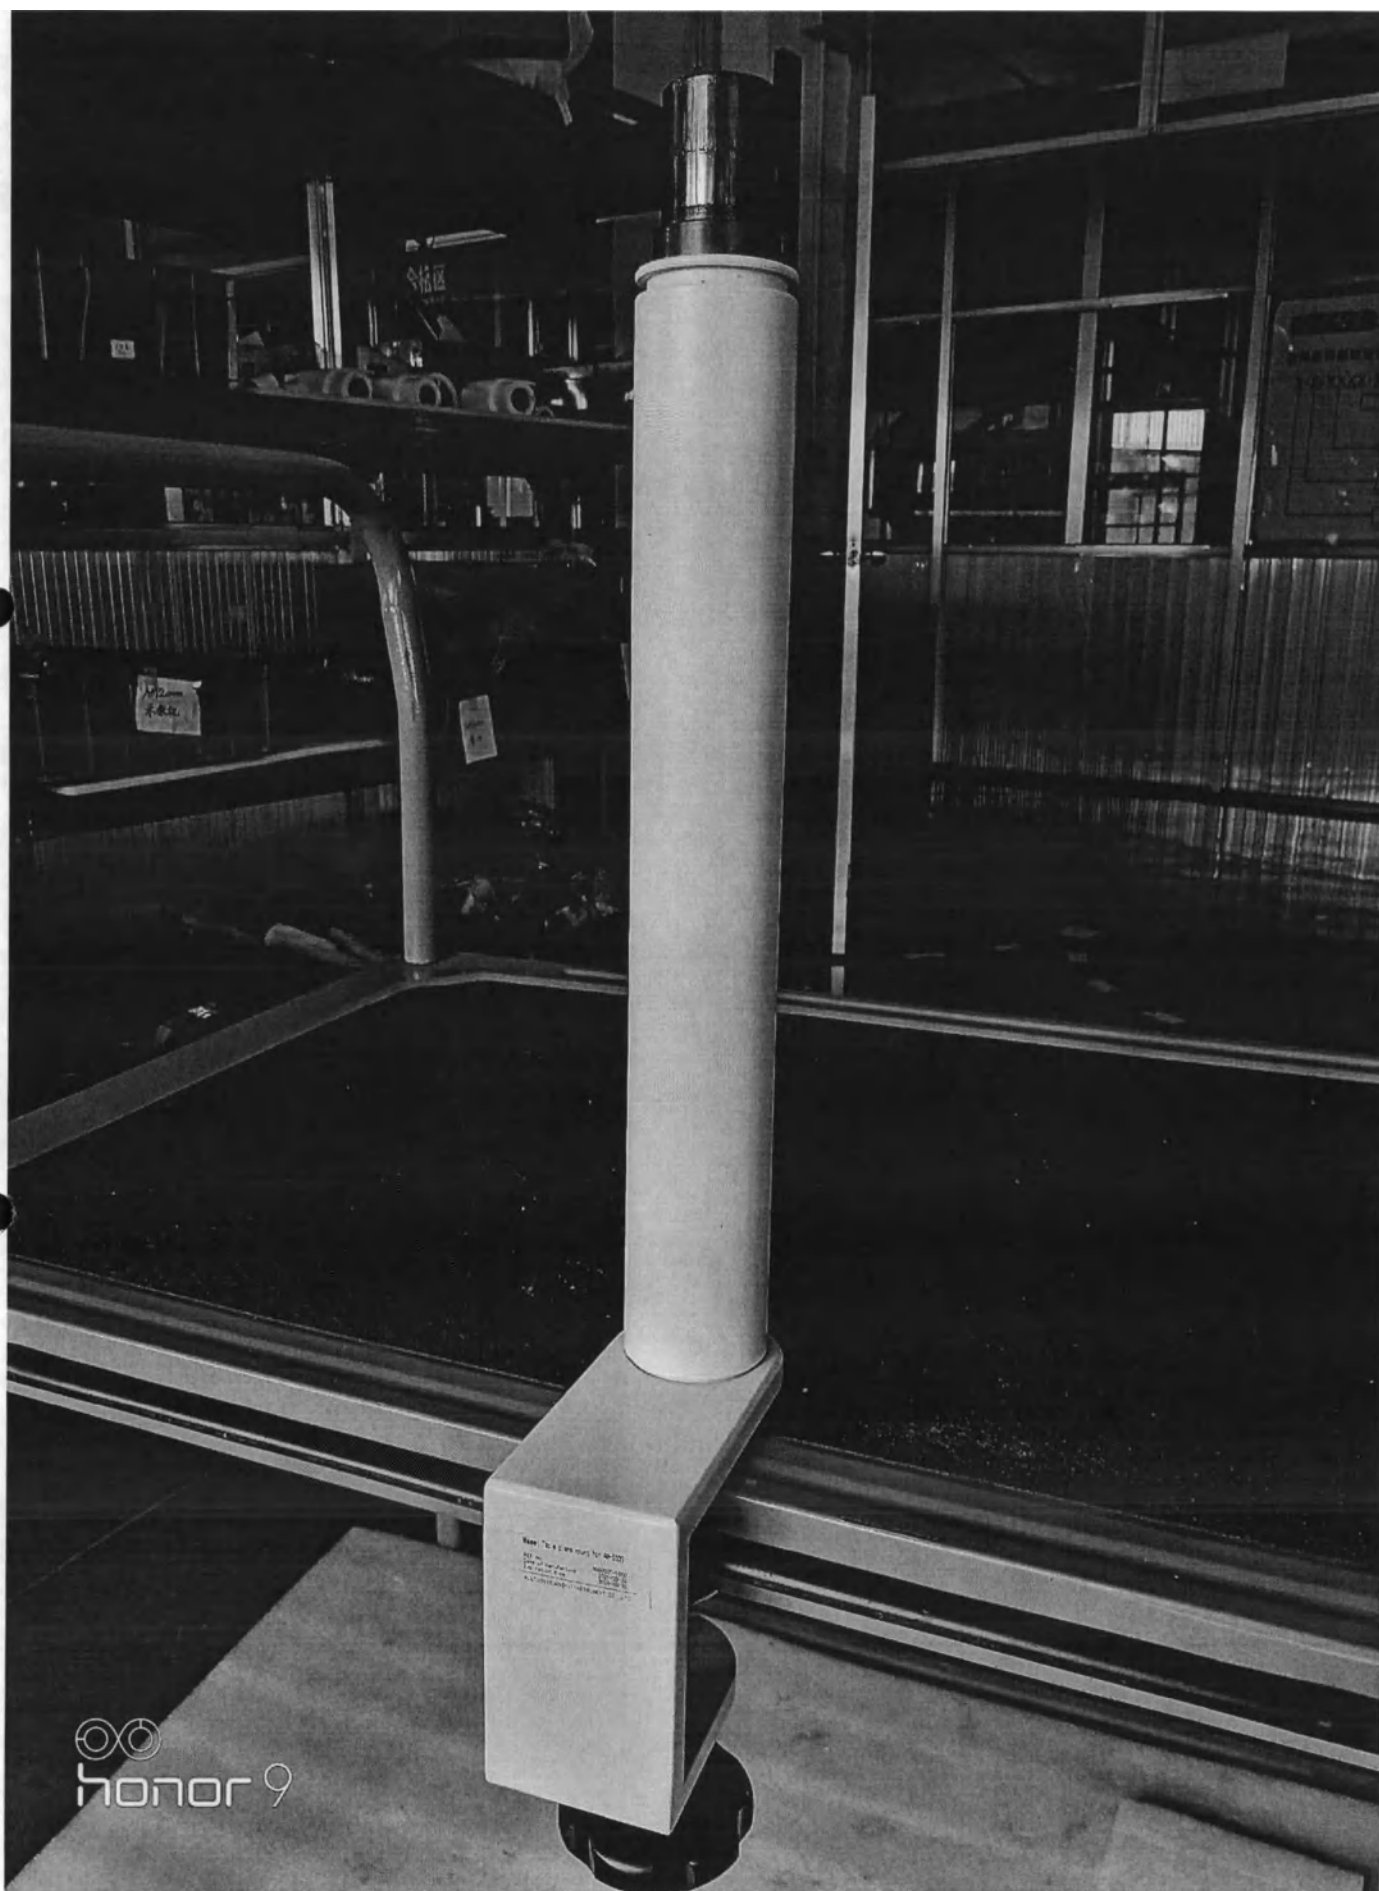


honor 9

9) Рычаг первый нормальный (при необходимости) – 1 шт. (The First Arm (Normal Installation)(if necessary) – 1 pc.)

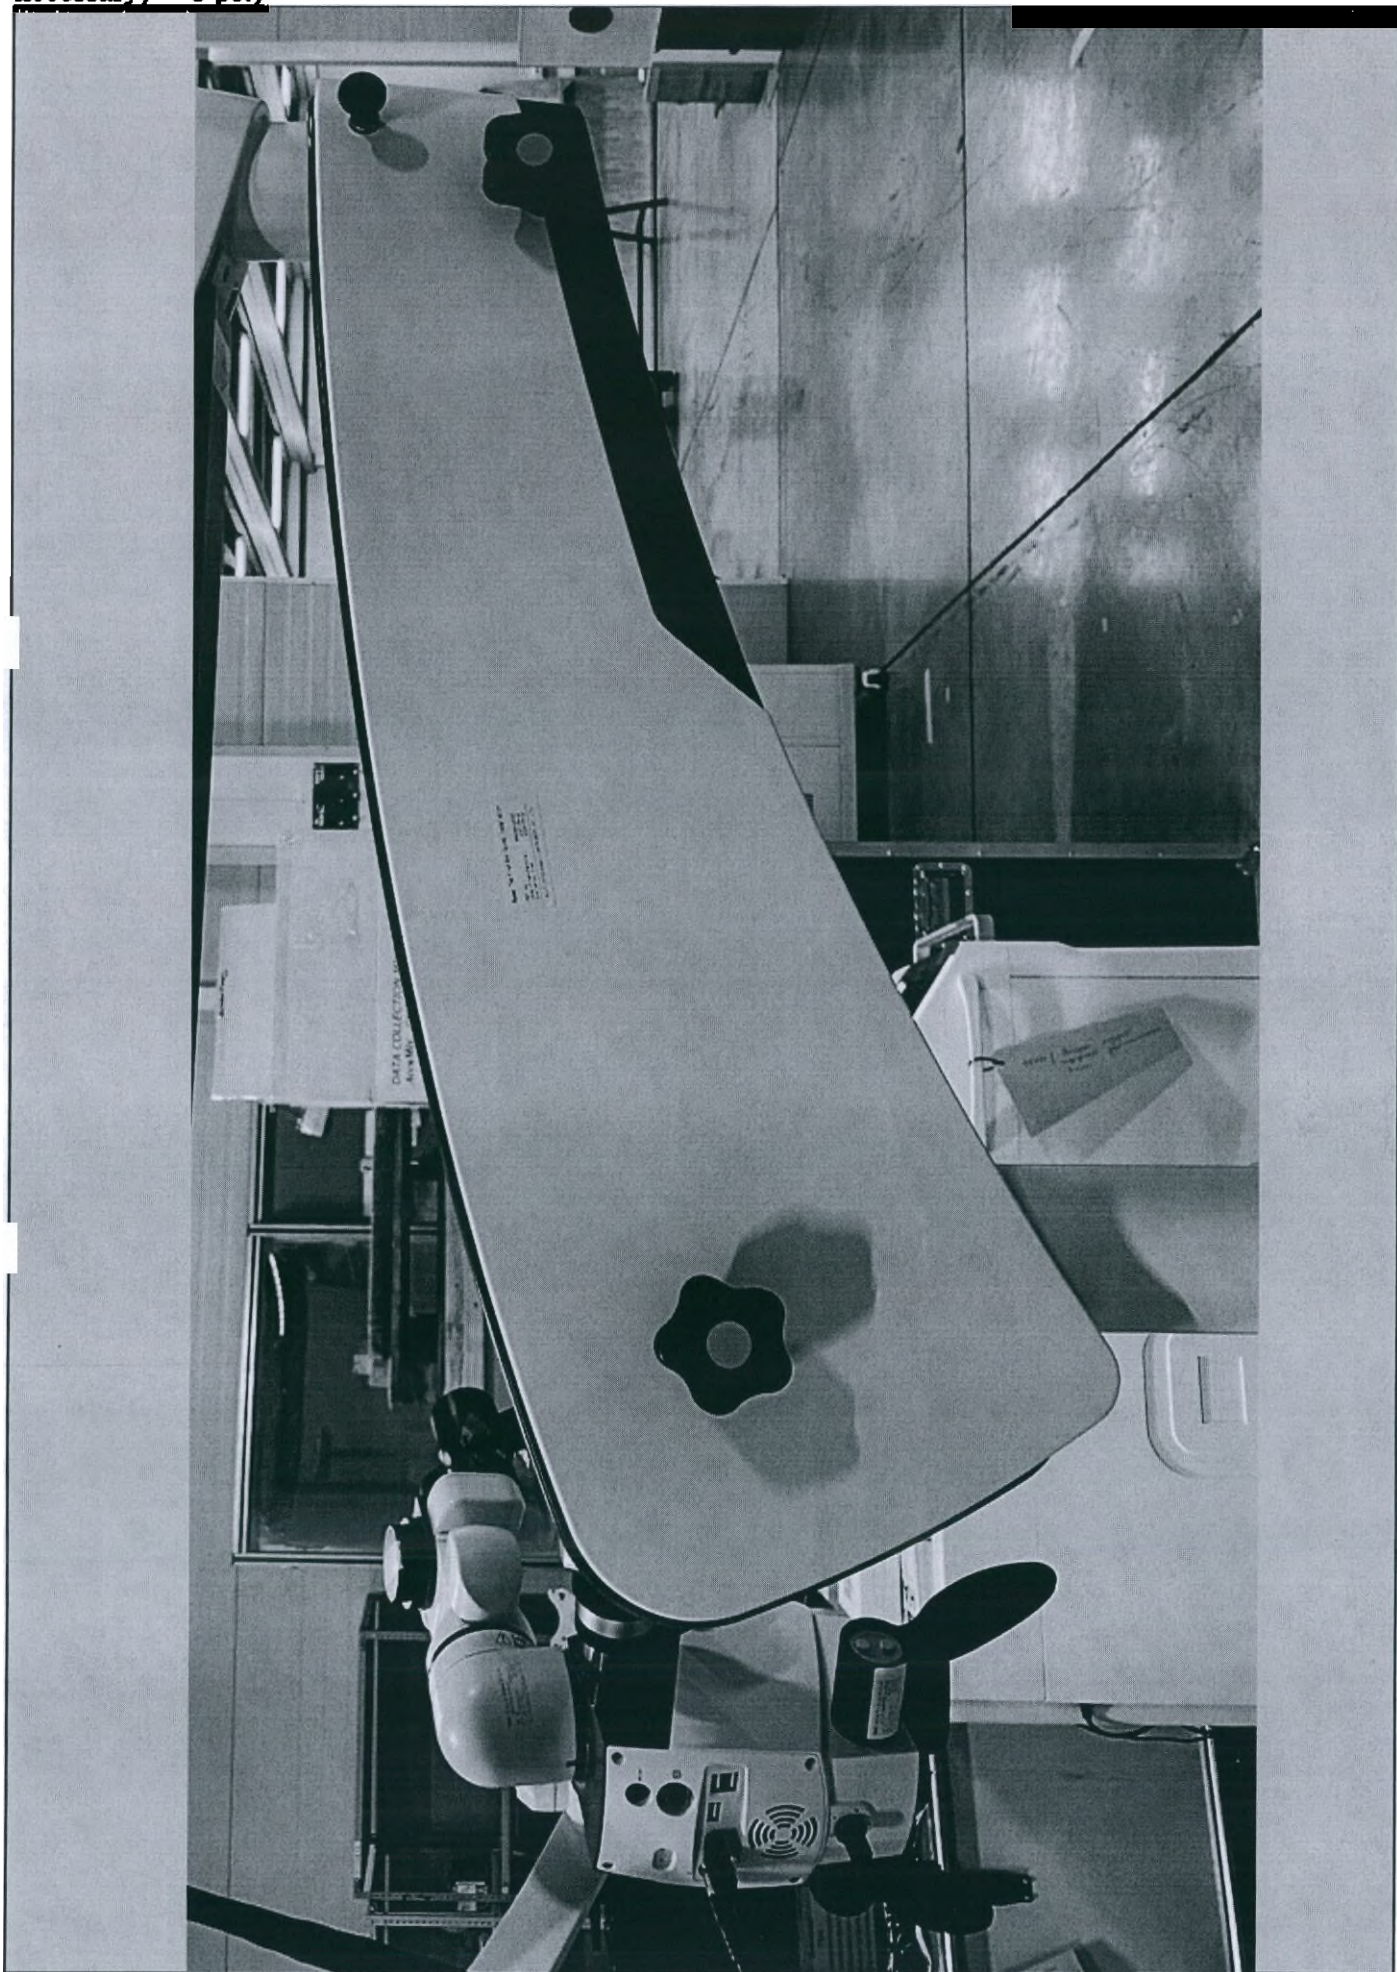


10) Рычаг первый подъемный (при необходимости) – 1 шт. (The First Arm (Hoisting Installation) (if necessary) – 1 pc)

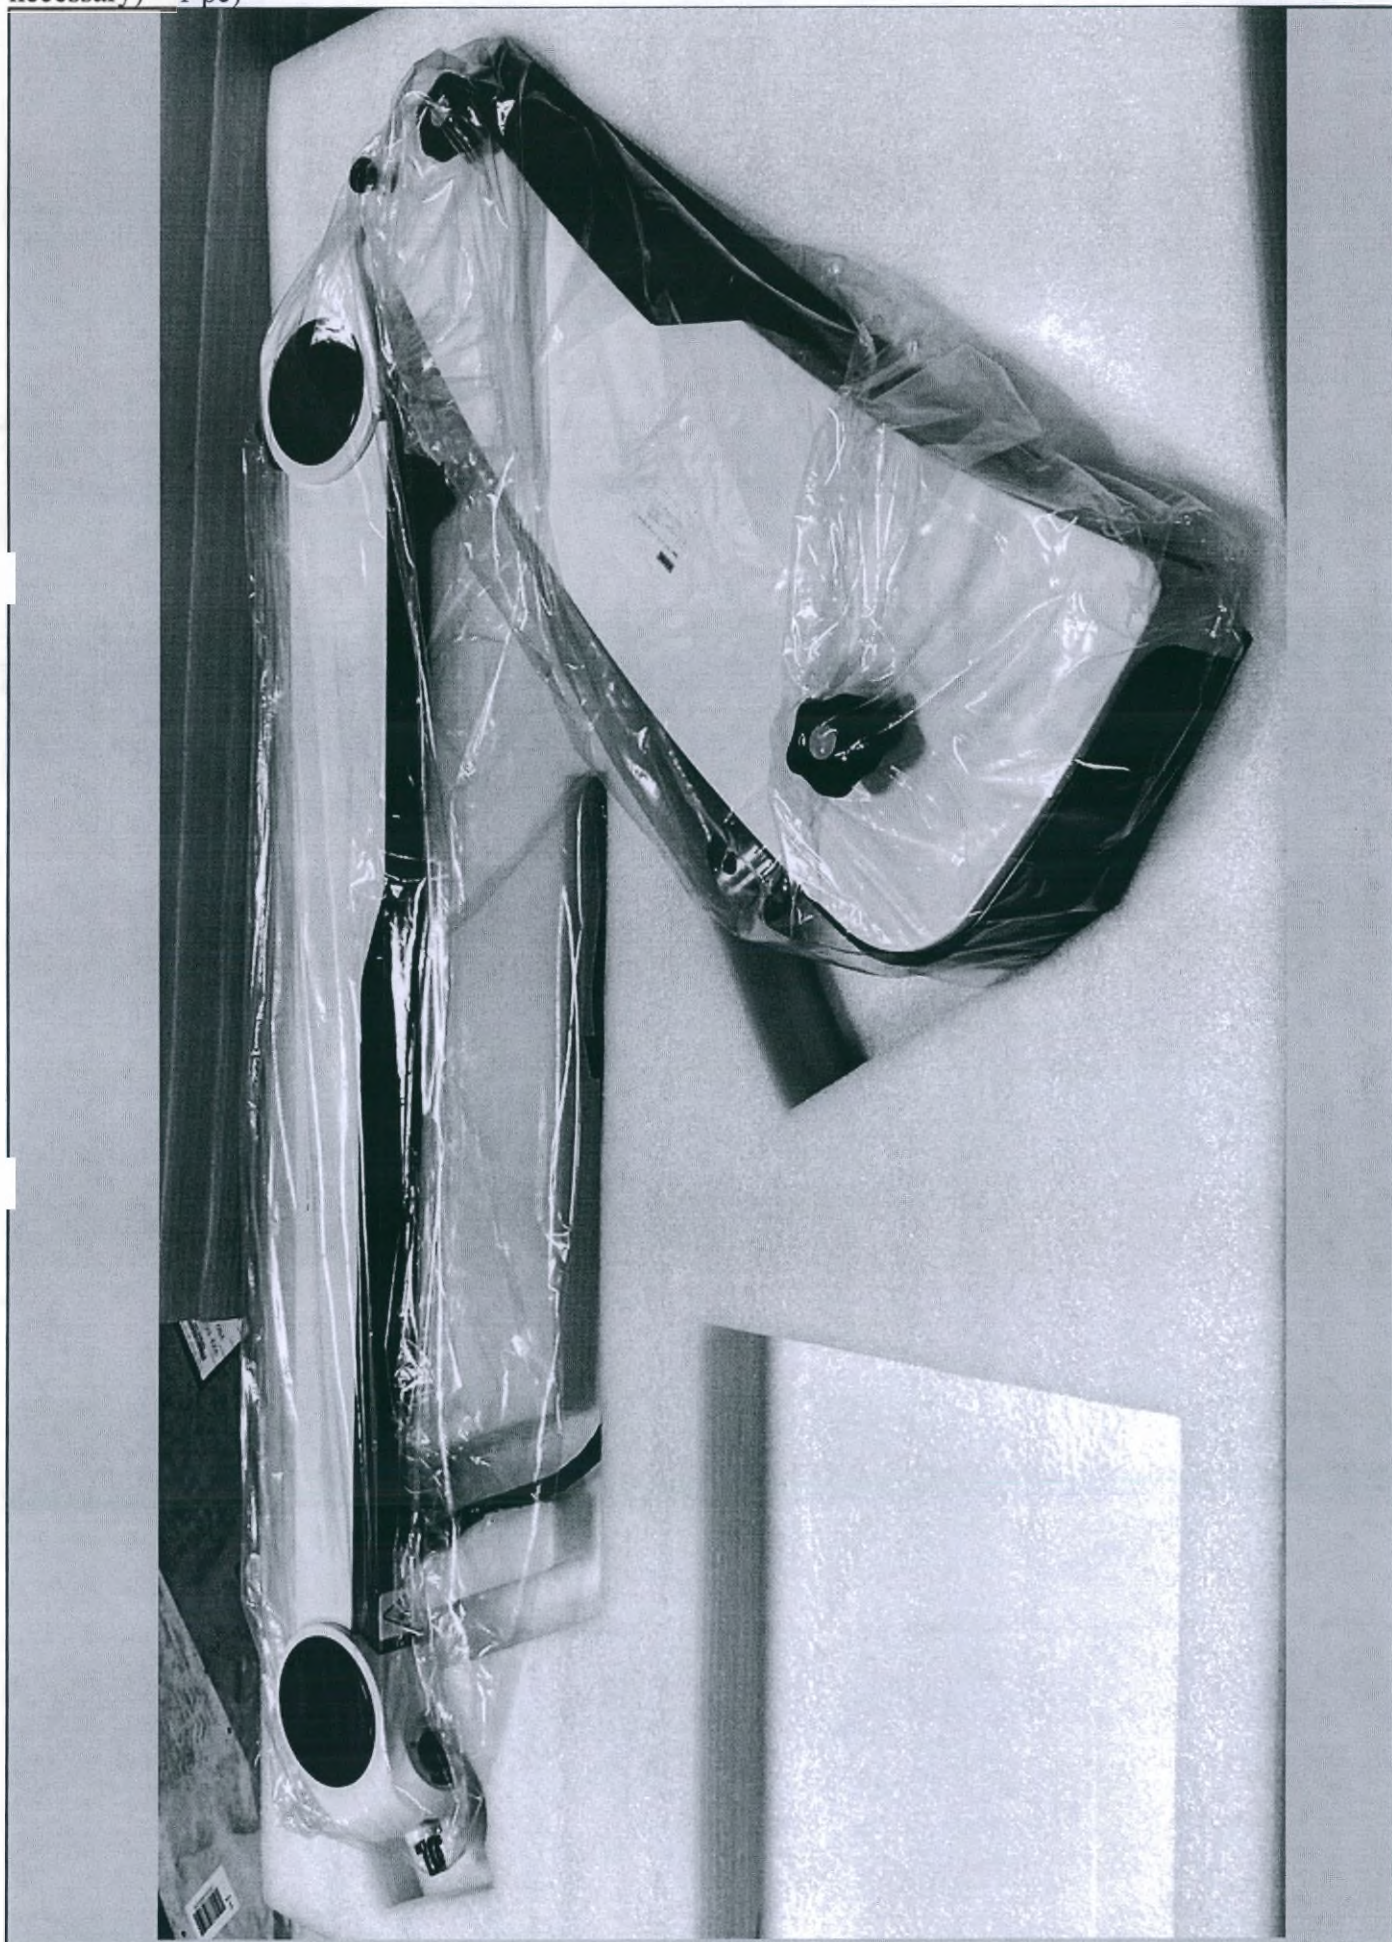


11) Рычаг первый настольный (при необходимости) – 1 шт. (The First Arm (Table Installation) (if necessary) – 1 pc.)




12) Рычаг второй настольный (при необходимости) – 1 шт. (The Second Arm (Table Installation) (if necessary) – 1 pc.)

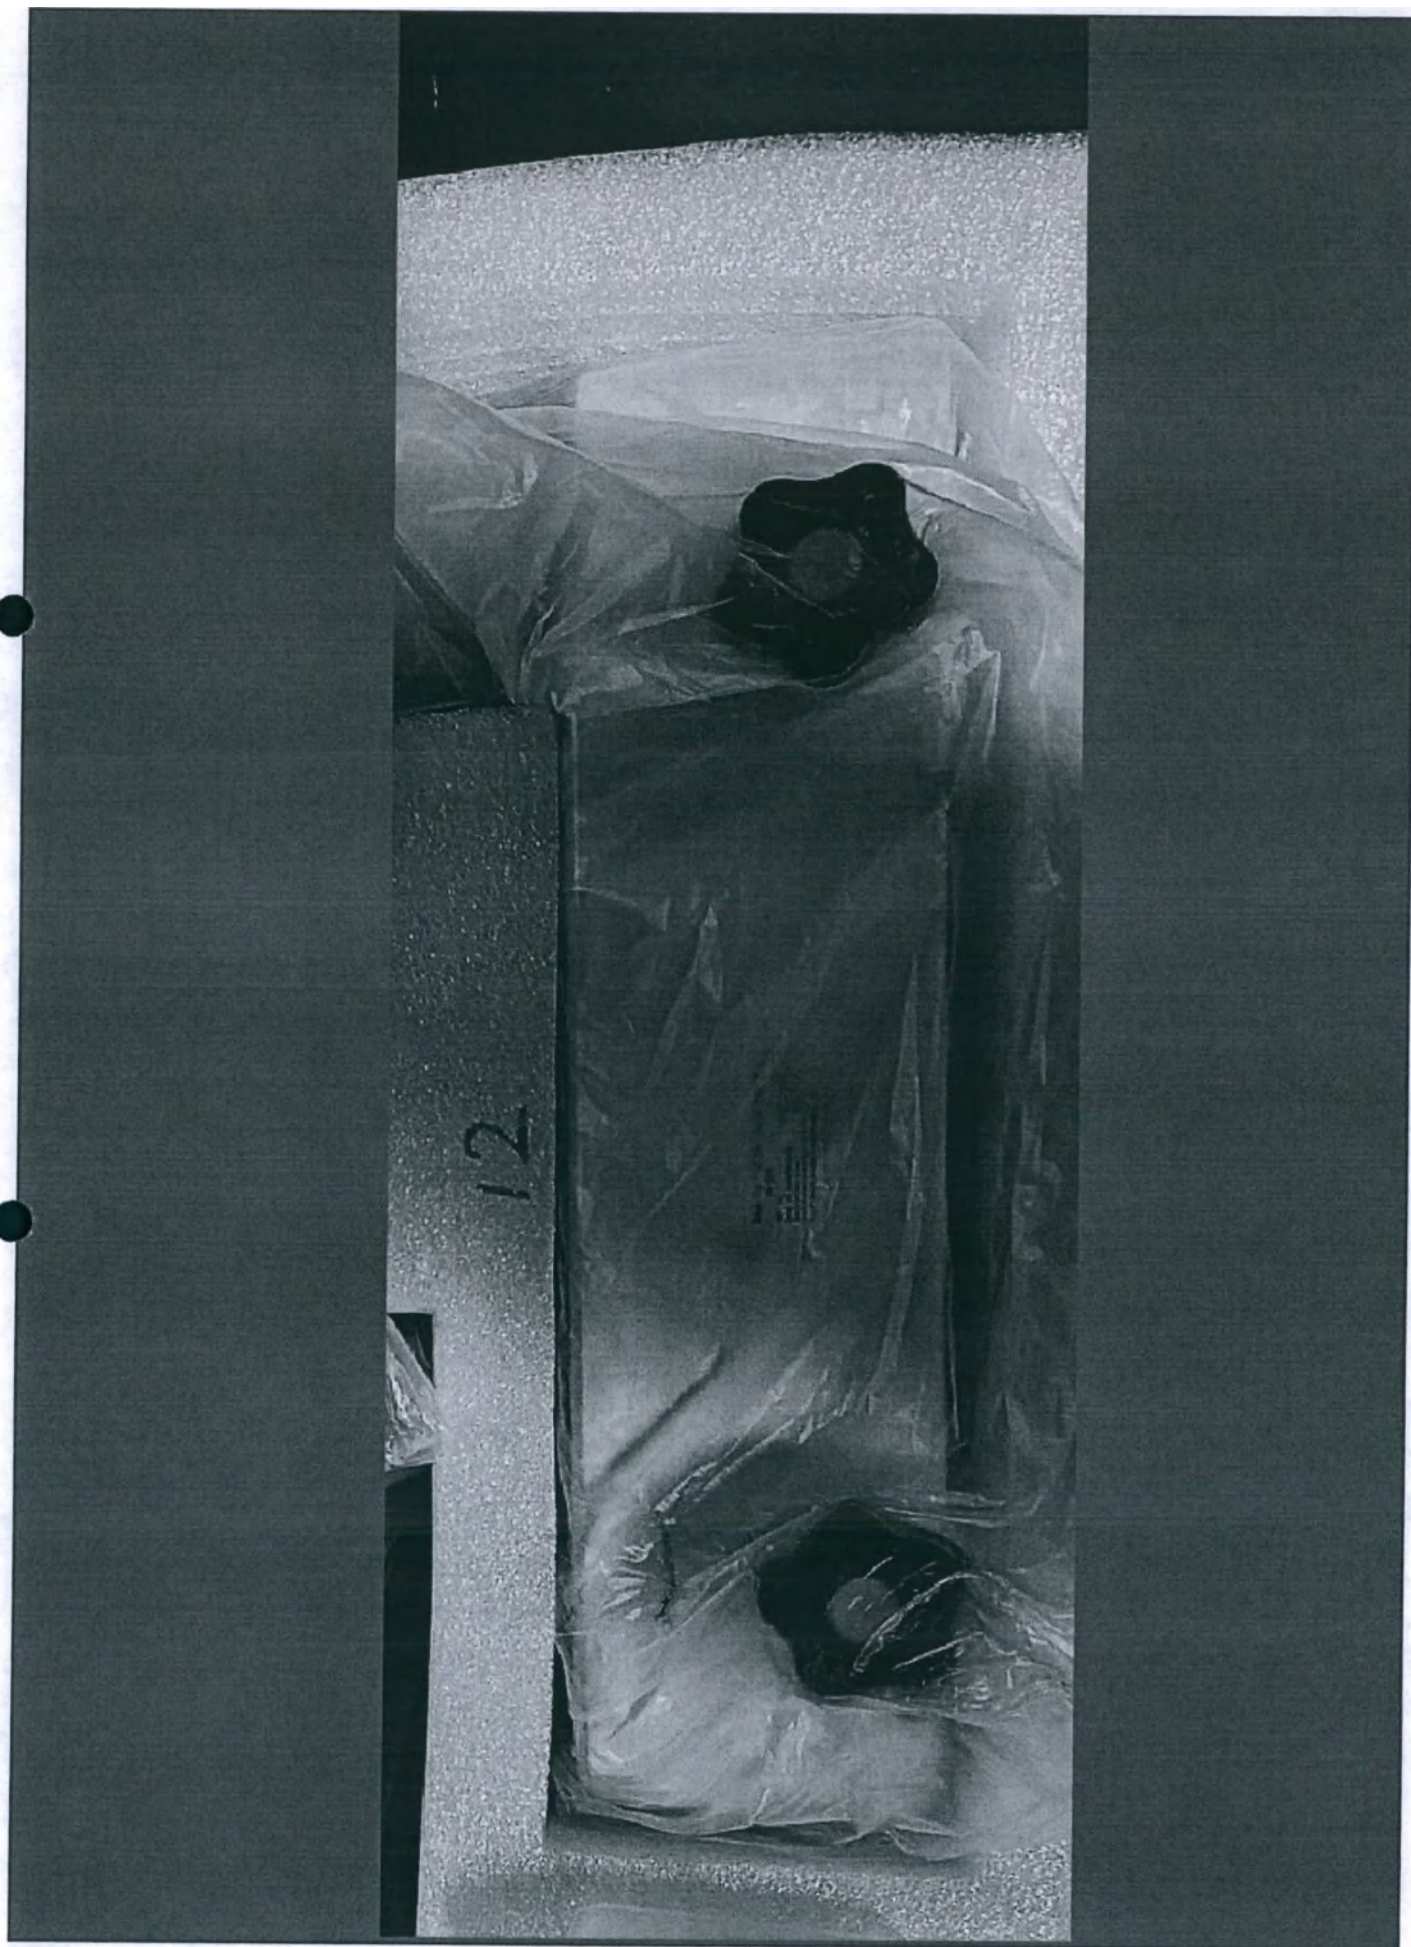


13) Рычаг второй подъемный 950mm (при необходимости) – 1 шт. (The Second Arm 950mm (if necessary) – 1pc.)

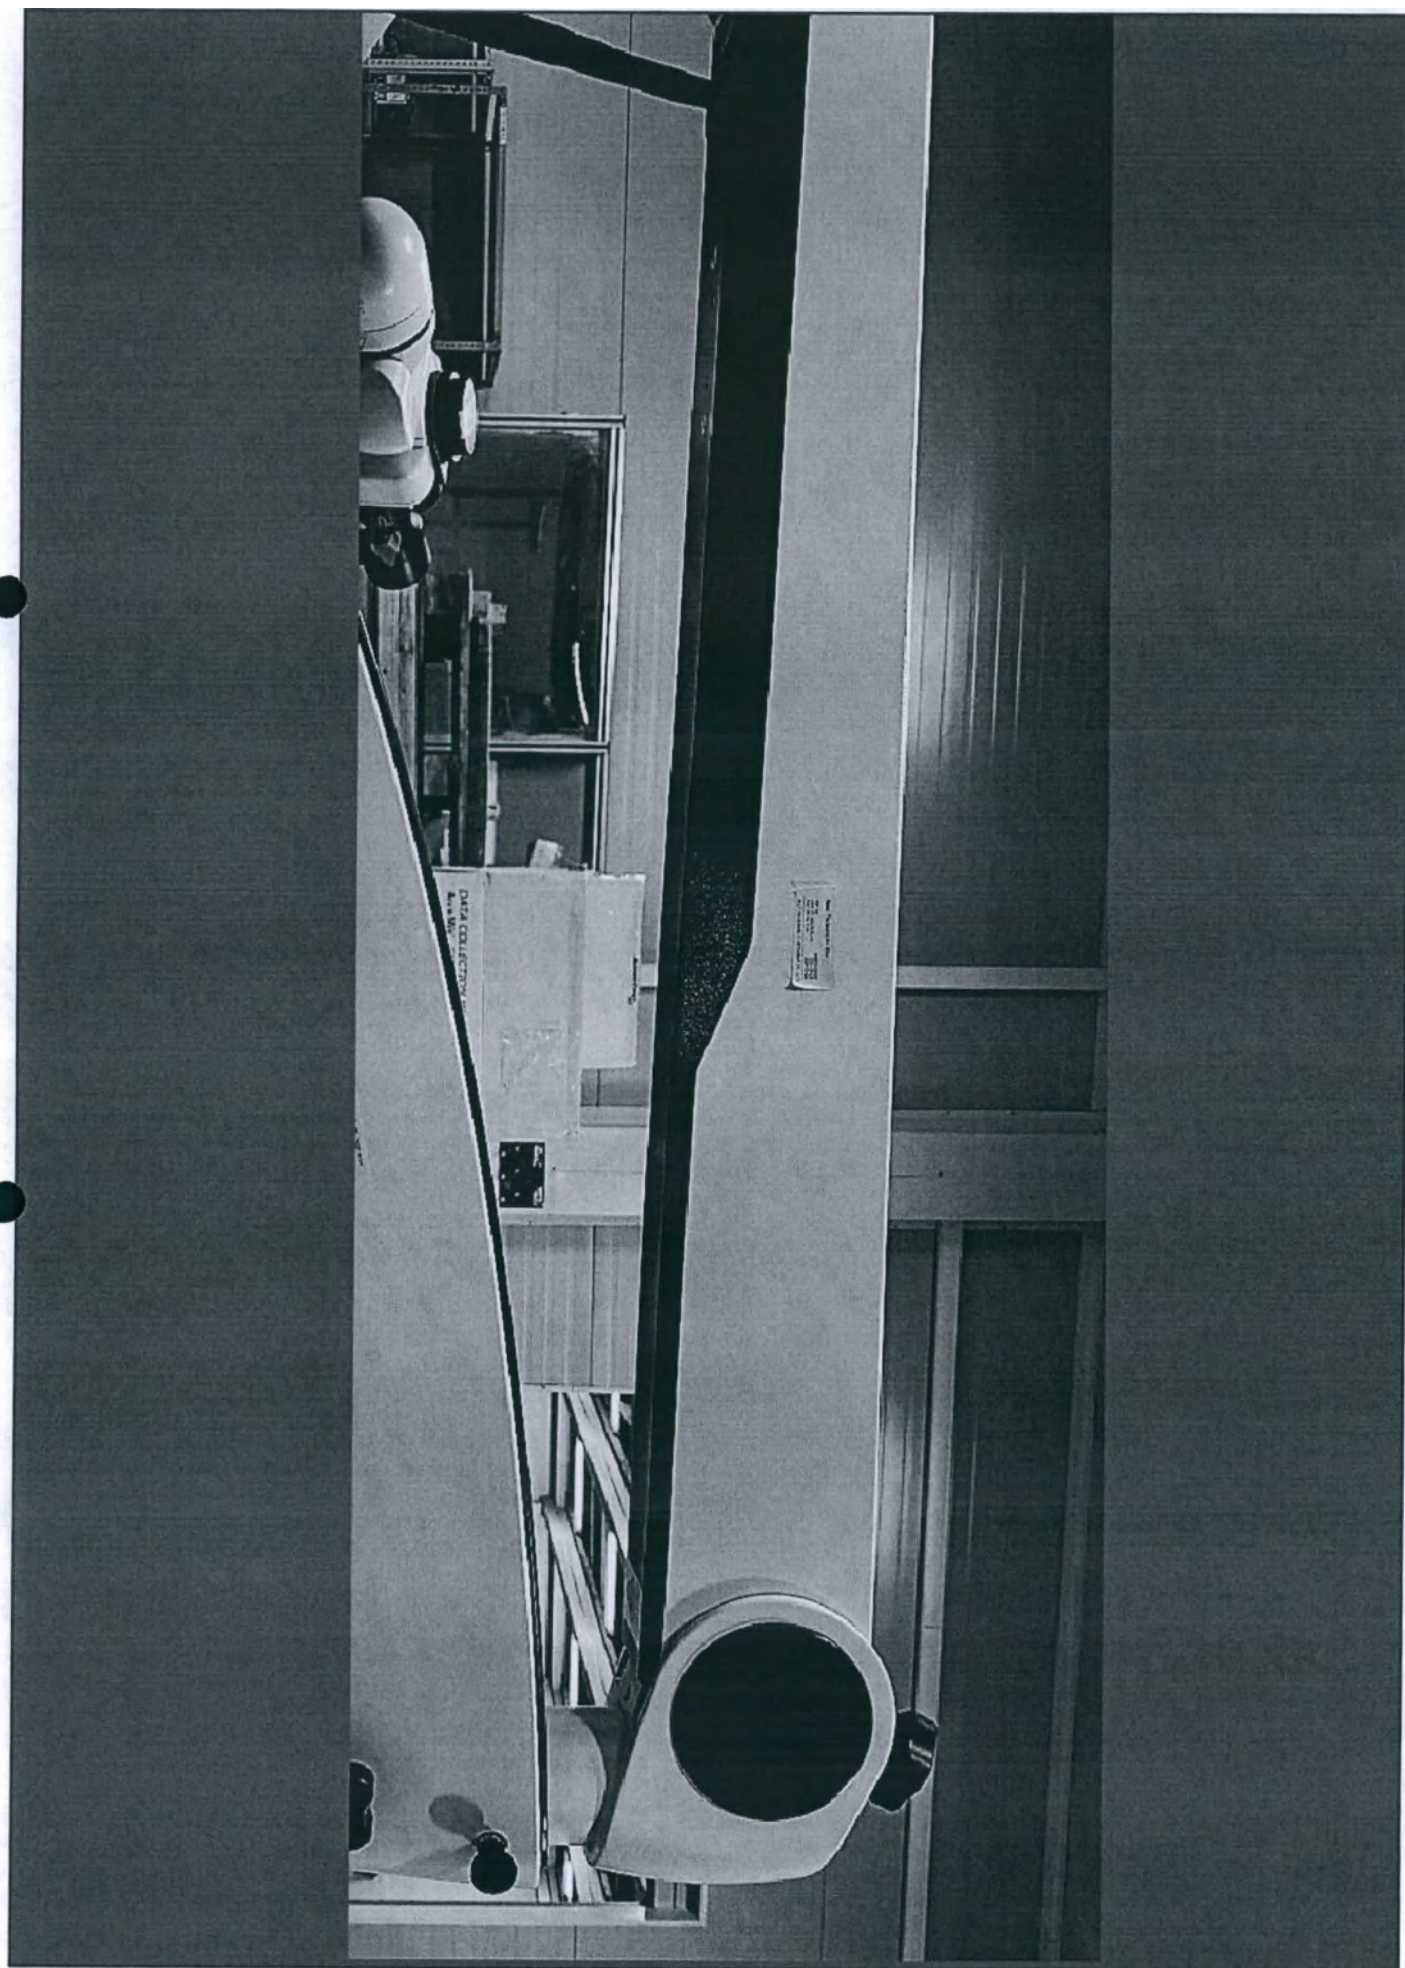

14) Рычаг балансирующий для АМ-6000 (Balance Arm for AM-6000)

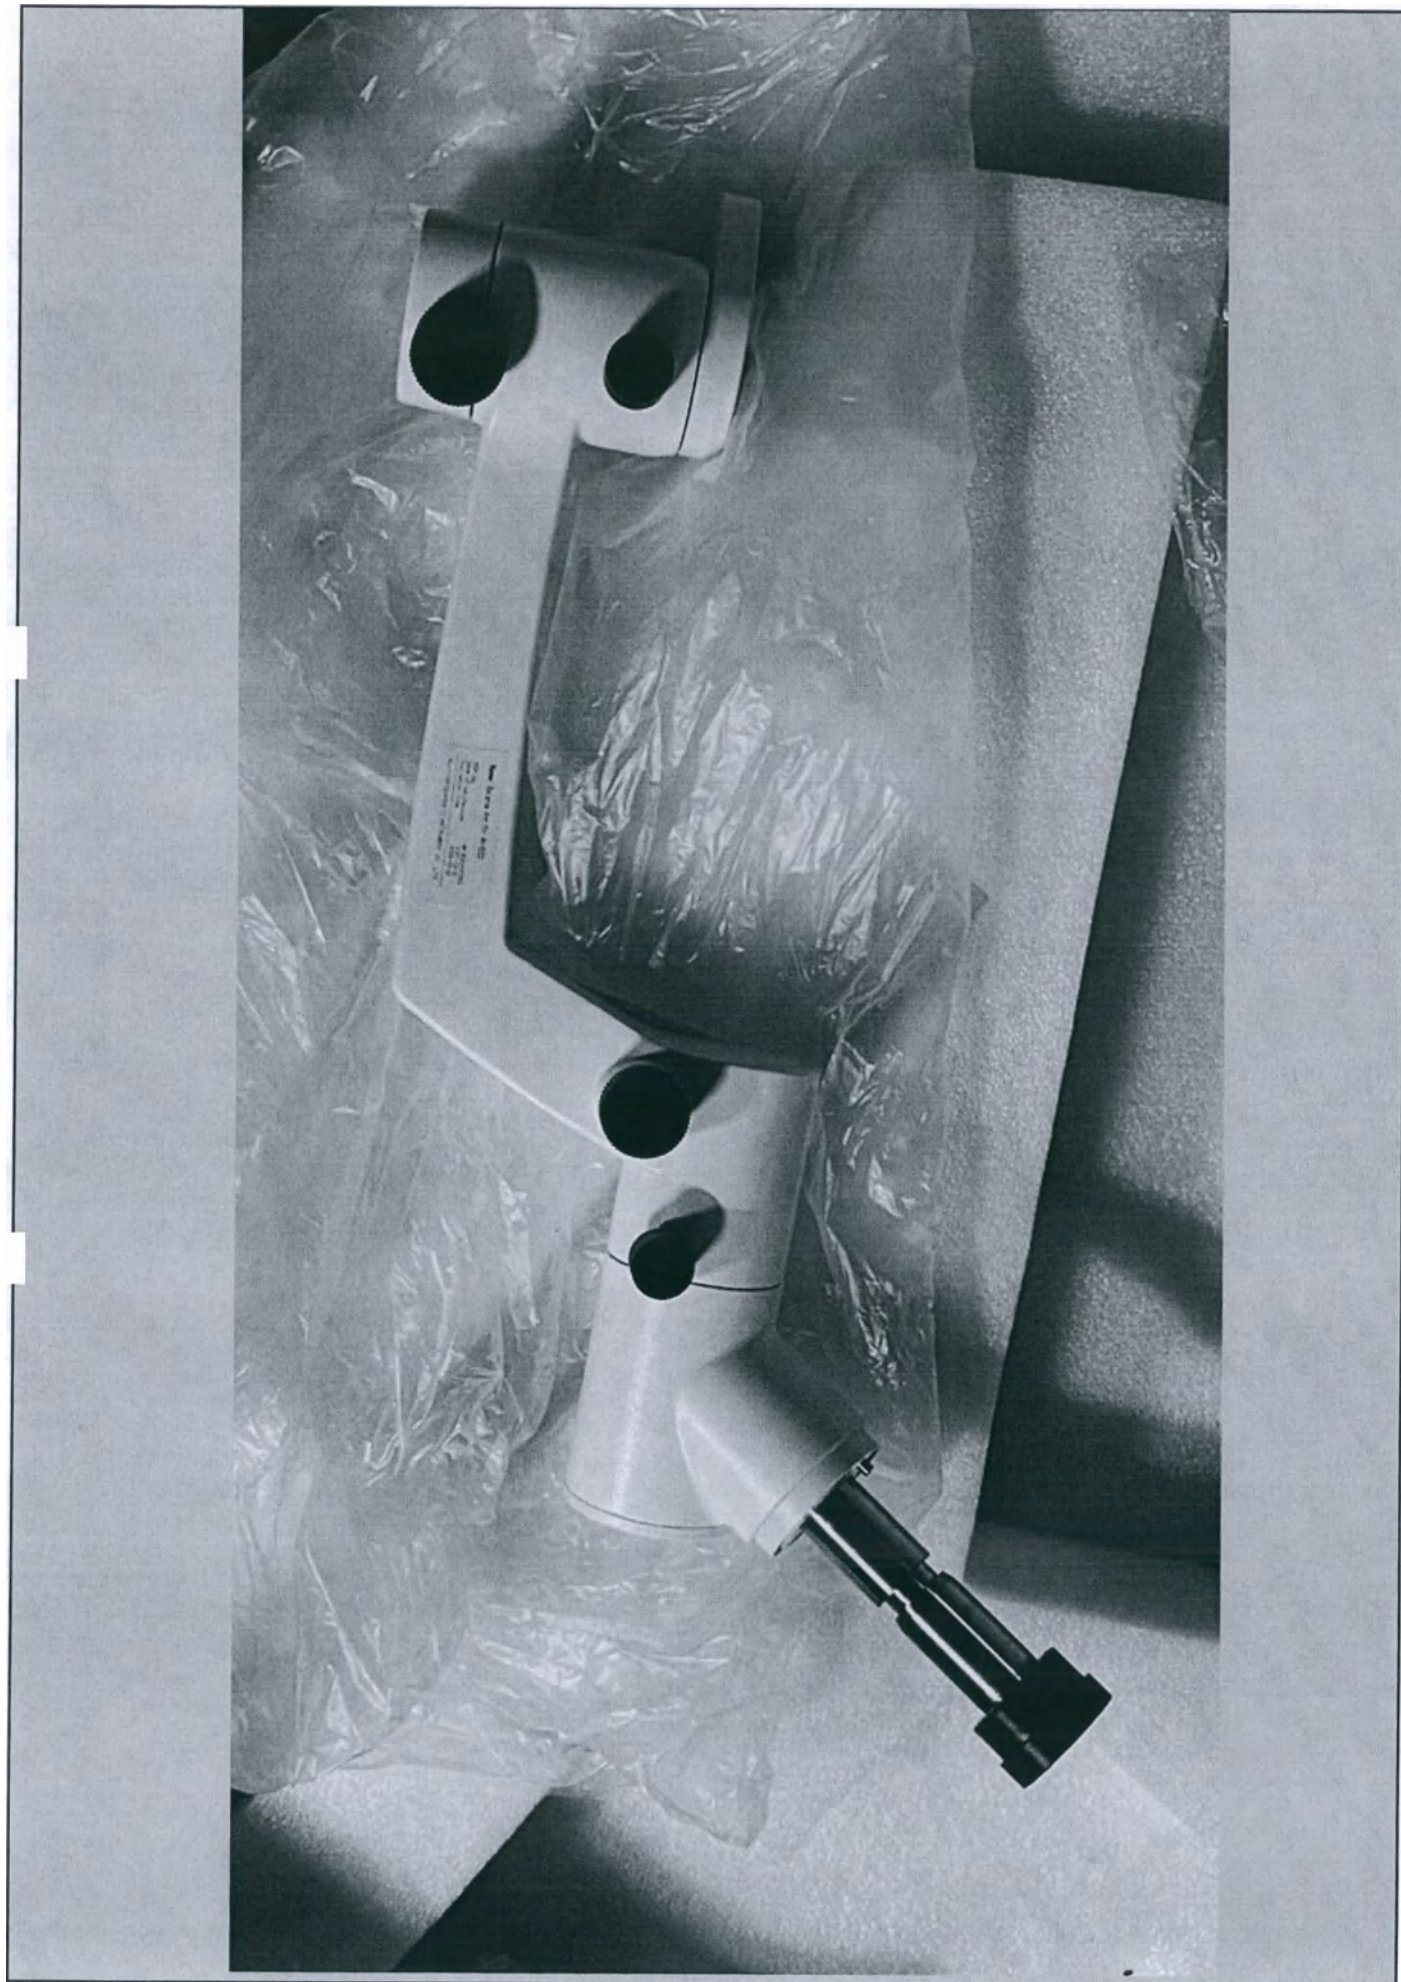


15) Рычаг соединительный под 120° для AM-6000 (при необходимости) – 1 шт. (120 Degrees Connecting Arm for AM-6000 (if necessary) – 1 pc.)

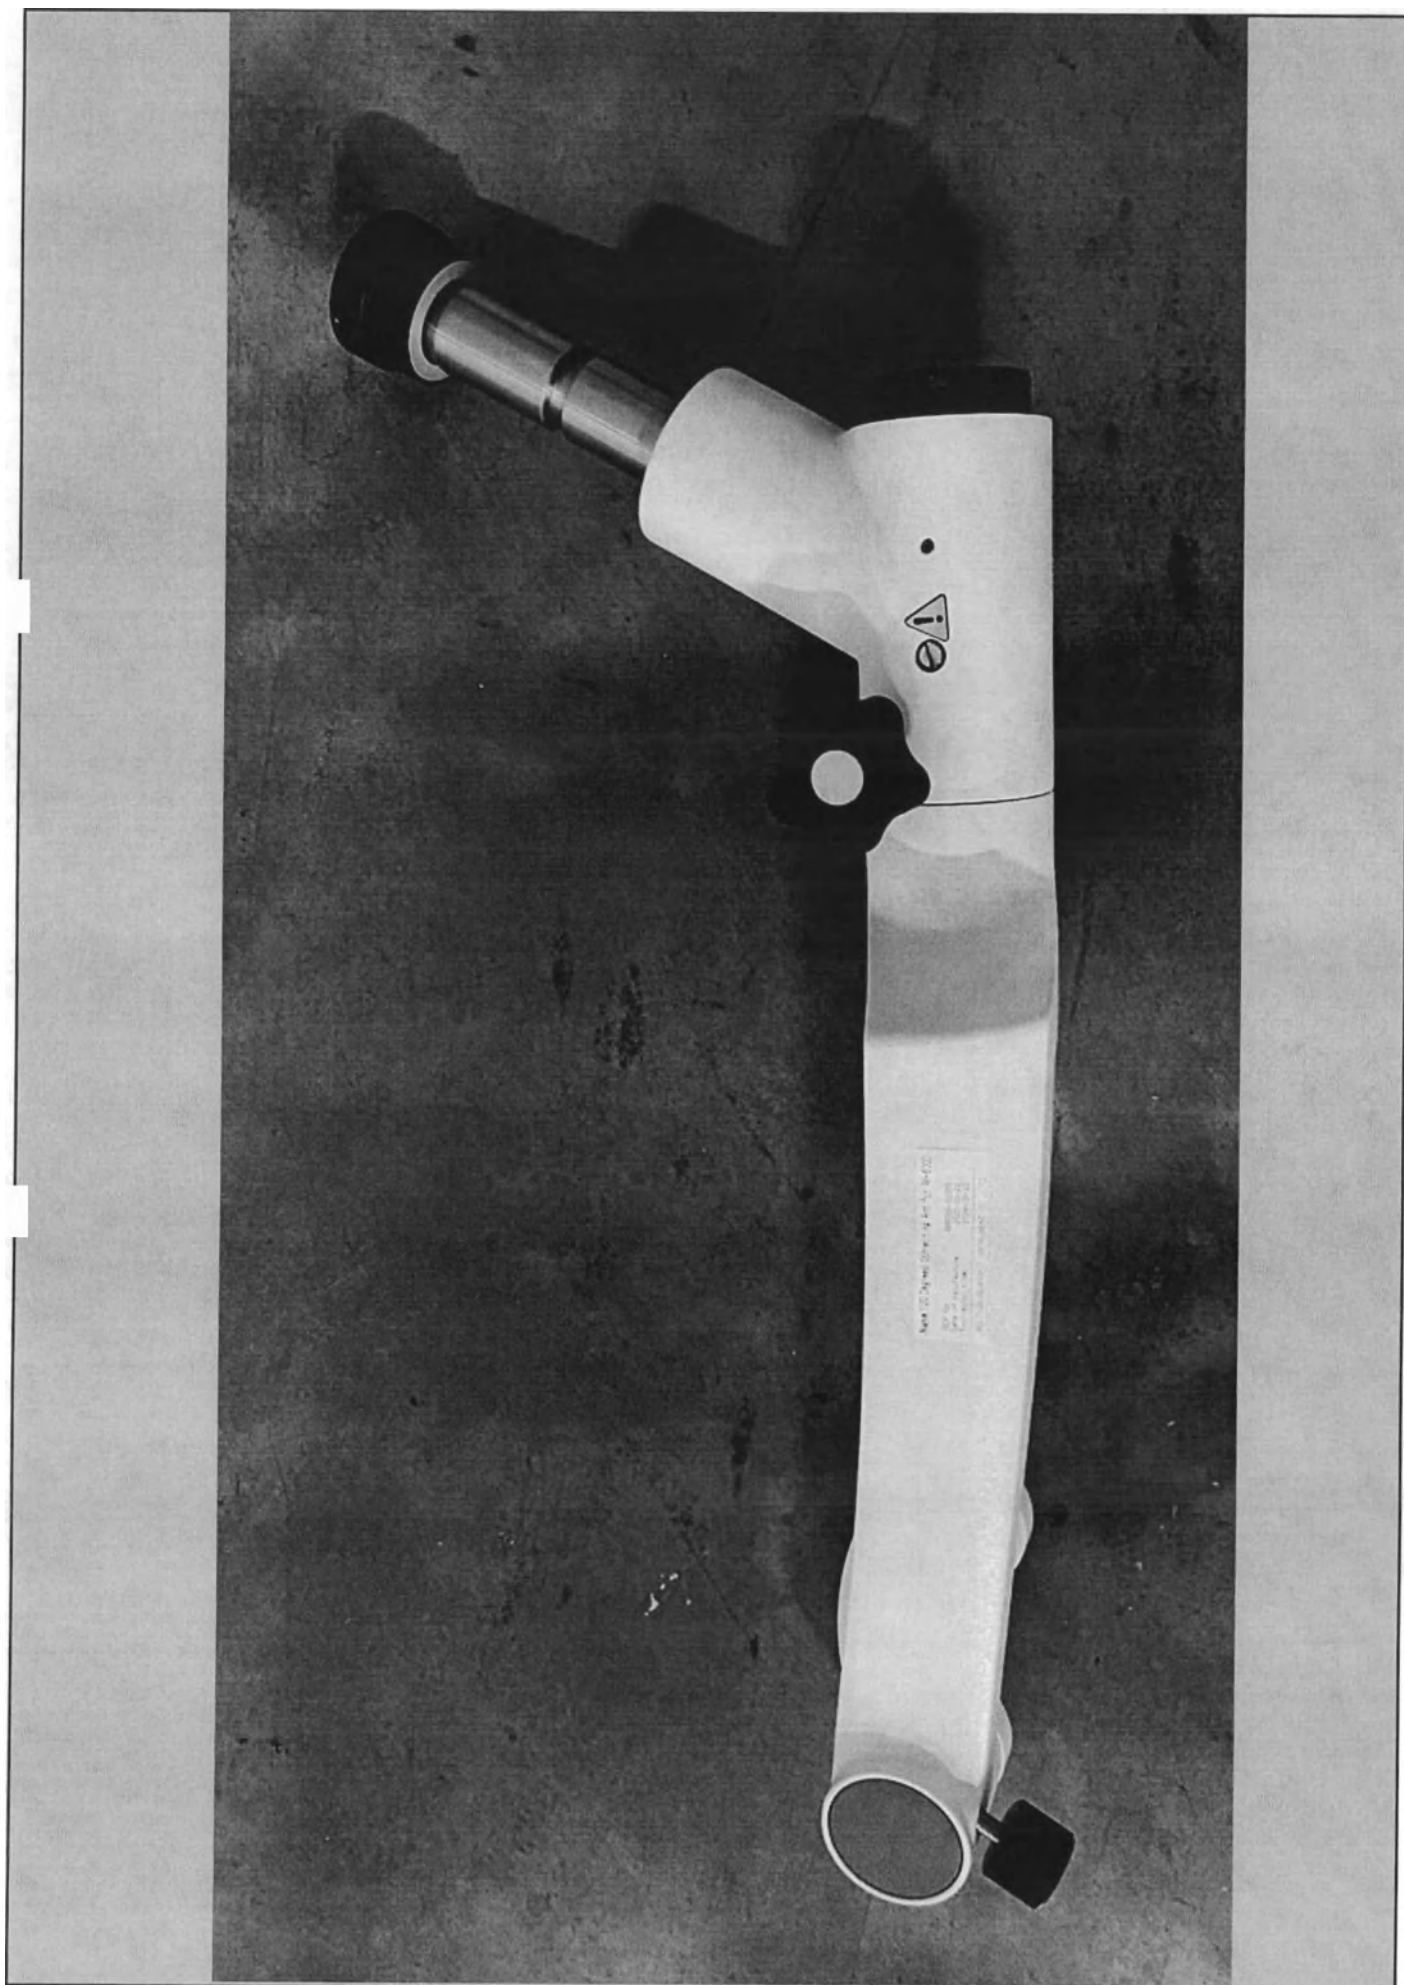


16) Рычаг соединительный для перемещения оптического блока микроскопа АМ-6000 (при необходимости) – 1 шт. (Lever connecting for moving the optical unit of the microscope AM-6000 (if necessary) – 1 pc.)



17) Рукоятки для перемещения оптического блока микроскопа АМ-6000 (при необходимости) – 1 шт.
(Handles for moving the optical unit of the AM-6000 microscope (if necessary) – 1 pc.)

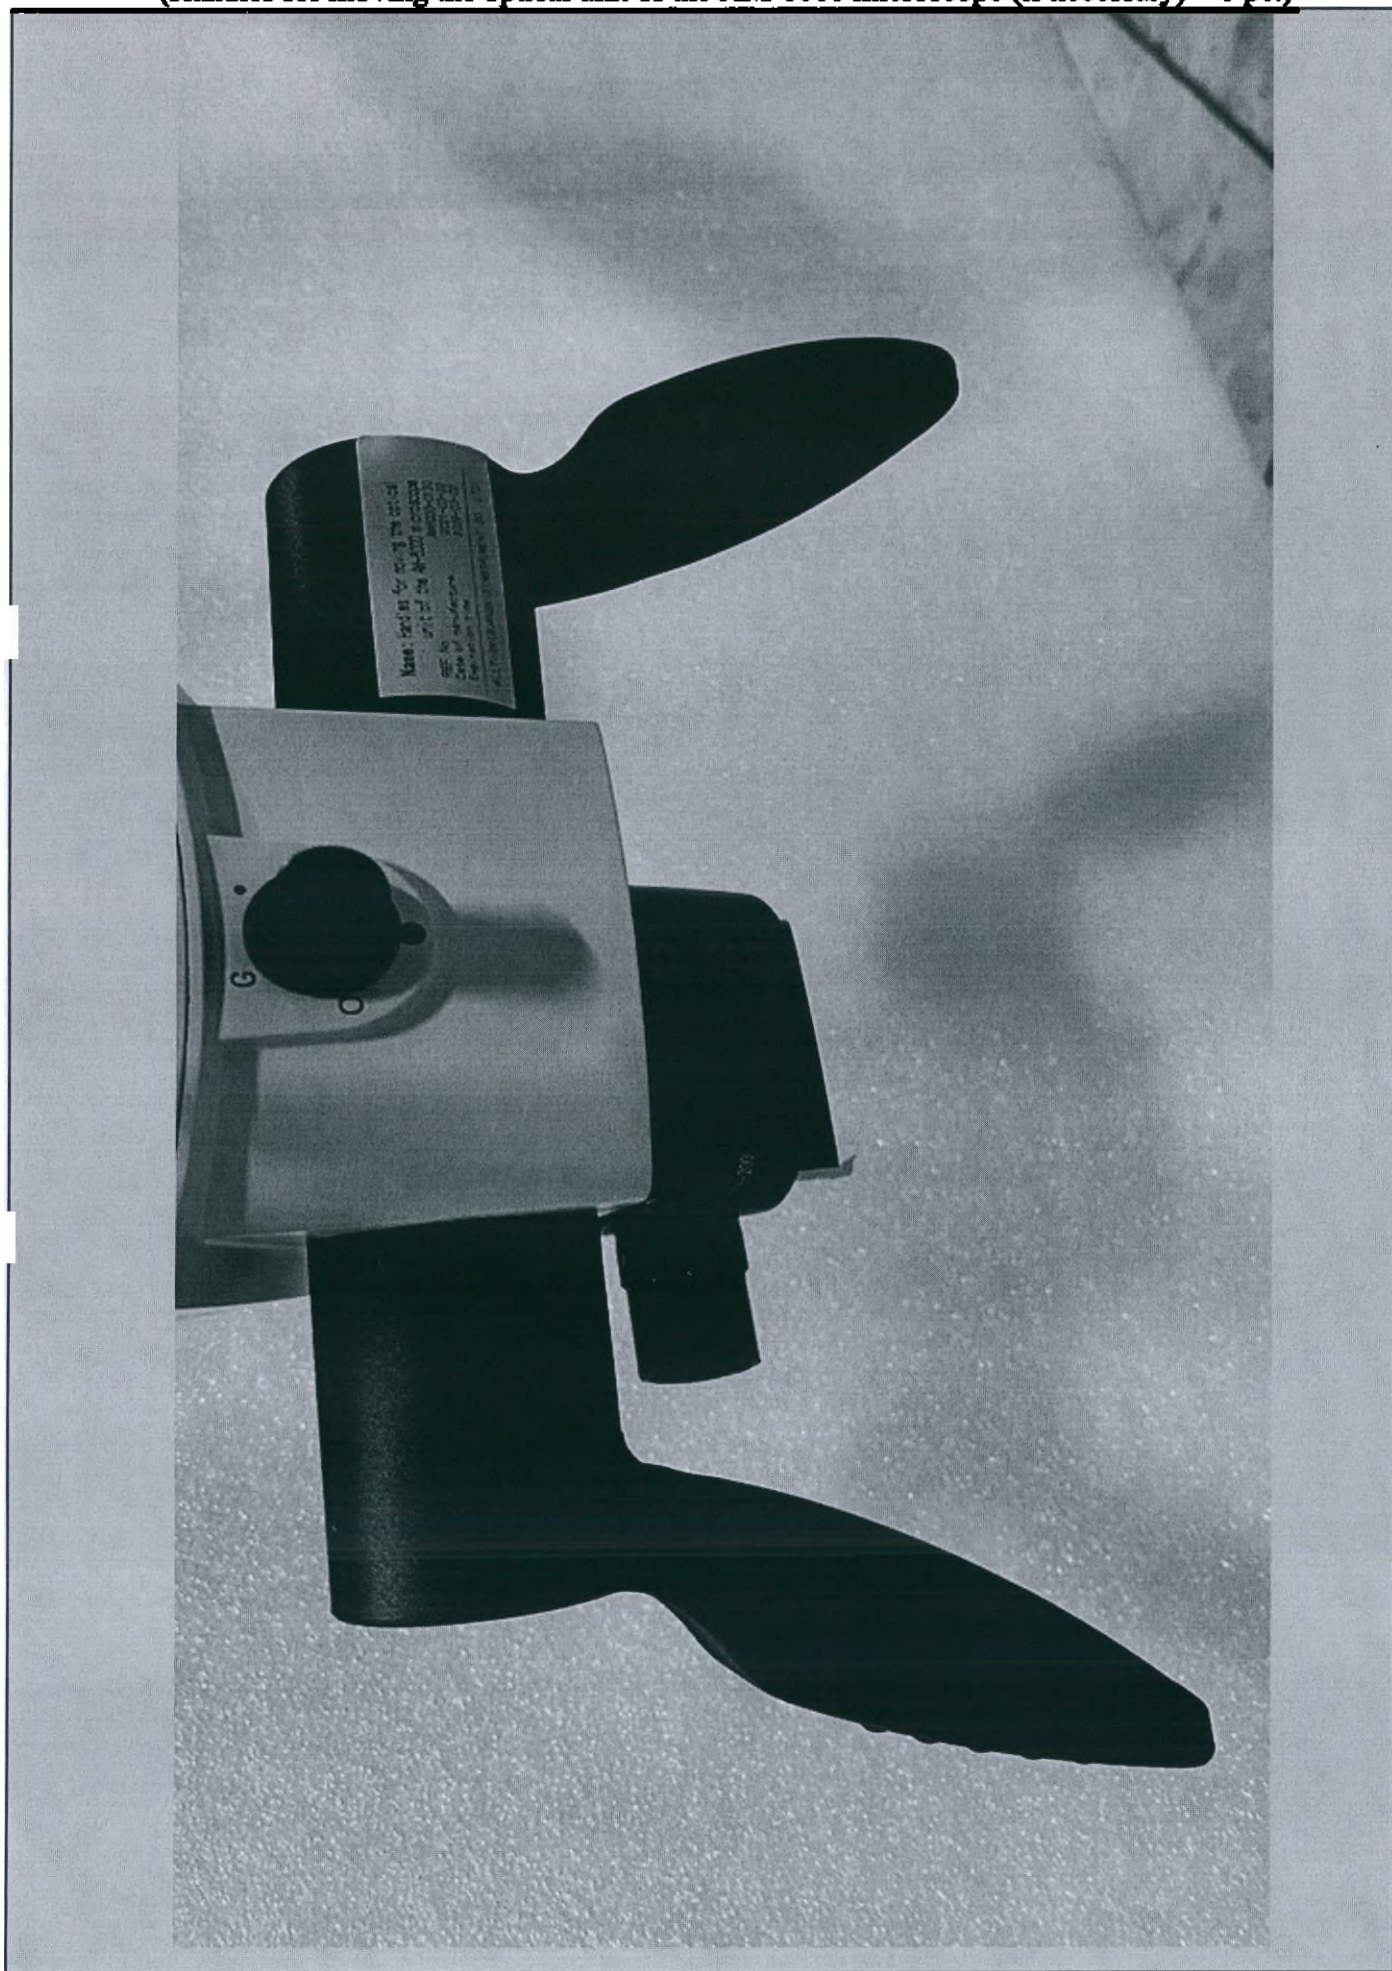


18) Рукоятка Т-образная для перемещения оптического блока микроскопа АМ-6000 (при необходимости) – 1 шт. (T-shape Handle for moving the optical unit of the AM-6000 microscope (if necessary) – 1 pc)

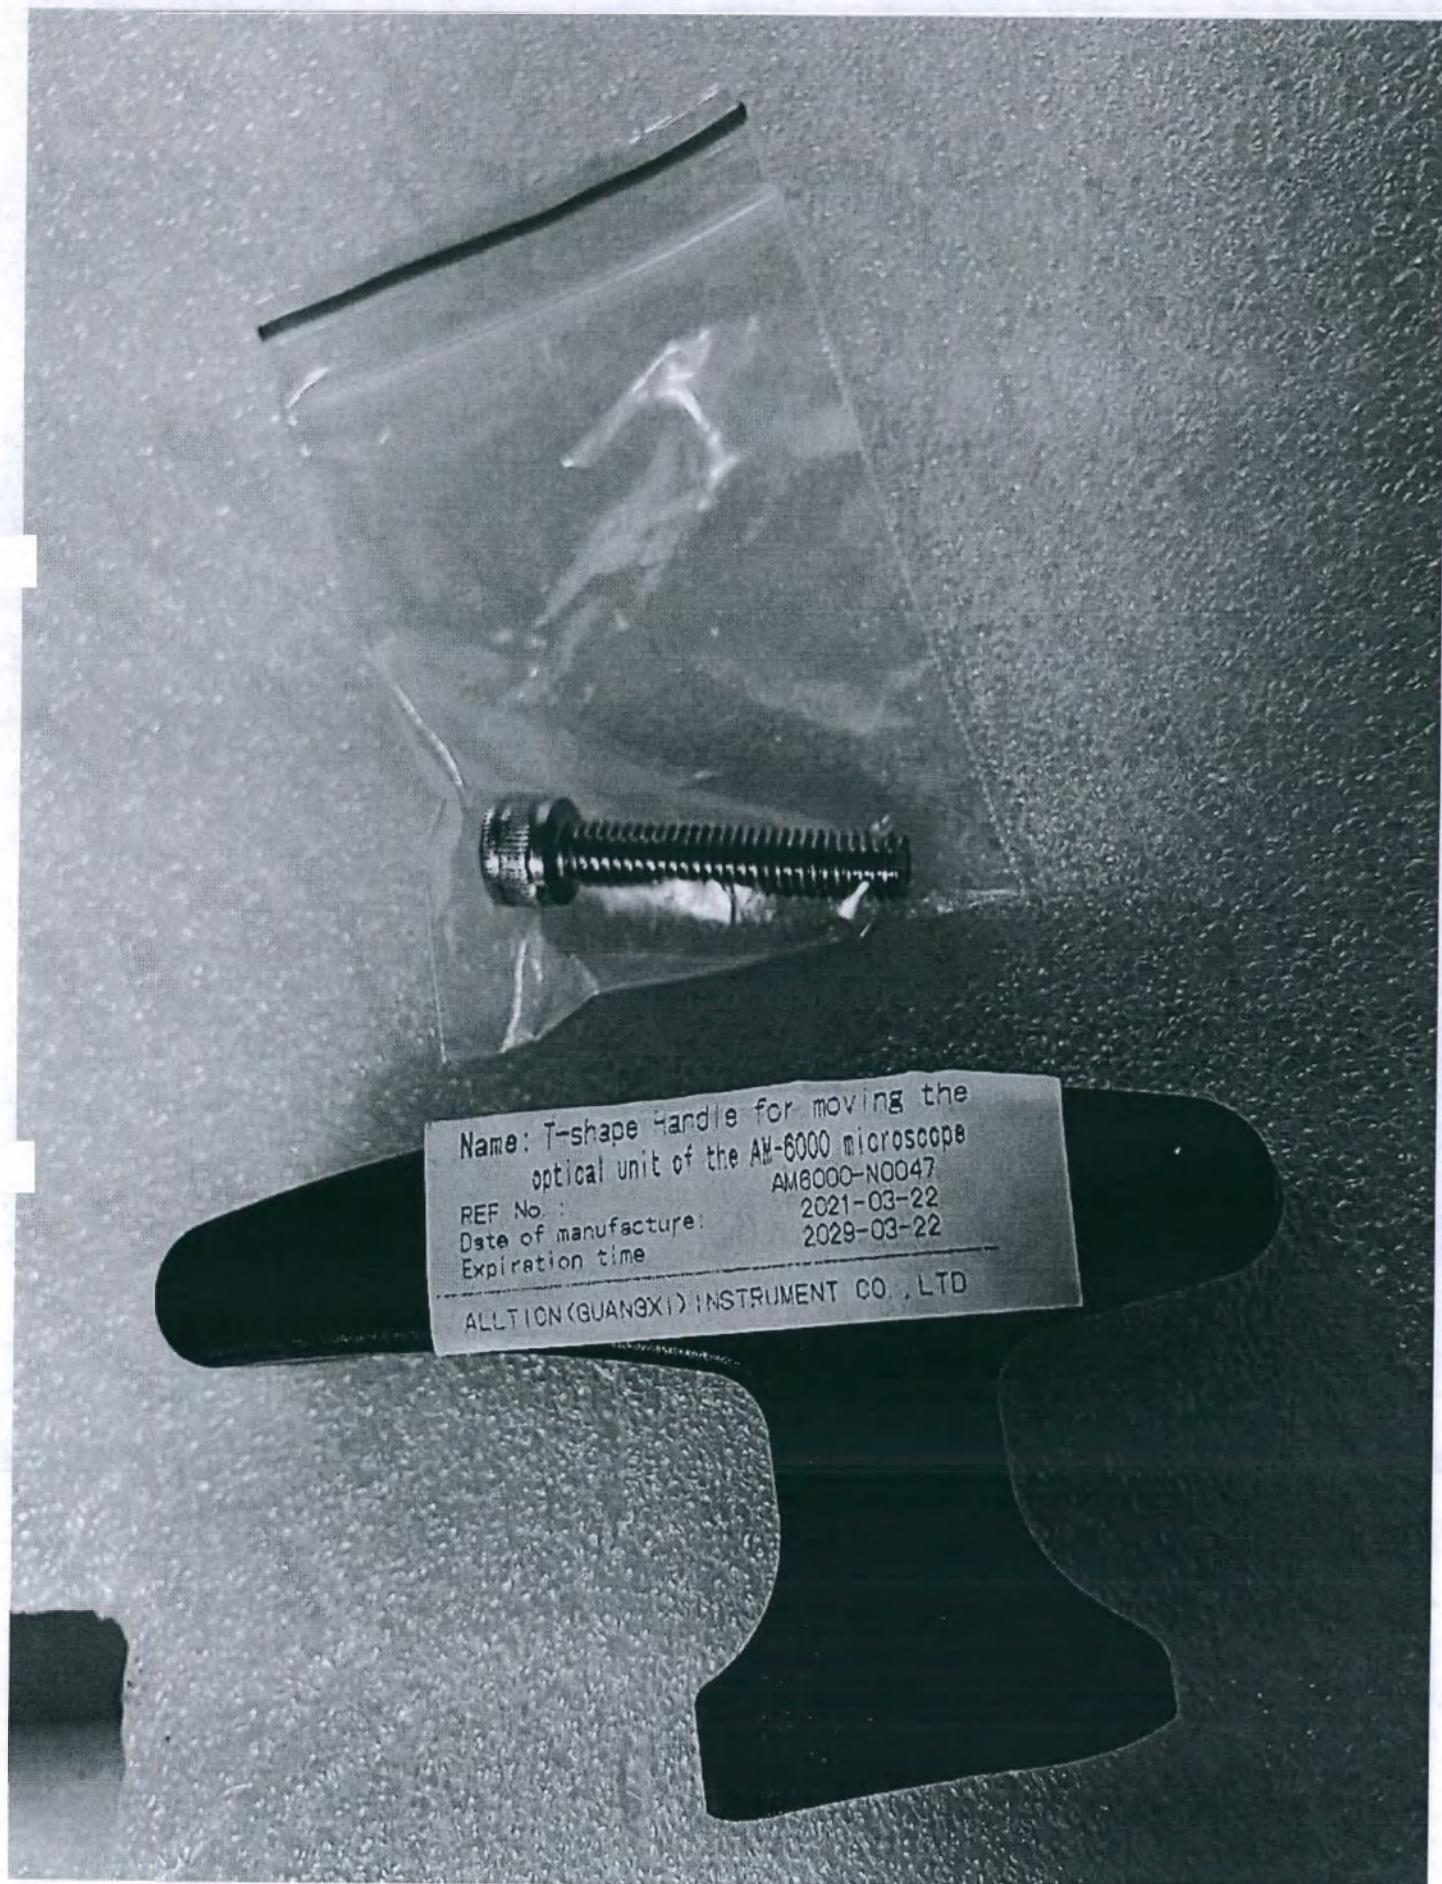

19) Трубка бинокулярная АМ-6000 с изменяемым углом наклона 0-180° (при необходимости) - 1 шт. (0-180 Degrees Inclinable Binocular for AM-6000 (if necessary) – 1 pc.)




20) Тубус биноклярный прямой (при необходимости) – 1 шт. (90 Degrees Inclined Binocular (if necessary) – 1 pc.)

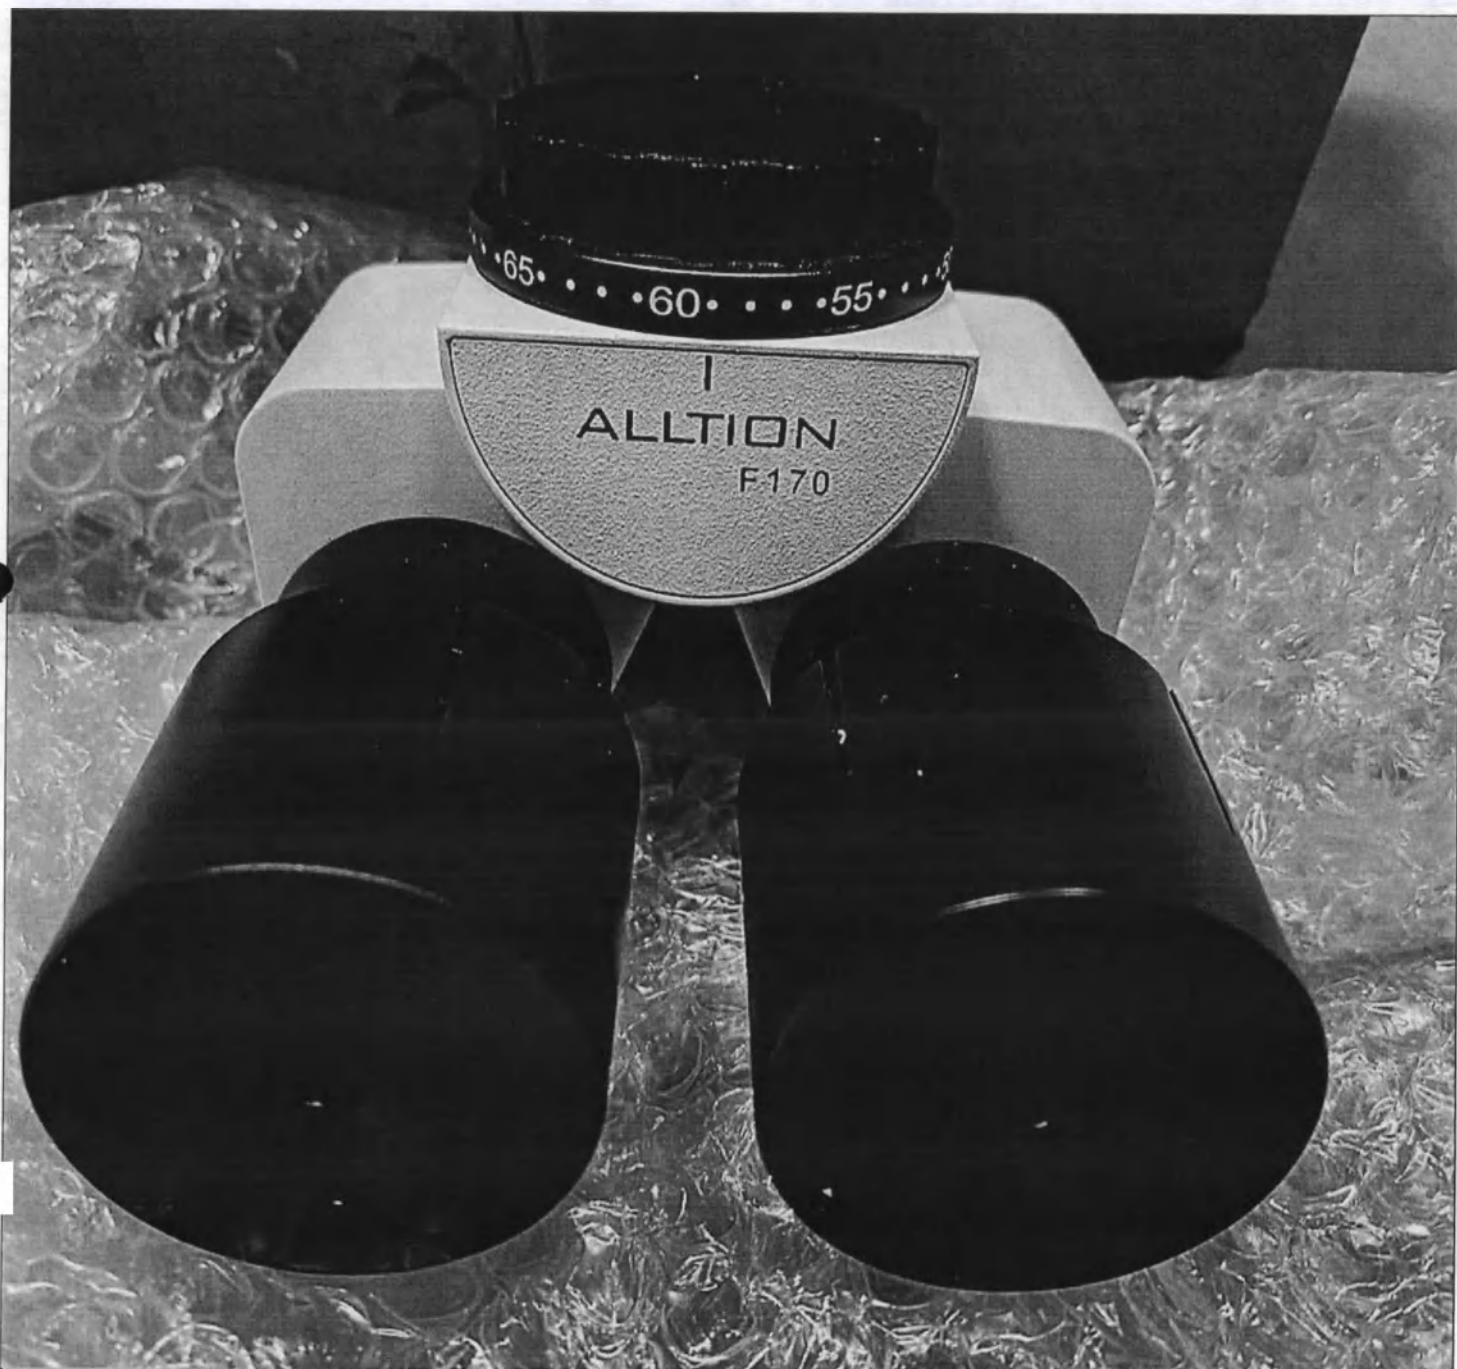


21) Тубус бинокулярный с углом наклона 45°(при необходимости) - 1 шт. (45 Degrees Inclined Binocular (if necessary) – 1 pc.)



22) Светоделитель (при необходимости) – 1 шт. (Beam splitter (if necessary) – 1 pc.)

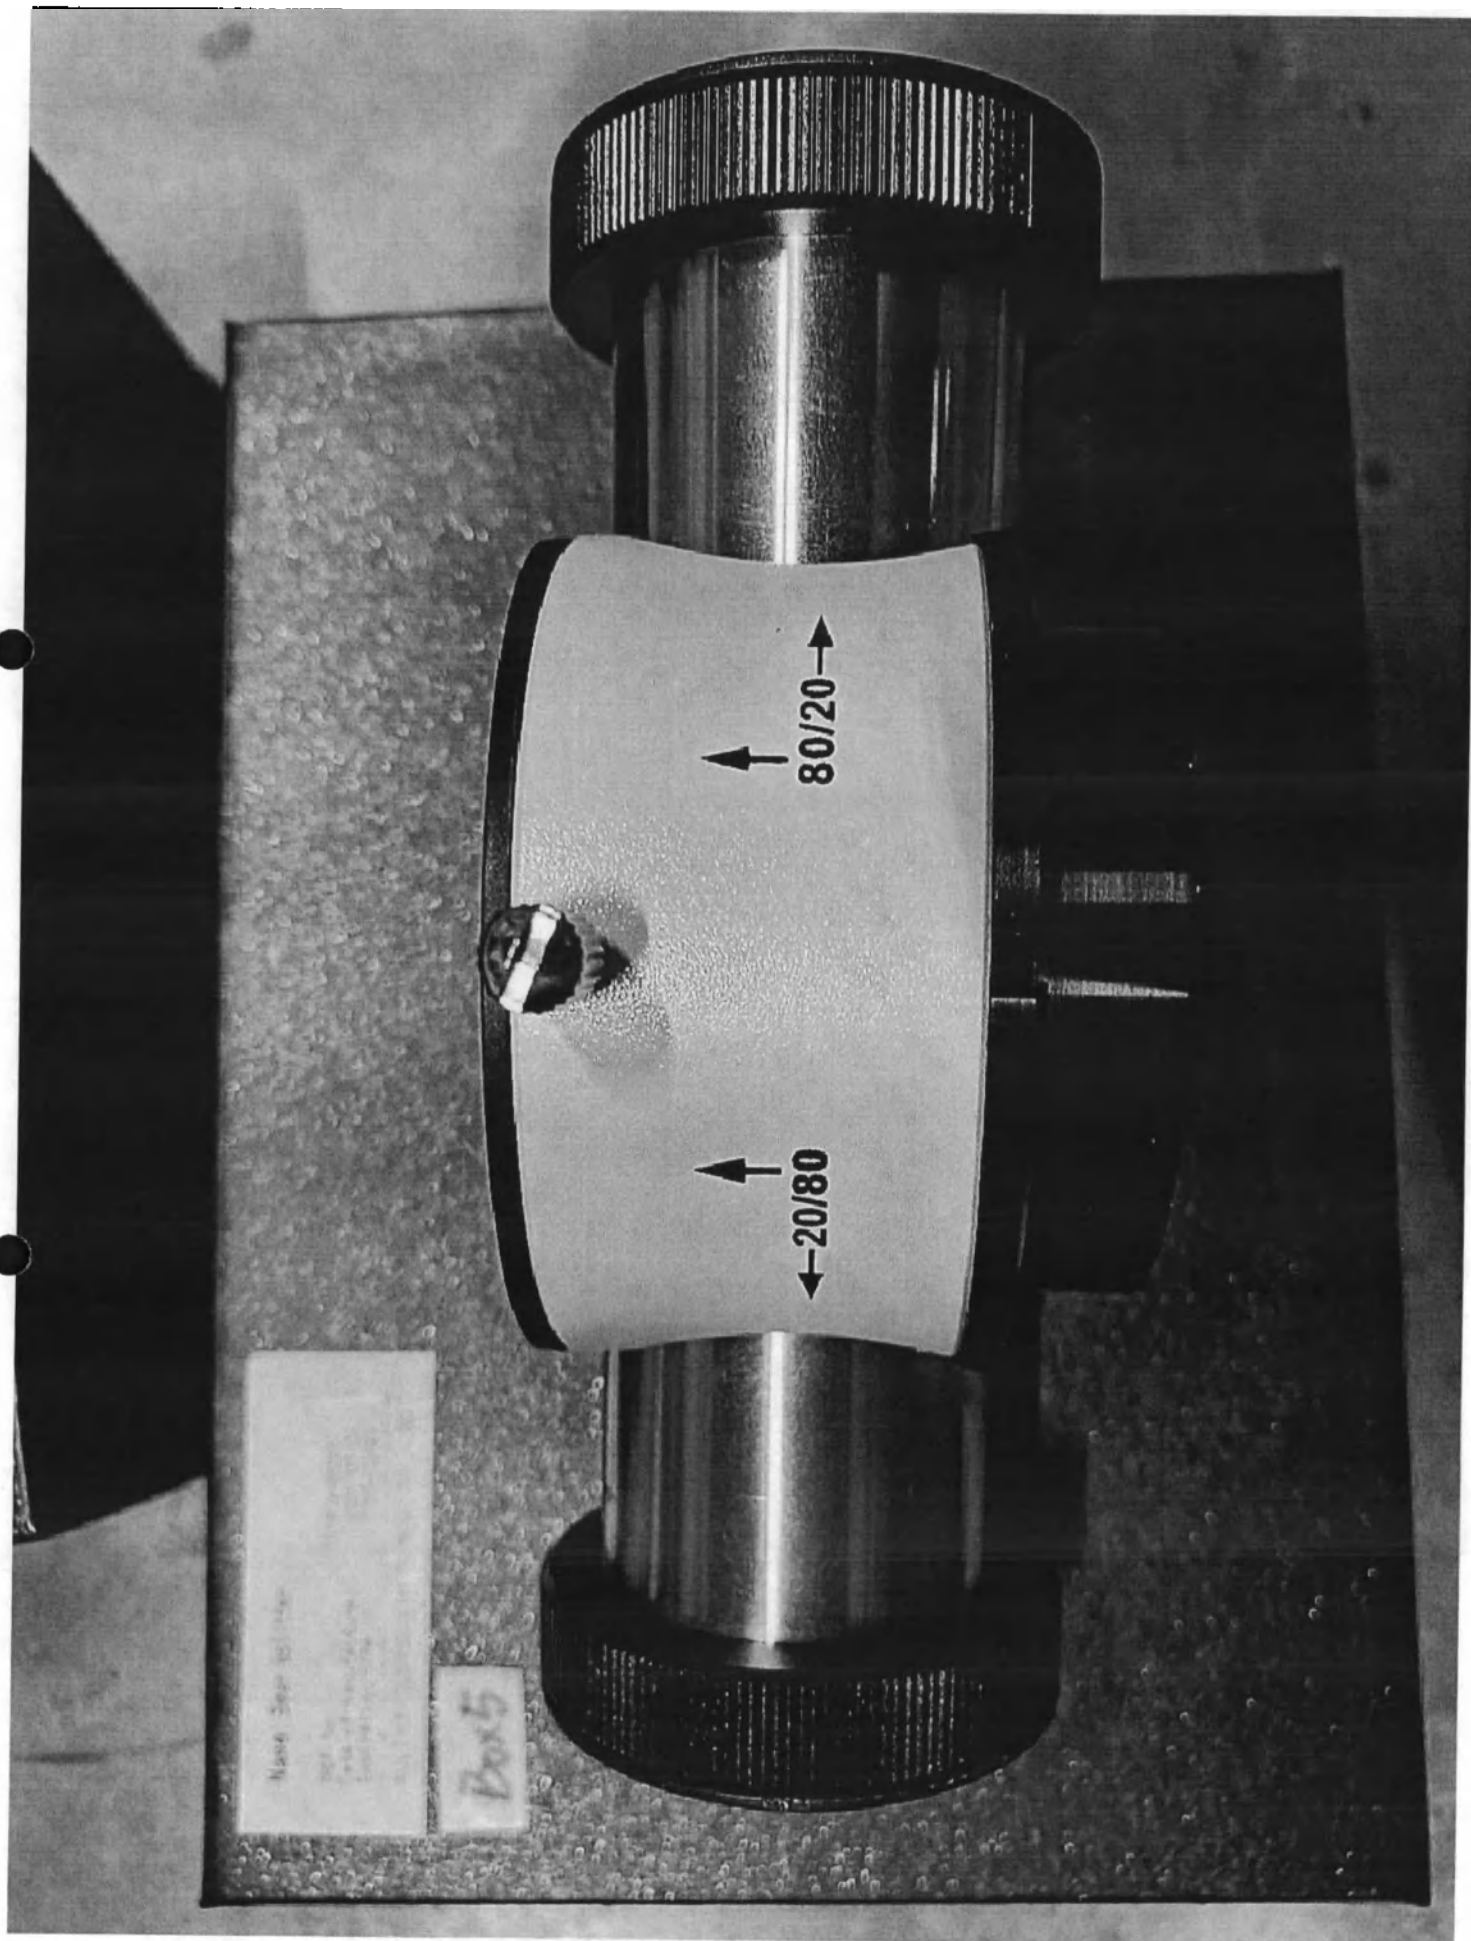


23) Устройство для углового поворота (при необходимости) – 1 шт. (Angle Rotation Device (if necessary) – 1 pc.)

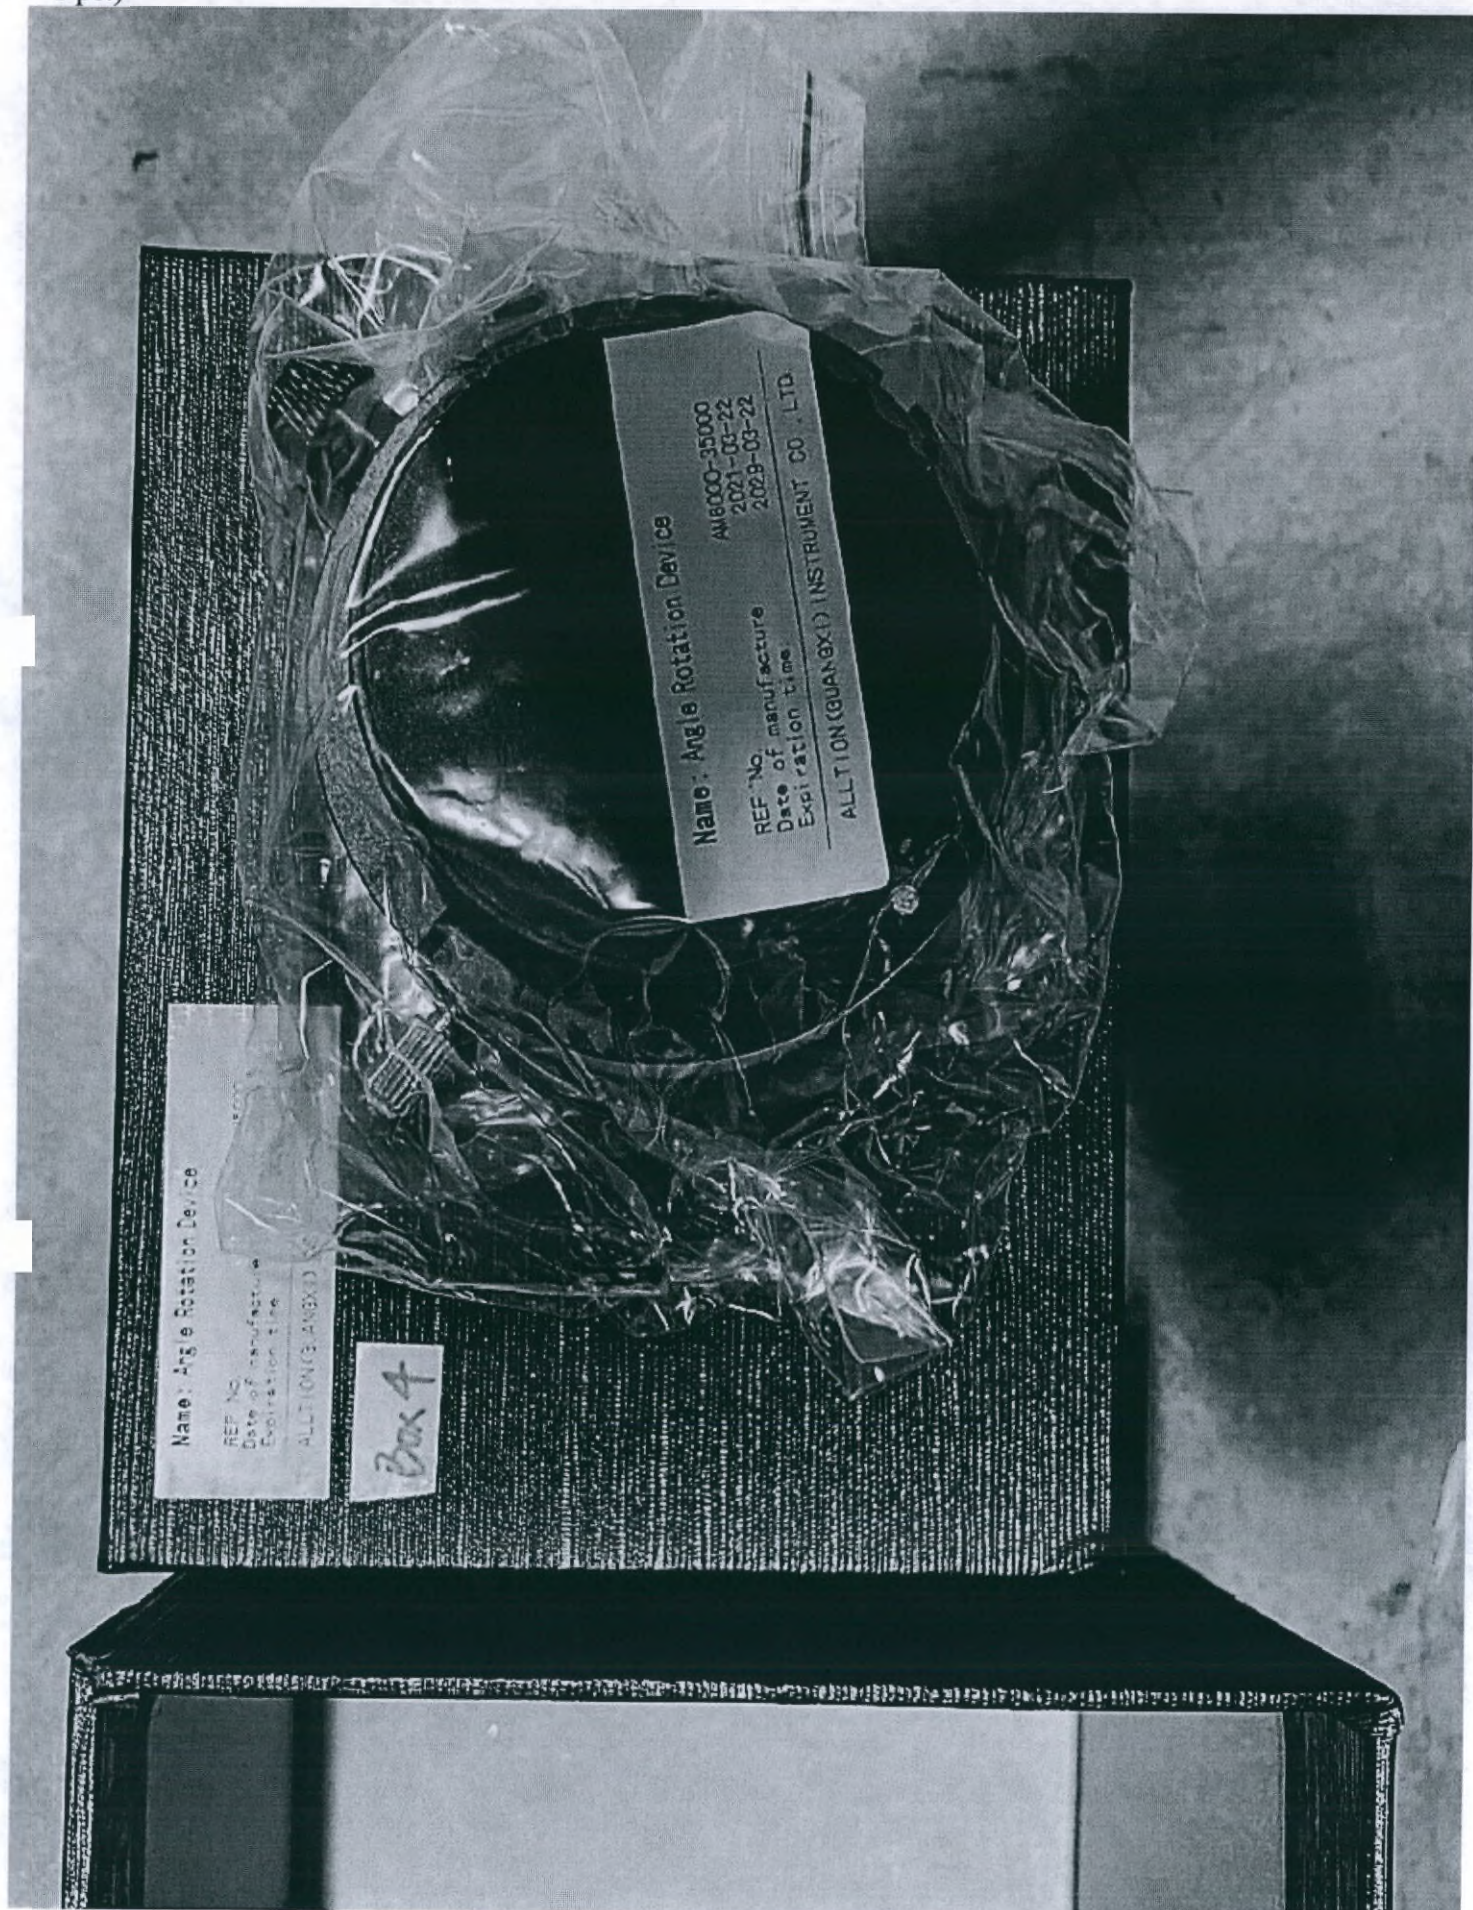

24) Удлинитель биноклярный под 30° с светоделителем и устройством для углового поворота (при необходимости) – 1 шт. (Binocular Extender (30°) with Beam Splitter with Angle Rotation Device (if necessary) – 1 pc.)




25) Удлинитель биноклярный под 30° с устройством для углового поворота (при необходимости) – 1 шт. (Binocular Extender (30°) with Angle Rotation Device (if necessary) – 1 pc.)

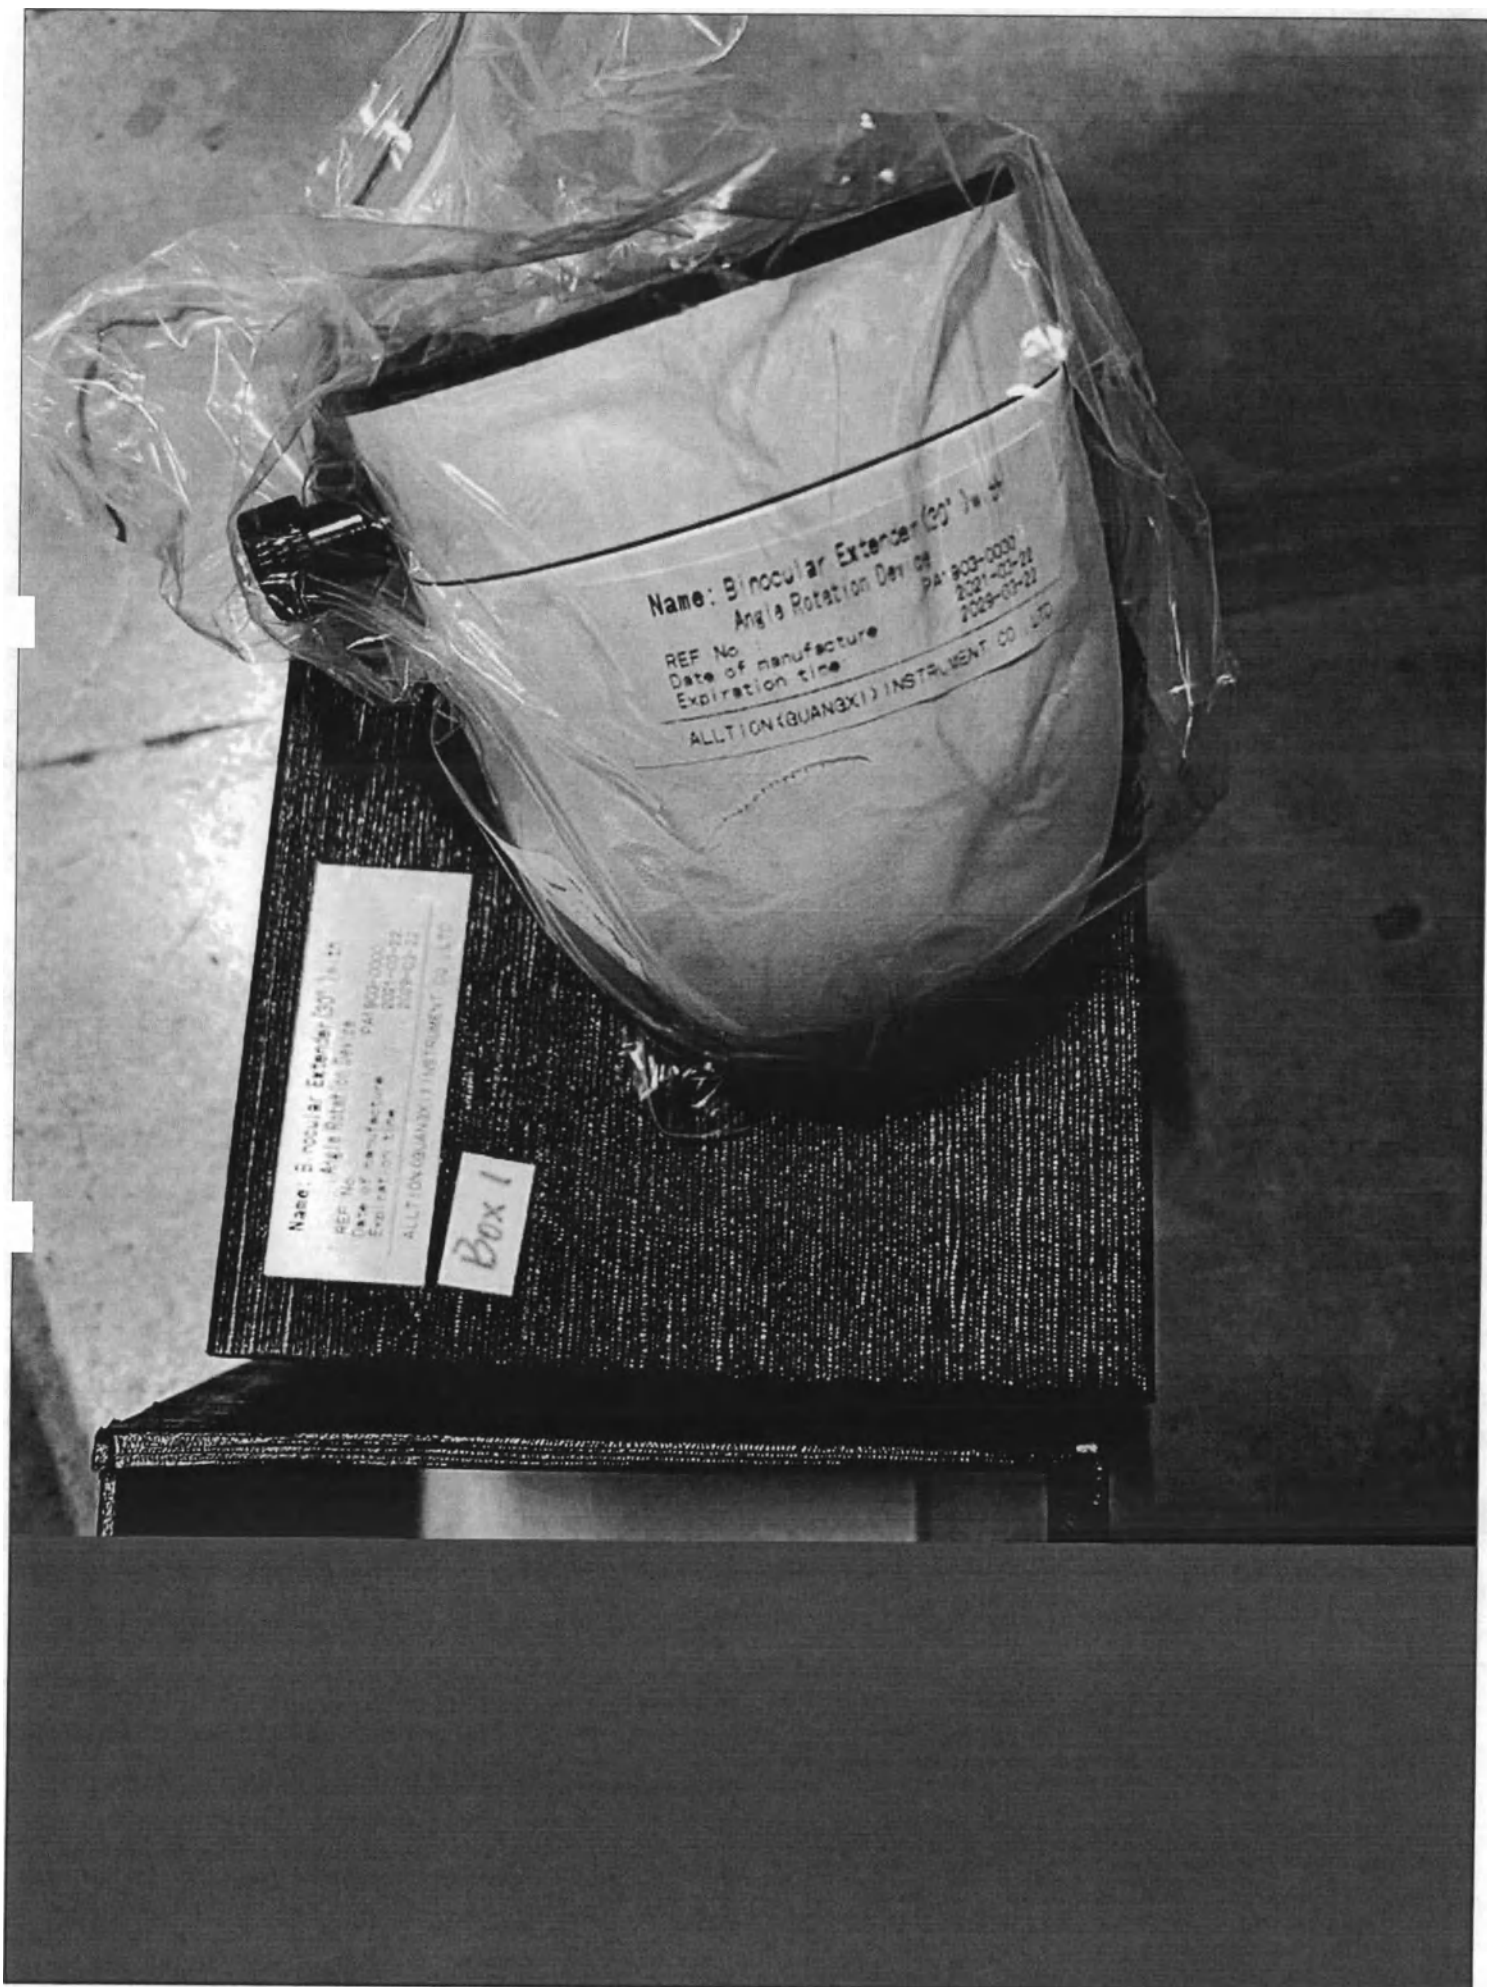

26) Удлинитель биноклярный под 90° с устройством углового поворота (при необходимости) – 1 шт.
(Binocular Extender (90°) with Angle Rotation Device (if necessary) – 1 pc)



27) Удлинитель биноклярный под 90° со светоделителем с устройством углового поворота (при необходимости) – 1 шт. (Binocular Extender (90°) with Beam Splitter with Angle Rotation Device (if necessary))

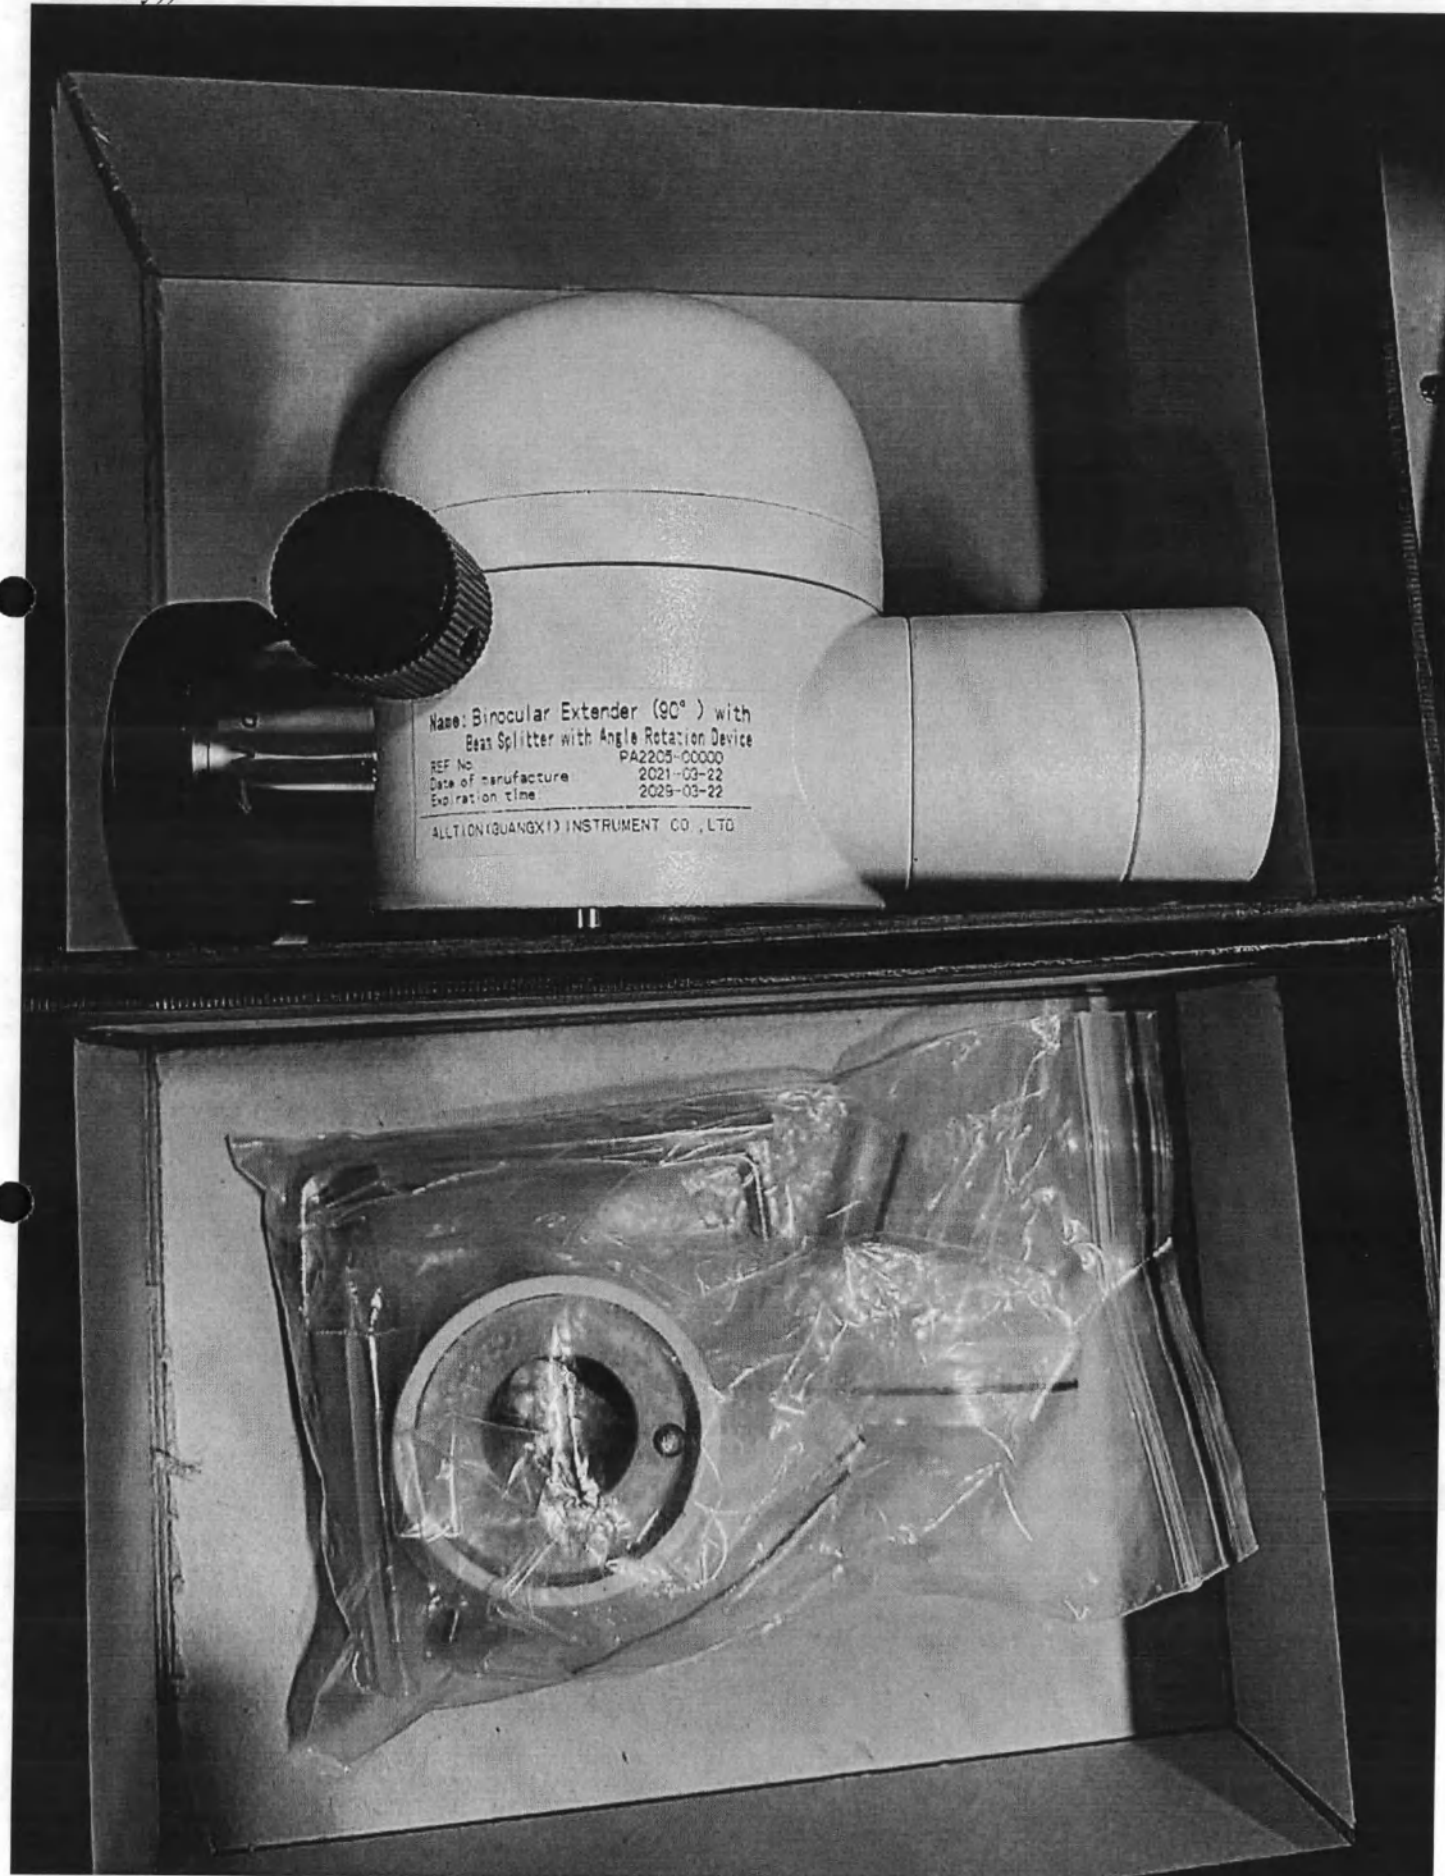

28) Удлинитель биноклярный под 45° (при необходимости) – 1 шт. (Binocular Extender (45°) (if necessary) – 1 pc.)



29) Муфта для двухмерного вращения бинокулярного тубуса ассистента (при необходимости) – 1 шт.
(2-D Rotation Binocular Assistant Scope Connector (if necessary) – 1 pc.)




30) Муфта для трехмерного вращения бинокулярного тубуса ассистента (при необходимости) – 1 шт.
(3-D Rotation Binocular Assistant Scope Connector (if necessary) – 1 pc.)




31) Окуляр 10X (при необходимости) – 2 шт. (10X Eyepiece (if necessary) – 2 pcs.)




32) Окуляр 12.5X (при необходимости) – 2 шт. (12.5X Eyepiece (if necessary) – 2 pcs.)

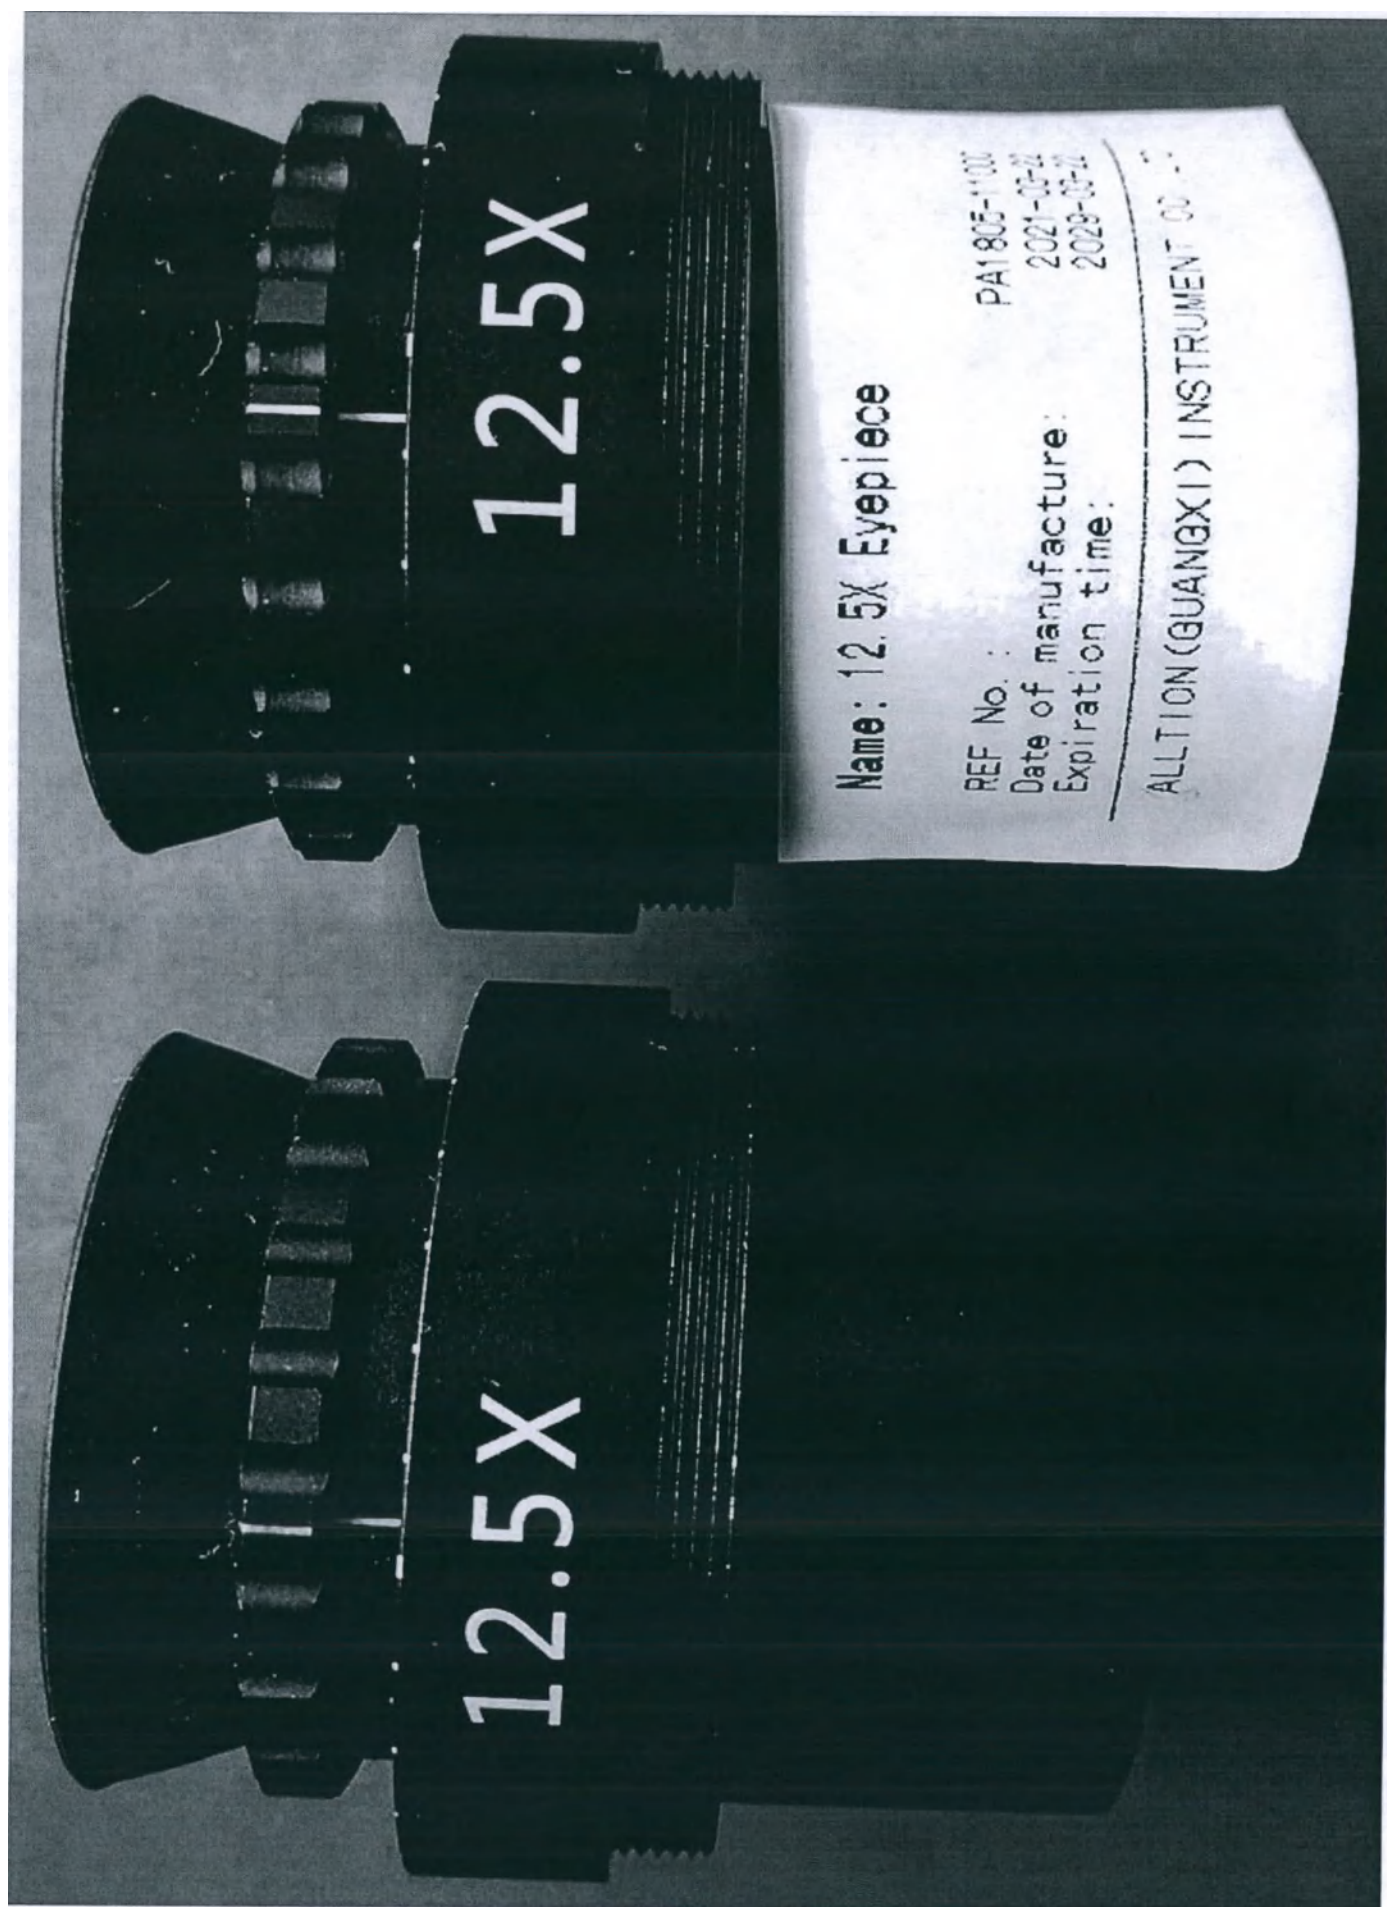


33) Модуль камеры (при необходимости) – 1 шт. (Camera Module (if necessary) – 1 pc.)

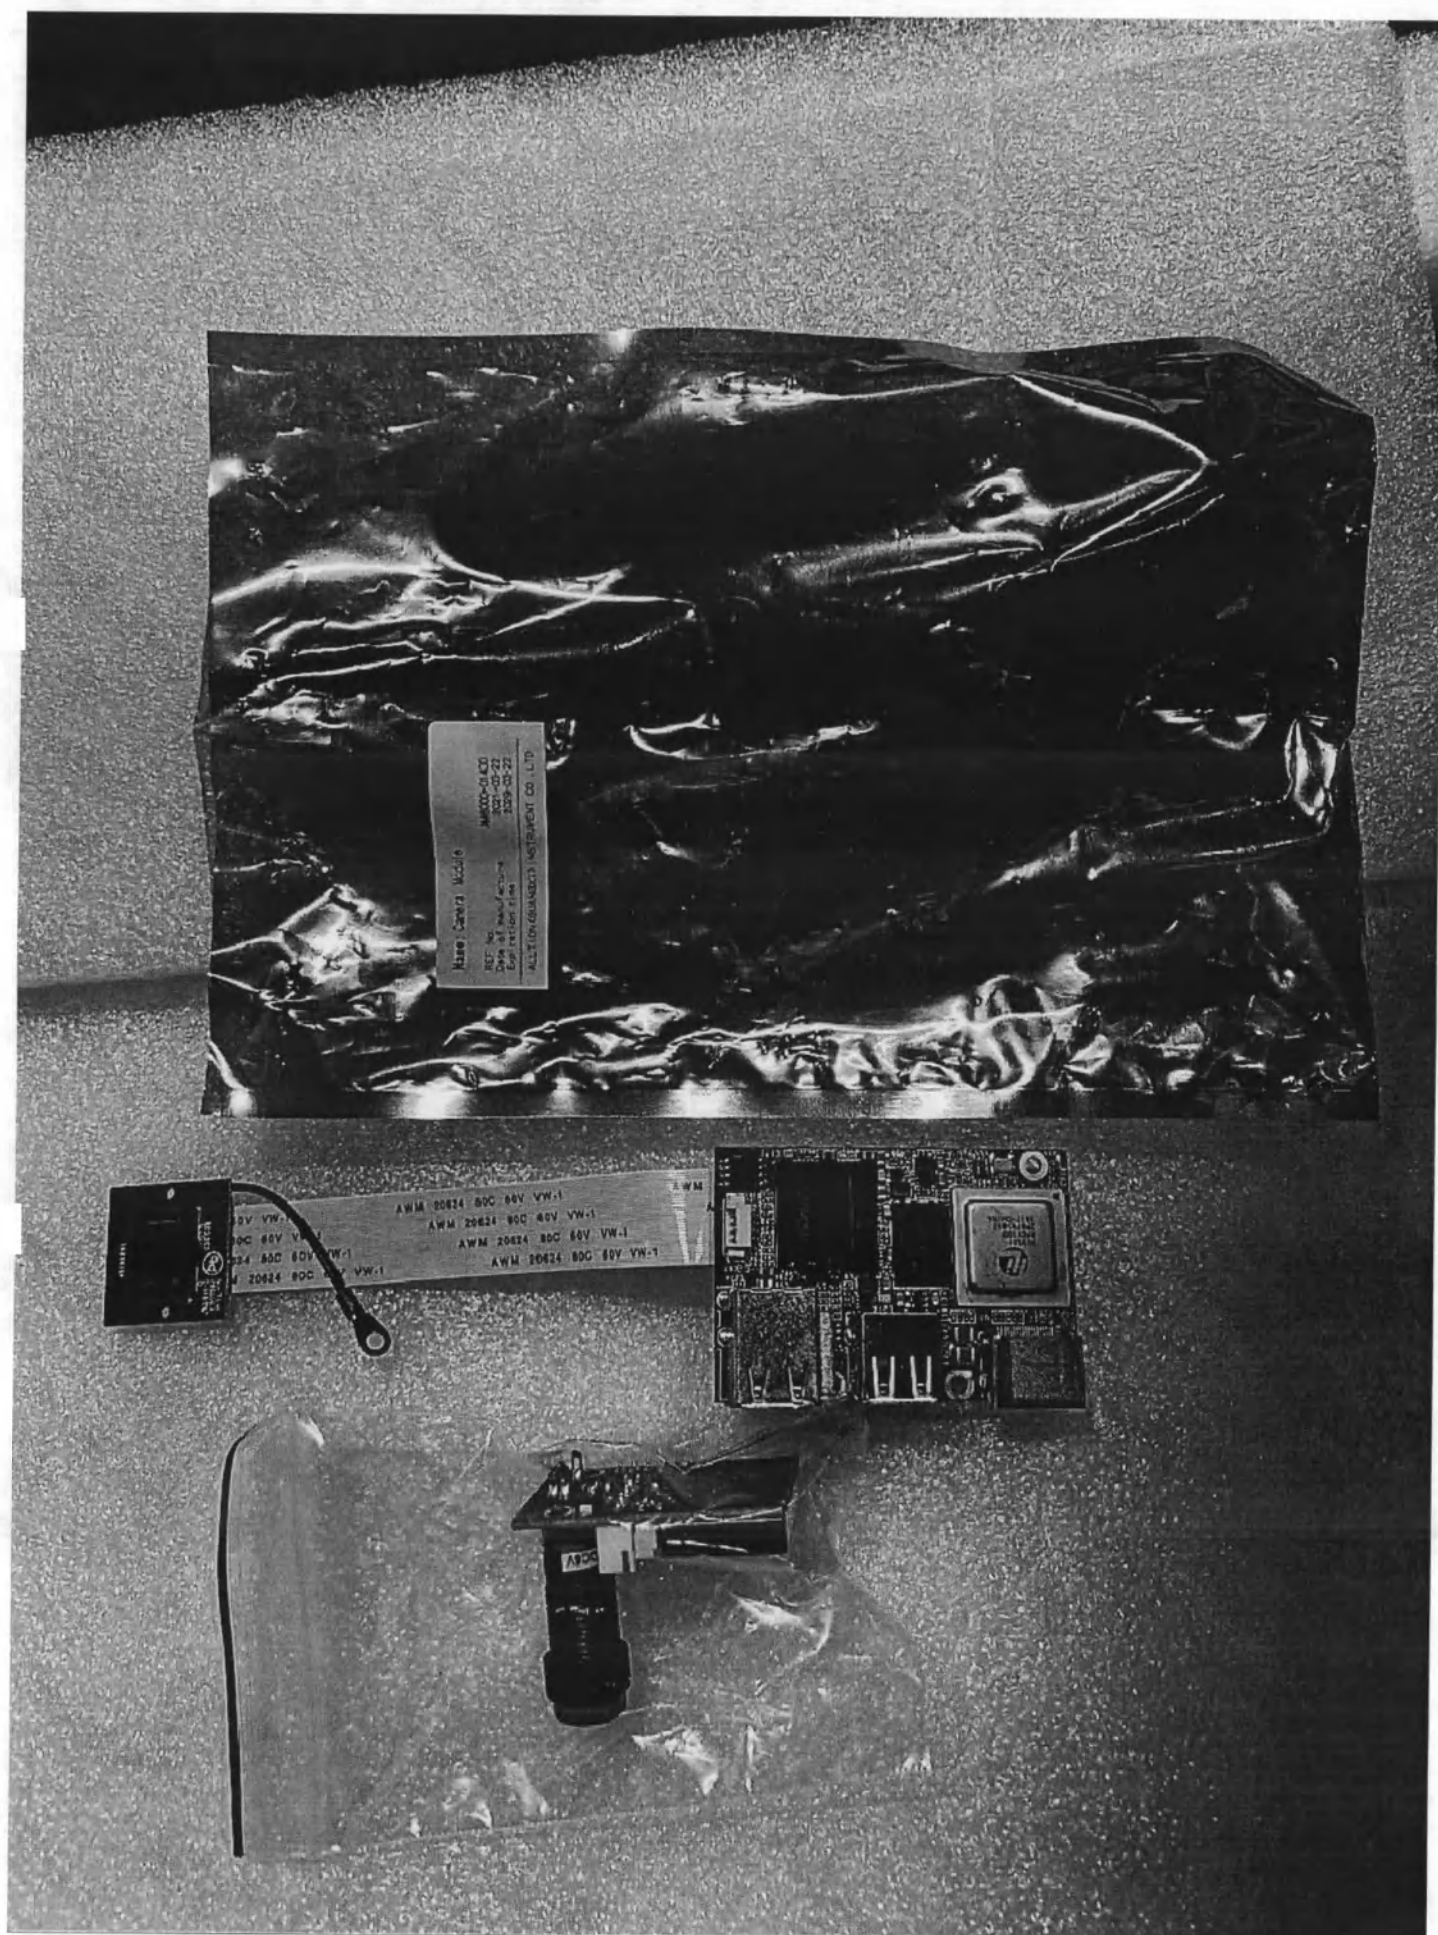


34) Поршень пневматический для АМ-6000 (при необходимости) – 1 шт. (Gas Spring (if necessary) – 1 pc.)

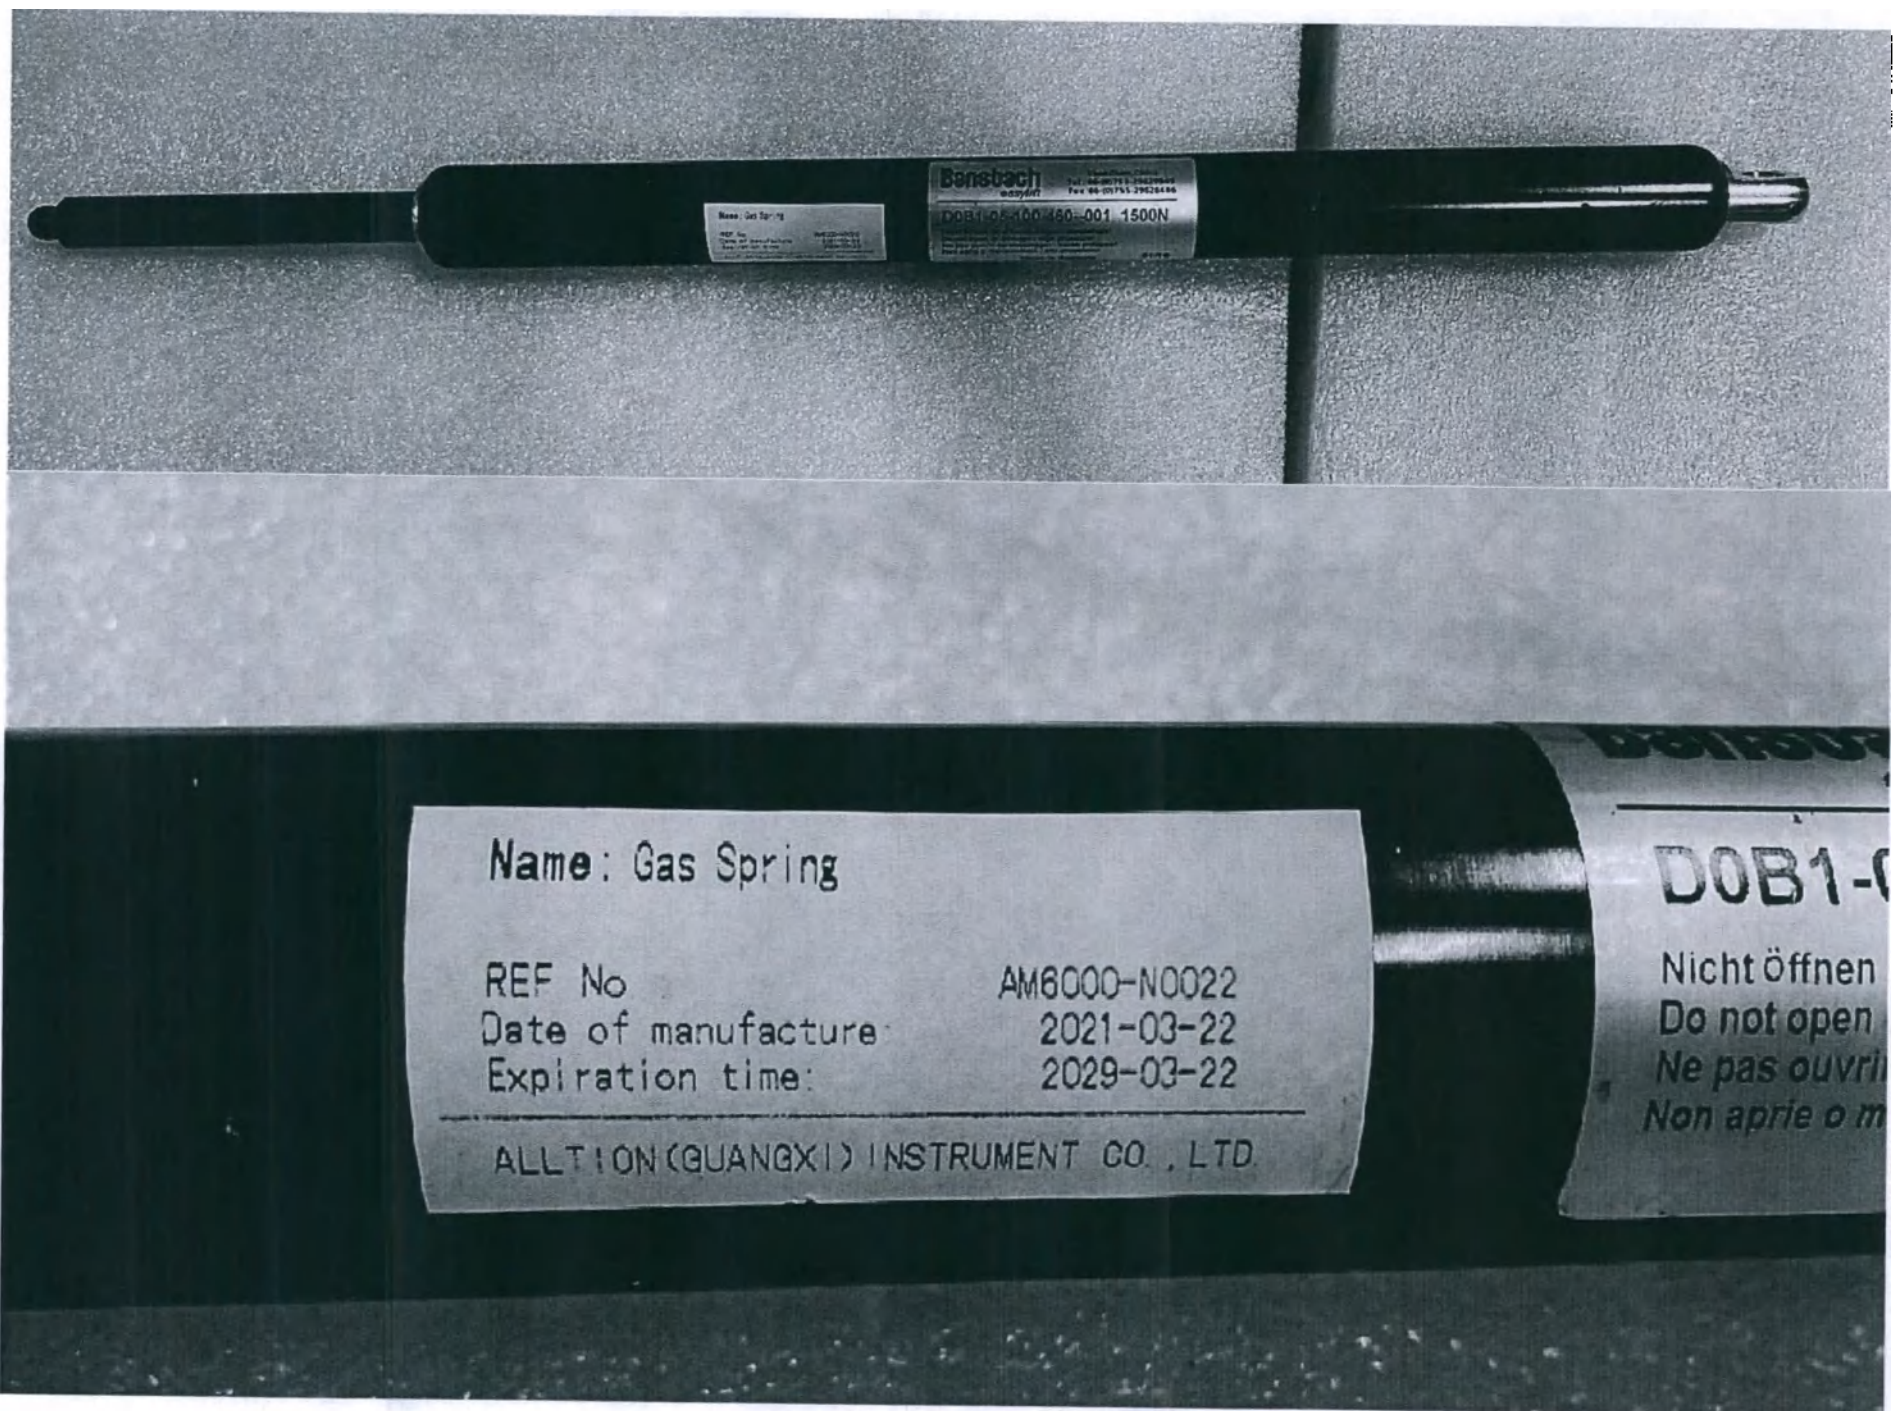

35) Модуль светодиодный (при необходимости) – 1 шт. (LED Module (if necessary) – 1 pc.)

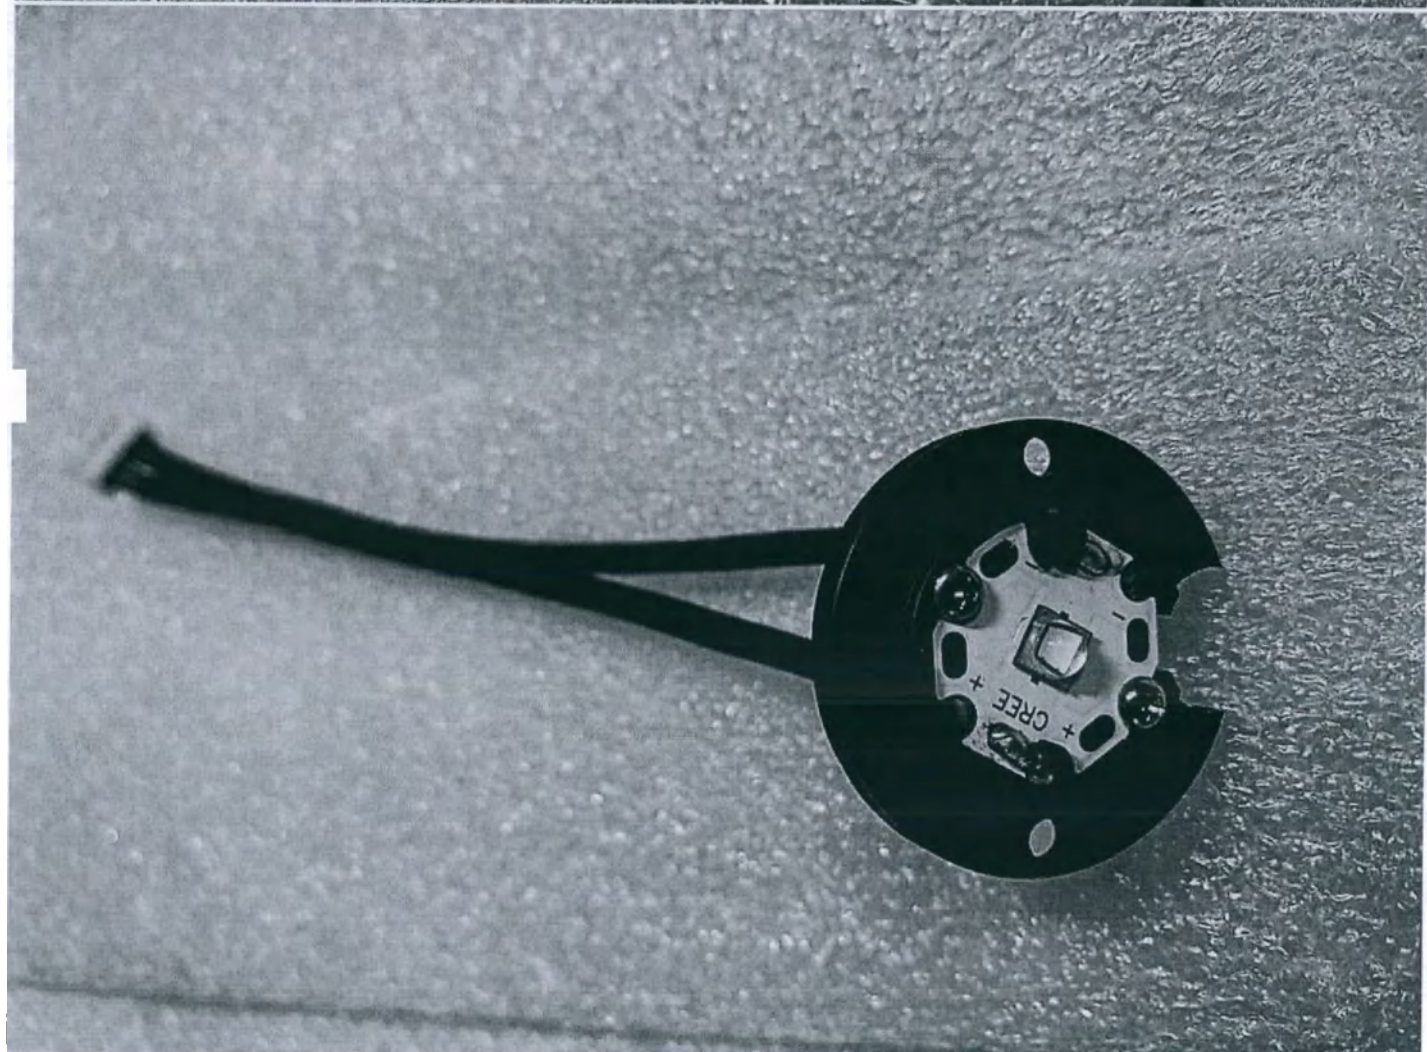

36) Кулер (при необходимости) – 1 шт. (Cooling Fan (if necessary) – 1 pc.)

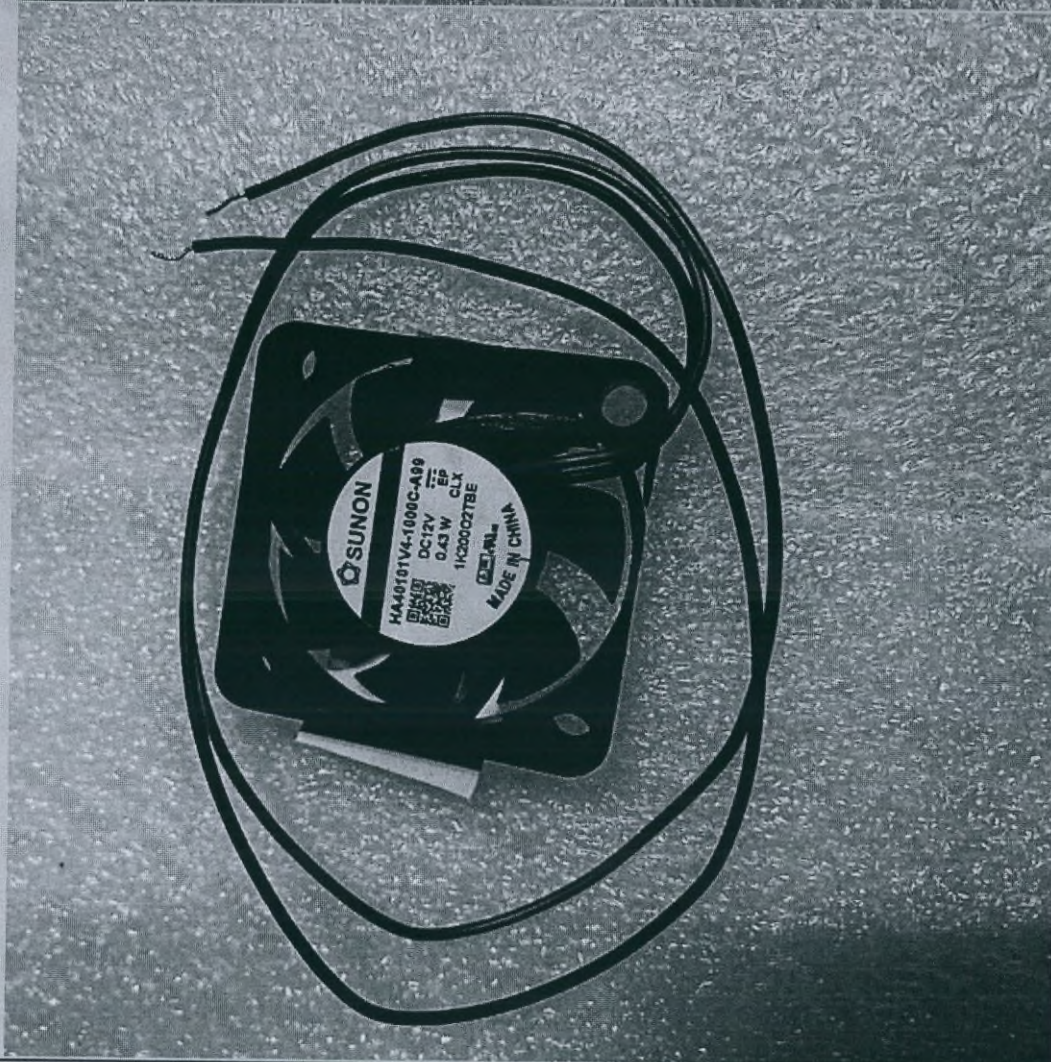

37) Кабель питания (при необходимости) – 1 шт. (Power cable (if necessary) – 1 pc.)



38) Кабель HDMI (при необходимости) – 1 шт. (HDMI Video Line (if necessary) – 1 pc.)




6 JONON


39) Комплект крышек стерилизуемых АМ-6000 – 1 шт. (Set of AM-6000 sterilizable lids – 1 pc.)




40) Крышка для защиты объектива – 1 шт. (Objective Protective Cap – 1 pc.)

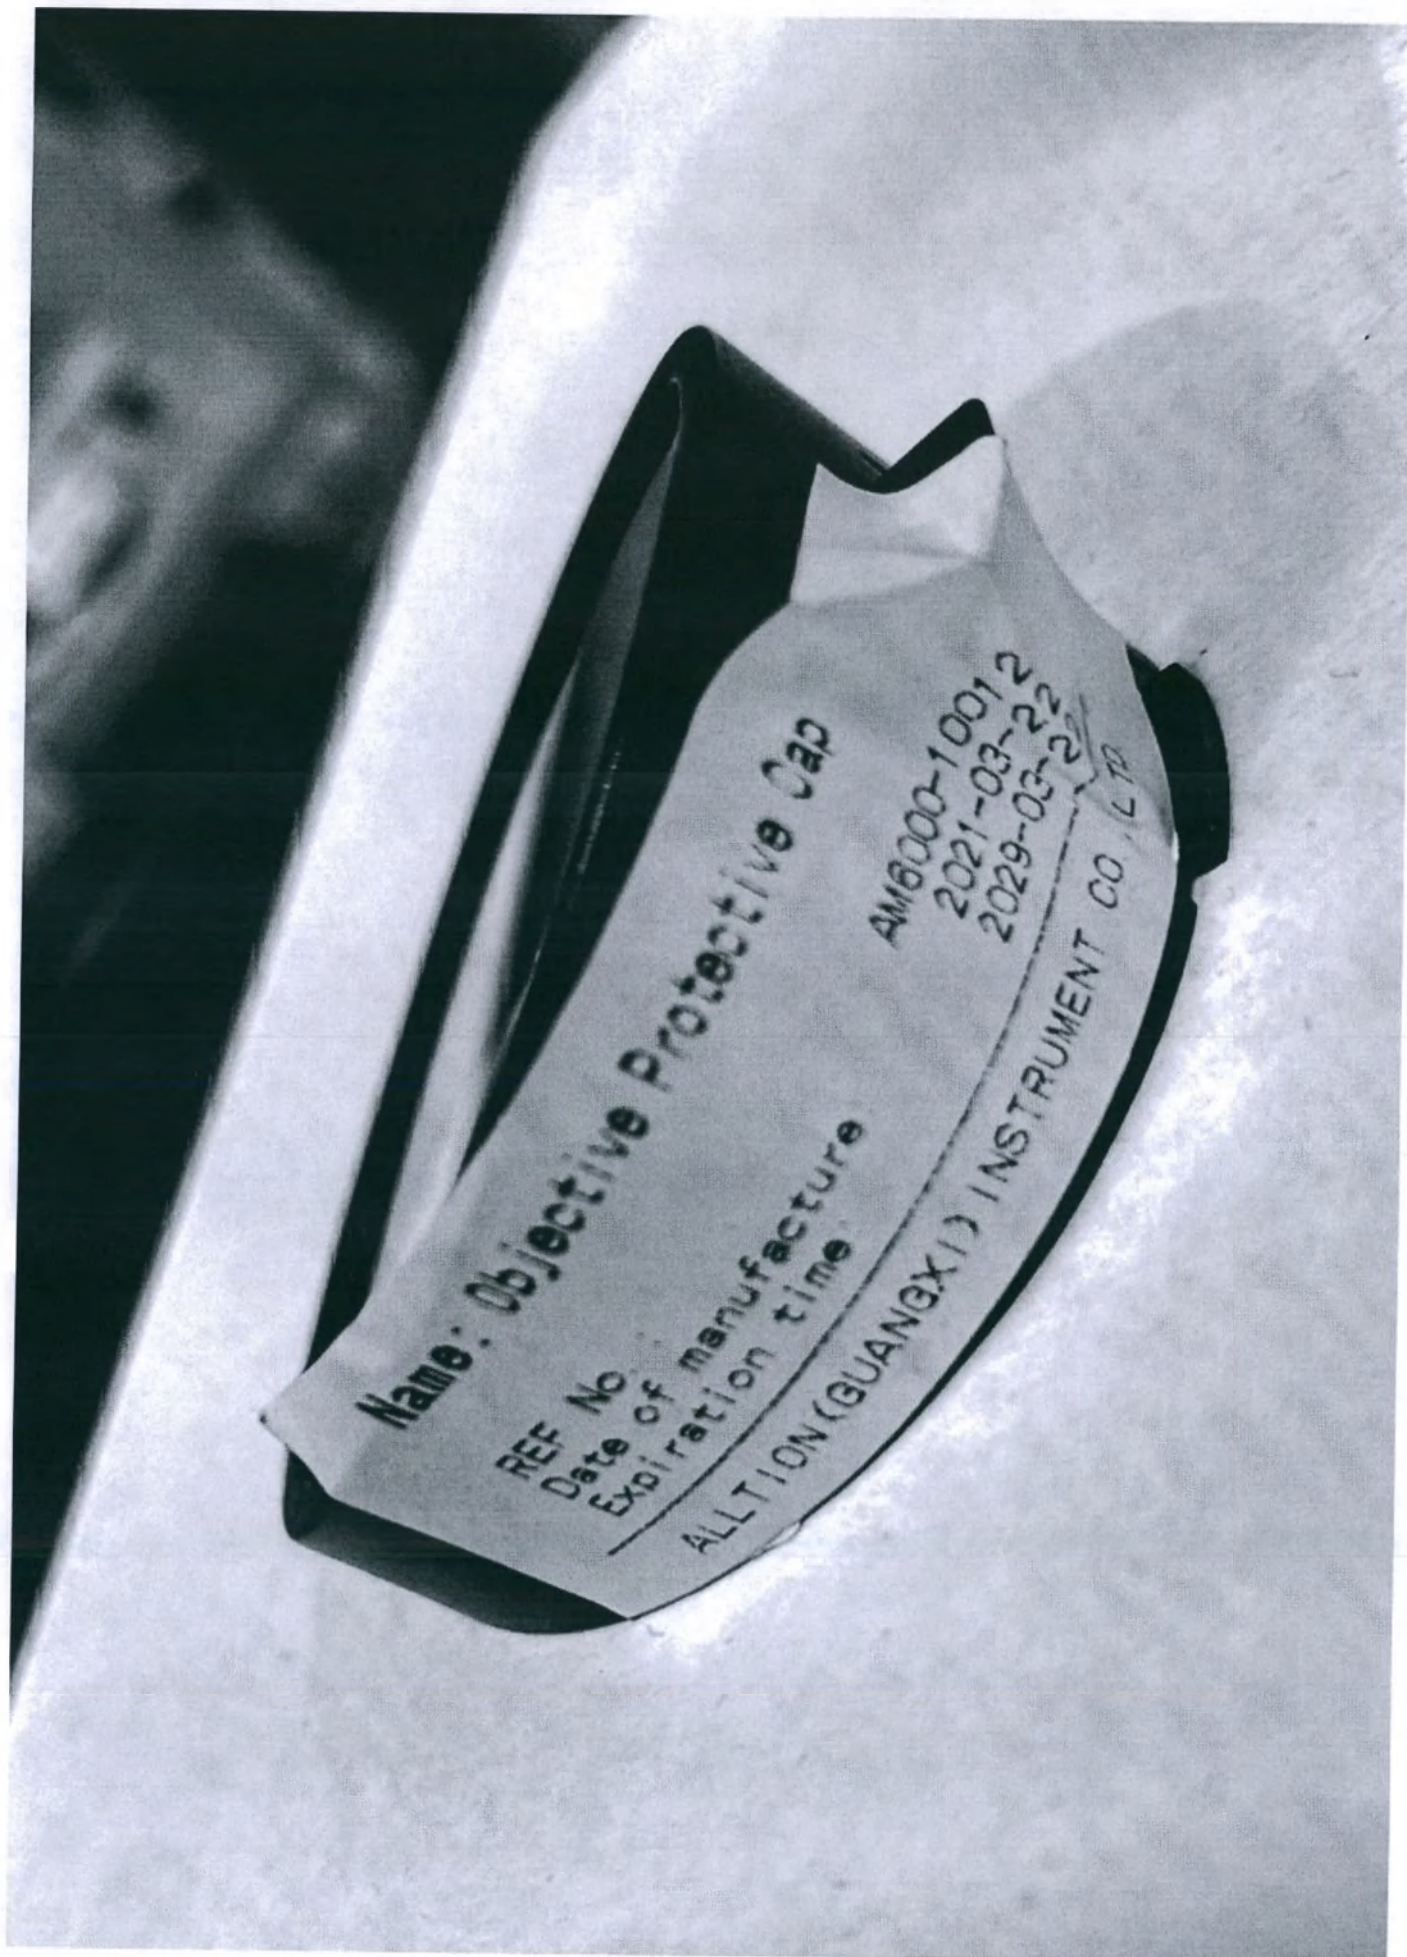


41) USB-накопитель (при необходимости) – 1 шт. (USB drive (if necessary) – 1 pc.)

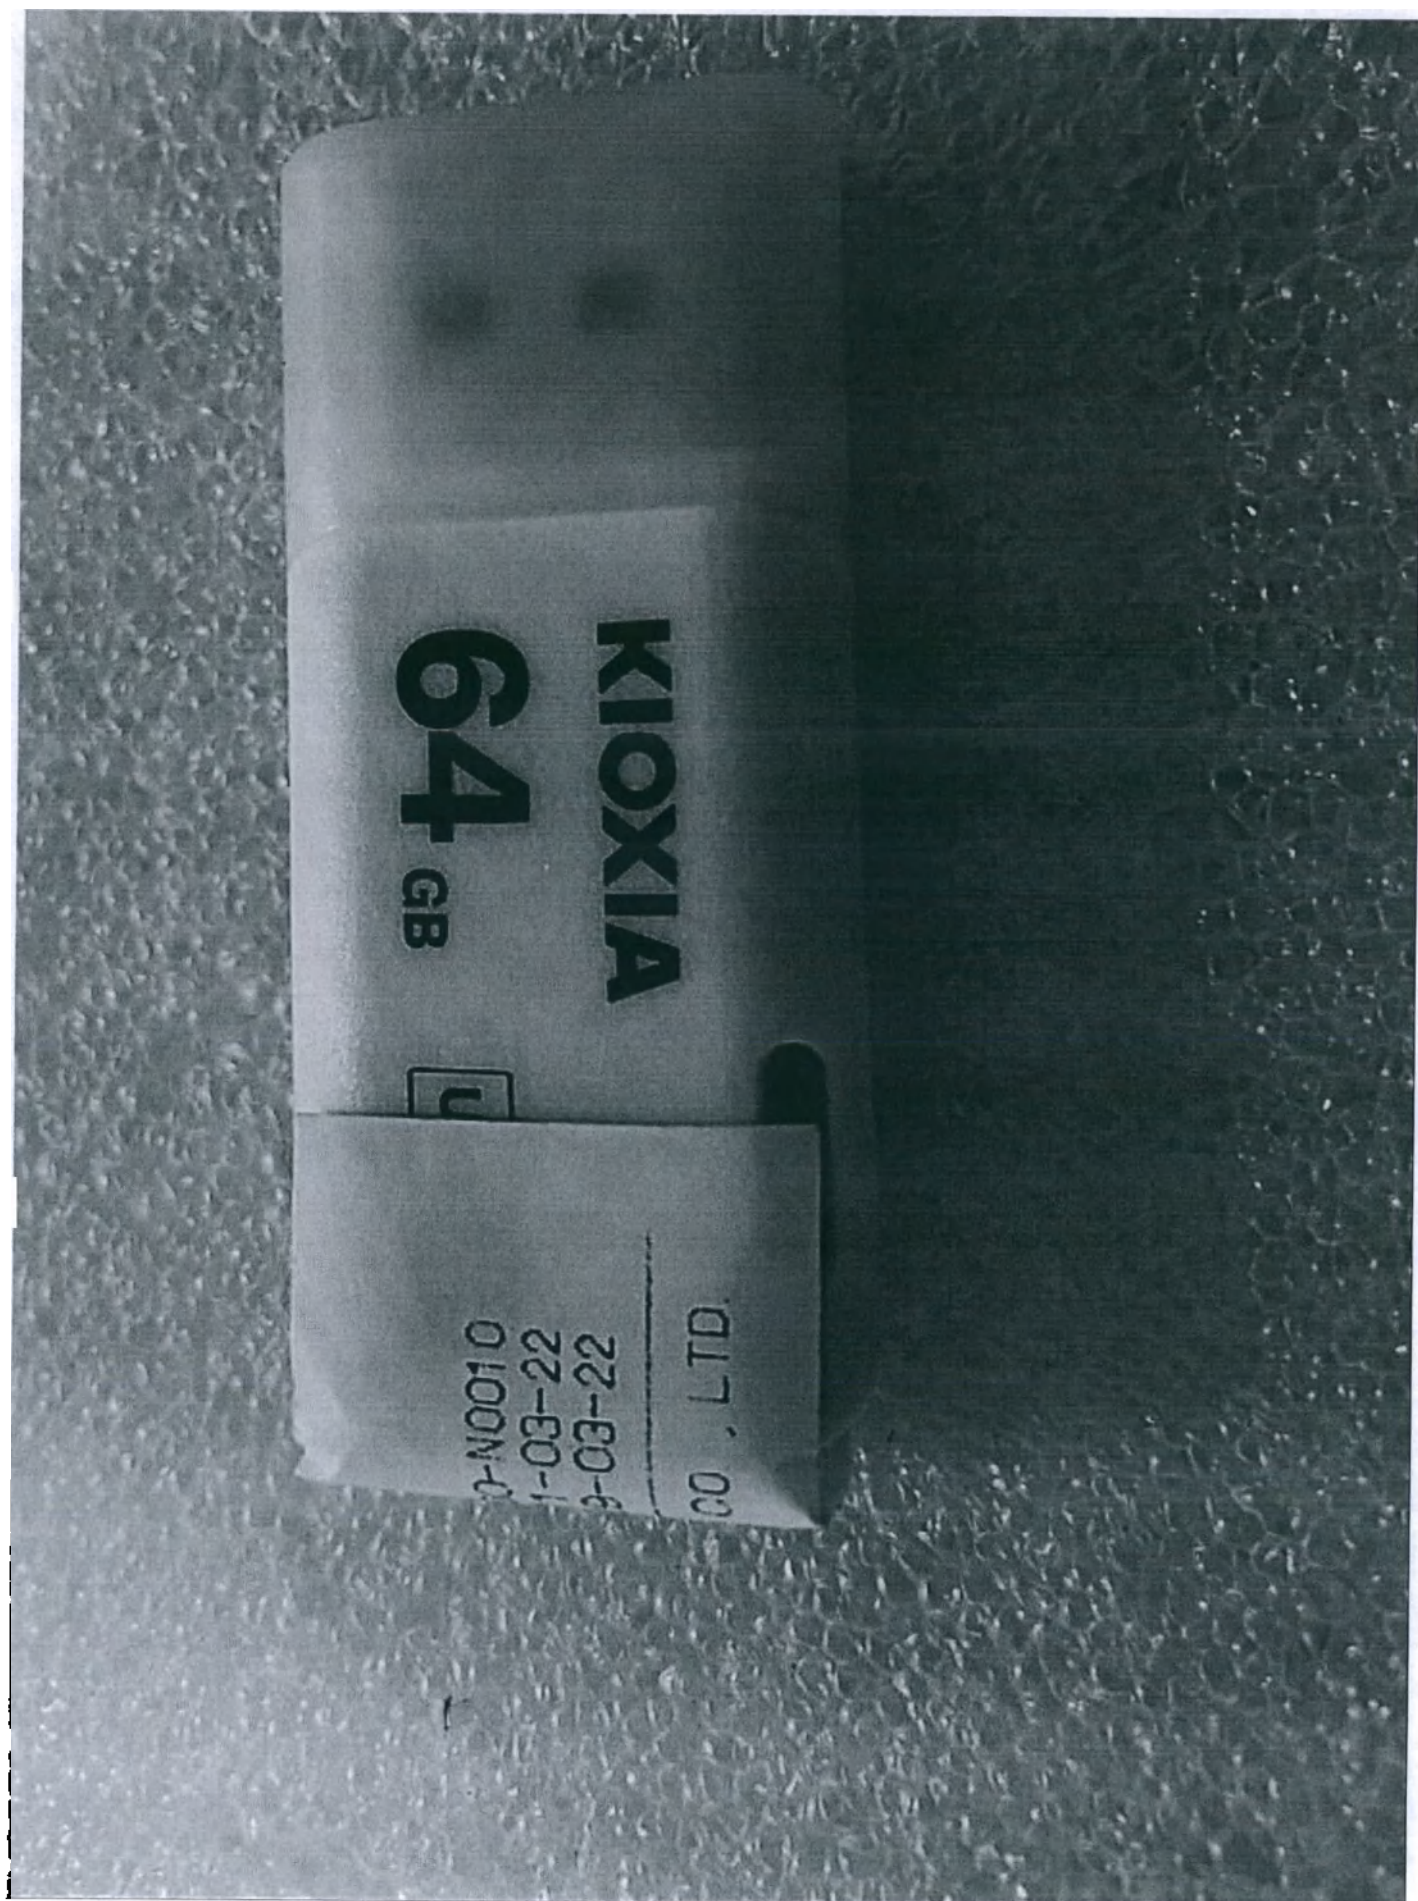


42) Модуль беспроводной сети (при необходимости) – 1 шт. (Wireless Network Card (if necessary) – 1 pc.)

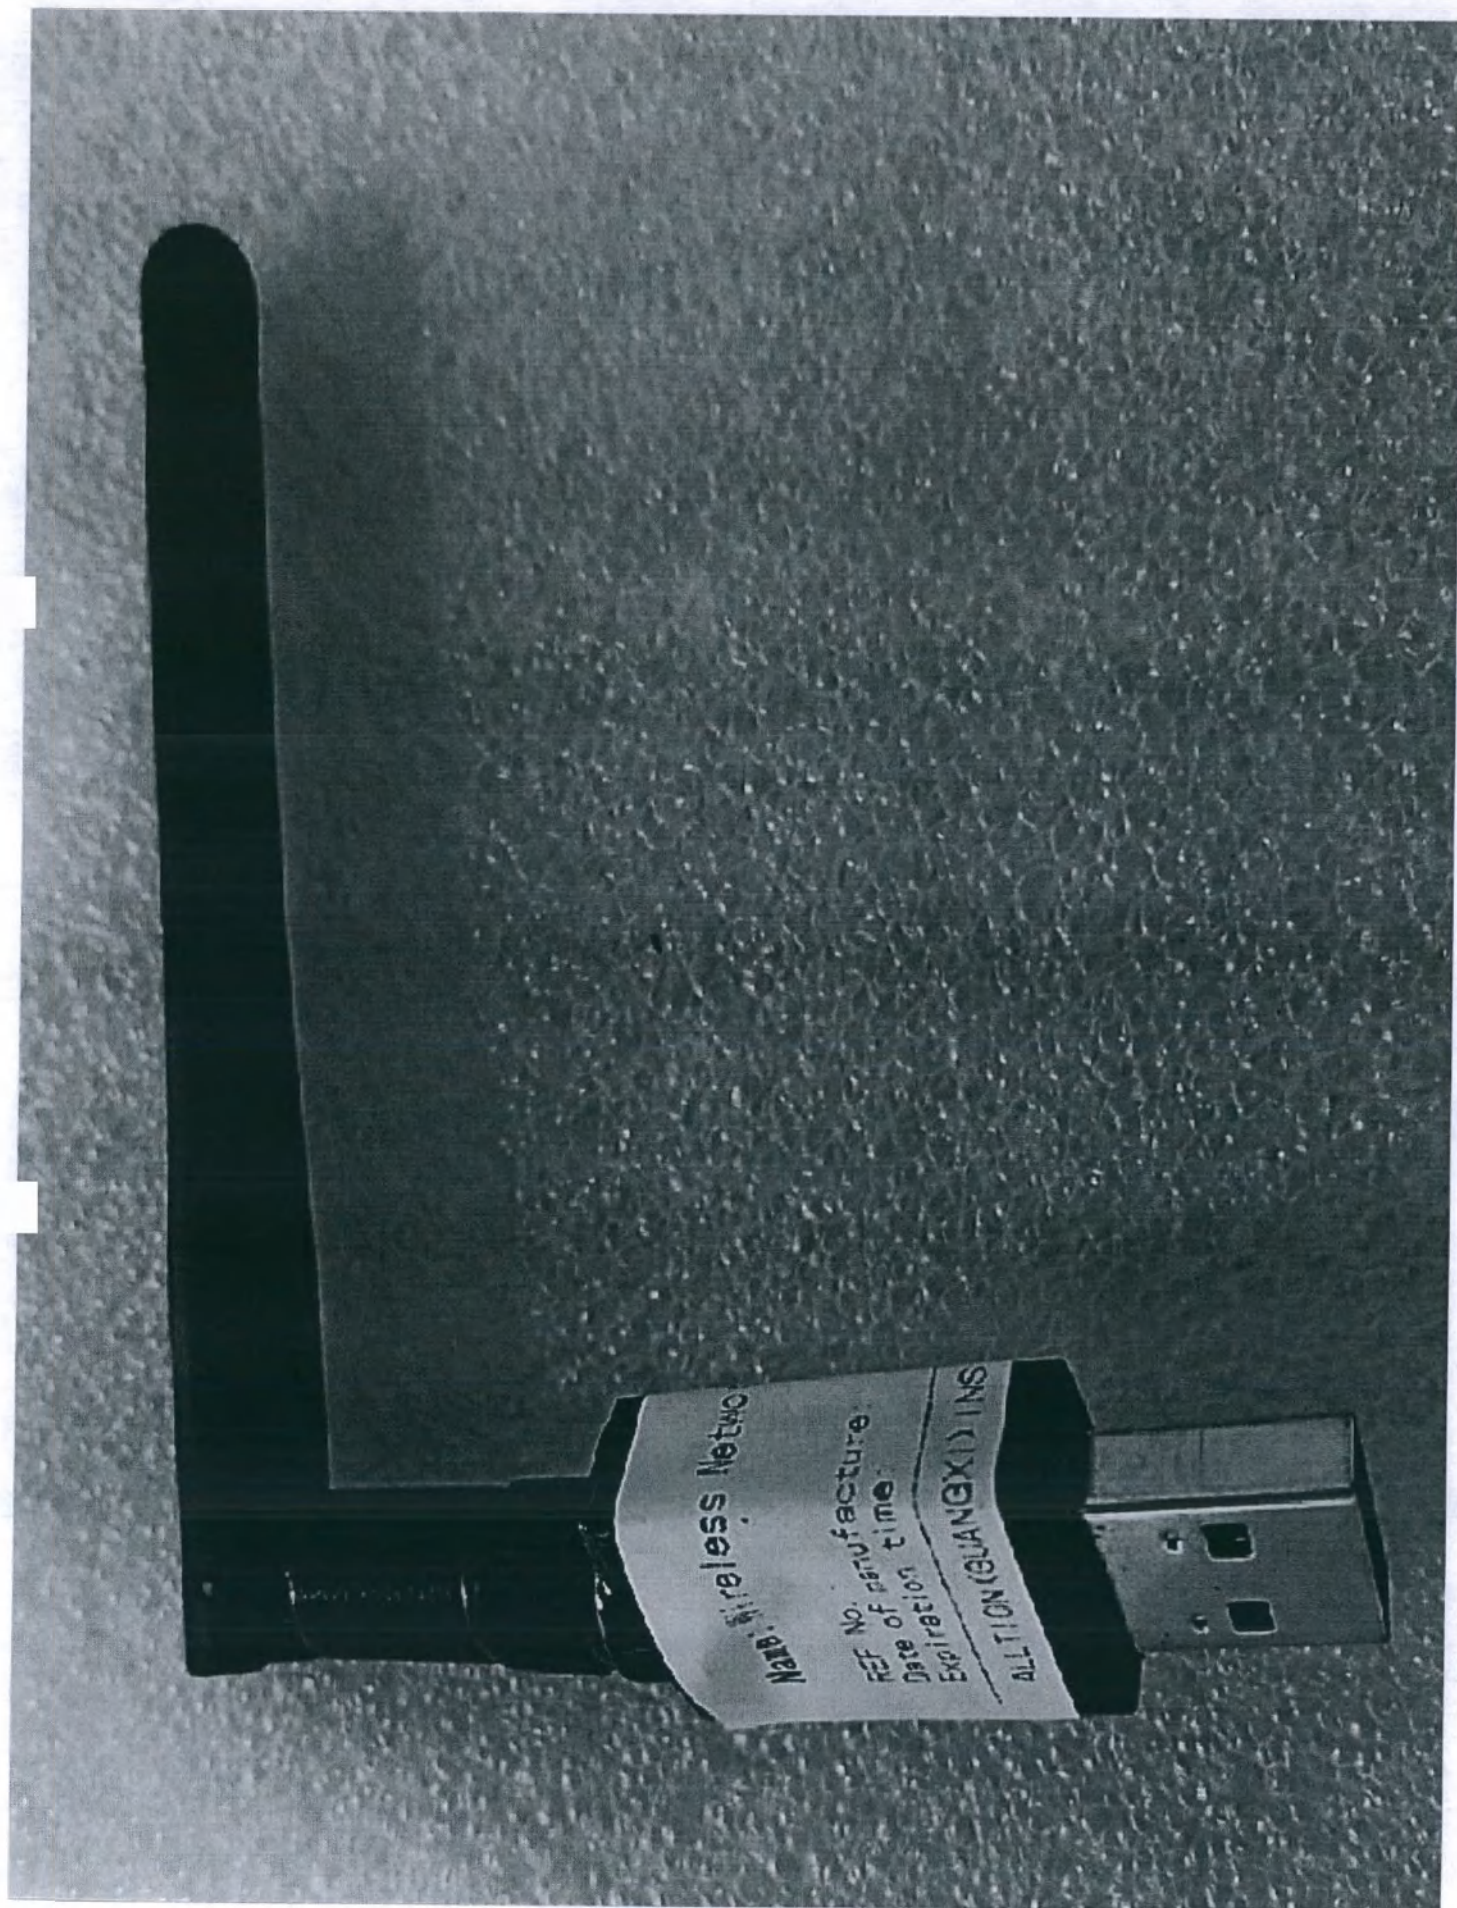

43) Мышка беспроводная (при необходимости) – 1 шт. (Wireless Mouse (if necessary) - 1 pc)

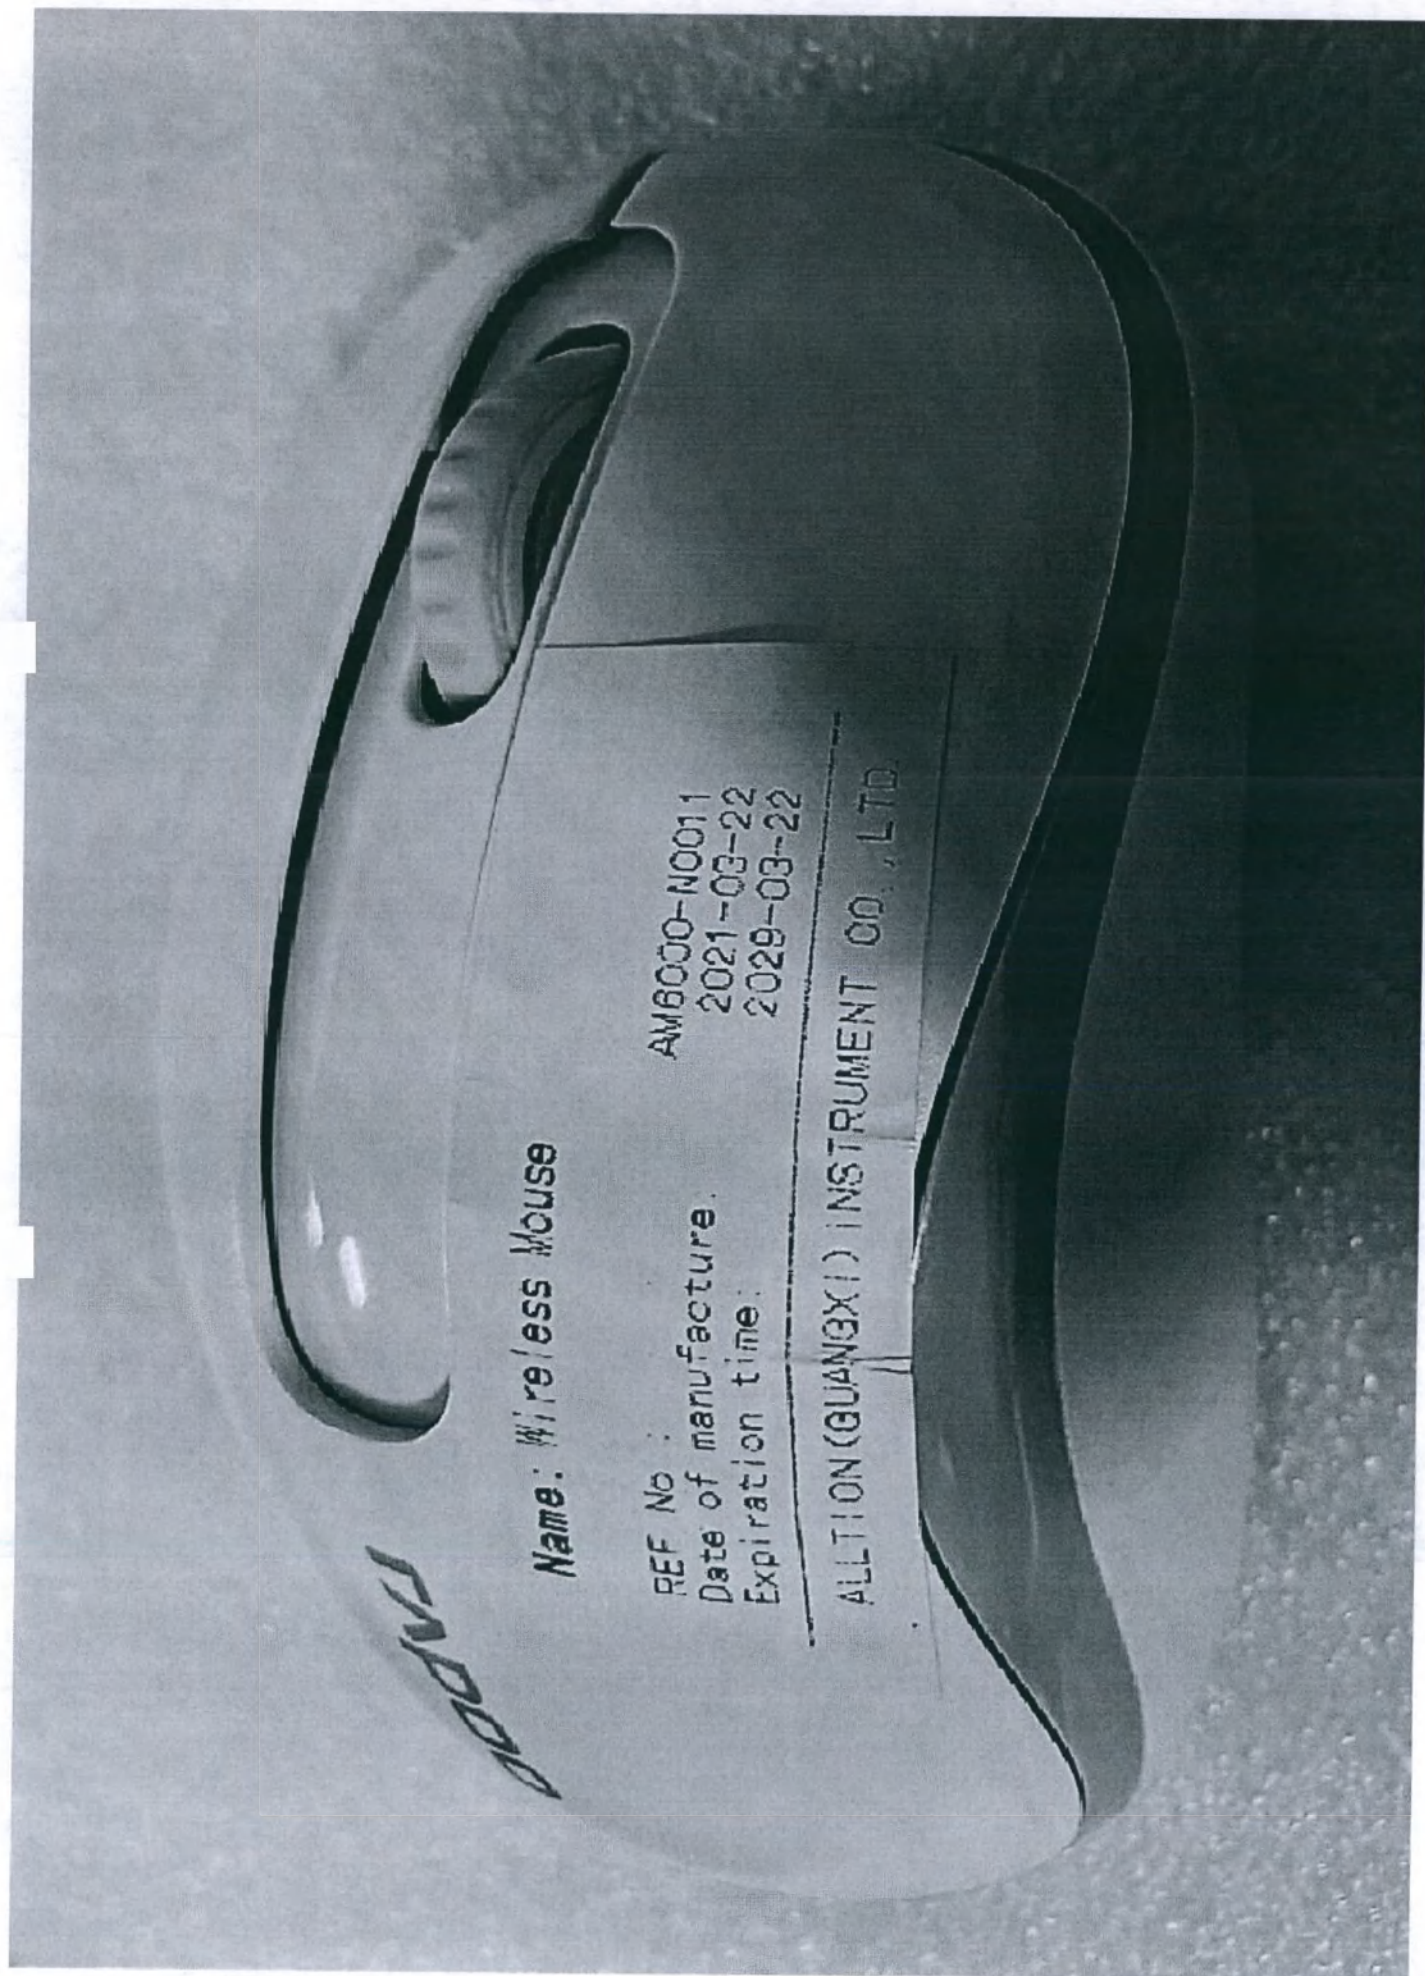


44) Предохранитель (при необходимости) – 2 шт. (Fuse (if necessary) – 1 pcs.)

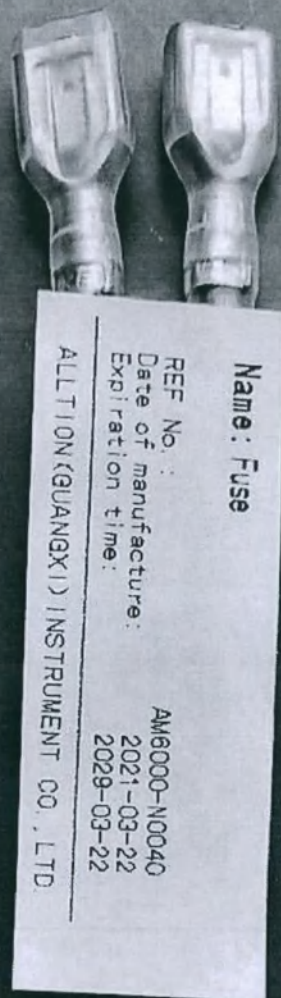


45) Комплект ручек регулировки для АМ-6000 (при необходимости) – 1 шт. (Set of adjustment knobs for AM-6000 (if necessary) – 1 pc.)




46) Подставка для телефона/планшета (при необходимости) – 1 шт. (Phone/Pad Holder (if necessary) – 1 pc)

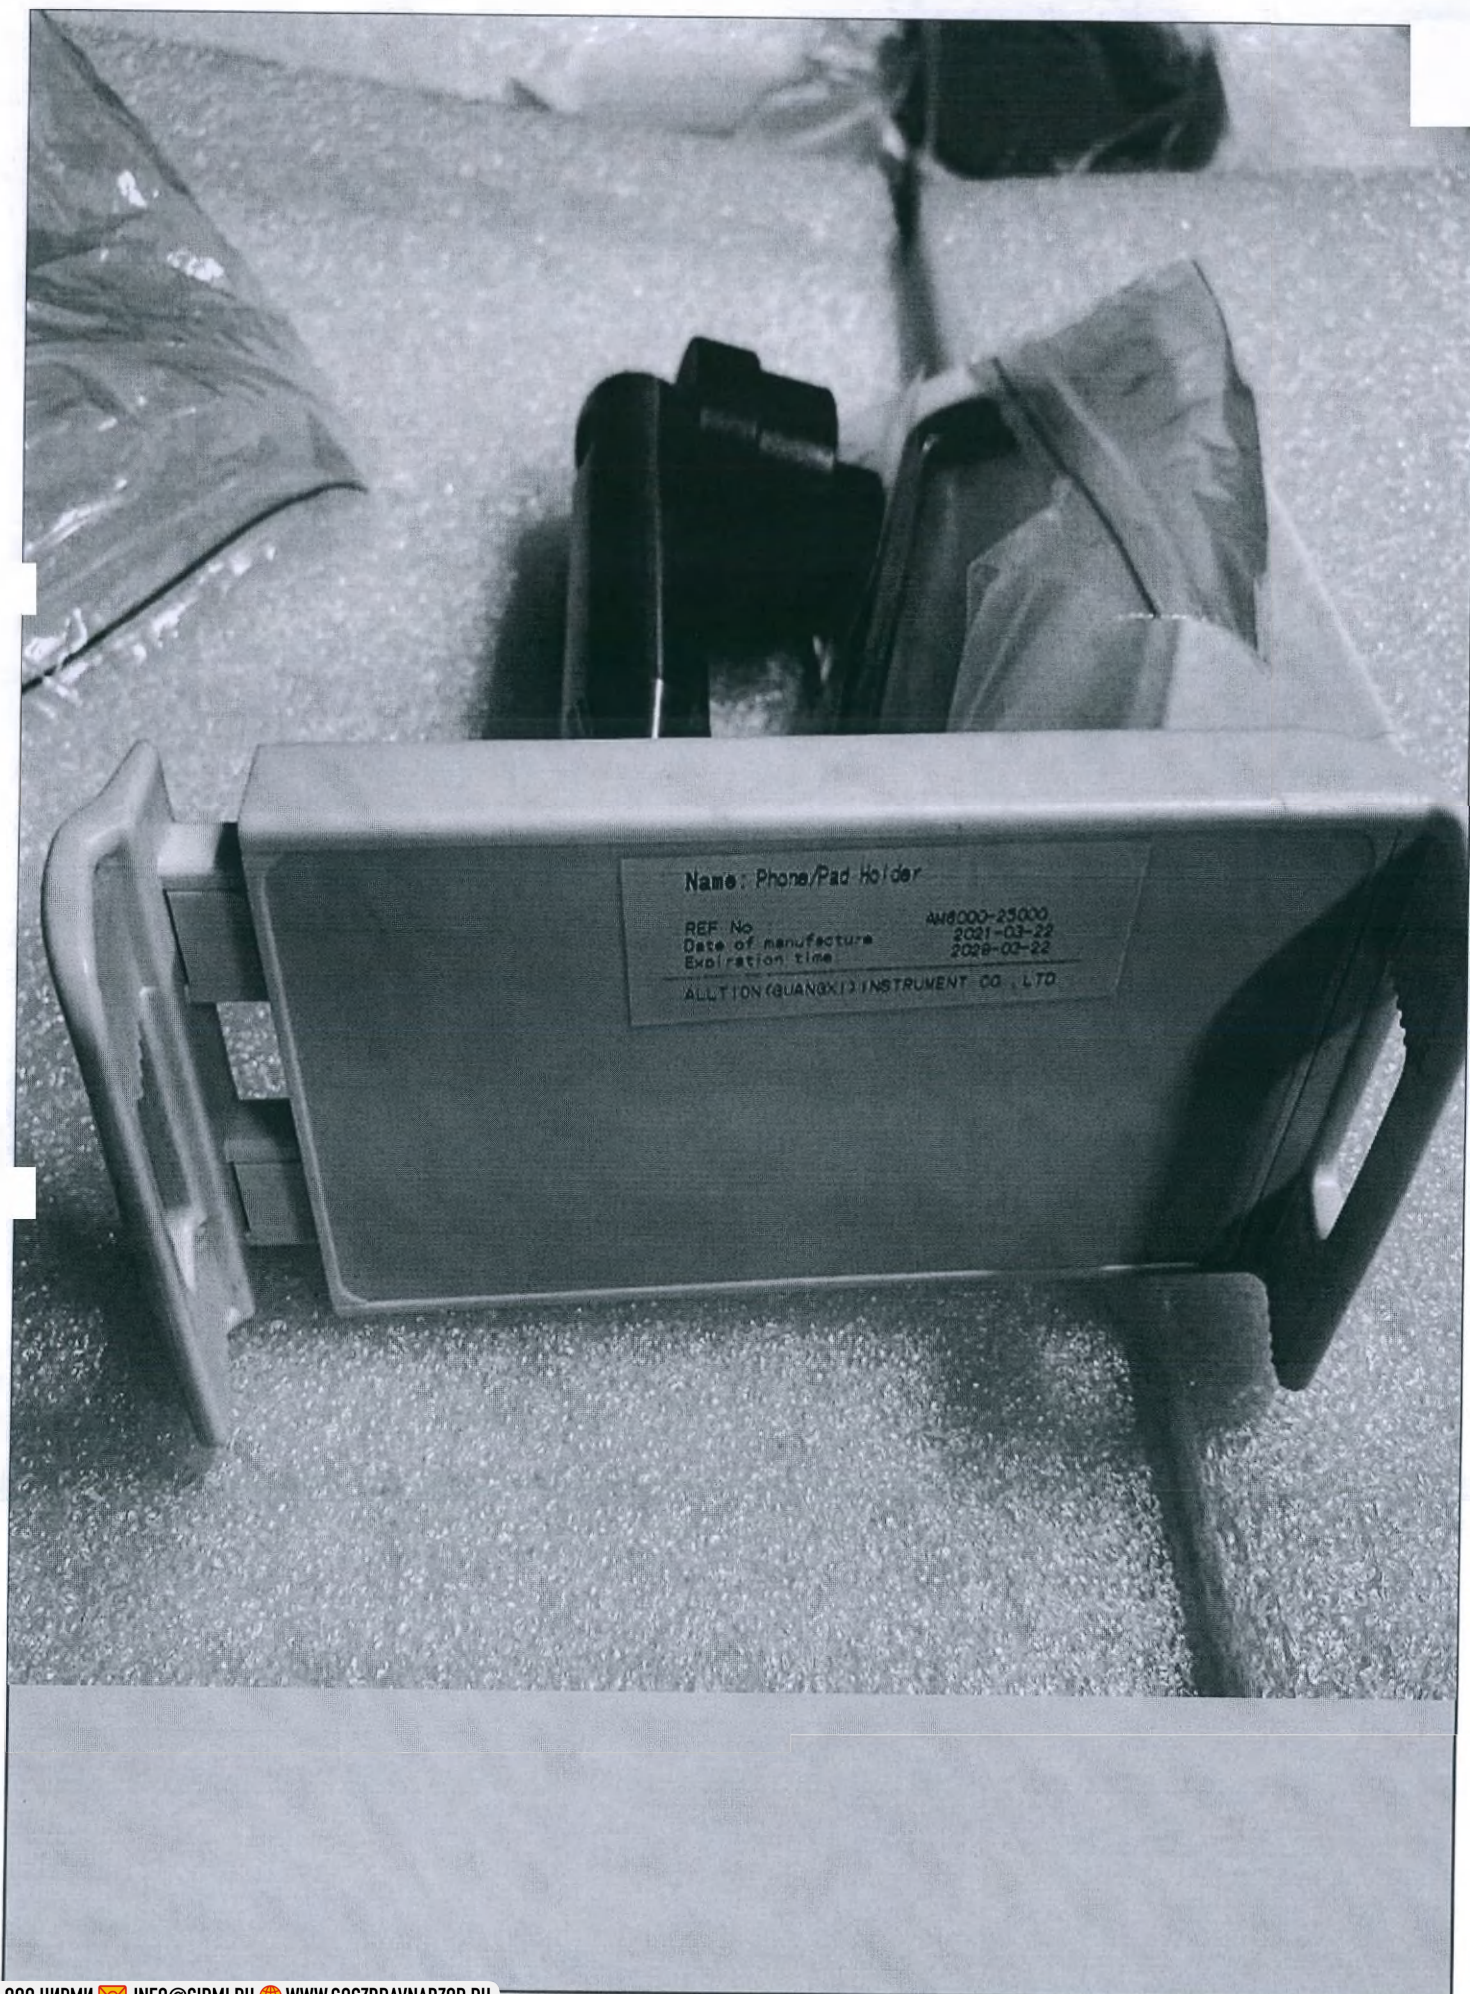

47) Кронштейн для монитора (при необходимости) – 1 шт. (Monitor Bracket (if necessary) – 1 pc.)

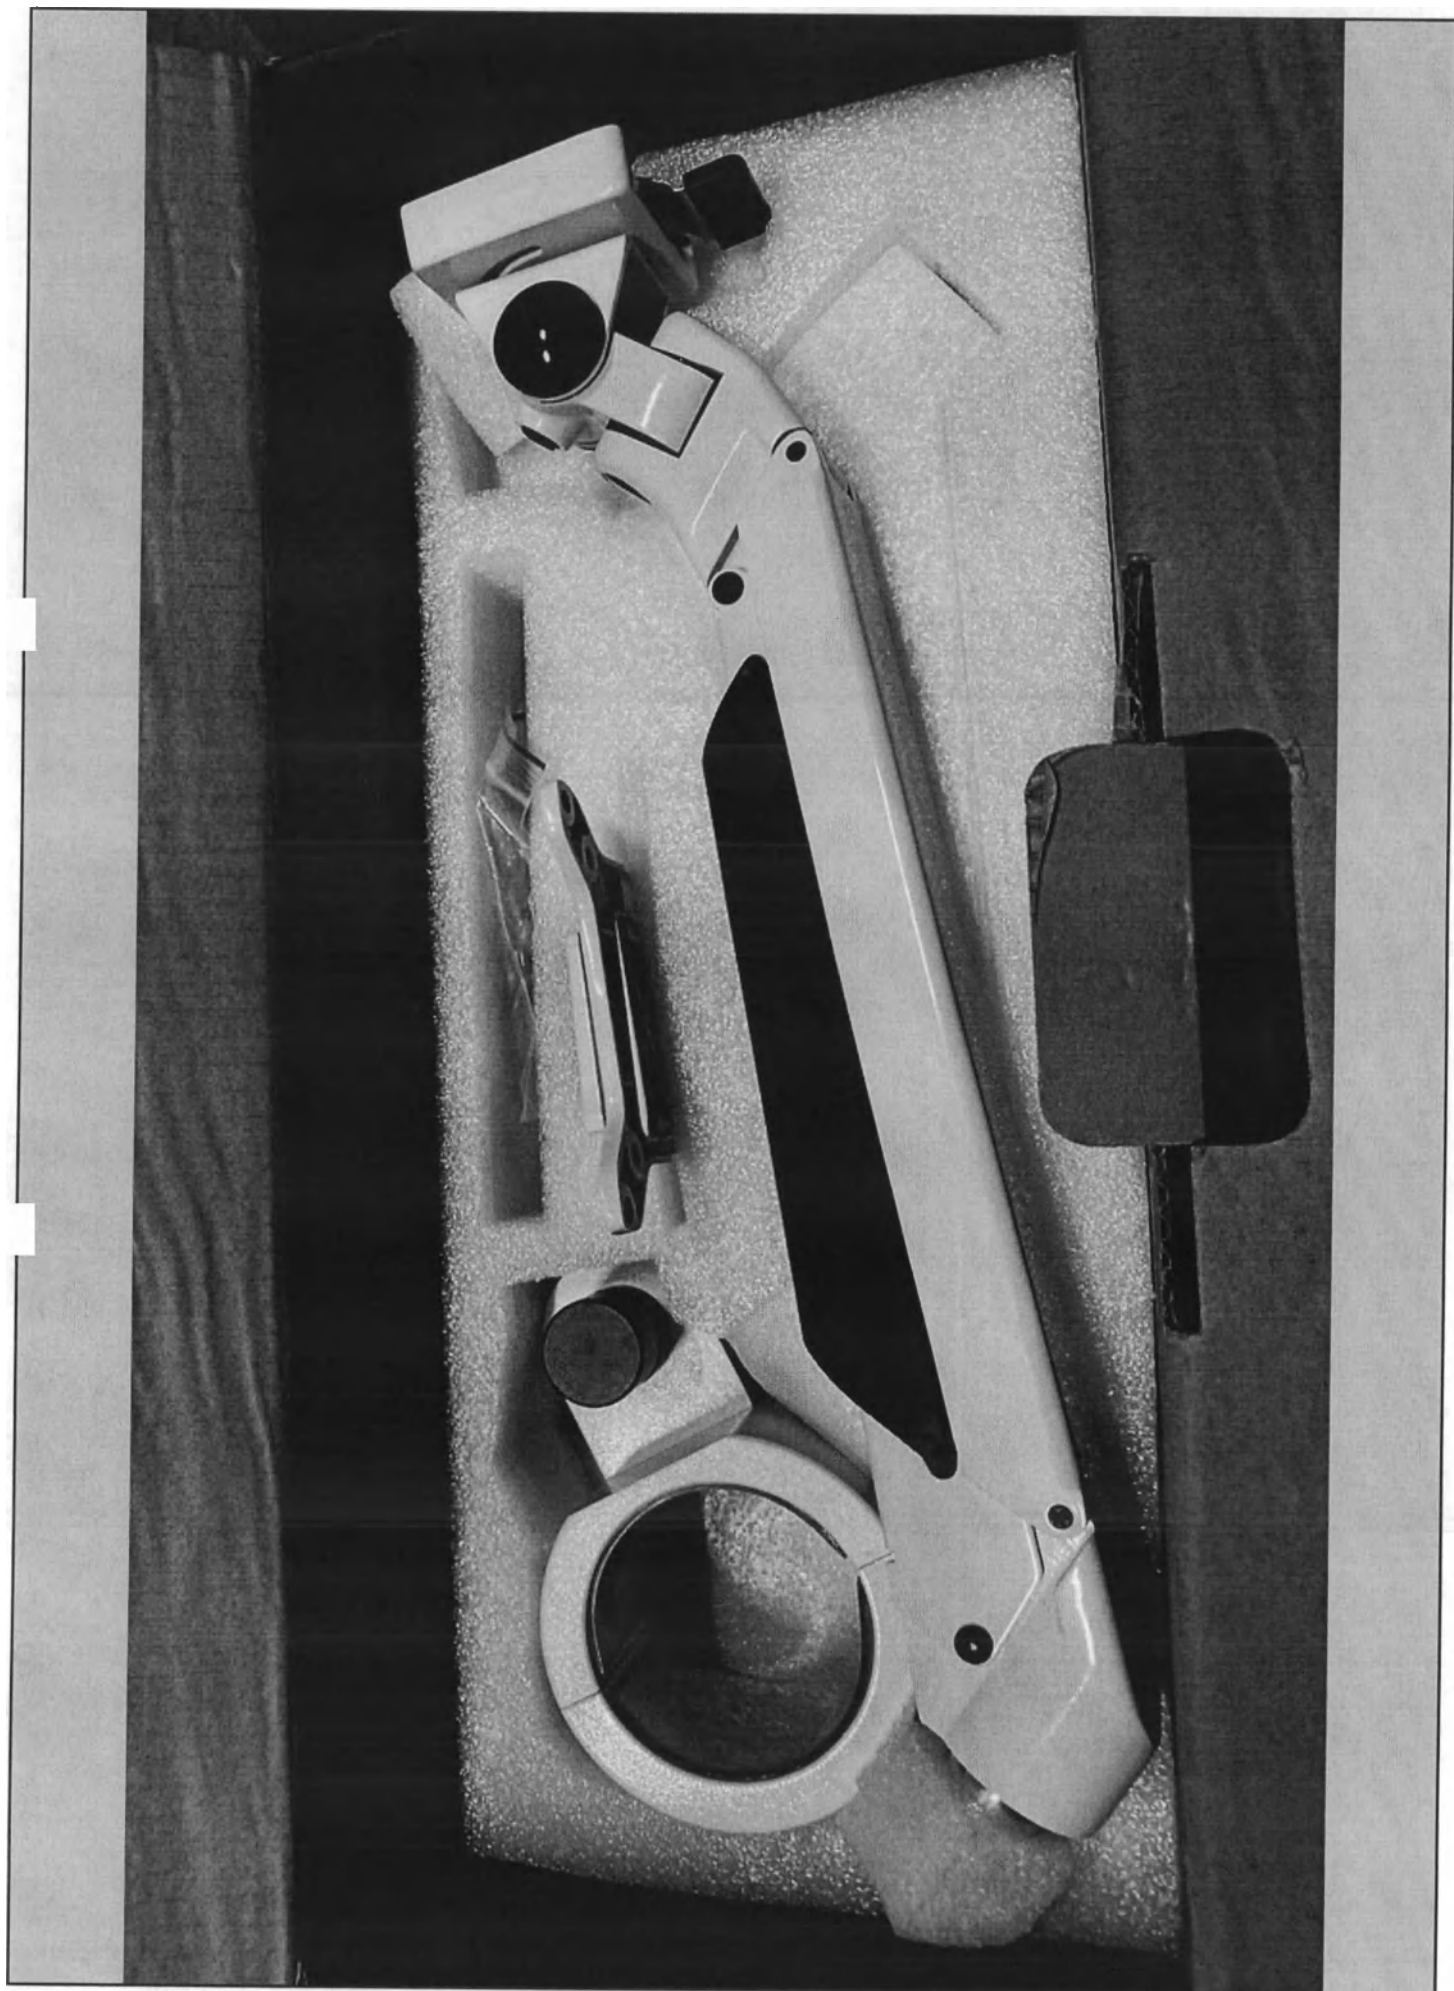

48) Объектив с переменным фокусным расстоянием F=200-300 мм для АМ-6000 (при необходимости) – 1 шт. (F200-300 mm Variable Objective Lens for AM-6000 (if necessary) – 1 pc.)

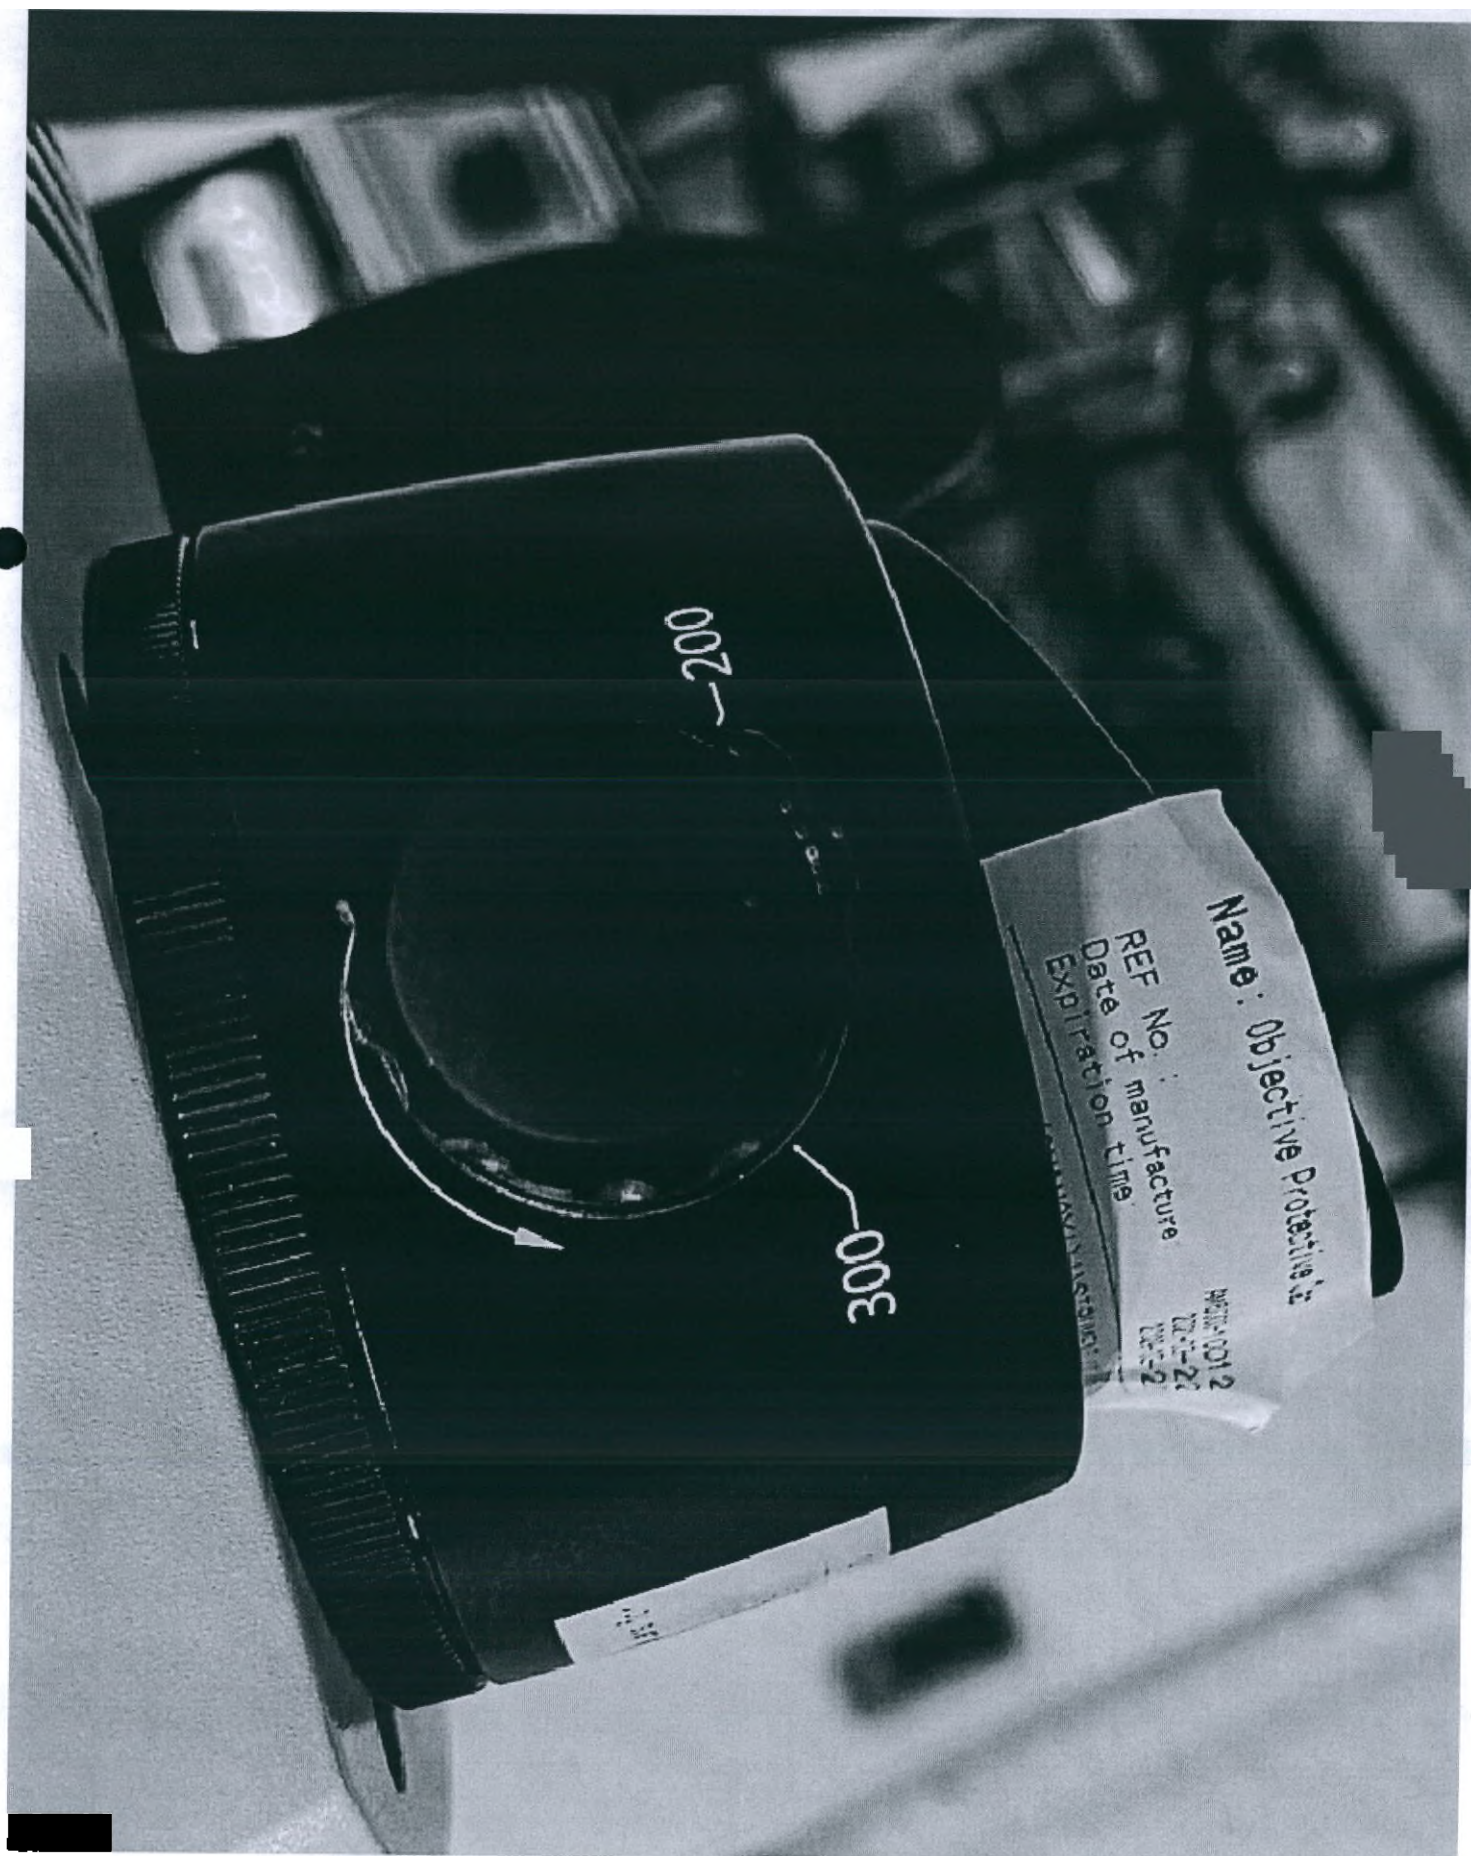

49) Объектив с переменным фокусным расстоянием $F=198-455$ мм для АМ-6000 (при необходимости) – 1 шт. (F198-455 mm Variable Objective Lens for AM-6000 (if necessary) – 1 pc.)




50) Объектив F250 для AM-6000 (при необходимости) – 1 шт. (F250mm Objective Lens for AM-6000 (if necessary)

1

pc.)


нопор 9

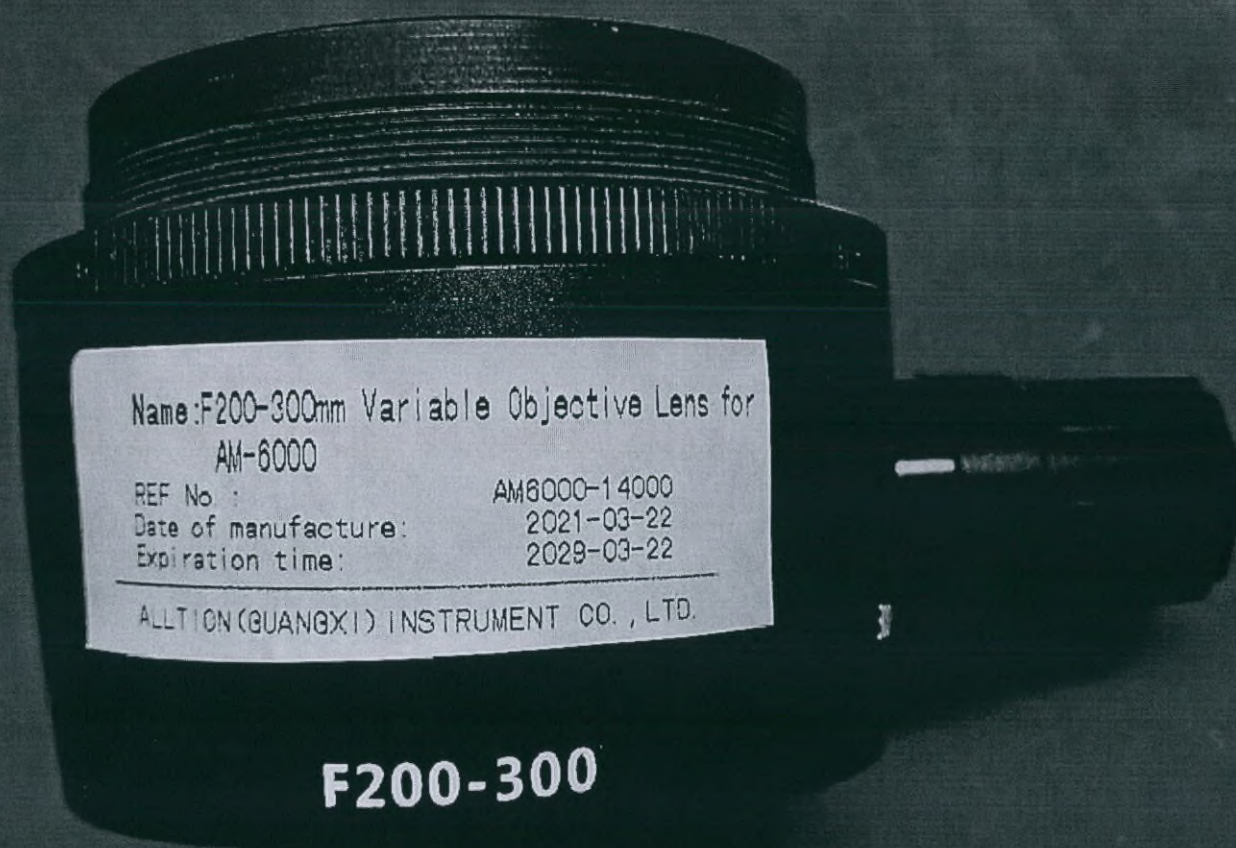


51) Объектив F300 для AM-6000 (при необходимости) – 1 шт. (F300mm Objective Lens for AM-6000 (if necessary) – 1 pc.)



52) Набор инструментов для установки (Toolbox for installation)

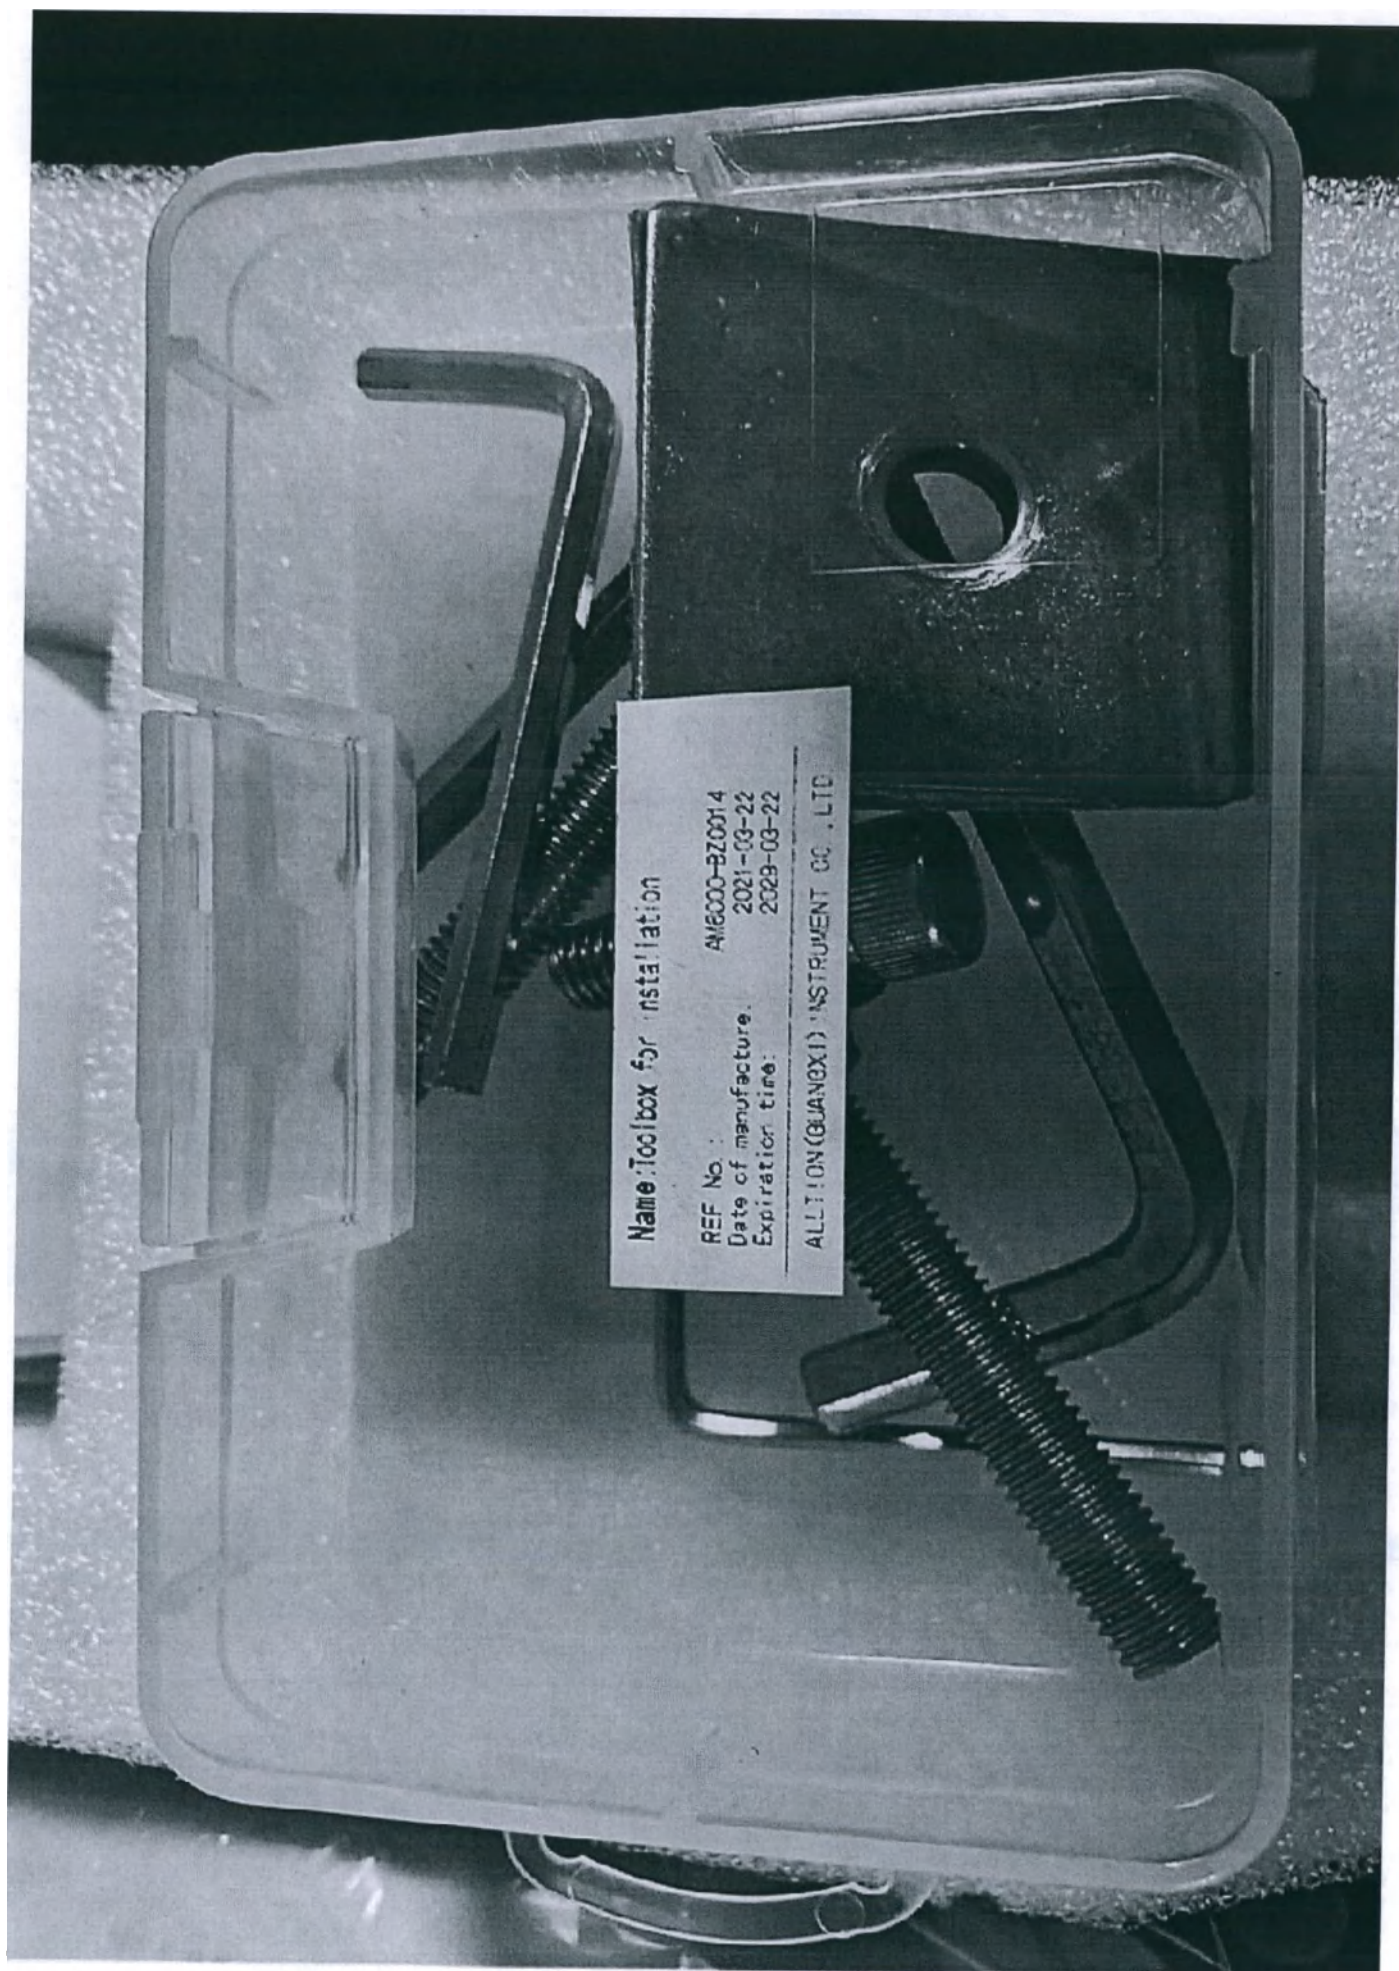

53) Печатная плата для АМ-6000 (при необходимости) – 1 шт. (Dimming Circuit Board for AM-6000 (if necessary) – 1 pc.)

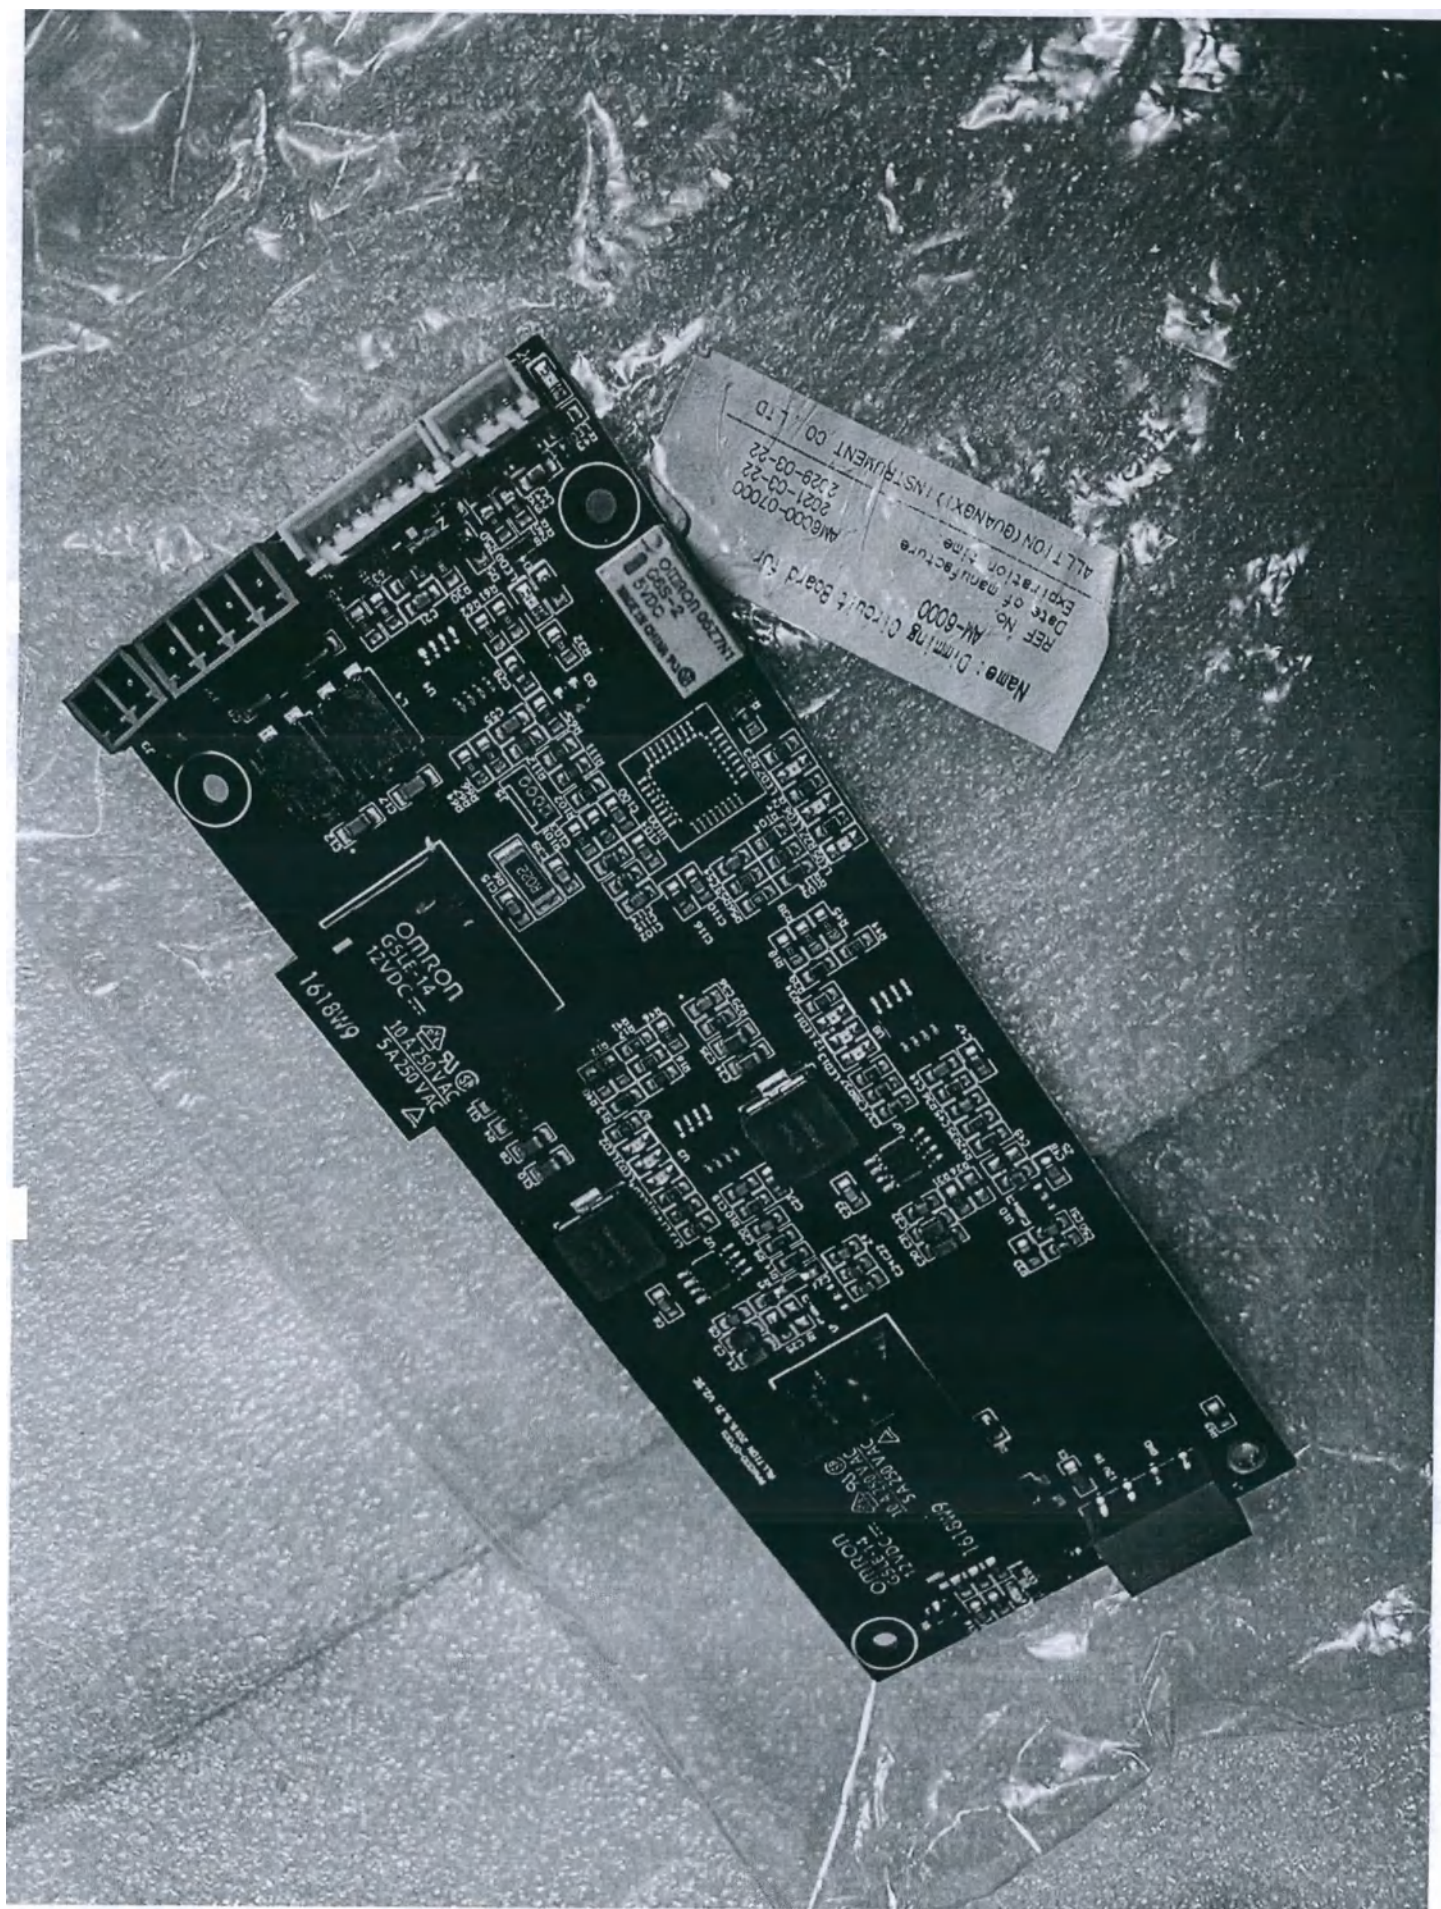

54) Переключатель педальный беспроводной FS-2 (при необходимости) – 1 шт. (Wireless footswitch FS-2 (if necessary) – 1 pc.)




55) Чехол пылезащитный – 1 шт. (Dust Cover – 1 pc)




honor 9

56) Колесо запасное (при необходимости) – не более 10 шт. (Caster (if necessary) – no more than 10 pcs.)

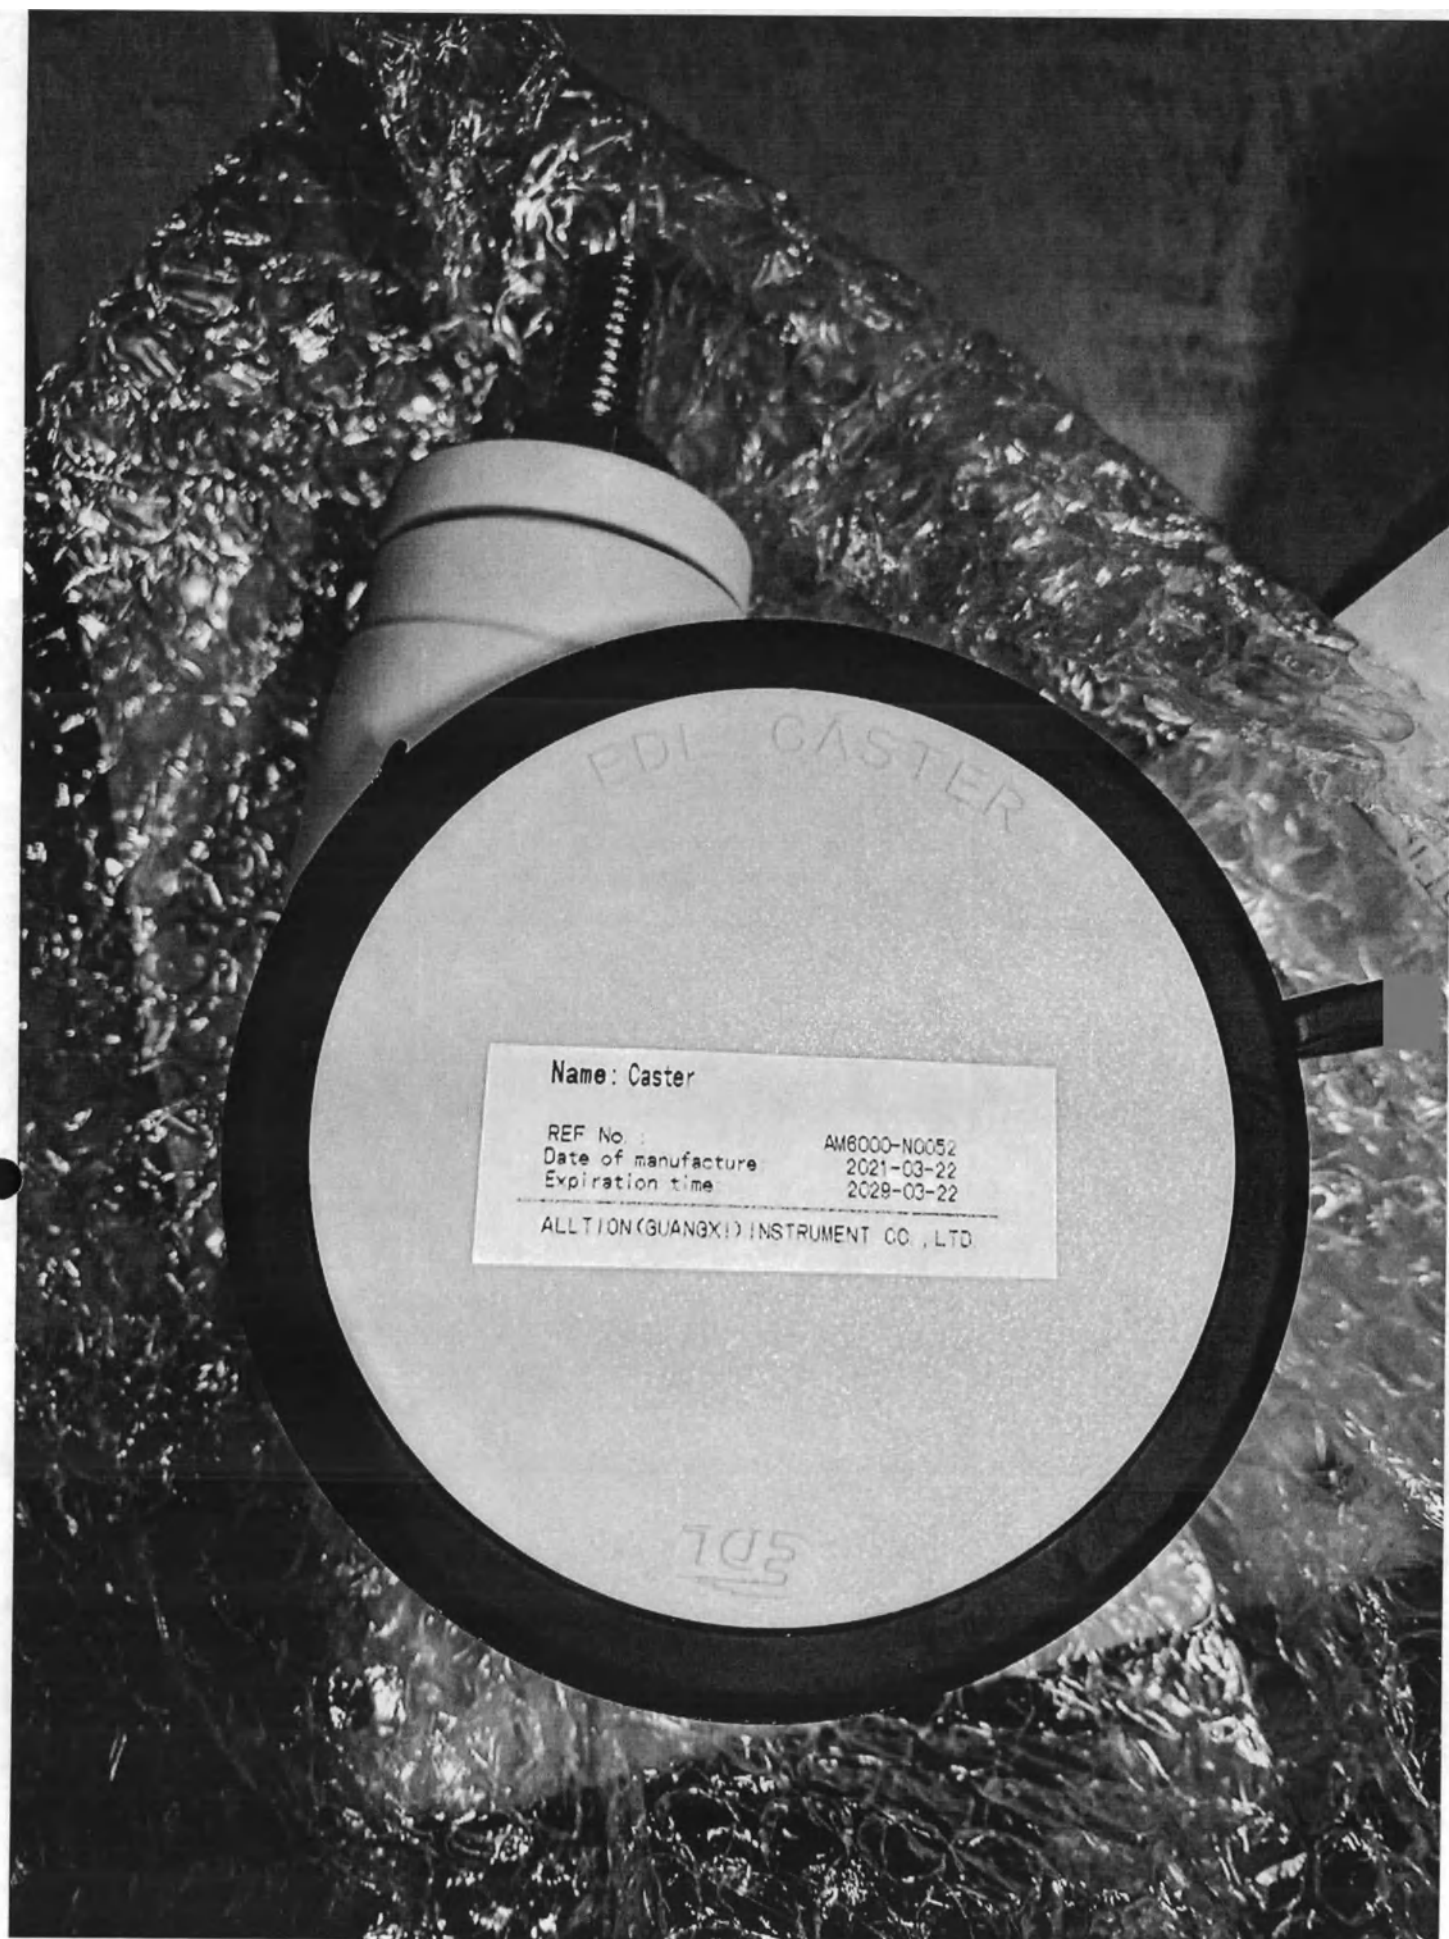

Name: Caster

REF No :	AM6000-N0052
Date of manufacture	2021-03-22
Expiration time	2029-03-22

ALLTION(GUANGXI) INSTRUMENT CO., LTD


57) Потенциометр (при необходимости) – 1 шт. (Potentiometer (if necessary) – 1 pc.)



58) Адаптер питания (при необходимости) – 1 шт. (Power adapter (if necessary) – 1 pc.)



59) Адаптер цифровой камеры F180 (при необходимости) – 1 шт. (F180 Digital Camera Adapter (if necessary) – 1 pc.)

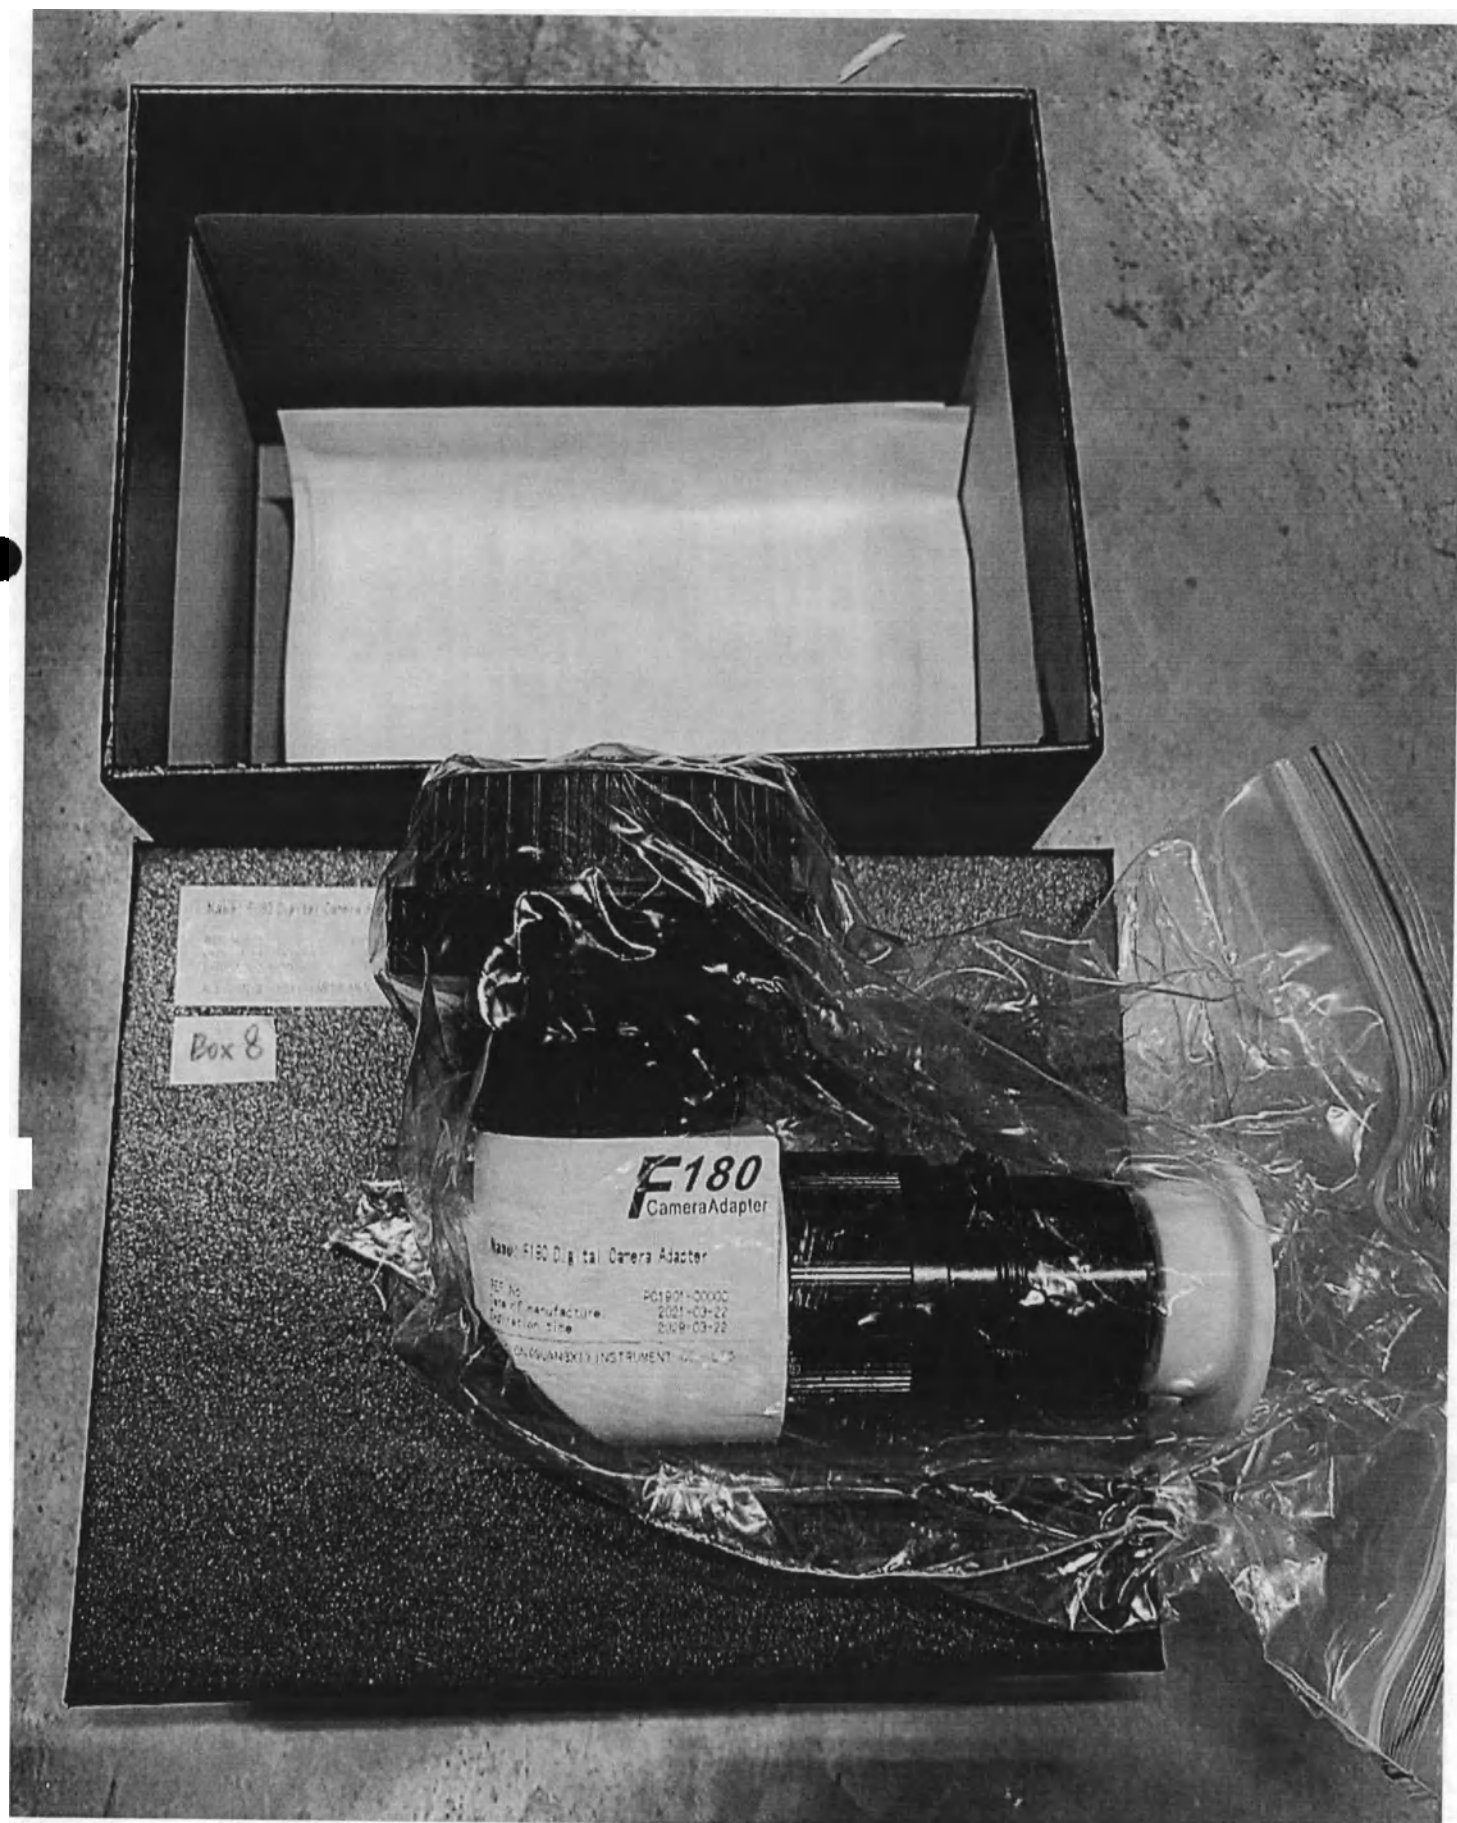


60) Адаптер цифровой камеры F340 (при необходимости) – 1 шт. (F340 Digital Camera Adapter (if necessary) – 1 pc.)



61) Адаптер для мобильного телефона (Mobile Phone Adapter)



62) Муфта противоположного тубуса (Opposite scope connector)

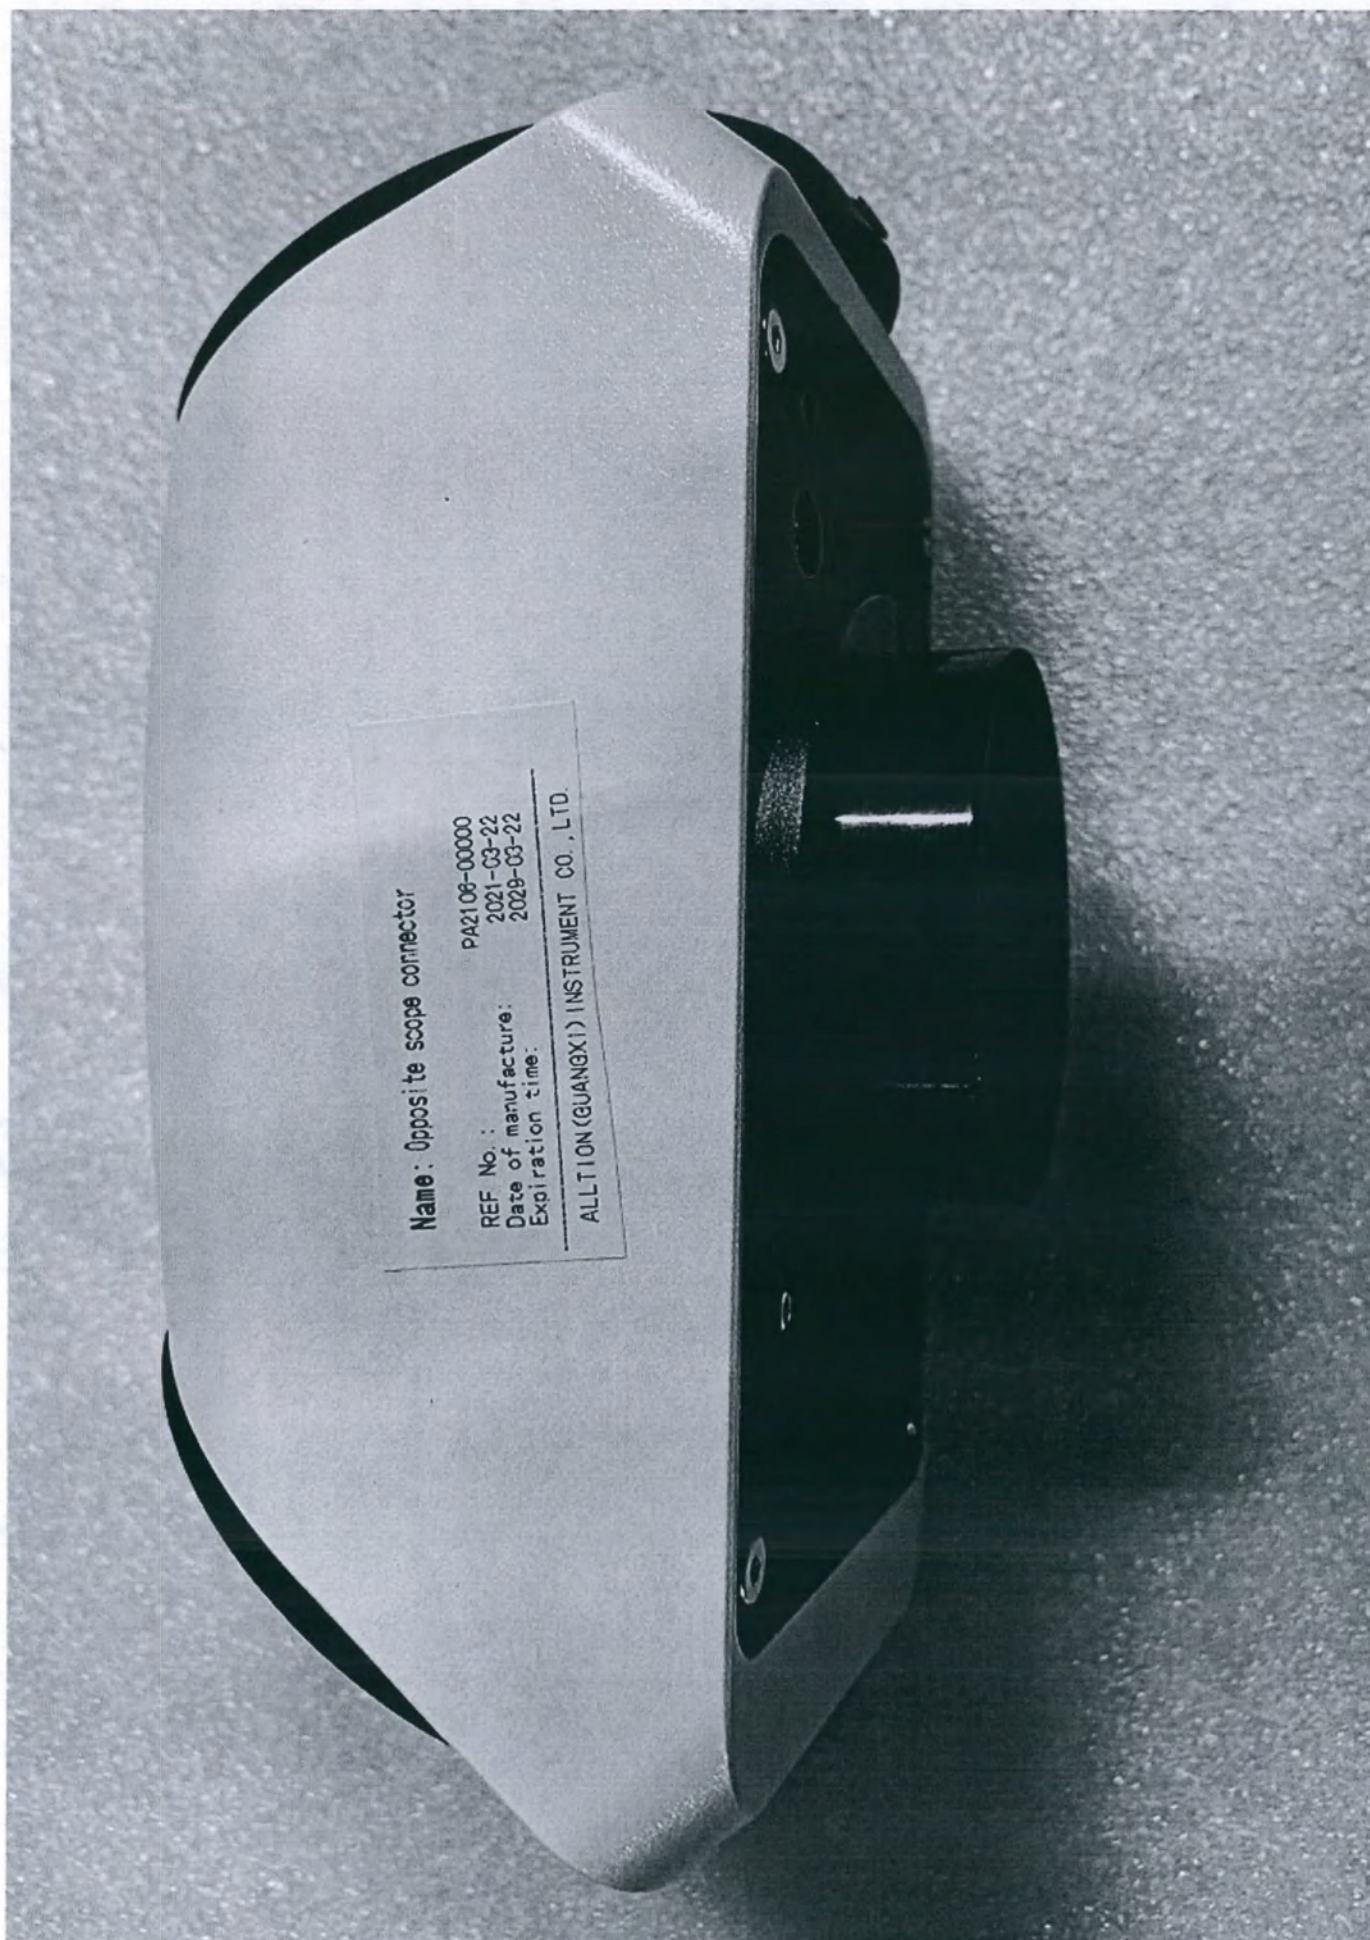

64) Руководство по эксплуатации – 1 шт. (User's manual – 1 pc.)



