

«Утверждаю»

Генеральный директор

ООО «БТЛ»



Мираев И.

«2» августа 2023 г.

Фотографические изображения медицинского изделия:

**«Многофункциональная платформа BTL-785F комбинированного радиочастотного
и ультразвукового воздействия»**

I. Базовый состав:




1. Основной блок 1 шт.



2. Запасные предохранители Т10АН/250V для основного блока 2 шт.



3. Основной кабель 1 шт.



4. Кабель нейтрального электрода BTL-785-6 1 шт.





5. Нейтральные электроды BTL-NE-170, 25 шт. в упаковке - 1 упаковка



6. Силиконовый стакан BTL-785-10 - 1 шт.



7. Силиконовый стакан BTL-785-11 (при необходимости) - 2 шт.



8. Силиконовый стакан BTL-785-12 (при необходимости) - 1 шт.



9. Подставка для хранения BTL-785-13 1 шт.






10. Держатель для аппликатора BTL-785-14 - 1 шт.







11. Держатель для аппликатора BTL-785-15 (при необходимости) - 1 шт.

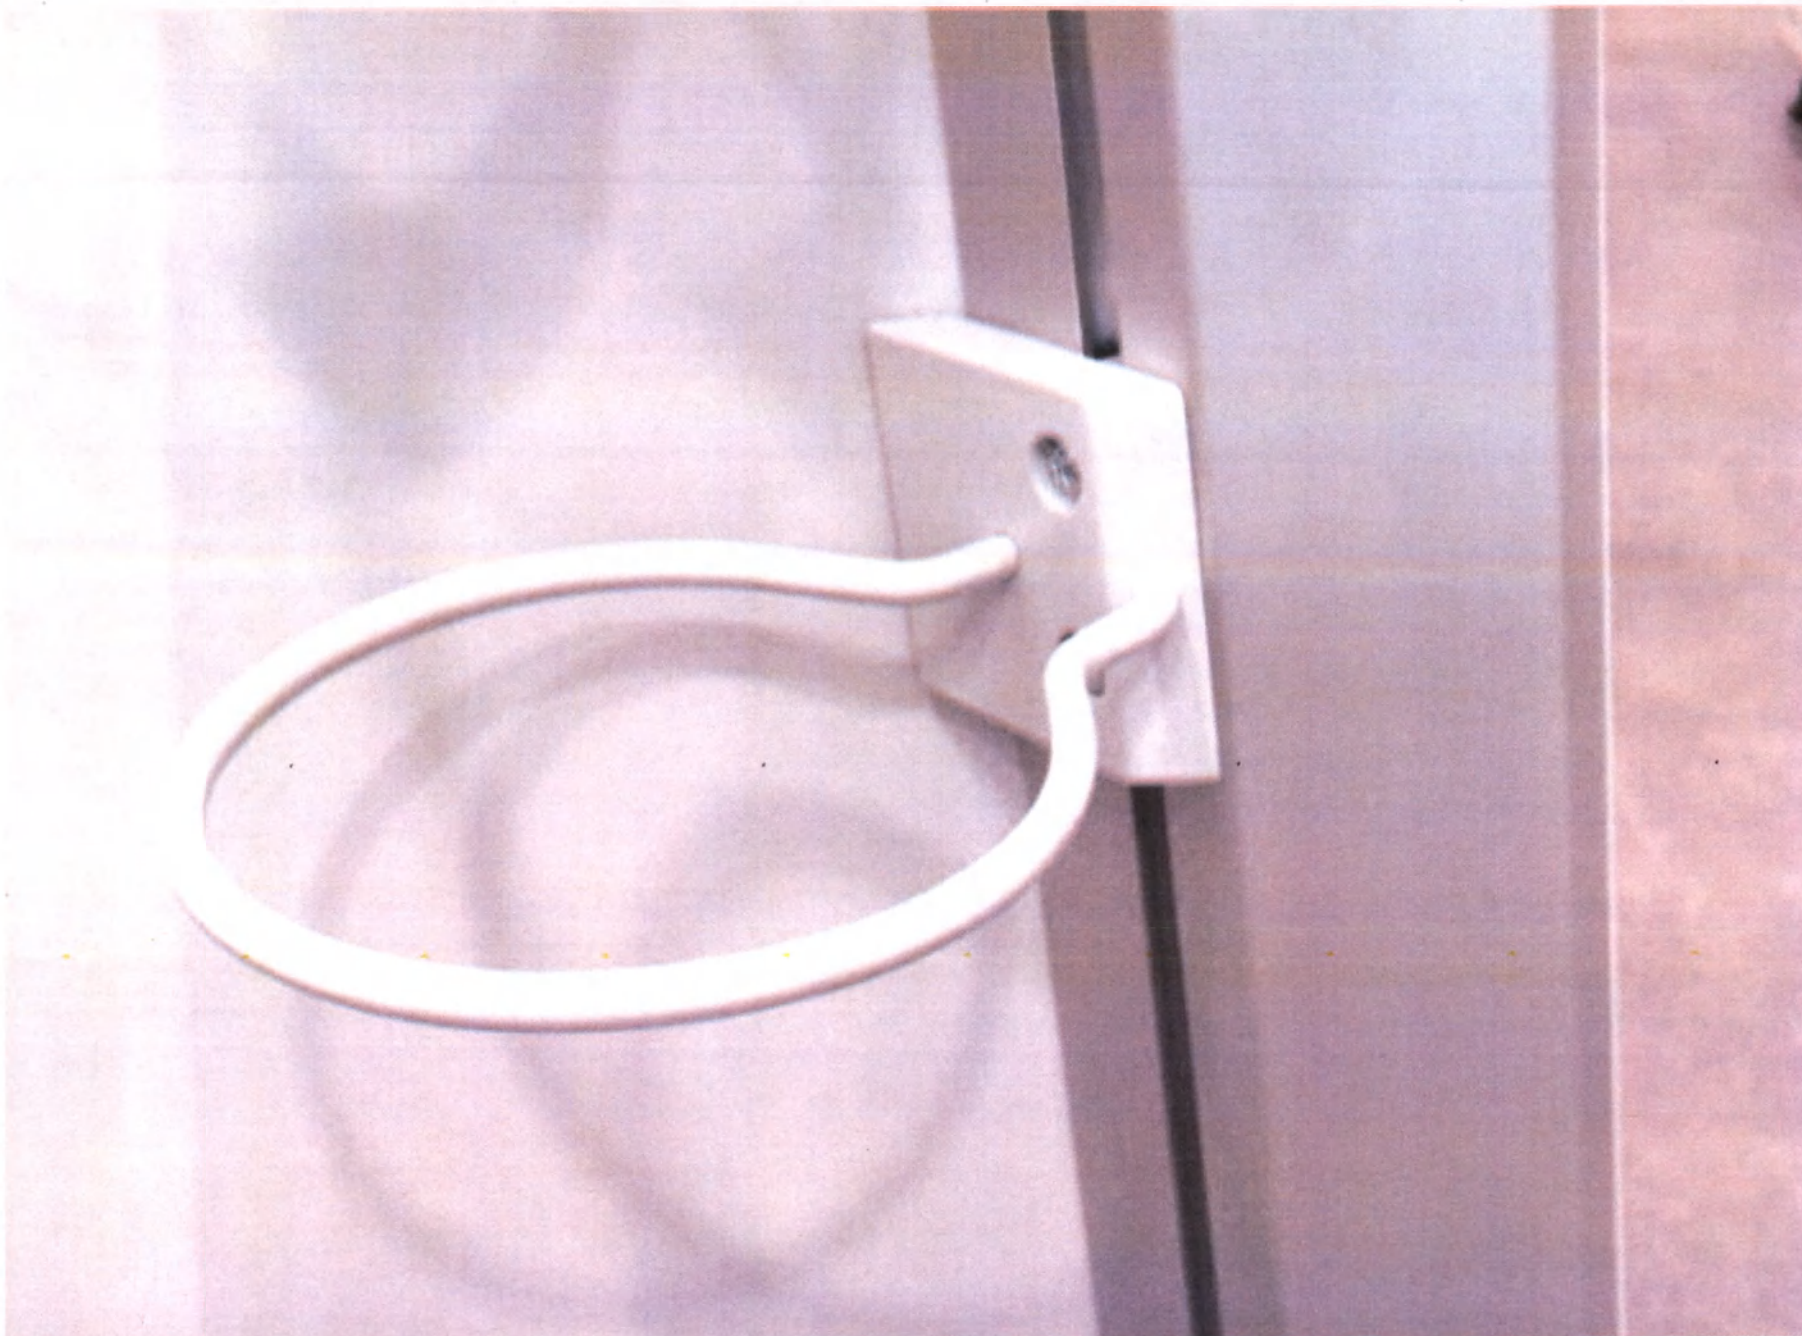

12. Держатель для аппликатора BTL-785-16 - 1 шт.

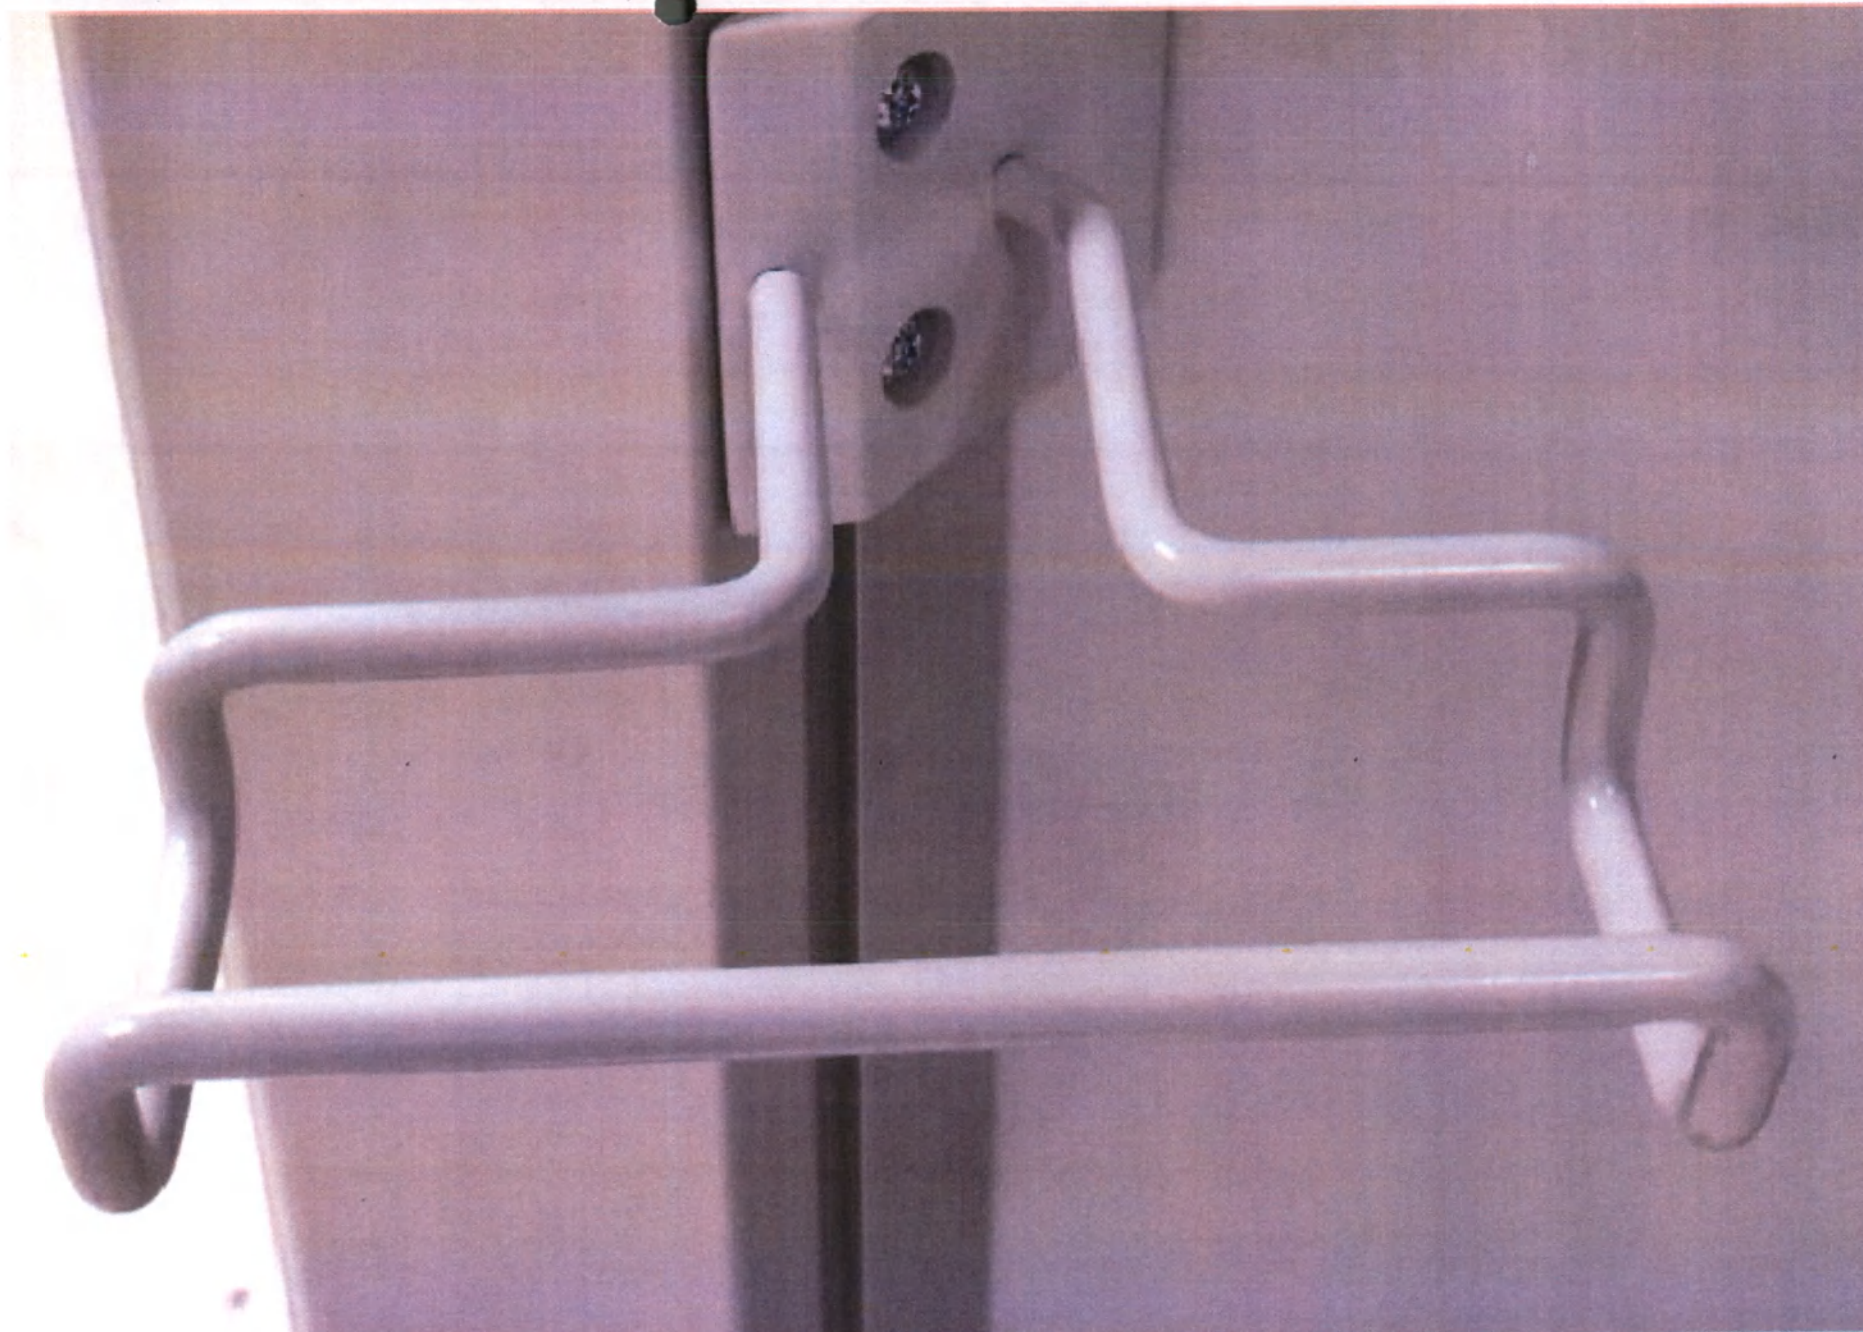


13. Держатель для аппликатора BTL-785-17 - 1 шт.



14. Держатель кабеля BTL-785-18 - 1 шт.





15. Большой аппликатор BTL-785-1 - 1 шт.






16. Малый аппликатор BTL-785-2 (при необходимости) - 1 шт.



17. Аппликатор EMFEMME 360 BTL-785-3 (при необходимости) - 1 шт.




18. Аппликатор фракционный BTL-785-4 (при необходимости) - 1 шт.



19. Аппликатор EMFACE BTL-785-7, в составе (при необходимости):

- Держатель аппликатора EMFace – 1 шт.
- Электрод EMFace для лба BTL-785-7-1, в упаковке 20 шт. – 1 уп.
- Электрод EMFace для щеки BTL-785-7-2, в упаковке 40 шт. – 1 уп.
- Кабель для электродов EMFace – 3 шт.

- Кабель для подключения аппликатора EMFace – 1 шт.
- Кнопка пациента (Therapy Discomfort Button) – 1 шт.
- Держатель кнопки пациента – 1 шт.



- Держатель аппликатора EMFace – 1 шт.

EMFACE




РФ 1000 011
79 500 100000 100
84 111 800000 000

84 111 800000 000
84 111 800000 000



BTL-785-7-1
Use with
BTL-785-7

BTL Italia S.r.l.
Via Sesto San Giovanni, 120.
04131, Sesto San Giovanni, Italy





BTL Industries Ltd.
161 Cleveland Way, Stevenage, Hertfordshire,
SG1 6BU, United Kingdom



EMFACE









- Электрод EMFace для лба BTL-785-7-1, в упаковке 20 шт. – 1 уп.

EMFACE




STL-TMS-7-2
STL-TMS-1







- Электрод EMFace для щеки BTL-785-7-2, в упаковке 40 шт. – 1 уп.



- Кабель для электродов EMFace – 3 шт



- Кабель для подключения аппликатора EMFace – 1 шт.



- Держатель кнопки пациента – 1 шт.



- Кнопка пациента (Therapy Discomfort Button) – 1 шт.



**Многофункциональная
платформа BTL-785F
комбинированного
радиочастотного и
ультразвукового
воздействия с
принадлежностями**

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

20. Руководство пользователя - 1 шт.

II. Принадлежности



1. Насадка аппликатора BTL-785-1-1 (при необходимости) - 1 шт.



2. Сменная насадка аппликатора BTL-785-2-1 (при необходимости) - 1 шт.




3. Набор насадок V tip BTL-785-3-1, в наборе 5 шт. (при необходимости) - 1 шт.



4. Набор насадок V 24 tip BTL-785-3-2, в наборе 5 шт (при необходимости) - 1 шт.



5. Набор насадок V 30 тип BTL-785-3-3, в наборе 5 шт (при необходимости) - 1 шт.



6. Набор неизолированных насадок BTL-785-4-5, в наборе 10 шт (при необходимости) - 1 шт.

7. Набор изолированных насадок BTL-785-4-6, в наборе 10 шт (при необходимости) - 1 шт.



8. Набор поверхностных насадок 32 BTL-785-4-7, в наборе 10 шт (при необходимости) - 1 шт.



9. Набор поверхностных насадок 64 BTL-785-4-8, в наборе 10 шт (при необходимости) - 1 шт.



10. Чистящая салфетка - 1 шт.



11. Чехол для транспортировки - 1 шт.



12. Сервисная карта - 1 шт.

 ВНИМАНИЕ

Не снимайте корпус. Опасность поражения электрическим током. Не содержит обслуживаемых пользователем компонентов. Обратитесь к квалифицированному обслуживающему персоналу.

**Многофункциональная платформа BTL-785F
комбинированного радиочастотного и ультразвукового
воздействия с принадлежностями**

Ультразвук – непрерывная форма волны

1,9 МГц $\pm 10\%$

570 кГц $\pm 10\%$




IP20




БТЛ Индастриз Лимитед (BTL Industries Limited)

161 Cleveland Way, Stevenage, Hertfordshire, SG1 6BU, United Kingdom, Соединенное Королевство



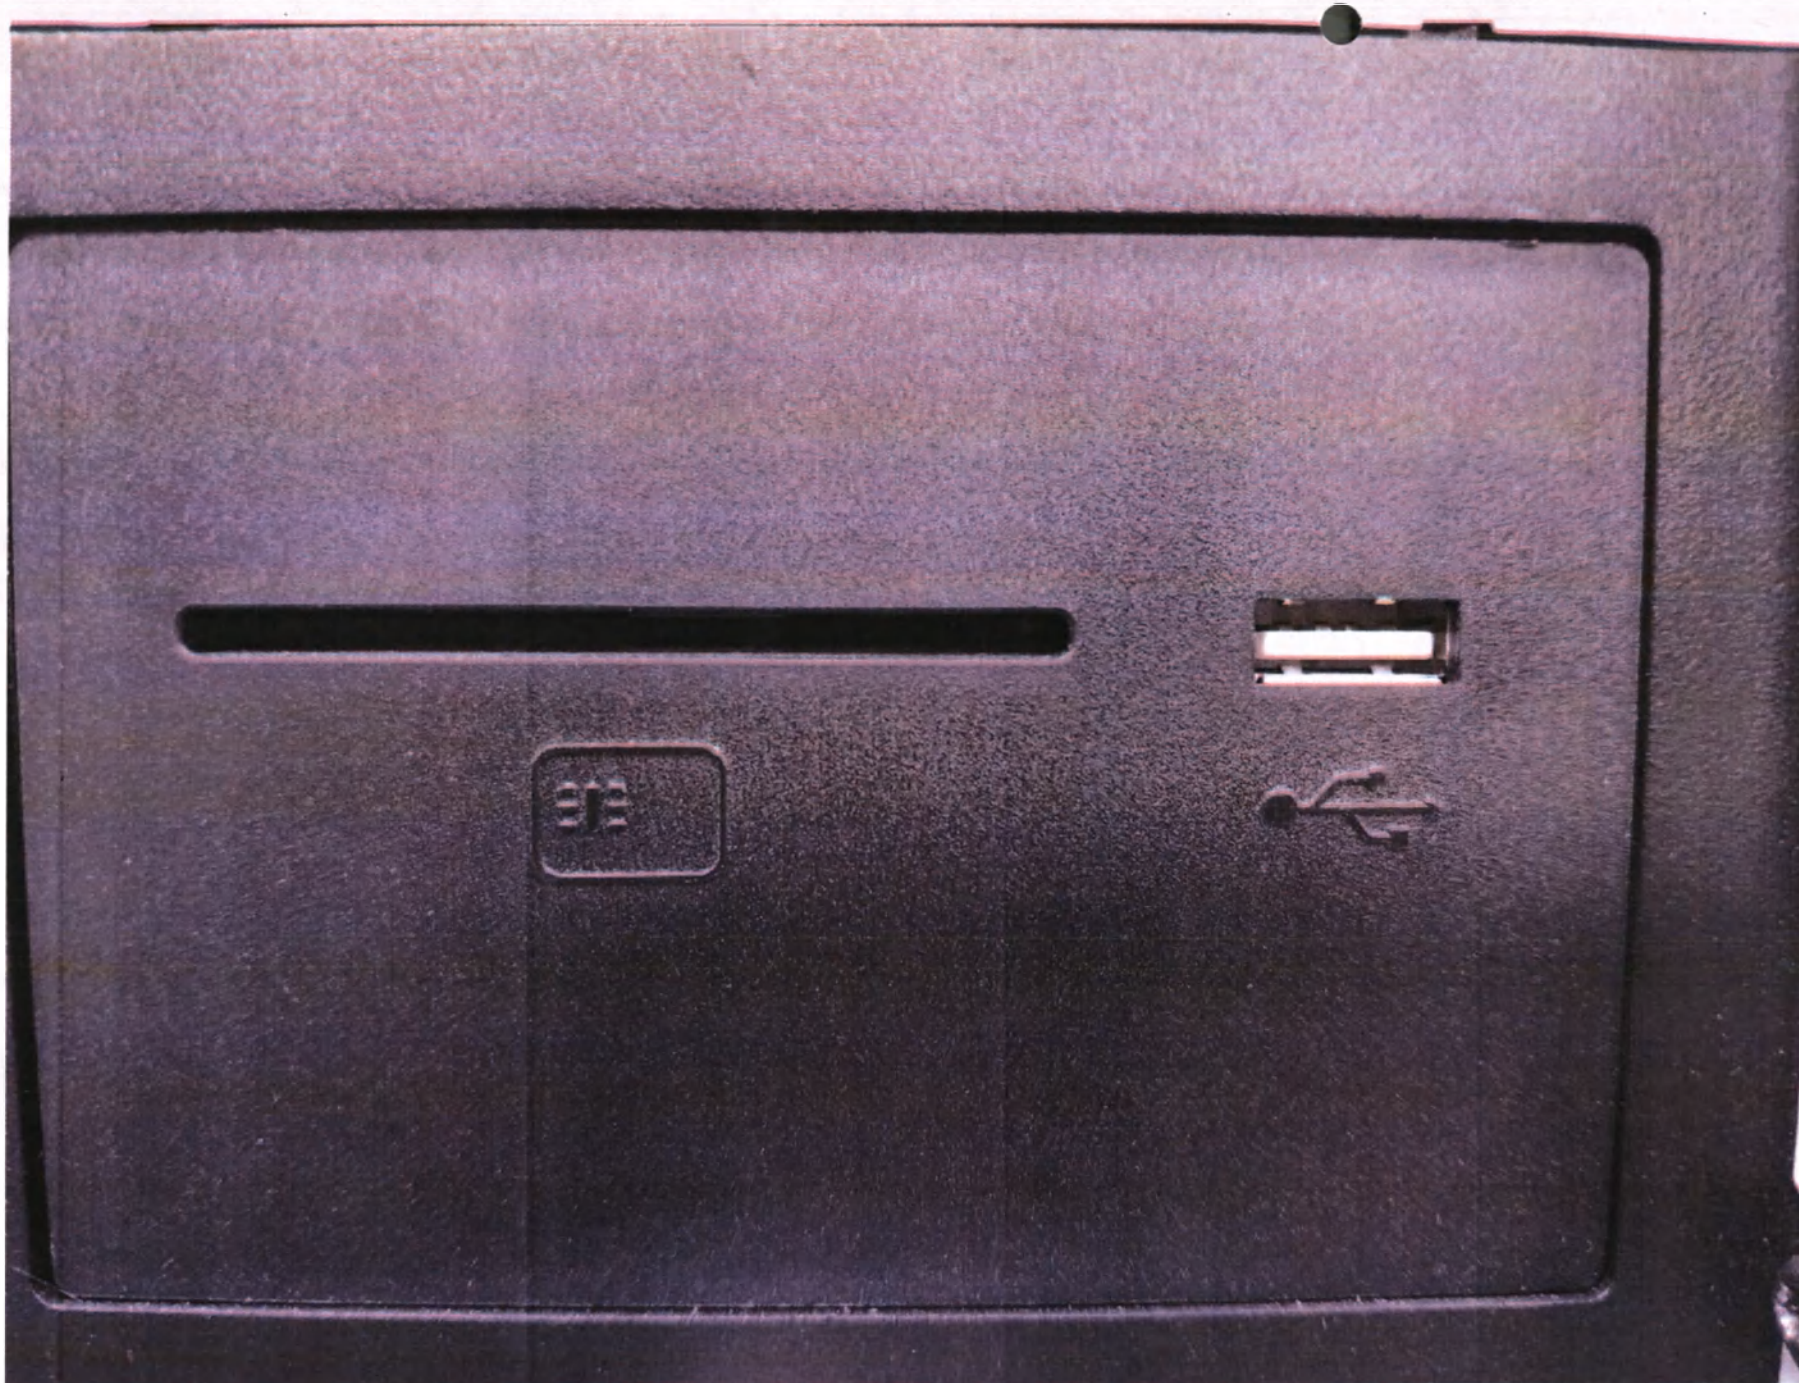


Разъем сервисной карты

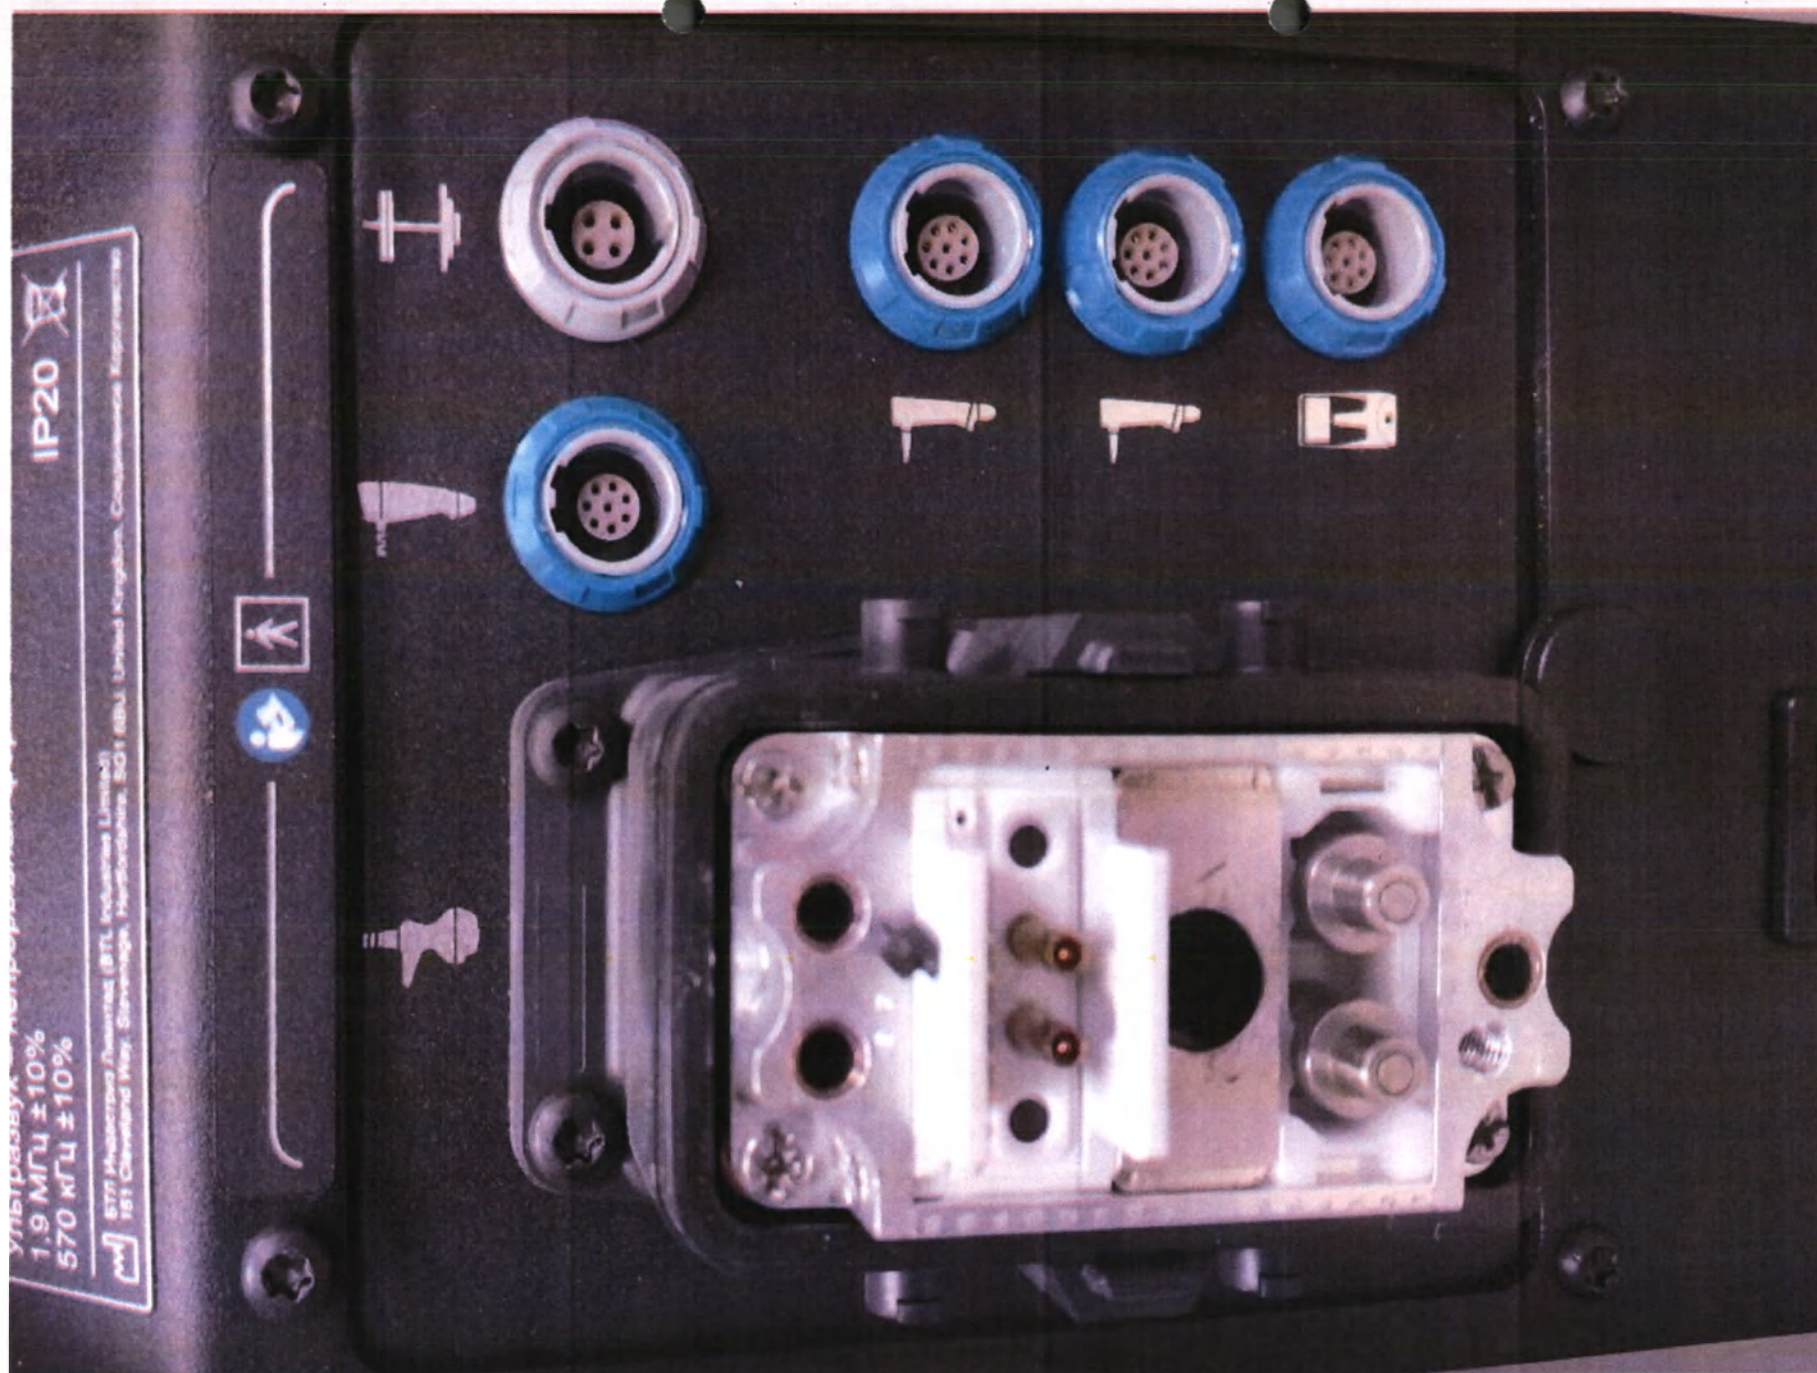

Разъем подключения аппликаторов



Разъемы основного блока



Маркировка основного блока (серийный номер и дата производства)



Кнопки управления на передней панели основного блока

Кабель нейтрального электрода
BTL-785-6



Использовать с BTL-785F

SN POM000003

LOT


2020-11-05

REF 785-55CABNEU-M




БТИ Индастриз Лимитед (BTL Industries Limited)
161 Cleveland Way, Stevenage, Hertfordshire, SG1 6BU,
United Kingdom, Соединенное Королевство

Маркировка упаковки кабеля нейтрального электрода BTL-785-6



Маркировка кабеля нейтрального электрода BTL-785-6



Маркировка кабеля нейтрального электрода BTL-785-6

REF

Нейтральные электроды BTL-NE-170,
25 шт. в упаковке

63600-146

LOT

2012028



2024-02



0086



x 25



MIN
+5°C
RH 20%-80%

MAX
+35°C

Произведена для:

www.btl.net.com

БТЛ Индастриз Лимитед
(BTL Industries Limited)
151 Cleveland Way, Stevenage,
Hertfordshire, SG1 6BU,
United Kingdom, Соединенное
Королевство



Производитель:
ФИАБ (FIAB)
Via Costoli, 4-50039 - Vicchio
(Florence, Italy (Флоренция,
Италия)) - www.fiab.it

96550440401ET90



011118054933 54351 1111240200 (101P211000)

Маркировка упаковки нейтральных электродов BTL-NE-170, 25 шт. в упаковке

REF

Нейтральные электроды BTL-NE-170,
25 шт. в упаковке

63000-146

LOT


2012028



2024-02



0086



MIN +5°C MAX +35°C
RH 20%-80%

Произведено для:

www.btlnet.com

БТЛ Индастриз Лимитед
(BTL Industries Limited)
161 Cleveland Way, Stevenage,
Hertfordshire, SG1 6BU,
United Kingdom, Соединенное
Королевство



Производитель:
ФИАБ (FIAB)
Via Costoli, 4-50039 – Vicchio
(Florence, Italy (Флоренция,
Италия) - www.fiab.it

96550444040ET90



(01) 1 8054953 34351 5 (17) 240200 (10) P2110002

Маркировка упаковки нейтральных электродов BTL-NE-170, 25 шт. в упаковке

PIASTRE MONOUSO PER ELETTROCHIRURGIA
ELECTROSURGICAL DISPOSABLE GROUND PADS
PLAQUES USAGE UNIQUE POUR ELECTROCHIRURGIE
PLATTEN ZU EINMALIGEN GEBRAUCH FÜR ELEKTROCHIRURGIE
PLACAS DESECHABLES PARA ELECTROCIRUGIA
PLACA DESCARTÁVEL PARA ELECTROCIRURGIA

CE
2797

REF BTL-NE-170

Manufactured for



www.btl.net.com

BTL Industries Limited
161 Cleveland Way Stevenage
Hertfordshire SG1 6BU
UNITED KINGDOM

ADULT / ADULT
ADULTES / ERWACHSENE
ADULTOS / ADULTOS



169cm²

LOT P2126030



2024-07




R_x ONLY



Via Castoli, 4 - 50039 - Vicchio (Florence, ITALY)
www.fiab.it - prodotto ed importato

cod. 95503985ET9C



Маркировка нейтральных электродов BTL-NE-170

AVVERTENZE

- L'uso non corretto può provocare ustioni: leggere attentamente le istruzioni d'uso fornite nella confezione.
- Per elettrobisturi dotati di controllo "REM", il sistema non si attiva nel caso di utilizzo di piastre a sezione conduttiva unica.
- Dimensioni adatte per impiego su pazienti adulti.

WARNING

- Incorrect use can cause burns: read carefully the instructions for use supplied with the packaging.
- For ESU devices with REM control, the function is not activated in case of use of grounding pads with single conductive surface.
- Dimensions suitable for use on adult patients.

ATTENTION

- Une utilisation incorrecte peut provoquer des brûlures: lisez attentivement les instructions d'utilisation fournies sur l'emballage.
- Pour les appareils électrochirurgicaux équipés de la fonction "REM", le système ne s'active pas lors de l'utilisation des plaques avec surface conductrice unique.
- Dimensions adaptées aux patients adultes.

WARNHINWEISE

- Falscher Gebrauch kann zu Verbrennungen führen: Lesen Sie sorgfältig die in der Verpackung vorhandene Gebrauchsanweisung.
- Bei Elektrophysikgeräten mit "REM", Kontrolle wird das System nicht aktiviert, wenn Elektroden mit einzelner leitende Fläche verwendet werden.
- Größe für den Einsatz bei erwachsenen Patienten geeignet.

ATENCIÓN

- El uso incorrecto puede provocar quemaduras: leer atentamente las instrucciones provistas con el embalaje.
- Para electrobisturios con control REM, el sistema no se activa en el caso que se utilicen placas monopartida.
- Dimensiones adecuadas para su uso en pacientes adultos.

ATENÇÃO

- O uso incorrecto pode causar queimaduras: leia atentamente as instruções de uso fornecidas com a embalagem.
- Em unidades de electrocirurgia (Dispositivos ESU) com controlo REM, a função não é activada no caso de placas com única secção condutora.
- Dimensões adequadas para uso em pacientes adultos.

cod. 96503986ET9A

Маркировка нейтральных электродов BTL-NE-170

Силиконовый стакан BTL-785-12



Использовать с Аппликатором фракционным
BTL-785-4 и Держателем для аппликатора BTL-785-14 /
Держателем для аппликатора BTL-785-15

LOT 785F0M000009

2020-11-18

REF 785-SILCUP3-U



БТЛ Индастриз Лимитед (BTL Industries Limited)
161 Cleveland Way, Stevenage, Hertfordshire, SG1 6BU,
United Kingdom, Соединенное Королевство

Маркировка упаковки силиконового стакана BTL-785-12

Большой аппликатор
BTL-785-1



Номинальная выходная мощность (IEC 60601-2-5): 1 Вт $\pm$ 20%
Эффективная площадь излучения (IEC 60601-2-5): 0,5 см² $\pm$ 20%
Коэффициент неоднородности пучка (IEC 60601-2-5): 4,5 $\pm$ 30%
Тип луча (IEC 60601-2-5): дивергентный
Код защиты: IP67

Использовать с BTL-785F

SN 78510M000007

2020-11-18

LOT




REF 785-APL-M



БТЛ Индустриал Лимитед (BTL Industries Limited)
161 Cleveland Way, Stevenage, Hertfordshire, SG1 5BU,
United Kingdom, Соединенное Королевство

Маркировки упаковки большого аппликатора BTL-785-1



Маркировки большого аппликатора BTL-785-1



Маркировки большого аппликатора BTL-785-1

Малый аппликатор
BTL-785-2



Номинальная выходная мощность (IEC 60601-2-5): 1 Вт $\pm$ 20%
Эффективная площадь излучения (IEC 60601-2-5): 0,5 см² $\pm$ 20%
Коэффициент неоднородности пучка (IEC 60601-2-5): 5,0 $\pm$ 30%
Тип пучка (IEC 60601-2-5): дивергентный
Код защиты: IP67

Использовать с BTL-785F

SN 78520M000007

2020-11-05

LOT




REF 785-APS-M



БТЛ Индастриз Лимитед (BTL Industries Limited)
161 Cleveland Way, Stevenage, Hertfordshire, SG1 6BU,
United Kingdom, Соединенное Королевство

Маркировка упаковки малого аппликатора BTL-785-2



SN 78520M000007
LOT
REF 785-APS-M

2020-11-05



BTI Medics Limited (BTI Industries Limited)
161 Cleveland Way, Stevinge, Northampton, NN1 8BU,
United Kingdom. Copyright © 2020

Маркировка малого аппликатора BTL-785-2



Малый аппликатор
BTL-785-2

Номинальная выходная мощность (IEC 60601-2-5): 1 Вт $\pm$ 20%
Эффективная площадь излучения (IEC 60601-2-5): 0,5 см² $\pm$ 20%
Коэффициент неоднородности пучка (IEC 60601-2-5): 5,0 $\pm$ 30%
Тип луча (IEC 60601-2-5): дивергентный
Код защиты: IP67

Использовать с BTL-785F

Маркировка малого аппликатора BTL-785-2

Аппликатор EMFEMME 360
BTL-785-3



Код защиты: IP20

Использовать с BTL-785F

SN 78530M000006

LOT

2020-11-05




REF 785-APV-M



БТЛ Индустриз Лимитед (BTL Industries Limited)
161 Cleveland Way, Stevenage, Hertfordshire, SG1 6BU,
United Kingdom, Соединенное Королевство

Маркировка упаковки аппликатора EMFEMME 360 BTL-785-3




Аппликатор EMFEMME 360
BTL-785-3



Код защиты: IP20

Использовать с BTL-785F

Маркировка аппликатора EMFEMME 360 BTL-785-3

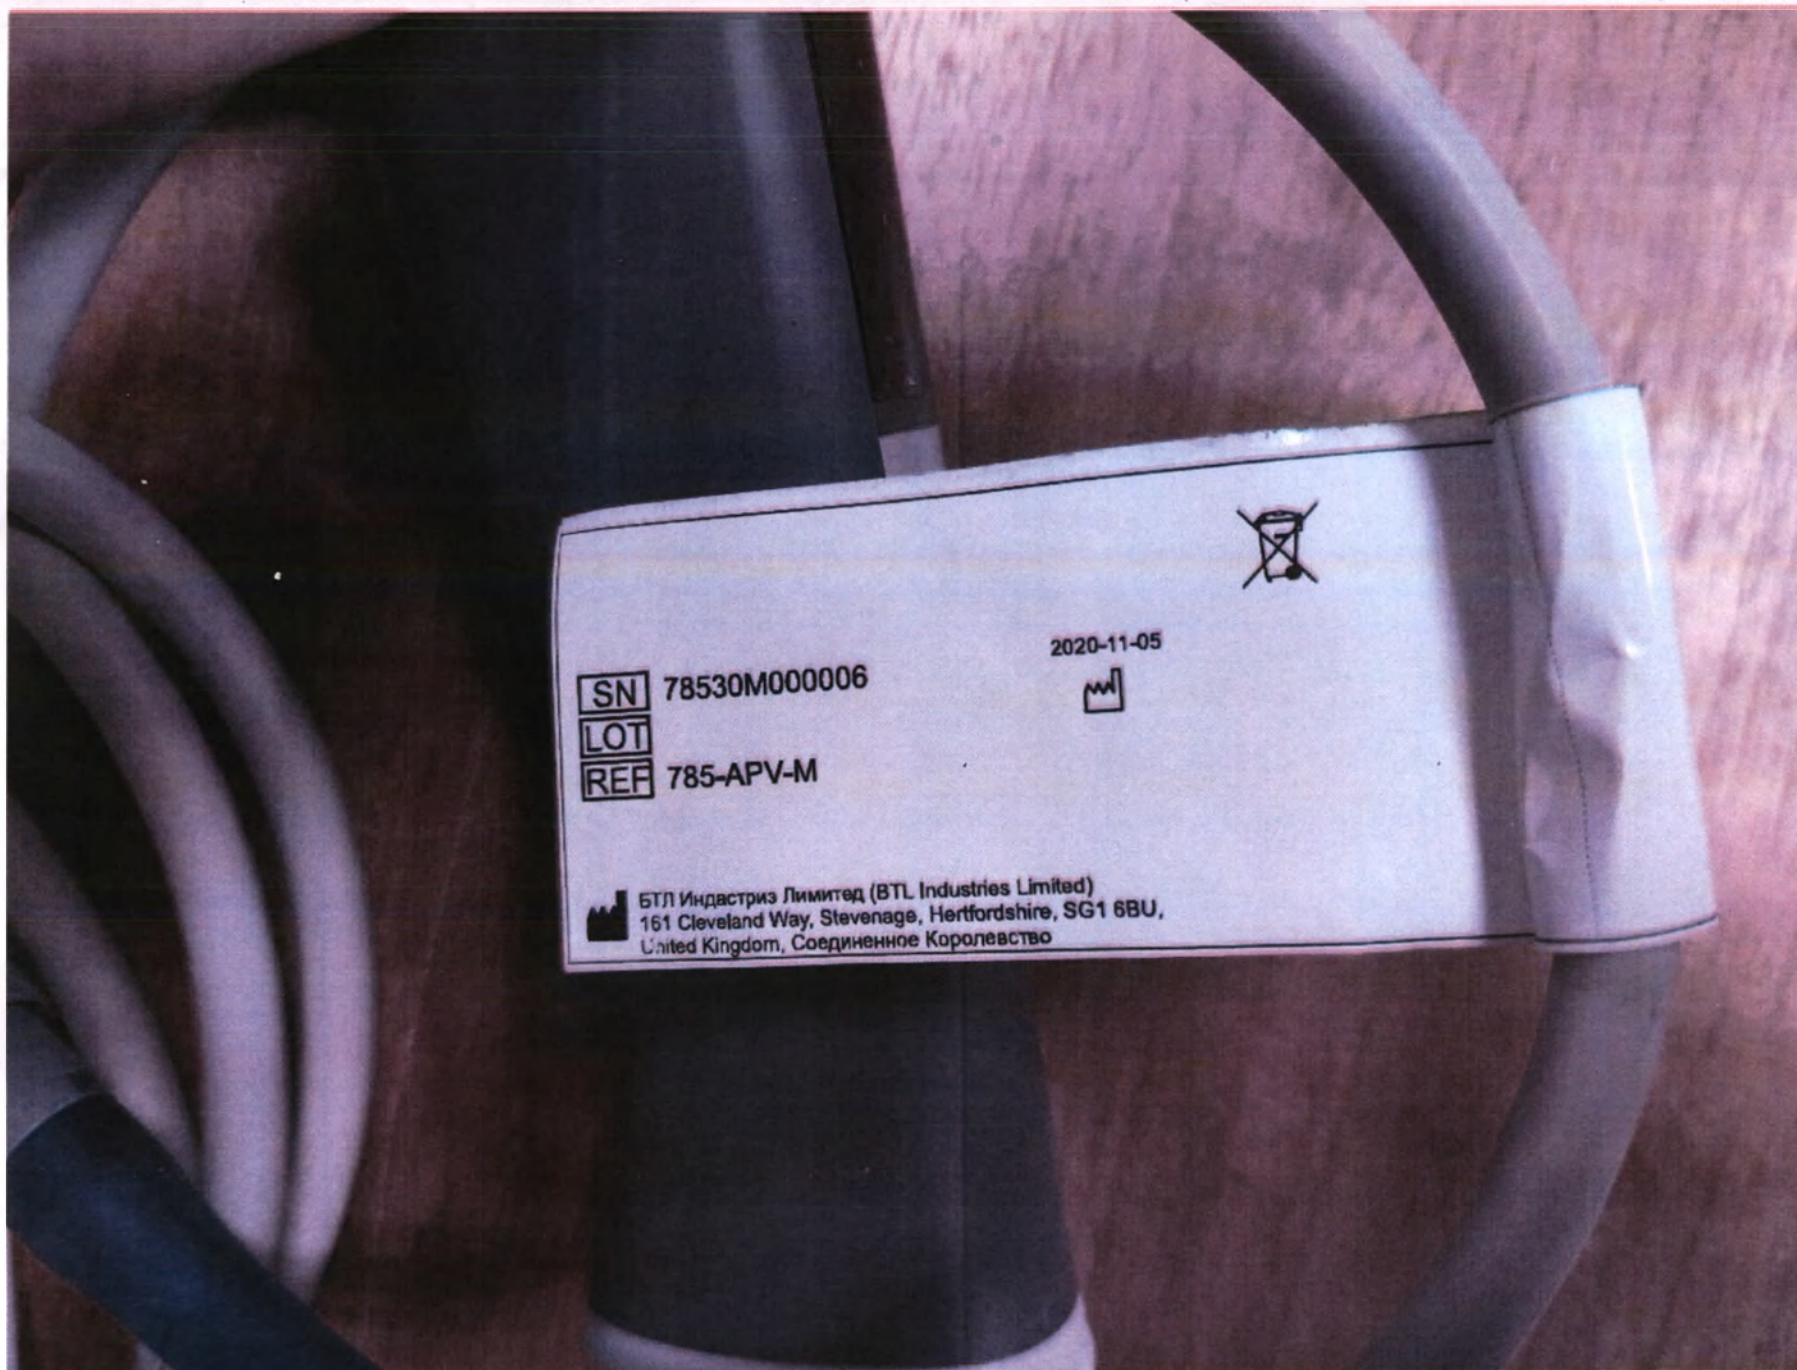

Маркировка аппликатора EMFEMME 360 BTL-785-3

Аппликатор фракционный
BTL-785-4



Код защиты: IP20

Использовать с BTL-785F

SN 78540M000006

LOT

2020-11-18

REF 785-APF-M



БТЛ Индастриз Лимитед (BTL Industries Limited)
161 Cleveland Way, Stevenage, Hertfordshire, SG1 6BU,
United Kingdom, Соединенное Королевство

Маркировка упаковки аппликатора фракционного BTL-785-4

Аппликатор фракционный
BTL-785-4


Код защиты: IP20

Использовать с BTL-785F



Маркировка аппликатора фракционного BTL-785-4

ООО ЦИРМИ  info@cirmi.ru  www.goszdravnadzor.ru



SN 78540M000006
LOT
REF 785-APF-M

2020-11-18



БТЛ Индастриз Лимитед (BTL Industries Limited)
161 Cleveland Way, Stevenage, Hertfordshire, SG1 6BU,
United Kingdom, Соединенное Королевство

Маркировка аппликатора фракционного BTL-785-4

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Насадка аппликатора
BTL-785-1-1



Использовать с Большим аппликатором
BTL-785-1

SN 78511M000006

LOT

REF 785-TIPLHP-M

2020-11-18



БТЛ Индастриз Лимитед (BTL Industries Limited)
161 Cleveland Way, Stevenage, Hertfordshire, SG1 6BU,
United Kingdom, Соединенное Королевство

Маркировка упаковки насадки аппликатора BTL-785-1-1

Сменная насадка аппликатора
BTL-785-2-1



Использовать с Малым аппликатором
BTL-785-2

SN 78521M000014

LOT

2020-11-05

REF 785-TIPSHP-M



БТЛ Индастриз Лимитед (BTL Industries Limited)
161 Cleveland Way, Stevenage, Hertfordshire, SG1 6BU,
United Kingdom, Соединенное Королевство

Маркировка упаковки сменной насадки аппликатора BTL-785-2-1

Набор насадок V tip BTL-785-3-1,
в наборе 5 шт



НЕ СТЕРИЛЬНО

Использовать с Аппликатором EMFEMME 360
BTL-785-3

SN 78531M000025

LOT

2020-11-05

REF 785-TIPV-M



БТЛ Индастриз Лимитед (BTL Industries Limited)
161 Cleveland Way, Stevenage, Hertfordshire, SG1 6BU,
United Kingdom, Соединенное Королевство

MEAS: 237 x
9.3 x



Маркировка упаковки набора насадок V tip BTL-785-3-1, в наборе 5 шт

Набор насадок V 24 tip BTL-785-3-2,
в наборе 5 шт



НЕ СТЕРИЛЬНО


Использовать с Аппликатором EMFEMME 360
BTL-785-3

SN 78532M000014

LOT


2020-11-05

REF 785-TIPV24-M



БТЛ Индастриз Лимитед (BTL Industries Limited)
161 Cleveland Way, Stevenage, Hertfordshire, SG1 6BU,
United Kingdom, Соединенное Королевство

MEAS: 237 x 192 x 55 mm
9.3 x 7.6 x 2.2 in



Маркировка упаковки набора насадок V 24 tip BTL-785-3-2, в наборе 5 шт


ООО ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Набор насадок V 24 tip BTL-785-3-2



НЕ СТЕРИЛЬНО

Использовать с Аппликатором EMFEMME 360
BTL-785-3



LOT 28570D000060

2022-06-15

REF 785-TIPV24-M



БТЛ Индастриз Лимитед (BTL Industries Limited)
161 Cleveland Way, Stevenage, Hertfordshire, SG1 6BU,
United Kingdom, Соединенное Королевство

Маркировка набора насадок V 24 tip BTL-785-3-2

Набор насадок V 30 tip BTL-785-3-3,
в наборе 5 шт



НЕ СТЕРИЛЬНО

Использовать с Аппликатором EMFEMME 360
BTL-785-3

SN 78533M000017

LOT


2020-11-05

REF 785-TIPV30-M



БТЛ Индастриз Лимитед (BTL Industries Limited)
161 Cleveland Way, Stevenage, Hertfordshire, SG1 6BU,
United Kingdom, Соединенное Королевство

MEAS: 237 x 19
9.3 x 7.6



Маркировка упаковки набора насадок V 30 tip BTL-785-3-3, в наборе 5 шт

Набор насадок V 30 tip BTL-785-3-3



НЕ СТЕРИЛЬНО

Использовать с Аппликатором EMFEMME 360
BTL-785-3

LOT 28570D000060

2022-06-15

REF 785-TIPV30-M



БТЛ Индастриз Лимитед (BTL Industries Limited)
161 Cleveland Way, Stevenage, Hertfordshire, SG1 6BU,
United Kingdom, Соединенное Королевство

Маркировка набора насадок V 30 tip BTL-785-3-3, в наборе 5 шт

Набор неизолированных насадок
BTL-785-4-5, в наборе 10 шт



United Kingdom, Соединенное Королевство
Использовать с Аппликатором фракционным
BTL-785-4

SN 10666-NIN

LOT

REF 785-TIPFNIMHP-M



2023-12-25

2020-06-25



STERILE EO



БТЛ Индастриз Лимитед (BTL Industries Limited)
161 Cleveland Way, Stevenage, Hertfordshire, SG1 6BU,

MEAS: 237 x 192
9.3 x 7.6



Маркировка упаковки набора неизолированных насадок BTL-785-4-5, в наборе 10 шт

Набор неизолированных насадок
BTL-785-4-5



Использовать с Аппликатором фракционным
BTL-785-4



2024-06-17

STERILE EO

LOT SPP0021220

2022-01-19

REF 785-TIPFNIMHP-M



БТЛ Индустриз Лимитед (BTL Industries Limited)
101 Cleveland Way, Stevenage, Hertfordshire, SG1 6BU,
United Kingdom, Соединенное Королевство

Маркировка набора неизолированных насадок BTL-785-4-5, в наборе 10 шт

Набор изолированных насадок
BTL-785-4-6, в наборе 10 шт



United Kingdom, Соединенное Королевство
Использовать с Аппликатором фракционным
BTL-785-4

SN 10908-IN

LOT

REF 785-TIPFIMHP-M



2023-12-24

2020-06-24



STERILE EO



БТЛ Индастриз Лимитед (BTL Industries Limited)
161 Cleveland Way, Stevenage, Hertfordshire, SG1 6BU,

MEAS: 237
9.3



Маркировка упаковки набора изолированных насадок BTL-785-4-6, в наборе 10 шт

Набор изолированных насадок
BTL-785-4-6



Использовать с Аппликатором фракционным
BTL-785-4



2024-06-17

STERILE EO

2022-01-19

LOT SPP0021220

REF 785-TIPFIMHP-M



БТЛ Индастриз Лимитед (BTL Industries Limited)
161 Cleveland Way, Stevenage, Hertfordshire, SG1 6BU,
United Kingdom, Соединенное Королевство

Маркировка набора изолированных насадок BTL-785-4-6, в наборе 10 шт

Набор поверхностных насадок 32
BTL-785-4-7, в наборе 10 шт



United Kingdom, Соединенное Королевство
Использовать с Аппликатором фракционным
BTL-785-4

SN 10713-S32

LOT

REF 785-TIPF32HP-M



2023-12-25

2020-06-25



STERILE EO



БТЛ Индастриз Лимитед (BTL Industries Limited)
161 Cleveland Way, Stevenage, Hertfordshire, SG1 6BU,

Маркировка упаковки набора поверхностных насадок 32 BTL-785-4-7, в наборе 10 шт

02/18/2021 12:42 SPP0021219/S02 V=4.8m/min T=170°C A Kudrova

Набор поверхностных насадок 32
BTL-785-4-7



Использовать с Аппликатором фракционным
BTL-785-4



2024-06-17

2022-01-19

LOT SPP0021220

REF 785-TIPF32HP-M



STERILE EO



БТЛ Индастриз Лимитед (BTL Industries Limited)
161 Cleveland Way, Stevenage, Hertfordshire, SG1 6BU,
United Kingdom, Соединенное Королевство

Маркировка набора поверхностных насадок 32 BTL-785-4-7, в наборе 10 шт

Набор поверхностных насадок 64
BTL-785-4-8, в наборе 10 шт



Использовать с Аппликатором фракционным
BTL-785-4

SN 10713-S64

LOT

REF 785-TIPF64HP-M



2023-06-24

2020-01-24



STERILE EO



БТЛ Индастриз Лимитед (BTL Industries Limited)
161 Cleveland Way, Stevenage, Hertfordshire, SG1 6BU,
United Kingdom, Соединенное Королевство

MEAS: 237 x 1
9.3 x 7



Маркировка упаковки набора поверхностных насадок 64 BTL-785-4-8, в наборе 10 шт

Набор поверхностных насадок 64
BTL-785-4-8



Использовать с Аппликатором фракционным
BTL-785-4

LOT SPP0021220


REF 785-TIPF64HP-M



2024-06-17

STERILE EO

2022-01-19



БТЛ Индастриз Лимитед (BTL Industries Limited)
161 Cleveland Way, Stevenage, Hertfordshire, SG1 6BU,
United Kingdom, Соединенное Королевство

Маркировка набора поверхностных насадок 64 BTL-785-4-8, в наборе 10 шт

Электрод EMFace для лба
BTL-785-7-1
Количество – 20 шт



990-908AG87EN02101

SN 28570D000060

LOT

Использовать с BTL-785-7


REF 785-APMAFHM-M



2022-06-15

ГГГГ-ММ-ДД

 БТЛ Индастриз Лимитед (BTL Industries Limited)
161 Cleveland Way, Stevenage, Hertfordshire, SG1 6BU,
United Kingdom, Соединенное Королевство



Маркировка упаковки электрода EMFace для лба BTL-785-7-1, в упаковке 20 шт.

ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



EMFACE



BTL Industries Ltd.
151 Cleveland Way, Stevenage, Hertfordshire,
SG1 6BU, United Kingdom



BTL Italia S.r.l.
Via San Leonardo, 120,
84 131, Salerno, Italy

BTL-785-7-1
Use with:
BTL-785-7

Маркировка электрода EMFace для лба BTL-785-7-1, в упаковке 20 шт.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Электрод EMFace для щеки
BTL-785-7-2
Количество – 40 шт



990-90BAG87EN02101


SN 28570D000060

LOT


2022-06-15
ГГГГ-ММ-ДД

Использовать с BTL-785-7

REF 785-APMACHIM-M



 БТЛ Индастриз Лимитед (BTL Industries Limited)
161 Cleveland Way, Stevenage, Hertfordshire, SG1 6BU,
United Kingdom, Соединенное Королевство



Маркировка упаковки электрода EMFace для щеки BTL-785-7-2, в упаковке 40 шт.



EMFACE



BTL Industries Ltd.
161 Cleveland Way, Stevenage, Hertfordshire,
SG1 6BU, United Kingdom



BTL Italia S.r.l.
Via San Leonardo, 120,
84 131, Salerno, Italy


BTL-785-7-2
Use with
BTL-785-7

Маркировка электрода EMFace для щеки BTL-785-7-2, в упаковке 40 шт.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Маркировка аппликатора EMFACE BTL-785-7



SN



78570D000060


v003
2022-06




IP20

Маркировка аппликатора EMFACE BTL-785-7

000 ЦРПМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

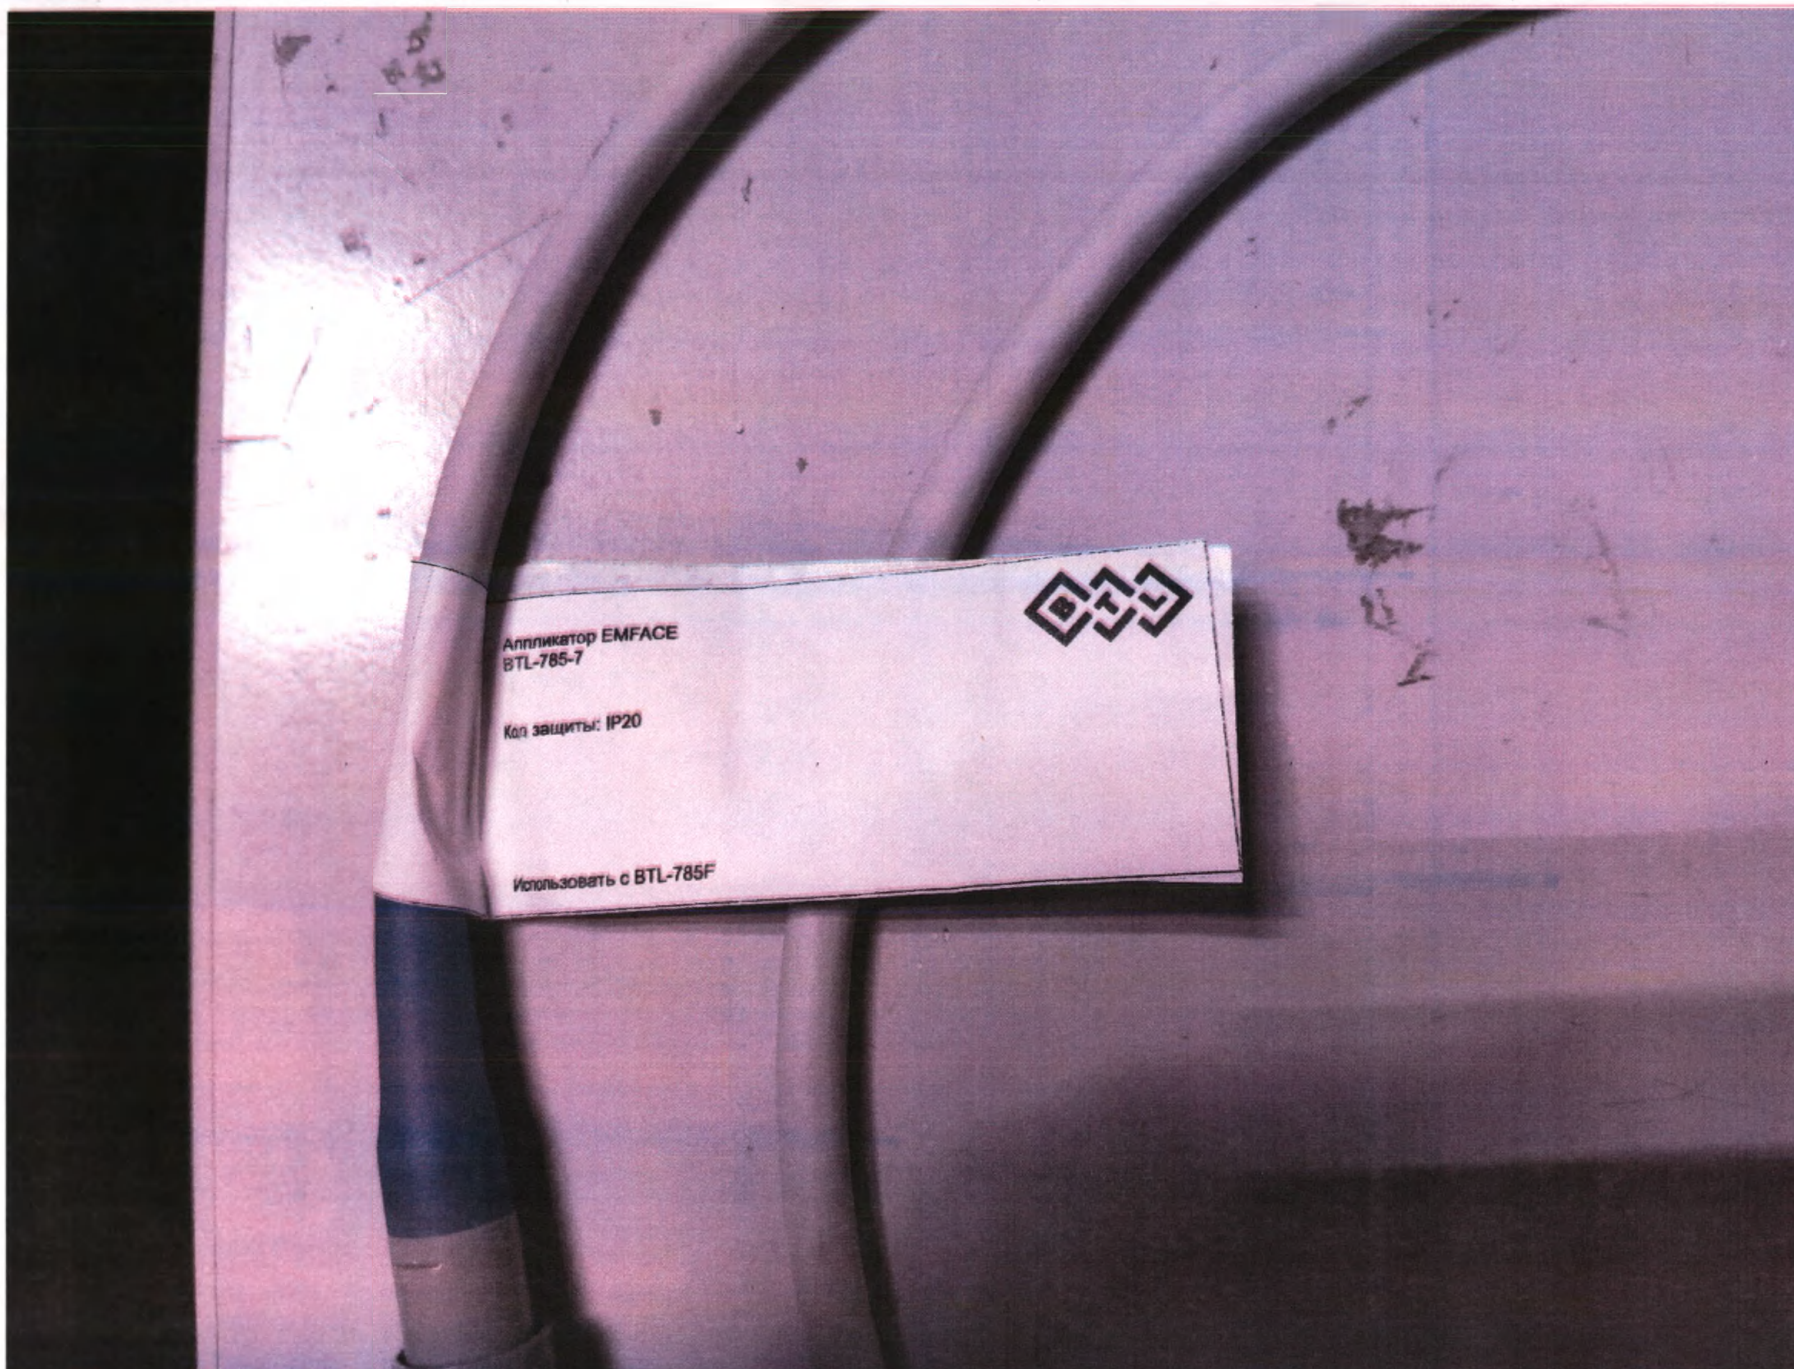

Маркировка аппликатора EMFACE BTL-785-7



Маркировка аппликатора EMFACE BTL-785-7

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью
100 лист 06
Генеральный директор
Мираев И.

