

PHILIPS

Руководитель по нормативному регулированию

ООО «ФИЛИПС»

Горкуша Д. В.

04 2023 г.




ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

«Система флюороскопическая рентгеновская передвижная цифровая Zenition 50 с принадлежностями»

Общий вид



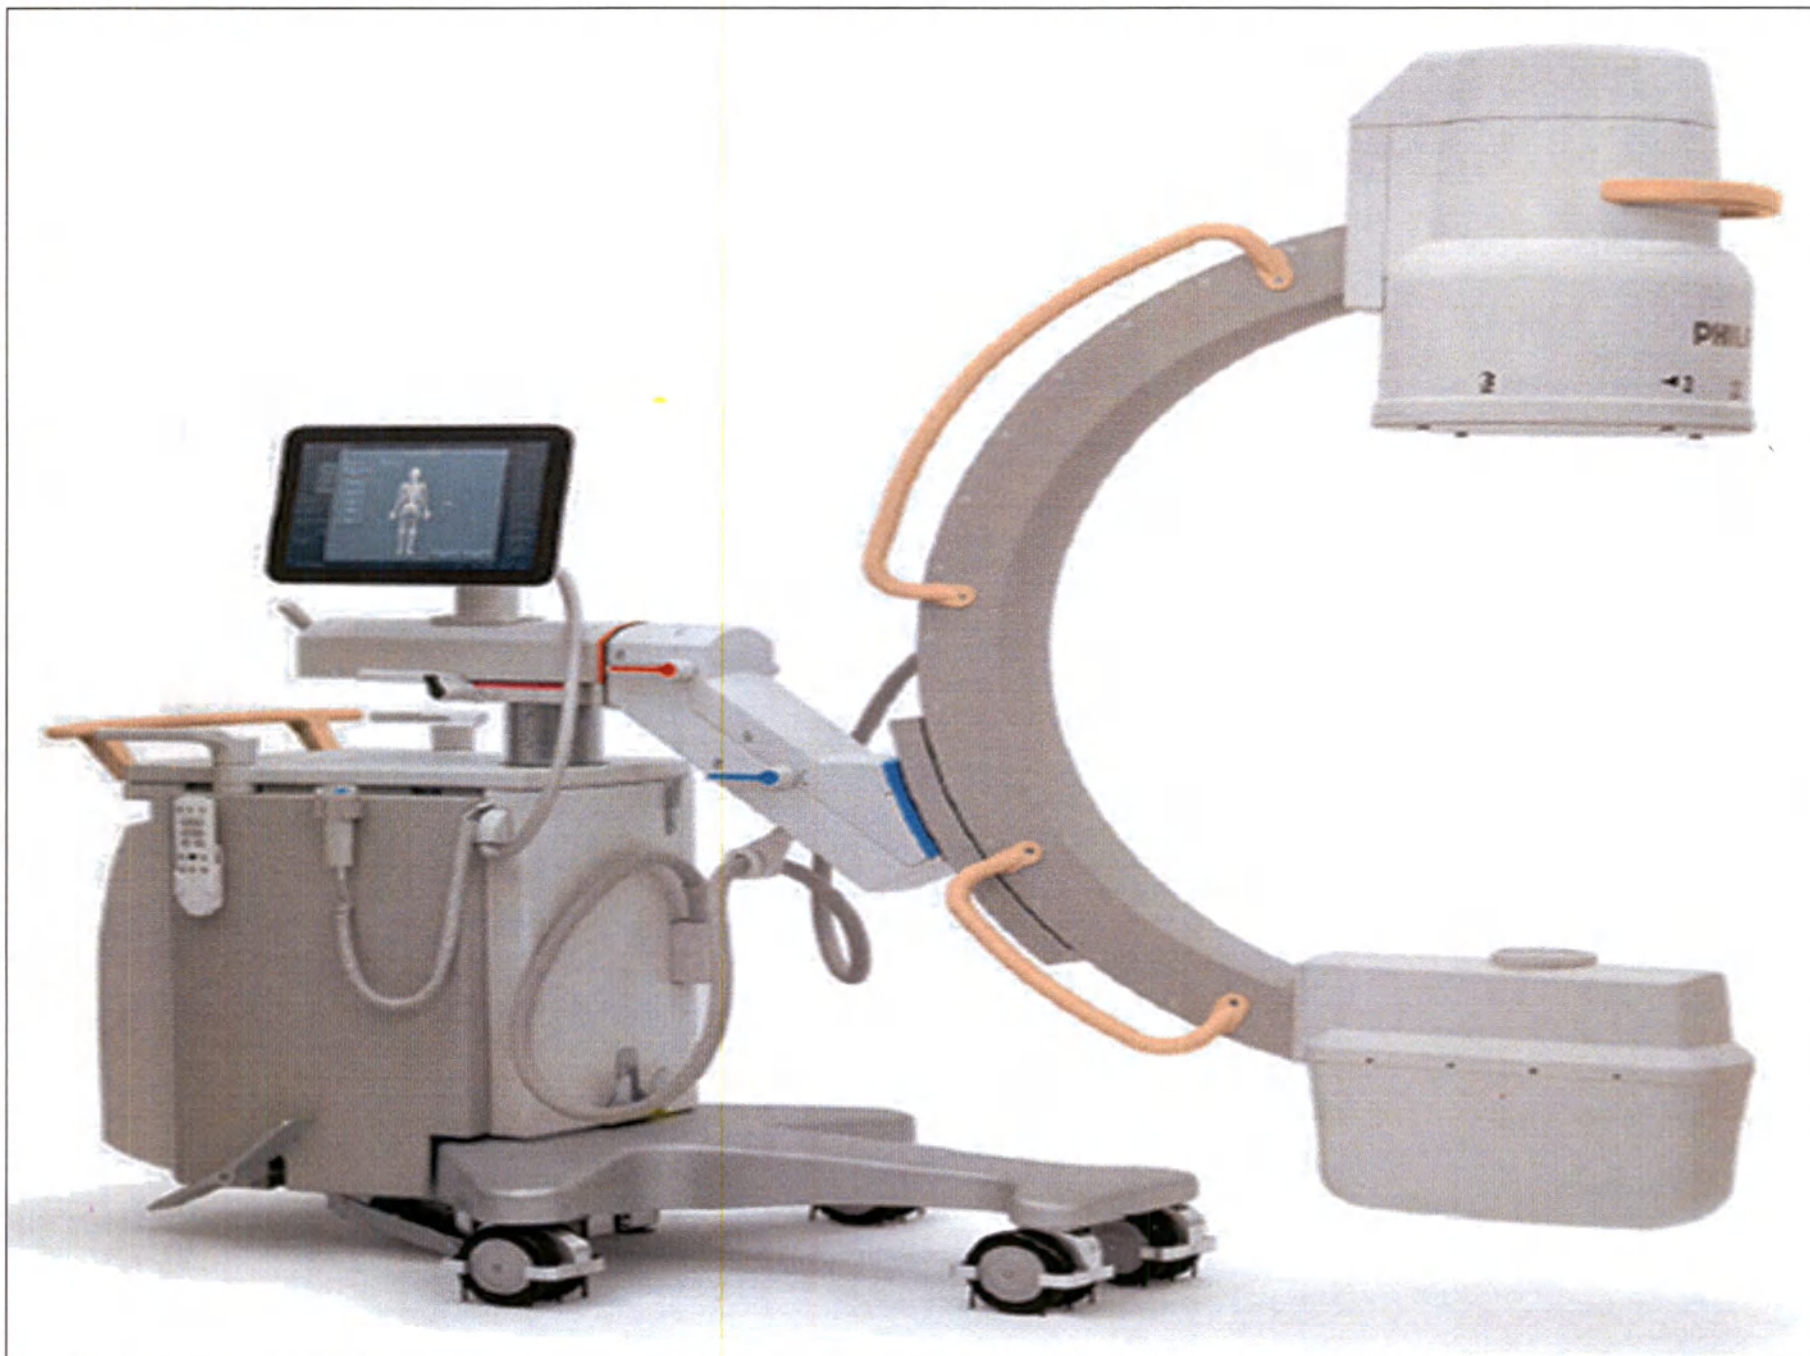

1. Базовый блок с С-дугой




1.1. Стойка С-дуги




1.2. С-дуга




1.3. Блок источника рентгеновского излучения

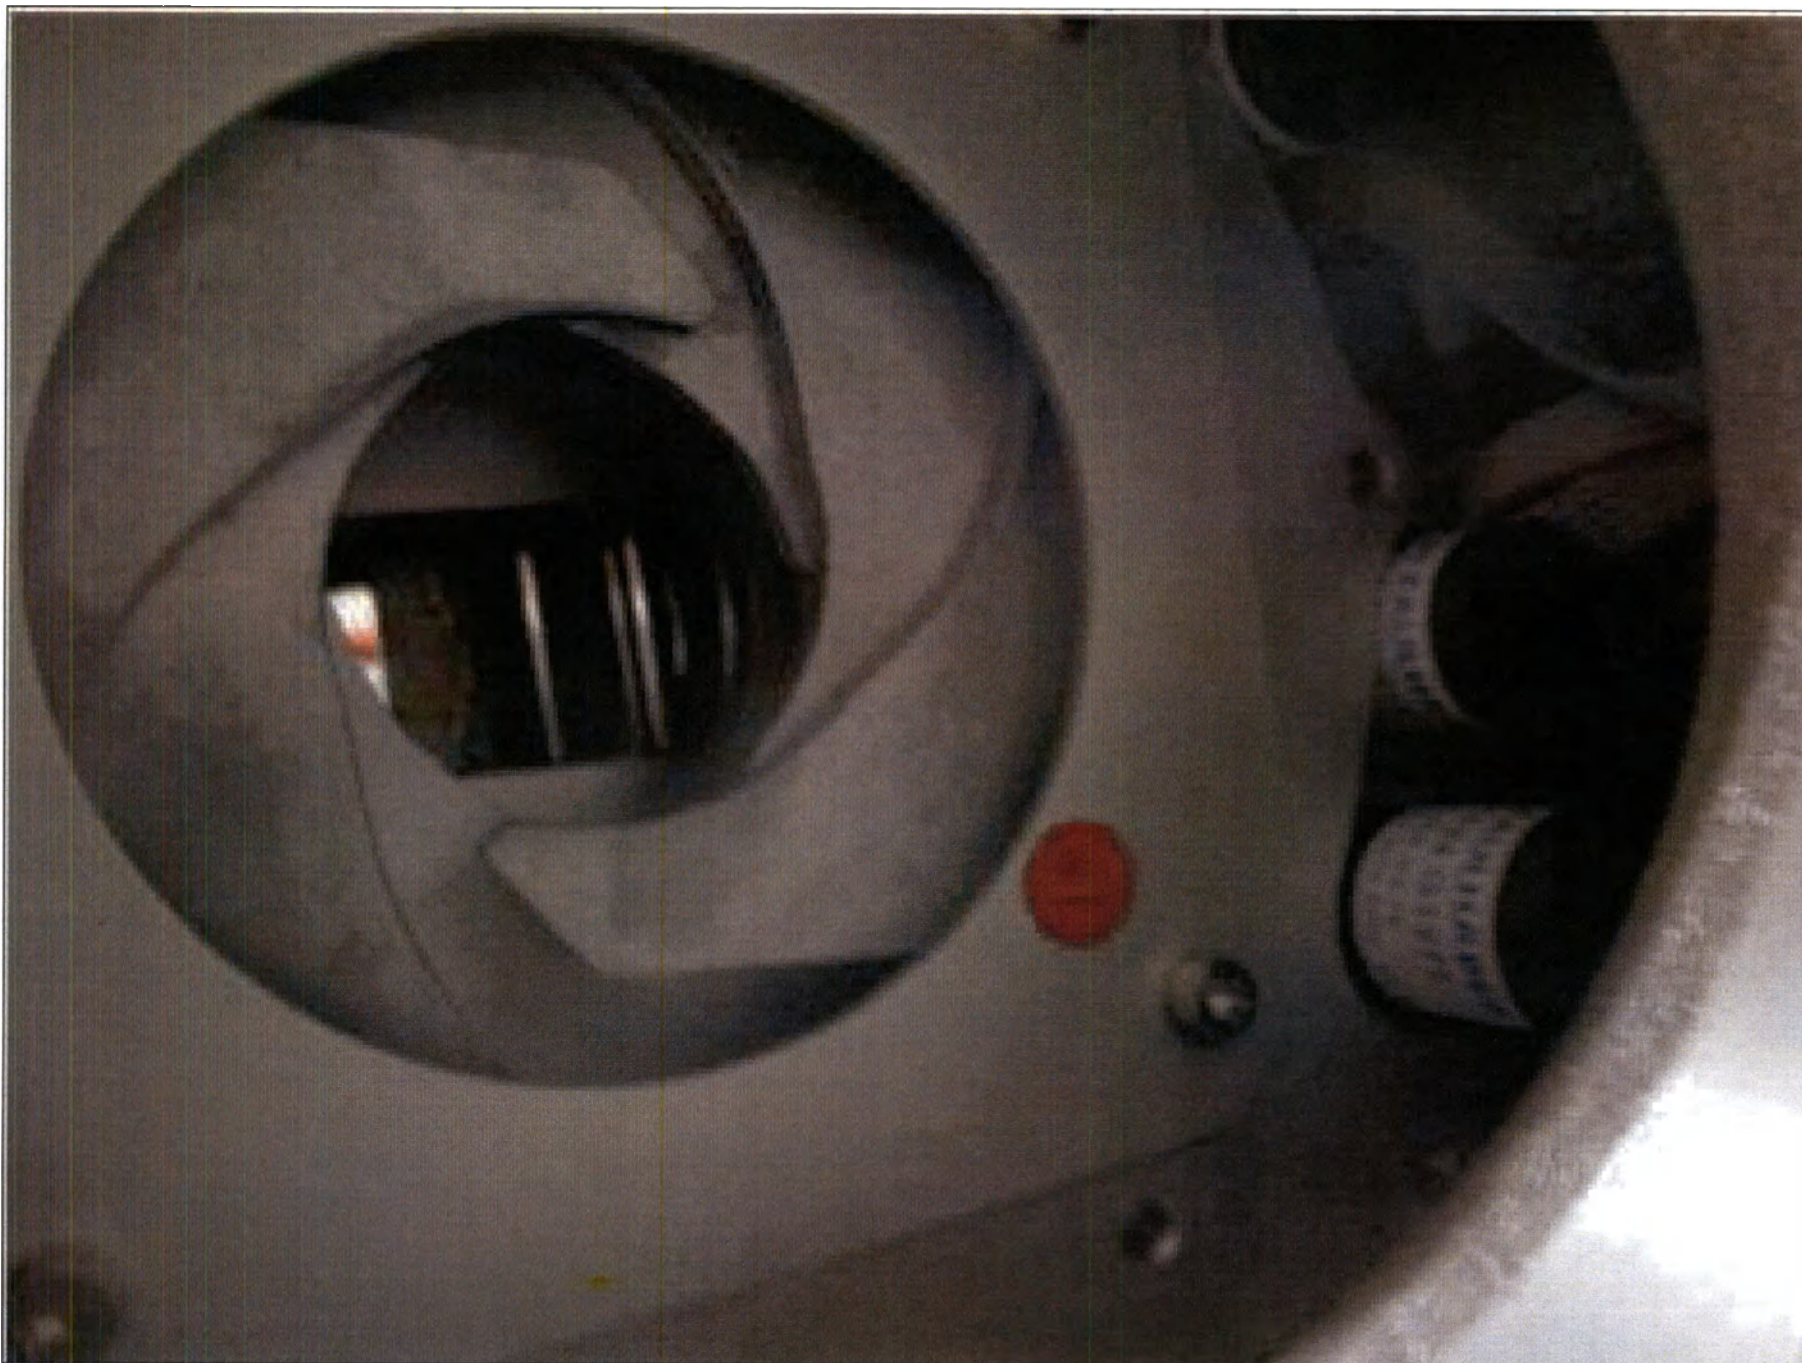


1.4. Коллиматор

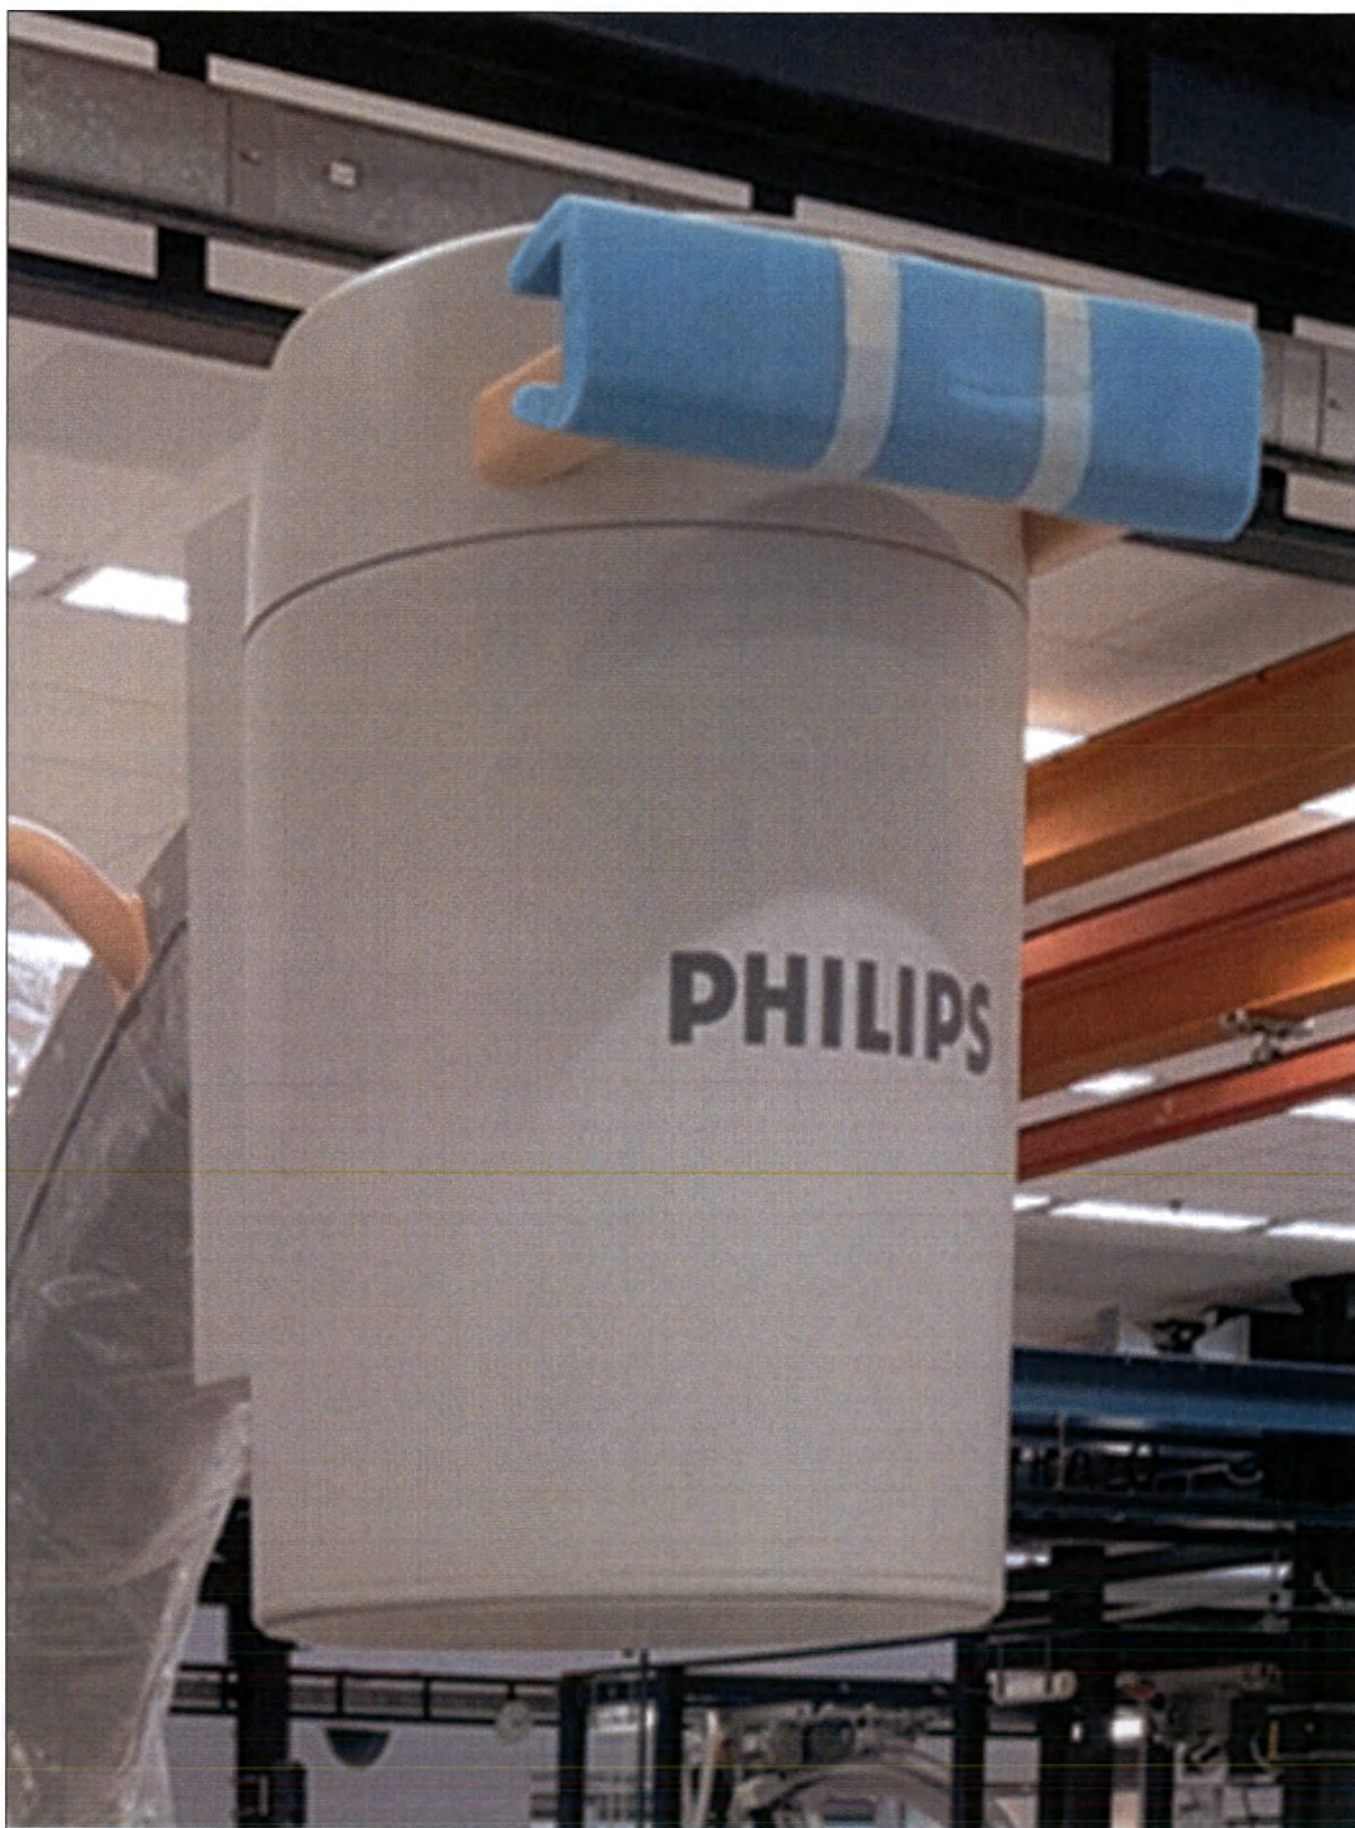


1.5.1. Усилитель изображений 9"(23HRC)

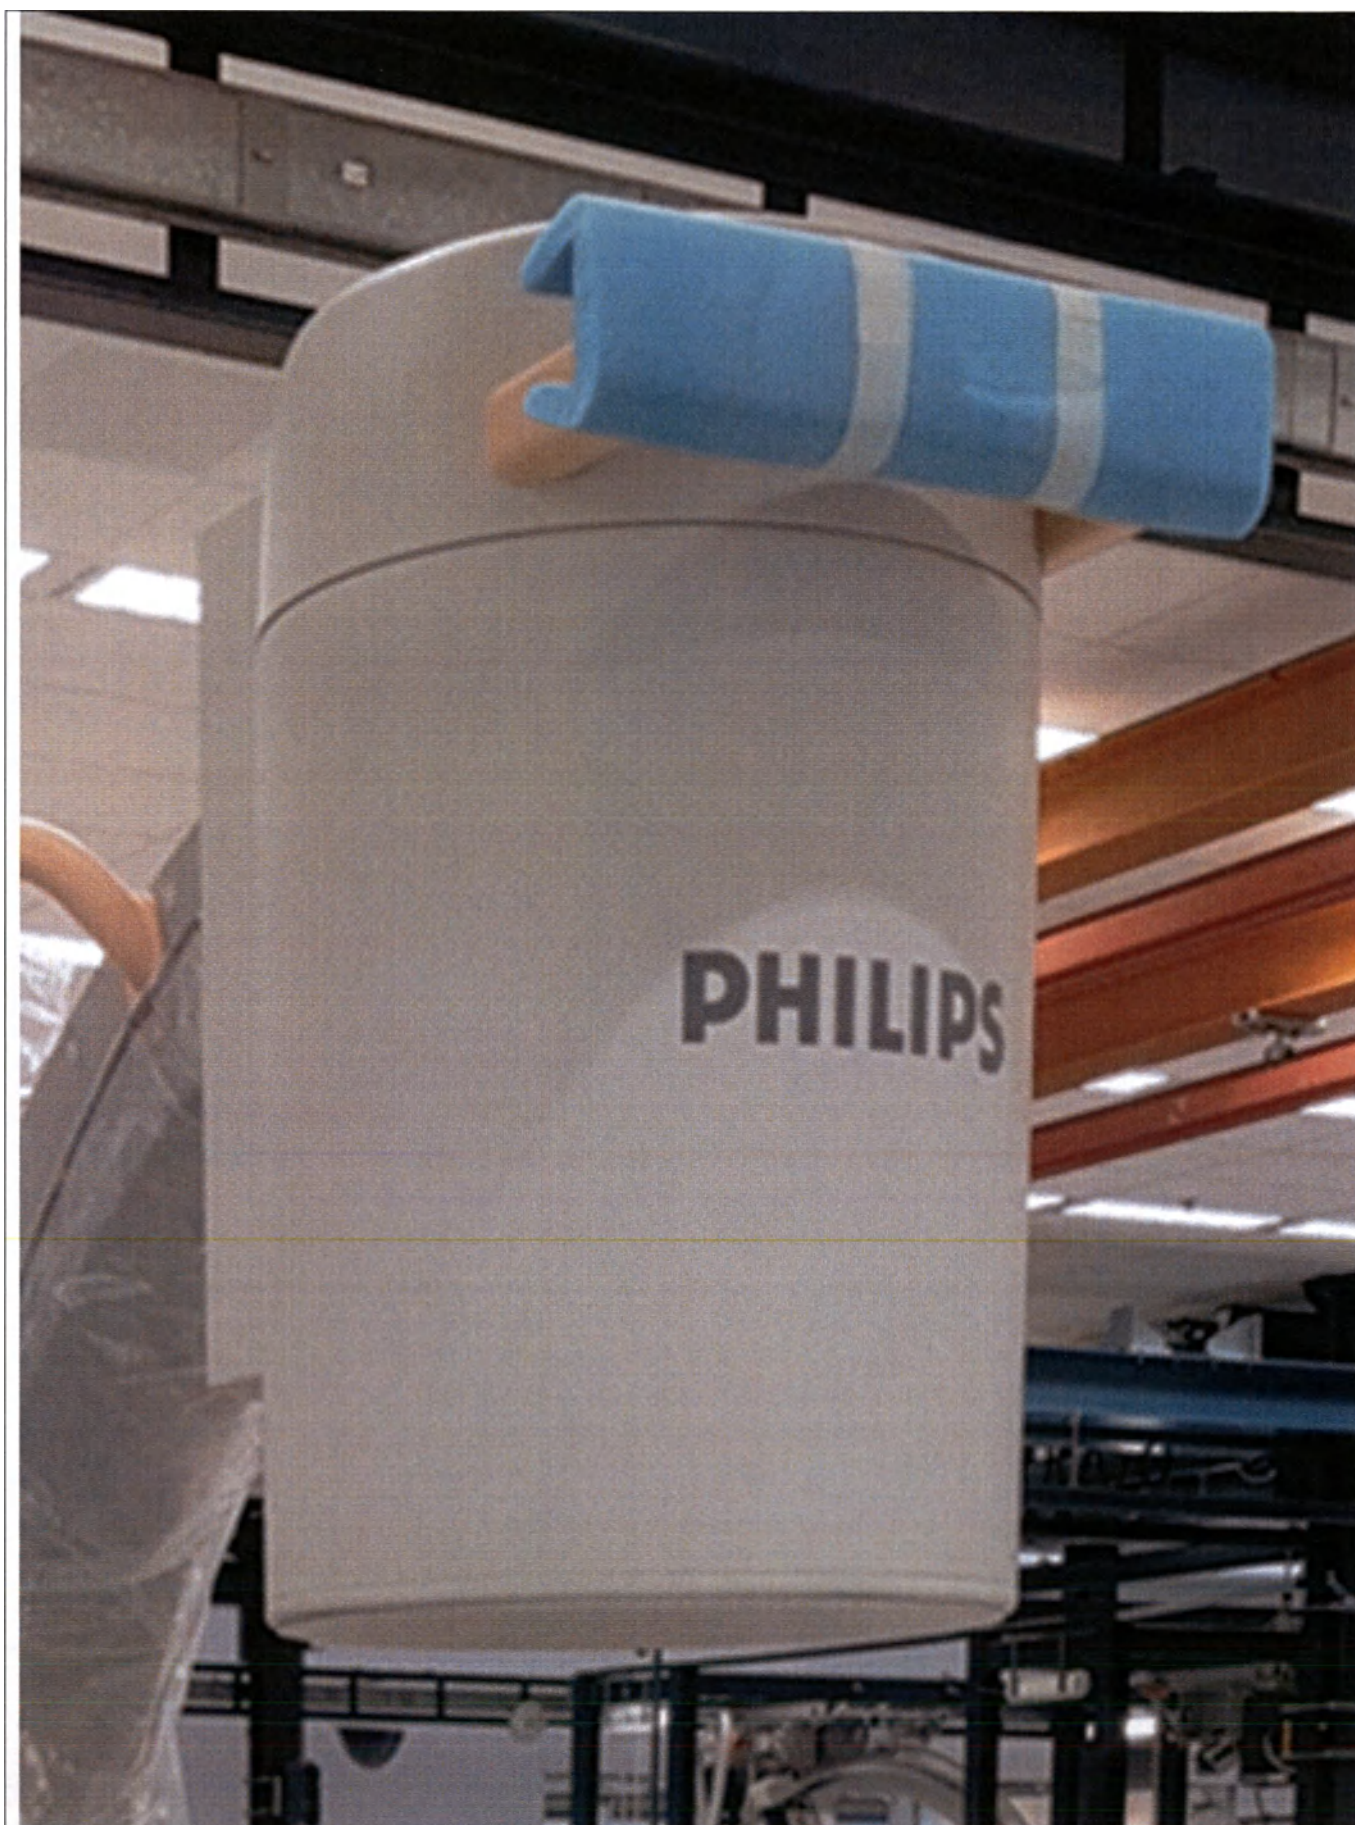


1.5.2 Усилитель изображений 9”(E5830SD) '

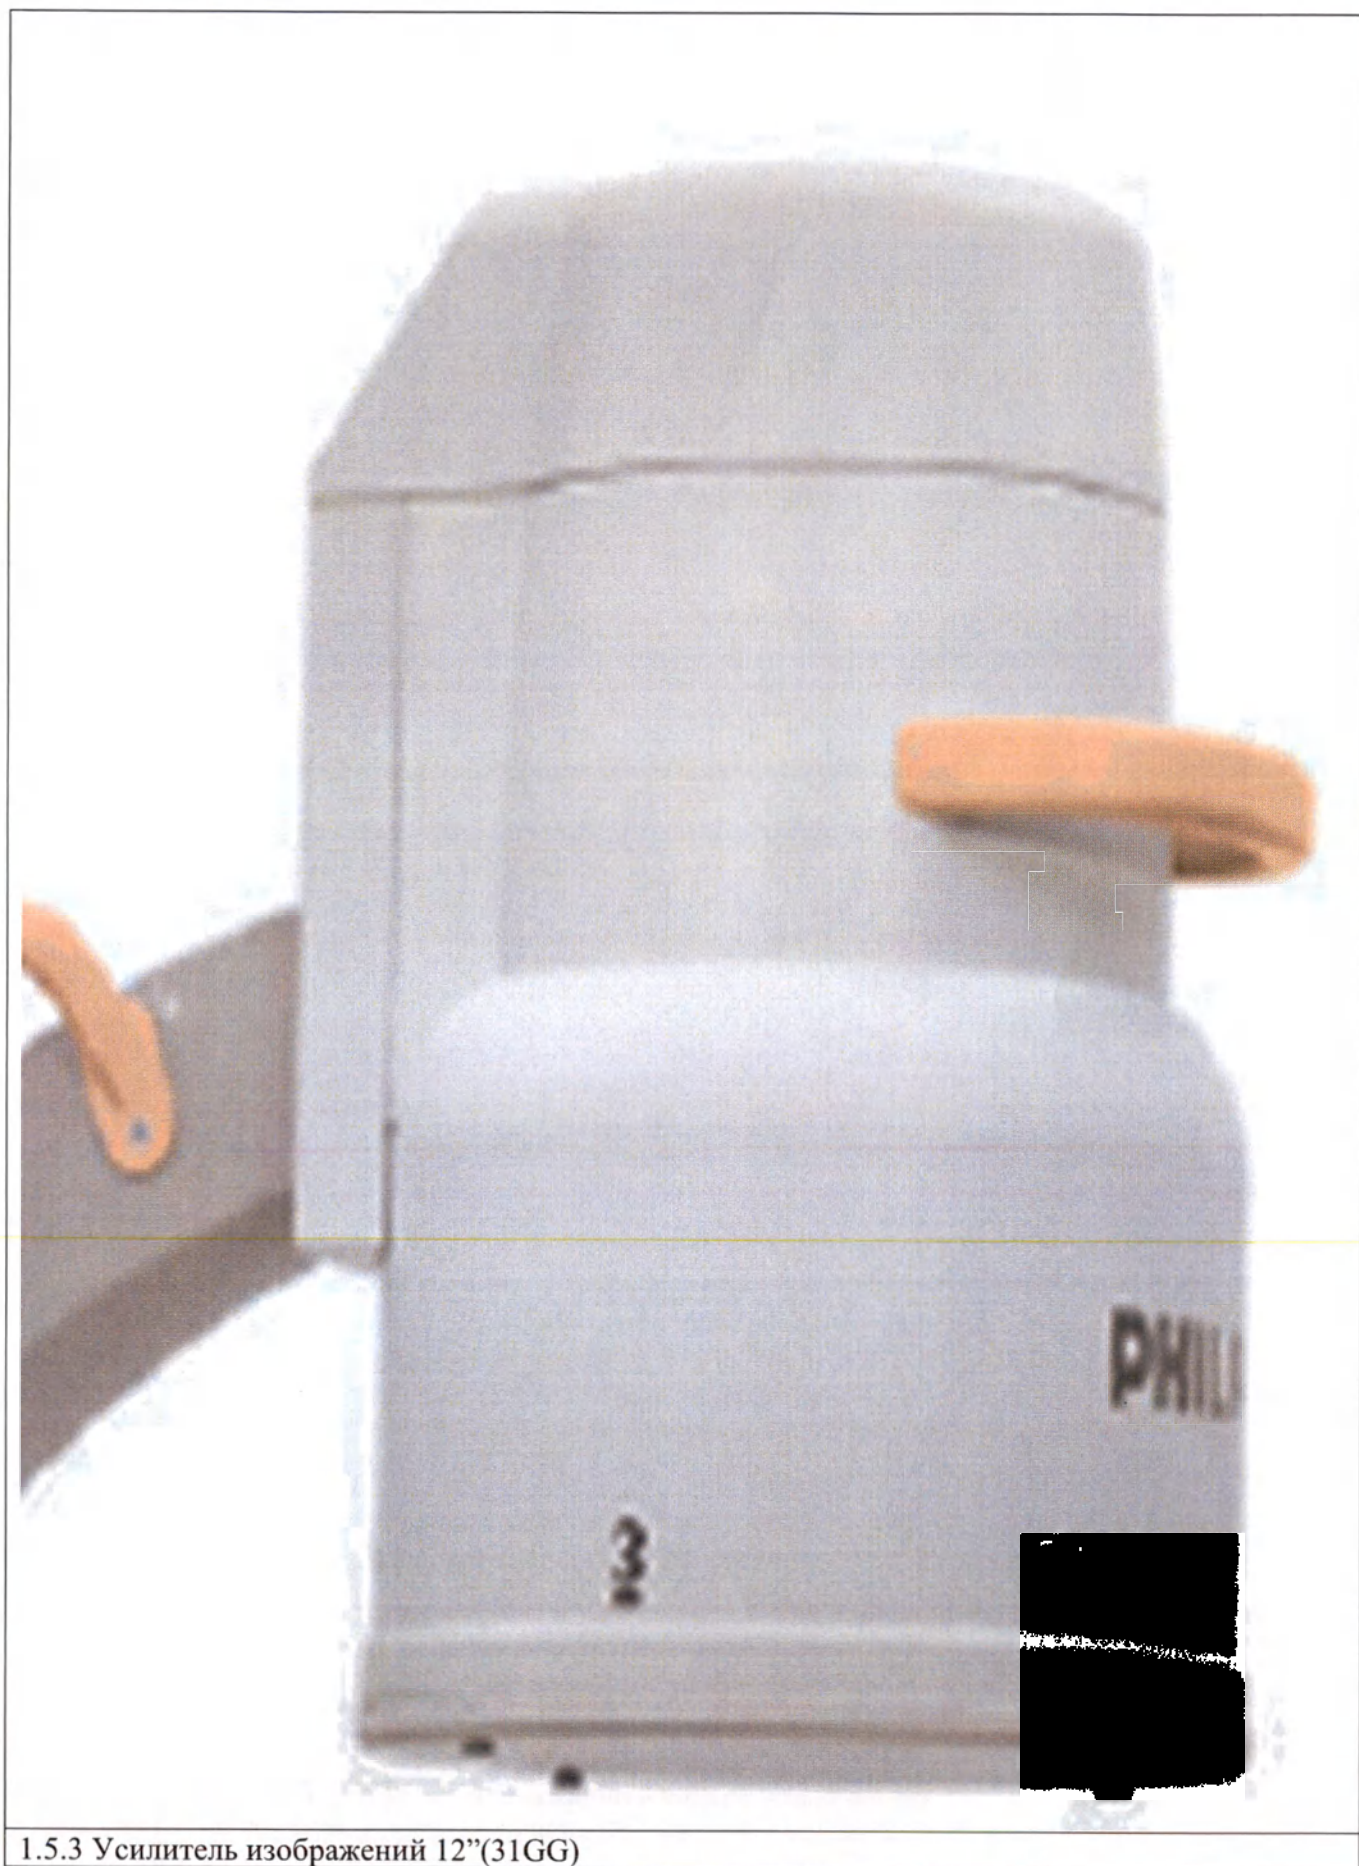


1.5.3 Усилитель изображений 12"(31GG)

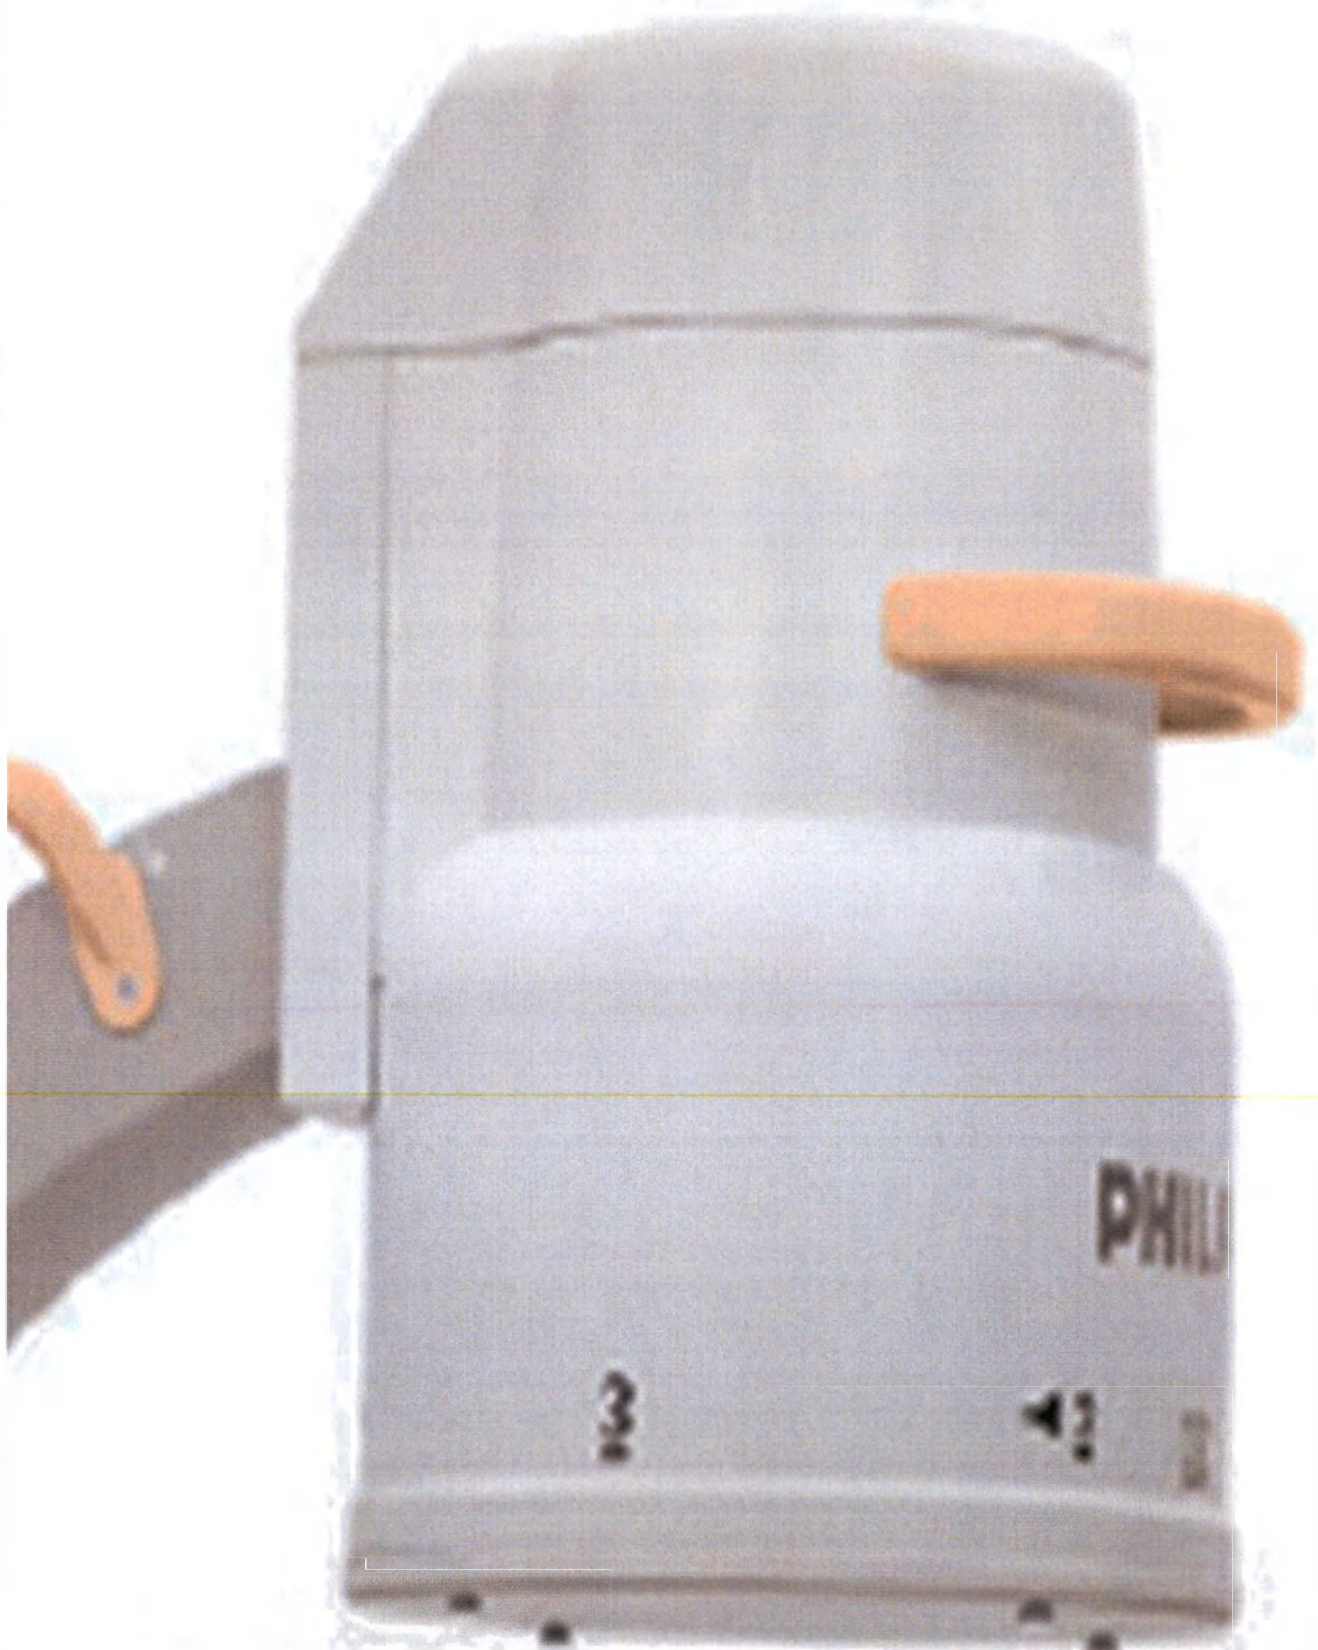


1.5.4 Усилитель изображений 12"(E5796SD)

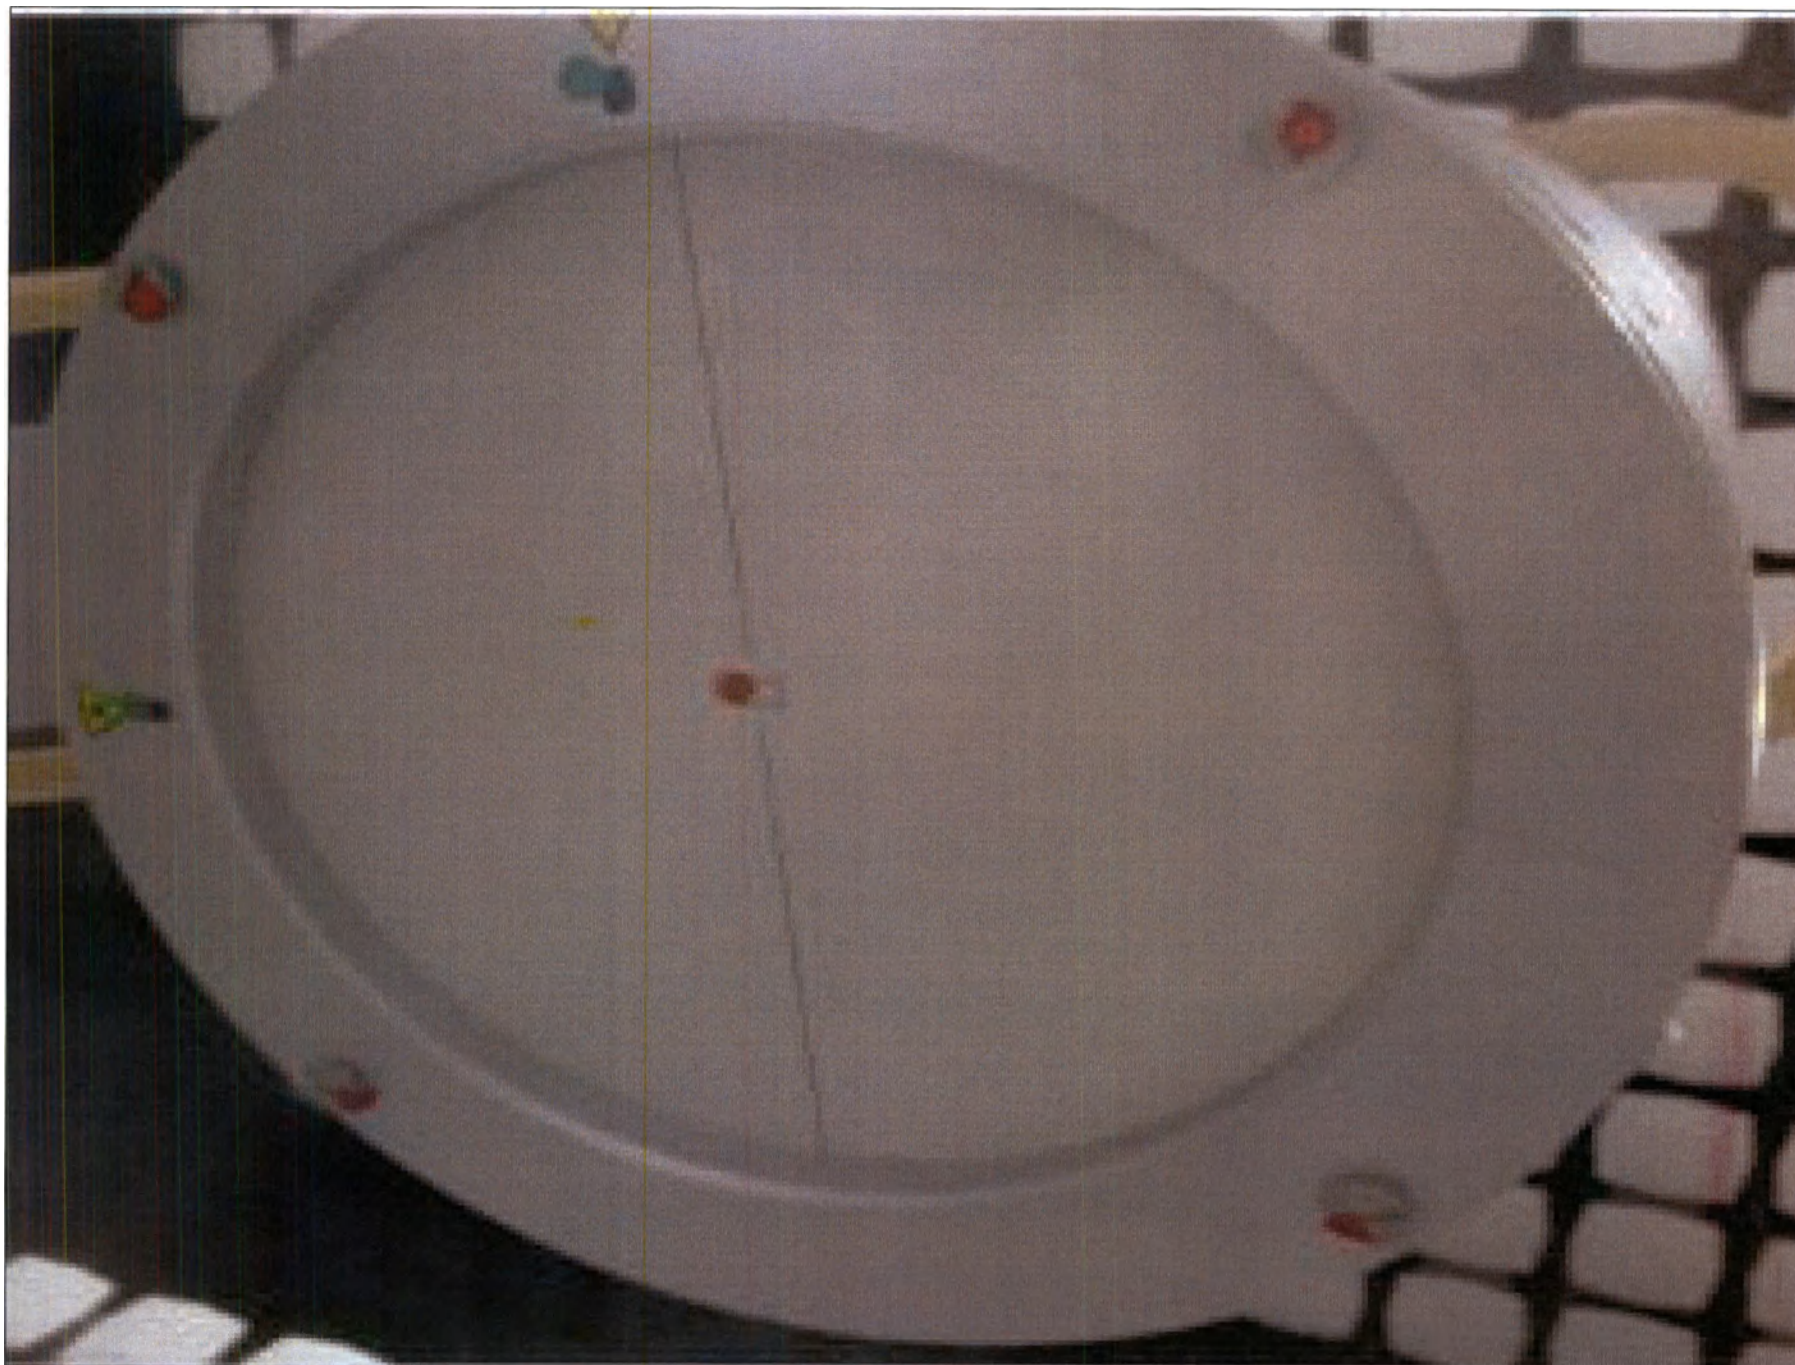


1.6. Отсеивающая решетка 9" или 12".

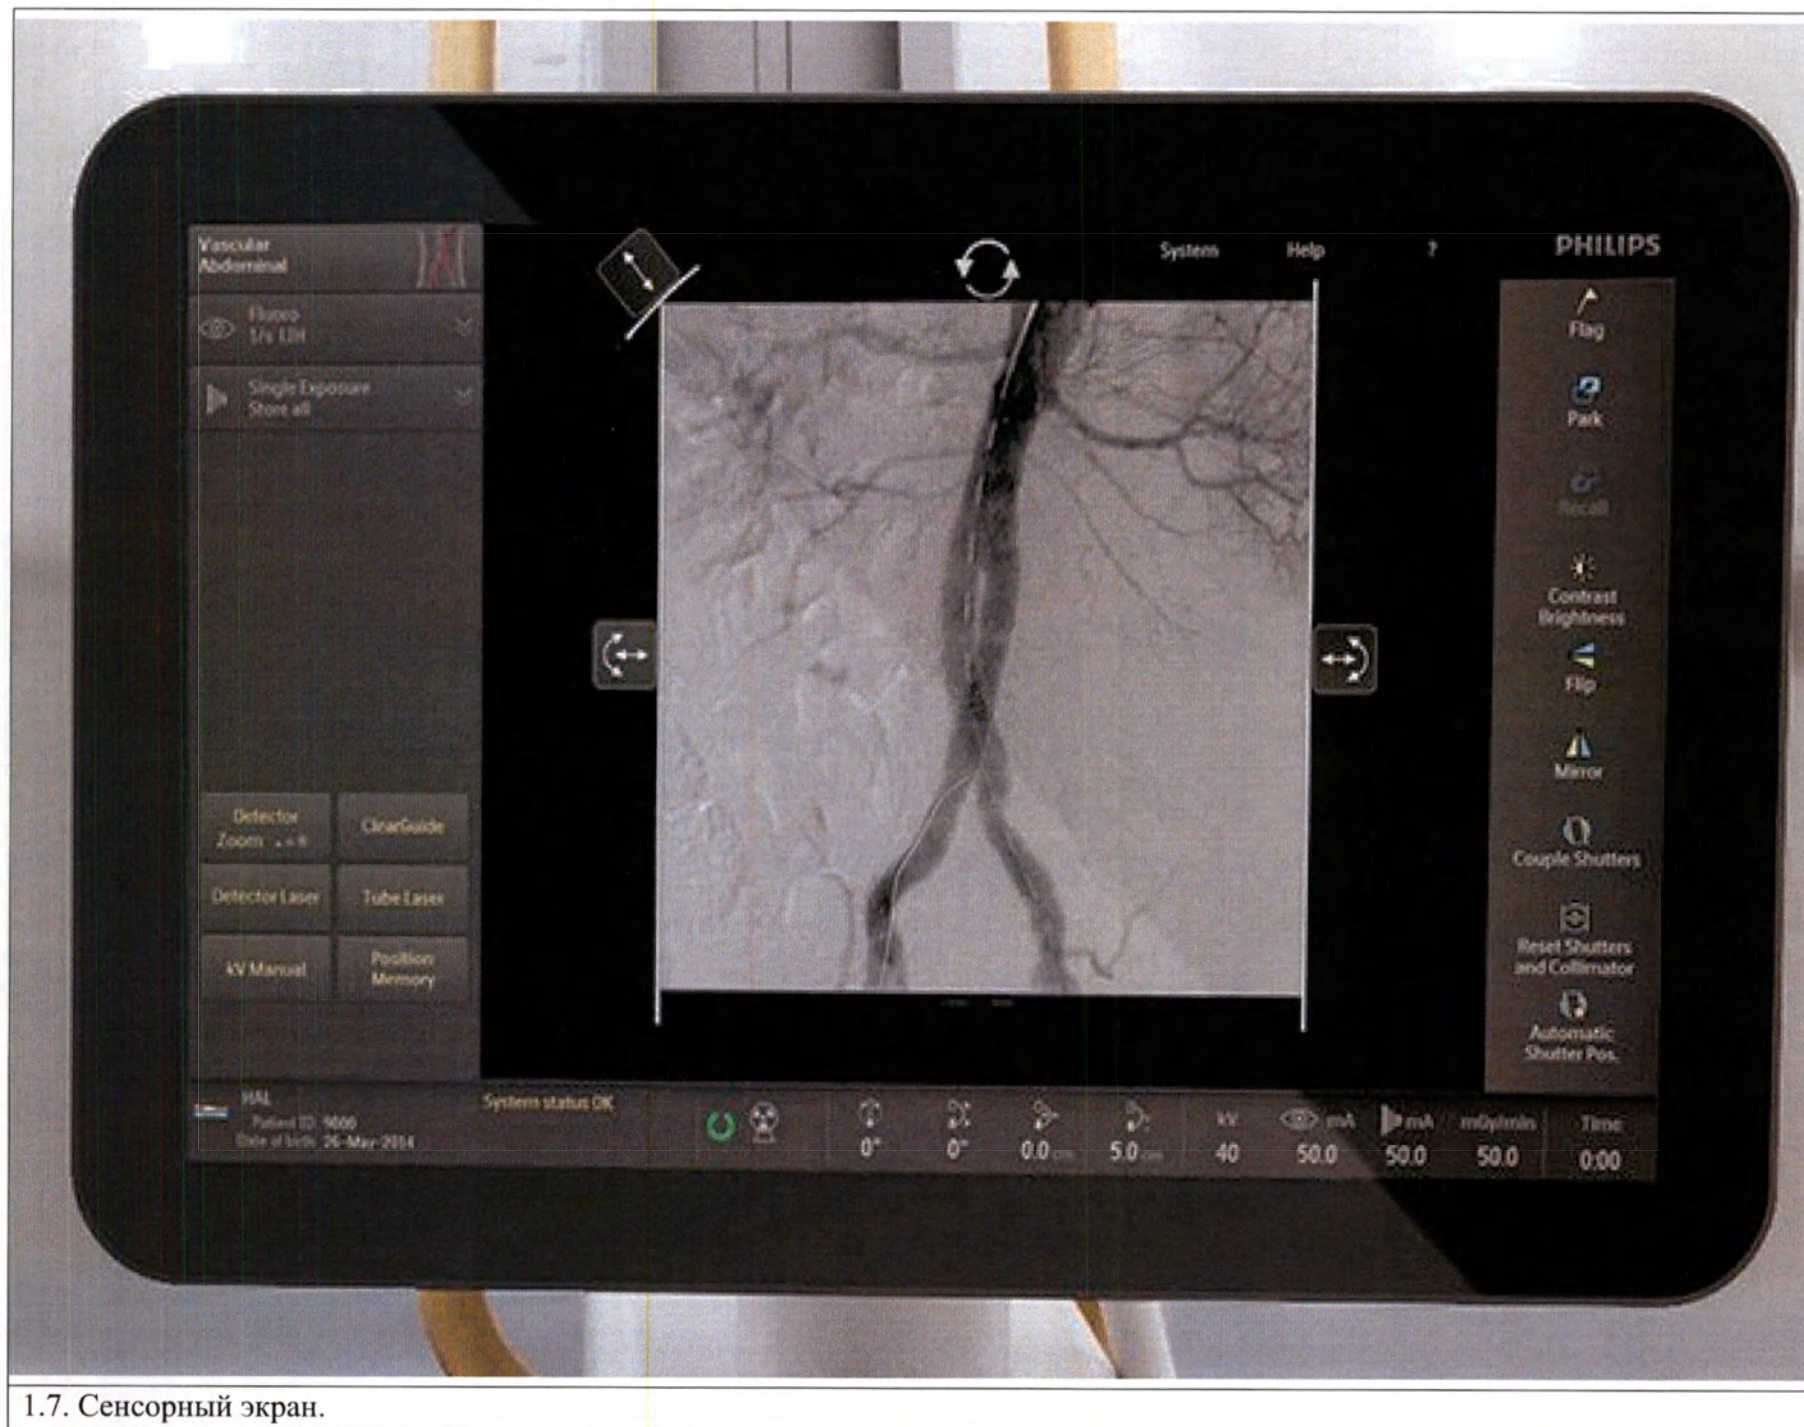

1.7. Сенсорный экран.

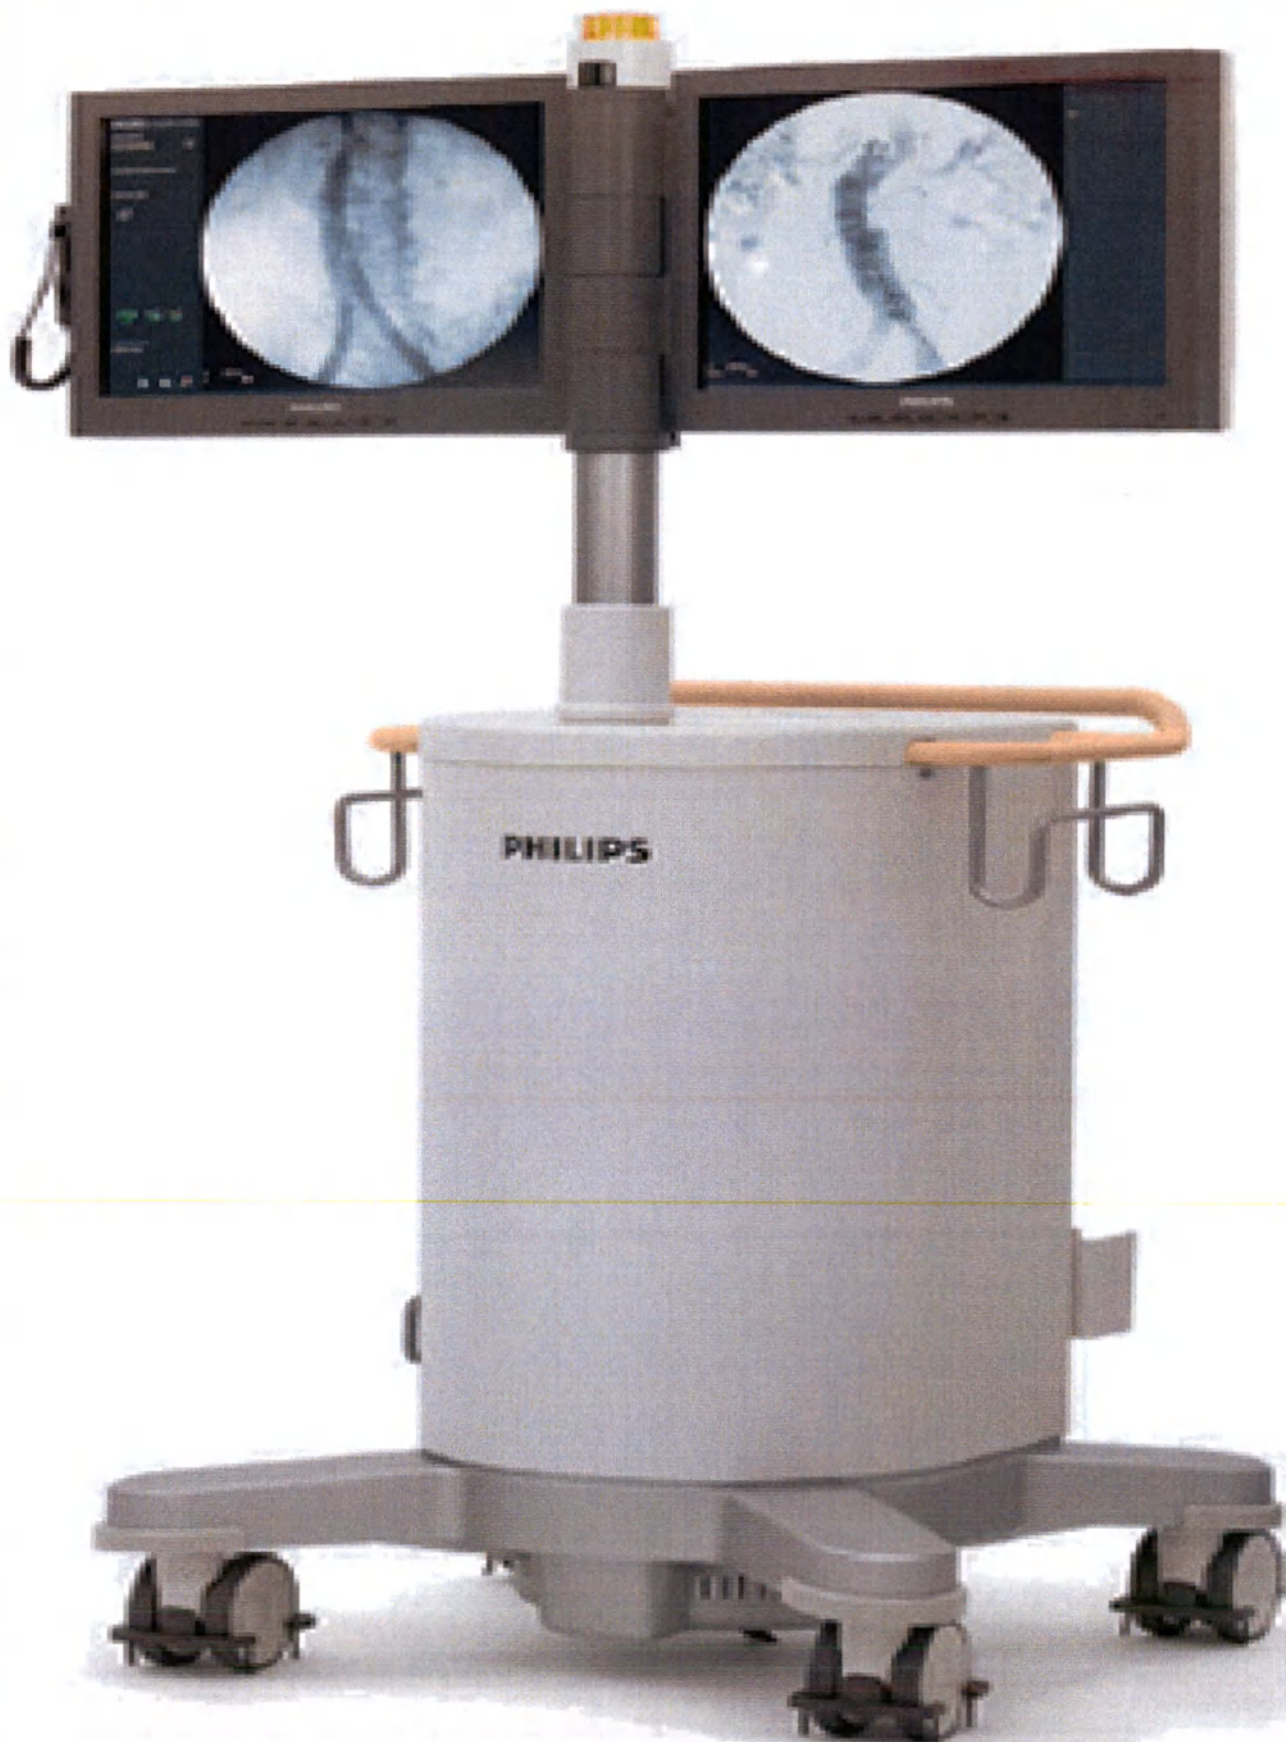


2. Передвижная станция просмотра

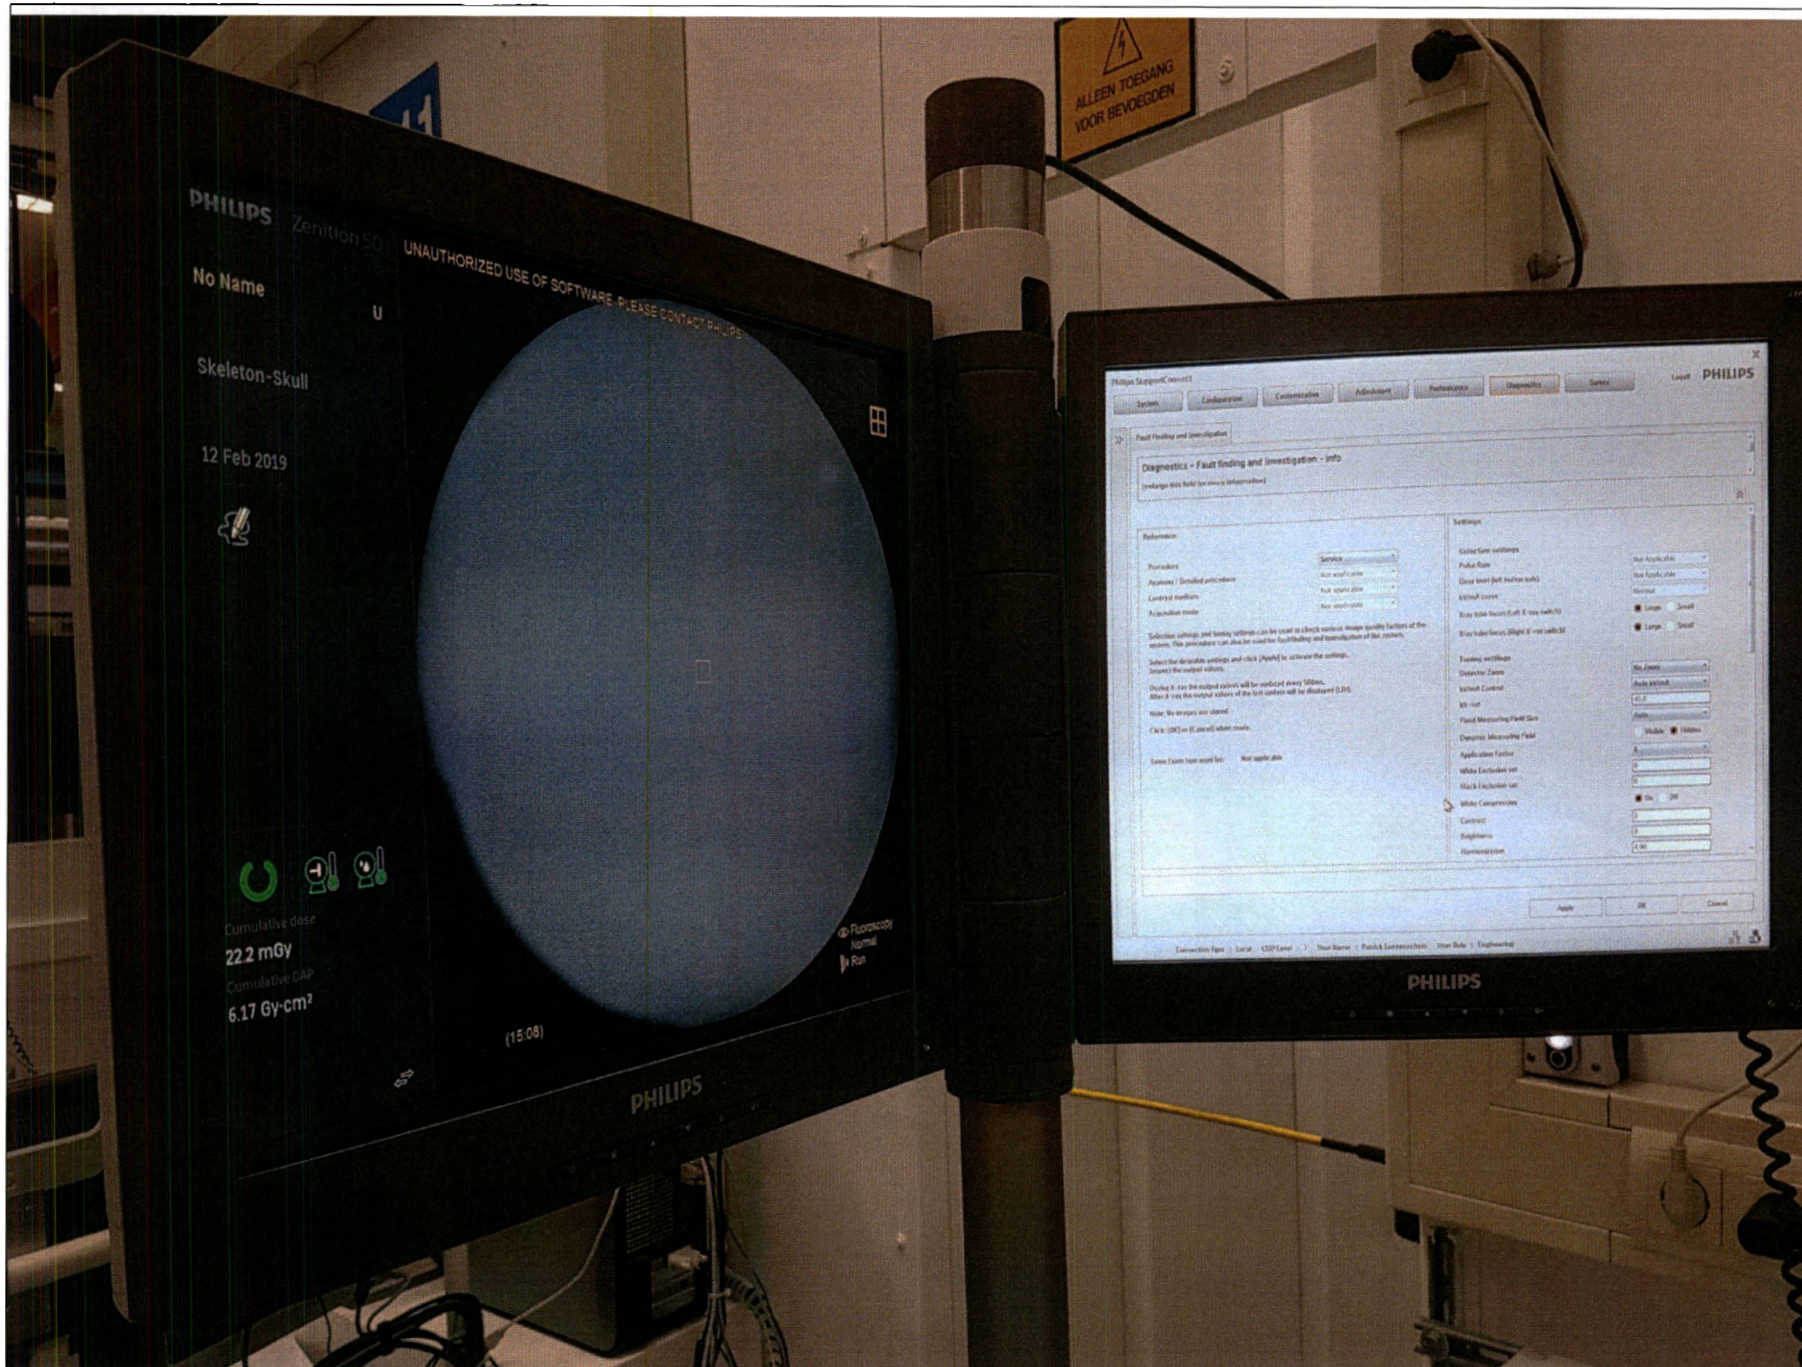


2.1 Монитор для исследований типа MLCD19, в вариантах исполнения:


2.1.1 Монитор для исследований типа MLCD19 стандартной яркости (слева).

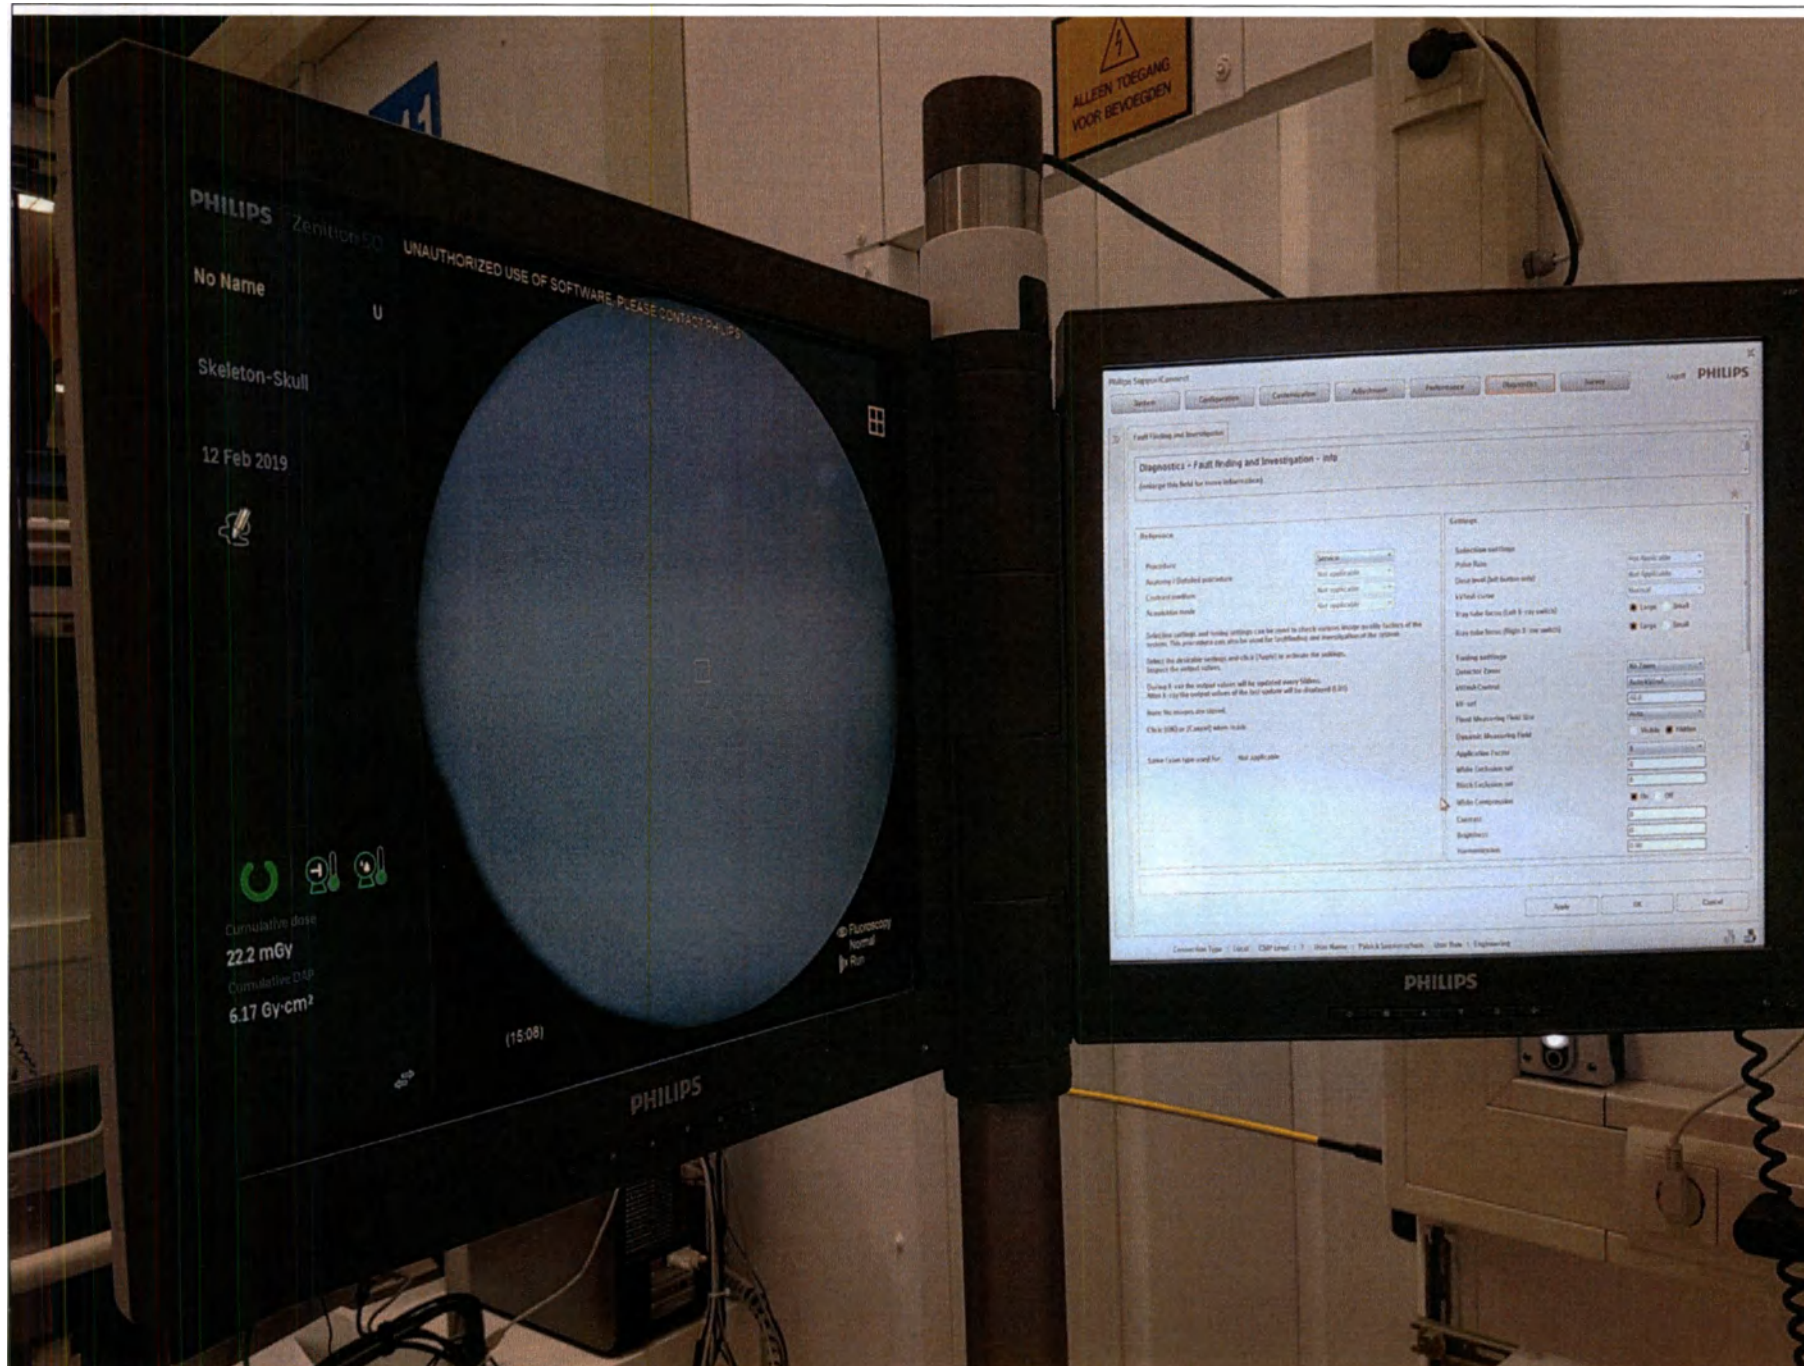

2.1.3. Монитор для исследований типа MLCD19 стандартной яркости с функцией сенсорного экрана (слева).

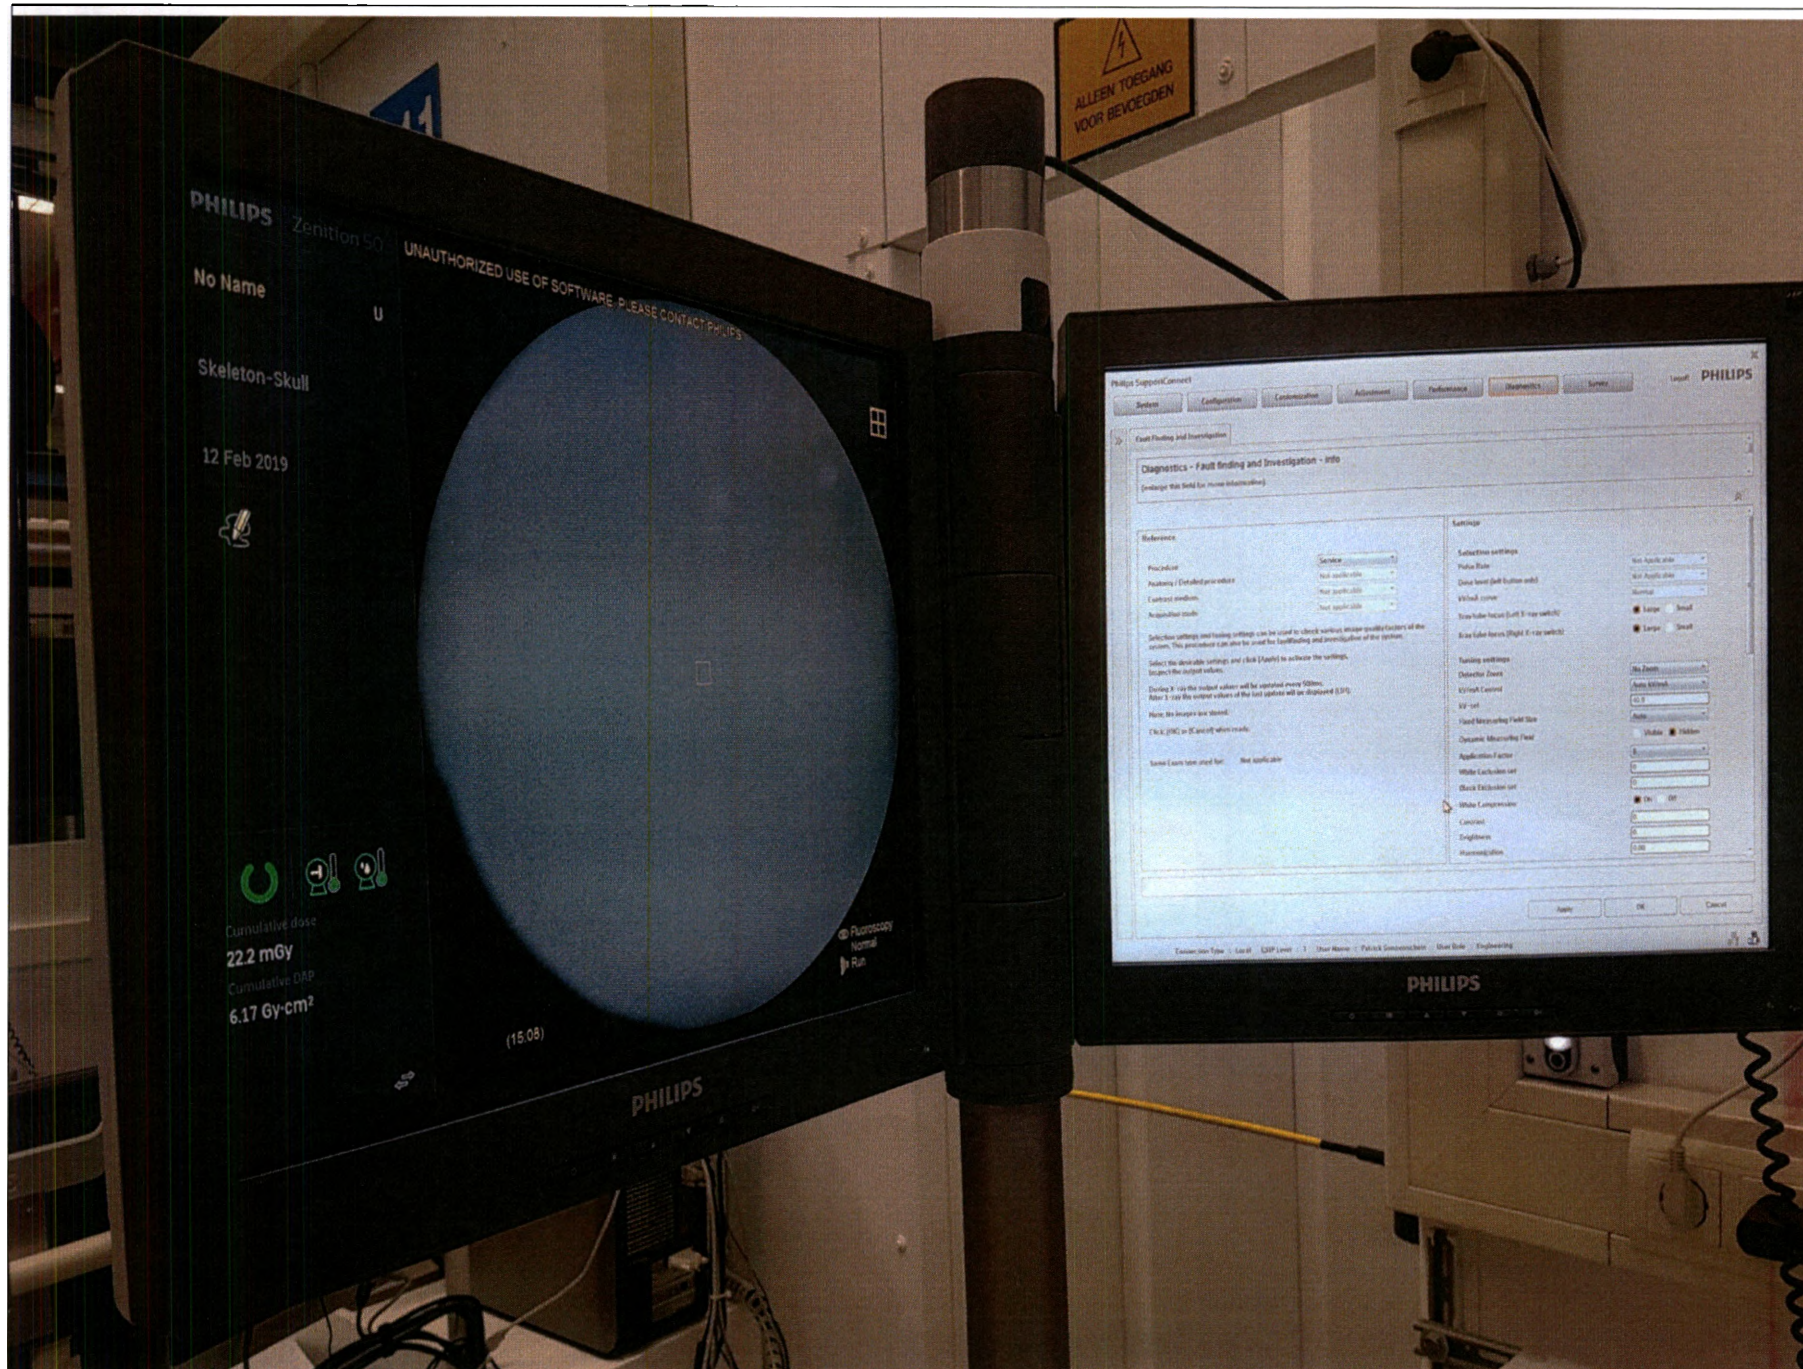


2 1 4 Монитор для исследований типа MLCD19 высокой яркости с функцией сенсорного экрана (слева).

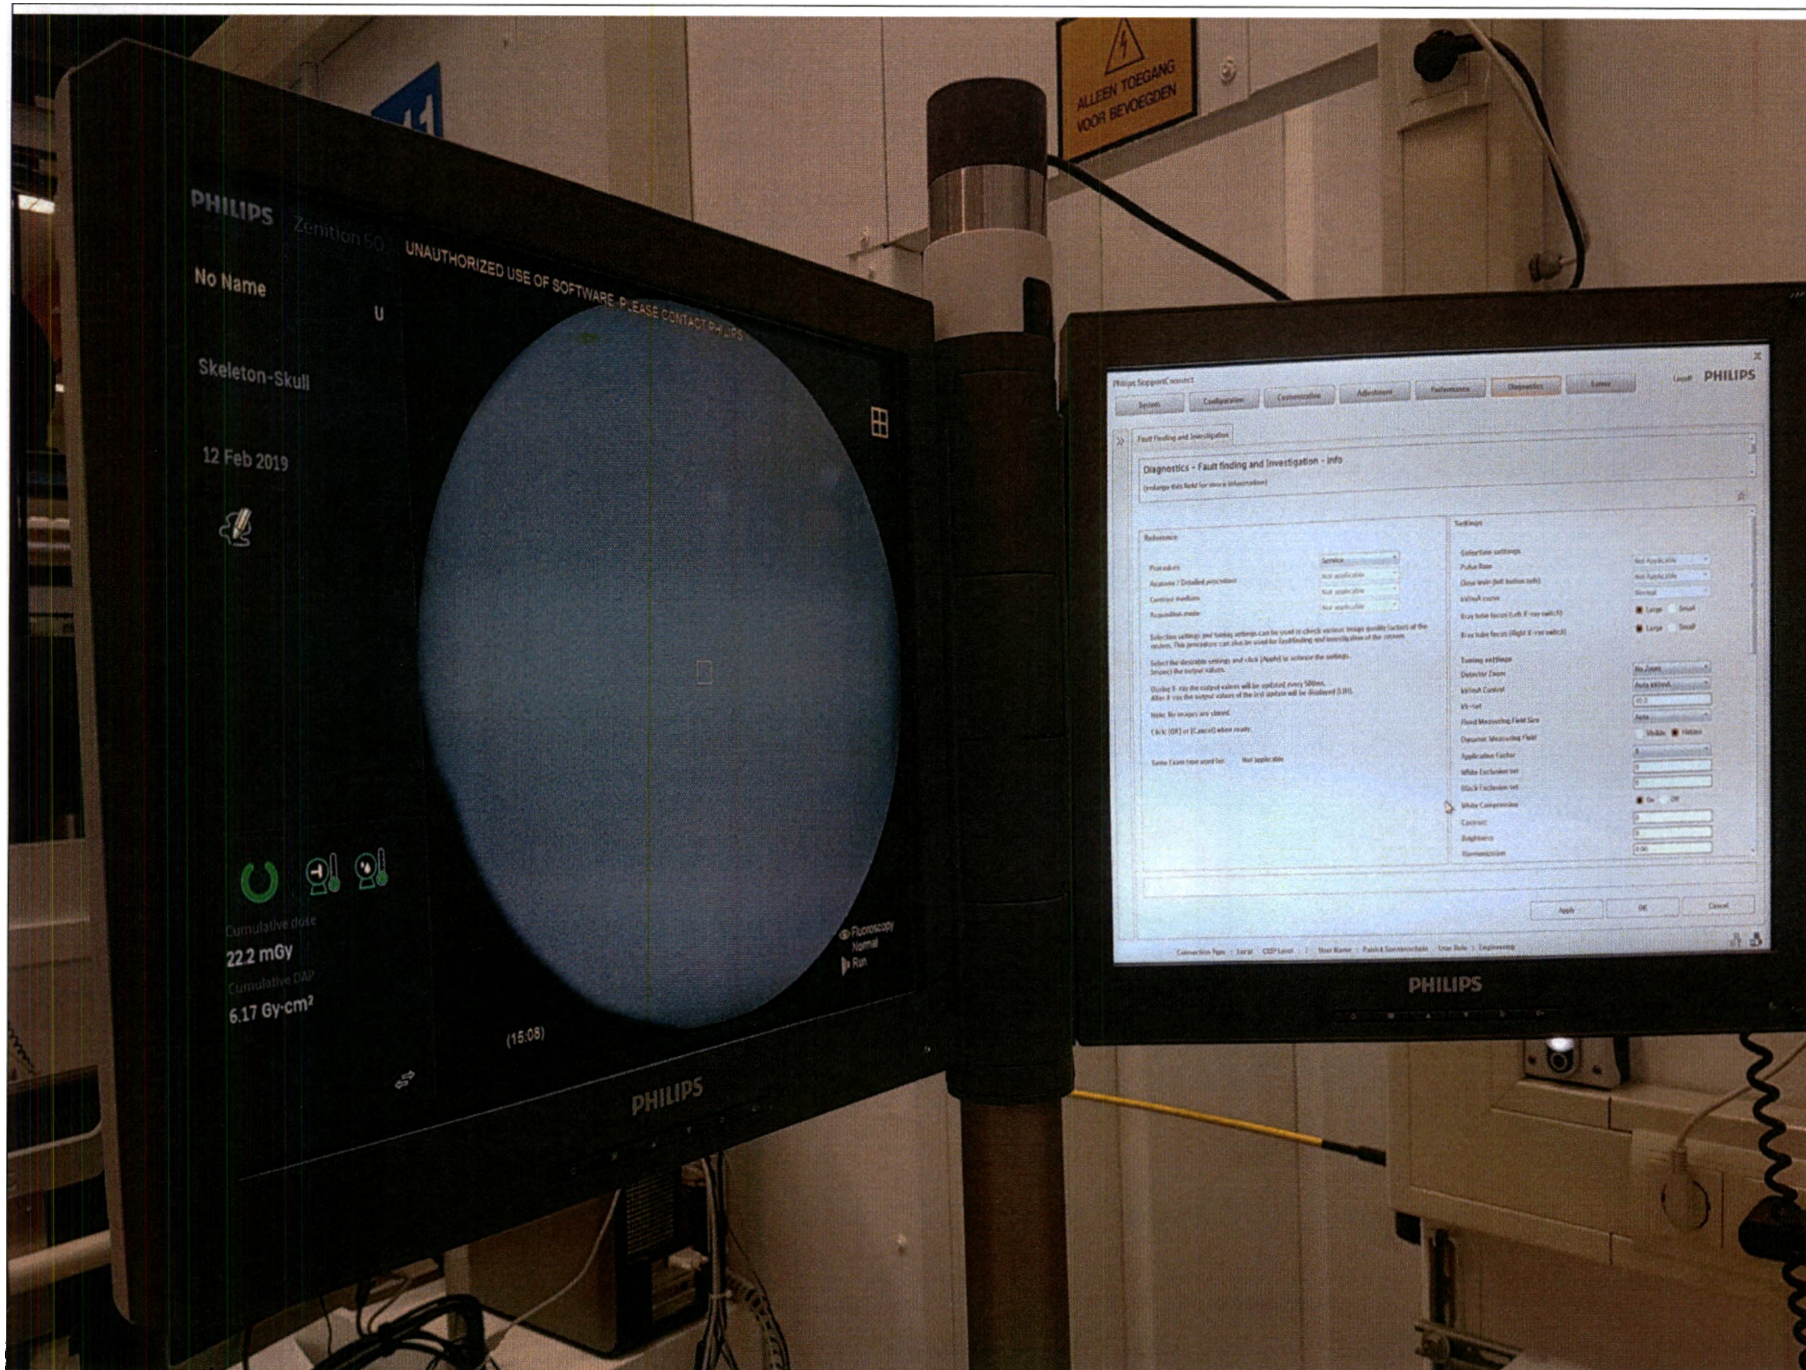

2.2. Контрольный монитор, в вариантах исполнения:

2.2.2 Контрольный монитор стандартной яркости (справа).

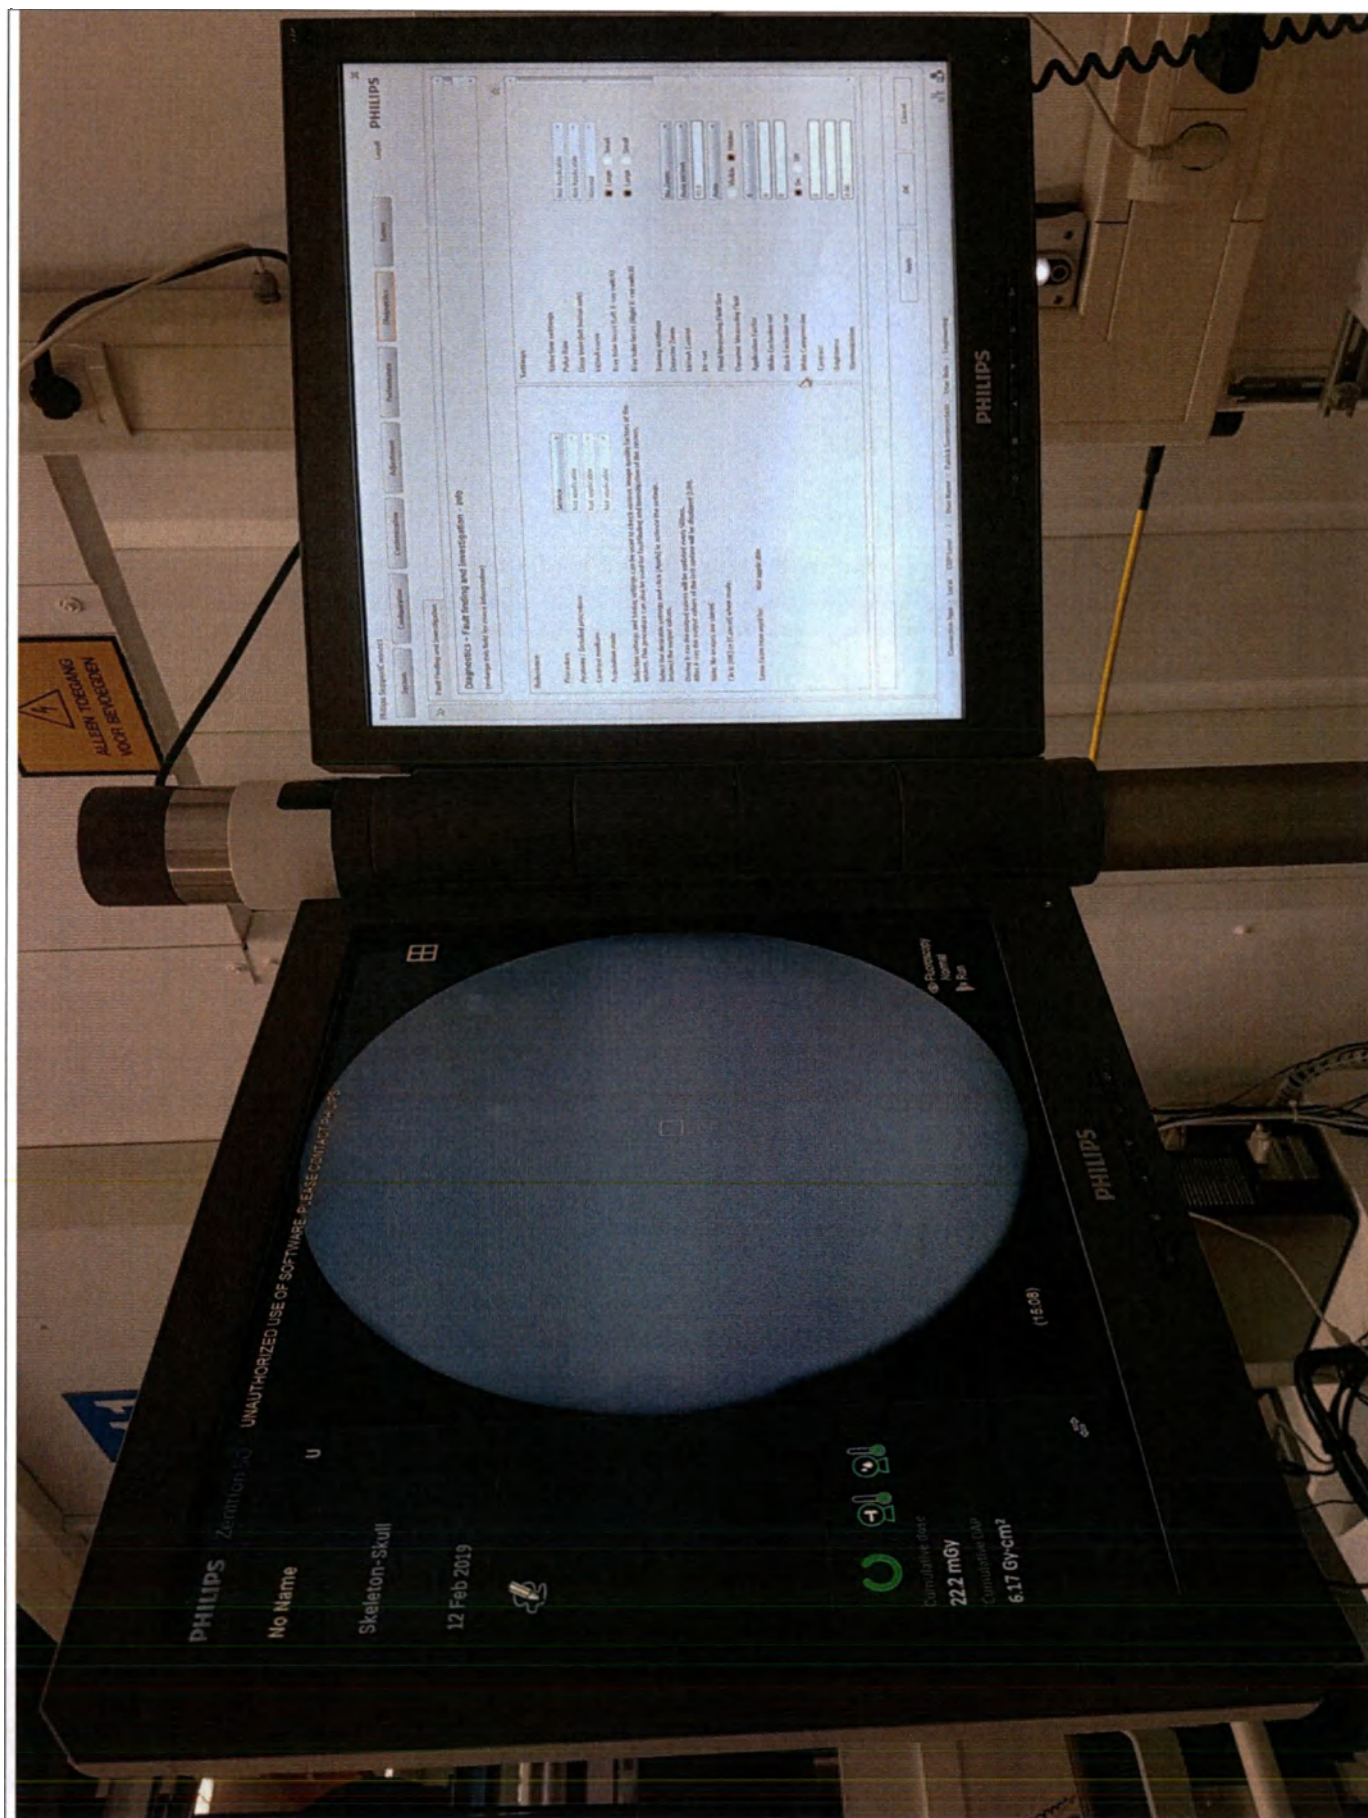

2.2.3 Контрольный монитор высокой яркости (справа).



3. Программное обеспечение для обработки изображений.



4. Ручной переключатель.



5. Ножной переключатель.



6. Кабель питания длиной 3м.

PHILIPS

Руководство по
эксплуатации

Русский

4598 013 57671




Philips Zenition 50

Версия 1.1

7. Эксплуатационная документация.



1. Пульт дистанционного управления.

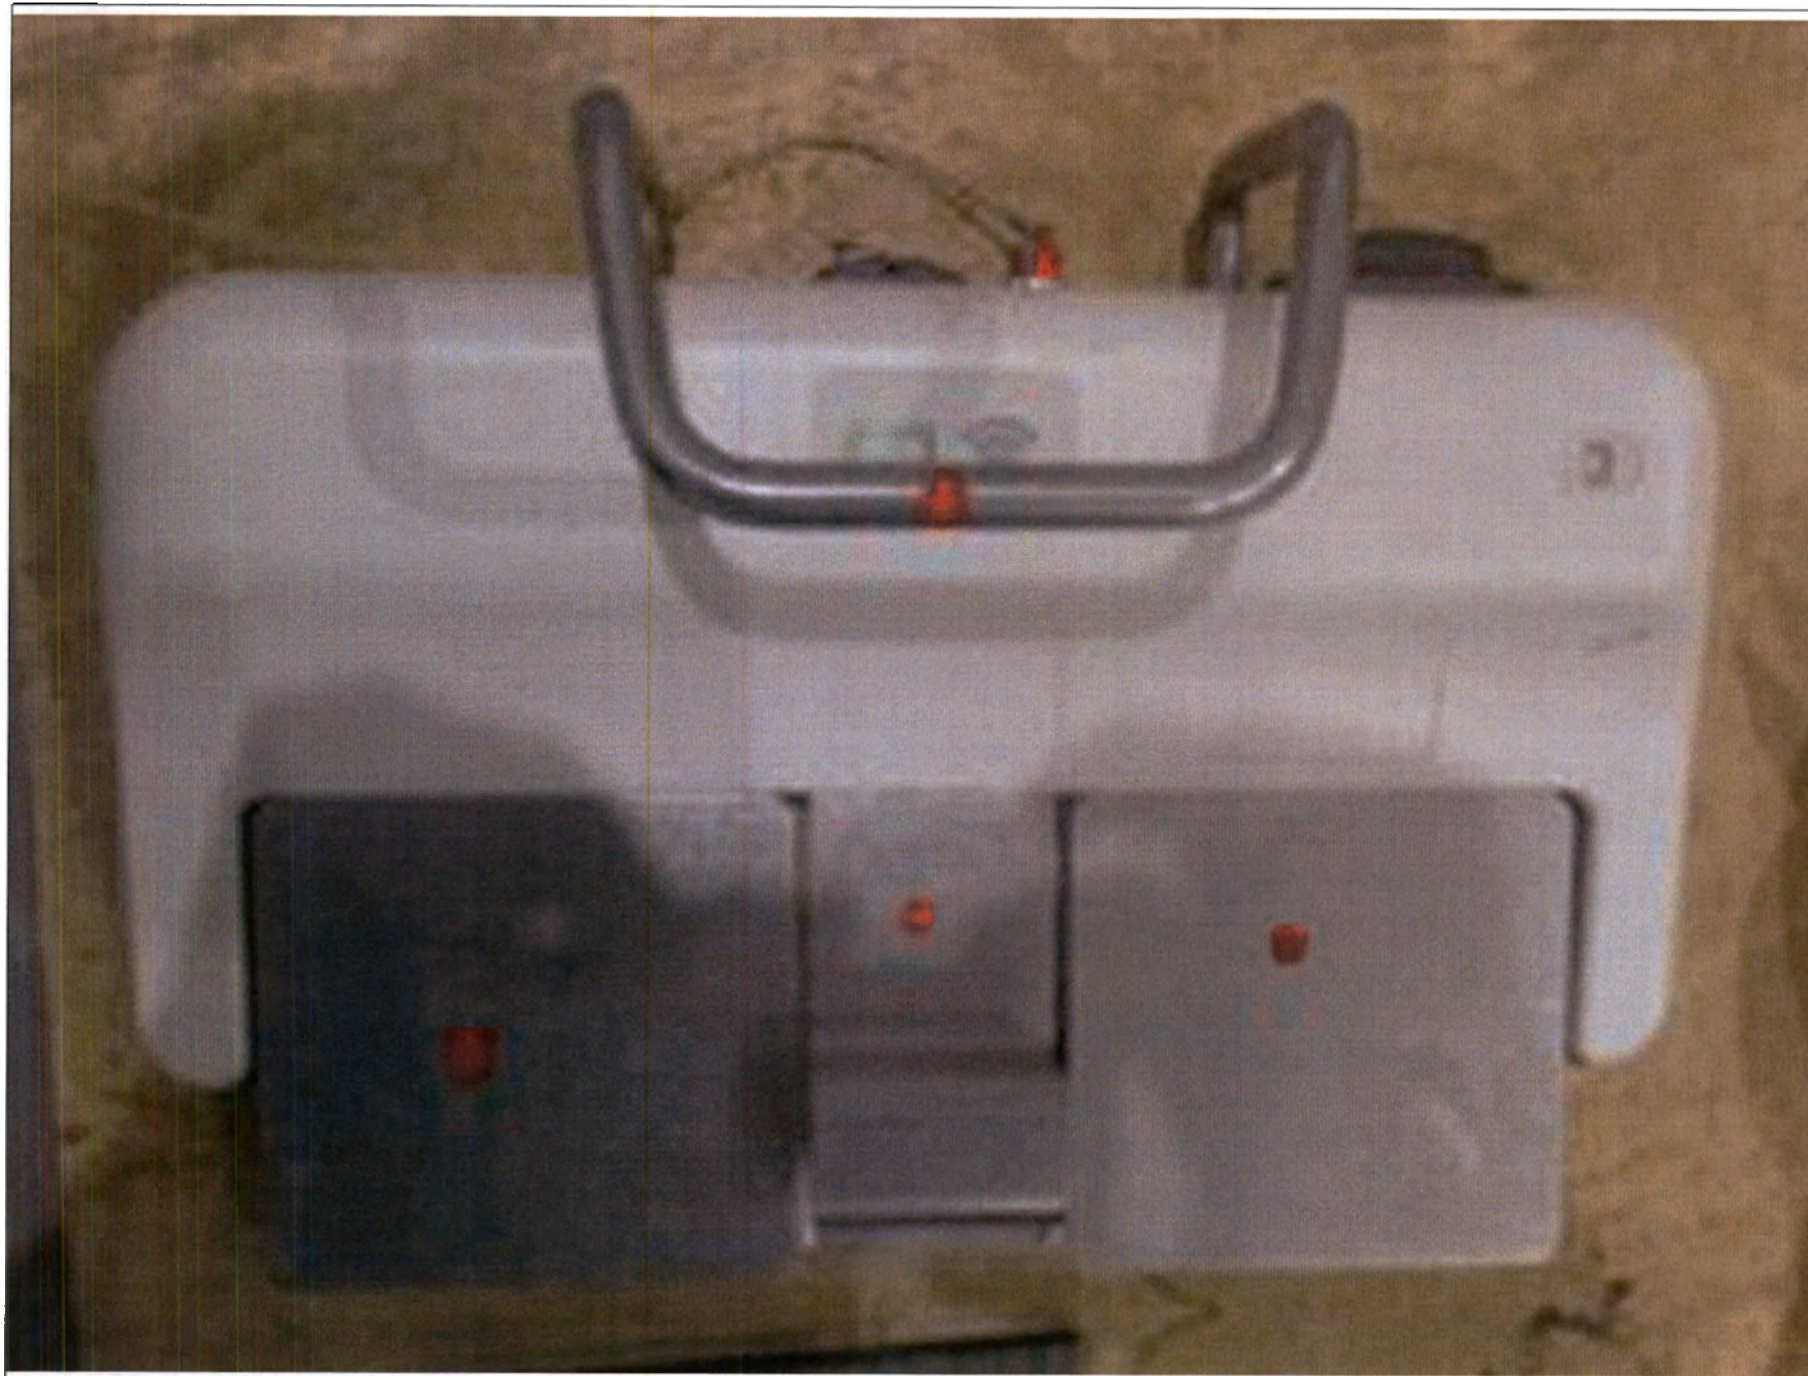


2. Беспроводной ножной переключатель.




3 а) Зарядное устройство беспроводного ножного переключателя.



3. b) Зарядное устройство беспроводного ножного переключателя.

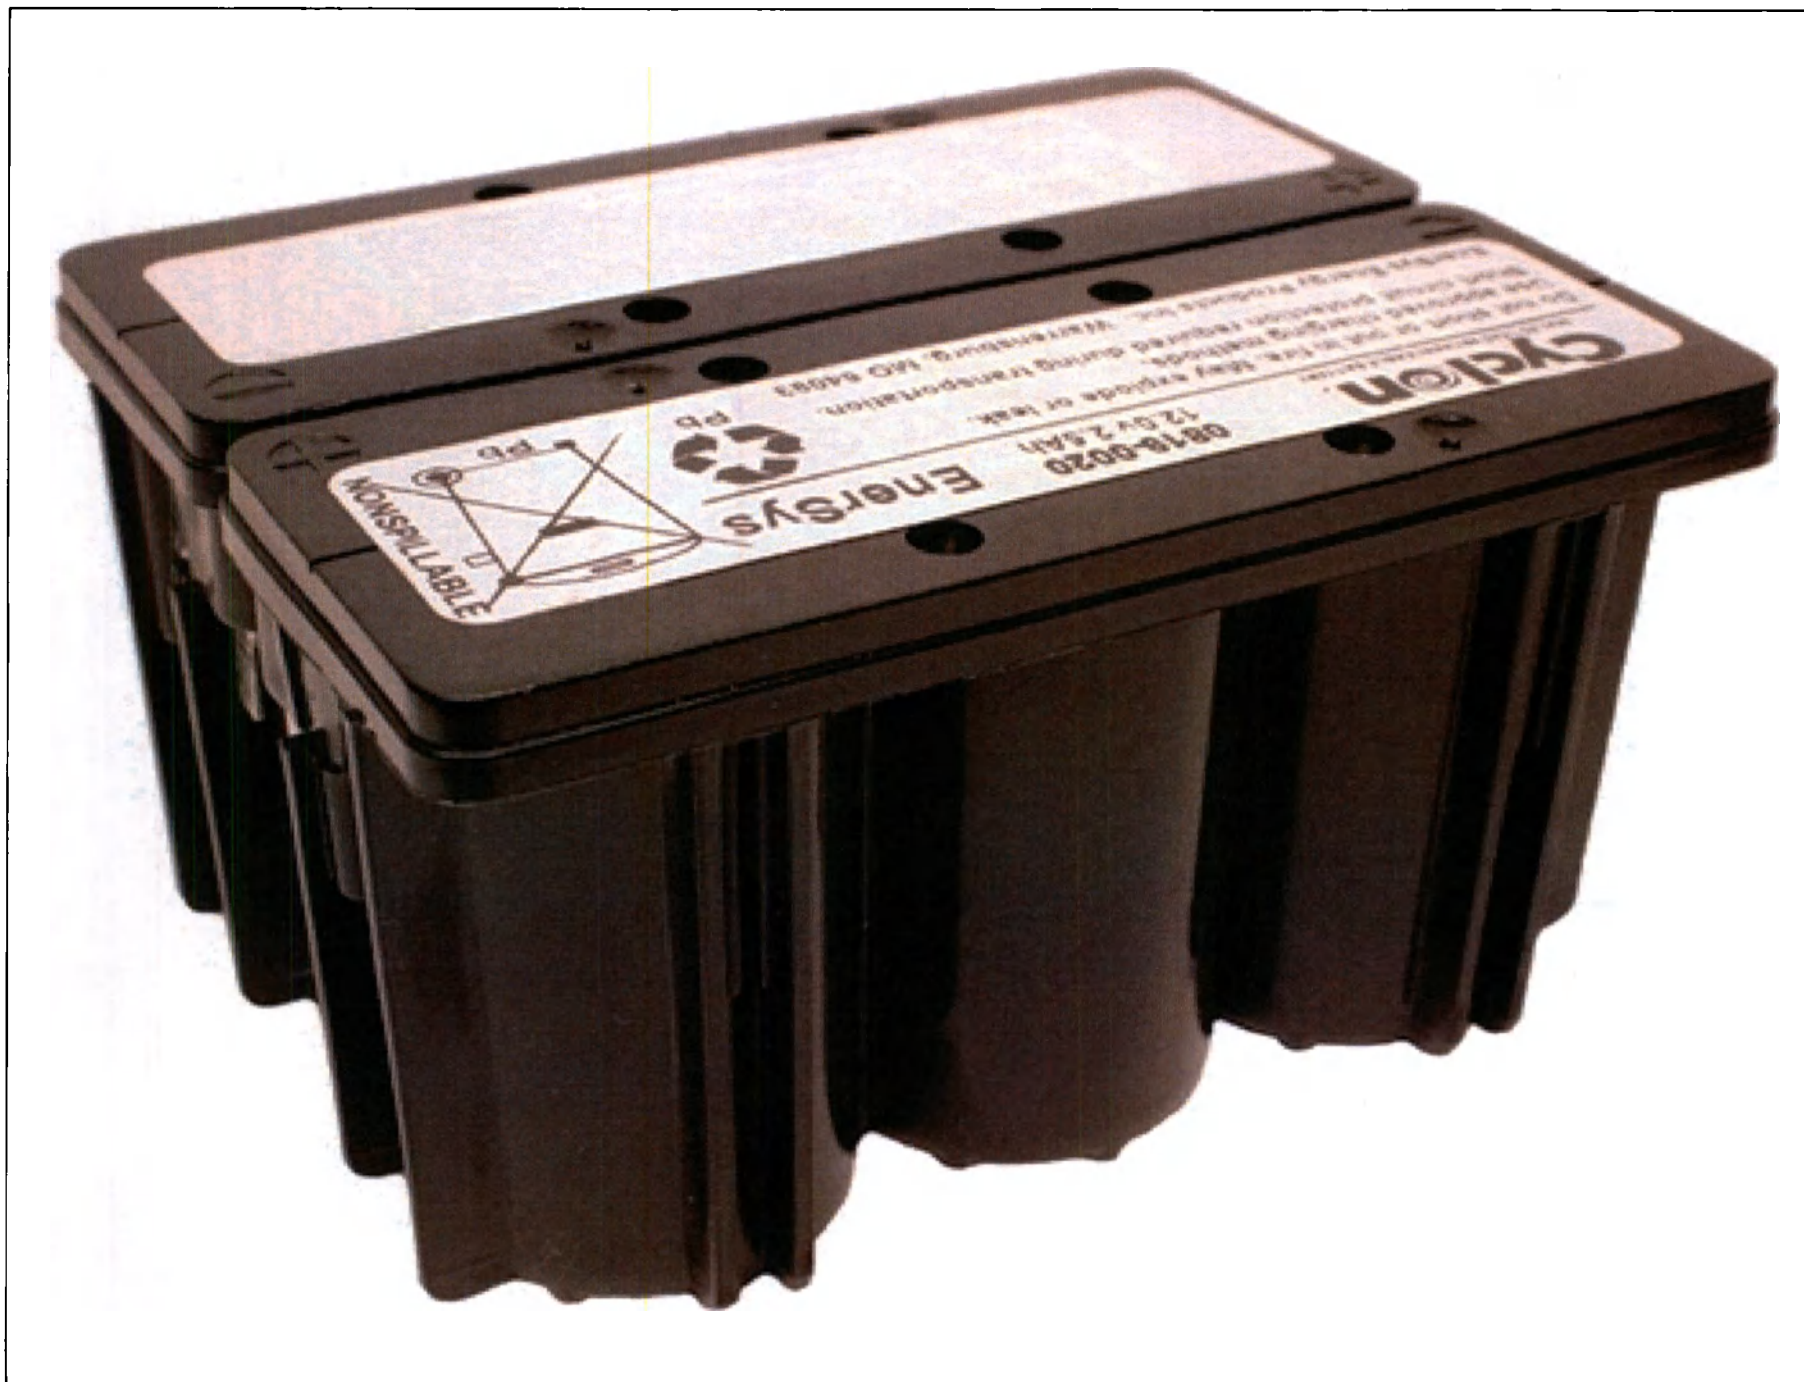

4. Аккумулятор накопителя энергии.

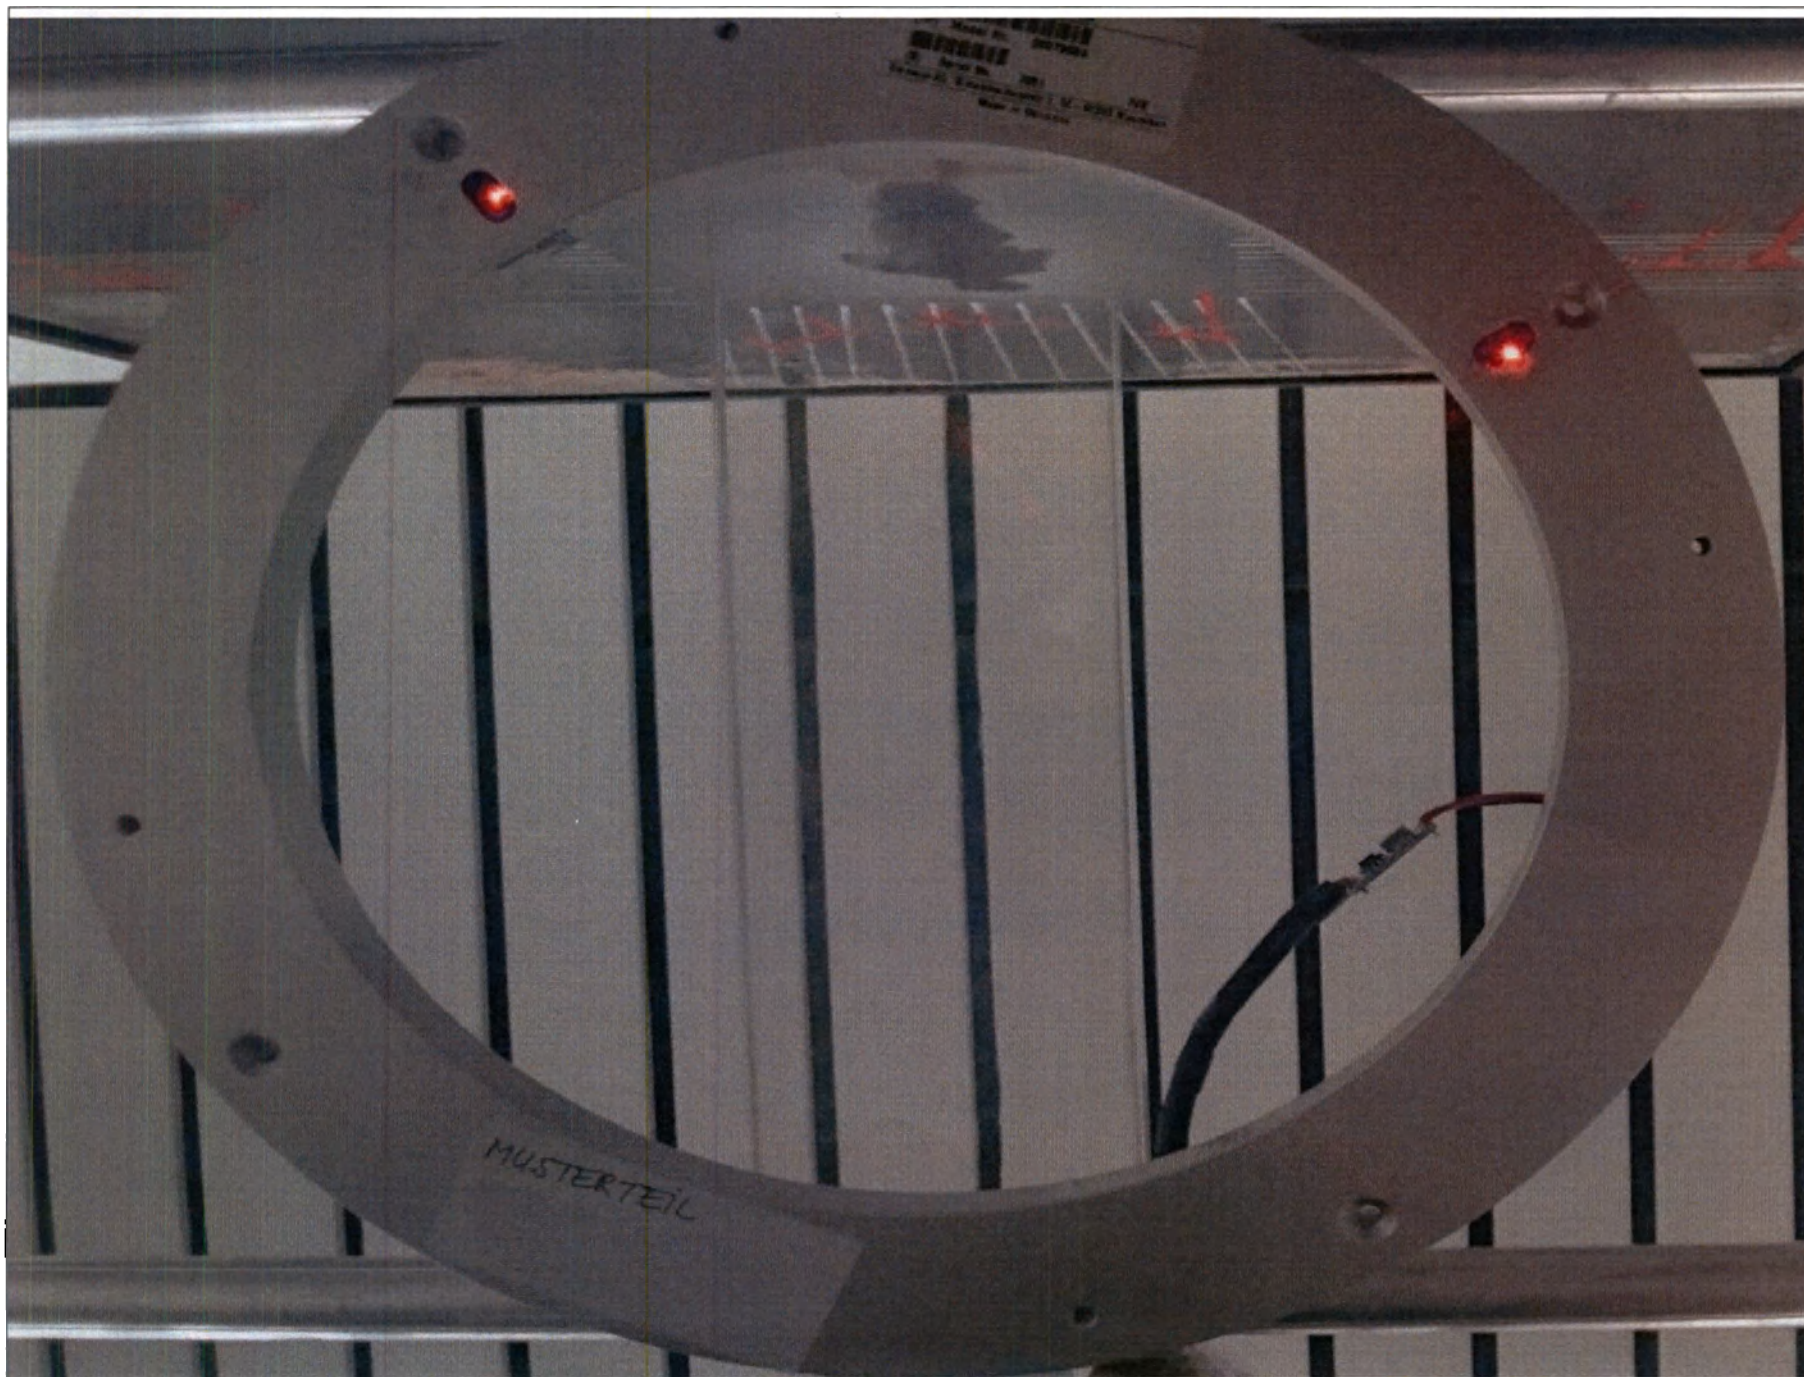

5. Лазерный прицел усилителя изображений Z-LAD Endura.



6. Лазерный прицел трубки.



7. Антенны беспроводной связи.



8. Мелипинский принтер Sony UP-971AD.



9. Медицинский принтер Sony UP-991AD.



10. а) Бумага для принтера Sony UPP-210SE.







11. Подпружиненная дуга для чехлов С-дуги.




12. а) Чехлы тканевые.



12. b) Чехлы тканевые.




12. с) Чехлы тканевые.

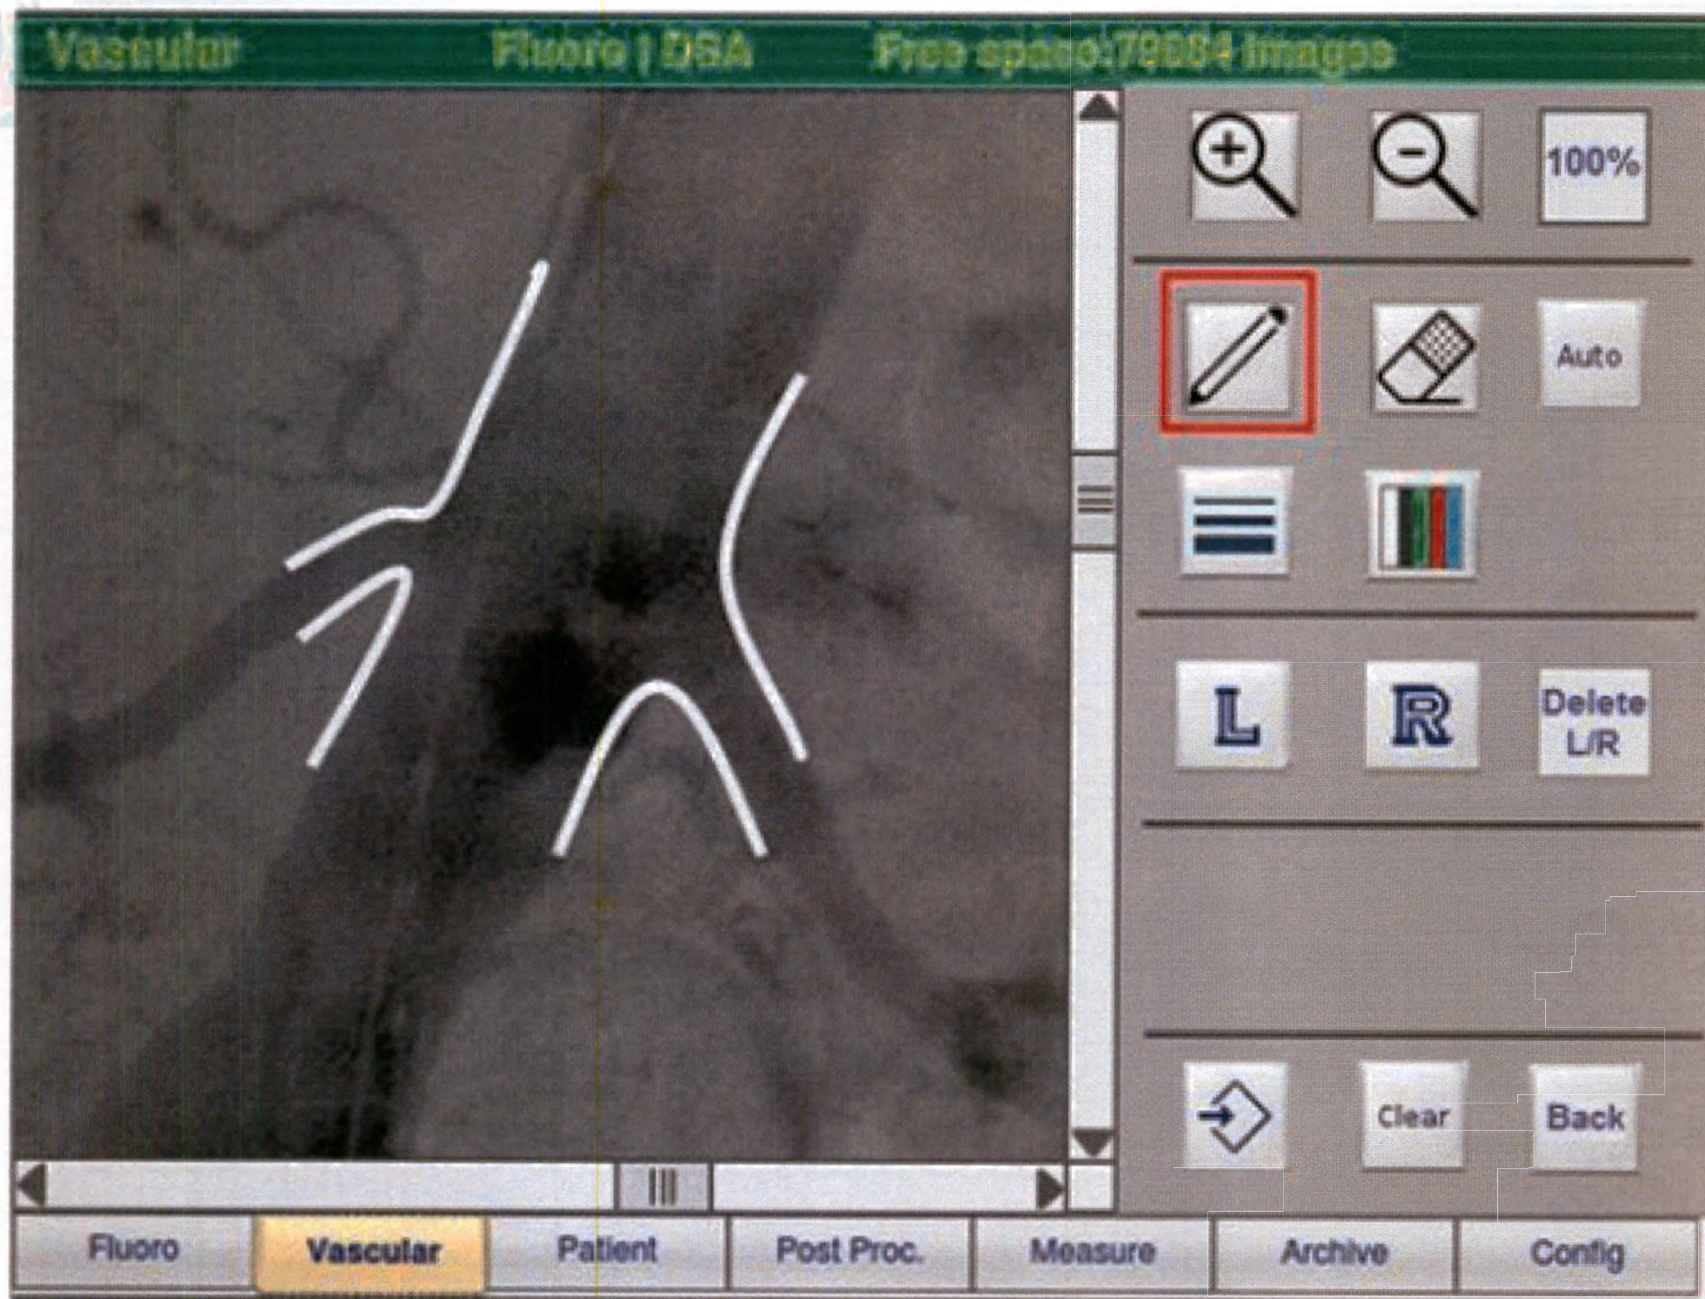

13. Модуль программный в варианте исполнения:


000 ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

13.1. модуль программный: Инструмент очерчивания.

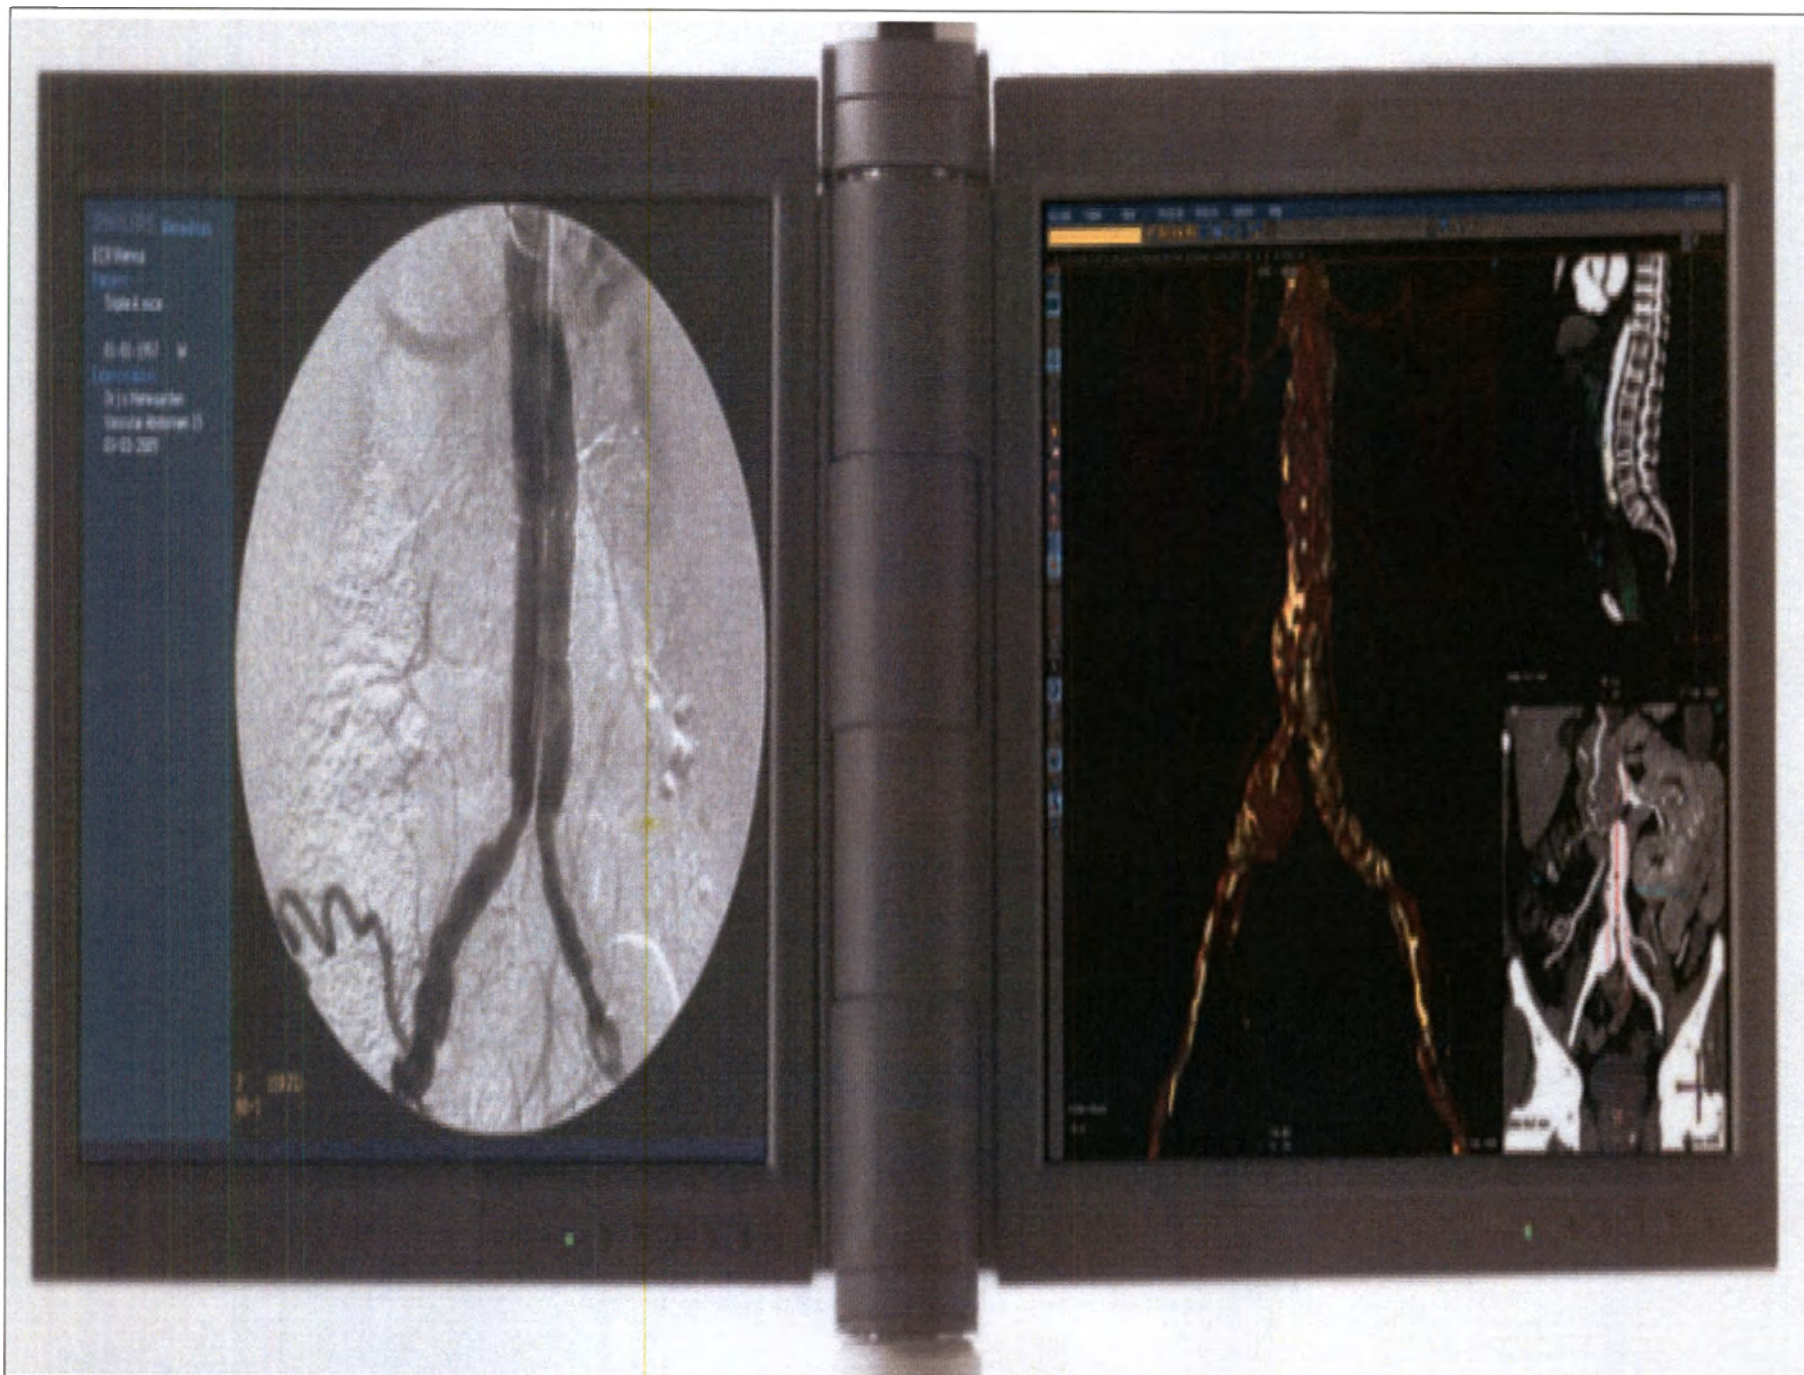


13. Модуль программный в варианте исполнения:

13.2. модуль программный: Функция просмотр видеосигнала от внешних источников.




13. Модуль программный в варианте исполнения:

13.3. модуль программный: Функция расширенной визуализации сосудов.

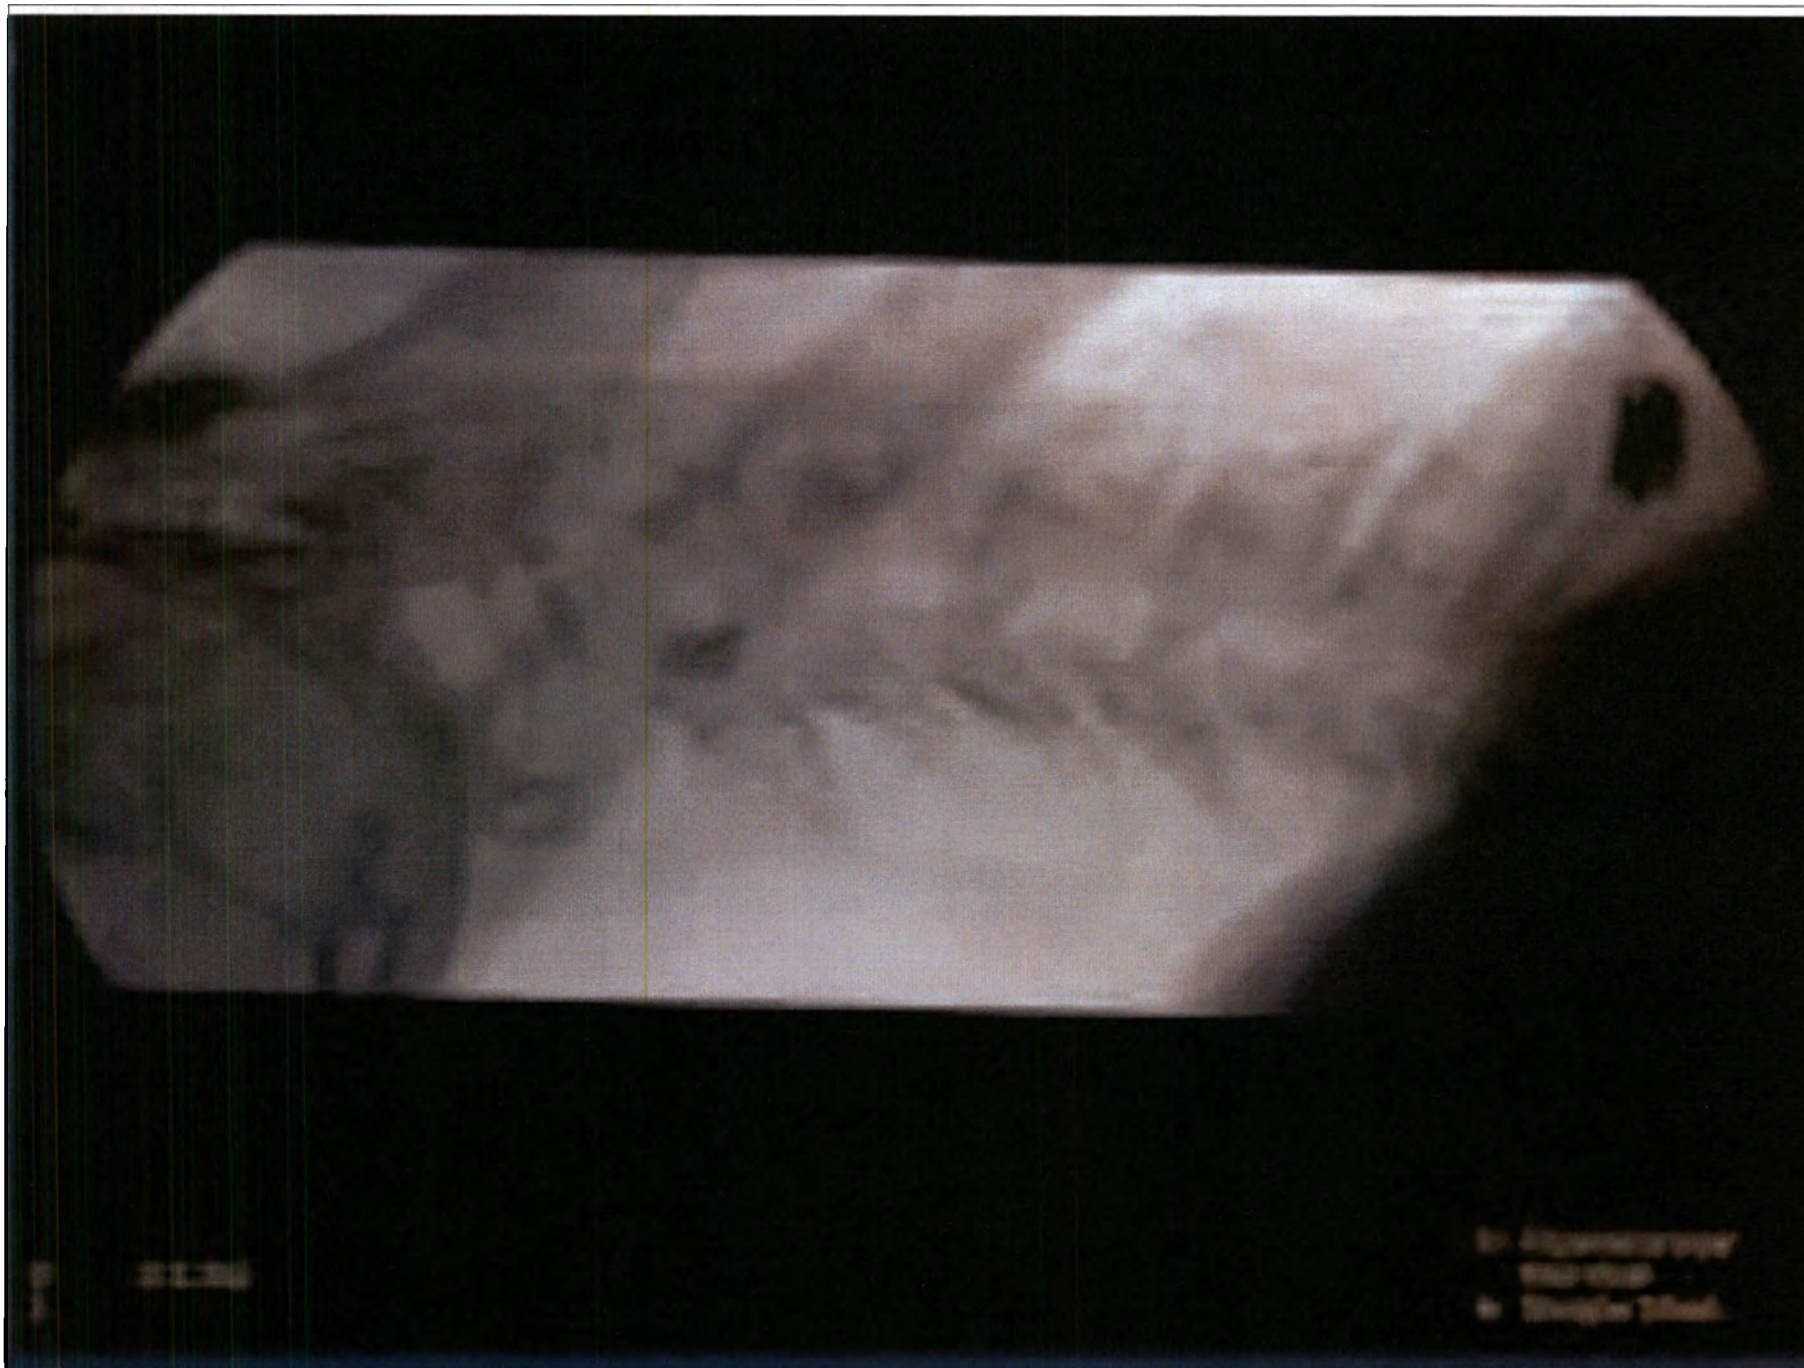

13. Модуль программный в варианте исполнения:


13.4. Модуль программный: Расширенное исследование болевого синдрома.

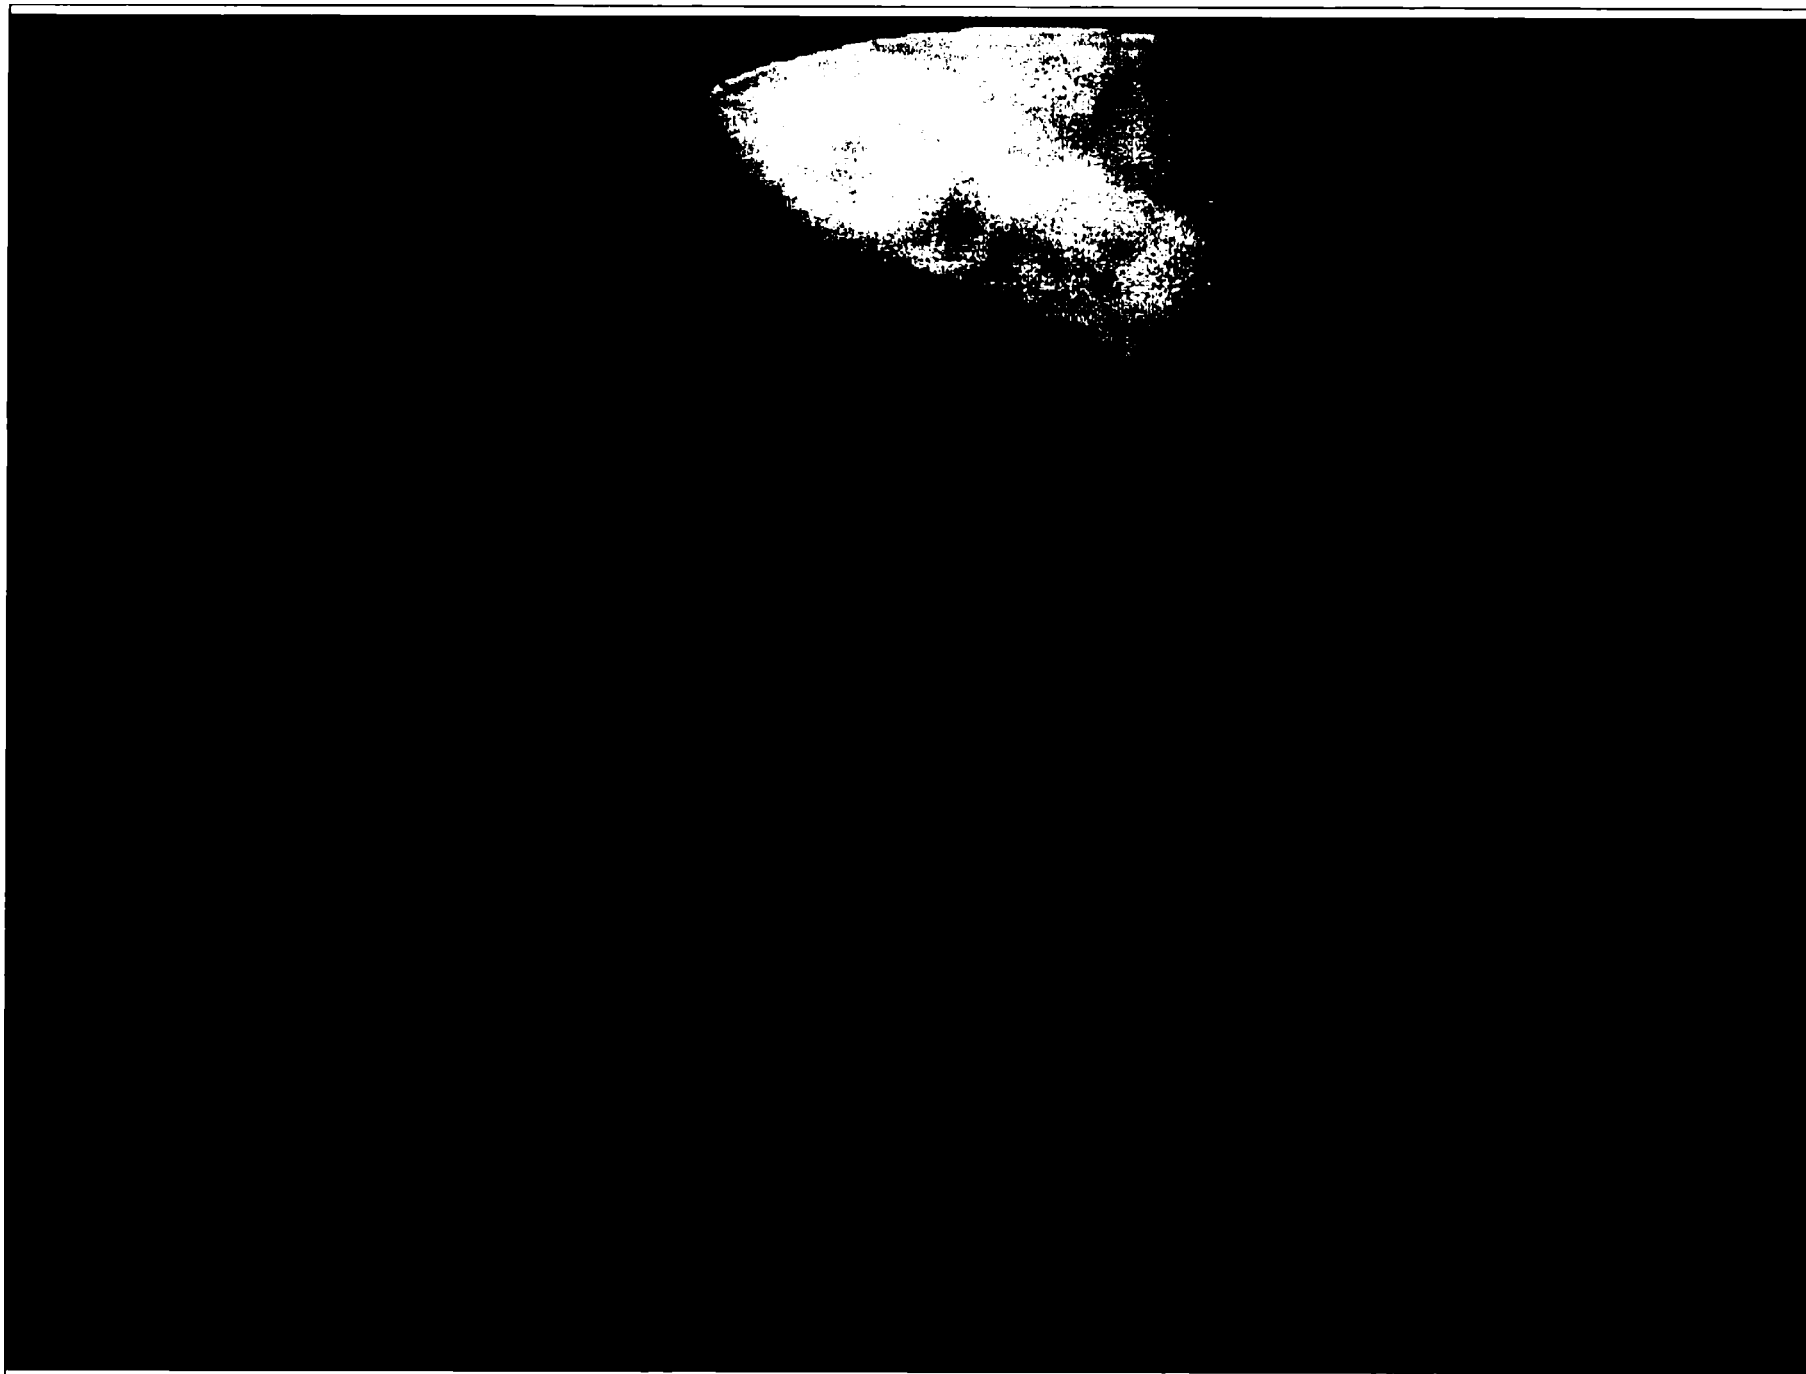

13. Модуль программный в варианте исполнения:


000 ЦИРМИ  info@cirmi.ru  www.goszdravnadzor.ru

13.5. модуль программный: Расширенная визуализация сердца.

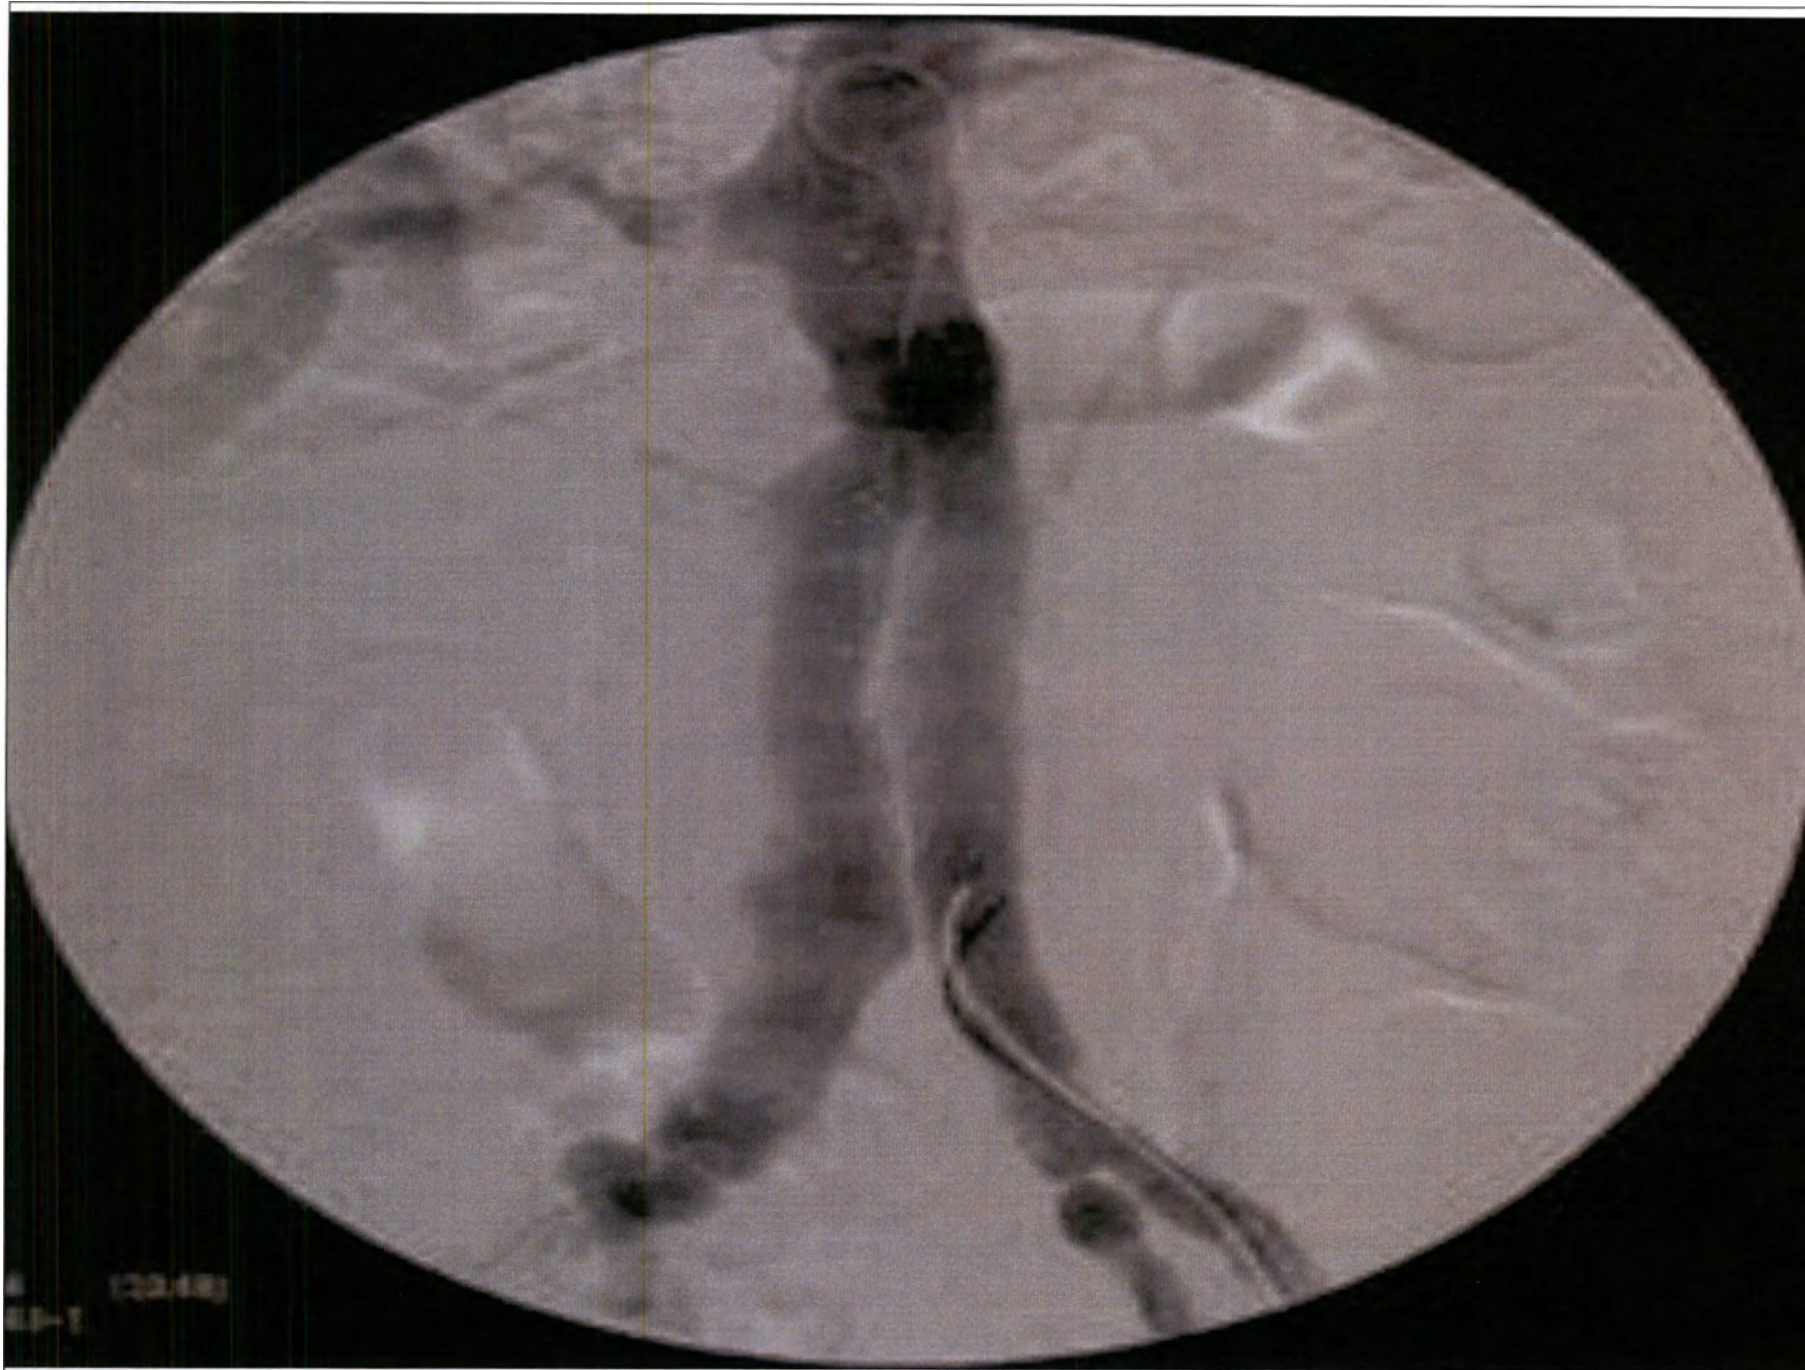

13. Молуль программный в варианте исполнения:

13.0. модуль программный: Расширенная визуализация сердца и сосудов.



13. Модуль программный в варианте исполнения:

13.1. модуль программный: Визуализации стентов в сосудах StentBoost Mobile.





14. Лицензии DICOM.



15. Блок для сохранения и передачи данных.

Упаковка:

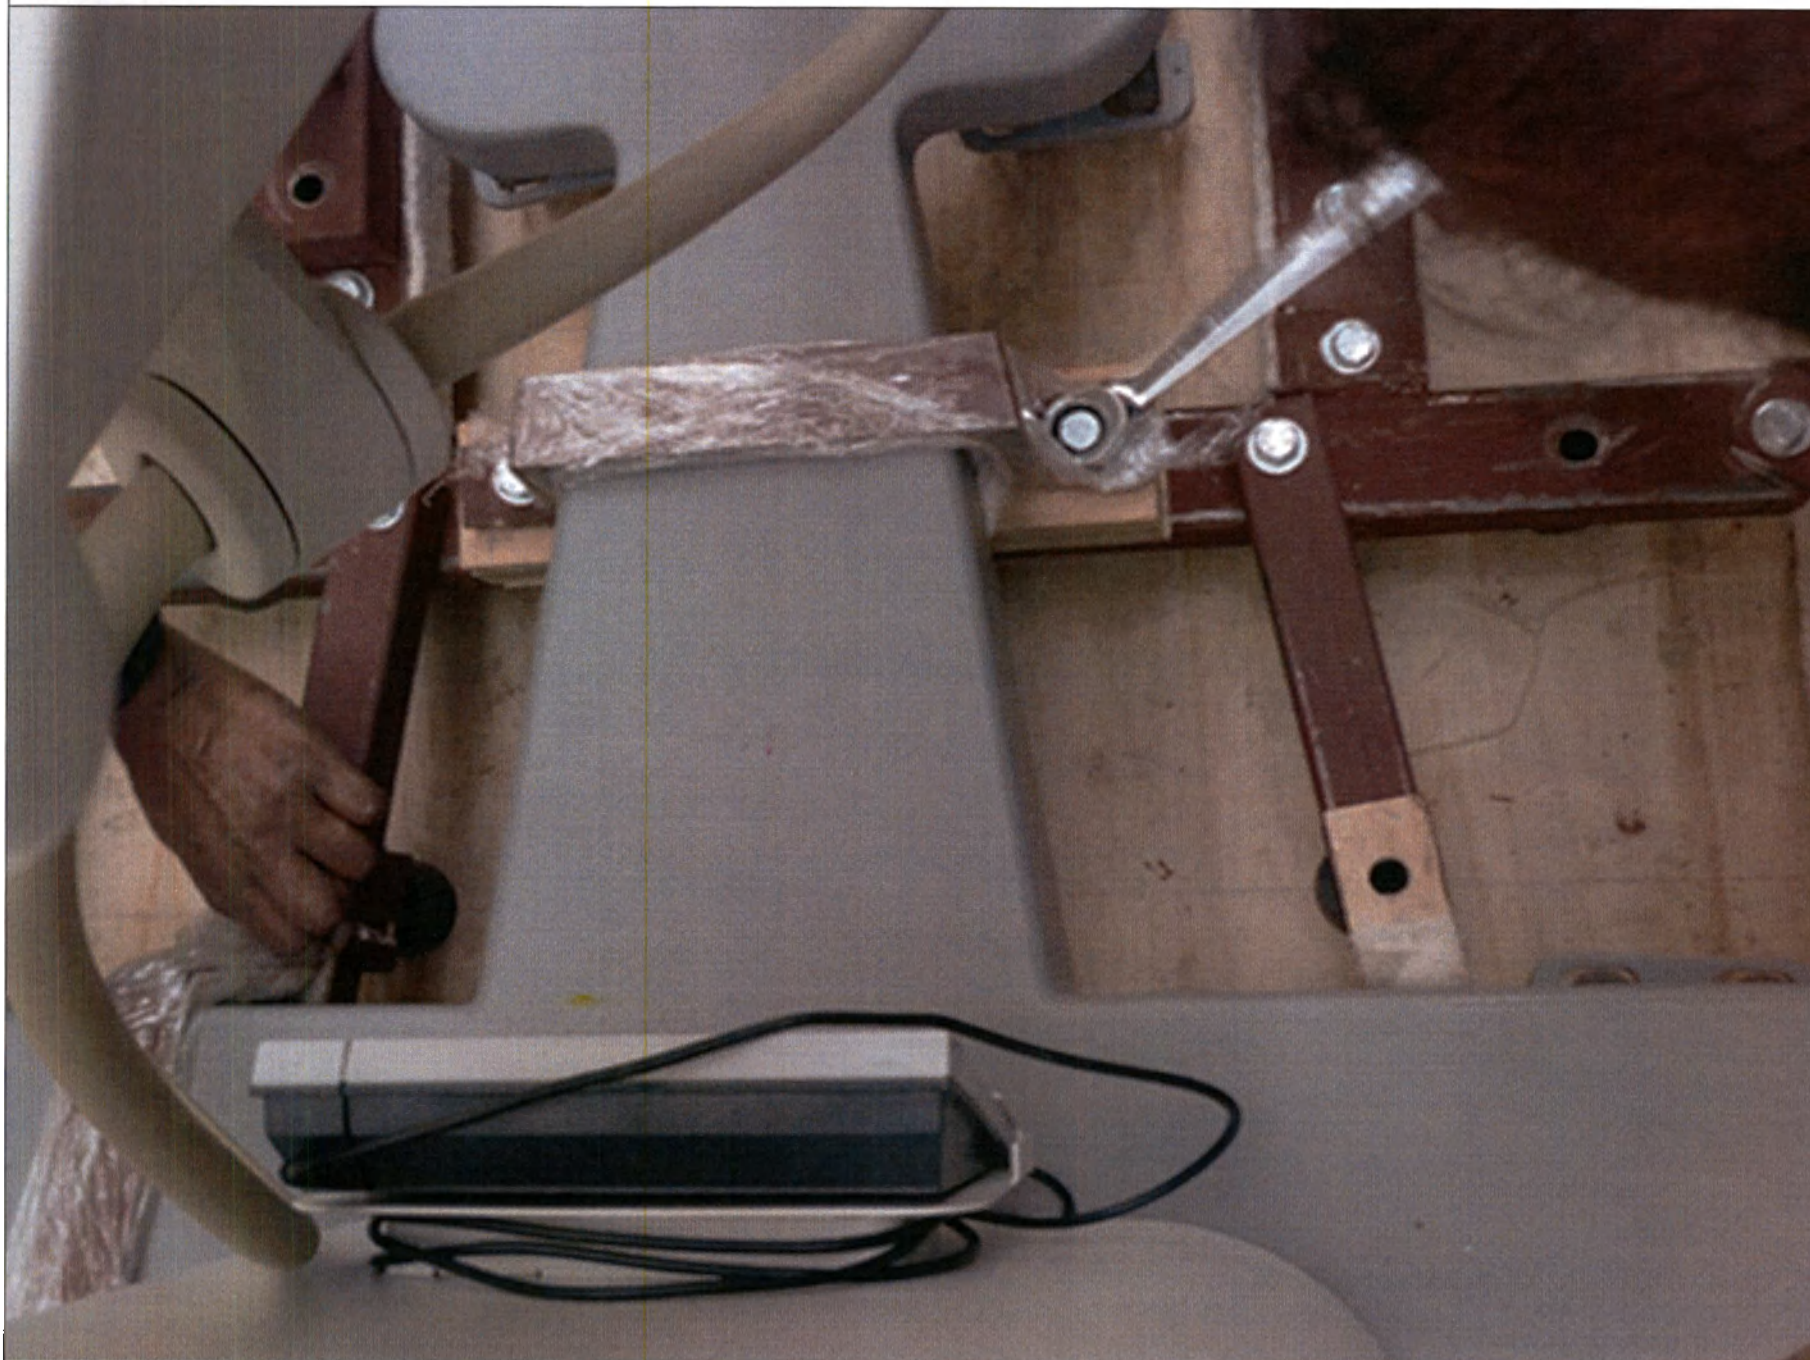

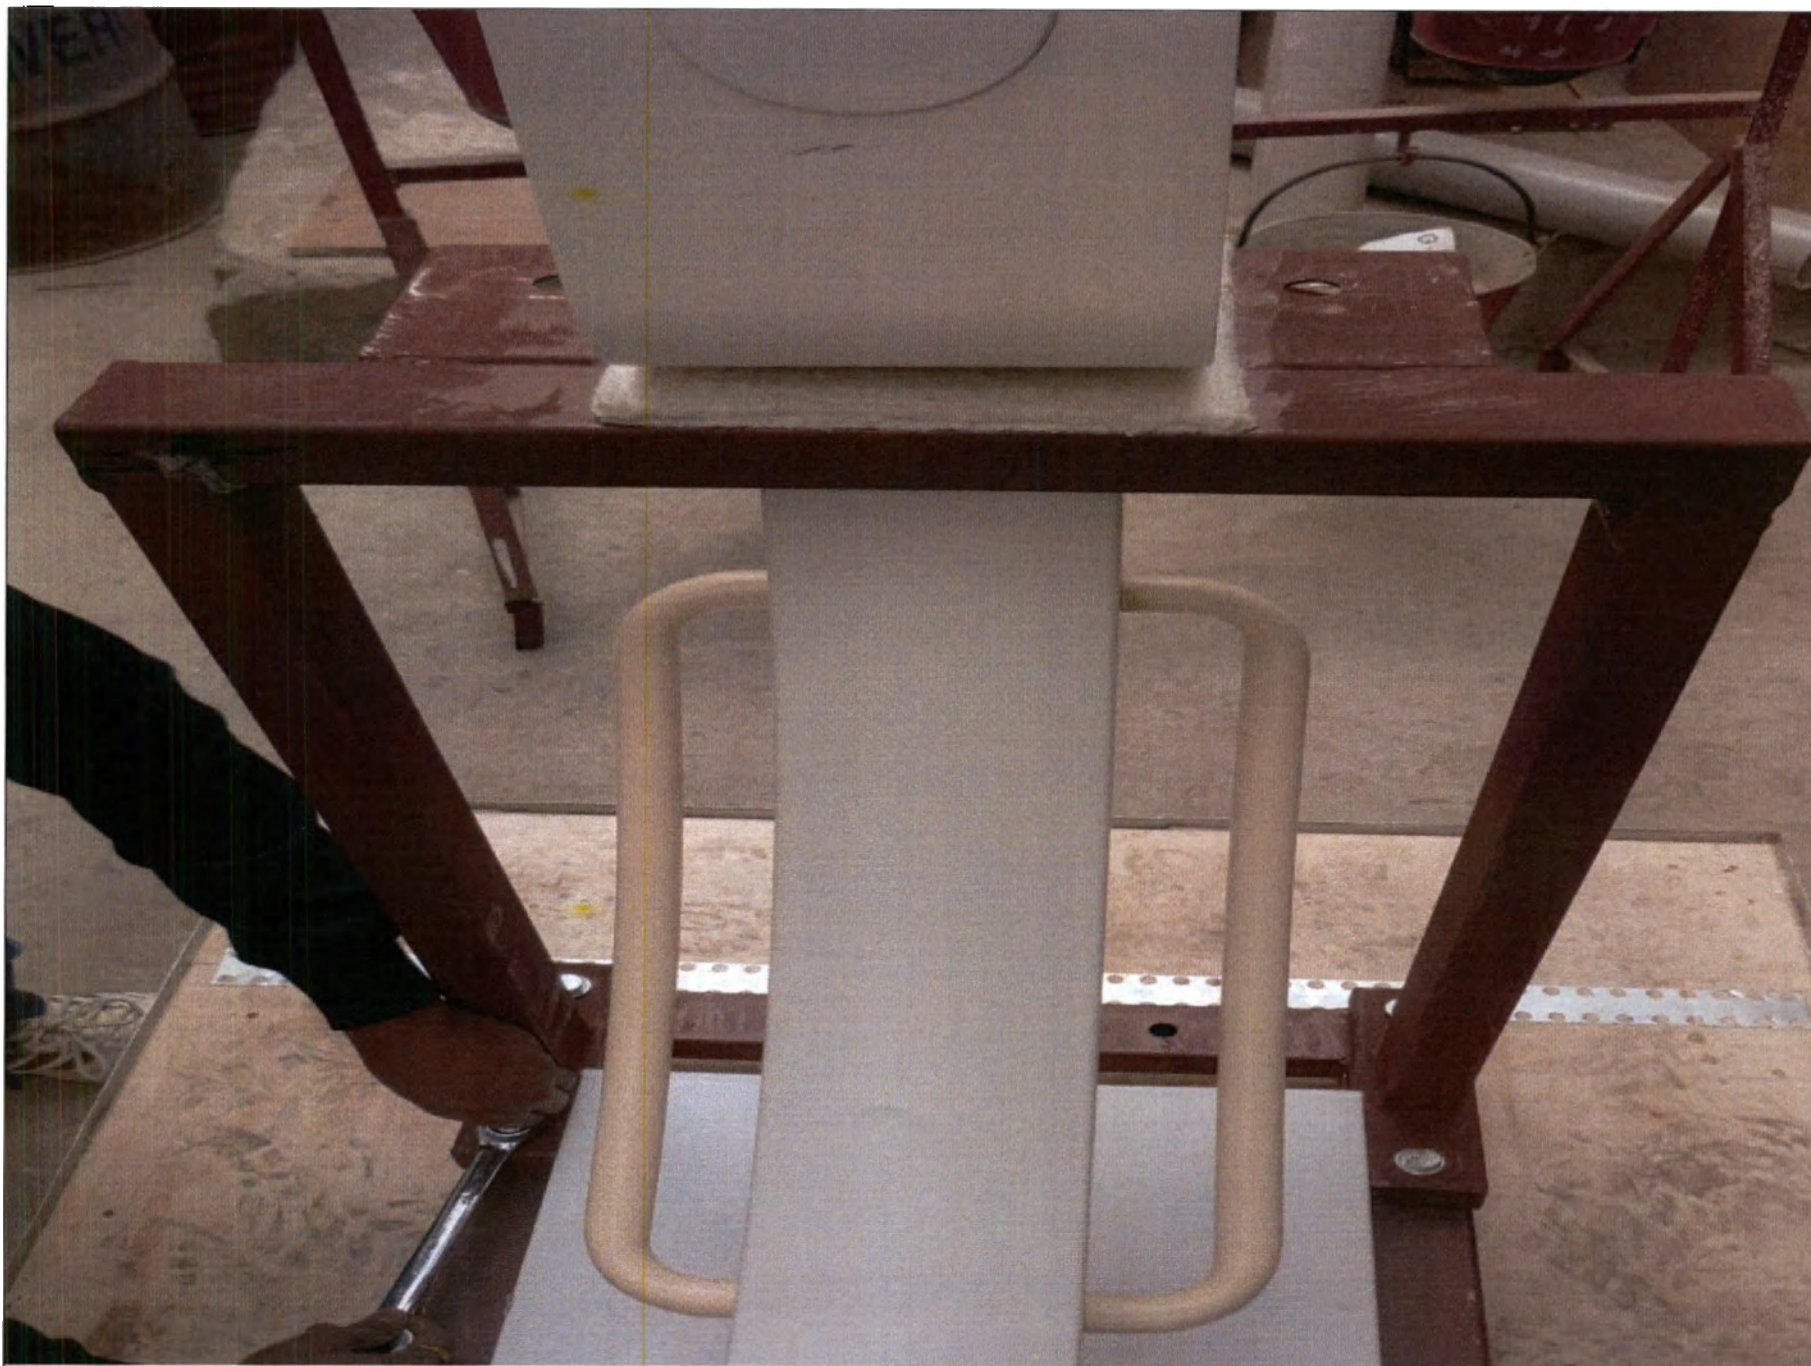


1. б) Закрепление стойки С-дуги на поддоне



2. б) Накрытие алюминиевой фольгой стойки С-дуги и оборачивание пластиковой пленкой после процедуры вакуумизации.



3. Деревянный ящик со стойкой С-дуги.

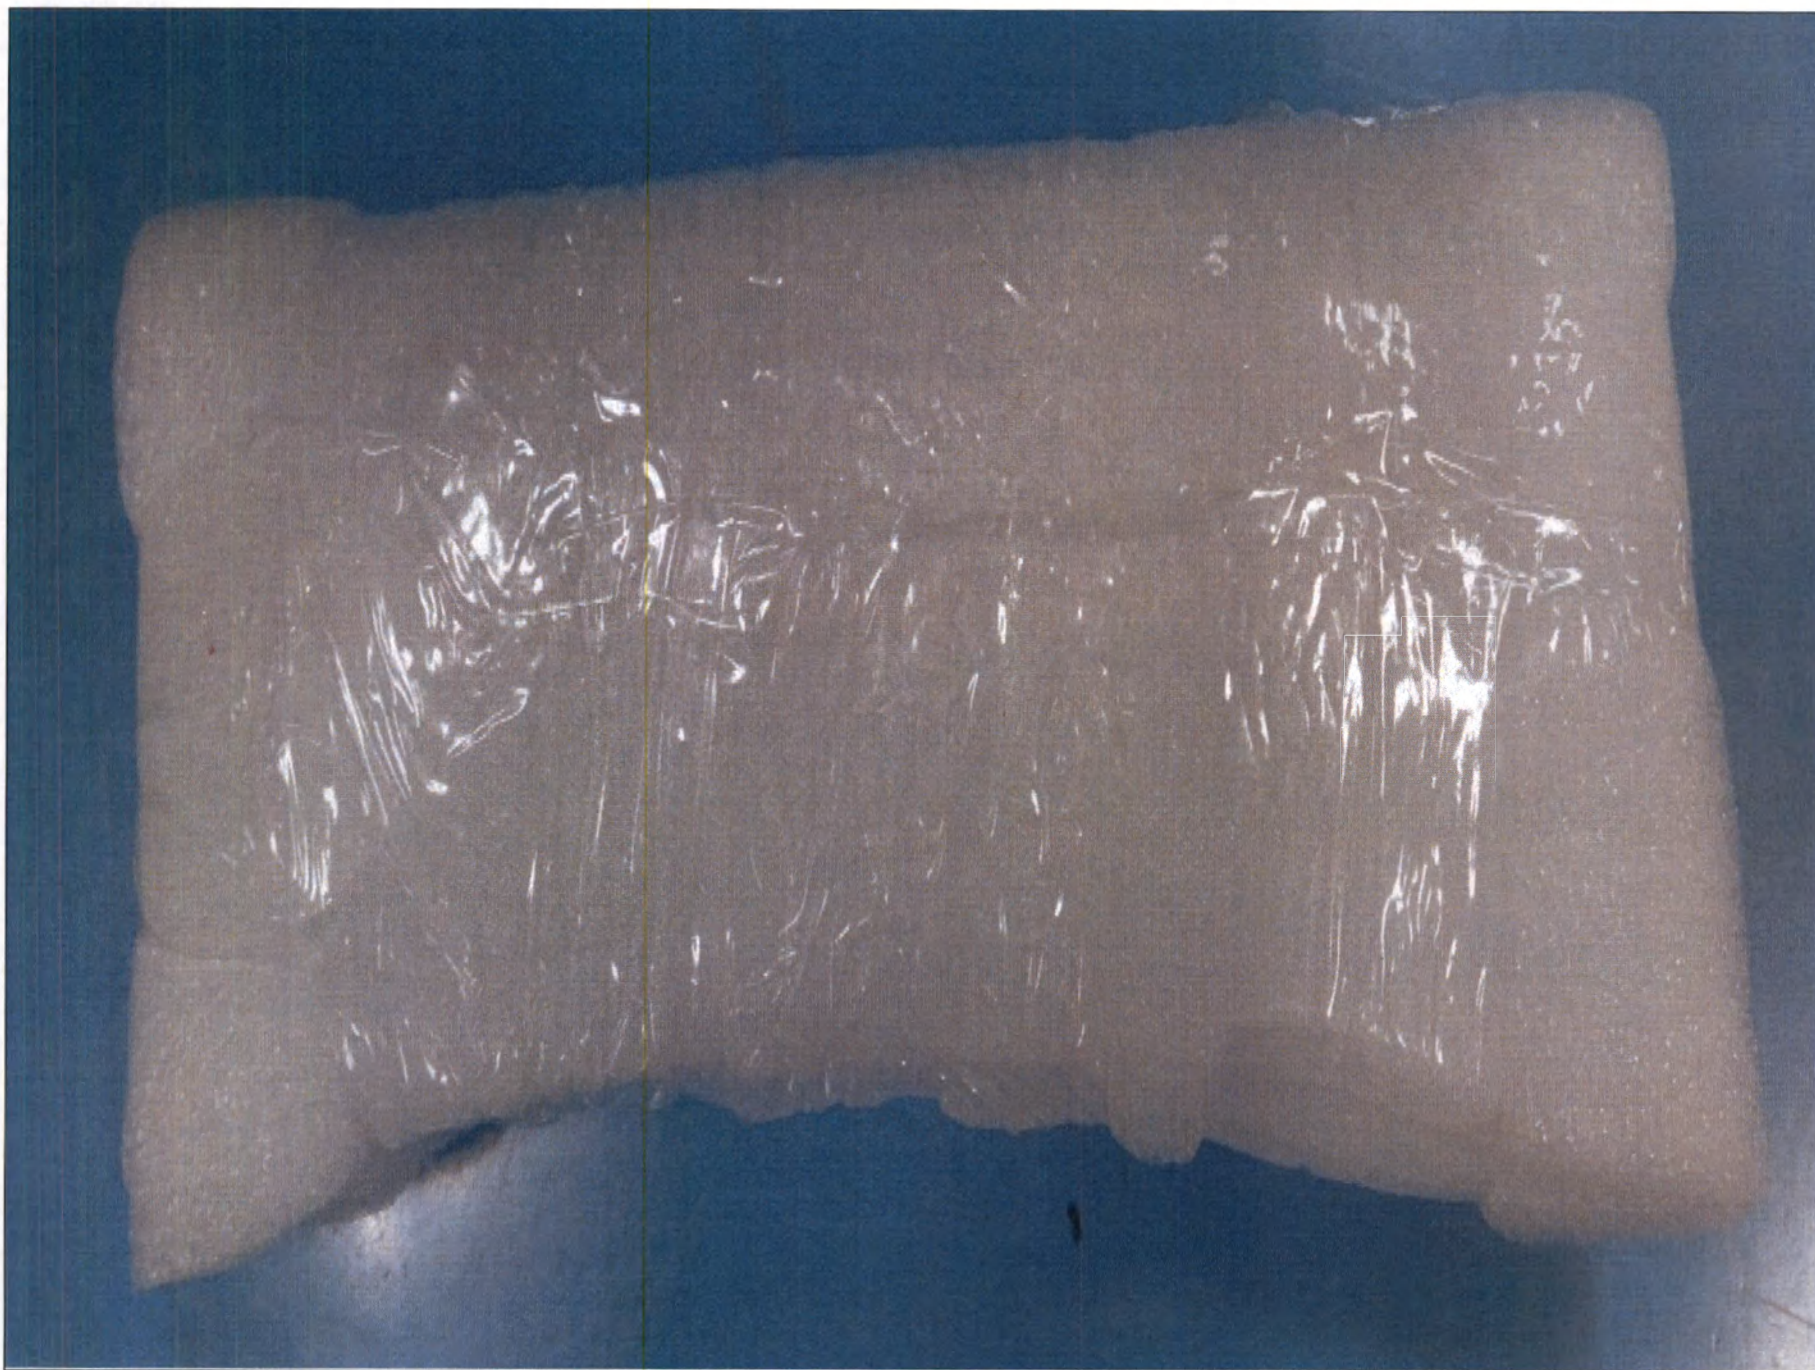

4. Упаковка пульта дистанционного контроля.



5. Коробка с принадлежностями.



6. Размещение коробки с принадлежностями в ящике со стойкой С-дуги.



7. Деревянный ящик с передвижной станцией просмотра

Макет вариантов маркировки на русском языке системы Zenition 50

Медицинское изделие:

Zenition 50

Описание:

Система флюороскопическая рентгеновская
передвижная цифровая Zenition 50 с
принадлежностями



Производитель:

«Филипс Медикал Системс Нидерланд Б.В.»

Нидерланды

Veenpluis 6, 5684 PC Best, The Netherlands

Место производства:

Филипс Индия Лимитед, Индия

Plot no. B-79, MIDC, Phase-II, Chakan Taluka - khed,

Village – Savardari

District: Pune Maharashtra, 410501, India

REF: 718096

Серийный номер: см. маркировку на английском

языке

Дата производства: см. маркировку на английском

языке

Основные технические характеристики:

Меры предосторожности:

Регистрационное удостоверение: P3H 2020/9650

Медицинское изделие:

Zenition 50

Описание:

Система флюороскопическая рентгеновская
передвижная цифровая Zenition 50 с
принадлежностями



Производитель:

«Филипс Медикал Системс Нидерланд Б.В.»

Нидерланды

Veenpluis 6, 5684 PC Best, The Netherlands

Место производства:

Филипс Медикал Системс Нидерланд Б.В.

Нидерланды

Veenpluis 6, 5684 PC Best, The Netherlands

REF: 718096

Серийный номер: см. маркировку на английском

языке

Дата производства: см. маркировку на английском

языке

Основные технические характеристики:

Меры предосторожности:

Регистрационное удостоверение: P3H 2020/9650

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью 61 листа (ов)

ООО «Филипс»

