

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «Лидкор»



Е. Ю. Гохгут

5 апреля 2023 г.

Макеты этикеток на медицинское изделие

Контейнеры полимерные для крови и ее компонентов стерильные,
однократного применения
по ТУ 9444-007-70440344-2016 в вариантах исполнения

Контейнеры полимерные для крови и ее компонентов стерильные, однократного применения по ТУ 9444-007-70440344-2016 в вариантах исполнения
Макет этикетки пакета упаковочного (тары потребительской):
- КПК1(300) однокамерный 300мл с иглой полимерной одноканальной



LEADCORE

ООО «Лидкор»
Россия, 620102, Свердловская область,
г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская стр. 23, офис 204

mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



КОНТЕЙНЕРЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ

стерильные однократного применения
КПК1(300)

ТУ 9444-007-70440344-2016

Стерильно, Апирогенно, Нетоксично.
Стерилизовано оксидом этилена.
Однократного применения.
Не применять при наличии признаков повреждения.
Перед использованием ознакомится с инструкцией по применению.



Партия №:000

Годен до: 00.0000



РУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022

Место
производства:

ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

000-000000

Контейнеры полимерные для крови и ее компонентов стерильные, однократного применения по ТУ 9444-007-70440344-2016 в вариантах исполнения

Макет этикетки контейнера:

- КПК1(300) однокамерный 300мл с иглой полимерной одноканальной



LEADCORE

Вид: КПК1(300)

Контейнер для компонентов крови полимерный 300 мл

ООО «Лидкор»

Россия, 620102, Свердловская область,

г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,

ул. Посадская стр. 23, офис 204

mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



AB0

Rh-фактор

Стерильно, Апирогенно, Нетоксично.

Переливать согласно приказам
гемотрансфузии.

Не предназначено для переливания крови,
пока не наклеена марка группы крови.

Не применять при наличии признаков
повреждения.

Перед использованием ознакомится с
инструкцией по применению.

Хранить при температуре от +5° до +40°C



6 969696 969692

Партия №:000

ПУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022


Годен до: 00.0000

Место
производства:

ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

000-000000

Контейнеры полимерные для крови и ее компонентов стерильные, однократного применения по ТУ 9444-007-70440344-2016 в вариантах исполнения
Макет этикетки транспортной тары:
- КПК1(300) однокамерный 300мл с иглой полимерной одноканальной



ООО «Лидкор»

Россия, 620102, Свердловская область,
г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская стр. 23, офис 204

LEADCORE mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



КОНТЕЙНЕРЫ ПОЛИМЕРНЫЙ ДЛЯ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ стерильные однократного применения КПК1(300)

ТУ 9444-007-70440344-2016

Стерильно, апирогенно, нетоксично.
Хранить при температуре от +5° до +40°C

Партия №: 000

Годен до: 00.0000

Количество, шт: 160

Брутто, кг:



75 кг
max



ПУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022

Место
производства:

ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru



000-000000

Контейнеры полимерные для крови и ее компонентов стерильные, однократного применения по ТУ 9444-007-70440344-2016 в вариантах исполнения
Макет этикетки пакета упаковочного (тары потребительской):
- КПК1(500) однокамерный 500мл с иглой полимерной одноканальной



LEADCORE

ООО «Лидкор»
Россия, 620102, Свердловская область,
г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская стр. 23, офис 204

mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



**КОНТЕЙНЕРЫ ПОЛИМЕРНЫЕ
ДЛЯ КРОВИ
И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ**
стерильные однократного применения
КПК1(500)
ТУ 9444-007-70440344-2016

Стерильно, Апирогенно, Нетоксично.
Стерилизовано оксидом этилена.
Однократного применения.
Не применять при наличии признаков повреждения.
Перед использованием ознакомится с инструкцией по
применению.



Партия №:000

Годен до: 00.0000



РУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022

Место
производства:

ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

000-000000

Контейнеры полимерные для крови и ее компонентов стерильные, однократного применения по ТУ 9444-007-70440344-2016 в вариантах исполнения

Макет этикетки контейнера:

- КПК1(500) однокамерный 500мл с иглой полимерной одноканальной



LEADCORE

Вид: КПК1(500)

Контейнер для компонентов крови полимерный 500 мл

ООО «Лидкор»

Россия, 620102, Свердловская область,
г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,

ул. Посадская стр. 23, офис 204

mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



AB0

Rh-фактор

Стерильно, Апиrogenно, Нетокично.
Переливать согласно приказам
гемотрансфузии.
Не предназначено для переливания крови,
пока не наклеена марка группы крови.
Не применять при наличии признаков
повреждения.
Перед использованием ознакомится с
инструкцией по применению.
Хранить при температуре от +5° до +40°C



Партия №:000


РУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022 Годен до: 00.0000

Место
производства:

ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

000-000000

Контейнеры полимерные для крови и ее компонентов стерильные, однократного применения по ТУ 9444-007-70440344-2016 в вариантах исполнения
Макет этикетки транспортной тары:
- КПК1(500) однокамерный 500мл с иглой полимерной одноканальной



ООО «Лидкор»

Россия, 620102, Свердловская область,
г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская стр. 23, офис 204

LEADCORE mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



КОНТЕЙНЕРЫ ПОЛИМЕРНЫЙ ДЛЯ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ **стерильные однократного применения** **КПК1(500)**

ТУ 9444-007-70440344-2016

Стерильно, апиrogenно, нетоксично.
Хранить при температуре от +5° до +40°С

Партия №: 000

Годен до: 00.0000

Количество, шт: 100

Брутто, кг:



75 кг
max



000-000000

ПУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022

Место
производства:

ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

Контейнеры полимерные для крови и ее компонентов стерильные, однократного применения по ТУ 9444-007-70440344-2016 в вариантах исполнения
Макет этикетки пакета упаковочного (тары потребительской):
- КПК1(1000) однокамерный 1000 мл с иглой полимерной одноканальной



LEADCORE

ООО «Лидкор»

Россия, 620102, Свердловская область,
г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская стр. 23, офис 204

mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



КОНТЕЙНЕРЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ

стерильные однократного применения
КПК1(1000)

ТУ 9444-007-70440344-2016

Стерильно, Апирогенно, Нетоксично.

Стерилизовано оксидом этилена.

Однократного применения.

Не применять при наличии признаков повреждения.

Перед использованием ознакомится с инструкцией по применению.



Партия №:000

Годен до: 00.0000



6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 2 1

РУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022

Место
производства:

ООО «Виробан»

141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

000-000000

Контейнеры полимерные для крови и ее компонентов стерильные, однократного применения по ТУ 9444-007-70440344-2016 в вариантах исполнения

Макет этикетки контейнера:

- КПК1(1000) однокамерный 1000мл с иглой полимерной одноканальной



LEADCORE

Вид: КПК1(1000)

Контейнер для компонентов крови полимерный 1000 мл

ООО «Лидкор»

Россия, 620102, Свердловская область,

г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,

ул. Посадская стр. 23, офис 204

mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



AB0

Rh-фактор

Стерильно, Апиrogenно, Нетоксично.
Переливать согласно приказам
гемотрансфузии.

Не предназначено для переливания крови,
пока не наклеена марка группы крови.

Не применять при наличии признаков
повреждения.

Перед использованием ознакомится с
инструкцией по применению.

Хранить при температуре от +5° до +40°C

Партия №:000

РУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022 Годен до: 00.0000

Место
производства:

ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

000-000000



Контейнеры полимерные для крови и ее компонентов стерильные, однократного применения по ТУ 9444-007-70440344-2016 в вариантах исполнения
Макет этикетки транспортной тары:
- КПК1(1000) однокамерный 1000мл с иглой полимерной одноканальной



LEADCORE

ООО «Лидкор»

Россия, 620102, Свердловская область,
г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская стр. 23, офис 204

mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



КОНТЕЙНЕРЫ ПОЛИМЕРНЫЙ ДЛЯ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ
стерильные однократного применения
КПК1(1000)

ТУ 9444-007-70440344-2016

Стерильно, апирогенно, нетоксично.
Хранить при температуре от +5° до +40°С

Партия №: 000

Годен до: 00.0000

Количество, шт: 100

Брутто, кг:



75 кг
max



000-000000

ПУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022

Место
производства:

ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

Контейнеры полимерные для крови и ее компонентов стерильные, однократного применения по ТУ 9444-007-70440344-2016 в вариантах исполнения
Макет этикетки пакета упаковочного (тары потребительской):

- КПК1(300)PL однокамерный 300 мл с иглой полимерной одноканальной для хранения тромбоцитов



ООО «Лидкор»
Россия, 620102, Свердловская область,
г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская стр. 23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



КОНТЕЙНЕРЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ

стерильные однократного применения
КПК1(300)PL
ТУ 9444-007-70440344-2016

Стерильно, Апирогенно, Нетоксично.
Стерилизовано оксидом этилена.
Однократного применения.
Не применять при наличии признаков повреждения.
Перед использованием ознакомится с инструкцией по применению.



Партия №:000

Годен до: 00.0000



РУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022

Место
производства:


ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

000-000000

Контейнеры полимерные для крови и ее компонентов стерильные, однократного применения по ТУ 9444-007-70440344-2016 в вариантах исполнения

Макет этикетки контейнера:

- КПК1(300)PL однокамерный 300мл с иглой полимерной одноканальной для хранения тромбоцитов



LEADCORE

Вид: КПК1(300)PL

Контейнер для компонентов крови полимерный 300 мл

ООО «Лидкор»

Россия, 620102, Свердловская область,

г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,

ул. Посадская стр. 23, офис 204

mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



AB0

Rh-фактор

Стерильно, Апирогенно, Нетоксично.
Переливать согласно приказам
гемотрансфузии.
Не предназначено для переливания крови,
пока не наклеена марка группы крови.
Не применять при наличии признаков
повреждения.
Перед использованием ознакомьтесь с
инструкцией по применению.
Хранить при температуре от +5° до +40°С



Партия №:000

РУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022 Годен до: 00.0000

Место
производства:

ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

000-000000

Контейнеры полимерные для крови и ее компонентов стерильные, однократного применения по ТУ 9444-007-70440344-2016 в вариантах исполнения
Макет этикетки транспортной тары:
- КПК1(300)PL однокамерный 300мл с иглой полимерной одноканальной для хранения тромбоцитов




LEADCORE

ООО «Лидкор»

Россия, 620102, Свердловская область,
г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская стр. 23, офис 204

mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



КОНТЕЙНЕРЫ ПОЛИМЕРНЫЙ ДЛЯ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ
стерильные однократного применения
КПК1(300)PL

ТУ 9444-007-70440344-2016

Стерильно, апиrogenно, нетоксично.
Хранить при температуре от +5° до +40°C

Партия №: 000

Годен до: 00.0000

Количество, шт: 100

Брутто, кг:



75 кг
max



000-000000

ПУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022

Место
производства:

ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

Контейнеры полимерные для крови и ее компонентов стерильные, однократного применения по ТУ 9444-007-70440344-2016 в вариантах исполнения
Макет этикетки пакета упаковочного (тары потребительской):

- КПК1(500)PL однокамерный 500 мл с иглой полимерной одноканальной для хранения тромбоцитов



LEADCORE

ООО «Лидкор»

Россия, 620102, Свердловская область,
г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская стр. 23, офис 204

mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



КОНТЕЙНЕРЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ

стерильные однократного применения
КПК1(500)PL

ТУ 9444-007-70440344-2016

Стерильно, Апирогенно, Нетоксично.

Стерилизовано оксидом этилена.

Однократного применения.

Не применять при наличии признаков повреждения.

Перед использованием ознакомится с инструкцией по применению.



Партия №:000

Годен до: 00.0000



6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 2

РУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022


Место
производства

ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

000-000000

Контейнеры полимерные для крови и ее компонентов стерильные, однократного применения по ТУ 9444-007-70440344-2016 в вариантах исполнения
Макет этикетки контейнера:

- КПК1(500)PL однокамерный 500мл с иглой полимерной одноканальной для хранения тромбоцитов



LEADCORE

Вид: КПК1(500)PL

Контейнер для компонентов крови полимерный 500 мл

ООО «Лидкор»

Россия, 620102, Свердловская область,

г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,

ул. Посадская стр. 23, офис 204

mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



AB0

Rh-фактор

Стерильно, Апиrogenно, Нетоксично.
Переливать согласно приказам
гемотрансфузии.
Не предназначено для переливания крови,
пока не наклеена марка группы крови.
Не применять при наличии признаков
повреждения.

Перед использованием ознакомьтесь с
инструкцией по применению.

Хранить при температуре от +5° до +40°C

ПУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022

Место
производства:

ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

Партия №:000

Годен до: 00.0000



000-000000

Контейнеры полимерные для крови и ее компонентов стерильные, однократного применения по ТУ 9444-007-70440344-2016 в вариантах исполнения
Макет этикетки транспортной тары:
- КПК1(500)PL однокамерный 500мл с иглой полимерной одноканальной для хранения тромбоцитов



LEADCORE

ООО «Лидкор»

Россия, 620102, Свердловская область,
г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская стр. 23, офис 204

mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



КОНТЕЙНЕРЫ ПОЛИМЕРНЫЙ ДЛЯ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ
стерильные однократного применения
КПК1(500)PL

ТУ 9444-007-70440344-2016

Стерильно, апирогенно, нетоксично.
Хранить при температуре от +5° до +40°С

Партия №: 000

Годен до: 00.0000

Количество, шт: 100

Брутто, кг:



**75 кг
max**



6 969696 969692

000-000000

ПУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022

Место
производства:

ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru
tel.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

Контейнеры полимерные для крови и ее компонентов стерильные, однократного применения по ТУ 9444-007-70440344-2016 в вариантах исполнения
Макет этикетки пакета упаковочного (тары потребительской):

- КПК1(1000)PL однокамерный 1000 мл с иглой полимерной одноканальной для хранения тромбоцитов



LEADCORE

ООО «Лидкор»
Россия, 620102, Свердловская область,
г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская стр. 23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



КОНТЕЙНЕРЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ

стерильные однократного применения

КПК1(1000)PL

ТУ 9444-007-70440344-2016

Стерильно, Апирогенно, Нетоксично.

Стерилизовано оксидом этилена.

Однократного применения.

Не применять при наличии признаков повреждения.

Перед использованием ознакомится с инструкцией по применению.



Партия №:000

Годен до: 00.0000



РУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022


Место
производства:

ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

000-000000

Контейнеры полимерные для крови и ее компонентов стерильные, однократного применения по ТУ 9444-007-70440344-2016 в вариантах исполнения
Макет этикетки контейнера:

- КПК1(1000)PL однокамерный 1000мл с иглой полимерной одноканальной для хранения тромбоцитов



LEADCORE

Вид: КПК1(1000)PL

Контейнер для компонентов крови полимерный 1000 мл

ООО «Лидкор»

Россия, 620102, Свердловская область,

г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,

ул. Посадская стр. 23, офис 204

mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



AB0

Rh-фактор

Стерильно, Апирогенно, Нетоксично.
Переливать согласно приказам
гемотрансфузии.
Не предназначено для переливания крови,
пока не наклеена марка группы крови.
Не применять при наличии признаков
повреждения.
Перед использованием ознакомится с
инструкцией по применению.
Хранить при температуре от +5° до +40°C



6 1969696969692

ПУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022

Партия №:000


Годен до: 00.0000

Место
производства:

ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

000-000000

Контейнеры полимерные для крови и ее компонентов стерильные, однократного применения по ТУ 9444-007-70440344-2016 в вариантах исполнения
Макет этикетки транспортной тары:
- КПК1(1000)PL однокамерный 1000мл с иглой полимерной одноканальной для хранения тромбоцитов




LEADCORE

ООО «Лидкор»

Россия, 620102, Свердловская область,
г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская стр. 23, офис 204

mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



КОНТЕЙНЕРЫ ПОЛИМЕРНЫЙ ДЛЯ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ
стерильные однократного применения
КПК1(1000)PL

ТУ 9444-007-70440344-2016

Стерильно, апирогенно, нетоксично.
Хранить при температуре от +5° до +40°С

Партия №: 000

Годен до: 00.0000

Количество, шт:

Брутто, кг:



75 kg
max



000-000000

ПУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022

Место
производства:

ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

Контейнеры полимерные для крови и ее компонентов стерильные, однократного применения по ТУ 9444-007-70440344-2016 в вариантах исполнения
Макет этикетки пакета упаковочного (тары потребительской):

- КПК1(500/4) однокамерный с четырьмя портами 500 мл с иглой полимерной одноканальной



LEADCORE

ООО «Лидкор»
Россия, 620102, Свердловская область,
г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская стр. 23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



КОНТЕЙНЕРЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ

стерильные однократного применения
КПК1(500/4)

ТУ 9444-007-70440344-2016

Стерильно, Апирогенно, Нетоксично.

Стерилизовано оксидом этилена.

Однократного применения.

Не применять при наличии признаков повреждения.

Перед использованием ознакомится с инструкцией по применению.



Партия №:000

Годен до: 00.0000



6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 2

РУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022

Место
производства:

ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

000-000000

Контейнеры полимерные для крови и ее компонентов стерильные, однократного применения по ТУ 9444-007-70440344-2016 в вариантах исполнения
Макет этикетки контейнера:

- КПК1(500/4) однокамерный с четырьмя портами 500 мл с иглой полимерной одноканальной



LEADCORE

Вид: КПК1(500/4)

Контейнер для компонентов крови полимерный 500 мл

ООО «Лидкор»

Россия, 620102, Свердловская область,

г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,

ул. Посадская стр. 23, офис 204

mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



AB0

Rh-фактор

Стерильно, Апирогенно, Нетоксично.
Переливать согласно приказам
гемотрансфузии.
Не предназначено для переливания крови,
пока не наклеена марка группы крови.
Не применять при наличии признаков
повреждения.
Перед использованием ознакомится с
инструкцией по применению.
Хранить при температуре от +5° до +40°C



ПУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022

Партия №:000


Годен до: 00.0000

Место
производства:

ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

000-000000

Контейнеры полимерные для крови и ее компонентов стерильные, однократного применения по ТУ 9444-007-70440344-2016 в вариантах исполнения
Макет этикетки транспортной тары:
- КПК1(500/4) однокамерный с четырьмя портами 500 мл с иглой полимерной одноканальной



ООО «Лидкор»
Россия, 620102, Свердловская область,
г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская стр. 23, офис 204

LEADCORE mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

КОНТЕЙНЕРЫ ПОЛИМЕРНЫЙ ДЛЯ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ стерильные однократного применения КПК1(500/4)

ТУ 9444-007-70440344-2016

Стерильно, апиrogenно, нетоксично.
Хранить при температуре от +5° до +40°C

Партия №: 000

Годен до: 00.0000

Количество, шт:

Брутто, кг:



75 kg
max



000-000000

ПУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022

Место
производства:

ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

Контейнеры полимерные для крови и ее компонентов стерильные, однократного применения по ТУ 9444-007-70440344-2016 в вариантах исполнения
Макет этикетки пакета упаковочного (тары потребительской):

- КПК1(600/4) однокамерный с четырьмя портами 600 мл с иглой полимерной одноканальной



LEADCORE

ООО «Лидкор»

Россия, 620102, Свердловская область,
г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская стр. 23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



КОНТЕЙНЕРЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ

стерильные однократного применения
КПК1(600/4)

ТУ 9444-007-70440344-2016

Стерильно, Апирогенно, Нетоксично.

Стерилизовано оксидом этилена.

Однократного применения.

Не применять при наличии признаков повреждения.

Перед использованием ознакомится с инструкцией по применению.



Партия №:000

Годен до: 00.0000



6 969696 969692

РУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022

Место
производства

ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

000-000000

Контейнеры полимерные для крови и ее компонентов стерильные, однократного применения по ТУ 9444-007-70440344-2016 в вариантах исполнения

Макет этикетки контейнера:

- КПК1(600/4) однокамерный с четырьмя портами 600 мл с иглой полимерной одноканальной



Вид: КПК1(600/4)

Контейнер для компонентов крови полимерный 600 мл

ООО «Лидкор»

Россия, 620102, Свердловская область,

г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,

ул. Посадская стр. 23, офис 204

mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



AB0

Rh-фактор

Стерильно, Апиrogenно, Нетоксично.

Переливать согласно приказам
гемотрансфузии.

Не предназначено для переливания крови,
пока не наклеена марка группы крови.

Не применять при наличии признаков
повреждения.

Перед использованием ознакомится с
инструкцией по применению.

Хранить при температуре от +5° до +40°C

РУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022

Место
производства:

ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru


000-000000



Партия №: 000

Годен до: 00.0000

Контейнеры полимерные для крови и ее компонентов стерильные, однократного применения по ТУ 9444-007-70440344-2016 в вариантах исполнения
Макет этикетки транспортной тары:
- КПК1(600/4) однокамерный с четырьмя портами 600 мл с иглой полимерной
одноканальной



LEADCORE

ООО «Лидкор»

Россия, 620102, Свердловская область,
г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская стр. 23, офис 204

mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



КОНТЕЙНЕРЫ ПОЛИМЕРНЫЙ ДЛЯ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ
стерильные однократного применения
КПК1(600/4)

ТУ 9444-007-70440344-2016

Стерильно, апиrogenно, нетоксично.
Хранить при температуре от +5° до +40°C

Партия №: 000

Годен до: 00.0000

Количество, шт:

Брутто, кг:



75 кг
max



000-000000

ПУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022

Место
производства:

ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

Контейнеры полимерные для крови и ее компонентов стерильные, однократного применения по ТУ 9444-007-70440344-2016 в вариантах исполнения
Макет этикетки пакета упаковочного (тары потребительской):

- КПК1(1000/4) однокамерный с четырьмя портами 1000 мл с иглой полимерной одноканальной



LEADCORE

ООО «Лидкор»

Россия, 620102, Свердловская область,
г. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская стр. 23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



**КОНТЕЙНЕРЫ ПОЛИМЕРНЫЕ
ДЛЯ КРОВИ
И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ**

стерильные однократного применения
КПК1(1000/4)

ТУ 9444-007-70440344-2016

Стерильно, Апиrogenно, Нетоксично.

Стерилизовано оксидом этилена.

Однократного применения.

Не применять при наличии признаков повреждения.

Перед использованием ознакомится с инструкцией по применению.



Партия №:000

Годен до: 00.0000



РУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022


Место
производства:

ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

000-000000

Контейнеры полимерные для крови и ее компонентов стерильные, однократного применения по ТУ 9444-007-70440344-2016 в вариантах исполнения
Макет этикетки контейнера:

- КПК1(1000/4) однокамерный с четырьмя портами 1000 мл с иглой полимерной одноканальной



LEADCORE

Вид: КПК1(1000/4)

Контейнер для компонентов крови полимерный 1000 мл

ООО «Лидкор»

Россия, 620102, Свердловская область,

г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,

ул. Посадская стр. 23, офис 204

mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



AB0

Rh-фактор

Стерильно, Апиrogenно, Нетоксично.
Переливать согласно приказам
гемотрансфузии.

Не предназначено для переливания крови,
пока не наклеена марка группы крови.

Не применять при наличии признаков
повреждения.

Перед использованием ознакомьтесь с
инструкцией по применению.

Хранить при температуре от +5° до +40°С

ПУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022

Место
производства:

ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

000-000000




6196969619696921

Партия №:000

Годен до: 00.0000

Контейнеры полимерные для крови и ее компонентов стерильные, однократного применения по ТУ 9444-007-70440344-2016 в вариантах исполнения
Макет этикетки транспортной тары:
- КПК1(1000/4) однокамерный с четырьмя портами 1000 мл с иглой полимерной
одноканальной



ООО «Лидкор»

Россия, 620102, Свердловская область,
г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская стр. 23, офис 204

LEADCORE mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



КОНТЕЙНЕРЫ ПОЛИМЕРНЫЙ ДЛЯ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ
стерильные однократного применения
КПК1(1000/4)

ТУ 9444-007-70440344-2016

Стерильно, апиrogenно, нетоксично.
Хранить при температуре от +5° до +40°С

Партия №: 000

Годен до: 00.0000

Количество, шт:

Брутто, кг:



EO

STERILE EO



**75 кг
max**



000-000000


ПУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022

Место
производства:

ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru
tel.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

Контейнеры полимерные для крови и ее компонентов стерильные, однократного применения по ТУ 9444-007-70440344-2016 в вариантах исполнения
Макет этикетки пакета упаковочного (тары потребительской):

- КПК1(1500/4) однокамерный с четырьмя портами 1500 мл с иглой полимерной одноканальной



LEADCORE

ООО «Лидкор»
Россия, 620102, Свердловская область,
г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская стр. 23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



КОНТЕЙНЕРЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ

стерильные однократного применения
КПК1(1500/4)

ТУ 9444-007-70440344-2016

Стерильно, Апирогенно, Нетоксично.
Стерилизовано оксидом этилена.
Однократного применения.
Не применять при наличии признаков повреждения.
Перед использованием ознакомится с инструкцией по
применению.



Партия №:000

Годен до: 00.0000



РУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022


Место
производства:

ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

000-000000

Контейнеры полимерные для крови и ее компонентов стерильные, однократного применения по ТУ 9444-007-70440344-2016 в вариантах исполнения
Макет этикетки контейнера:

- КПК1(1500/4) однокамерный с четырьмя портами 1500 мл с иглой полимерной одноканальной



LEADCORE

Вид: КПК1(1500/4)

Контейнер для компонентов крови полимерный 1500 мл

ООО «Лидкор»

Россия, 620102, Свердловская область,

г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,

ул. Посадская стр. 23, офис 204

mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



AB0

Rh-фактор

Стерильно, Алирогенно, Нетокично.
Переливать согласно приказам
гемотрансфузии.
Не предназначено для переливания крови,
пока не наклеена марка группы крови.
Не применять при наличии признаков
повреждения.

Перед использованием ознакомится с
инструкцией по применению.

Хранить при температуре от +5° до +40°C

РУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022

Место
производства:

ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru


Партия №:000

Годен до: 00.0000

000-000000



Контейнеры полимерные для крови и ее компонентов стерильные, однократного применения по ТУ 9444-007-70440344-2016 в вариантах исполнения
Макет этикетки транспортной тары:
- КПК1(1500/4) однокамерный с четырьмя портами 1500 мл с иглой полимерной
одноканальной



LEADCORE

ООО «Лидкор»

Россия, 620102, Свердловская область,
г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская стр. 23, офис 204

mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



КОНТЕЙНЕРЫ ПОЛИМЕРНЫЙ ДЛЯ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ
стерильные однократного применения
КПК1(1500/4)

ТУ 9444-007-70440344-2016

Стерильно, апиrogenно, нетоксично.
Хранить при температуре от +5° до +40°C

Партия №: 000

Годен до: 00.0000

Количество, шт:

Брутто, кг:



75 кг
max



6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 2

000-000000

ПУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022

Место
производства:

ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

Контейнеры полимерные для крови и ее компонентов стерильные, однократного применения по ТУ 9444-007-70440344-2016 в вариантах исполнения
Макет этикетки пакета упаковочного (тары потребительской):

- КПК1(300)2 однокамерный 300 мл с двумя иглами полимерными
одноканальными



LEADCORE

ООО «Лидкор»

Россия, 620102, Свердловская область,
г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская стр. 23, офис 204

mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



КОНТЕЙНЕРЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ

стерильные однократного применения
КПК1(300)2

ТУ 9444-007-70440344-2016

Стерильно, Апирогенно, Нетоксично.

Стерилизовано оксидом этилена.

Однократного применения.

Не применять при наличии признаков повреждения.

Перед использованием ознакомится с инструкцией по
применению.



Партия №:000

Годен до: 00.0000



6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 2 1

РУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022

Место
производства:

ООО «Виробан»

141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

000-000000

Контейнеры полимерные для крови и ее компонентов стерильные, однократного применения по ТУ 9444-007-70440344-2016 в вариантах исполнения
Макет этикетки контейнера:

- КПК1(300)2 однокамерный 300мл с двумя иглами полимерными
одноканальными



Вид: КПК1(300)2

Контейнер для компонентов крови полимерный 300 мл

ООО «Лидкор»

Россия, 620102, Свердловская область,

г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,

ул. Посадская стр. 23, офис 204

mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



AB0

Rh-фактор

Стерильно, Апиrogenно, Нетоксично.
Переливать согласно приказам
гемотрансфузии.
Не предназначено для переливания крови,
пока не наклеена марка группы крови.
Не применять при наличии признаков
повреждения.

Перед использованием ознакомится с
инструкцией по применению.

Хранить при температуре от +5° до +40°С

ПУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022

Место
производства:

ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru




Партия №:000

Годен до: 00.0000

000-000000

Контейнеры полимерные для крови и ее компонентов стерильные, однократного применения по ТУ 9444-007-70440344-2016 в вариантах исполнения
Макет этикетки транспортной тары:

- КПК1(300)2 однокамерный 300мл с двумя иглами полимерными
одноканальными



LEADCORE

ООО «Лидкор»
Россия, 620102, Свердловская область,
г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская стр. 23, офис 204

mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



КОНТЕЙНЕРЫ ПОЛИМЕРНЫЙ ДЛЯ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ стерильные однократного применения КПК1(300)2

ТУ 9444-007-70440344-2016

Стерильно, апиrogenно, нетоксично.
Хранить при температуре от +5° до +40°C

Партия №: 000

Годен до: 00.0000

Количество, шт: 100

Брутто, кг:



EO

STERILE EO



75 kg
max



000-000000

ПУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022

Место
производства:

ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru
tel.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

Контейнеры полимерные для крови и ее компонентов стерильные, однократного применения по ТУ 9444-007-70440344-2016 в вариантах исполнения
Макет этикетки пакета упаковочного (тары потребительской):

- КПК1(500)2 однокамерный 500мл с двумя иглами полимерными
одноканальными



LEADCORE

ООО «Лидкор»
Россия, 620102, Свердловская область,
г.О. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская стр. 23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



КОНТЕЙНЕРЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ

стерильные однократного применения
КПК1(500)2

ТУ 9444-007-70440344-2016

Стерильно, Апирогенно, Нетоксично.
Стерилизовано оксидом этилена.
Однократного применения.
Не применять при наличии признаков повреждения.
Перед использованием ознакомится с инструкцией по
применению.



Партия №:000

Годен до: 00.0000



6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 2

РУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022

Место
производства:

ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

000-000000

Контейнеры полимерные для крови и ее компонентов стерильные, однократного применения по ТУ 9444-007-70440344-2016 в вариантах исполнения
Макет этикетки контейнера:

- КПК1(500)2 однокамерный 500мл с двумя иглами полимерными
одноканальными



LEADCORE

Вид: КПК1(500)2

Контейнер для компонентов крови полимерный 500 мл

ООО «Лидкор»

Россия, 620102, Свердловская область,

г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,

ул. Посадская стр. 23, офис 204

mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



AB0

Rh-фактор

Стерильно, Апиrogenно, Нетокаично.
Переливать согласно приказам
гемотрансфузии.
Не предназначено для переливания крови,
пока не наклеена марка группы крови.
Не применять при наличии признаков
повреждения.

Перед использованием ознакомится с
инструкцией по применению.

Хранить при температуре от +5° до +40°C

ПУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022

Место
производства:

ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru




Партия №:000

Годен до: 00.0000

000-000000

Контейнеры полимерные для крови и ее компонентов стерильные, однократного применения по ТУ 9444-007-70440344-2016 в вариантах исполнения
Макет этикетки транспортной тары:
- КПК1(500)2 одноканальный 500мл с двумя иглами полимерными
одноканальными



ООО «Лидкор»
Россия, 620102, Свердловская область,
г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская стр. 23, офис 204

LEADCORE mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



КОНТЕЙНЕРЫ ПОЛИМЕРНЫЙ ДЛЯ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ стерильные однократного применения КПК1(500)2

ТУ 9444-007-70440344-2016


Стерильно, апиrogenно, нетоксично.
Хранить при температуре от +5° до +40°C

Партия №: 000

Годен до: 00.0000

Количество, шт: 100

Брутто, кг:



ПУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022

Место
производства:

ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru
tel.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru



000-000000

Контейнеры полимерные для крови и ее компонентов стерильные, однократного применения по ТУ 9444-007-70440344-2016 в вариантах исполнения
Макет этикетки пакета упаковочного (тары потребительской):

- КПК1(1000)2 однокамерный 1000мл с двумя иглами полимерными
одноканальными



LEADCORE

ООО «Лидкор»

Россия, 620102, Свердловская область,
г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская стр. 23, офис 204

mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



КОНТЕЙНЕРЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ

стерильные однократного применения
КПК1(1000)2

ТУ 9444-007-70440344-2016

Стерильно, Апирогенно, Нетоксично.

Стерилизовано оксидом этилена.

Однократного применения.

Не применять при наличии признаков повреждения.

Перед использованием ознакомится с инструкцией по
применению.



Партия №:000

Годен до: 00.0000



РУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022

Место
производства:

ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

000-000000

Контейнеры полимерные для крови и ее компонентов стерильные, однократного применения по ТУ 9444-007-70440344-2016 в вариантах исполнения
Макет этикетки контейнера:

- КПК1(1000)2 однокамерный 1000мл с двумя иглами полимерными
одноканальными



Вид: КПК1(1000)2

Контейнер для компонентов крови полимерный 1000 мл

ООО «Лидкор»

Россия, 620102, Свердловская область,

г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,

ул. Посадская стр. 23, офис 204

mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



AB0

Rh-фактор

Стерильно, Апиrogenно, Нетоксично.
Переливать согласно приказам
гемотрансфузии.
Не предназначено для переливания крови,
пока не наклеена марка группы крови.
Не применять при наличии признаков
повреждения.
Перед использованием ознакомится с
инструкцией по применению.
Хранить при температуре от +5° до +40°C



Партия №:000

РУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022 **Годен до: 00.0000**

Место
производства:

ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

000-000000

Контейнеры полимерные для крови и ее компонентов стерильные, однократного применения по ТУ 9444-007-70440344-2016 в вариантах исполнения
Макет этикетки транспортной тары:
- КПК1(1000)2 однокамерный 1000мл с двумя иглами полимерными
одноканальными



LEADCORE

ООО «Лидкор»

Россия, 620102, Свердловская область,
г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская стр. 23, офис 204

mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



КОНТЕЙНЕРЫ ПОЛИМЕРНЫЙ ДЛЯ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ
стерильные однократного применения
КПК1(1000)2

ТУ 9444-007-70440344-2016

Стерильно, апирогенно, нетоксично.
Хранить при температуре от +5° до +40°С

Партия №: 000

Годен до: 00.0000

Количество, шт:

Брутто, кг:



000-000000

ПУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022

Место
производства:

ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

Контейнеры полимерные для крови и ее компонентов стерильные, однократного применения по ТУ 9444-007-70440344-2016 в вариантах исполнения
Макет этикетки пакета упаковочного (тары потребительской):

- КПК2(300)1 двухкамерный 300 мл с иглой полимерной одноканальной



ООО «Лидкор»
Россия, 620102, Свердловская область,
г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская стр. 23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



КОНТЕЙНЕРЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ

стерильные однократного применения
КПК2(300)1

ТУ 9444-007-70440344-2016

Стерильно, Апирогенно, Нетоксично.

Стерилизовано оксидом этилена.

Однократного применения.

Не применять при наличии признаков повреждения.

Перед использованием ознакомится с инструкцией по применению.



Партия №:000

Годен до: 00.0000



РУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022


Место
производства:

ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

000-000000

Контейнеры полимерные для крови и ее компонентов стерильные, однократного применения по ТУ 9444-007-70440344-2016 в вариантах исполнения
Макет этикетки контейнера:

- КПК2(300)1 двухкамерный 300 мл с иглой полимерной одноканальной



LEADCORE

Вид: КПК2(300)1

Контейнер для компонентов крови полимерный 300 мл

ООО «Лидкор»

Россия, 620102, Свердловская область,

г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,

ул. Посадская стр. 23, офис 204

mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



AB0

Rh-фактор

Стерильно, Апиrogenно, Нетокично.
Переливать согласно приказам
гемотрансфузии.

Не предназначено для переливания крови,
пока не наклеена марка группы крови.

Не применять при наличии признаков
повреждения.

Перед использованием ознакомится с
инструкцией по применению.

Хранить при температуре от +5° до +40°C



Партия №: 000


РУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022 Годен до: 00.0000

Место
производства:

ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

000-000000

Контейнеры полимерные для крови и ее компонентов стерильные, однократного применения по ТУ 9444-007-70440344-2016 в вариантах исполнения
Макет этикетки транспортной тары:
- КПК2(300)1 двухкамерный 300 мл с иглой полимерной одноканальной



ООО «Лидкор»

Россия, 620102, Свердловская область,
г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская стр. 23, офис 204

LEADCORE mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



КОНТЕЙНЕРЫ ПОЛИМЕРНЫЙ ДЛЯ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ
стерильные однократного применения
КПК2(300)1

ТУ 9444-007-70440344-2016

Стерильно, апирогенно, нетоксично.
Хранить при температуре от +5° до +40°C

Партия №: 000

Годен до: 00.0000

Количество, шт: 100

Брутто, кг:



75 кг
max



000-000000

ПУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022

Место
производства:

ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

Контейнеры полимерные для крови и ее компонентов стерильные, однократного применения по ТУ 9444-007-70440344-2016 в вариантах исполнения
Макет этикетки пакета упаковочного (тары потребительской):

- КПК2(500)1 двухкамерный 500 мл с иглой полимерной одноканальной



LEADCORE

ООО «Лидкор»

Россия, 620102, Свердловская область,
г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская стр. 23, офис 204

mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



КОНТЕЙНЕРЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ

стерильные однократного применения
КПК2(500)1

ТУ 9444-007-70440344-2016

Стерильно, Апирогенно, Нетоксично.

Стерилизовано оксидом этилена.

Однократного применения.

Не применять при наличии признаков повреждения.

Перед использованием ознакомится с инструкцией по применению.



Партия №:000

Годен до: 00.0000



6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 2 1

РУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022

Место
производства:


ООО «Виробан»

141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

000-000000

Контейнеры полимерные для крови и ее компонентов стерильные, однократного применения по ТУ 9444-007-70440344-2016 в вариантах исполнения
Макет этикетки контейнера:

- КПК2(500)1 двухкамерный 500 мл с иглой полимерной одноканальной



LEADCORE

Вид: КПК2(500)1

Контейнер для компонентов крови полимерный 500 мл

ООО «Лидкор»

Россия, 620102, Свердловская область,

г. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,

ул. Посадская стр. 23, офис 204

mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



AB0

Rh-фактор

Стерильно. Апиrogenно. Нетоксично.
Переливать согласно приказам
гемотрансфузии.
Не предназначено для переливания крови,
пока не наклеена марка группы крови.
Не применять при наличии признаков
повреждения.

Перед использованием ознакомится с
инструкцией по применению.

Хранить при температуре от +5° до +40°C

РУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022

Место
производства:

ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

Партия №:000

Годен до: 00.0000



6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 2

000-000000

Контейнеры полимерные для крови и ее компонентов стерильные, однократного применения по ТУ 9444-007-70440344-2016 в вариантах исполнения
Макет этикетки транспортной тары:

- КПК2(500)1 двухкамерный 500 мл с иглой полимерной одноканальной



ООО «Лидкор»

Россия, 620102, Свердловская область,
г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская стр. 23, офис 204

LEADCORE mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



КОНТЕЙНЕРЫ ПОЛИМЕРНЫЙ ДЛЯ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ
стерильные однократного применения
КПК2(500)1

ТУ 9444-007-70440344-2016

Стерильно, апирогенно, нетоксично.
Хранить при температуре от +5° до +40°С

Партия №: 000

Годен до: 00.0000

Количество, шт: 100

Брутто, кг:



75 кг
max



6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 2

000-000000

ПУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022

Место
производства:

ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru
tel.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

Контейнеры полимерные для крови и ее компонентов стерильные, однократного применения по ТУ 9444-007-70440344-2016 в вариантах исполнения
Макет этикетки пакета упаковочного (тары потребительской):

- КПК2(300)2 двухкамерный 300 мл с двумя иглами полимерными
одноканальными



ООО «Лидкор»
Россия, 620102, Свердловская область,
г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская стр. 23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



КОНТЕЙНЕРЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ

стерильные однократного применения
КПК2(300)2

ТУ 9444-007-70440344-2016

Стерильно, Апирогенно, Нетоксично.

Стерилизовано оксидом этилена.

Однократного применения.

Не применять при наличии признаков повреждения.

Перед использованием ознакомится с инструкцией по
применению.



Партия №:000

Годен до: 00.0000



РУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022


Место
производства:

ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

000-000000

Контейнеры полимерные для крови и ее компонентов стерильные, однократного применения по ТУ 9444-007-70440344-2016 в вариантах исполнения
Макет этикетки контейнера:

**- КПК2(300)2 двухкамерный 300 мл с двумя иглами полимерными
одноканальными**



LEADCORE

Вид: КПК2(300)2

Контейнер для компонентов крови полимерный 300 мл

ООО «Лидкор»

Россия, 620102, Свердловская область,

г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,

ул. Посадская стр. 23, офис 204

mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



AB0

Rh-фактор

Стерильно, Апиrogenно, Нетоксично.
Переливать согласно приказам
гемотрансфузии.
Не предназначено для переливания крови,
пока не наклеена марка группы крови.
Не применять при наличии признаков
повреждения.

Перед использованием ознакомится с
инструкцией по применению.

Хранить при температуре от +5° до +40°C

ПУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022

Место
производства:

ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru


Партия №:000

Годен до: 00.0000



000-000000

Контейнеры полимерные для крови и ее компонентов стерильные, однократного применения по ТУ 9444-007-70440344-2016 в вариантах исполнения
Макет этикетки транспортной тары:
- КПК2(300)2 двухкамерный 300 мл с двумя иглами полимерными
одноканальными



ООО «Лидкор»

Россия, 620102, Свердловская область,
г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская стр. 23, офис 204

LEADCORE mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



КОНТЕЙНЕРЫ ПОЛИМЕРНЫЙ ДЛЯ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ
стерильные однократного применения
КПК2(300)2

ТУ 9444-007-70440344-2016

Стерильно, апиrogenно, нетоксично.
Хранить при температуре от +5° до +40°C

Партия №: 000

Годен до: 00.0000

Количество, шт: 80

Брутто, кг:



75 кг
max



000-000000

ПУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022

Место
производства:

ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru
tel.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

Контейнеры полимерные для крови и ее компонентов стерильные, однократного применения по ТУ 9444-007-70440344-2016 в вариантах исполнения
Макет этикетки пакета упаковочного (тары потребительской):

- КПК2(500)2 двухкамерный 500 мл с двумя иглами полимерными
одноканальными



LEADCORE

ООО «Лидкор»
Россия, 620102, Свердловская область,
Г.О. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская стр. 23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



КОНТЕЙНЕРЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ

стерильные однократного применения
КПК2(500)1

ТУ 9444-007-70440344-2016

Стерильно, Апиrogenно, Нетоксично.
Стерилизовано оксидом этилена.
Однократного применения.
Не применять при наличии признаков повреждения.
Перед использованием ознакомится с инструкцией по
применению.



Партия №:000

Годен до: 00.0000



6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 2

РУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022

Место
производства:


ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

000-000000

Контейнеры полимерные для крови и ее компонентов стерильные, однократного применения по ТУ 9444-007-70440344-2016 в вариантах исполнения

Макет этикетки контейнера:

- КПК2(500)2 двухкамерный 500 мл с двумя иглами полимерными
одноканальными



LEADCORE

Вид: КПК2(500)2

Контейнер для компонентов крови полимерный 500 мл

ООО «Лидкор»

Россия, 620102, Свердловская область,

г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,

ул. Посадская стр. 23, офис 204

mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



AB0

Rh-фактор

Стерильно, Апирогенно, Нетоксично.
Переливать согласно приказам
гемотрансфузии.
Не предназначено для переливания крови,
пока не наклеена марка группы крови.
Не применять при наличии признаков
повреждения.

Перед использованием ознакомится с
инструкцией по применению.

Хранить при температуре от +5° до +40°C

ПУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022

Место
производства:

ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

Партия №:000

Годен до: 00.0000



место для
штрих-кода

6 9 6 9 6 9 6 1 9 6 9 6 9 2

000-000000

Контейнеры полимерные для крови и ее компонентов стерильные, однократного применения по ТУ 9444-007-70440344-2016 в вариантах исполнения
Макет этикетки транспортной тары:
- КПК2(500)2 двухкамерный 500 мл с двумя иглами полимерными одноканальными



LEADCORE

ООО «Лидкор»

Россия, 620102, Свердловская область,
г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская стр. 23, офис 204

mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



КОНТЕЙНЕРЫ ПОЛИМЕРНЫЙ ДЛЯ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ
стерильные однократного применения
КПК2(500)2

ТУ 9444-007-70440344-2016

Стерильно, апиrogenно, нетоксично.
Хранить при температуре от +5° до +40°C

Партия №: 000

Годен до: 00.0000

Количество, шт: 80

Брутто, кг:



75 кг
max



6 969696 969692

000-000000

ПУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022

Место
производства:

ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

Контейнеры полимерные для крови и ее компонентов стерильные, однократного применения по ТУ 9444-007-70440344-2016 в вариантах исполнения
Макет этикетки пакета упаковочного (тары потребительской):

- КПК4(300)1 четырехкамерный 300 мл с иглой полимерной двухканальной



ООО «Лидкор»
Россия, 620102, Свердловская область,
г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская стр. 23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



**КОНТЕЙНЕРЫ ПОЛИМЕРНЫЕ
ДЛЯ КРОВИ
И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ**
стерильные однократного применения
КПК4(300)1

ТУ 9444-007-70440344-2016

Стерильно, Апирогенно, Нетоксично.
Стерилизовано оксидом этилена.
Однократного применения.
Не применять при наличии признаков повреждения.
Перед использованием ознакомится с инструкцией по
применению.



Партия №:000

Годен до: 00.0000



РУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022

Место
производства:

ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

000-000000

Контейнеры полимерные для крови и ее компонентов стерильные, однократного применения по ТУ 9444-007-70440344-2016 в вариантах исполнения
Макет этикетки контейнера:

- КПК4(300)1 четырехкамерный 300 мл с иглой полимерной двухканальной



Вид: КПК4(300)1

Контейнер для компонентов крови полимерный 300 мл

ООО «Лидкор»

Россия, 620102, Свердловская область,

г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,

ул. Посадская стр. 23, офис 204

mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



AB0

Rh-фактор

Стерильно. Апирогенно. Нетоксично.
Переливать согласно приказам
гемотрансфузии.
Не предназначено для переливания крови,
пока не наклеена марка группы крови.
Не применять при наличии признаков
повреждения.

Перед использованием ознакомится с
инструкцией по применению.

Хранить при температуре от +5° до +40°С

ПУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022

Место
производства:

ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru



6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 2


Партия №:000

Годен до: 00.0000

000-000000

Контейнеры полимерные для крови и ее компонентов стерильные, однократного применения по ТУ 9444-007-70440344-2016 в вариантах исполнения
Макет этикетки транспортной тары:

- КПК4(300)1 четырехкамерный 300 мл с иглой полимерной двухканальной



LEADCORE

ООО «Лидкор»

Россия, 620102, Свердловская область,
г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская стр. 23, офис 204

mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



КОНТЕЙНЕРЫ ПОЛИМЕРНЫЙ ДЛЯ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ
стерильные однократного применения
КПК4(300)1

ТУ 9444-007-70440344-2016

Стерильно, апирогенно, нетоксично.
Хранить при температуре от +5° до +40°C

Партия №: 000

Годен до: 00.0000

Количество, шт:

Брутто, кг:



75 кг
max



6 969696 969692

000-000000

ПУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022

Место
производства:

ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

Контейнеры полимерные для крови и ее компонентов стерильные, однократного применения по ТУ 9444-007-70440344-2016 в вариантах исполнения
Макет этикетки пакета упаковочного (тары потребительской):

- КПК 692-2



LEADCORE

ООО «Лидкор»
Россия, 620102, Свердловская область,
г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская стр. 23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



КОНТЕЙНЕРЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ

стерильные однократного применения
КПК 692-2

ТУ 9444-007-70440344-2016

Стерильно, Апирогенно, Нетоксично.

Стерилизовано оксидом этилена.

Однократного применения.

Не применять при наличии признаков повреждения.

Перед использованием ознакомится с инструкцией по применению.



Партия №:000

Годен до: 00.0000



РУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022

Место
производства:

ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

000-000000

Контейнеры полимерные для крови и ее компонентов стерильные, однократного применения по ТУ 9444-007-70440344-2016 в вариантах исполнения
Макет этикетки контейнера:

- КПК 692-2



LEADCORE

Вид: КПК 692-2

Контейнер для компонентов крови полимерный 500 мл

ООО «Лидкор»

Россия, 620102, Свердловская область,

г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,

ул. Посадская стр. 23, офис 204

mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



AB0

Rh-фактор

Стерильно. Апиrogenно. Нетоксично.
Переливать согласно приказам
гемотрансфузии.
Не предназначено для переливания крови,
пока не наклеена марка группы крови.
Не применять при наличии признаков
повреждения.

Перед использованием ознакомится с
инструкцией по применению.

Хранить при температуре от +5° до +40°C



6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 2

Партия №:000

ПУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022

Годен до: 00.0000

Место
производства:

ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

000-000000

Контейнеры полимерные для крови и ее компонентов стерильные, однократного применения по ТУ 9444-007-70440344-2016 в вариантах исполнения
Макет этикетки транспортной тары:

- КПК 692-2



LEADCORE

ООО «Лидкор»
Россия, 620102, Свердловская область,
г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская стр. 23, офис 204

mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



КОНТЕЙНЕРЫ ПОЛИМЕРНЫЙ ДЛЯ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ
стерильные однократного применения
КПК 692-2

ТУ 9444-007-70440344-2016

Стерильно, апирогенно, нетоксично.
Хранить при температуре от +5° до +40°C

Партия №: 000

Годен до: 00.0000

Количество, шт: 80

Брутто, кг:



**75 кг
max**



6 969696 969692

000-000000

ПУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022

Место
производства:

ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

Контейнеры полимерные для крови и ее компонентов стерильные, однократного применения по ТУ 9444-007-70440344-2016 в вариантах исполнения
Макет этикетки пакета упаковочного (тары потребительской):

- КПК 692-4



ООО «Лидкор»
Россия, 620102, Свердловская область,
г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская стр. 23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



**КОНТЕЙНЕРЫ ПОЛИМЕРНЫЕ
ДЛЯ КРОВИ
И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ**
стерильные однократного применения
КПК 692-4

ТУ 9444-007-70440344-2016

Стерильно, Апирогенно, Нетоксично.
Стерилизовано оксидом этилена.
Однократного применения.
Не применять при наличии признаков повреждения.
Перед использованием ознакомится с инструкцией по
применению.



Партия №:000

Годен до: 00.0000



РУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022

Место
производства:


ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

000-000000

Контейнеры полимерные для крови и ее компонентов стерильные, однократного применения по ТУ 9444-007-70440344-2016 в вариантах исполнения
Макет этикетки контейнера:

- КПК 692-4

 Вид: КПК 692-4 Контейнер для компонентов крови полимерный 300 мл ООО «Лидкор», Россия, 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204 mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru	
ABO Rh-фактор	
Стерильно, Апиrogenно, Нетоксично. Переливать согласно приказам гемотрансфузии. Не предназначено для переливания крови, пока не наклеена марка группы крови. Не применять при наличии признаков повреждения. Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией по применению. Хранить при температуре от +5° до +40°С  место для штрих-кода Партия №:000 ГОДЕН ДО: 00.0000 ПУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022 Место производства: ООО «Виробан» 141981, Россия, Московская обл., г. Дубна ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru 000-000000	

 Вид: КПК 692-4 Контейнер для компонентов крови полимерный 1000 мл ООО «Лидкор», Россия, 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204 mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru	
ABO Rh-фактор	
Стерильно, Апиrogenно, Нетоксично. Переливать согласно приказам гемотрансфузии. Не предназначено для переливания крови, пока не наклеена марка группы крови. Не применять при наличии признаков повреждения. Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией по применению. Хранить при температуре от +5° до +40°С  место для штрих-кода Партия №:000 ГОДЕН ДО: 00.0000 ПУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022 Место производства: ООО «Виробан» 141981, Россия, Московская обл., г. Дубна ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru 000-000000	

Контейнеры полимерные для крови и ее компонентов стерильные, однократного применения по ТУ 9444-007-70440344-2016 в вариантах исполнения
Макет этикетки транспортной тары:

- КПК 692-4



LEADCORE

ООО «Лидкор»

Россия, 620102, Свердловская область,
г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская стр. 23, офис 204

mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



КОНТЕЙНЕРЫ ПОЛИМЕРНЫЙ ДЛЯ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ
стерильные однократного применения
КПК 692-4

ТУ 9444-007-70440344-2016

Стерильно, апирогенно, нетоксично.
Хранить при температуре от +5° до +40°C

Партия №: 000

Годен до: 00.0000

Количество, шт: 40

Брутто, кг:



EO

STERILE EO



75 кг
max



6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 2

000-000000

ПУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022

Место
производства:

ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru
tel.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

61 (шестьдесят один) л.

Директор
ООО «ТИДКОР»

 /Е. Ю. Гохгут/





«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
ООО «Лидкор»

Е. Ю. Гохгут
«5» апреля 2023 г.


Фотографические изображения медицинского изделия
«Контейнеры полимерные для крови и ее компонентов стерильные
однократного применения» по ТУ 9444-007-70440344-2016.



I. Фотографические изображения медицинского изделия с тарой потребительской (первичной упаковкой).

- КПК1(300) однокамерный 300 мл с иглой полимерной однокамерной.

Общий вид:

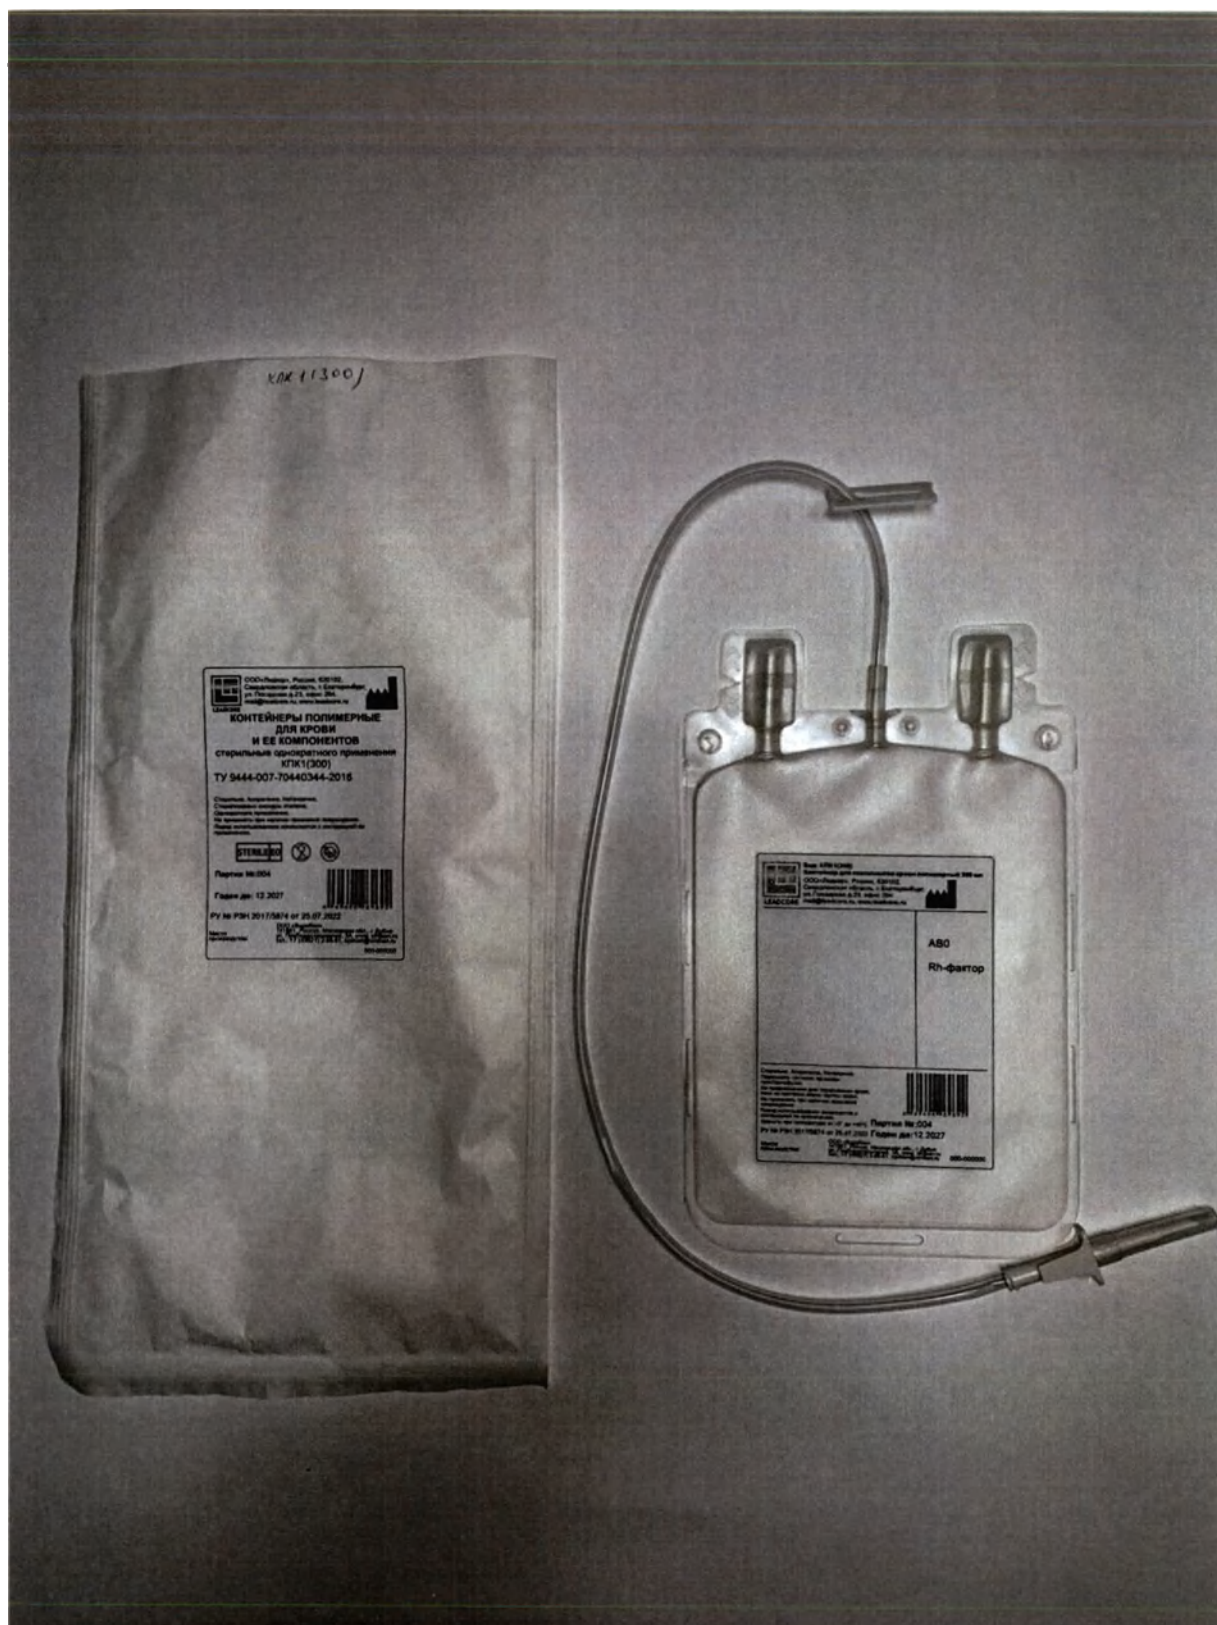

Этикетка пакета упаковочного (тары потребительской):

 LEADCORE	Вид: КПК1(300) Контейнер для компонентов крови полимерный 300 мл ООО «Лидкор», Россия, 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская стр.23, офис 204 mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru				
		AB0 Rh-фактор			
Стерильно, Апиrogenно, Нетоксично. Переливать согласно приказам гемотрансфузии. Не предназначено для переливания крови, пока не наклеена марка группы крови. Не применять при наличии признаков повреждения. Перед использованием ознакомится с инструкцией по применению. Хранить при температуре от +5° до +40°С Партия №:005 Годен до: 03.2028 ПУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022 <table border="0"><tr><td data-bbox="415 1532 553 1576">Место производства:</td><td data-bbox="650 1518 1052 1592">ООО «Виробан» 141981, Россия, Московская обл., г. Дубна ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru</td><td data-bbox="1078 1563 1208 1585">000-000000</td></tr></table>			Место производства:	ООО «Виробан» 141981, Россия, Московская обл., г. Дубна ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru	000-000000
Место производства:	ООО «Виробан» 141981, Россия, Московская обл., г. Дубна ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru	000-000000			



LEADCORE

ООО «Лидкор»,
Россия, 620102, Свердловская область,
г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская стр.23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



**КОНТЕЙНЕРЫ ПОЛИМЕРНЫЕ
ДЛЯ КРОВИ
И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ**
стерильные однократного применения
КПК1(300)

ТУ 9444-007-70440344-2016

Стерильно, Апирогенно, Нетоксично.
Стерилизовано оксидом этилена.
Однократного применения.
Не применять при наличии признаков повреждения.
Перед использованием ознакомится с инструкцией по
применению.

STERILE EO



Партия №:005

Годен до: 03.2028




РУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022

Место
производства:

ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

000-000000

- КПК1(500) однокамерный 500 мл с шглой полимерной одноканальной
Общий вид:

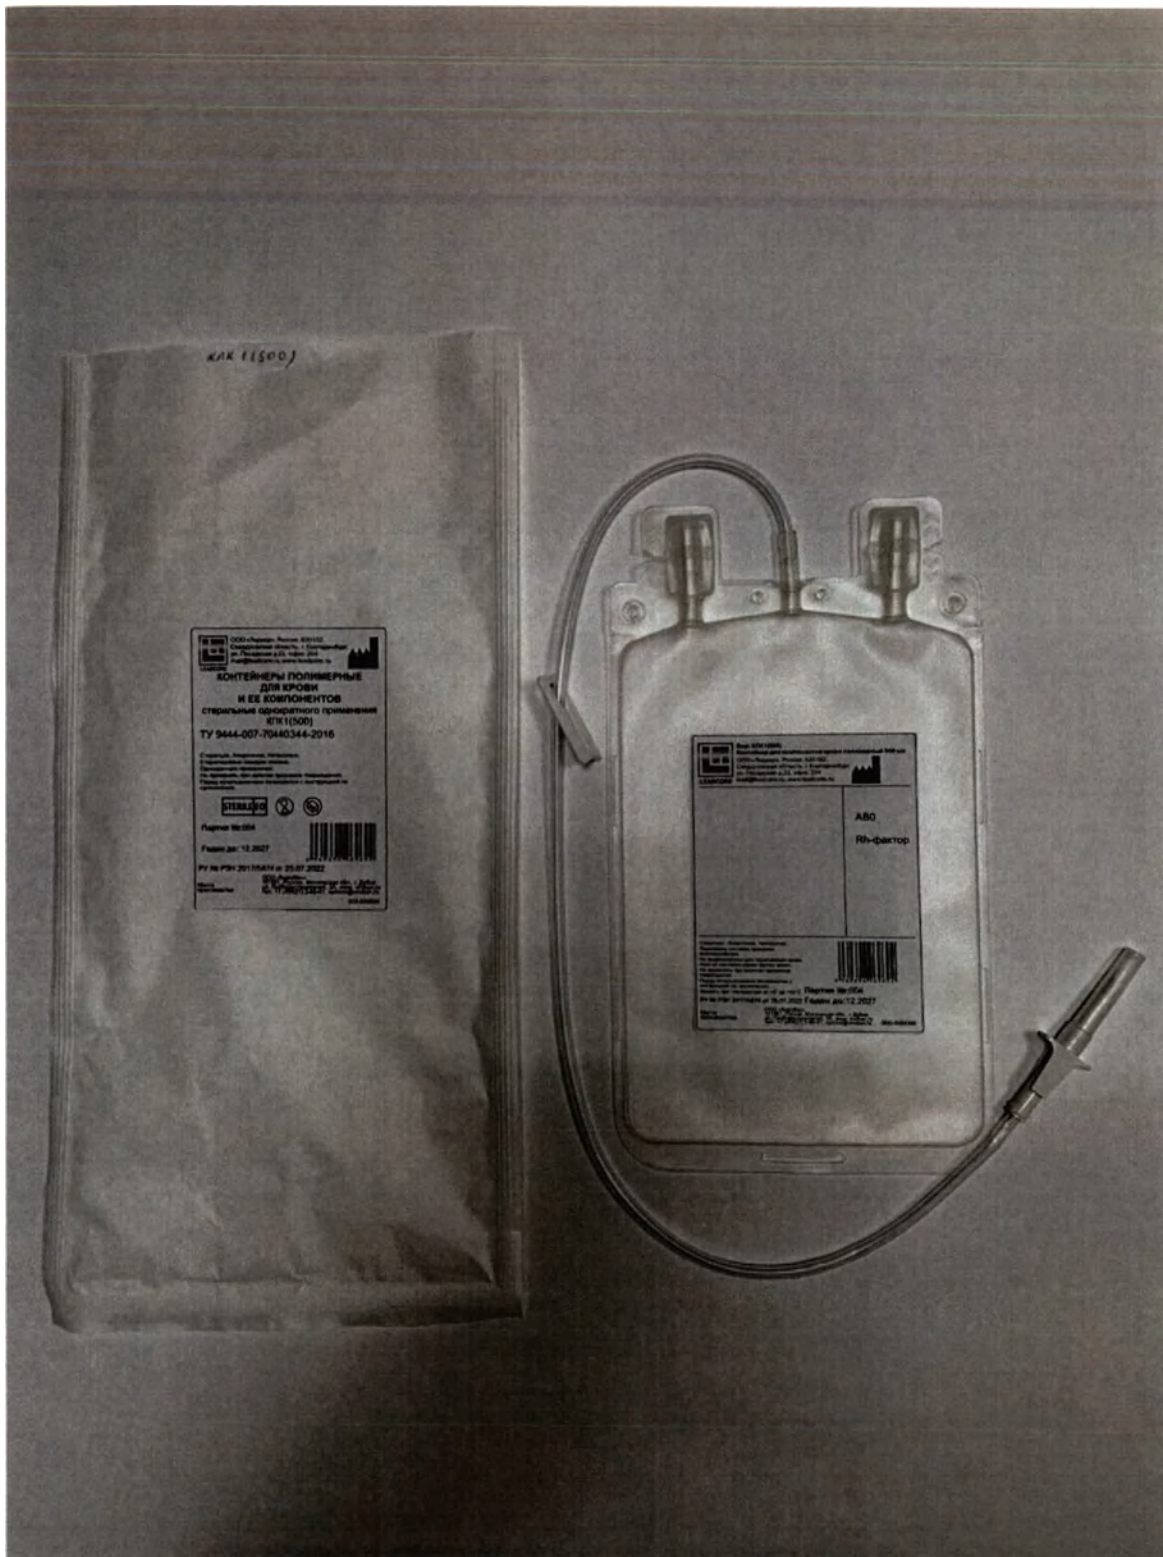



LEADCORE

ООО «Лидкор»,
Россия, 620102, Свердловская область,
г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская стр.23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



КОНТЕЙНЕРЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ

стерильные однократного применения
КПК1(500)

ТУ 9444-007-70440344-2016

Стерильно, Апирогенно, Нетоксично.
Стерилизовано оксидом этилена.
Однократного применения.
Не применять при наличии признаков повреждения.
Перед использованием ознакомится с инструкцией по
применению.

STERILE EO



Партия №:005

Годен до: 03.2028



ПУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022

Место
производства:

ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

000-000000

Этикетка контейнера:



LEADCORE

Вид: КПК1(500)

Контейнер для компонентов крови полимерный 500 мл

ООО «Лидкор»,
Россия, 620102, Свердловская область,
г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская стр.23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



AB0

Rh-фактор

Стерильно, Апиrogenно, Нетоксично.
Переливать согласно приказам
гемотрансфузии.
Не предназначено для переливания крови,
пока не наклеена марка группы крови.
Не применять при наличии признаков
повреждения.
Перед использованием ознакомится с
инструкцией по применению.



6 969696 969692

Хранить при температуре от +5° до +40°C

Партия №:005

РУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022

Годен до: 03.2028


Место
производства:

ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

000-000000

- КПК1(1000) однокамерный 1000 мл с иглой полимерной одноканальной

Общий вид:

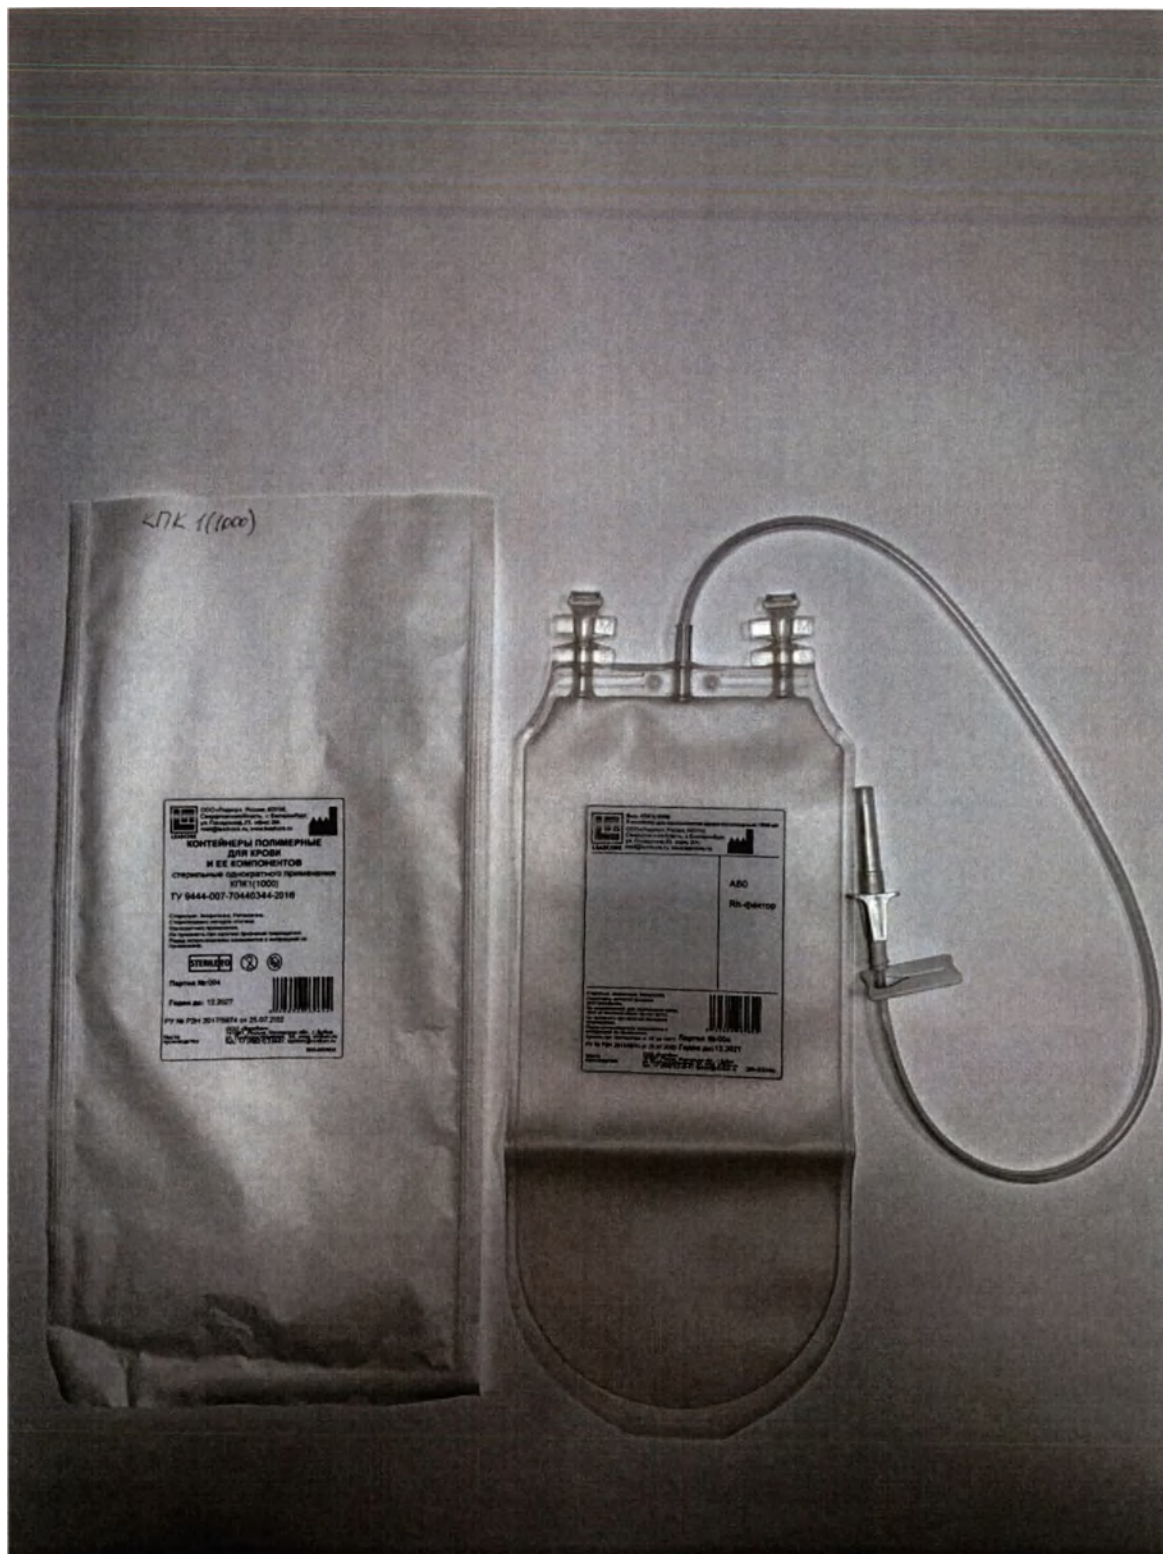



ООО «Лидкор»,
Россия, 620102, Свердловская область,
г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская стр. 23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



**КОНТЕЙНЕРЫ ПОЛИМЕРНЫЕ
ДЛЯ КРОВИ
И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ**
стерильные однократного применения
КПК1(1000)
ТУ 9444-007-70440344-2016

Стерильно, Апирогенно, Нетоксично.
Стерилизовано оксидом этилена.
Однократного применения.
Не применять при наличии признаков повреждения.
Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией по
применению.



Партия №:005

Годен до: 03.2028



6 9 6 9 6 9 6 1 9 6 9 6 9 2 1

РУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022

Место
производства:

ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

000-000000



LEADCORE

Вид: КПК1(1000)

Контейнер для компонентов крови полимерный 1000 мл

ООО «Лидкор»,
Россия, 620102, Свердловская область,
г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская стр.23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



AB0

Rh-фактор

Стерильно, Апиrogenно, Нетоксично.
Переливать согласно приказам
гемотрансфузии.

Не предназначено для переливания крови,
пока не наклеена марка группы крови.

Не применять при наличии признаков
повреждения.

Перед использованием ознакомится с
инструкцией по применению.

Хранить при температуре от +5° до +40°C



6 969696 969692

Партия №:005

РУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022 **Годен до: 03.2028**


Место
производства:

ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

000-000000

- КПК1(300)PL однокамерный 300 мл с иглой полимерной одноканальной для хранения тромбоцитов

Общий вид:

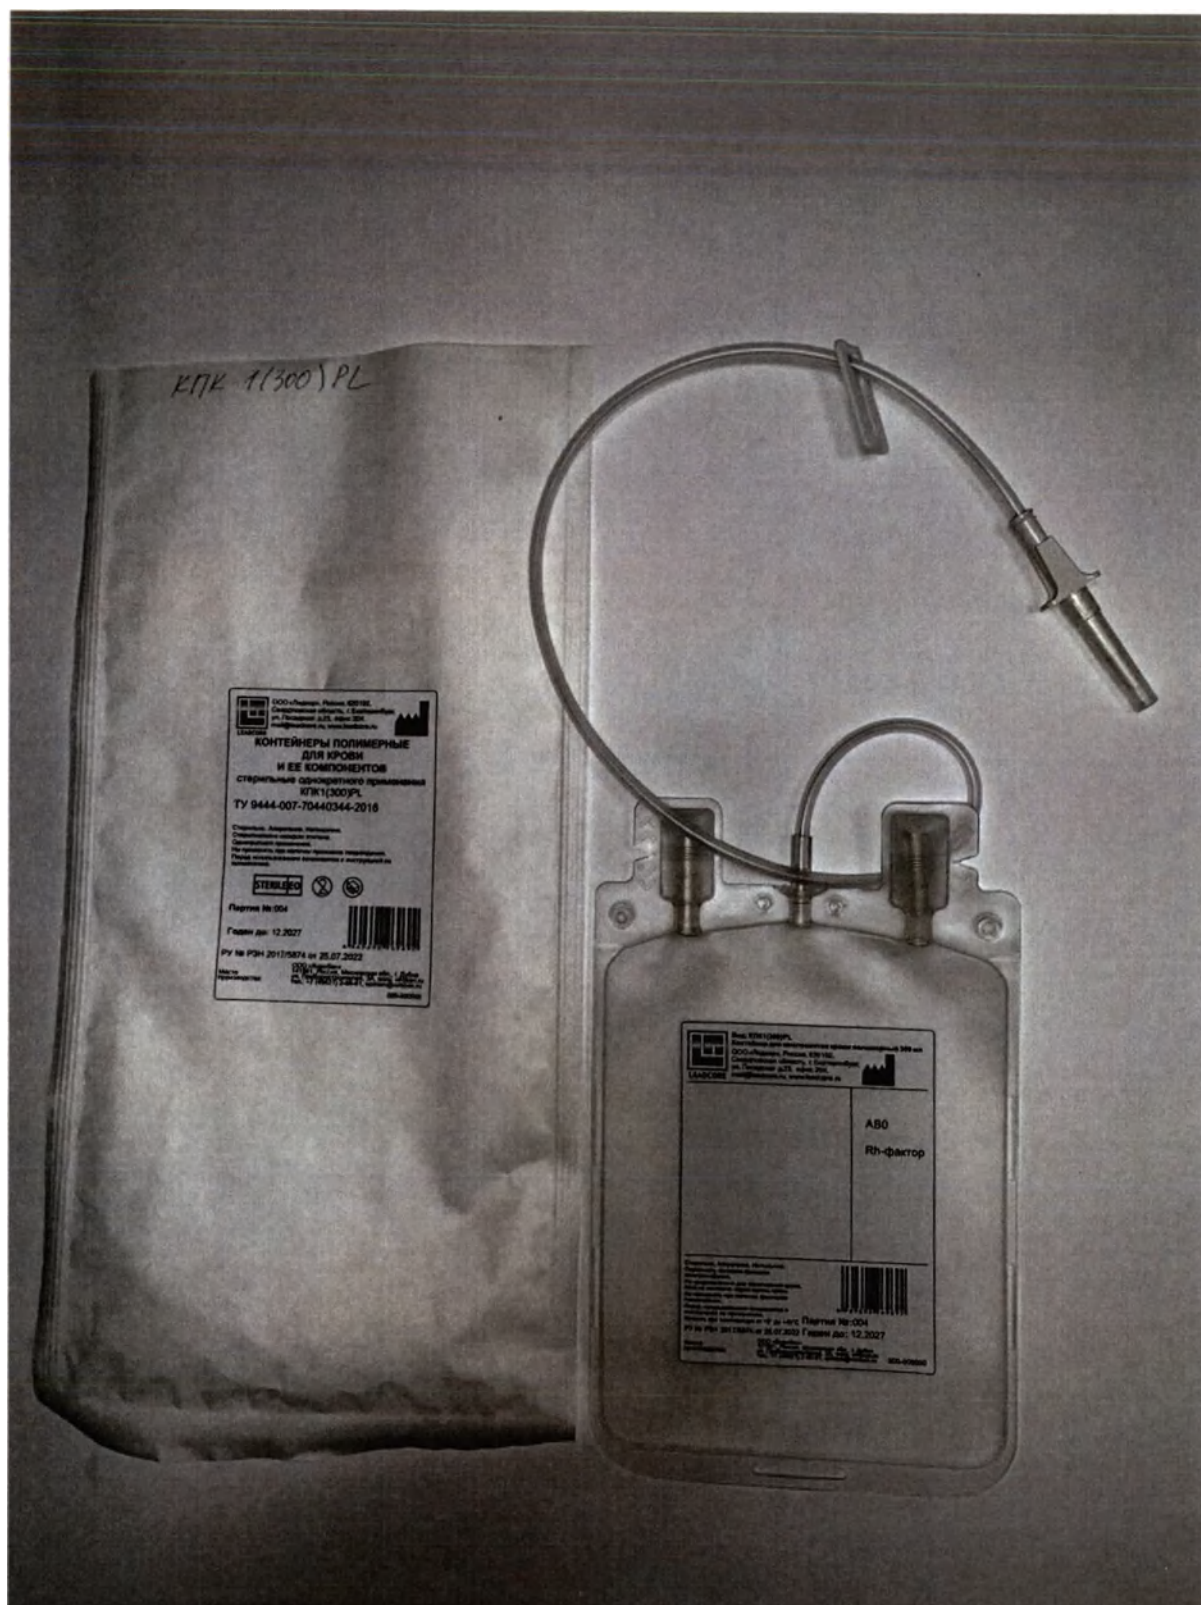



ООО «Лидкор»,
Россия, 620102, Свердловская область,
г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская стр.23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



ЛЕАДКОР

**КОНТЕЙНЕРЫ ПОЛИМЕРНЫЕ
ДЛЯ КРОВИ
И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ**
стерильные однократного применения
КПК1(300)PL
ТУ 9444-007-70440344-2016

Стерильно, Апиrogenно, Нетоксично.
Стерилизовано оксидом этилена.
Однократного применения.
Не применять при наличии признаков повреждения.
Перед использованием ознакомится с инструкцией по
применению.



Партия №:005

Годен до: 03.2028



6 969696 969692

РУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022

Место
производства:

ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

000-000000



LEADCORE

Вид: КПК1(300)PL

Контейнер для компонентов крови полимерный 300 мл

ООО «Лидкор».

Россия, 620102, Свердловская область,

г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,

ул. Посадская стр.23, офис 204

mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



AB0

Rh-фактор

Стерильно, Апиrogenно, Нетоксично.

Переливать согласно приказам
гемотрансфузии.

Не предназначено для переливания крови,
пока не наклеена марка группы крови.

Не применять при наличии признаков
повреждения.

Перед использованием ознакомится с
инструкцией по применению.

Хранить при температуре от +5° до +40°C



6 969696 969692

Партия №:005

ПУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022 Годен до: 03.2028


Место
производства:

ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru
тел.: +7 (49621) 2-66-61, opin@viroban.ru

000-000000

- КПК1(500)PL однокамерный 500 мл с иглой полимерной одноканальной для хранения тромбоцитов;

Общий вид:

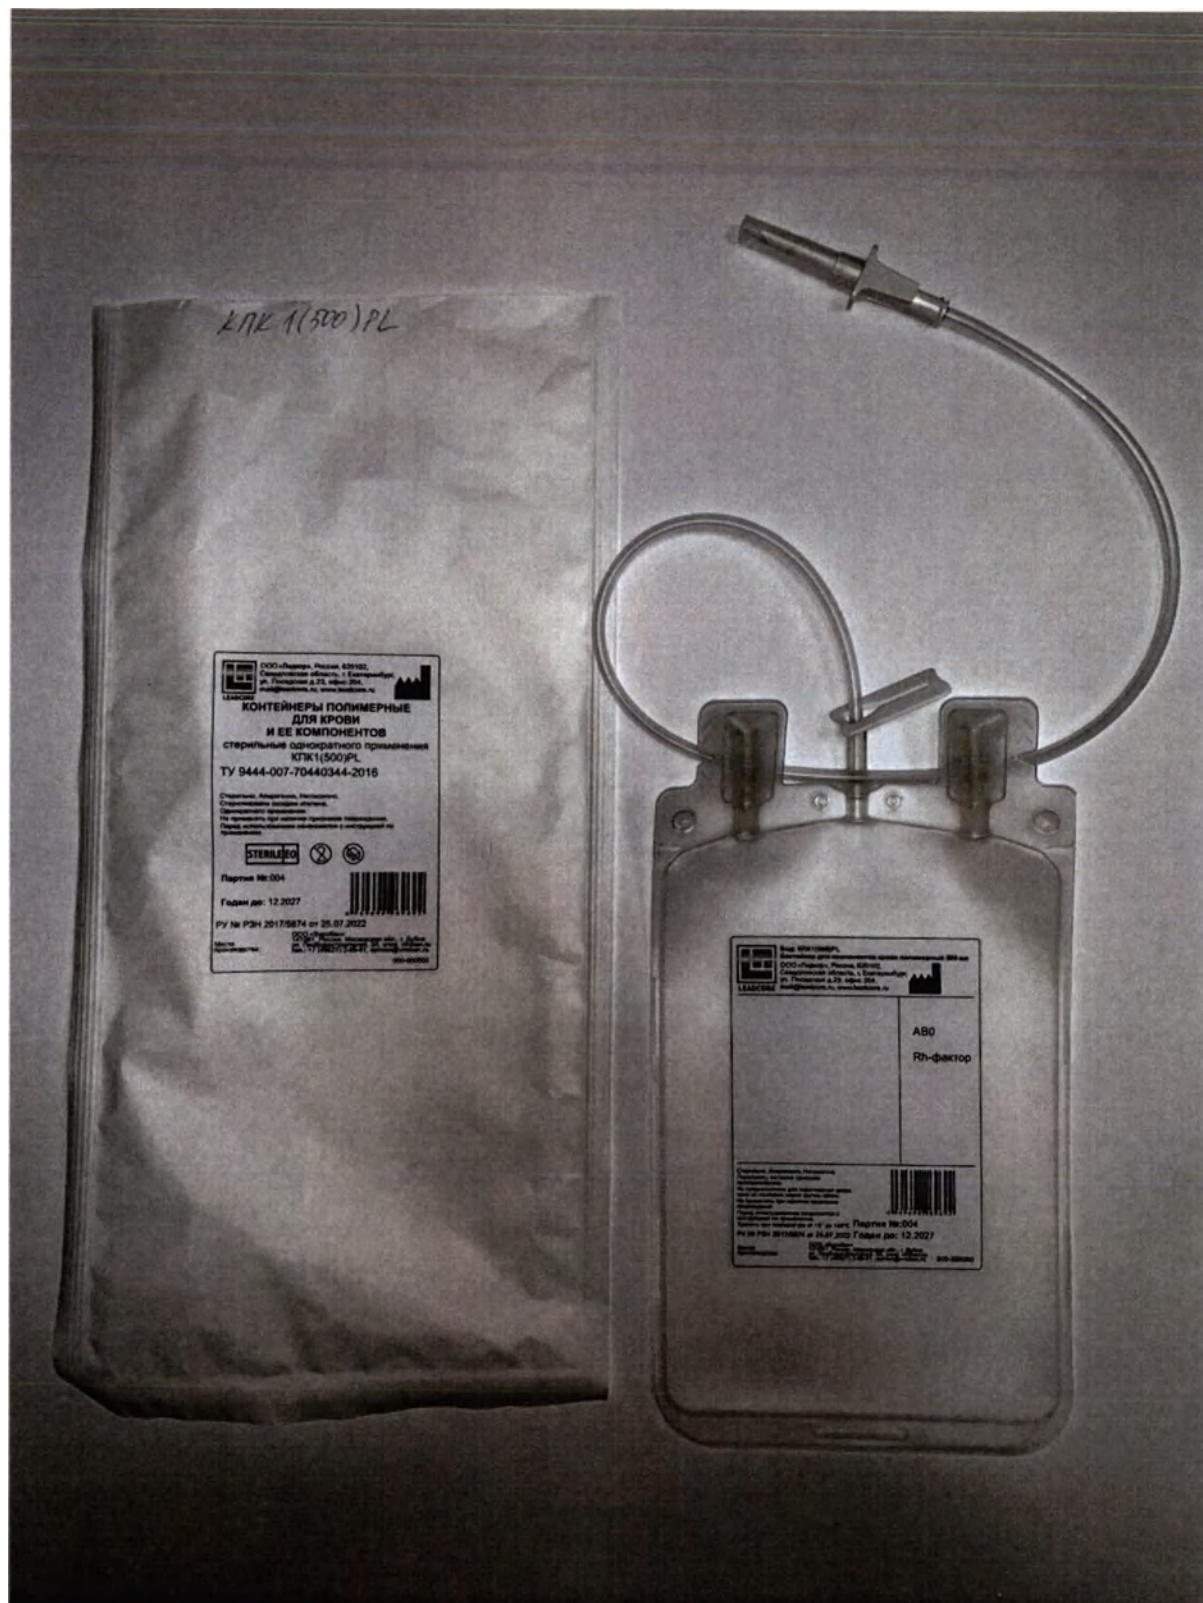



ООО «Лидкор»,
Россия, 620102, Свердловская область,
г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская стр.23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



КОНТЕЙНЕРЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ

**стерильные однократного применения
КПК1(500)PL**

ТУ 9444-007-70440344-2016

Стерильно, Апирогенно, Нетоксично.
Стерилизовано оксидом этилена.
Однократного применения.
Не применять при наличии признаков повреждения.
Перед использованием ознакомится с инструкцией по
применению.



Партия №:005

Годен до: 03.2028



6 9 6 9 6 9 6 1 9 6 9 6 9 2 1

ПУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022

Место
производства:

ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

000-000000



LEADCORE

Вид: КПК1(500)PL
Контейнер для компонентов крови полимерный 500 мл

ООО «Лидкор»,
Россия, 620102, Свердловская область,
г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская стр.23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



AB0

Rh-фактор

Стерильно, Апиrogenно, Нетоксично.
Переливать согласно приказам
гемотрансфузии.
Не предназначено для переливания крови,
пока не наклеена марка группы крови.
Не применять при наличии признаков
повреждения.
Перед использованием ознакомится с
инструкцией по применению.



Хранить при температуре от +5° до +40°С **Партия №:005**
ПУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022 Годен до: 03.2028


Место
производства:

ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

000-000000

- КПК1(1000)PL однокамерный 1000 мл с шлейфом полимерной одноканальной для хранения тромбоцитов;

Общий вид:

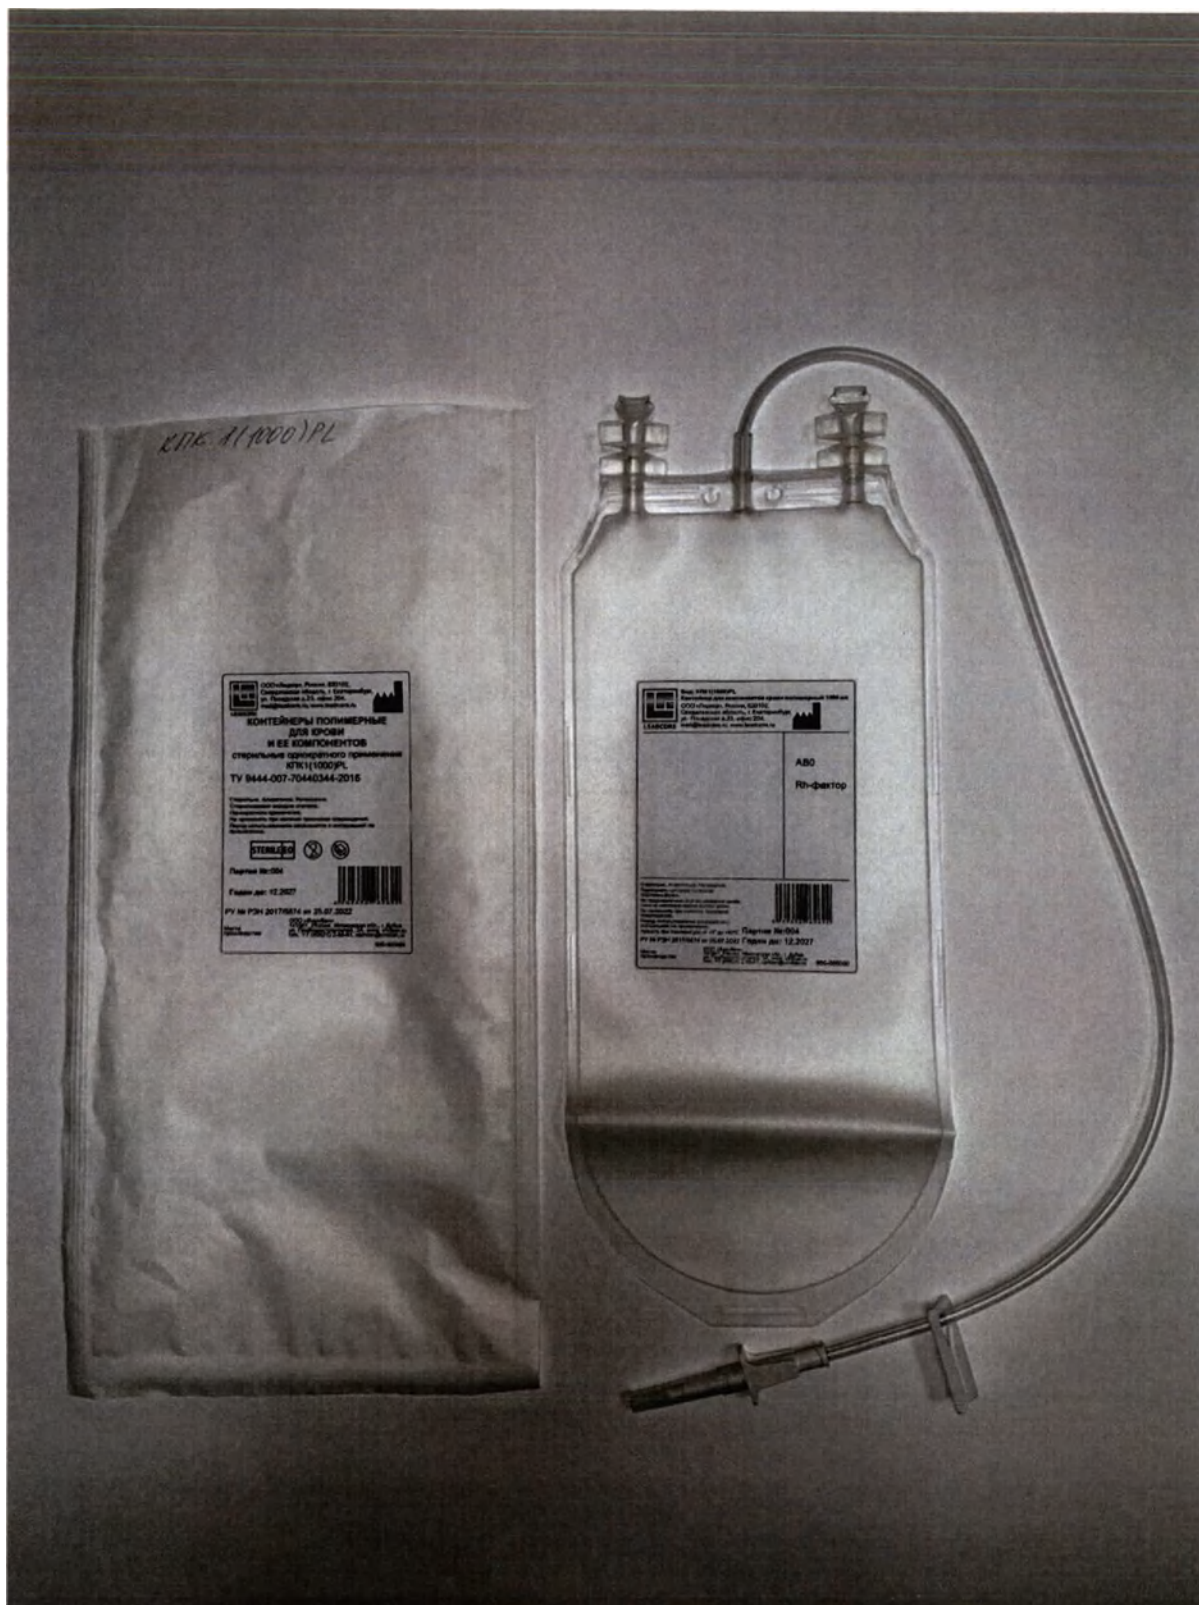

Этикетка пакета упаковочного (тары потребительской):



ООО «Лидкор»,
Россия, 620102, Свердловская область,
г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская стр.23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



ЛЕАДКОР

**КОНТЕЙНЕРЫ ПОЛИМЕРНЫЕ
ДЛЯ КРОВИ
И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ**
стерильные однократного применения
КПК1(1000)PL
ТУ 9444-007-70440344-2016

Стерильно, Апирогенно, Нетоксично.
Стерилизовано оксидом этилена.
Однократного применения.
Не применять при наличии признаков повреждения.
Перед использованием ознакомится с инструкцией по
применению.



Партия №:005

Годен до: 03.2028



РУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022

Место
производства:

ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

000-000000



LEADCORE

Вид: КПК1(1000)PL

Контейнер для компонентов крови полимерный 1000 мл

ООО «Лидкор»,

Россия, 620102, Свердловская область,

г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,

ул. Посадская стр.23, офис 204

mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



AB0

Rh-фактор

Стерильно, Апиrogenно, Нетоксично.

Переливать согласно приказам
гемотрансфузии.

Не предназначено для переливания крови,
пока не наклеена марка группы крови.

Не применять при наличии признаков
повреждения.

Перед использованием ознакомится с
инструкцией по применению.

Хранить при температуре от +5° до +40°С



Партия №:005

РУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022 Годен до: 03.2028

Место
производства:

ООО «Виробан»


141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru

тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

000-000000

- КПК1(500/4) однокамерный с четырьмя портами 500 мл с иглой полимерной одноканальной;

Общий вид:

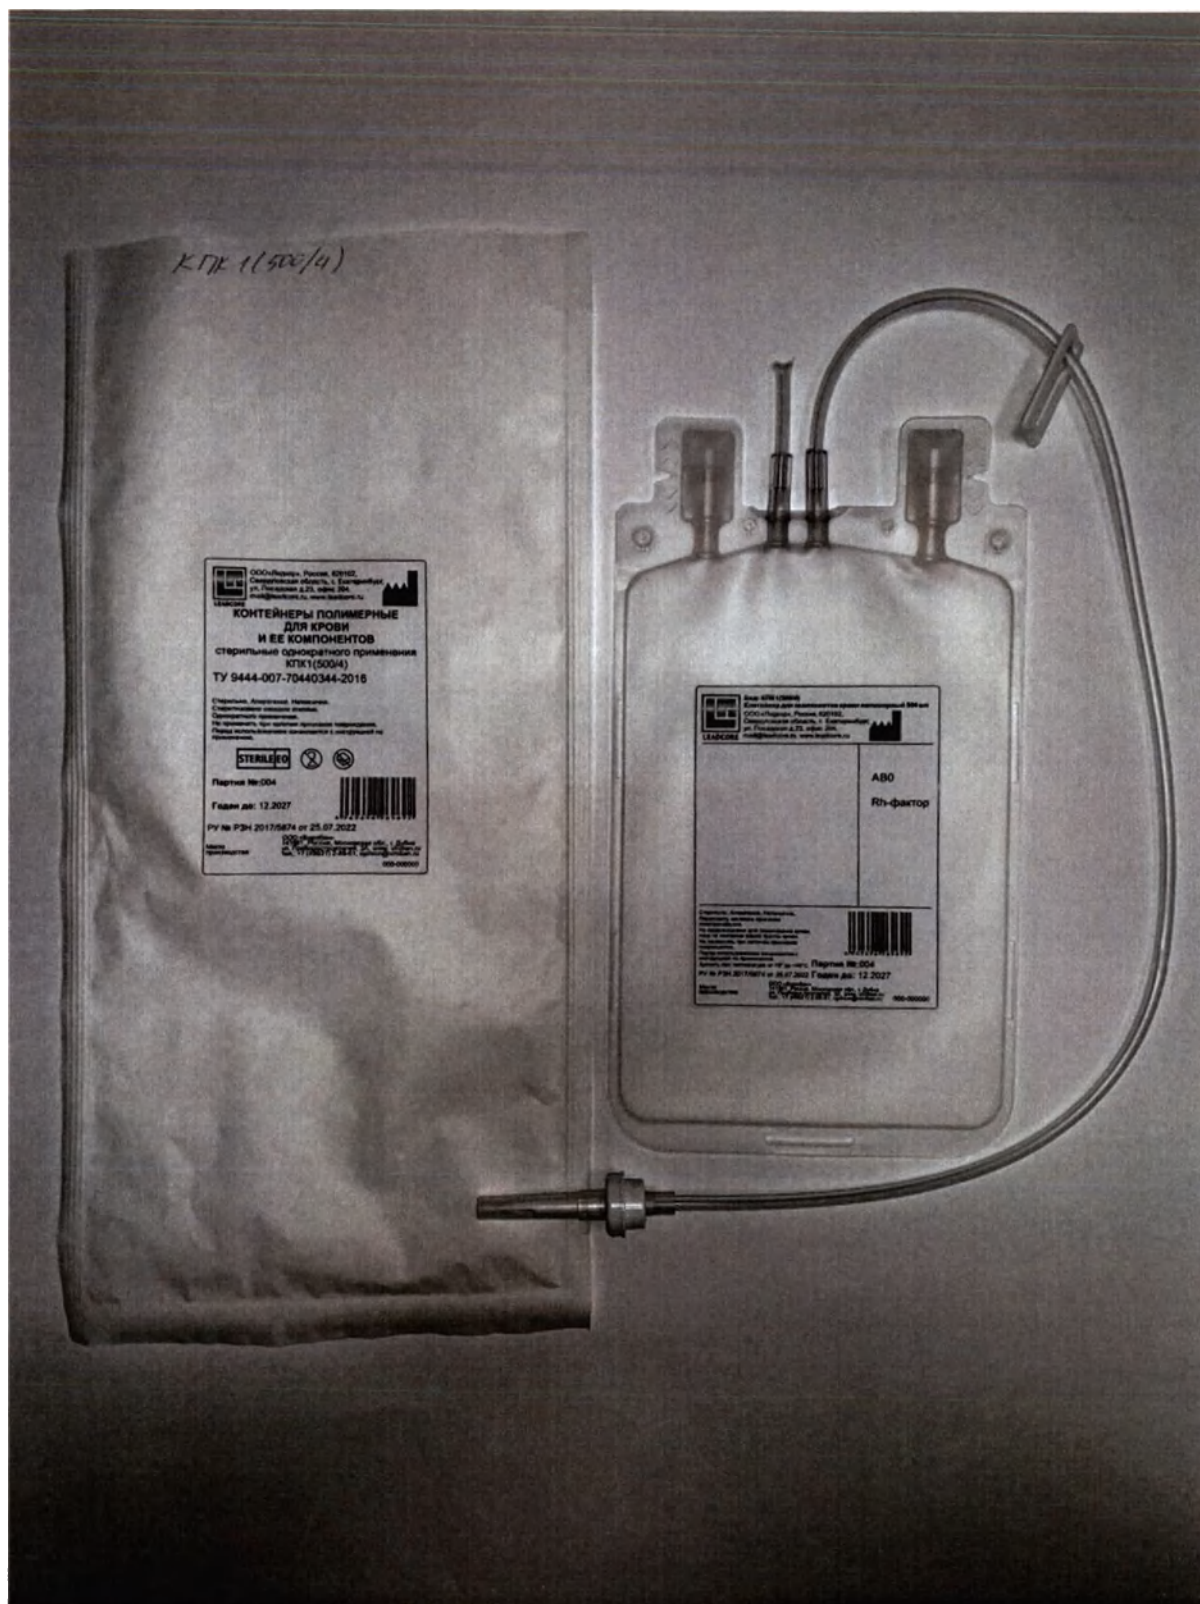



ООО «Лидкор»,
Россия, 620102, Свердловская область,
г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская стр.23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



**КОНТЕЙНЕРЫ ПОЛИМЕРНЫЕ
ДЛЯ КРОВИ
И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ**
стерильные однократного применения
КПК1(500/4)
ТУ 9444-007-70440344-2016

Стерильно, Апиrogenно, Нетоксично.
Стерилизовано оксидом этилена.
Однократного применения.
Не применять при наличии признаков повреждения.
Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией по
применению.



Партия №:005

Годен до: 03.2028



6 969696 969692

РУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022

Место
производства:

ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

000-000000



LEADCORE

Вид: КПК1(500/4)

Контейнер для компонентов крови полимерный 500 мл

ООО «Лидкор»,

Россия, 620102, Свердловская область,

г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,

ул. Посадская стр.23, офис 204

mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



AB0

Rh-фактор

Стерильно, Апиrogenно, Нетоксично.

Переливать согласно приказам
гемотрансфузии.

Не предназначено для переливания крови,
пока не наклеена марка группы крови.

Не применять при наличии признаков
повреждения.

Перед использованием ознакомится с
инструкцией по применению.

Хранить при температуре от +5° до +40°С

Партия №:005

РУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022 Годен до: 03.2028

Место
производства:

ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru


000-000000



6 1969696 196969 2

- КПК1(600/4) однокамерный с четырьмя портами 600 мл с иглой полимерной одноканальной;

Общий вид:

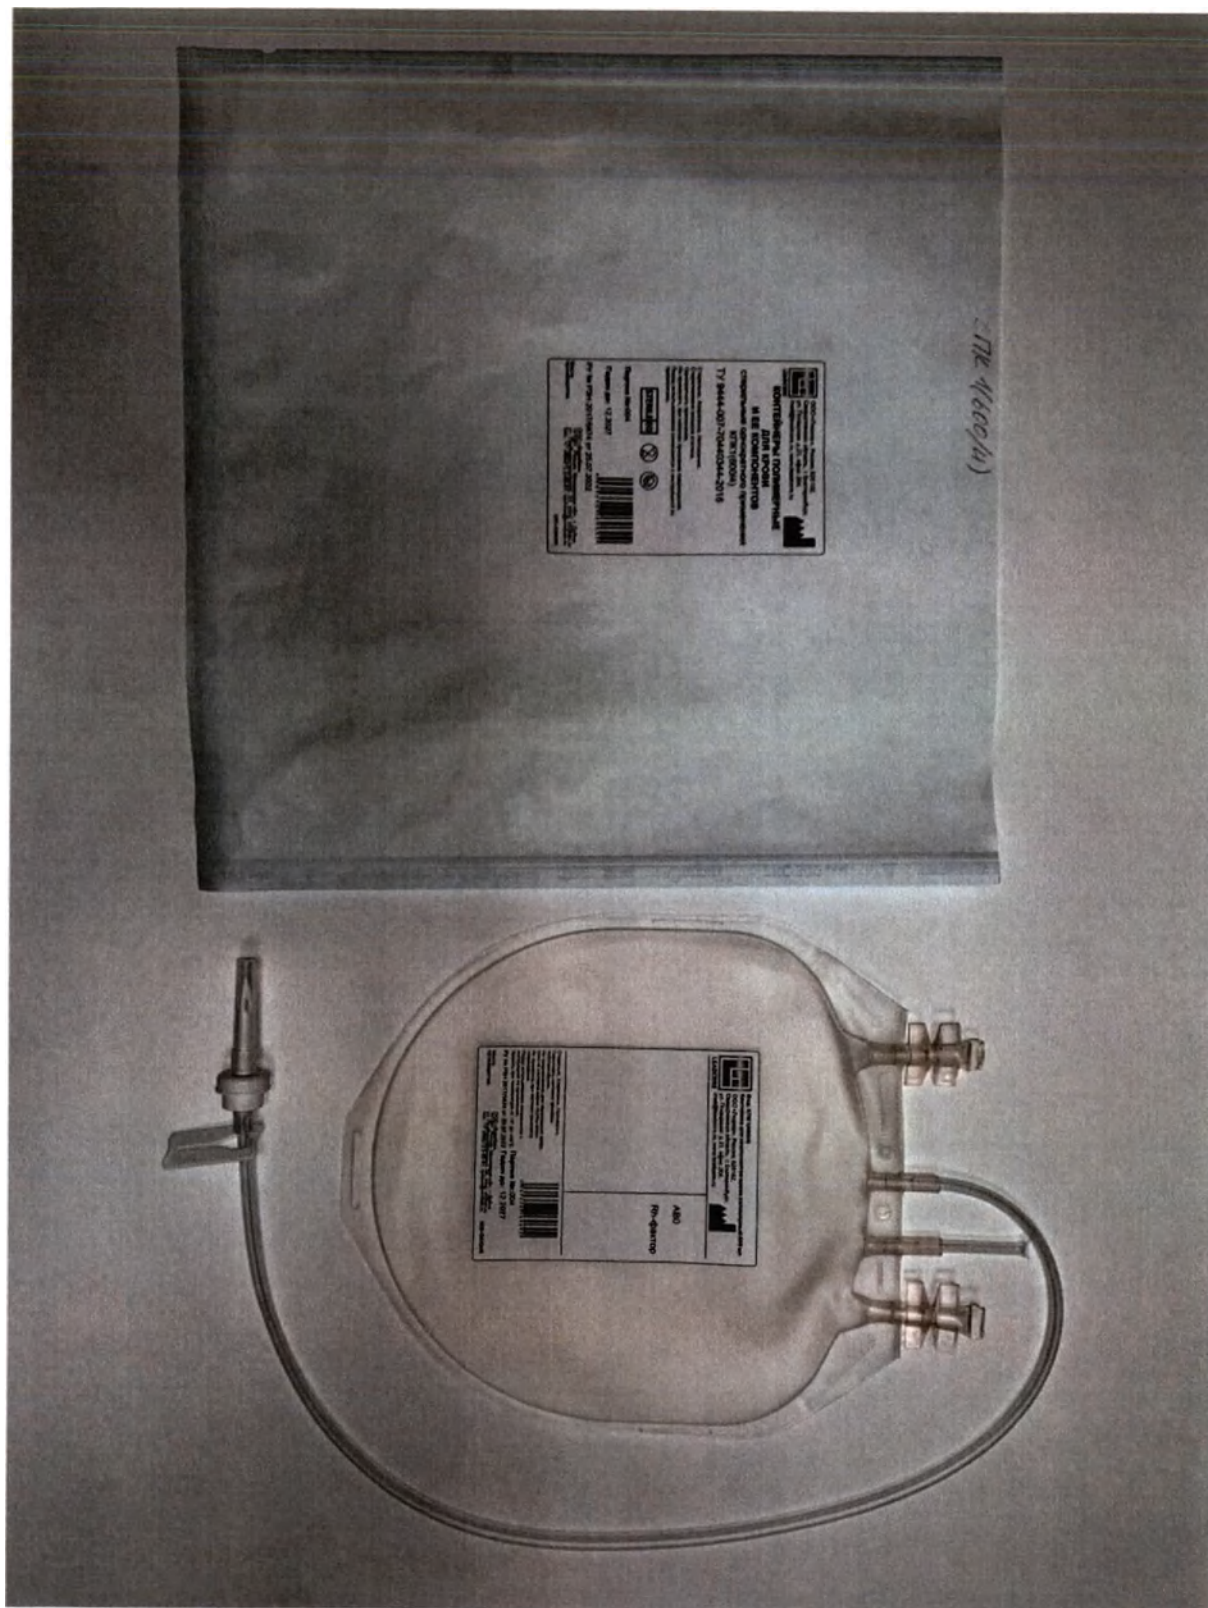



ООО «Лидкор»,
Россия, 620102, Свердловская область,
г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская стр.23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



КОНТЕЙНЕРЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ

стерильные однократного применения
КПК1(600/4)

ТУ 9444-007-70440344-2016

Стерильно, Апиrogenно, Нетоксично.

Стерилизовано оксидом этилена.

Однократного применения.

Не применять при наличии признаков повреждения.

Перед использованием ознакомится с инструкцией по применению.



Партия №:005

Годен до: 03.2028



6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 2 1

ПУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022

Место
производства:

ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru
тел.: +7 (49821) 2-88-61, opinion@viroban.ru


000-000000

Этикетка контейнера:

 LEADCORE	Вид: КПК1(600/4) Контейнер для компонентов крови полимерный 600 мл ООО «Лидкор», Россия, 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская стр.23, офис 204 mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru				
		AB0 Rh-фактор			
Стерильно, Апиrogenно, Нетоксично. Переливать согласно приказам гемотрансфузии. Не предназначено для переливания крови, пока не наклеена марка группы крови. Не применять при наличии признаков повреждения. Перед использованием ознакомится с инструкцией по применению. Хранить при температуре от +5° до +40°С Партия №: 005 Годен до: 03.2028 РУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022 <table border="0"><tr><td data-bbox="331 1509 491 1554">Место производства:</td><td data-bbox="592 1503 1034 1576">ООО «Виробан» 141981, Россия, Московская обл., г. Дубна ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru</td><td data-bbox="1066 1554 1209 1576">000-000000</td></tr></table>			Место производства:	ООО «Виробан» 141981, Россия, Московская обл., г. Дубна ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru	000-000000
Место производства:	ООО «Виробан» 141981, Россия, Московская обл., г. Дубна ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru	000-000000			

- КПК1(1000/4) однокамерный с четырьмя портами 1000 мл с иглой полимерной одноканальной;

Общий вид:

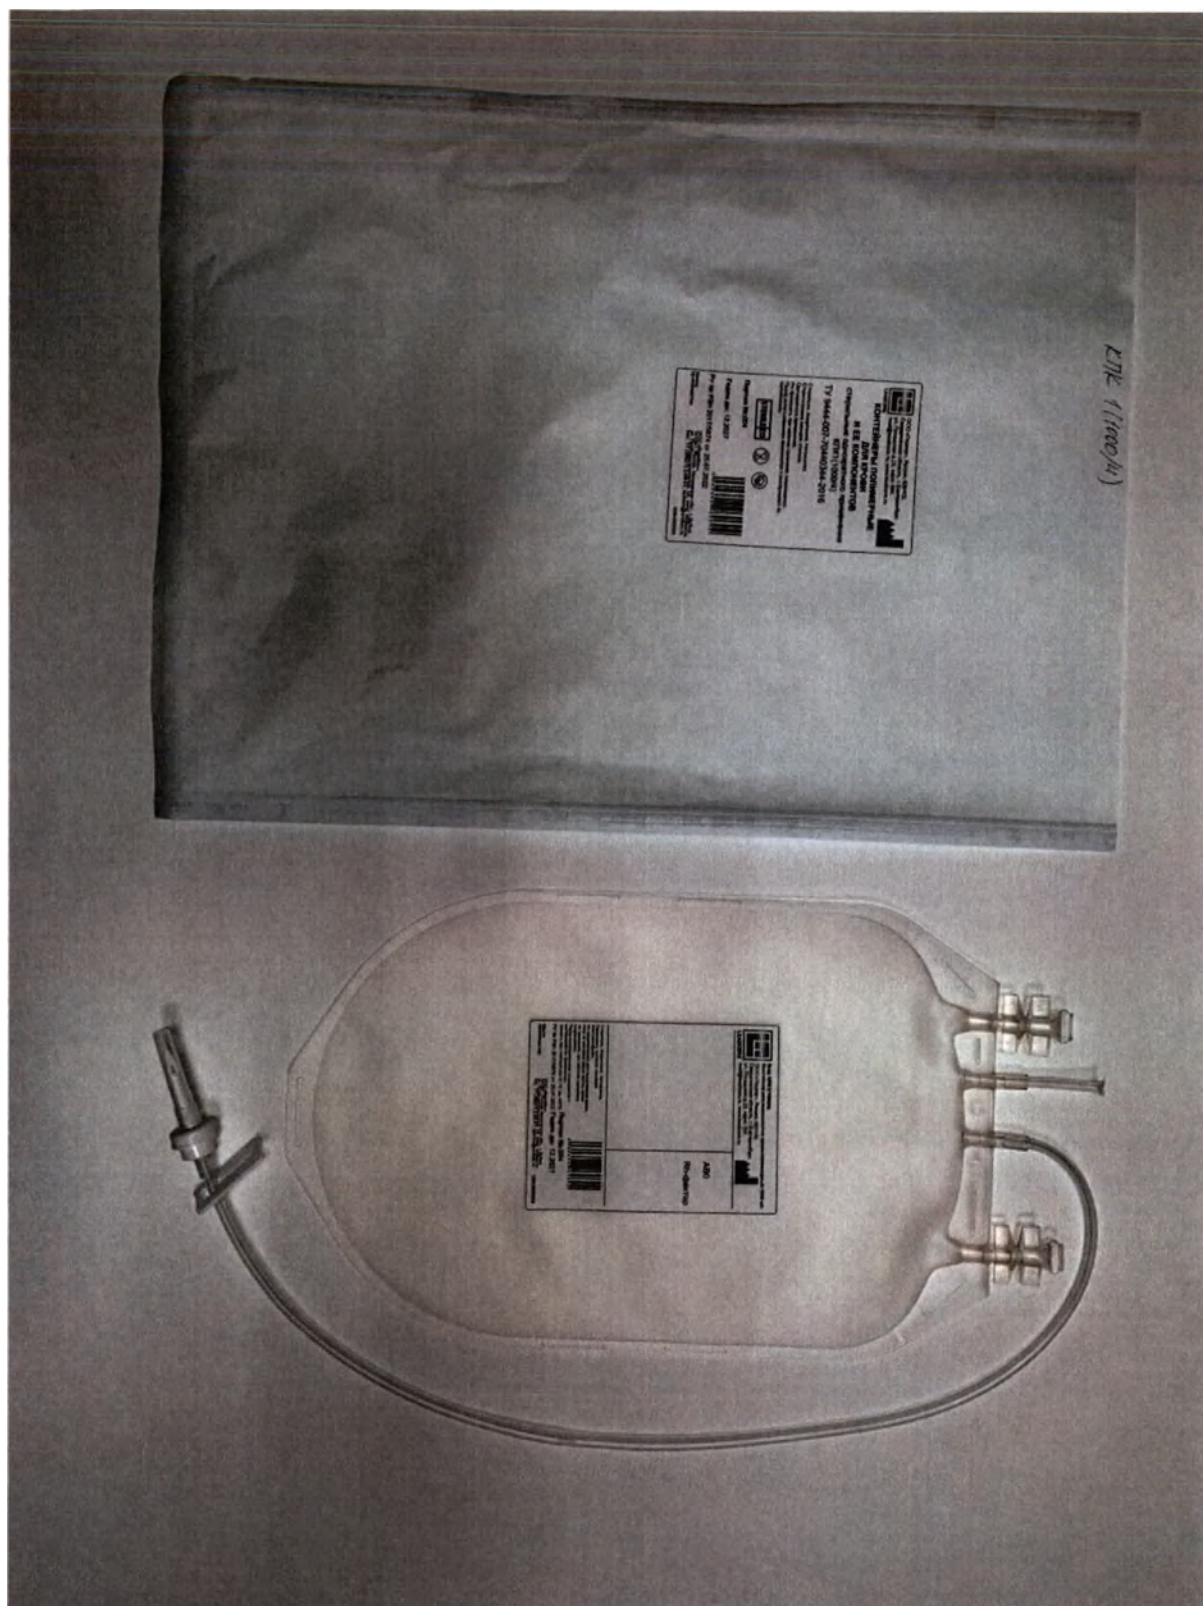



ООО «Лидкор»,
Россия, 620102, Свердловская область,
г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская стр.23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



КОНТЕЙНЕРЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ

стерильные однократного применения
КПК1(1000/4)

ТУ 9444-007-70440344-2016

Стерильно, Апирогенно, Нетоксично.
Стерилизовано оксидом этилена.
Однократного применения.
Не применять при наличии признаков повреждения.
Перед использованием ознакомится с инструкцией по
применению.



Партия №:005

Годен до: 03.2028



ПУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022

Место
производства:


ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

000-000000

 LEADCORE	Вид: КПК1(1000/4) Контейнер для компонентов крови полимерный 1000 мл ООО «Лидкор», Россия, 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская стр.23, офис 204 mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru 
	AB0 Rh-фактор
Стерильно, Апиrogenно, Нетоксично. Переливать согласно приказам гемотрансфузии. Не предназначено для переливания крови, пока не наклеена марка группы крови. Не применять при наличии признаков повреждения. Перед использованием ознакомится с инструкцией по применению. Хранить при температуре от +5° до +40°С Партия №:005 РУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022 Годен до: 03.2028 Место производства: ООО «Виробан» 141981, Россия, Московская обл., г. Дубна ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru 000-000000  6 1969696 11969692	

- КПК1(1500/4) однокамерный с четырьмя портами 1500 мл с шглой полимерной одноканальной;

Общий вид:

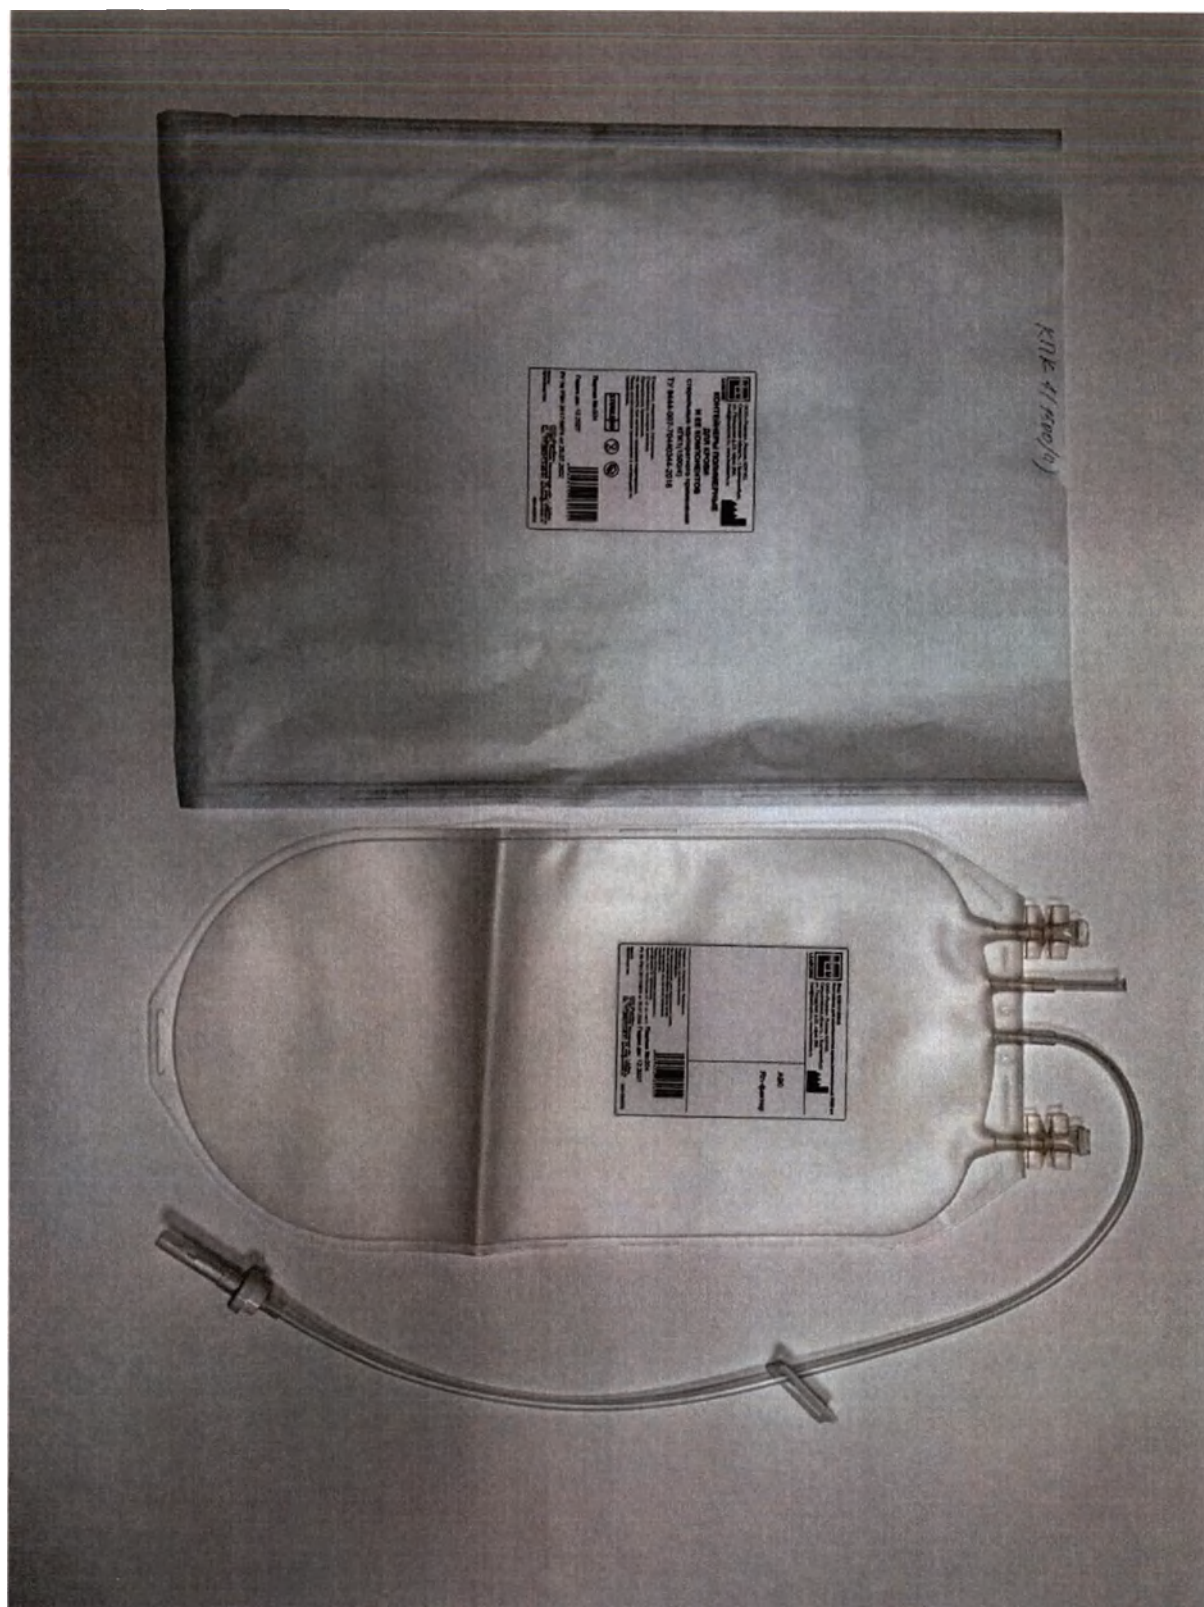



ООО «Лидкор»,
Россия, 620102, Свердловская область,
г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская стр.23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



КОНТЕЙНЕРЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ

стерильные однократного применения
КПК1(1500/4)

ТУ 9444-007-70440344-2016

Стерильно, Апирогенно, Нетоксично.
Стерилизовано оксидом этилена.
Однократного применения.
Не применять при наличии признаков повреждения.
Перед использованием ознакомится с инструкцией по
применению.



Партия №:005

Годен до: 03.2028



6 969696 969692

ПУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022

Место
производства:


ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

000-000000

	Вид: КПК1(1500/4) Контейнер для компонентов крови полимерный 1500 мл ООО «Лидкор», Россия, 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская стр.23, офис 204 mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru 
	AB0 Rh-фактор
Стерильно, Апиrogenно, Нетоксично. Переливать согласно приказам гемотрансфузии. Не предназначено для переливания крови, пока не наклеена марка группы крови. Не применять при наличии признаков повреждения. Перед использованием ознакомится с инструкцией по применению. Хранить при температуре от +5° до +40°С Партия №:005 Годен до: 03.2028 ПУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022 Место производства: ООО «Виробан» 141981, Россия, Московская обл., г. Дубна ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru 000-000000 	

- КПК1(300)2 однокамерный 300 мл с двумя иглами полимерными одноканальными;

Общий вид:

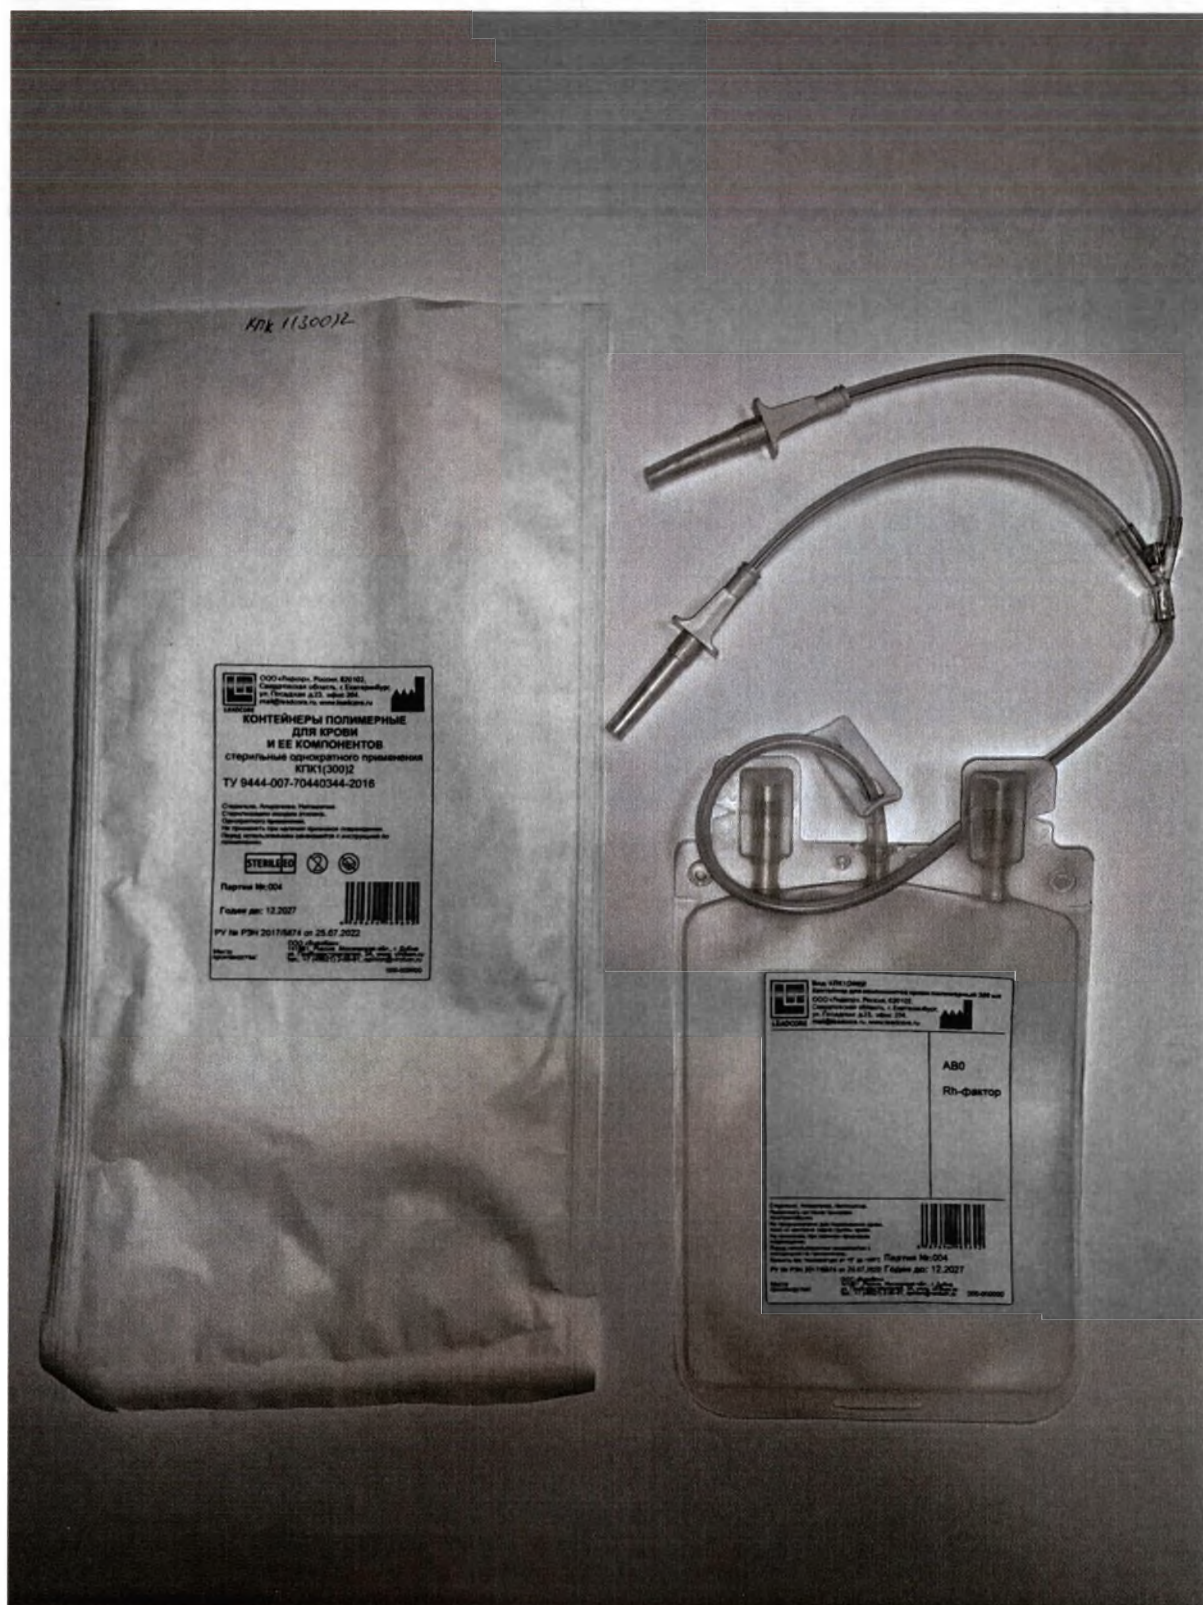

Этикетка пакета упаковочного (тары потребительской):



LEADCORE

ООО «Лидкор»,
Россия, 620102, Свердловская область,
г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская стр.23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



**КОНТЕЙНЕРЫ ПОЛИМЕРНЫЕ
ДЛЯ КРОВИ
И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ**

стерильные однократного применения
КПК1(300)2

ТУ 9444-007-70440344-2016

Стерильно, Апирогенно, Нетоксично.
Стерилизовано оксидом этилена.
Однократного применения.
Не применять при наличии признаков повреждения.
Перед использованием ознакомится с инструкцией по
применению.



Партия №:005

Годен до: 03.2028



6 969696 196969 2

ПУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022

Место
производства:

ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

000-000000



LEADCORE

Вид: КПК1(300)2

Контейнер для компонентов крови полимерный 300 мл

ООО «Лидкор»,

Россия, 620102, Свердловская область,

г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,

ул. Посадская стр.23, офис 204

mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



AB0

Rh-фактор

Стерильно, Алирогенно, Нетоксично.

Переливать согласно приказам
гемотрансфузии.

Не предназначено для переливания крови,
пока не наклеена марка группы крови.

Не применять при наличии признаков
повреждения.

Перед использованием ознакомится с
инструкцией по применению.

Хранить при температуре от +5° до +40°C



6 19 69 69 6 19 69 69 2 1

Партия №:005

РУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022 Годен до: 03.2028

Место
производства:

ООО «Виробан»


141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru

тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

000-000000

- КПК1(500)2 однокамерный 500 мл с двумя иглами полимерными одноканальными;

Общий вид:

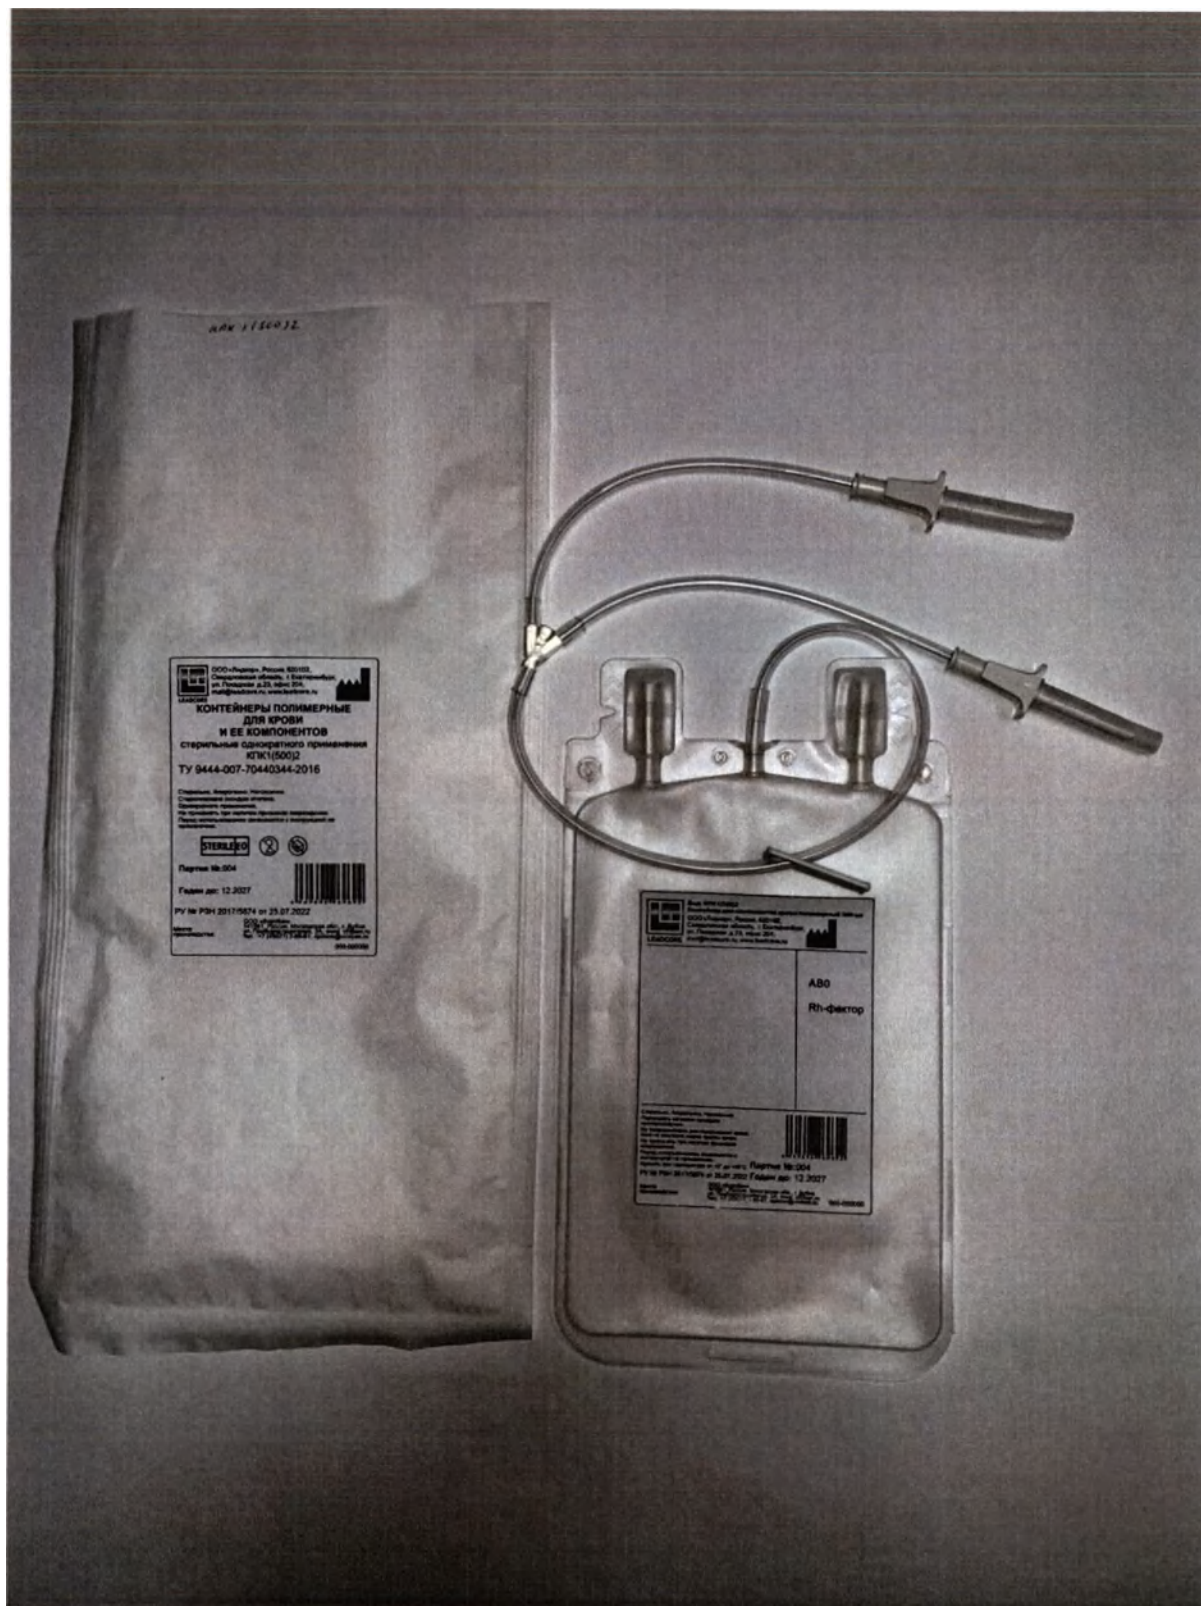



LEADCORE

ООО «Лидкор»,
Россия, 620102, Свердловская область,
г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская стр.23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



**КОНТЕЙНЕРЫ ПОЛИМЕРНЫЕ
ДЛЯ КРОВИ
И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ**

стерильные однократного применения

КПК1(500)2

ТУ 9444-007-70440344-2016

Стерильно, Апирогенно, Нетоксично.

Стерилизовано оксидом этилена.

Однократного применения.

Не применять при наличии признаков повреждения.

Перед использованием ознакомится с инструкцией по применению.



Партия №:005

Годен до: 03.2028



6 969696 196969 2

ПУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022

Место
производства:

ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

000-000000



Вид: КПК1(500)2
Контейнер для компонентов крови полимерный 500 мл
ООО «Лидкор»,
Россия, 620102, Свердловская область,
г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская стр.23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



AB0

Rh-фактор

Стерильно, Апиrogenно, Нетоксично.
Переливать согласно приказам
гемотрансфузии.
Не предназначено для переливания крови,
пока не наклеена марка группы крови.
Не применять при наличии признаков
повреждения.

Перед использованием ознакомится с
инструкцией по применению.
Хранить при температуре от +5° до +40°С



6 19 6 9 6 9 6 1 9 6 9 6 9 2 1

Партия №:005

РУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022 Годен до: 03.2028


Место
производства:

ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

000-000000

- КПК1(1000)2 однокамерный 1000 мл с двумя иглами полимерными
одноканальными;

Общий вид:

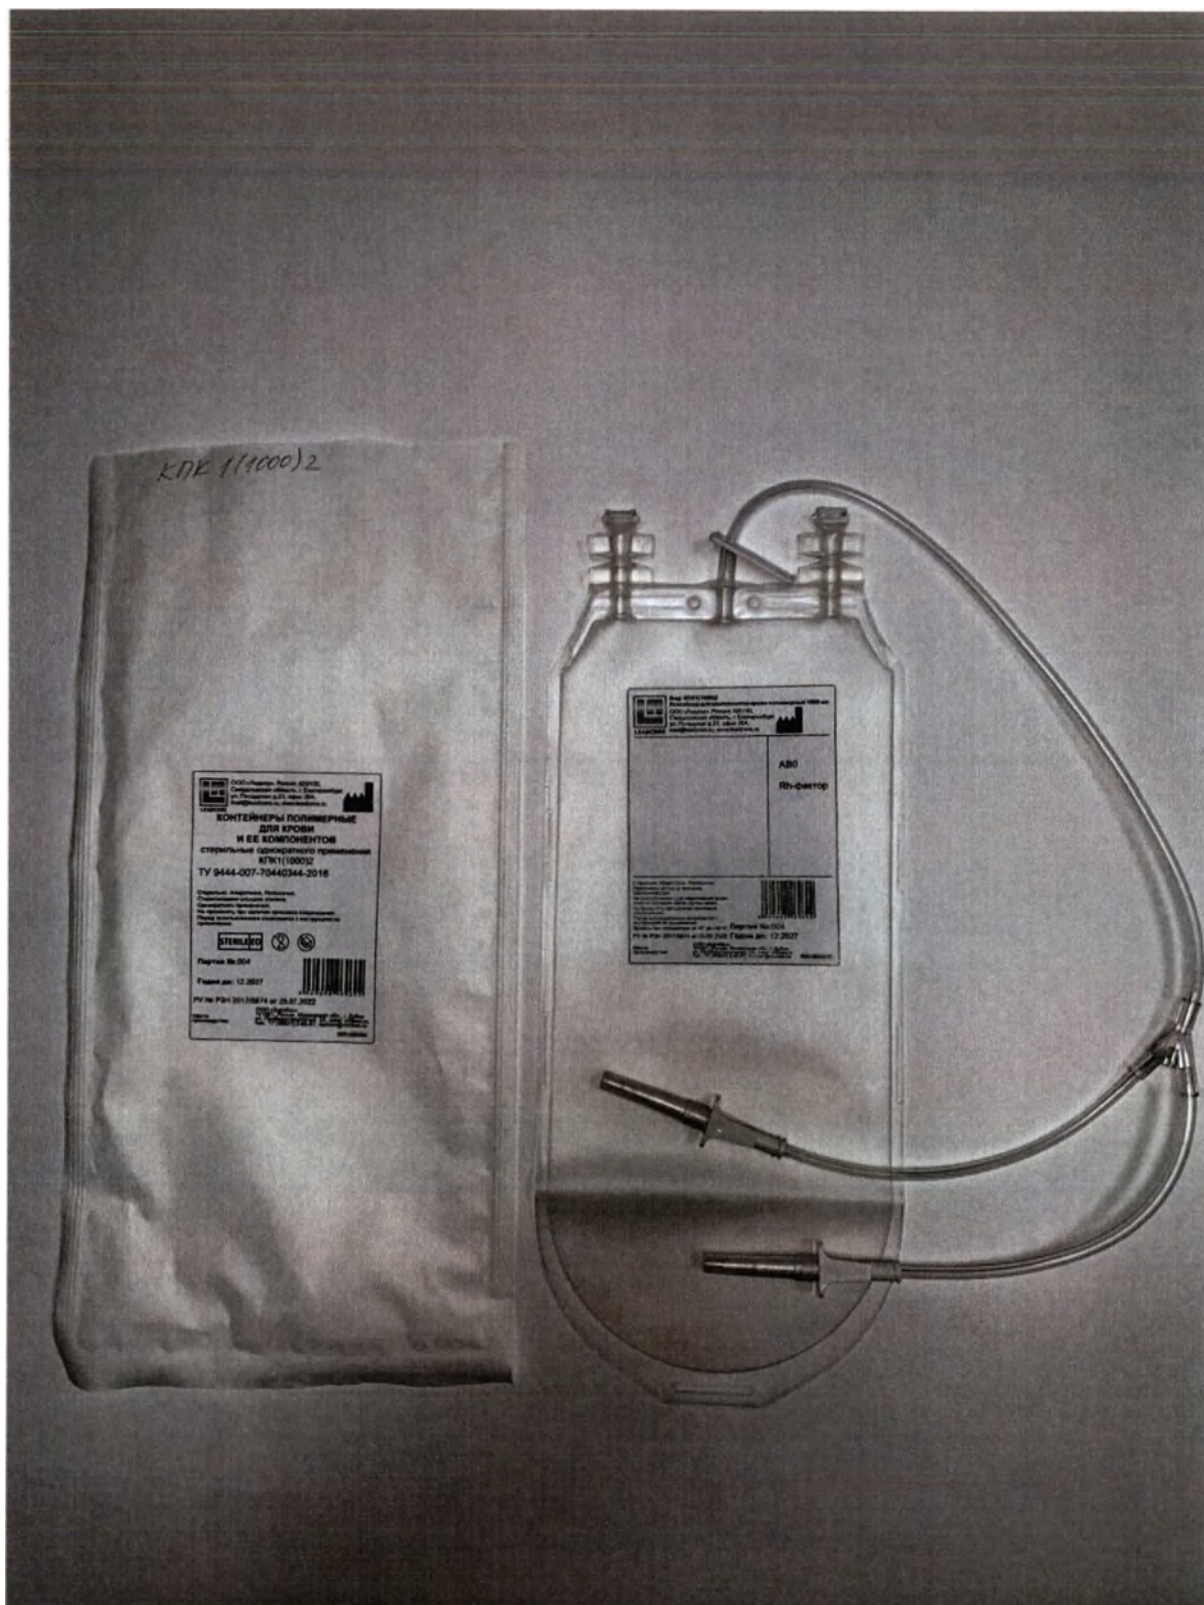



LEADCORE

ООО «Лидкор»,
Россия, 620102, Свердловская область,
г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская стр.23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



КОНТЕЙНЕРЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ

стерильные однократного применения
КПК1(1000)2

ТУ 9444-007-70440344-2016

Стерильно, Апирогенно, Нетоксично.

Стерилизовано оксидом этилена.

Однократного применения.

Не применять при наличии признаков повреждения.

Перед использованием ознакомится с инструкцией по применению.



Партия №:005

Годен до: 03.2028



6 969696 196969 2

РУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022

Место
производства:

ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

000-000000

Этикетка контейнера:



LEADCORE

Вид: КПК1(1000)2

Контейнер для компонентов крови полимерный 1000 мл

ООО «Лидкор».

Россия, 620102, Свердловская область,

г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,

ул. Посадская стр.23, офис 204

mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



AB0

Rh-фактор

Стерильно, Апиrogenно, Нетоксично.

Переливать согласно приказам
гемотрансфузии.

Не предназначено для переливания крови,
пока не наклеена марка группы крови.

Не применять при наличии признаков
повреждения.

Перед использованием ознакомится с
инструкцией по применению.

Хранить при температуре от +5° до +40°С



6 19 69 69 61 19 69 69 2

Партия №:005

РУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022 Годен до: 03.2028


Место
производства:

ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

000-000000

- КПК2(300)1 двухкамерный 300 мл с иглой полимерной одноканальной;

Общий вид:

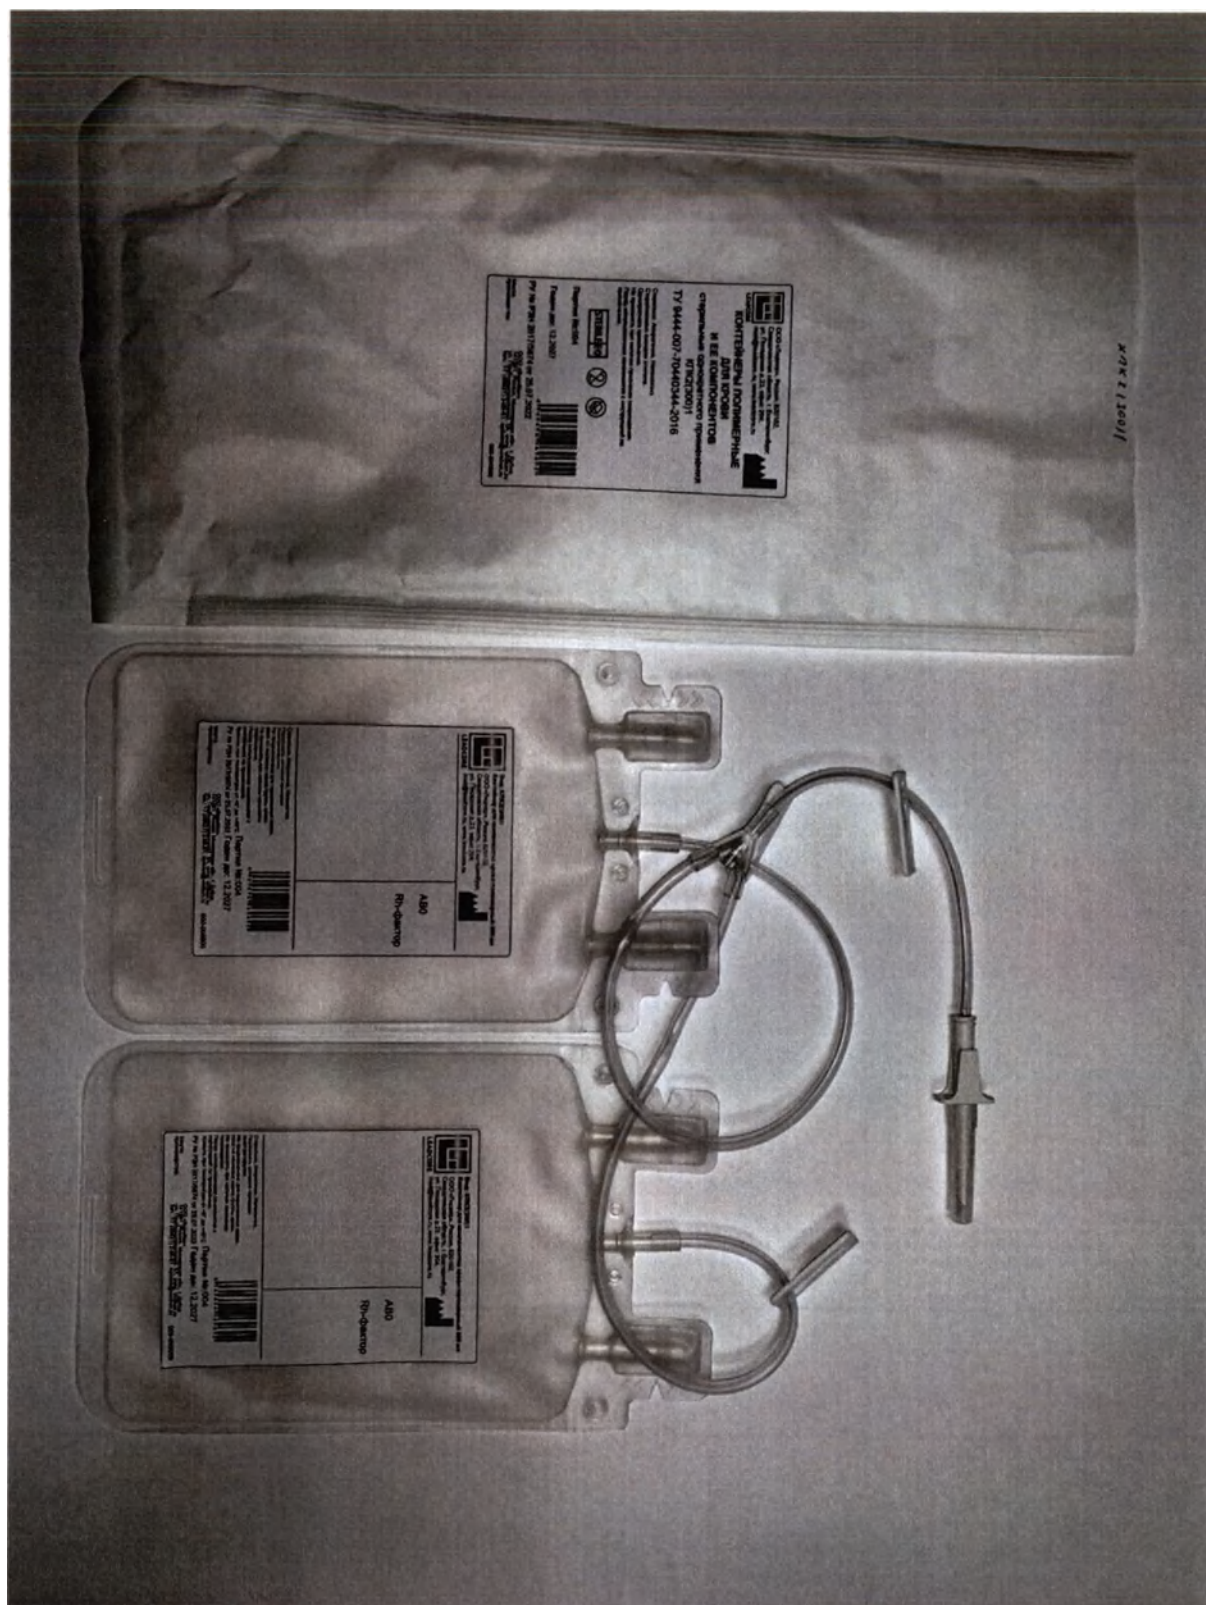



ООО «Лидкор»,
Россия, 620102, Свердловская область,
г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская стр.23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



**КОНТЕЙНЕРЫ ПОЛИМЕРНЫЕ
ДЛЯ КРОВИ
И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ**
стерильные однократного применения
КПК2(300)1
ТУ 9444-007-70440344-2016

Стерильно, Апирогенно, Нетоксично.
Стерилизовано оксидом этилена.
Однократного применения.
Не применять при наличии признаков повреждения.
Перед использованием ознакомится с инструкцией по
применению.



Партия №:005

Годен до: 03.2028



6 969696 196969 2

РУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022

Место
производства:

ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru
tel.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

000-000000



LEADCORE

Вид: КПК2(300)1

Контейнер для компонентов крови полимерный 300 мл

ООО «Лидкор»,

Россия, 620102, Свердловская область,

г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,

ул. Посадская стр. 23, офис 204

mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



AB0

Rh-фактор

Стерильно, Апиrogenно, Нетоксично.

Переливать согласно приказам
гемотрансфузии.

Не предназначено для переливания крови,
пока не наклеена марка группы крови.

Не применять при наличии признаков
повреждения.

Перед использованием ознакомится с
инструкцией по применению.

Хранить при температуре от +5° до +40°С



6 9 6 9 6 9 6 1 9 6 9 6 9 2

Партия №: 005

ПУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022 Годен до: 03.2028

Место
производства:

ООО «Виробан»

141981, Россия, Московская обл., г. Дубна


ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru

тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

000-000000

- КПК2(500)1 двухкамерный 500 мл с иглой полимерной одножильной;

Общий вид:

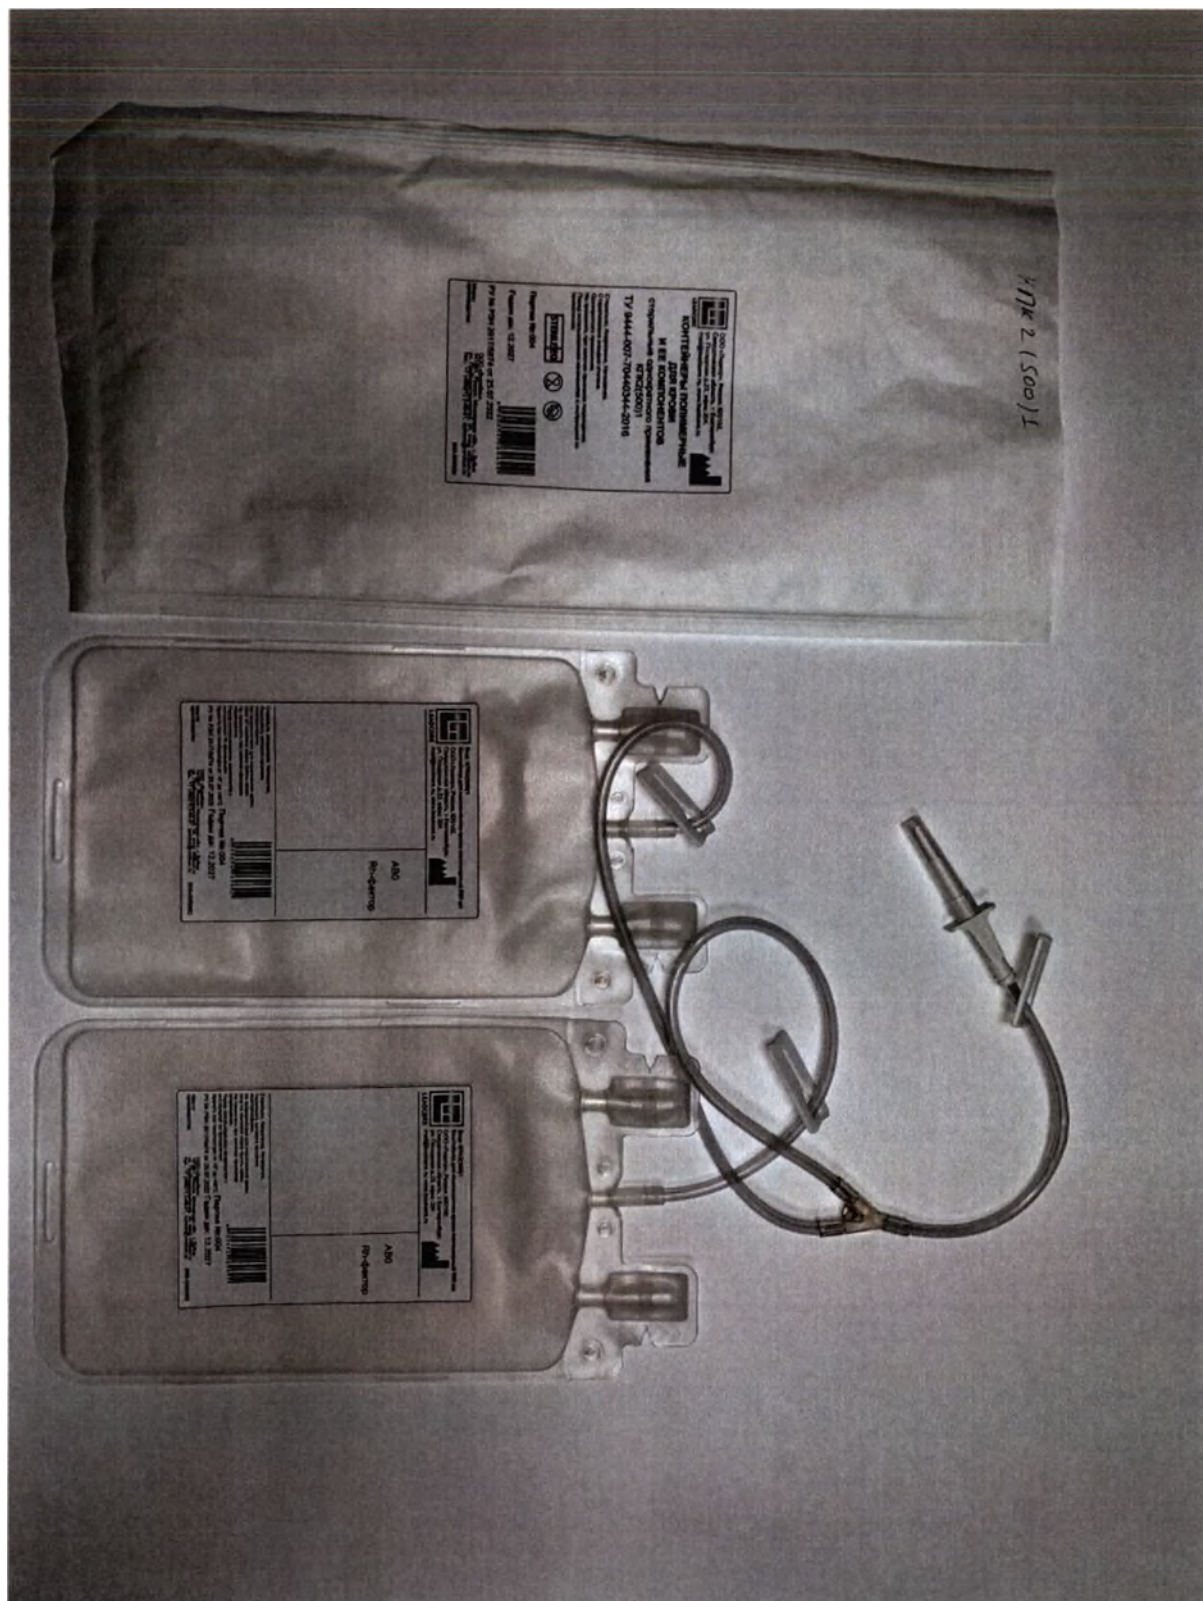



LEADCORE

ООО «Лидкор»,
Россия, 620102, Свердловская область,
г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская стр.23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



КОНТЕЙНЕРЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ

стерильные однократного применения
КПК2(500)1

ТУ 9444-007-70440344-2016

Стерильно, Апирогенно, Нетоксично.
Стерилизовано оксидом этилена.
Однократного применения.
Не применять при наличии признаков повреждения.
Перед использованием ознакомится с инструкцией по
применению.



Партия №:005

Годен до: 03.2028



6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 2

ПУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022

Место
производства:

ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

000-000000

Этикетка контейнера:



Вид: КПК2(500)1
Контейнер для компонентов крови полимерный 500 мл
ООО «Лидкор»,
Россия, 620102, Свердловская область,
г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская стр.23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



AB0

Rh-фактор

Стерильно, Апиrogenно, Нетоксично.
Переливать согласно приказам
гемотрансфузии.
Не предназначено для переливания крови,
пока не наклеена марка группы крови.
Не применять при наличии признаков
повреждения.
Перед использованием ознакомится с
инструкцией по применению.
Хранить при температуре от +5° до +40°С



6 969696 969692

Партия №:005

ПУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022 Годен до: 03.2028

Место
производства:

ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

000-000000

- КПК2(300)2 двухкамерный 300 мл с двумя иглами полимерными одноканальными;

Общий вид:



Этикетка пакета упаковочного (тары потребительской):



ООО «Лидкор»,
Россия, 620102, Свердловская область,
г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская стр.23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



**КОНТЕЙНЕРЫ ПОЛИМЕРНЫЕ
ДЛЯ КРОВИ
И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ**
стерильные однократного применения
КПК2(300)2
ТУ 9444-007-70440344-2016

Стерильно, Апирогенно, Нетоксично.
Стерилизовано оксидом этилена.
Однократного применения.
Не применять при наличии признаков повреждения.
Перед использованием ознакомится с инструкцией по
применению.



Партия №:005

Годен до: 03.2028



ПУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022

Место
производства:

ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

000-000000



LEADCORE

Вид: КПК2(300)2

Контейнер для компонентов крови полимерный 300 мл

ООО «Лидкор»,

Россия, 620102, Свердловская область,

г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,

ул. Посадская стр. 23, офис 204

mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



AB0

Rh-фактор

Стерильно, Апиrogenно, Нетоксично.

Переливать согласно приказам
гемотрансфузии.

Не предназначено для переливания крови,
пока не наклеена марка группы крови.

Не применять при наличии признаков
повреждения.

Перед использованием ознакомится с
инструкцией по применению.

Хранить при температуре от +5° до +40°С



6 1969696 196969 2

Партия №:005

ПУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022 Годен до: 03.2028


Место
производства:

ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

000-000000

- КПК2(500)2 двухкамерный 500 мл с двумя иглами полимерными одноканальными;

Общий вид:

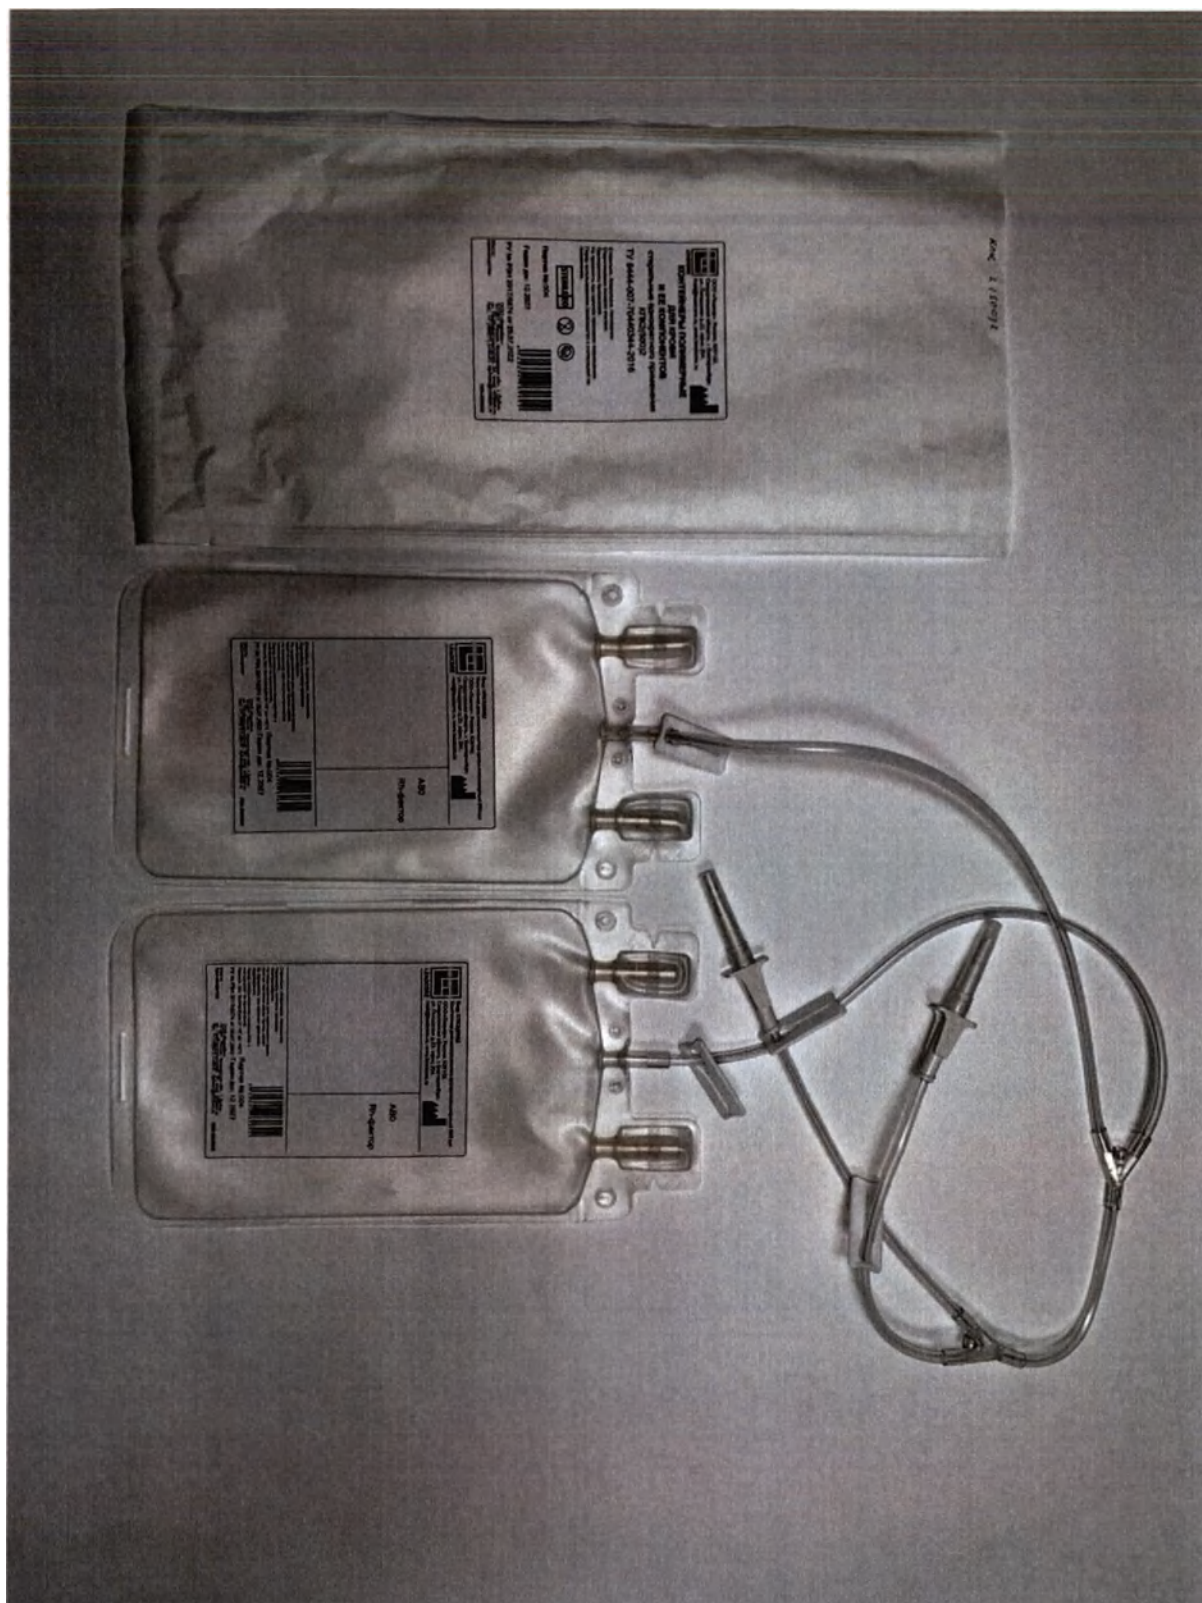



ООО «Лидкор»,
Россия, 620102, Свердловская область,
г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская стр.23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



КОНТЕЙНЕРЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ

**стерильные однократного применения
КПК2(500)2**

ТУ 9444-007-70440344-2016

Стерильно, Апирогенно, Нетоксично.

Стерилизовано оксидом этилена.

Однократного применения.

Не применять при наличии признаков повреждения.

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией по применению.



Партия №:005

Годен до: 03.2028



6 9 6 9 6 9 6 1 9 6 9 6 9 2 1

ПУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022

Место
производства:


ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

000-000000

 LEADCORE	Вид: КПК2(500)2 Контейнер для компонентов крови полимерный 500 мл ООО «Лидкор», Россия, 620102, Свердловская область, г.О. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская стр.23, офис 204 mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru	
		AB0 Rh-фактор
Стерильно, Алирогенно, Нетоксично. Переливать согласно приказам гемотрансфузии. Не предназначено для переливания крови, пока не наклеена марка группы крови. Не применять при наличии признаков повреждения. Перед использованием ознакомится с инструкцией по применению. Хранить при температуре от +5° до +40°С		 6 969696 969692 Партия №:005 Годен до: 03.2028
Место производства:	ООО «Виробан» 141981, Россия, Московская обл., г. Дубна ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru тел.: +7 (49621) 2-88-81, opinion@viroban.ru	
		000-000000

- КПК4(300)1 четырехкамерный 300 мл с иглой полимерной двухканальной;

Общий вид:

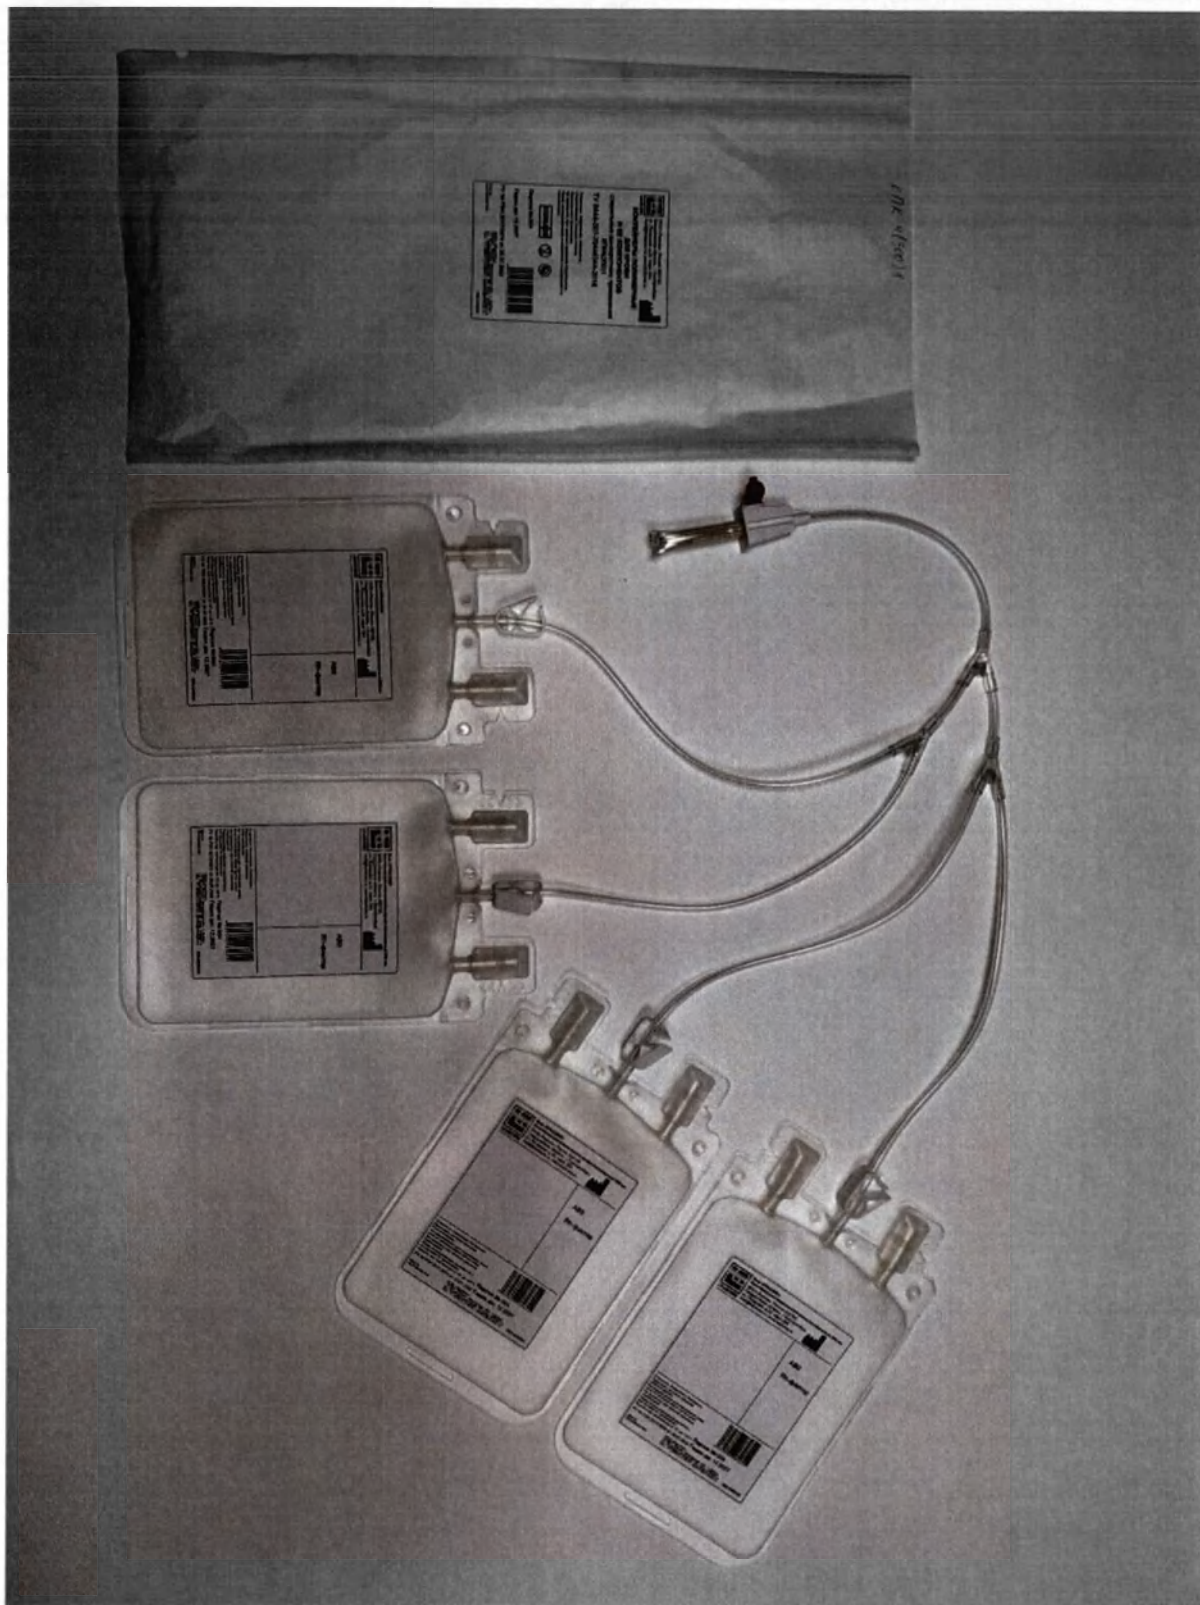

Этикетка пакета упаковочного (тары потребительской):



ООО «Лидкор»,
Россия, 620102, Свердловская область,
г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская стр.23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



**КОНТЕЙНЕРЫ ПОЛИМЕРНЫЕ
для КРОВИ
и ЕЕ КОМПОНЕНТОВ**
стерильные однократного применения
КПК4(300)1
ТУ 9444-007-70440344-2016

Стерильно, Апирогенно, Нетоксично.
Стерилизовано оксидом этилена.
Однократного применения.
Не применять при наличии признаков повреждения.
Перед использованием ознакомится с инструкцией по
применению.



Партия №:005

Годен до: 03.2028



6 969696 969692

РУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022

Место
производства:

ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

000-000000

Этикетка контейнера:



Вид: КПК4(300)1
Контейнер для компонентов крови полимерный 300 мл
ООО «Лидкор»,
Россия, 620102, Свердловская область,
г.О. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская стр.23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



AB0

Rh-фактор

Стерильно, Апиrogenно, Нетоксично.
Переливать согласно приказам
гемотрансфузии.
Не предназначено для переливания крови,
пока не наклеена марка группы крови.
Не применять при наличии признаков
повреждения.
Перед использованием ознакомится с
инструкцией по применению.
Хранить при температуре от +5° до +40°C



6 969696 969692

Партия №:005

ПУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022 Годен до: 03.2028


Место
производства:

ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

000-000000

- КПК 692-2;

Общий вид:

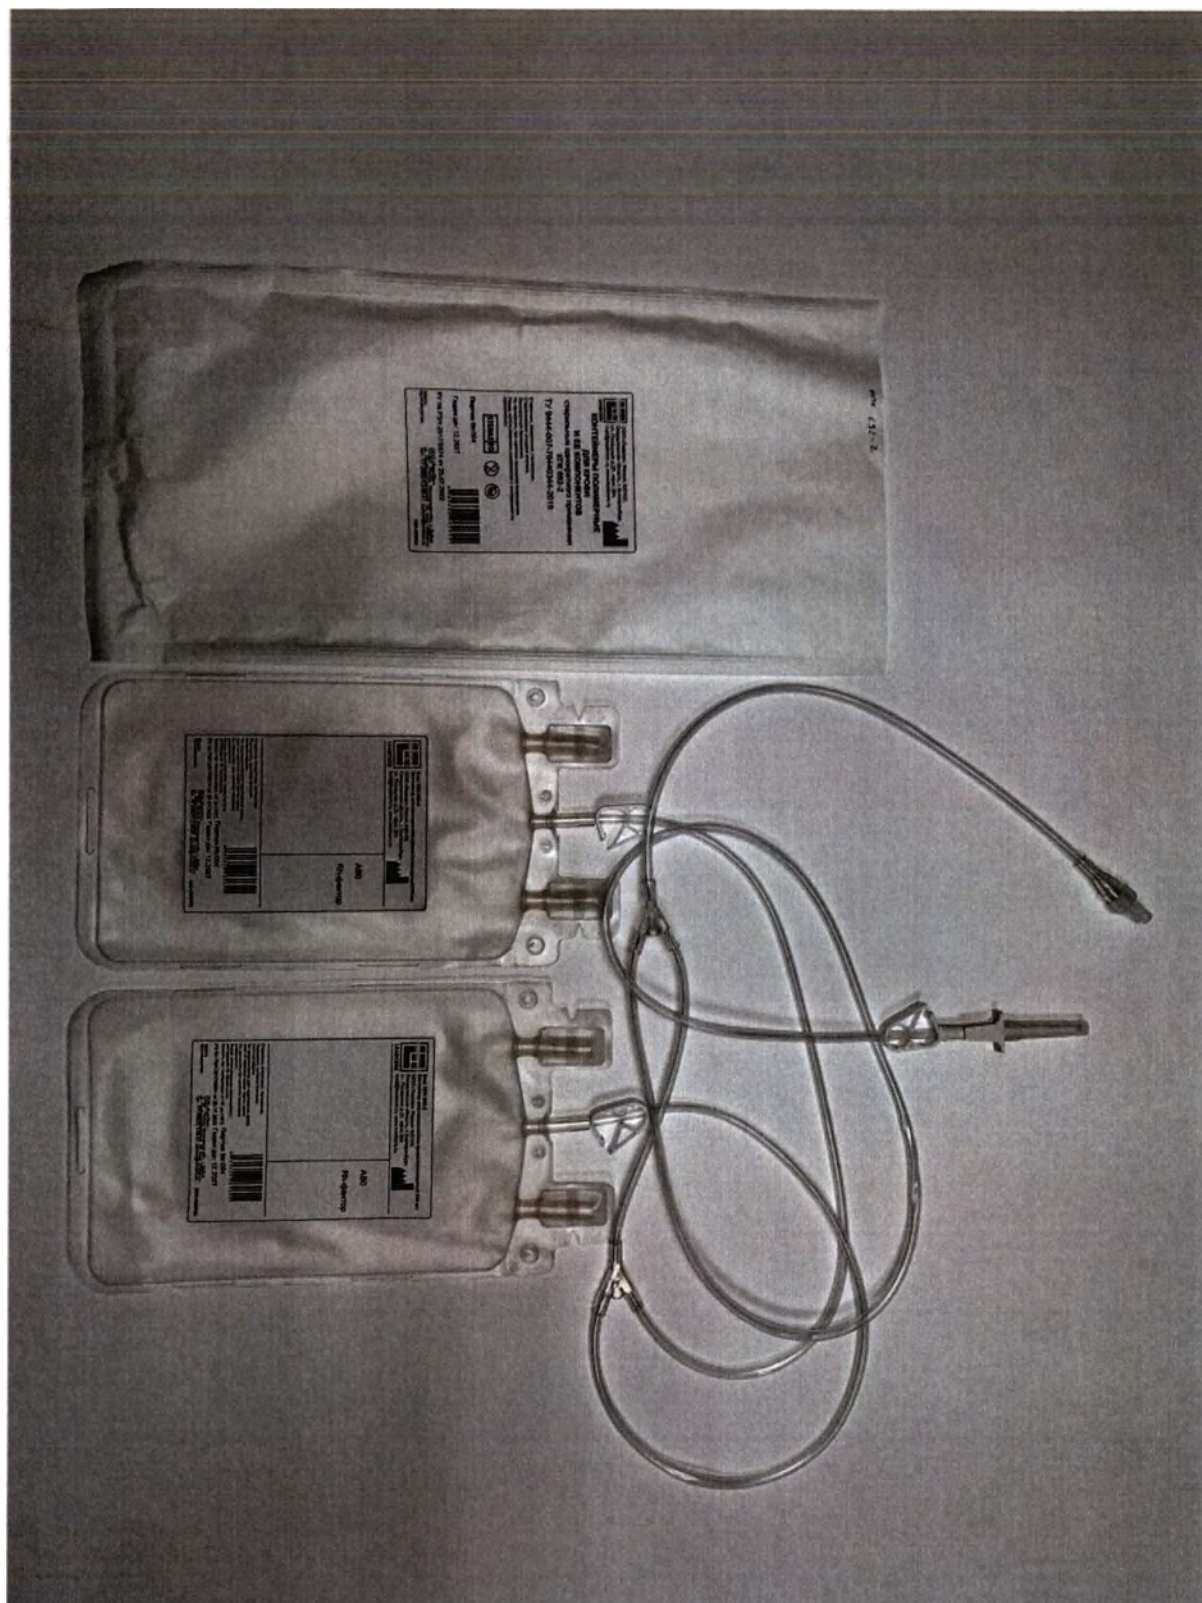



ООО «Лидкор»,
Россия, 620102, Свердловская область,
г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская стр.23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



**КОНТЕЙНЕРЫ ПОЛИМЕРНЫЕ
ДЛЯ КРОВИ
И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ**
стерильные однократного применения
КПК 692-2
ТУ 9444-007-70440344-2016

Стерильно, Апирогенно, Нетоксично.
Стерилизовано оксидом этилена.
Однократного применения.
Не применять при наличии признаков повреждения.
Перед использованием ознакомится с инструкцией по
применению.



Партия №:005

Годен до: 03.2028



6 969696 969692

РУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022

Место
производства:


ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

000-000000

	Вид: КПК 692-2 Контейнер для компонентов крови полимерный 500 мл ООО «Лидкор», Россия, 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская стр. 23, офис 204 mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru 
	AB0 Rh-фактор
Стерильно, Апиrogenно, Нетоксично. Переливать согласно приказам гемотрансфузии. Не предназначено для переливания крови, пока не наклеена марка группы крови. Не применять при наличии признаков повреждения. Перед использованием ознакомится с инструкцией по применению. Хранить при температуре от +5° до +40°С Партия №:005 РУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022 Годен до: 03.2028 Место производства: ООО «Виробан» 141981, Россия, Московская обл., г. Дубна ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru  6 969696 969692 000-000000	

- КПК 692-4;

Общий вид:

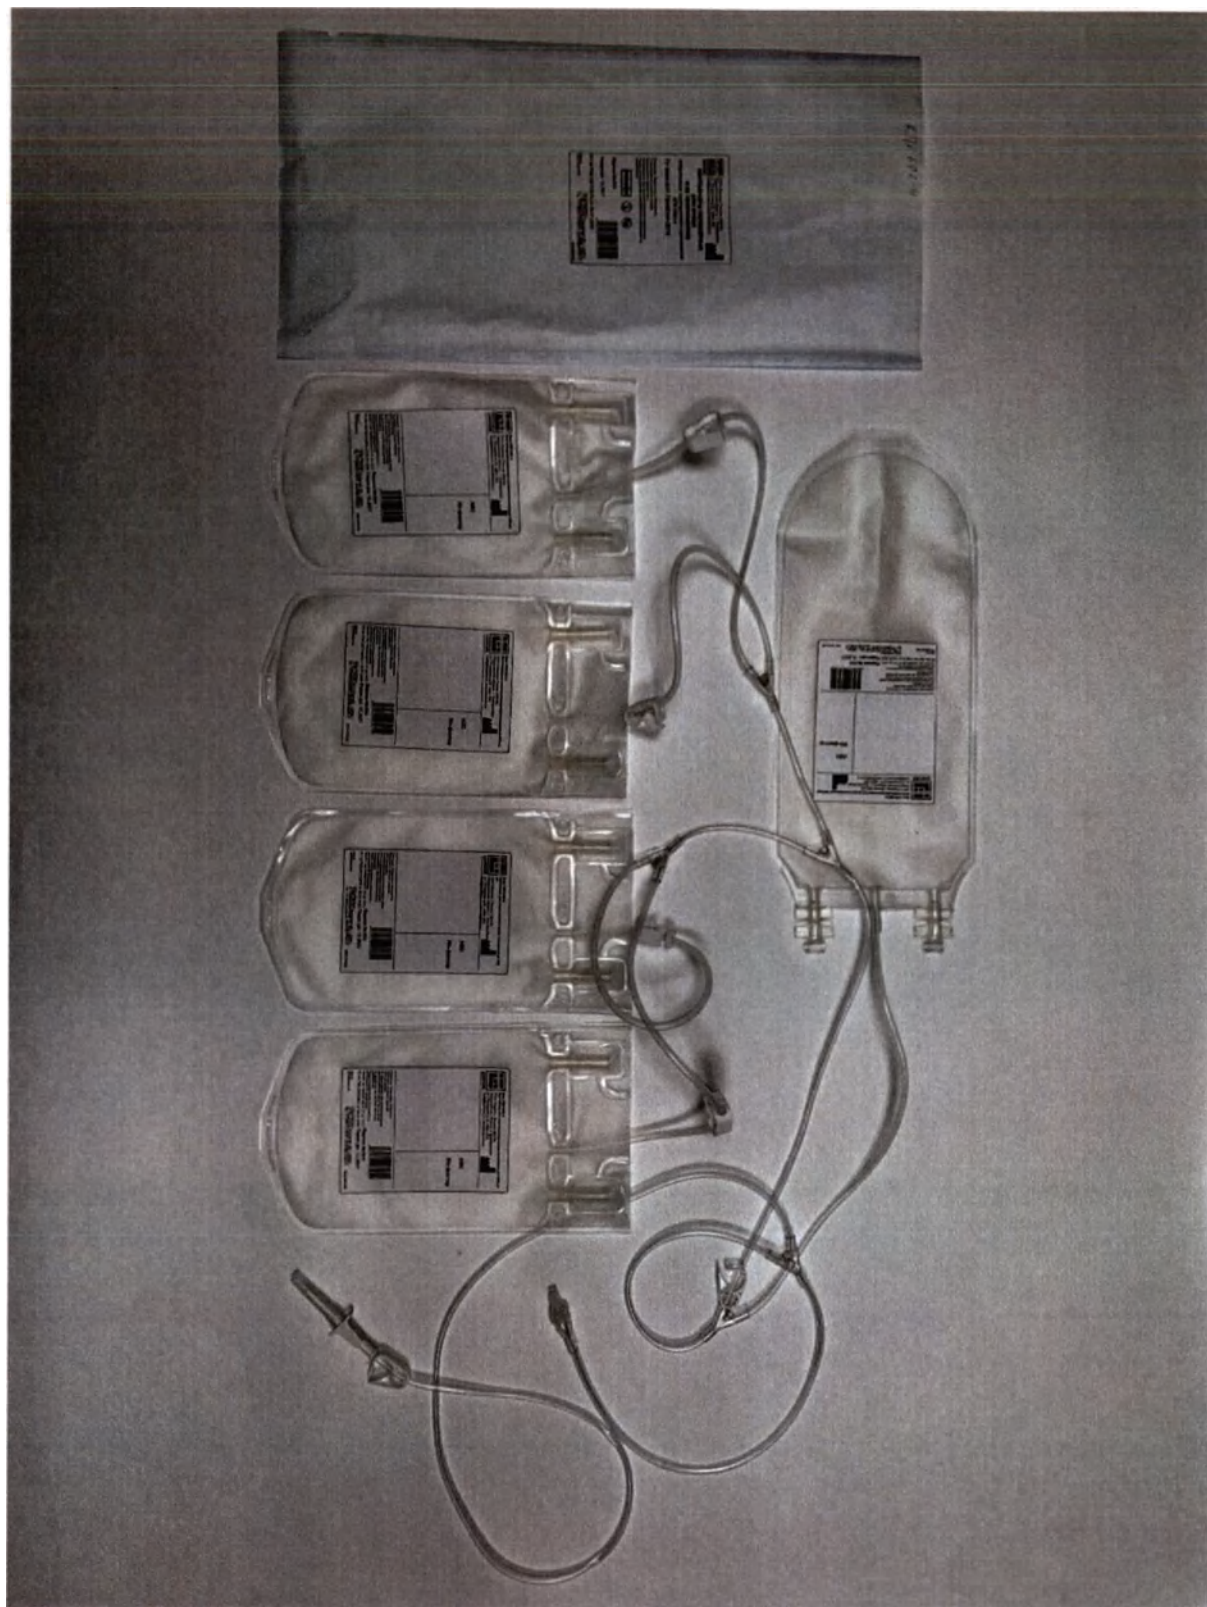

Этикетка пакета упаковочного (тары потребительской):



ООО «Лидкор»,
Россия, 620102, Свердловская область,
г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская стр. 23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



КОНТЕЙНЕРЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ

стерильные однократного применения
КПК 692-4

ТУ 9444-007-70440344-2016

Стерильно, Апиrogenно, Нетоксично.
Стерилизовано оксидом этилена.
Однократного применения.
Не применять при наличии признаков повреждения.
Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией по
применению.



Партия №:005

Годен до: 03.2028



6 969696 196962

ПУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022

Место
производства:

ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

000-000000

Этикетка контейнера: (1000 мл.).

	Вид: КПК 692-4 Контейнер для компонентов крови полимерный 1000 мл ООО «Лидкор», Россия, 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская стр.23, офис 204 mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru			
	AB0 Rh-фактор			
Стерильно, Апиrogenно, Нетоксично. Переливать согласно приказам гемотрансфузии. Не предназначено для переливания крови, пока не наклеена марка группы крови. Не применять при наличии признаков повреждения. Перед использованием ознакомится с инструкцией по применению. Хранить при температуре от +5° до +40°С Партия №:005 Годен до: 03.2028 РУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022 <table border="0"><tr><td>Место производства:</td><td>ООО «Виробан» 141981, Россия, Московская обл., г. Дубна ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru</td><td>000-000000</td></tr></table>		Место производства:	ООО «Виробан» 141981, Россия, Московская обл., г. Дубна ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru	000-000000
Место производства:	ООО «Виробан» 141981, Россия, Московская обл., г. Дубна ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru	000-000000		



Вид: КПК 692-4
Контейнер для компонентов крови полимерный 300 мл
ООО «Лидкор»,
Россия, 620102, Свердловская область,
г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская стр.23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



AB0

Rh-фактор

Стерильно, Апиrogenно, Нетоксично.

Переливать согласно приказам
гемотрансфузии.

Не предназначено для переливания крови,
пока не наклеена марка группы крови.

Не применять при наличии признаков
повреждения.

Перед использованием ознакомится с
инструкцией по применению.

Хранить при температуре от +5° до +40°C



6 119 69 69 6 119 69 69 2 11

Партия №:005

РУ № РЗН 2017/5874 от 25.07.2022 Годен до: 03.2028

Место
производства:

ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru
тел.: +7 (49621) 2-88-81, opinion@viroban.ru

000-000000

**II Тара транспортная (вторичная упаковка) для всех вариантов исполнения согласно
ТУ 9444-007-70440344-2016:**

- КПК1(300) однокамерный 300 мл с иглой полимерной одноканальной;
- КПК1(500) однокамерный 500 мл с иглой полимерной одноканальной;
- КПК1(1000) однокамерный 1000 мл с иглой полимерной одноканальной;
- КПК1(300)PL однокамерный 300 мл с иглой полимерной одноканальной для хранения тромбоцитов;
- КПК1(500)PL однокамерный 500 мл с иглой полимерной одноканальной для хранения тромбоцитов;
- КПК1(1000)PL однокамерный 1000 мл с иглой полимерной одноканальной для хранения тромбоцитов;
- КПК1(500/4) однокамерный с четырьмя портами 500 мл с иглой полимерной одноканальной;
- КПК1(600/4) однокамерный с четырьмя портами 600 мл с иглой полимерной одноканальной;
- КПК1(1000/4) однокамерный с четырьмя портами 1000 мл с иглой полимерной одноканальной;
- КПК1(1500/4) однокамерный с четырьмя портами 1500 мл с иглой полимерной одноканальной;
- КПК1(300)2 однокамерный 300 мл с двумя иглами полимерными одноканальными;
- КПК1(500)2 однокамерный 500 мл с двумя иглами полимерными одноканальными;
- КПК1(1000)2 однокамерный 1000 мл с двумя иглами полимерными одноканальными;
- КПК2(300)1 двухкамерный 300 мл с иглой полимерной одноканальной;
- КПК2(500)1 двухкамерный 500 мл с иглой полимерной одноканальной;
- КПК2(300)2 двухкамерный 300 мл с двумя иглами полимерными одноканальными;
- КПК2(500)2 двухкамерный 500 мл с двумя иглами полимерными одноканальными;
- КПК4(300)1 четырехкамерный 300 мл с иглой полимерной двухканальной;
- КПК 692-2;
- КПК 692-4.

1. Общий вид транспортной тары (вторичной упаковки):



2. Маркировка транспортной тары (вторичной упаковки):



Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

64 (шестьдесят четыре) л.



/Е. Ю. Гохгут/