



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «Лидкор»


Е.Ю. Гохгут
«13» марта 2023 г.

Макеты этикеток на медицинское изделие

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ КРОВИ
по ТУ 9464-027-70440344-2015 в вариантах исполнения

Устройство для фильтрации крови» по ТУ 9464-027-70440344-2015

в вариантах исполнения

Макет маркировки пакета упаковочного (тары потребительской):

- с лейкофильтром GLT



LEADCORE



ООО «Лидкор» Россия, 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204
marketing@leadcore.ru; www.leadcore.ru

**УСТРОЙСТВО
ДЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ КРОВИ
с лейкофильтром GLT
ТУ 9464-027-70440344-2015**

STERILE EO



Стерильно, апирогенно, нетоксично.
Стерилизовано оксидом этилена.
Однократного применения.
Не применять при наличии признаков повреждения.
Перед использованием ознакомится с инструкцией по применению.

Партия №: 000

Годен до: 00.0000



6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 2

РУ № РЗН 2016/4607 от 25.07.2022 г.

Место
производства:

ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, д.3а, www.viroban.ru
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

000-000000

Устройство для фильтрации крови» по ТУ 9464-027-70440344-2015

в вариантах исполнения

Макет индивидуальной маркировки контейнера:

- с лейкофильтром GLT



Устройство для фильтрации крови с лейкофильтром GLT



ООО «Лидкор» Россия, 620102, Свердловская
область, г.о. город Екатеринбург, г.
Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204
marketing@leadcore.ru; www.leadcore.ru

300 мл

ABO

Rh-фактор

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией по применению.

Стерильно, апирогенно, нетоксично.

Переливать согласно приказам
гемотрансфузии.

Не предназначено для переливания крови,
пока не наклеена марка группы крови.

Не применять при наличии признаков
повреждения.

Хранить при температуре от +5°C до +40°C



Партия №: 000

ТУ 9464-027-70440344-2015

Годен до: 00.0000

ПУ № РЗН 2016/4607 от 25.07.2022 г.

Место
производства:

ООО «Виробан» 141981, Россия,
Московская обл., г. Дубна ул. Приборостроителей, 3а,
тел./факс: (49621) 28861
E-mail: opinion@viroban.ru

000-000000

Устройство для фильтрации крови» по ТУ 9464-027-70440344-2015

в вариантах исполнения

Макет индивидуальной маркировки контейнера:

- с лейкофильтром GLT



Устройство для фильтрации крови с лейкофильтром GLT



ООО «Лидкор» Россия, 620102, Свердловская
область, г.о. город Екатеринбург, г.
Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204
marketing@leadcore.ru; www.leadcore.ru

500 мл

ABO

Rh-фактор

Перед использованием ознакомится с инструкцией по применению.

Стерильно, апиrogenно, нетоксично.

Переливать согласно приказам
гемотрансфузии.

Не предназначено для переливания крови,
пока не наклеена марка группы крови.

Не применять при наличии признаков
повреждения.

Хранить при температуре от +5°C до +40°C



Партия №: 000

ТУ 9464-027-70440344-2015

Годен до: 00.0000

ПУ № РЗН 2016/4607 от 25.07.2022 г.

Место
производства:

ООО «Виробан» 141981, Россия,
Московская обл., г. Дубна ул. Приборостроителей, 3а,
тел./факс: (49621) 28861
E-mail: opinion@viroban.ru

000-000000

Устройство для фильтрации крови» по ТУ 9464-027-70440344-2015

в вариантах исполнения

Макет этикетки транспортной тары:

- с лейкофильтром GLT



ООО «Лидкор» Россия, 620102, Свердловская
область, г.о. город Екатеринбург, г.
Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204
marketing@leadcore.ru; www.leadcore.ru

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ КРОВИ

Вариант исполнения: с лейкофильтром GLT

ТУ 9464-027-70440344-2015

Партия №: 000

Годен до: 00.0000

Брутто: кг

Кол-во: шт



Стерильно. Алирогенно. Нетоксично.
Хранить при температуре от +5 до +40°C

ПУ № РЗН 2016/4607 от 25.07.2022 г.

ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, д.3а, www.viroban.ru
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

Место
производства:



000-000000

Устройство для фильтрации крови» по ТУ 9464-027-70440344-2015
в вариантах исполнения
Макет маркировки пакета упаковочного (тары потребительской):
- с лейкофильтром WBF3



LEADCORE



ООО «Лидкор» Россия, 620102, Свердловская
область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская, стр. 23, офис 204
marketing@leadcore.ru; www.leadcore.ru

**УСТРОЙСТВО
ДЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ КРОВИ
с лейкофильтром WBF3
ТУ 9464-027-70440344-2015**

STERILE EO



Стерильно, апиrogenно, нетоксично.
Стерилизовано оксидом этилена.
Однократного применения.
Не применять при наличии признаков повреждения.
Перед использованием ознакомится с инструкцией по применению.

Партия №: 000

Годен до: 00.0000



6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 2

РУ № РЗН 2016/4607 от 25.07.2022 г.

Место
производства:

ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, д.3а, www.viroban.ru
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

000-000000

Устройство для фильтрации крови» по ТУ 9464-027-70440344-2015

в вариантах исполнения

Макет индивидуальной маркировки контейнера:

- с лейкофильтром WBF3



Устройство для фильтрации крови с лейкофильтром WBF3



ООО «Лидкор» Россия, 620102, Свердловская
область, г.о. город Екатеринбург, г.
Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204
marketing@leadcore.ru; www.leadcore.ru

300 мл

ABO

Rh-фактор

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией по применению.

Стерильно, апирогенно, нетоксично.

Переливать согласно приказам
гемотрансфузии.

Не предназначено для переливания крови,
пока не наклеена марка группы крови.

Не применять при наличии признаков
повреждения.

Хранить при температуре от +5°C до +40°C



Партия №: 000

ТУ 9464-027-70440344-2015

Годен до: 00.0000

ПУ № РЗН 2016/4607 от 25.07.2022 г.

Место
производства:

ООО «Виробан» 141981, Россия,
Московская обл., г. Дубна ул. Приборостроителей, 3а,
тел./факс: (49621) 28861
E-mail: opinion@viroban.ru

000-000000

Устройство для фильтрации крови» по ТУ 9464-027-70440344-2015
в вариантах исполнения
Макет индивидуальной маркировки контейнера:
- с лейкофильтром WBF3



LEADCORE

Устройство для фильтрации крови с лейкофильтром WBF3



ООО «Лидкор» Россия, 620102, Свердловская
область, г.о. город Екатеринбург, г.
Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204
marketing@leadcore.ru; www.leadcore.ru

500 мл

ABO

Rh-фактор

Перед использованием ознакомится с инструкцией по применению.

Стерильно, апирогенно, нетоксично.

Переливать согласно приказам
гемотрансфузии.

Не предназначено для переливания крови,
пока не наклеена марка группы крови.

Не применять при наличии признаков
повреждения.

Хранить при температуре от +5°C до +40°C



Партия №: 000

ТУ 9464-027-70440344-2015

Годен до: 00.0000

ПУ № РЗН 2016/4607 от 25.07.2022 г.

Место
производства:

ООО «Виробан» 141981, Россия,
Московская обл., г. Дубна ул. Приборостроителей, 3а,
тел./факс: (49621) 28861
E-mail: opinion@viroban.ru

000-000000

Устройство для фильтрации крови» по ТУ 9464-027-70440344-2015
в вариантах исполнения
Макет этикетки транспортной тары:
- с лейкофильтром WBF3



ООО «Лидкор» Россия, 620102, Свердловская
область, г.о. город Екатеринбург, г.
Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204
marketing@leadcore.ru; www.leadcore.ru

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ КРОВИ

Вариант исполнения: с лейкофильтром WBF3
ТУ 9464-027-70440344-2015

Партия №: 000

Годен до: 00.0000

Брутто: кг

Кол-во: шт



Стерильно. Апиrogenно. Нетоксично.
Хранить при температуре от +5 до +40°C

ПУ № РЗН 2016/4607 от 25.07.2022 г.

ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, д3а, www.viroban.ru
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru



Место
производства:

000-000000

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

9 (деветь) л.



Директор
ООО «ЛИДКОР»

[Signature] /Е. Ю. Гохгут/



LEADCORE

ООО «ЛИДКОР»



«Утверждаю»

Директор

ООО «ЛИДКОР»

Е. Ю. Гохгут

«29» марта 2023 г.

Фотографические изображения медицинского изделия

Устройство для фильтрации крови по ТУ 9464-027-70440344-2015

Устройство для фильтрации крови по ТУ 9464-027-70440344-2015,
в вариантах исполнения:

- с лейкофильтром GLT;
- с лейкофильтром WBF3.


Устройство для фильтрации крови по ТУ 9464-027-70440344-2015,
вариант исполнения:

1. С лейкофильтром GLT


1.1. Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия



1.2 Маркировка упаковки

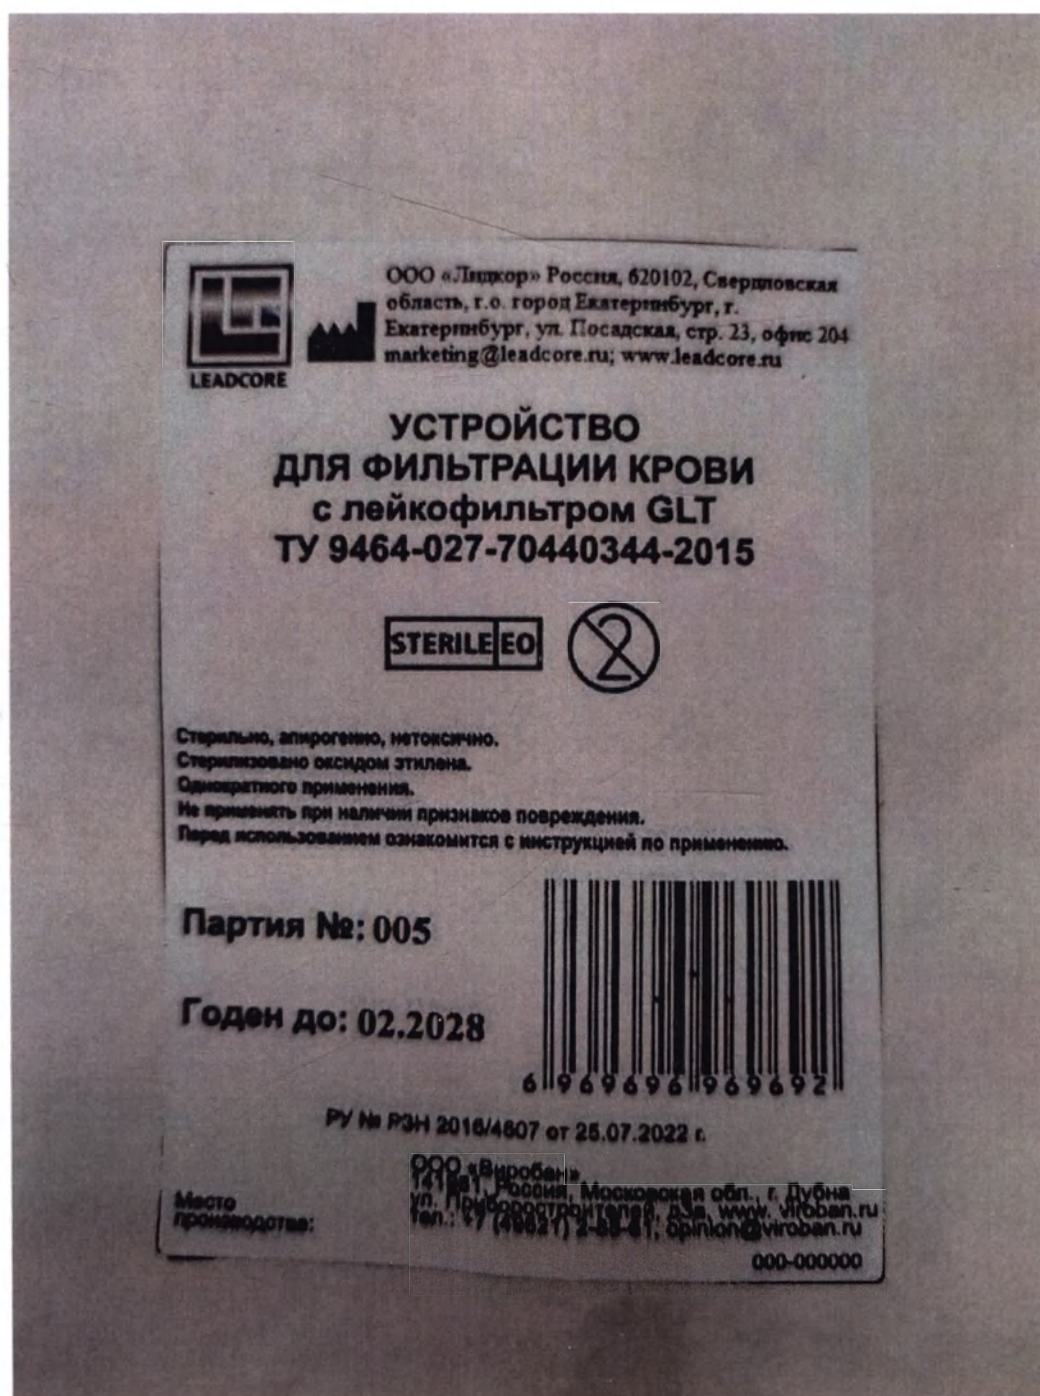

1.3 Маркировка медицинского изделия

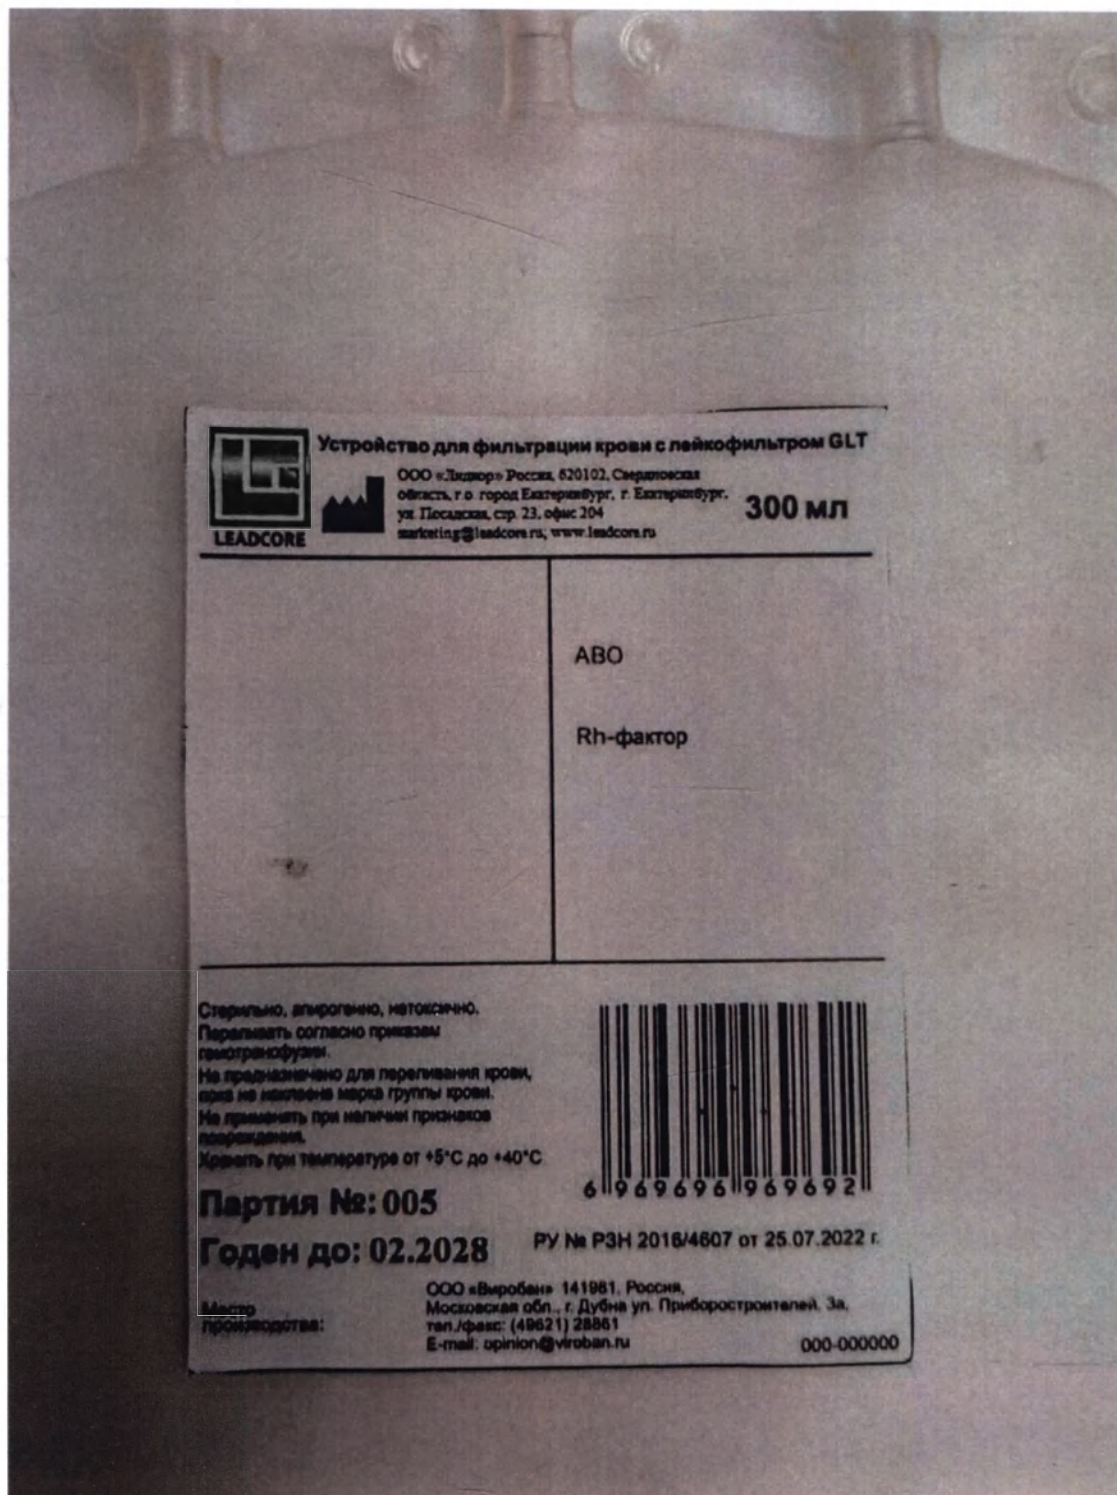



Устройство для фильтрации крови с лейкофильтром GLT



ООО «Лидкор» Россия, 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204
marketing@leadcore.ru; www.leadcore.ru

500 мл

ABO

Rh-фактор

Стерильно, апиrogenно, нетоксично.
Переливать согласно приказам
гемотрансфузии.
Не предназначено для переливания крови,
пока не наклеена марка группы крови.
Не применять при наличии признаков
повреждения.
Хранить при температуре от +5°C до +40°C



6 969696 969692

Партия №: 005

Годен до: 02.2028

РУ № РЗН 2016/4607 от 25.07.2022 г.

Место
производства:

ООО «Виробан» 141981, Россия,
Московская обл., г. Дубна ул. Приборостроителей, 3а.
тел./факс: (49621) 28861
E-mail: oripion@virban.ru

000-000000

Устройство для фильтрации крови по ТУ 9464-027-70440344-2015,
вариант исполнения:

2. С лейкофильтром WBF3.

2.1 Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия



2.2 Маркировка упаковки



LEADCORE

ООО «Лидкор» Россия, 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204
marketing@leadcore.ru; www.leadcore.ru

**УСТРОЙСТВО
ДЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ КРОВИ
с лейкофильтром WBF3
ТУ 9464-027-70440344-2015**

STERILE EO



Стерильно, апирогенно, нетоксично.
Стерилизовано оксидом этилена.
Однократного применения.
Не применять при наличии признаков повреждения.
Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией по применению.

Партия №: 005

Годен до: 02.2028




6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 2

РУ № РЗН 2016/4607 от 25.07.2022 г.

Место производства:

ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская обл., г. Дубна
ул. Приборостроителей, д.3а, www.viroban.ru
тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru
000-000000

2.3 Маркировка медицинского изделия

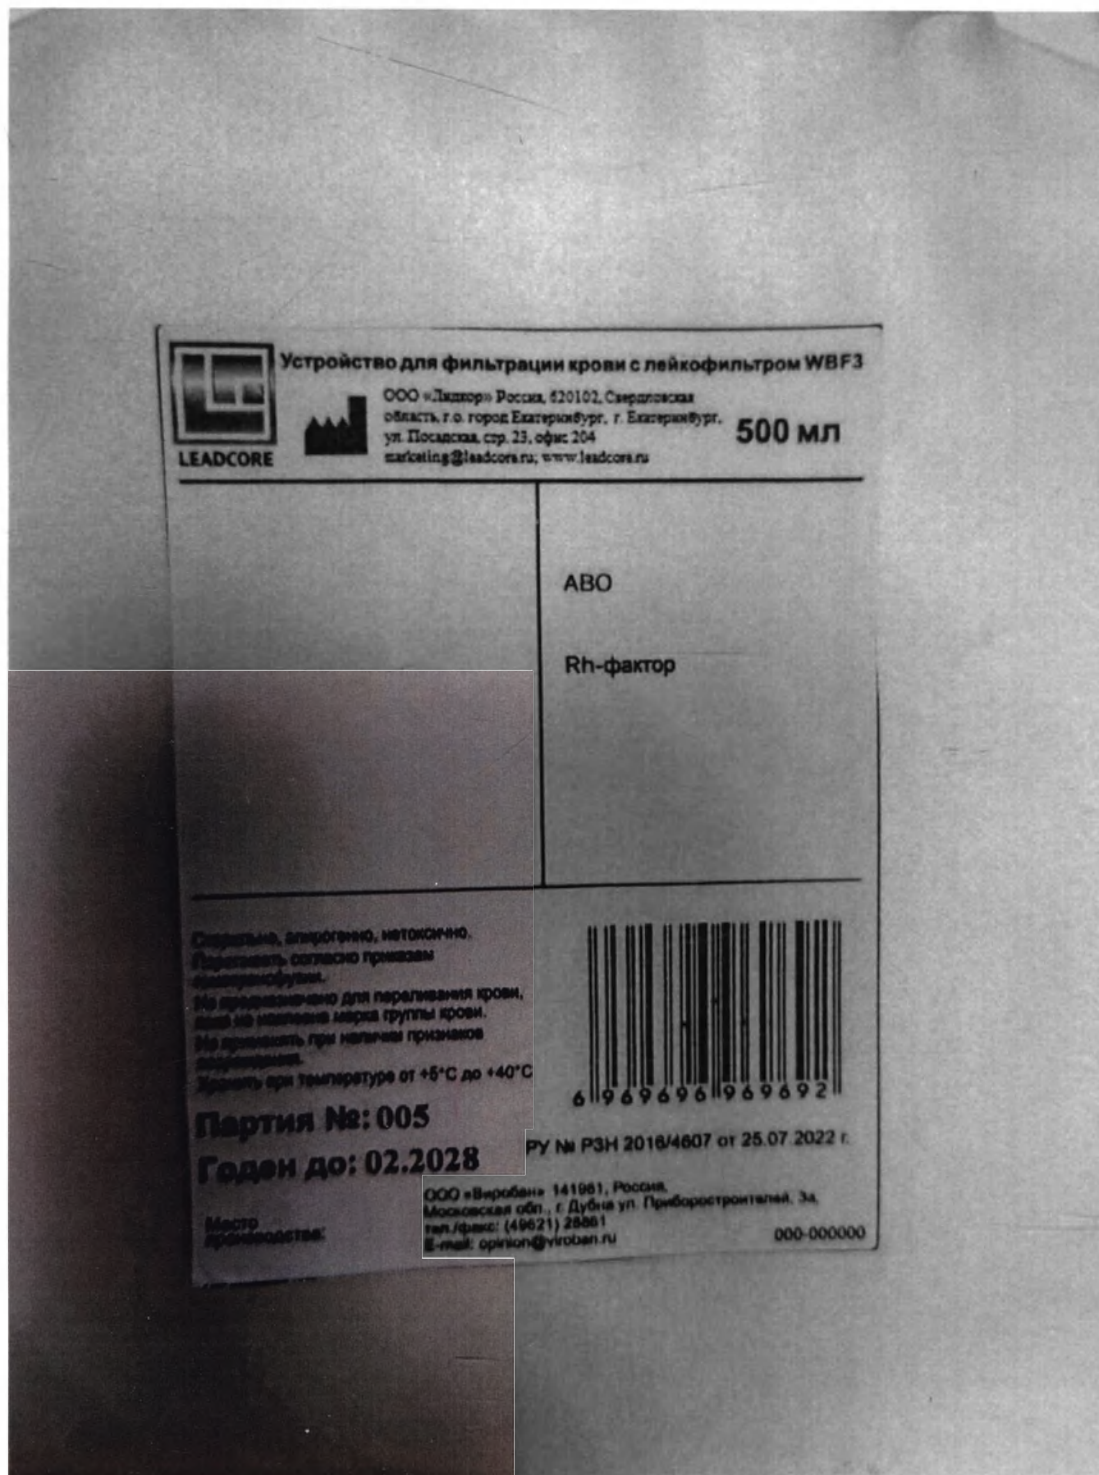



Устройство для фильтрации крови с лейкофильтром WBF3



ООО «Лидкор» Россия, 620102, Свердловская
область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская, стр. 23, офис 204
marketing@leadcore.ru, www.leadcore.ru

300 мл

ABO

Rh-фактор

Стерильно, апиrogenно, нетоксично.
Переливать согласно приказам
гемотрансфузии.
Не предназначено для переливания крови,
пока не наклеена марка группы крови.
Не применять при наличии признаков
повреждения.
Хранить при температуре от +5°C до +40°C.



Партия №: 005

Годен до: 02.2028

ПУ № РЗН 2016/4607 от 25.07.2022 г.

Место
производства:

ООО «Виробан» 141981, Россия,
Московская обл., г. Дубна ул. Приборостроитель. За.
тел./факс: (49621) 28861
E-mail: oprinion@viruban.ru

000-000000

II. Фотографические изображения вторичной упаковки и маркировки

Применимо для всех вариантов исполнения по ТУ 9464-027-70440344-2015

1. Фотографическое изображение транспортной упаковки



2. Фотографическое изображение маркировки транспортной упаковки


LEADCORE



ООО «Лидкор» Россия, 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204
marketing@leadcore.ru; www.leadcore.ru

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ КРОВИ

Вариант исполнения: с лейкофильтром WBF3

ТУ 9464-027-70440344-2015

Партия №: 005
Годен до: 02.2028
Брутто: кг
Кол-во: шт

STERILE EO









Стерильно. Апирогенно. Нетоксично.
Хранить при температуре от +5 до +40°C

ПУ № РЗН 2016/4607 от 25.07.2022 г.

Место производства: ООО «Виробан» 141981, Россия, Московская обл., г. Дубна ул. Приборостроителей, 3А, www.viroban.ru тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru


6 9 6 9 6 9 6 1 9 6 9 6 9 2 11
000-000000

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

12 (двенадцать) л.

Директор
ООО «ЛИДКОР»

/Е. Ю. Гохгут/

