



Генеральный директор
ООО «ГРУППА АЛЪЯНС»
Маханова Е.А.

ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

Миксер донорской крови с принадлежностями под торговой маркой Centron
Производства «Центрон Корпорейшн» (Centron Corporation), Корея

Миксер донорской крови модель CM735A

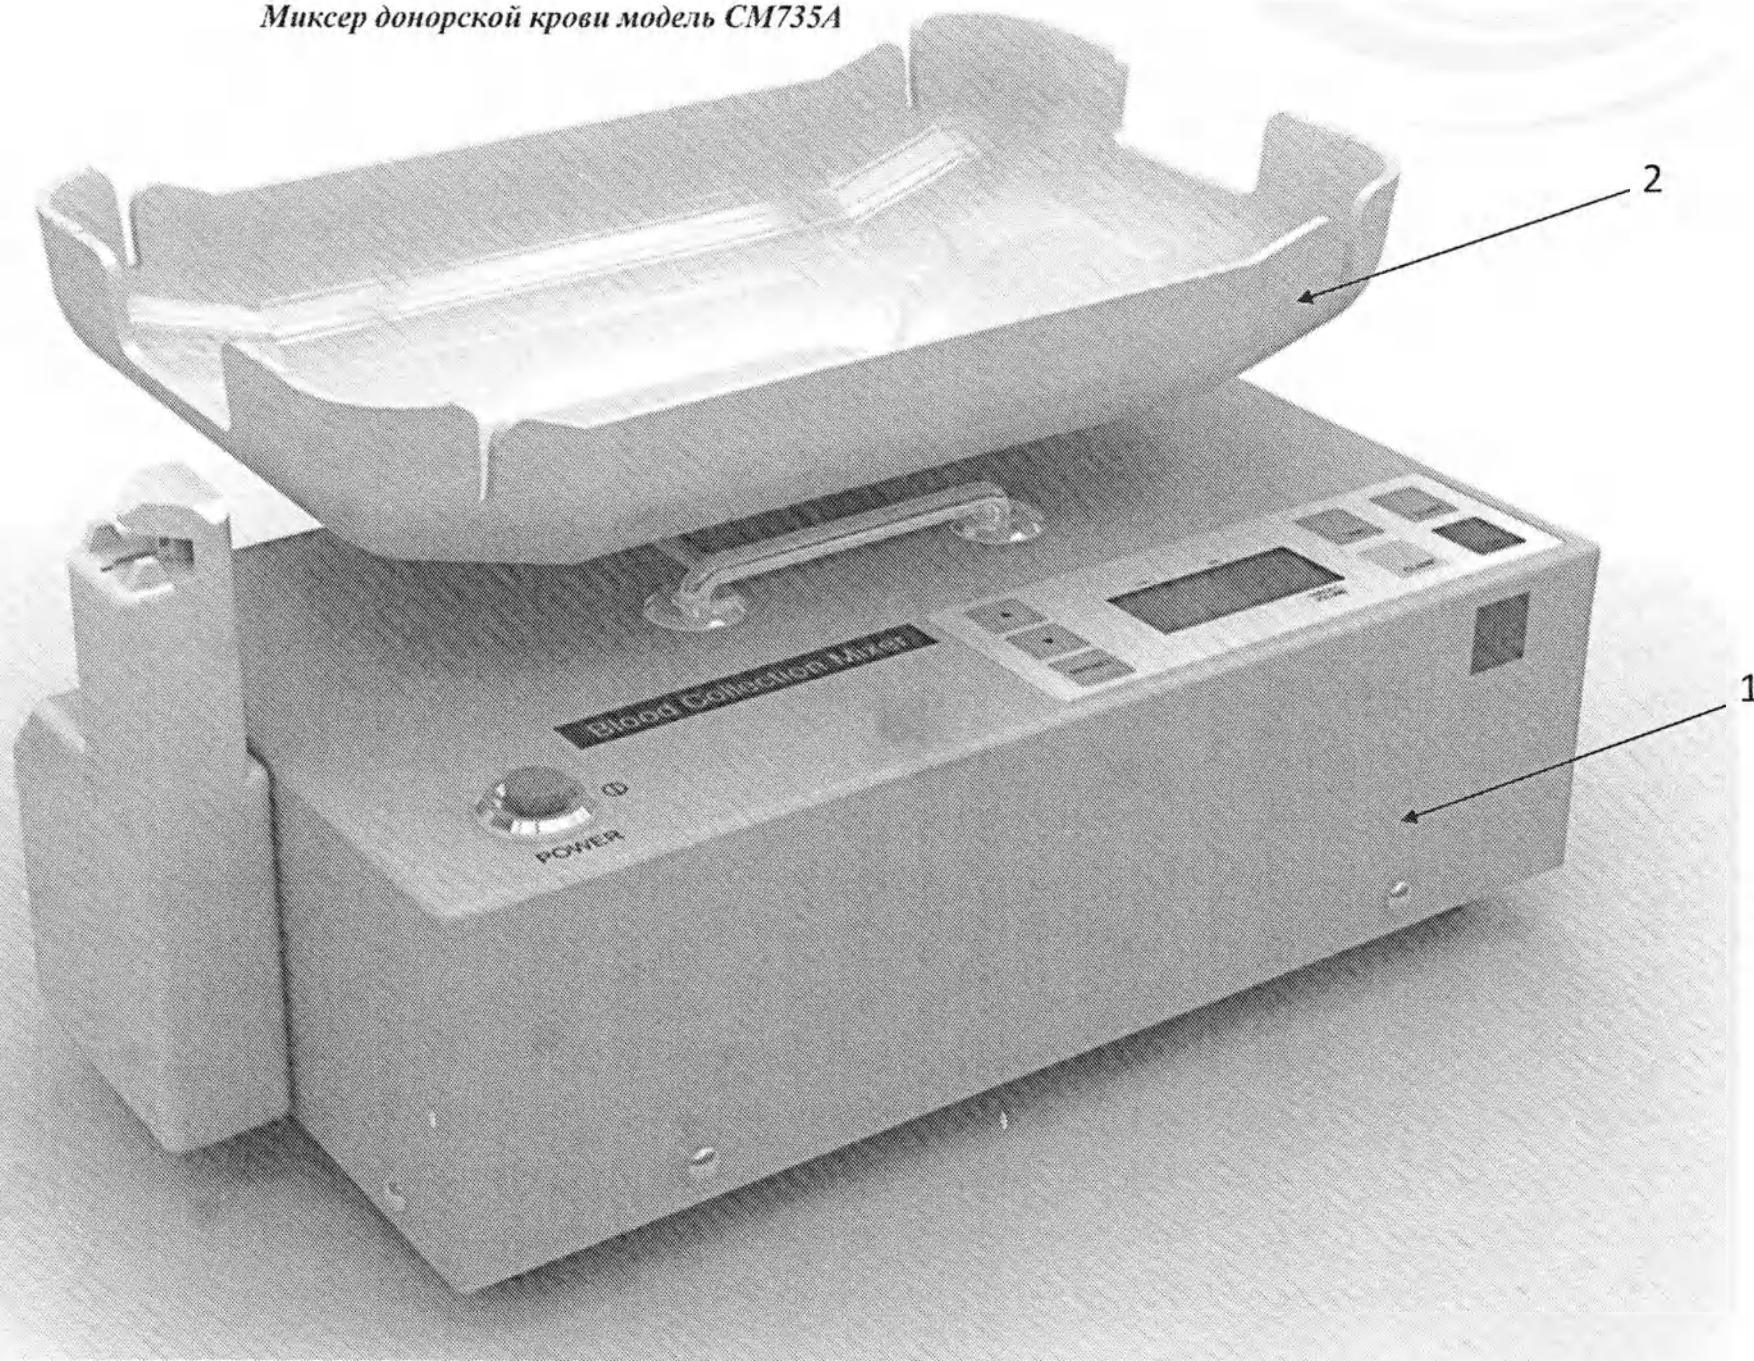


Фото 1: 1 – Блок основной, 2 - Лоток стандартный

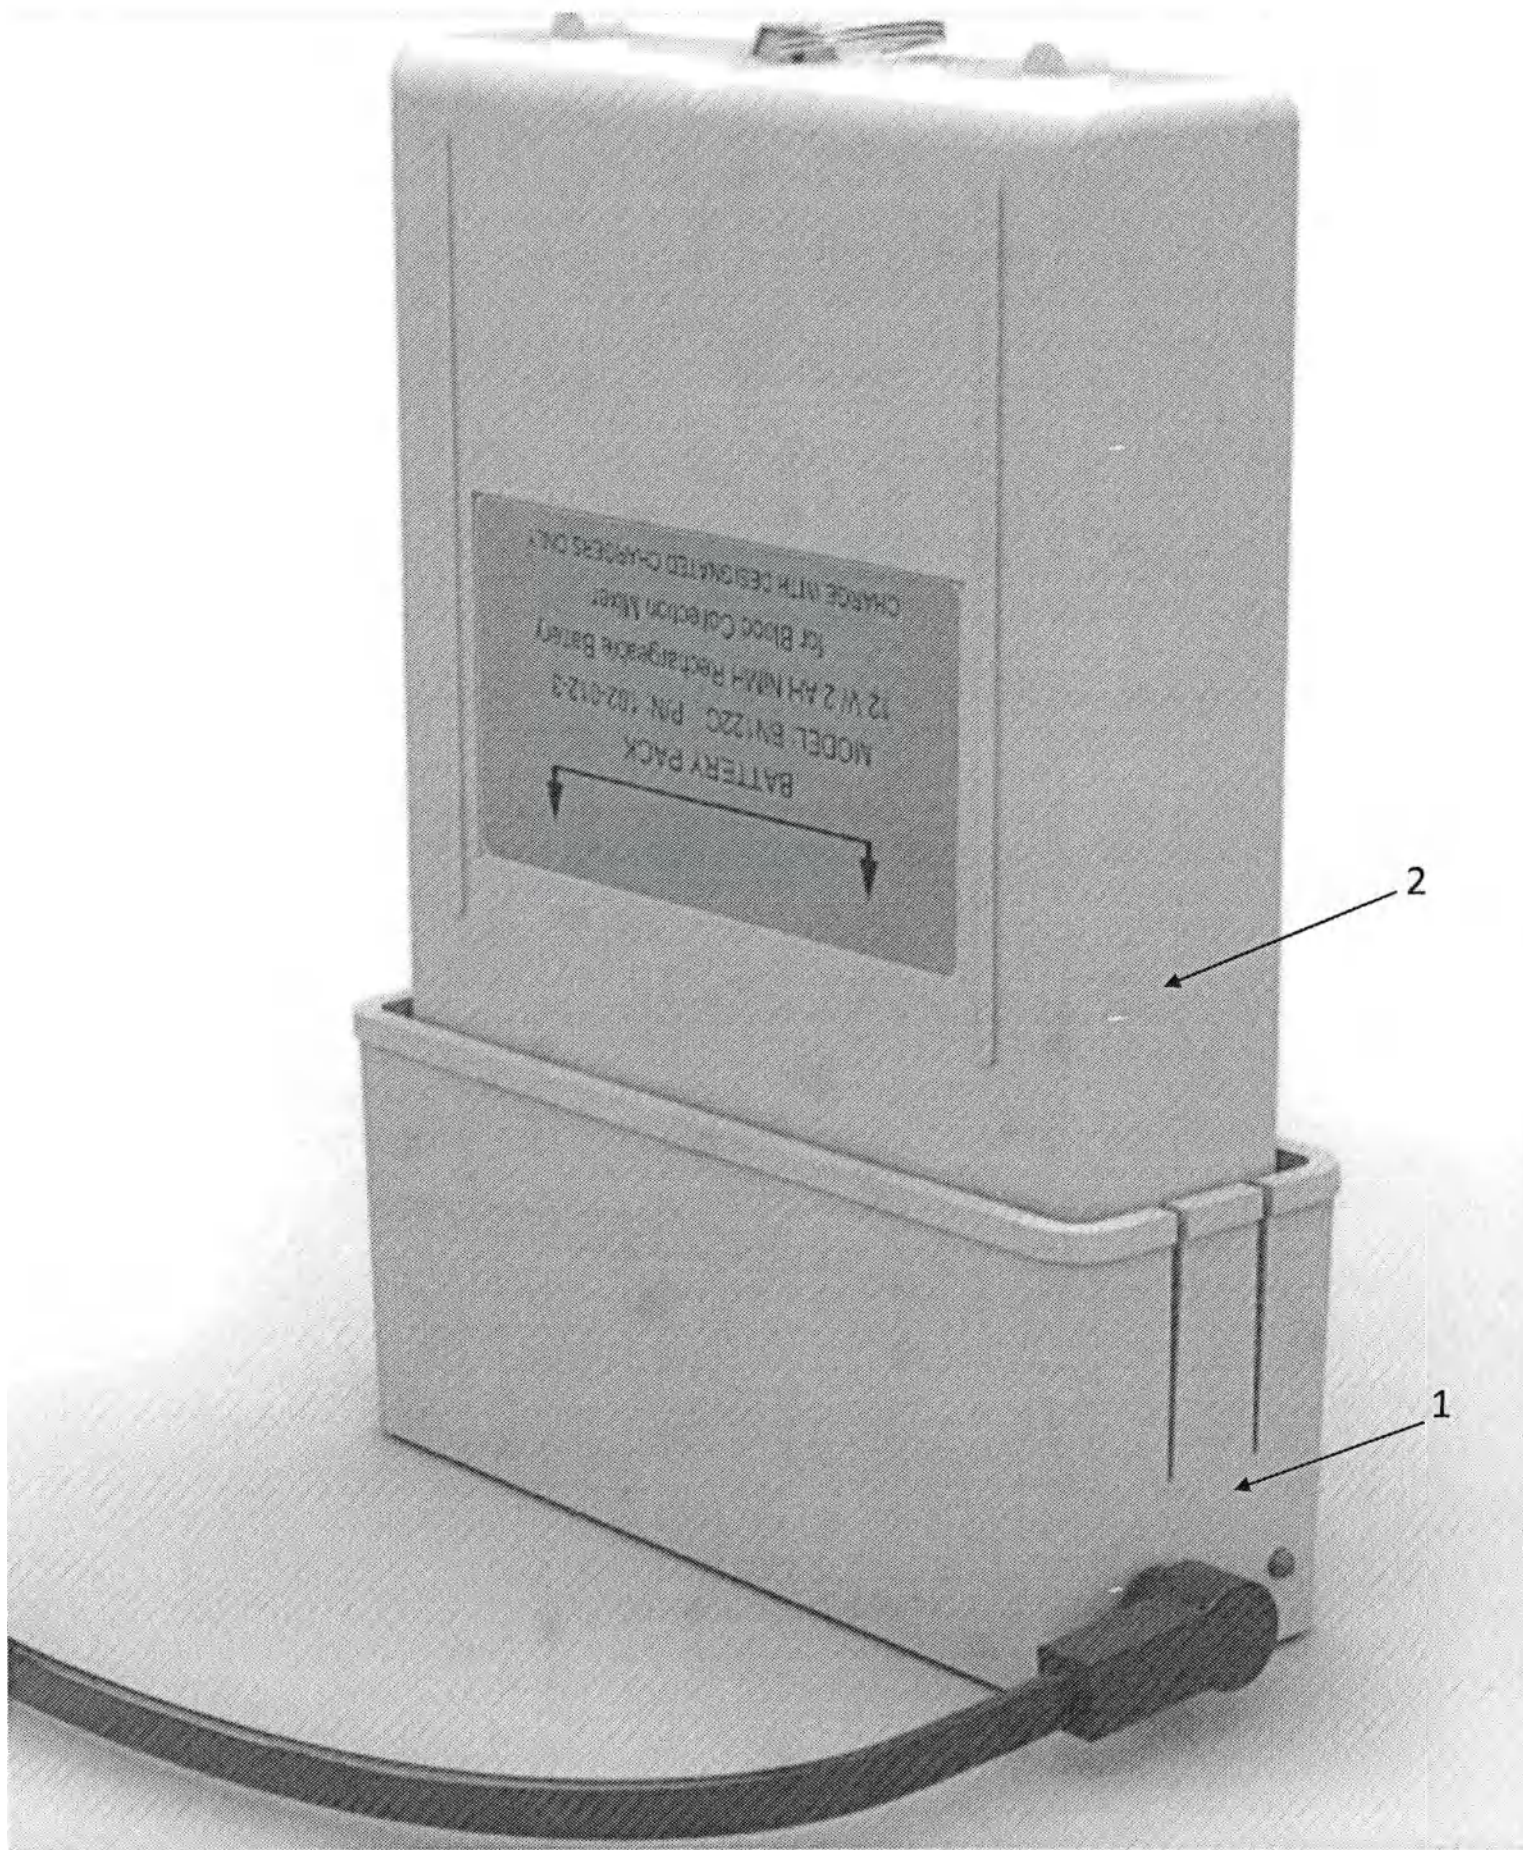


Фото 2: 1 - Зарядное устройство, 2 - Аккумуляторная батарея

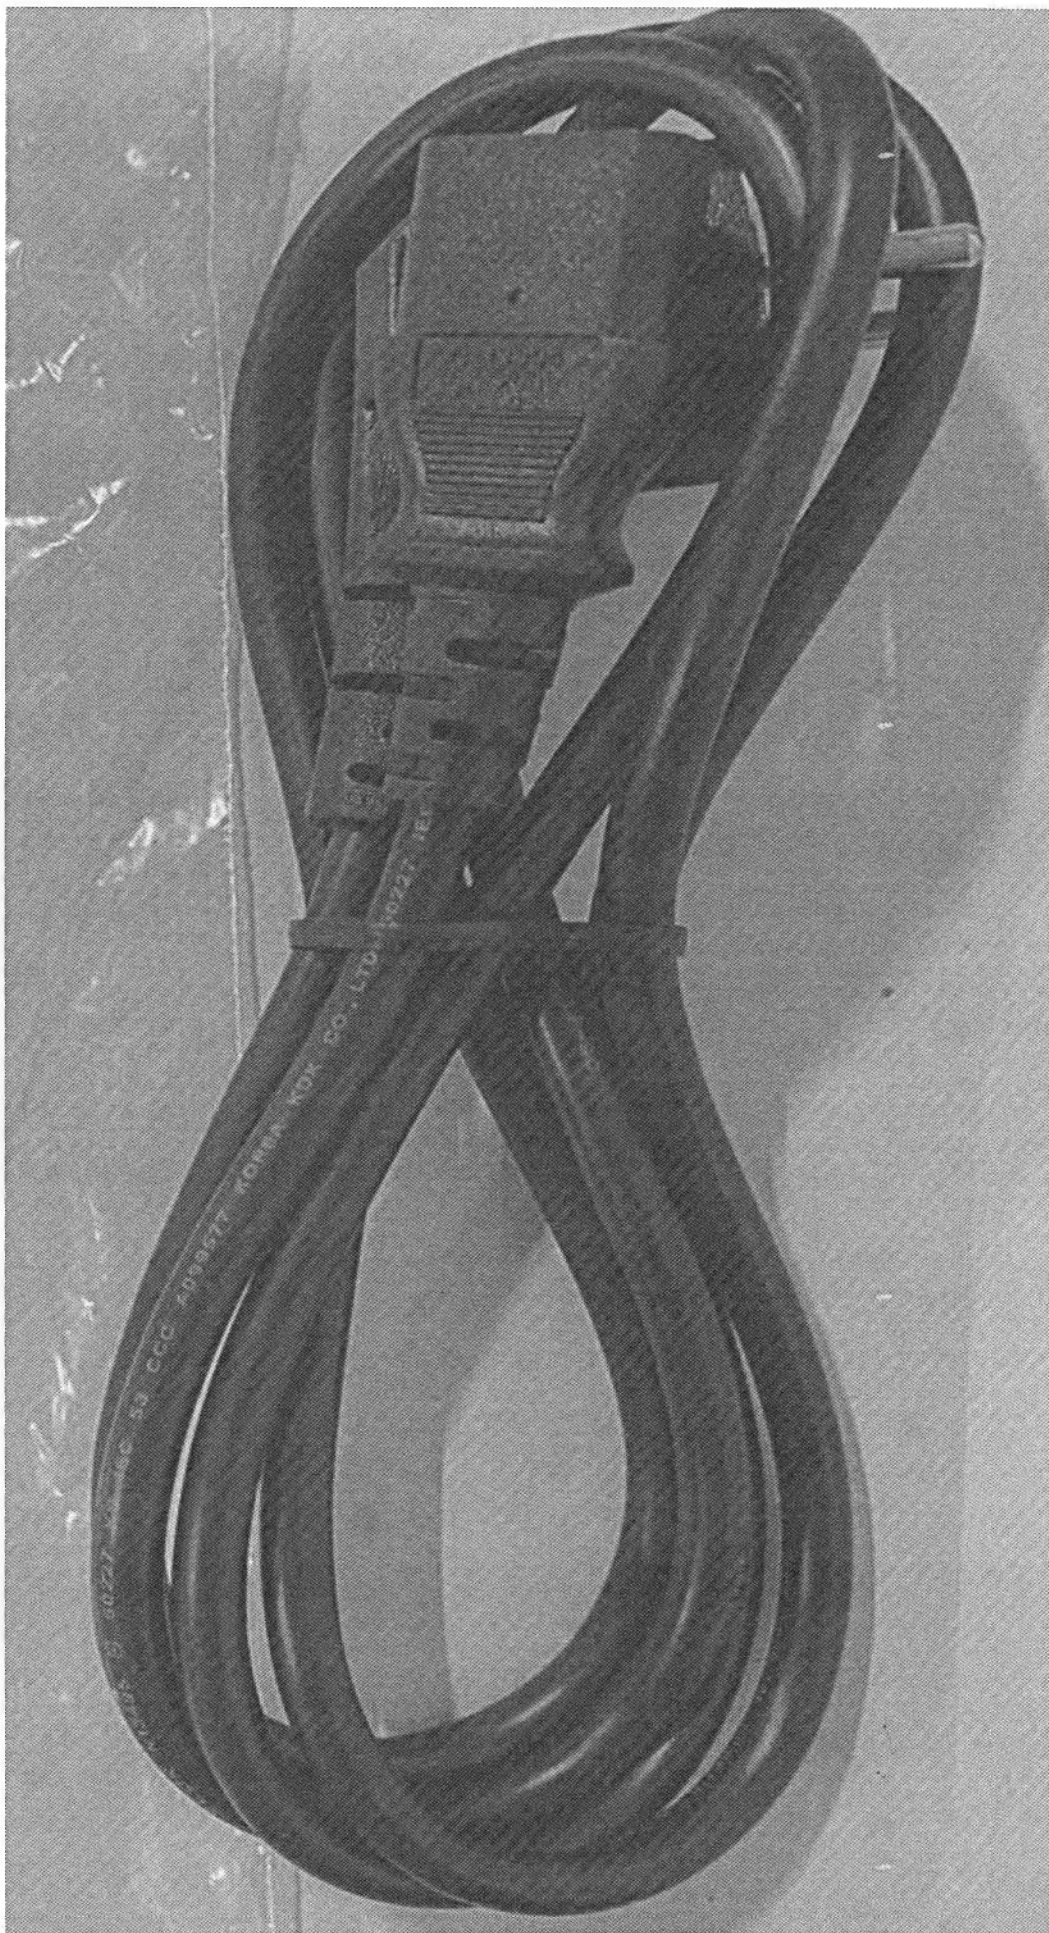


Фото 3: Шнур сетевой

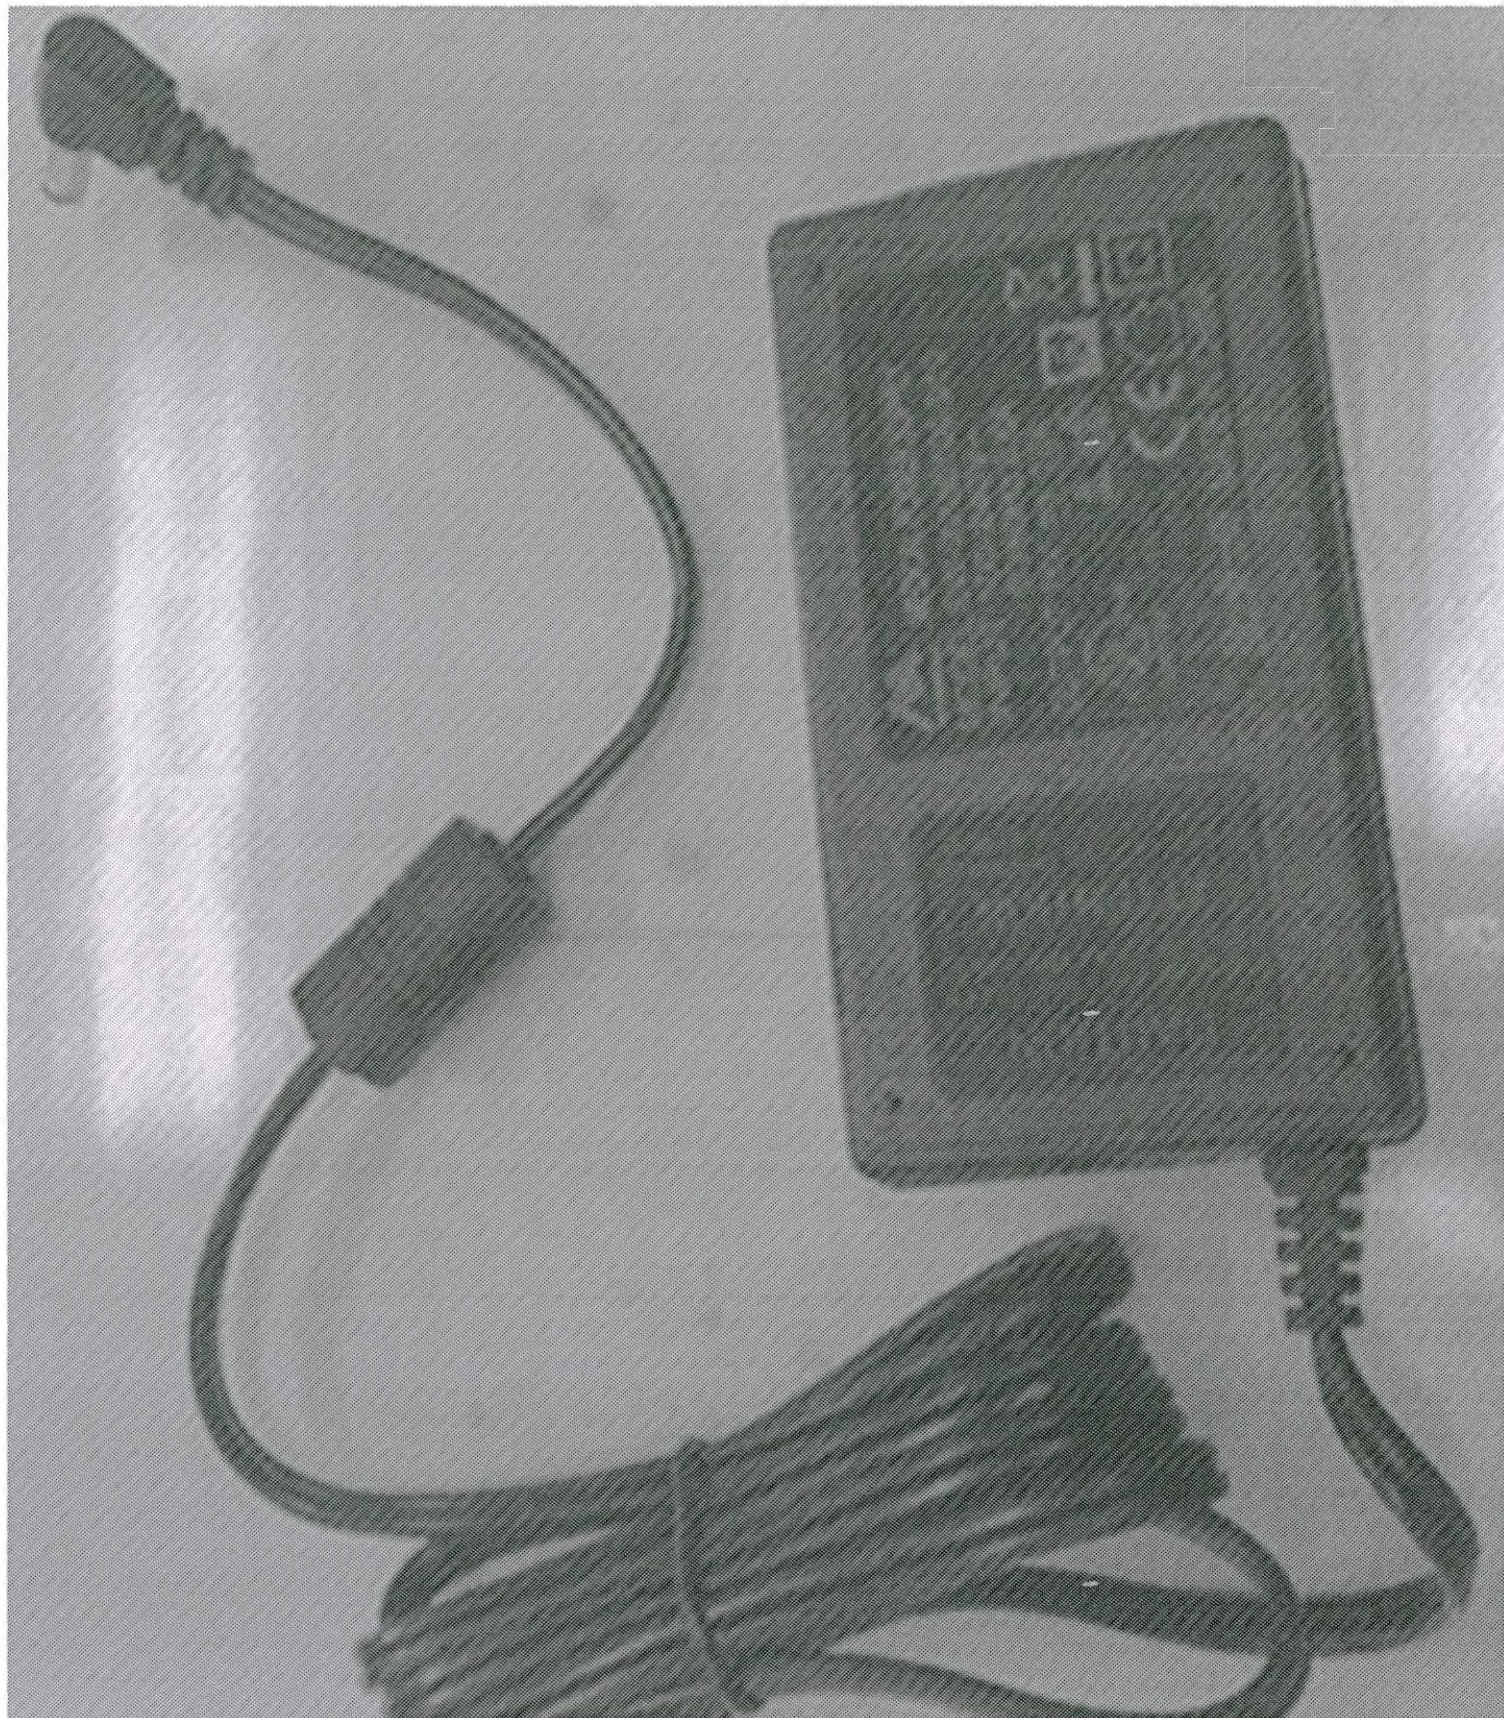


Фото 4: Адаптер питания



Фото 5: Сумка для переноски

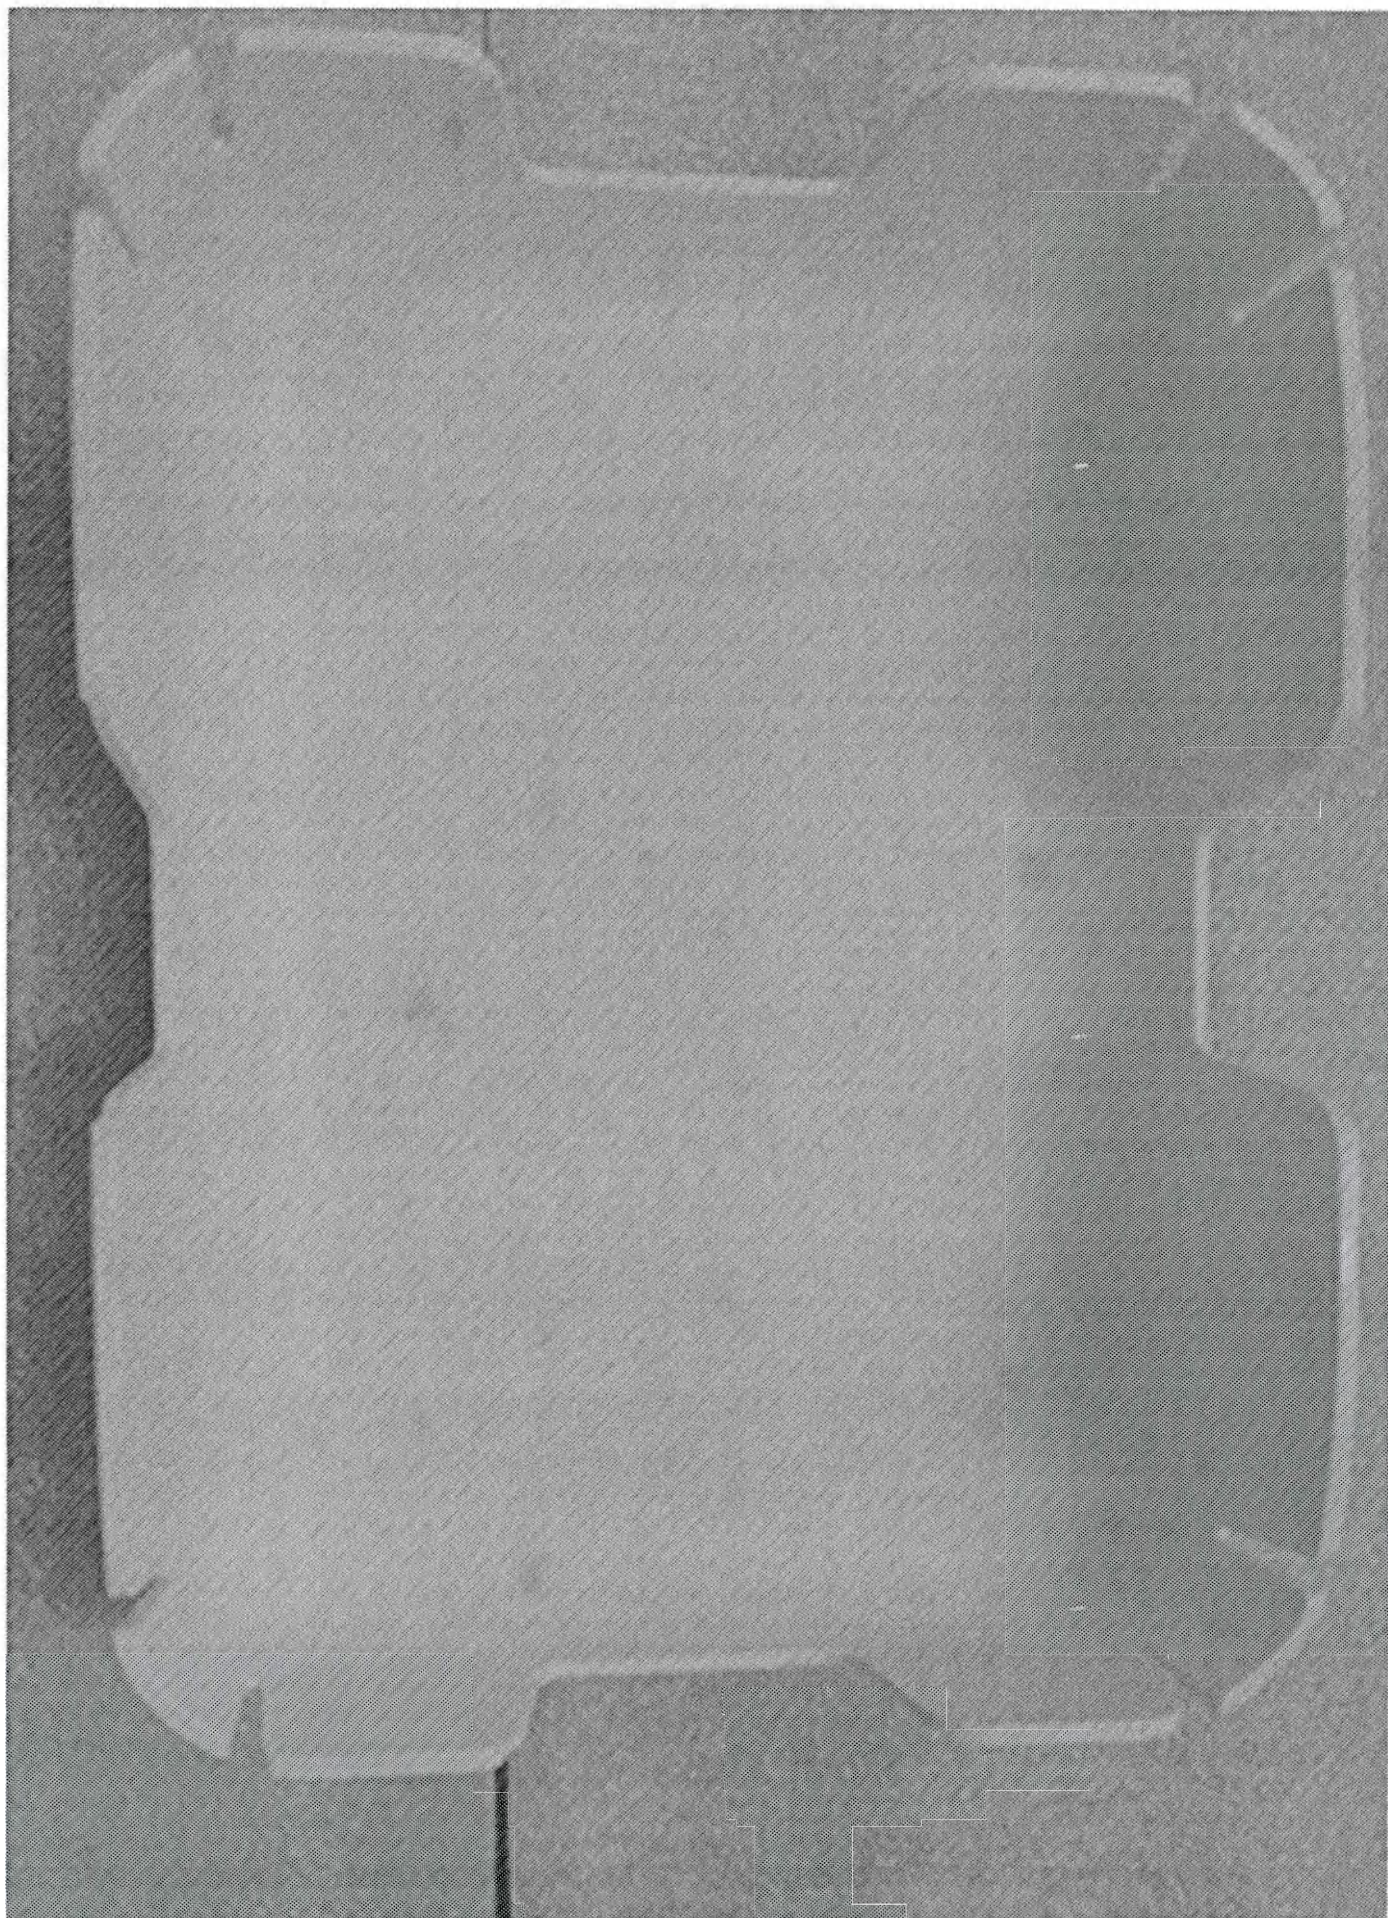


Фото 6: Лоток большой

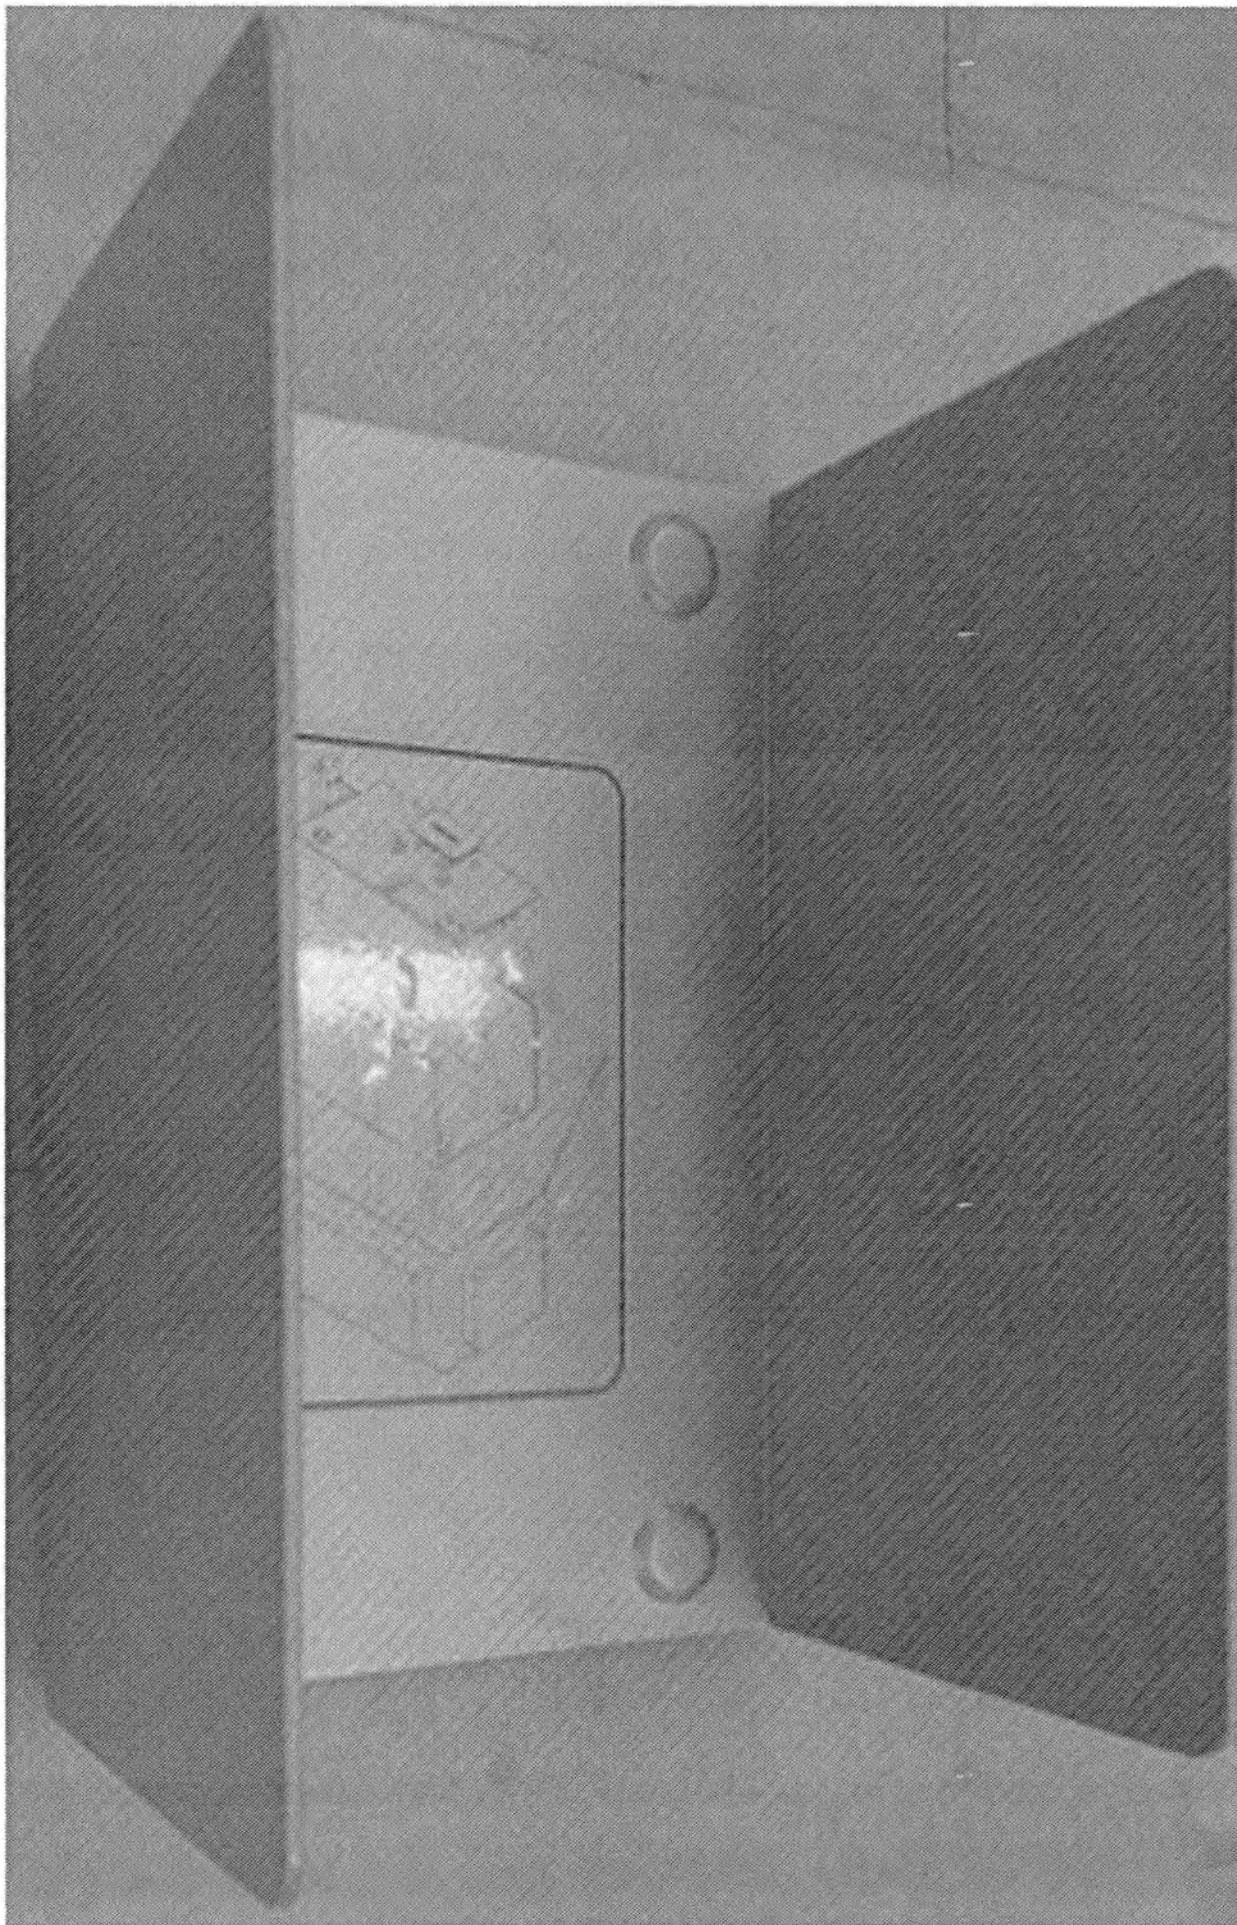


Фото 7: Пластина алюминиевая

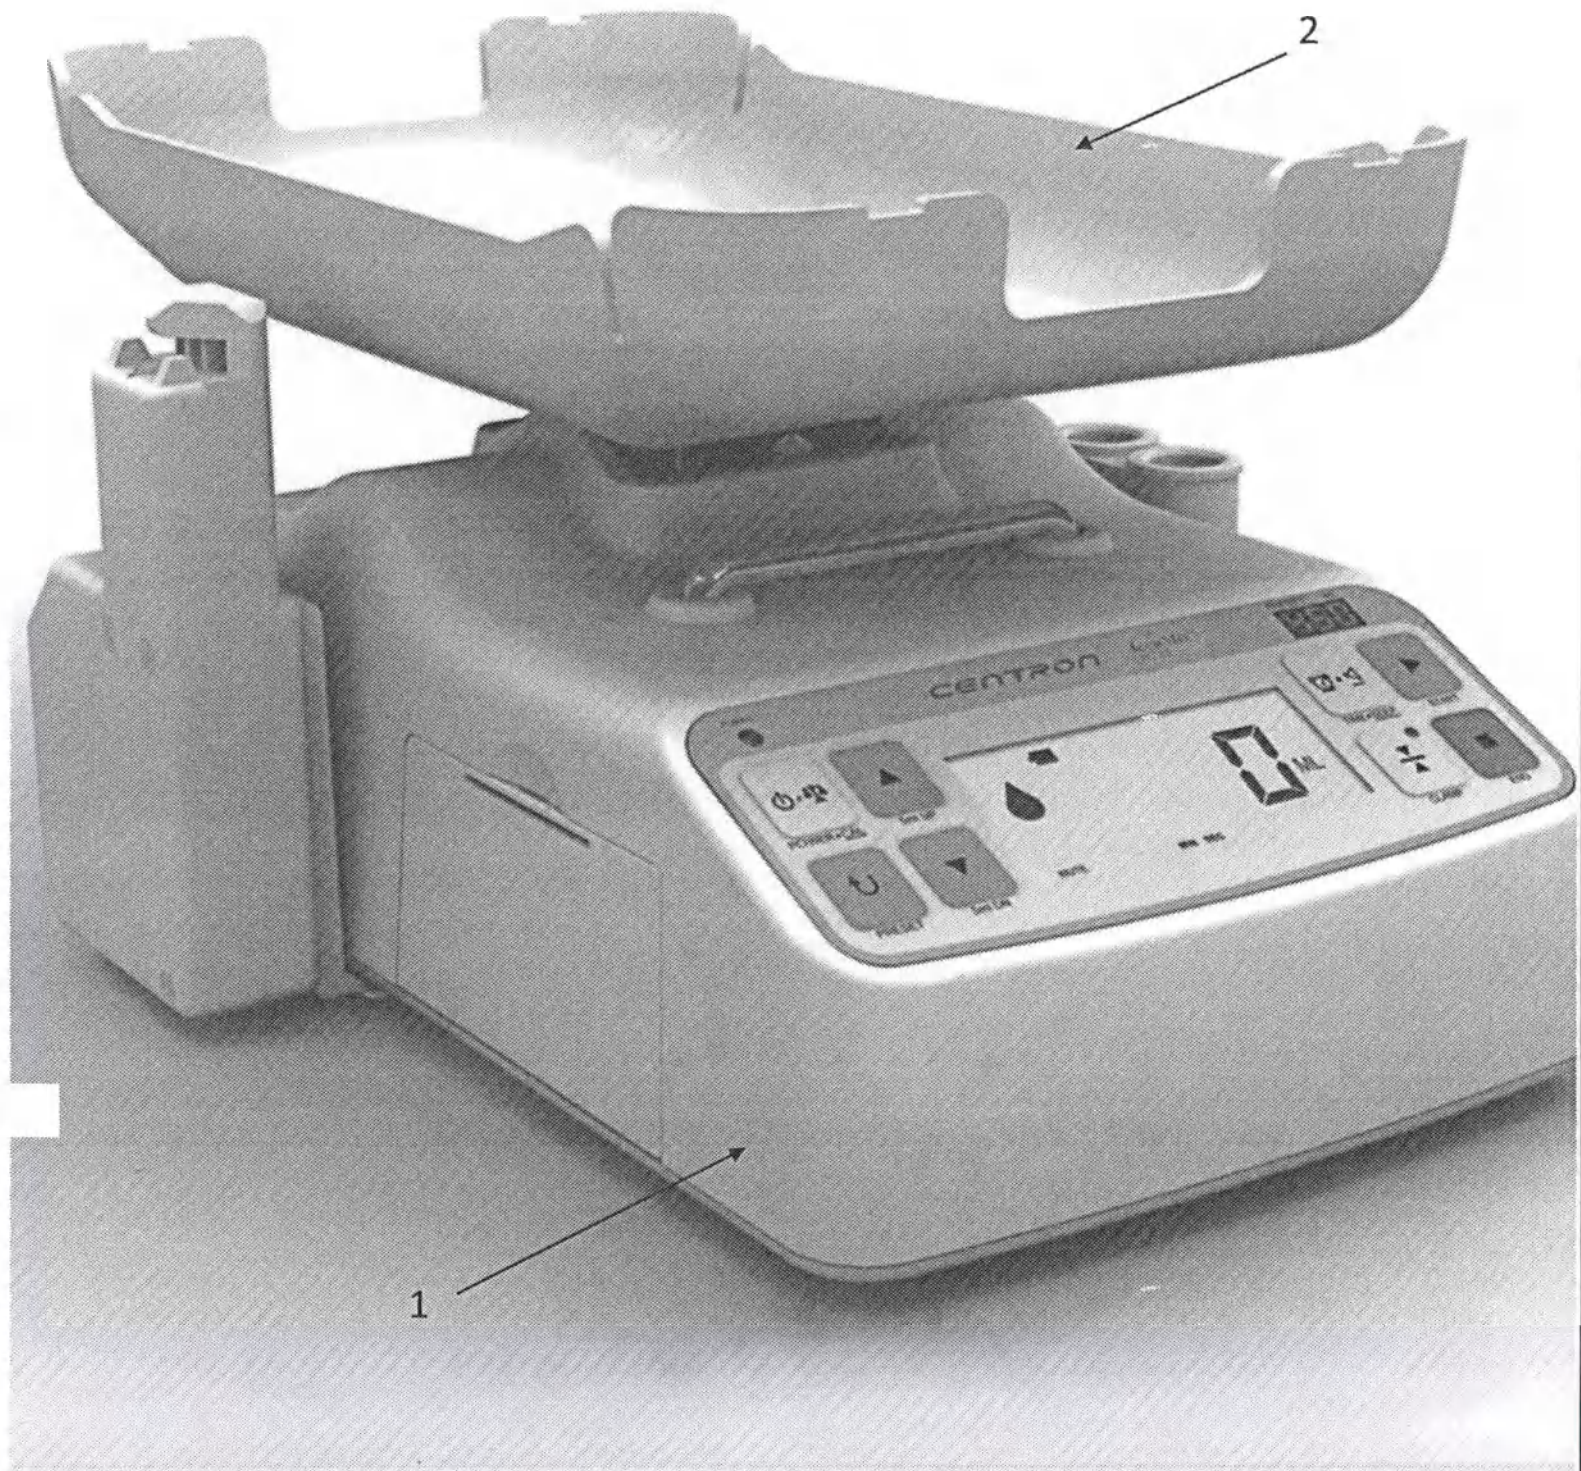


Фото 8: 1 – блок основной, 2 – лоток стандартный



Фото 9: Шнур сетевой



Фото 10: Адаптер питания

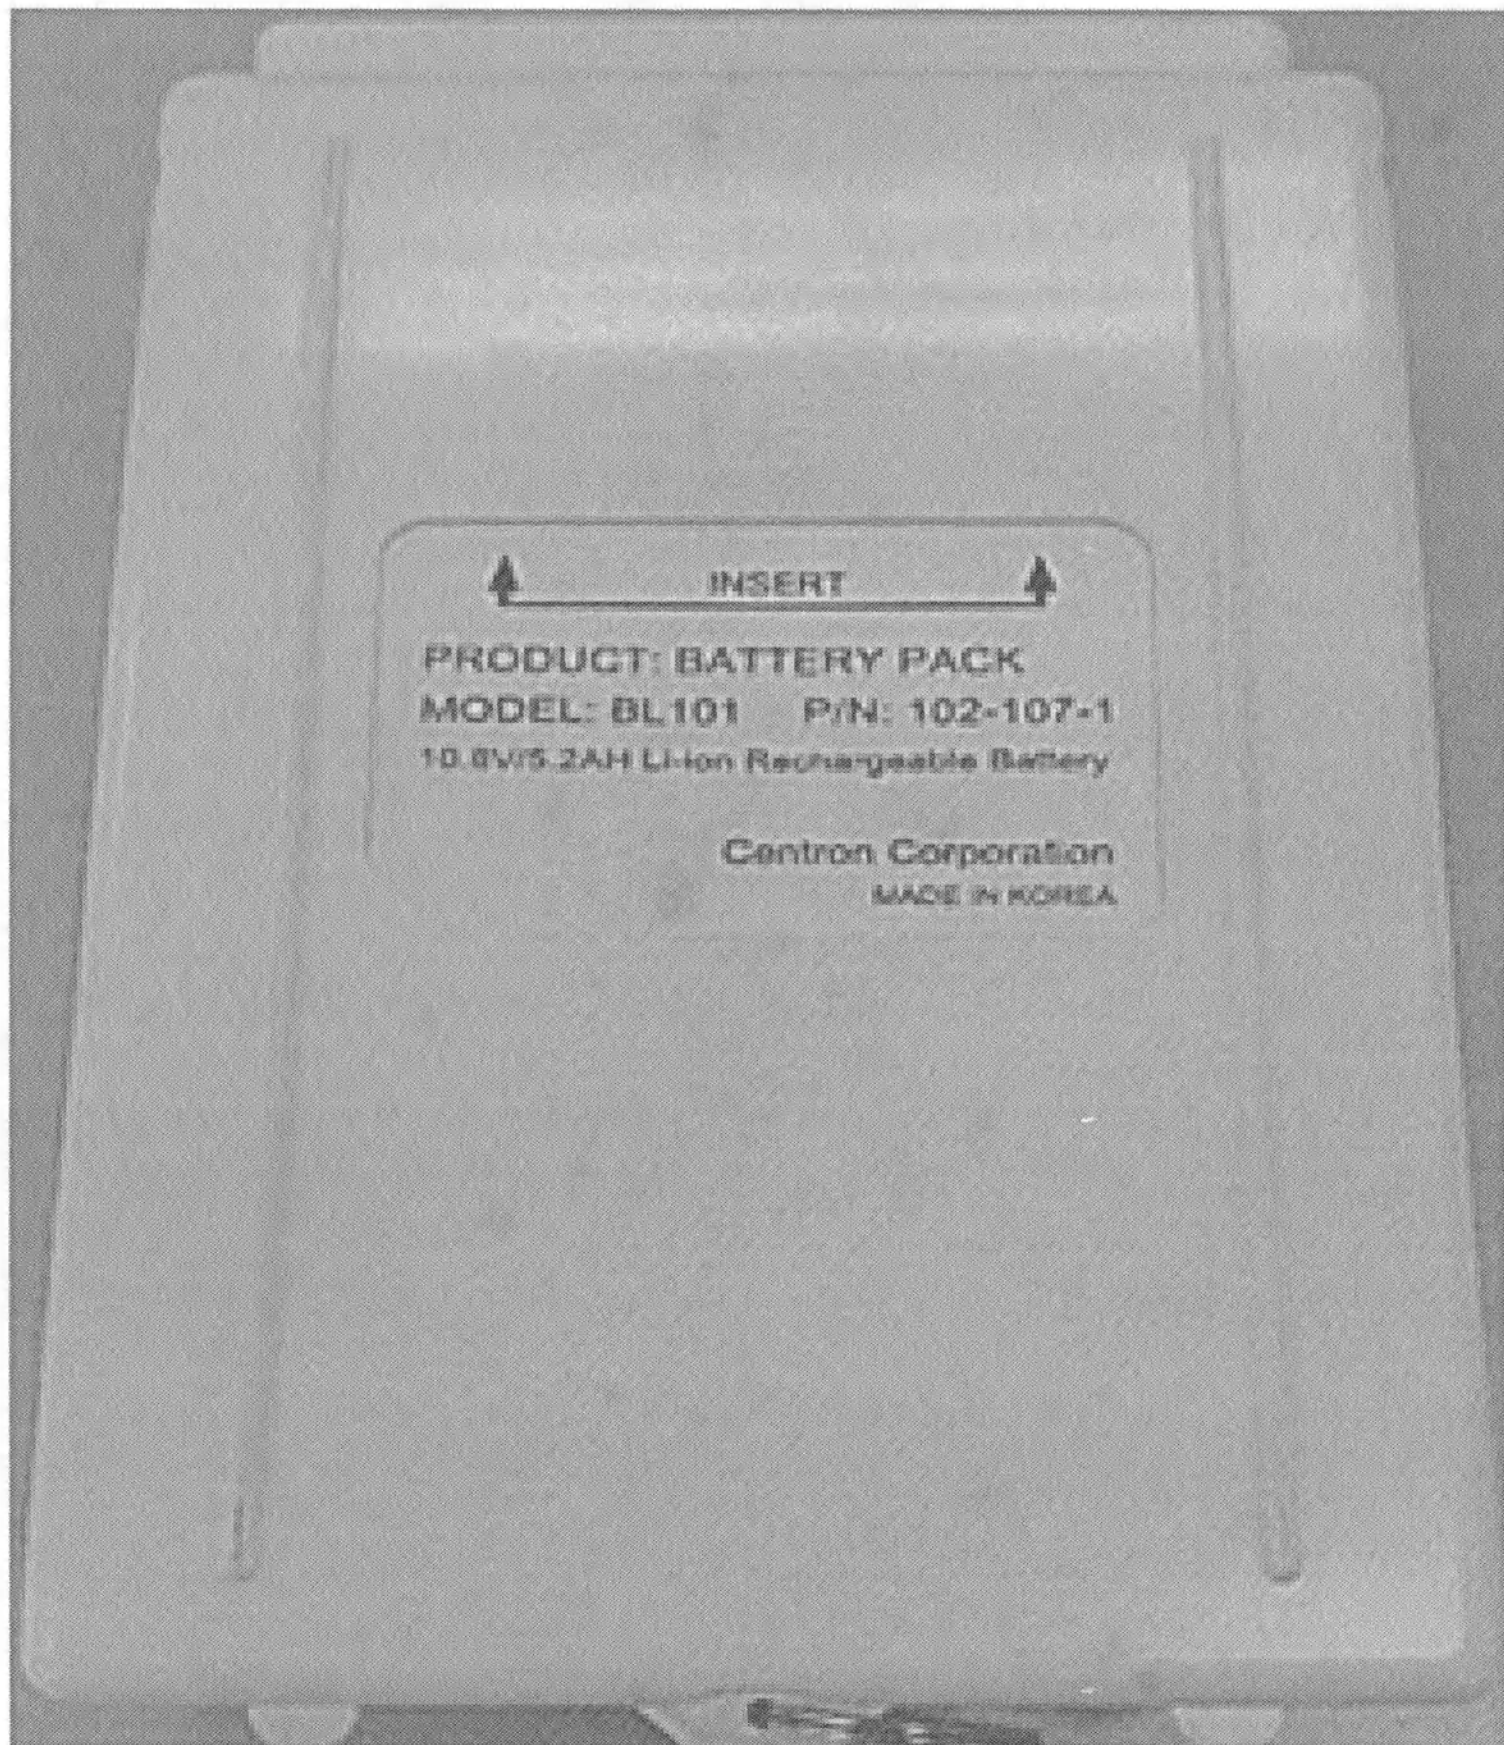


Фото 11: Аккумуляторная батарея

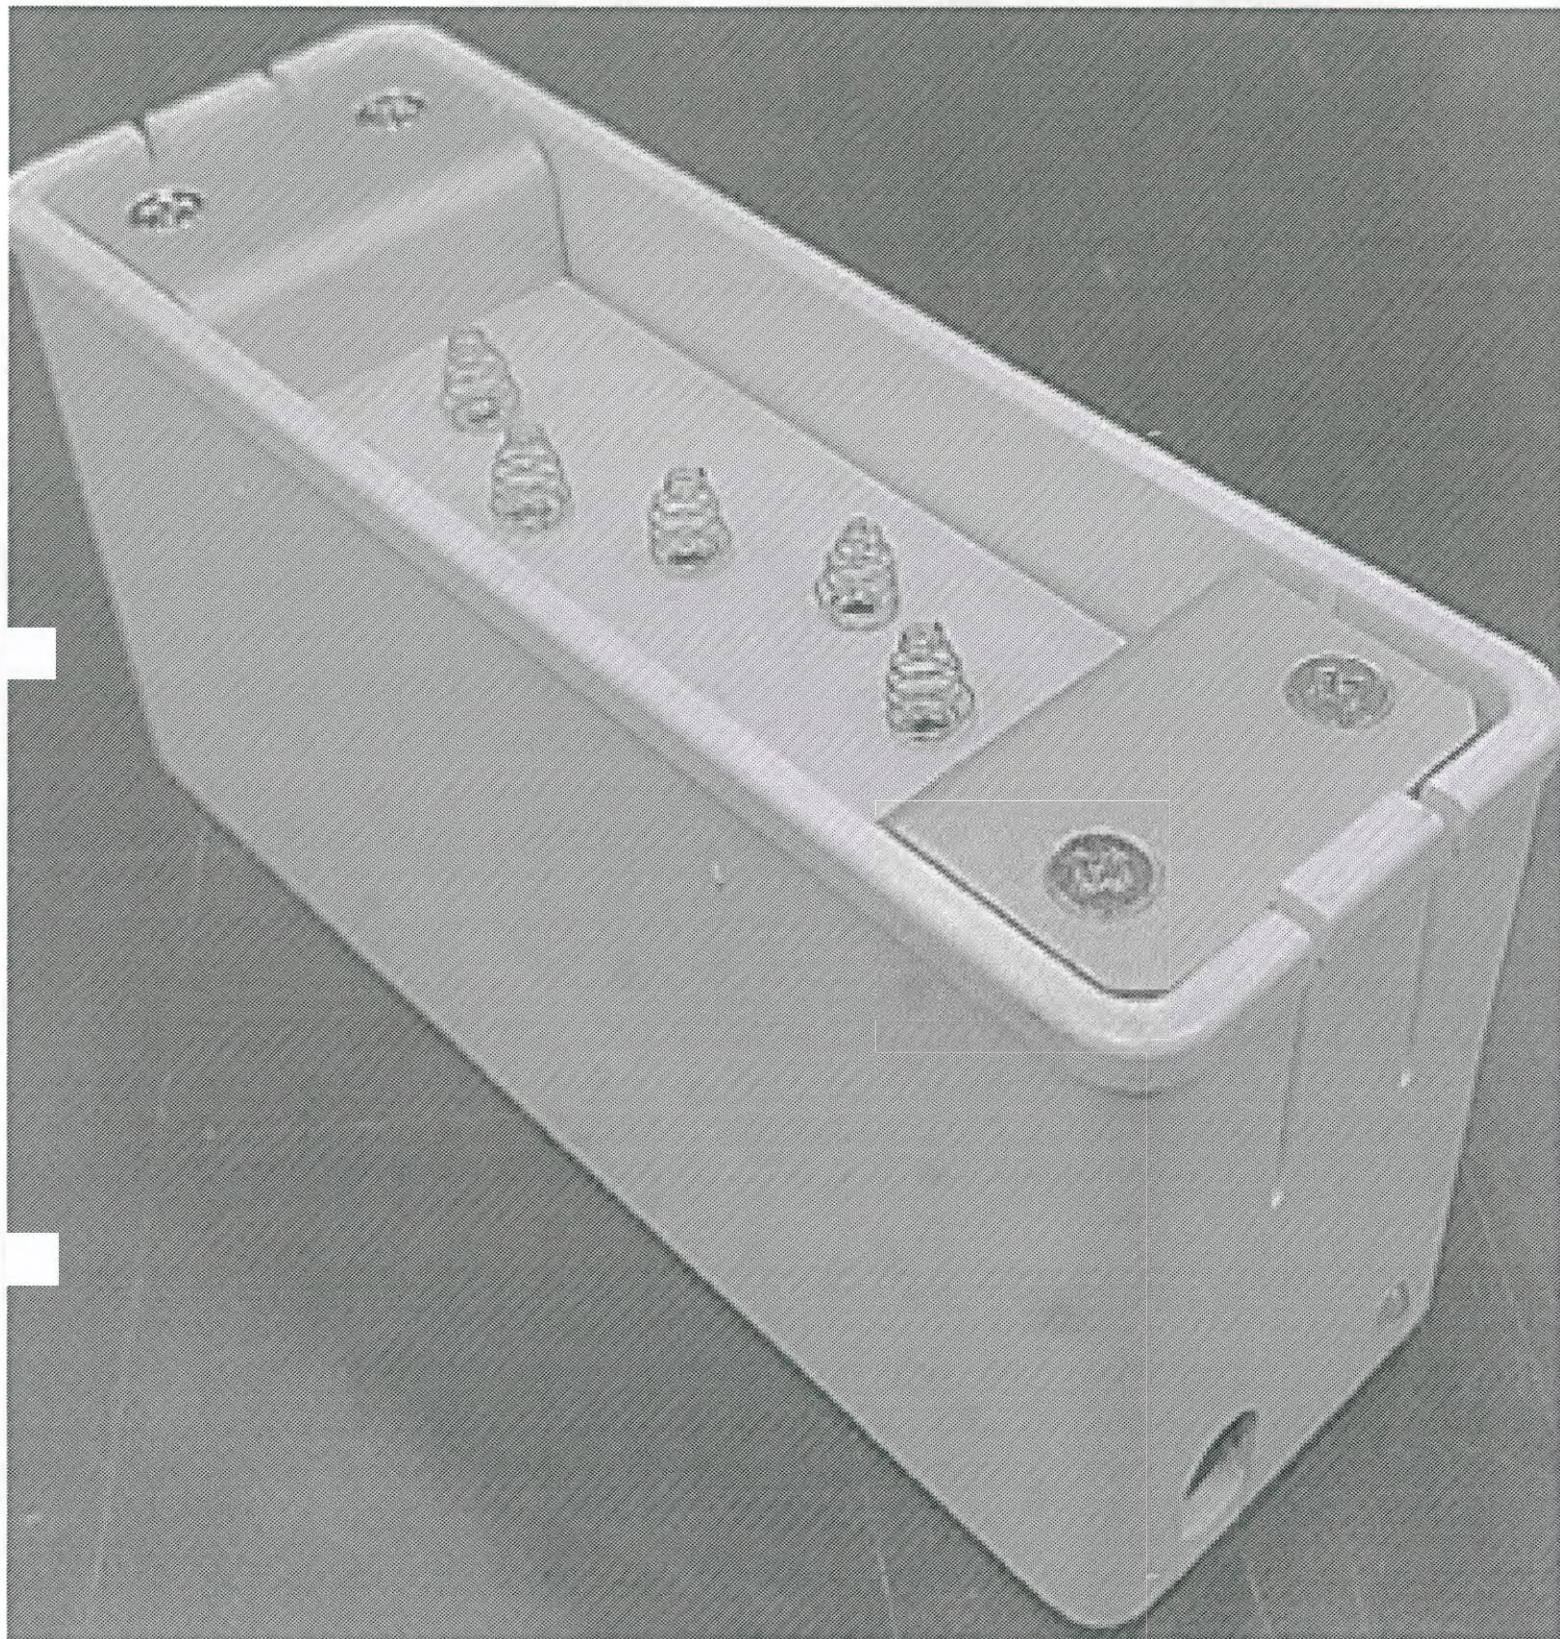


Фото 12: Зарядное устройство



Фото 13: Сканер штрих-кодов

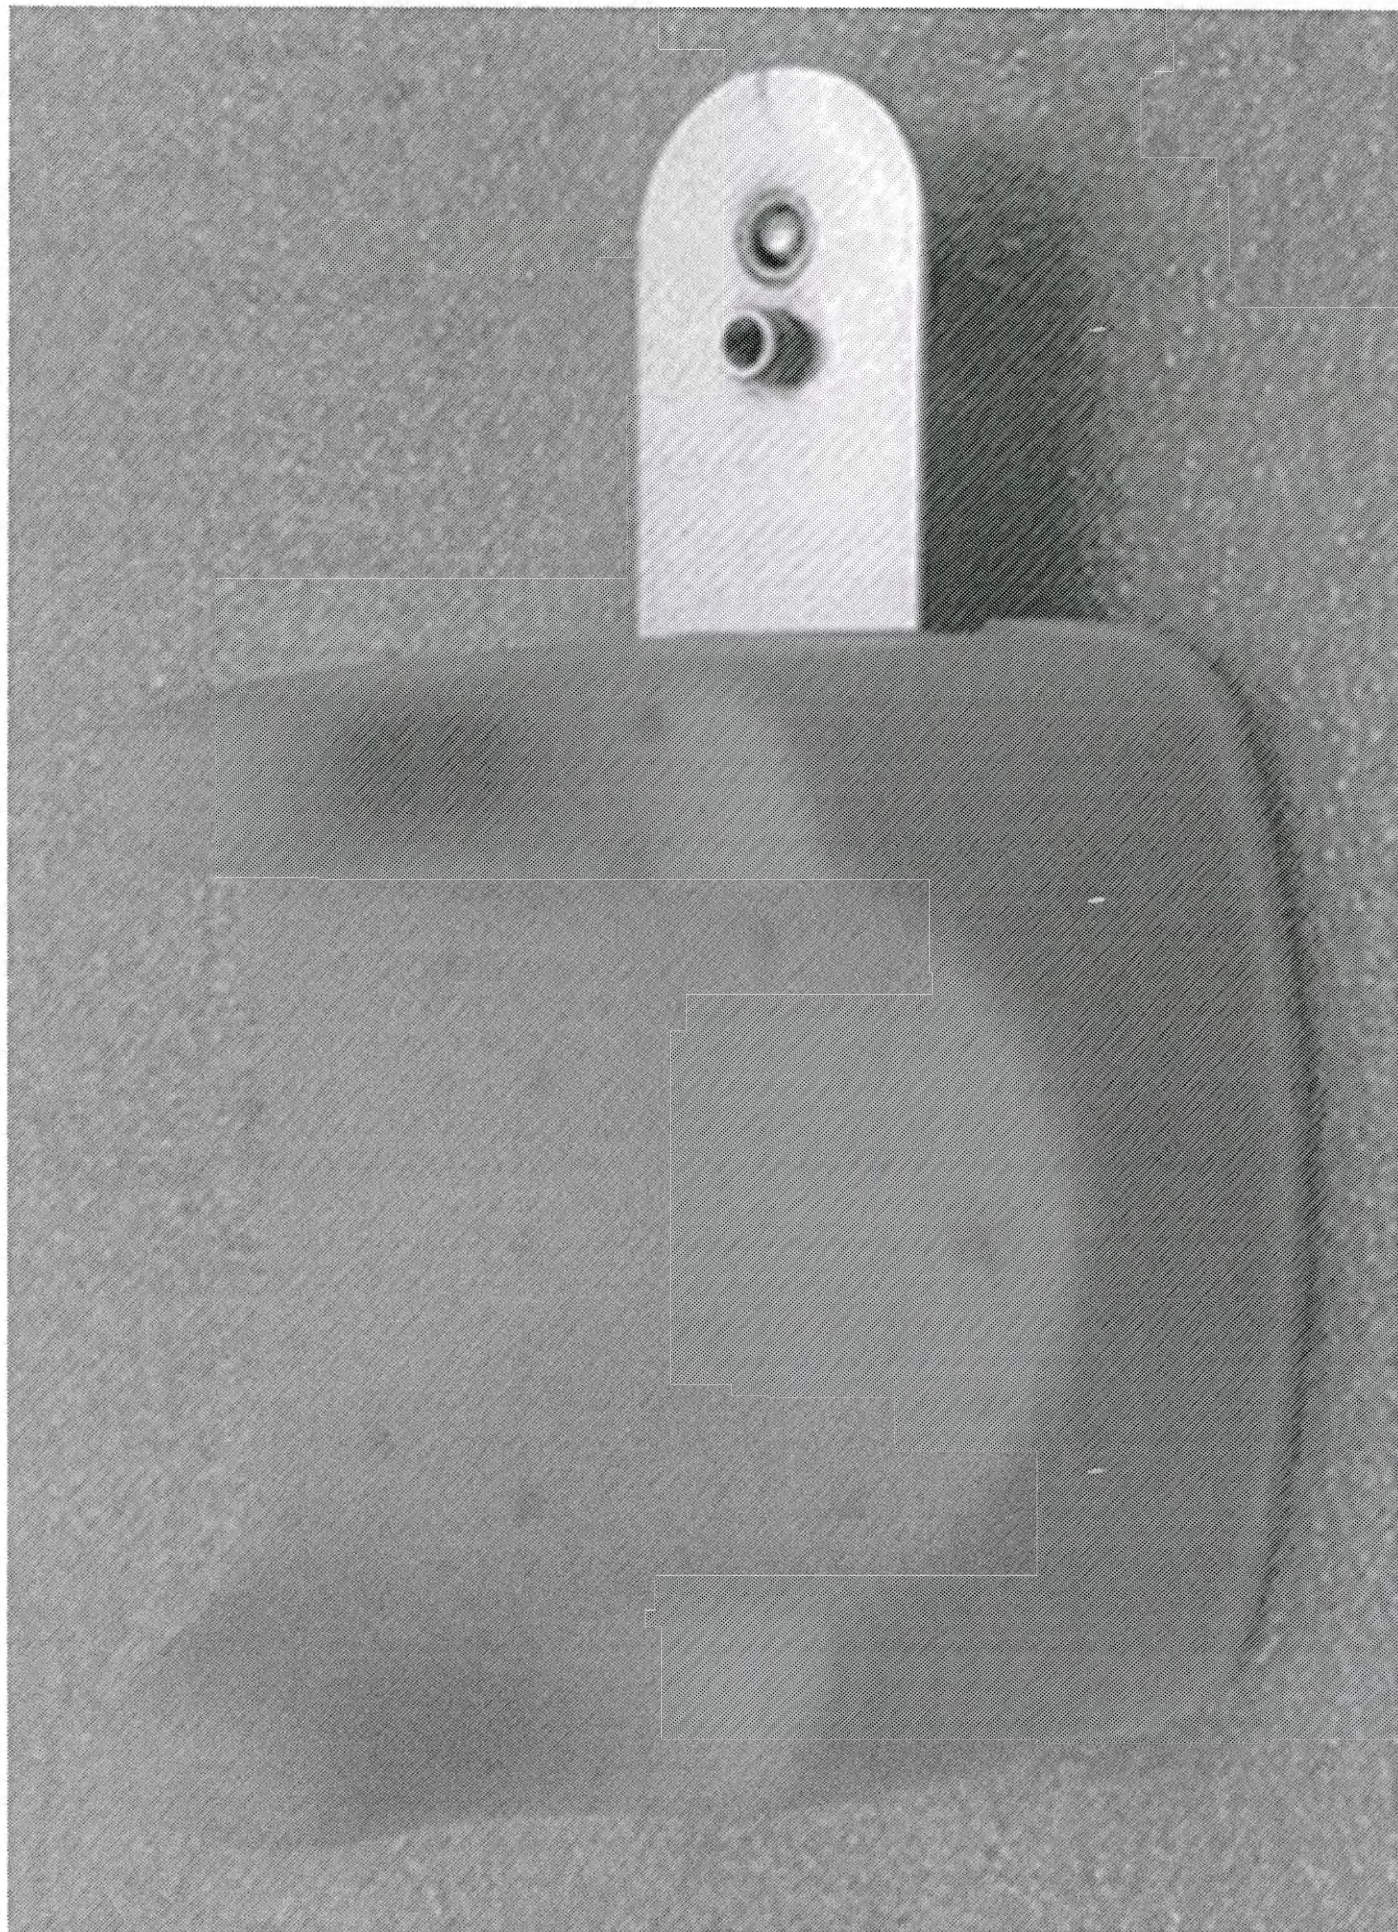


Фото 14: Держатель сканера штрих-кодов

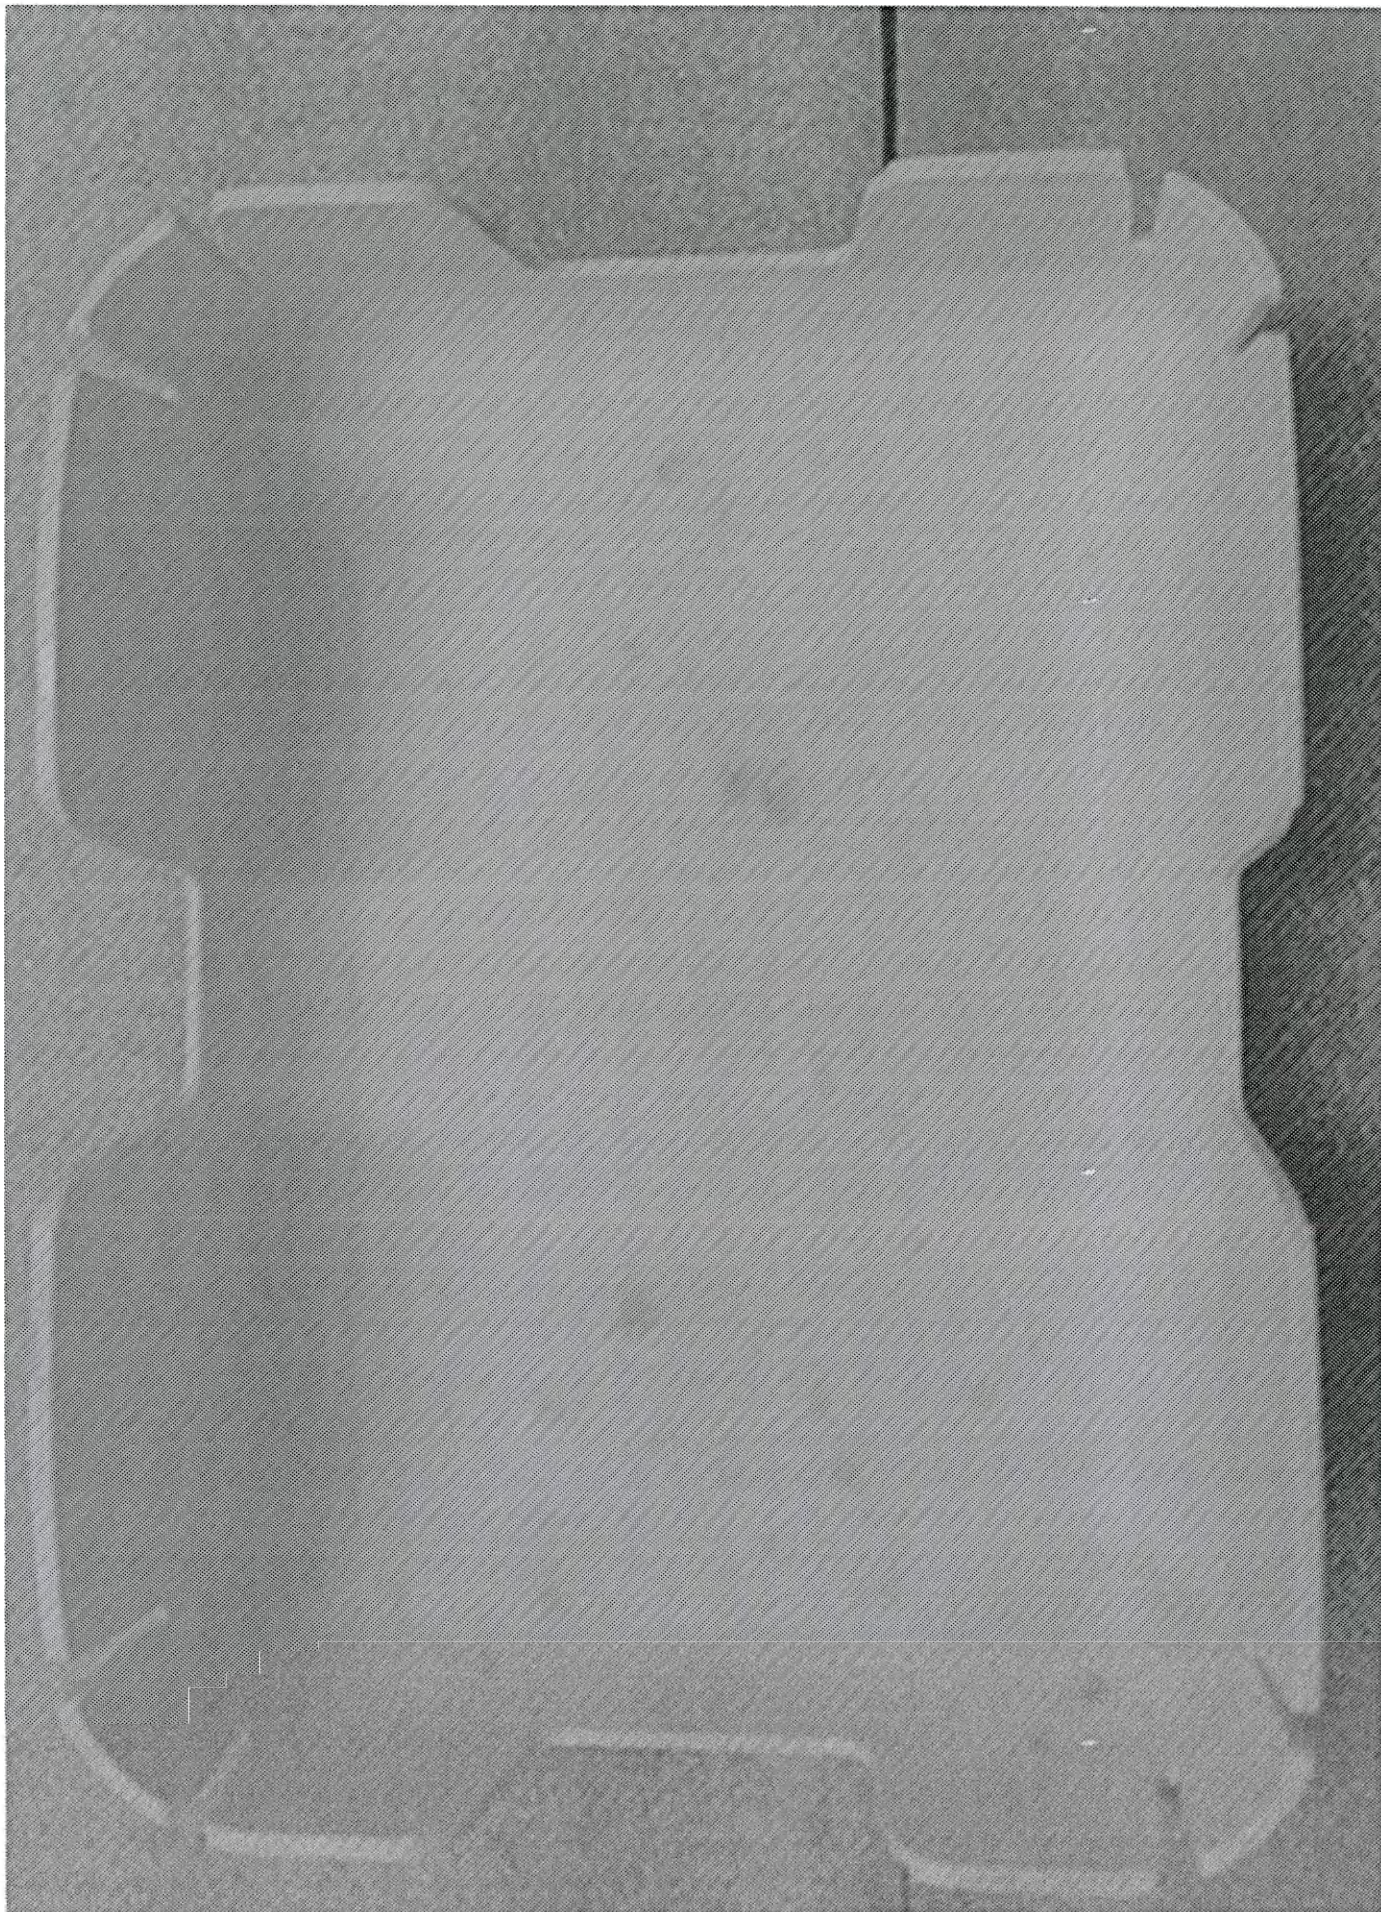


Фото 15: Лоток большой



Фото 16: Гиря 500г

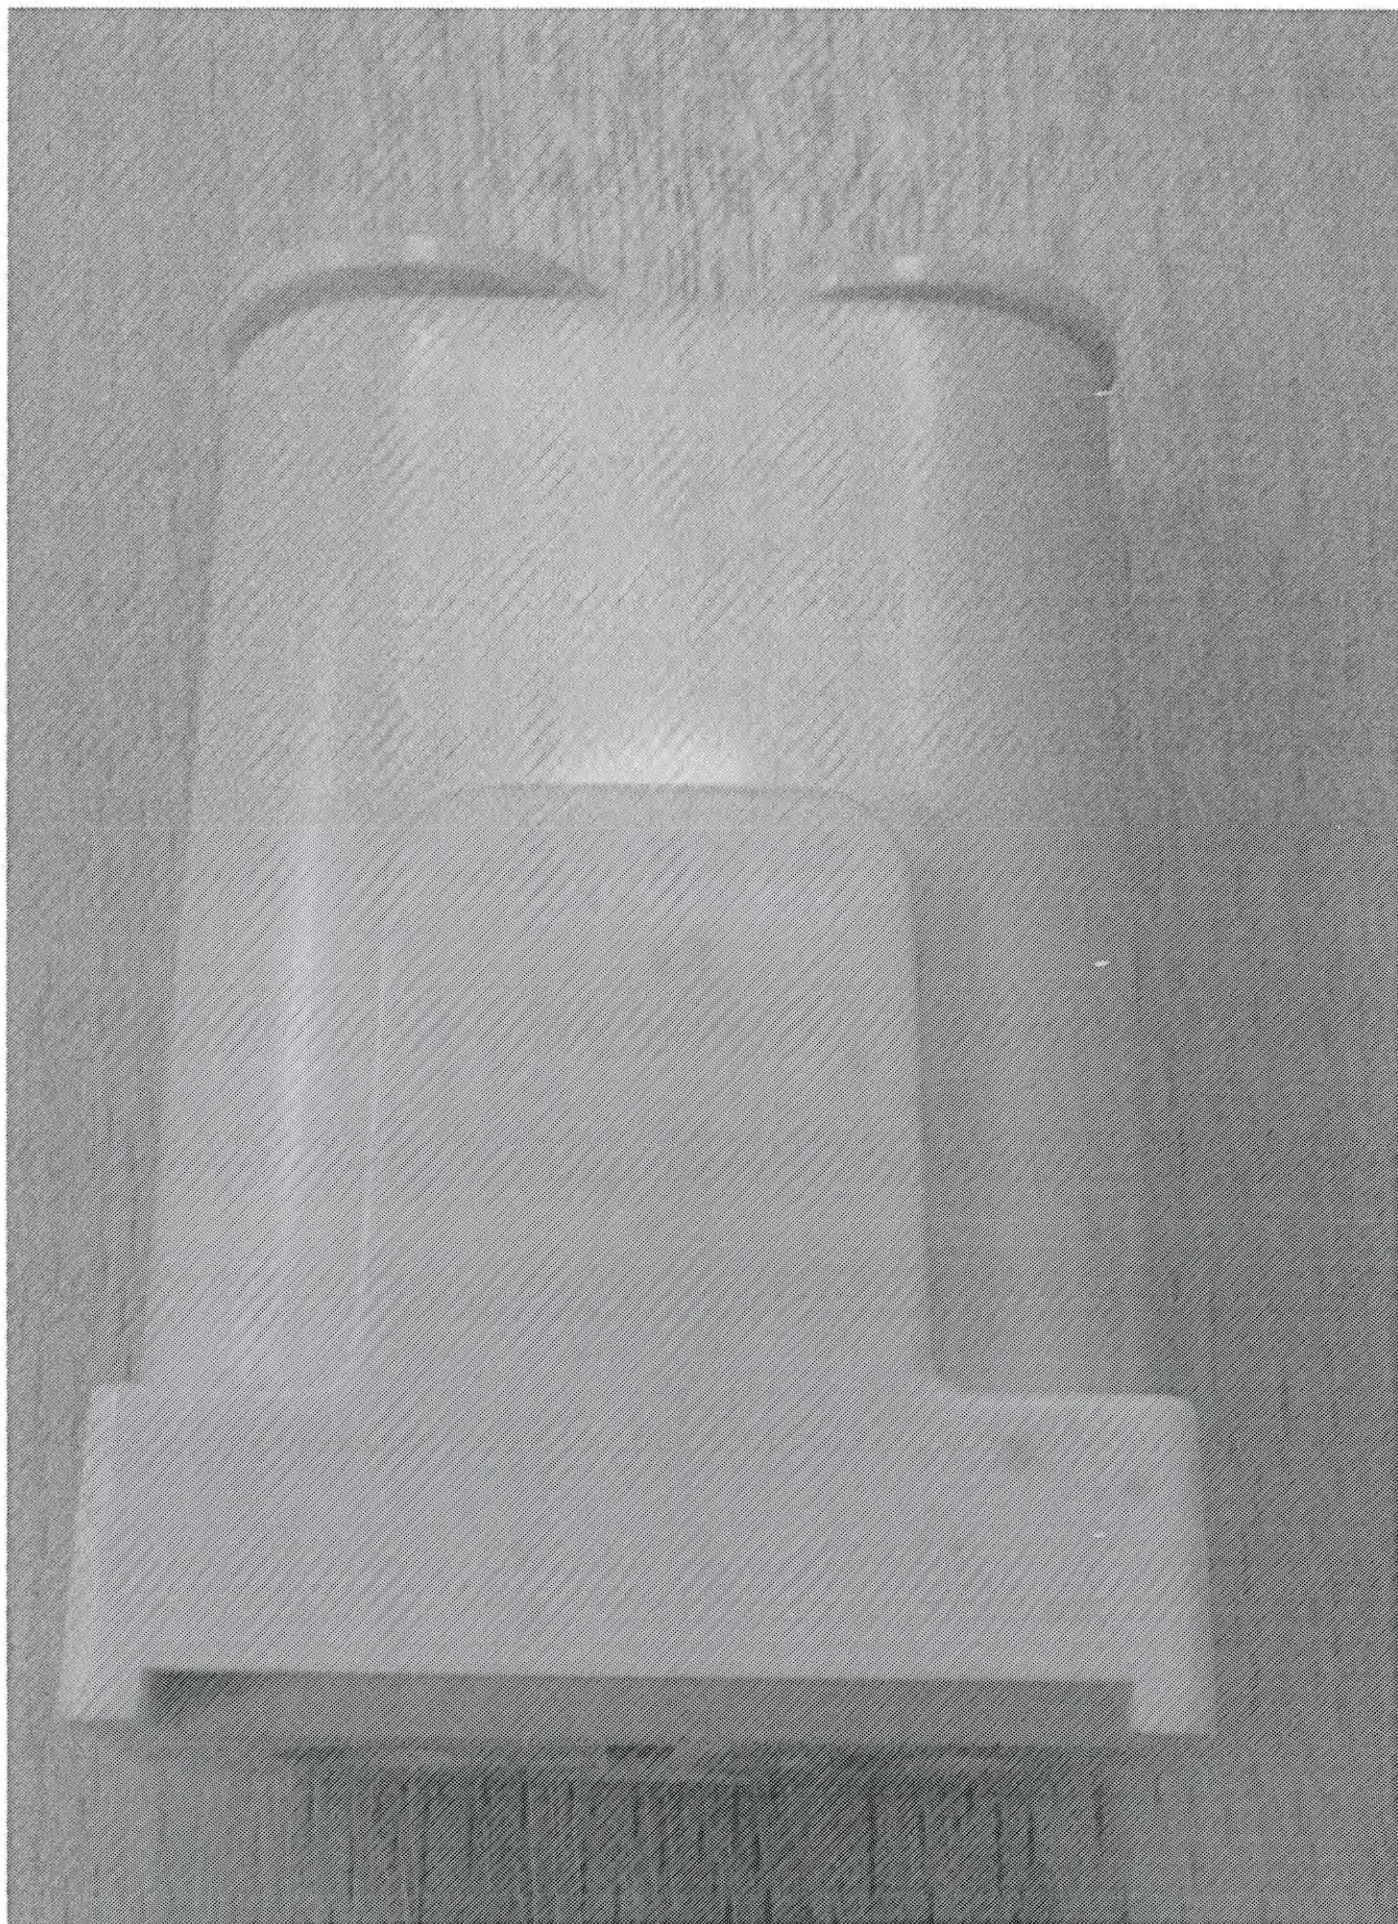


Фото 17: Комплект держателя пробирок для анализов: Держатель пробирок для анализов

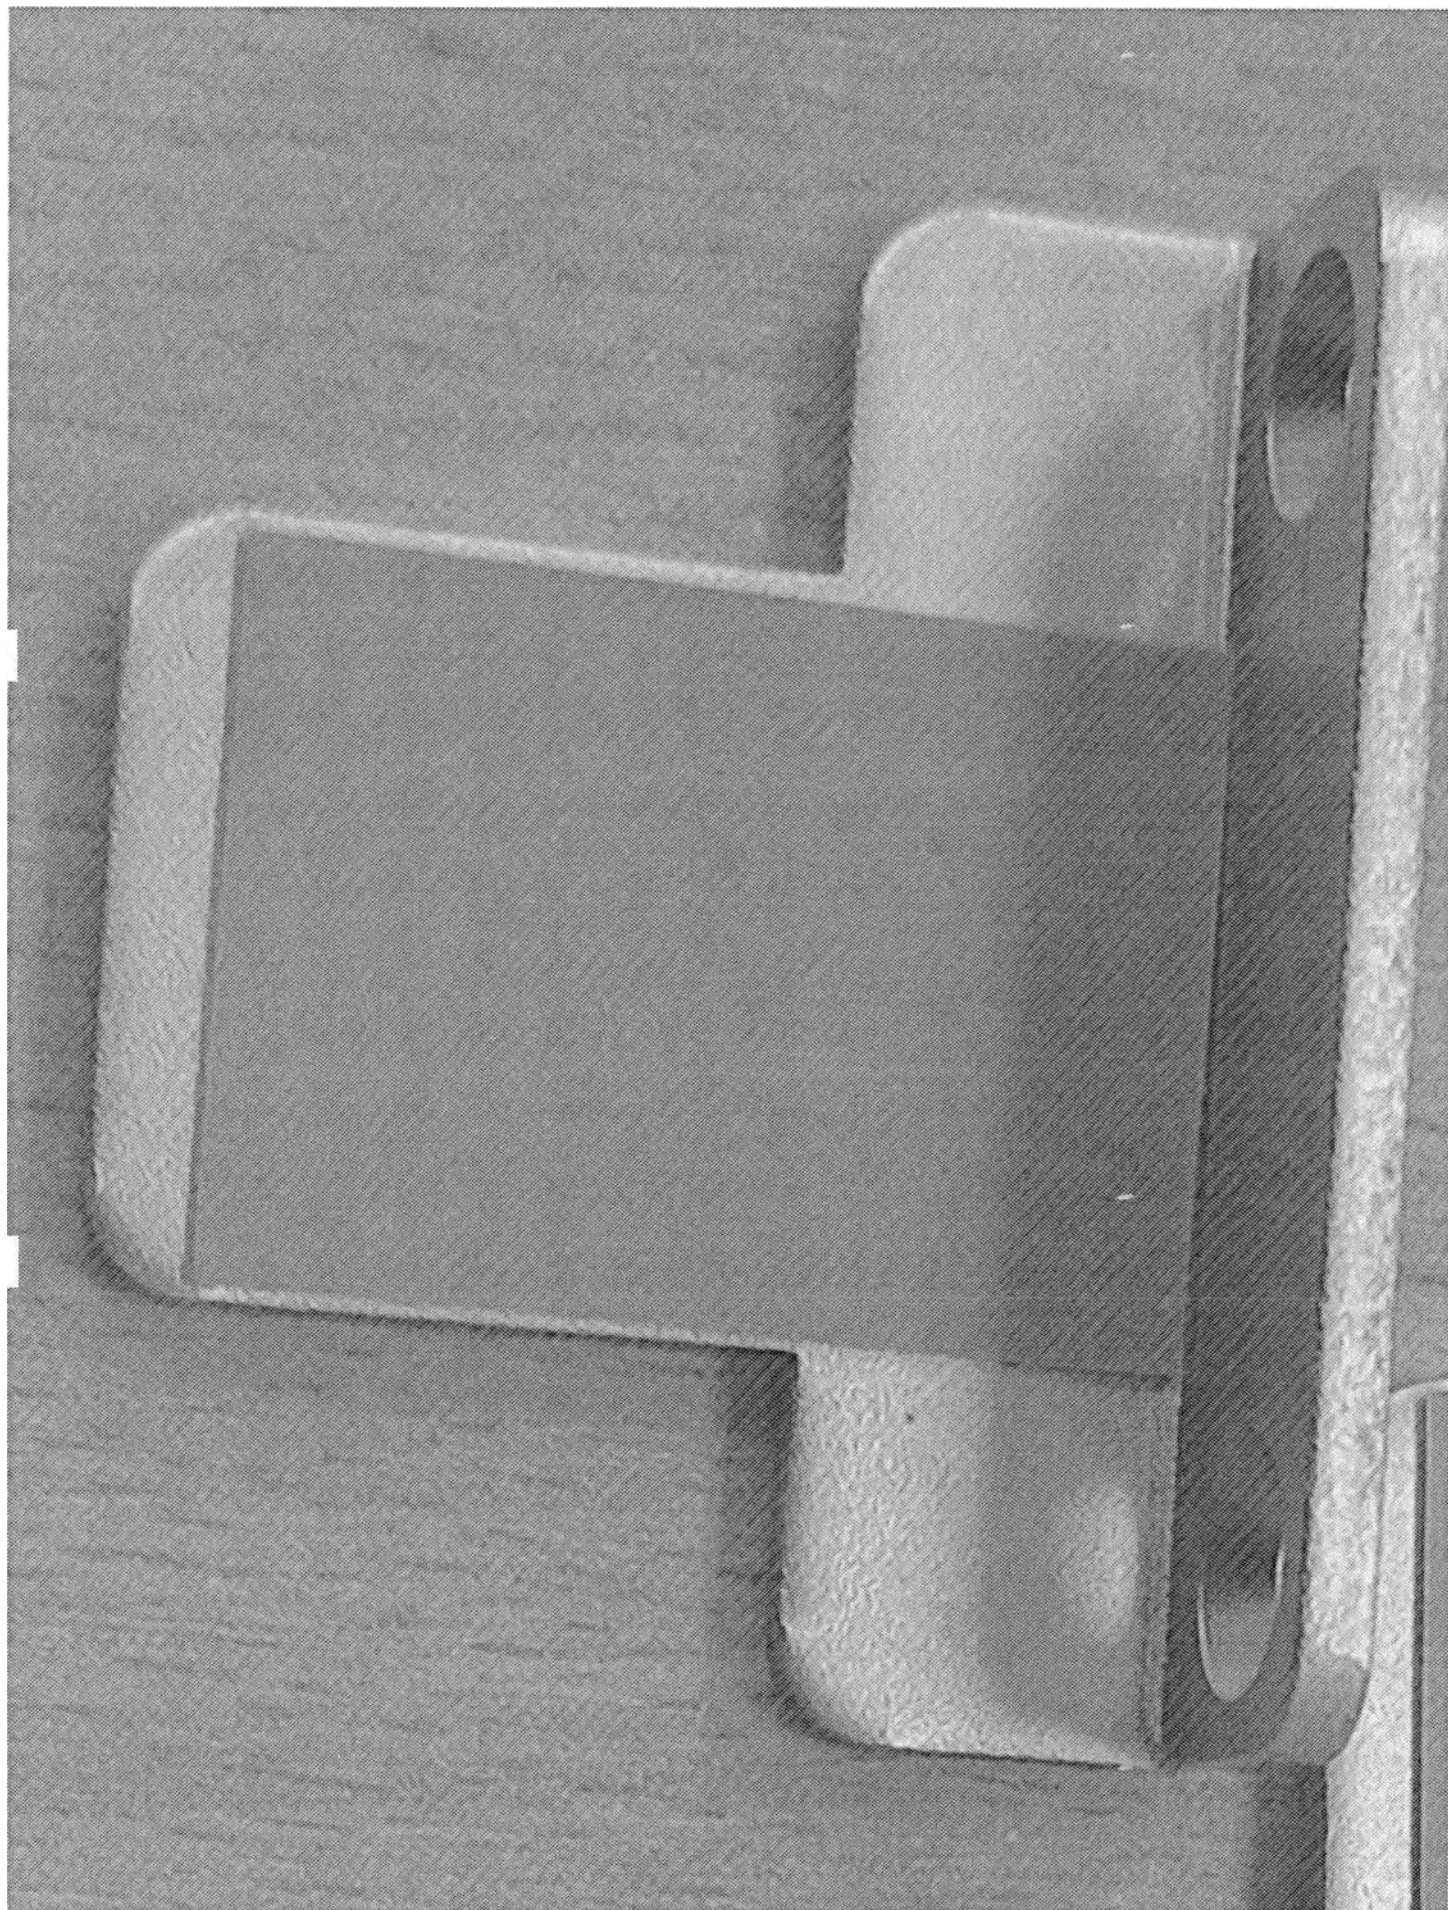


Фото 18: Комплект держателя пробирок для анализов: Кронштейн держателя



Фото 19: Комплект держателя пробирок для анализов: винты



Фото 20: Сумка для переноски

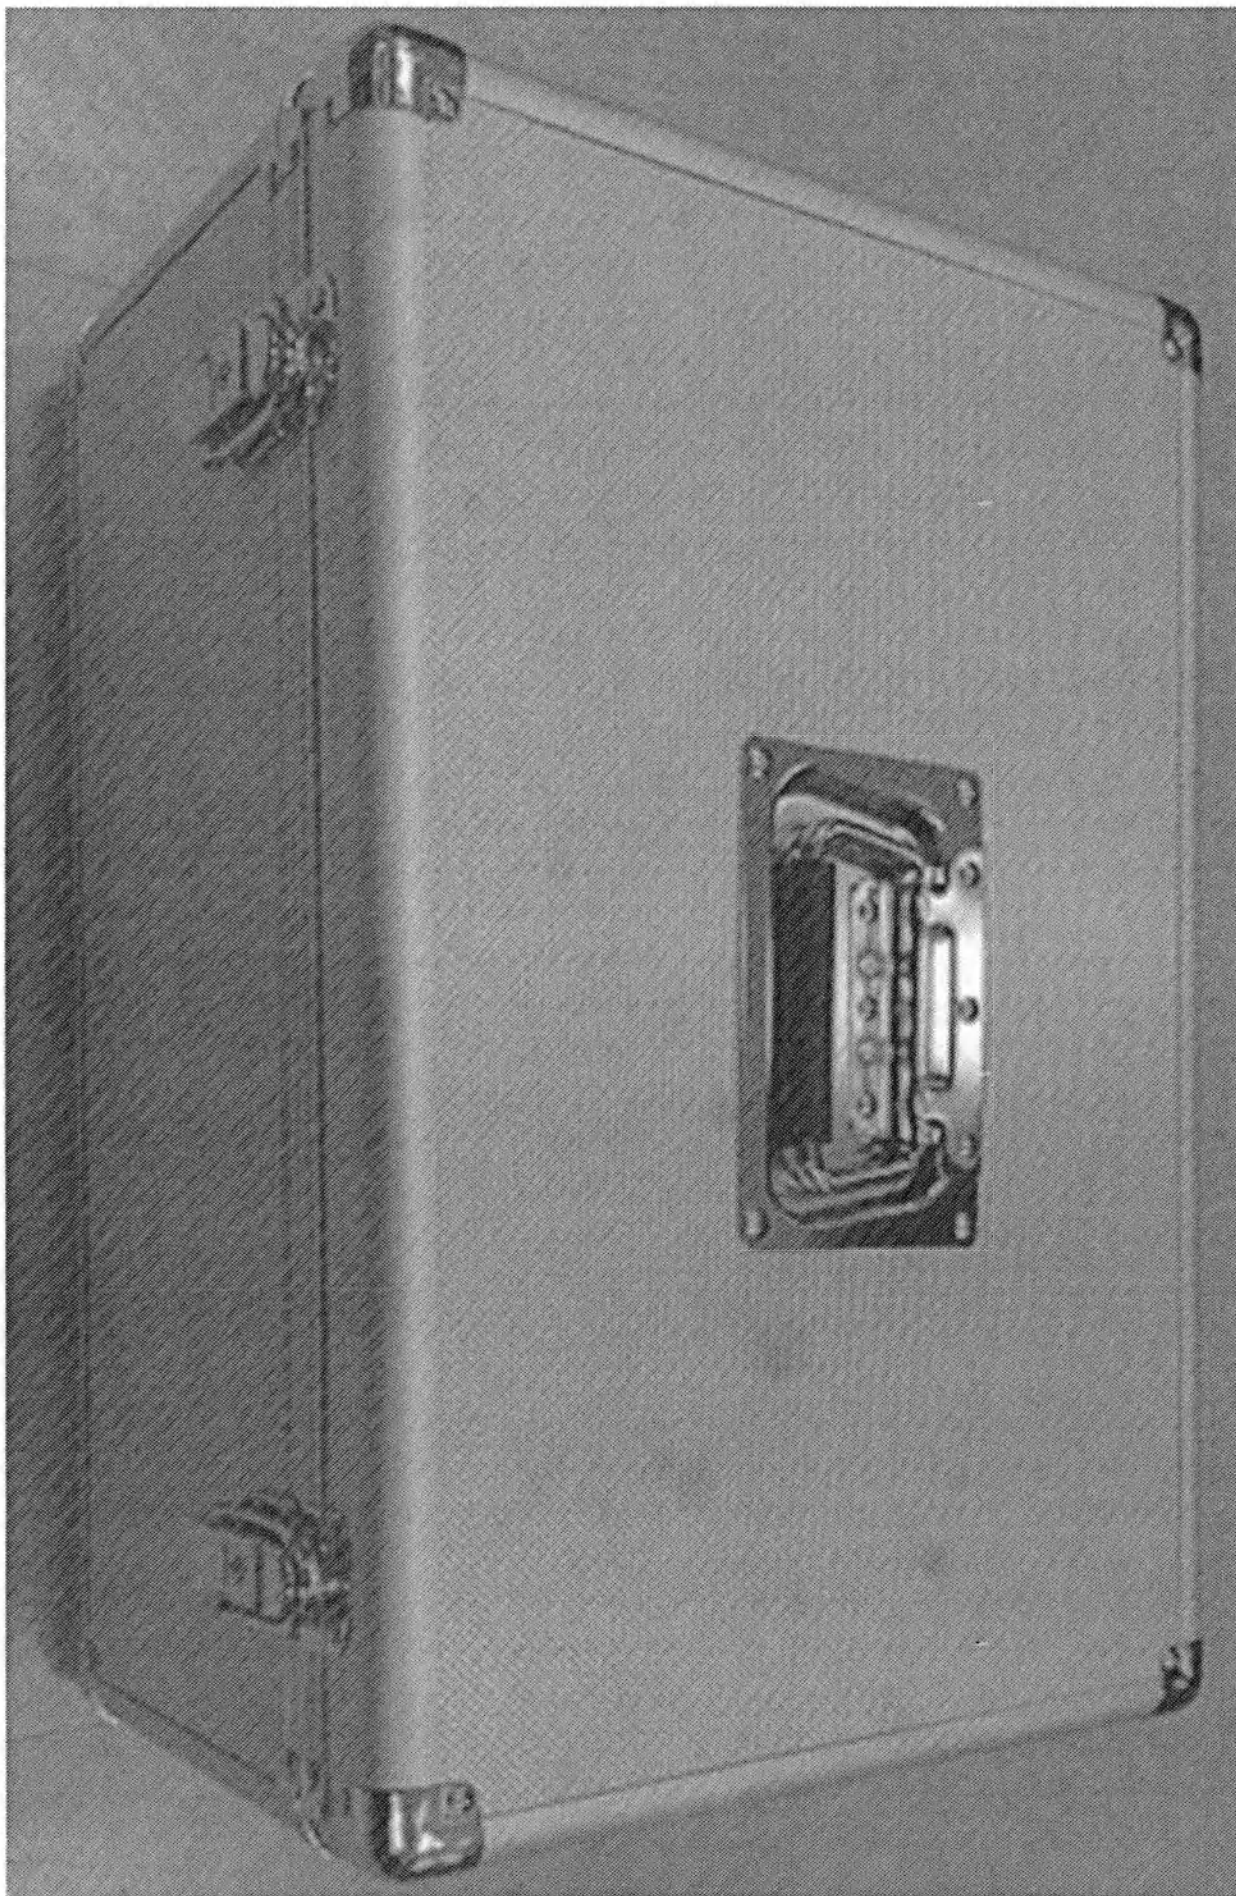


Фото 21: Чемодан для переноски

миксер донорской крови модель CM760



Фото 22: 1 - Блок основной, 2- лоток стандартный

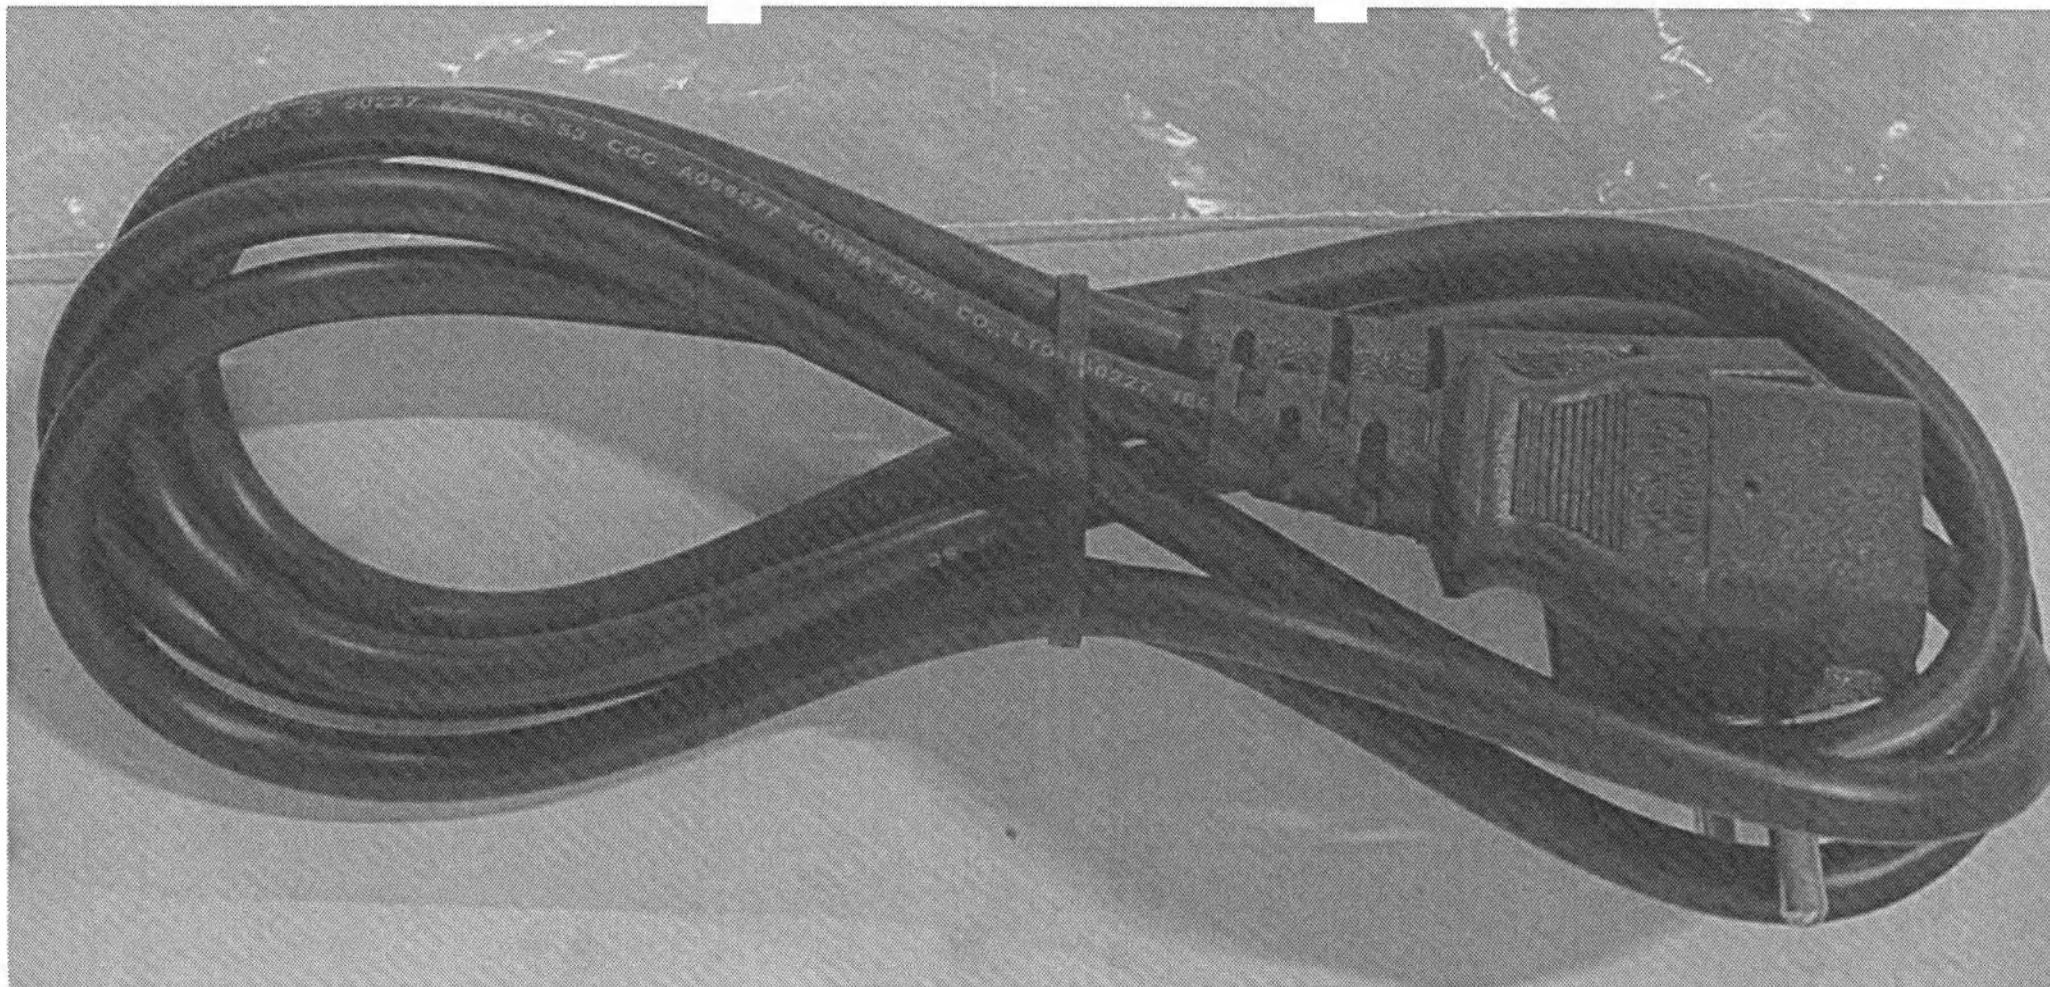


Фото 23: Шнур сетевой

Фото 24: Адаптер питания





Фото 25: Пакет управления данными P760D: Сканер штрих-кодов

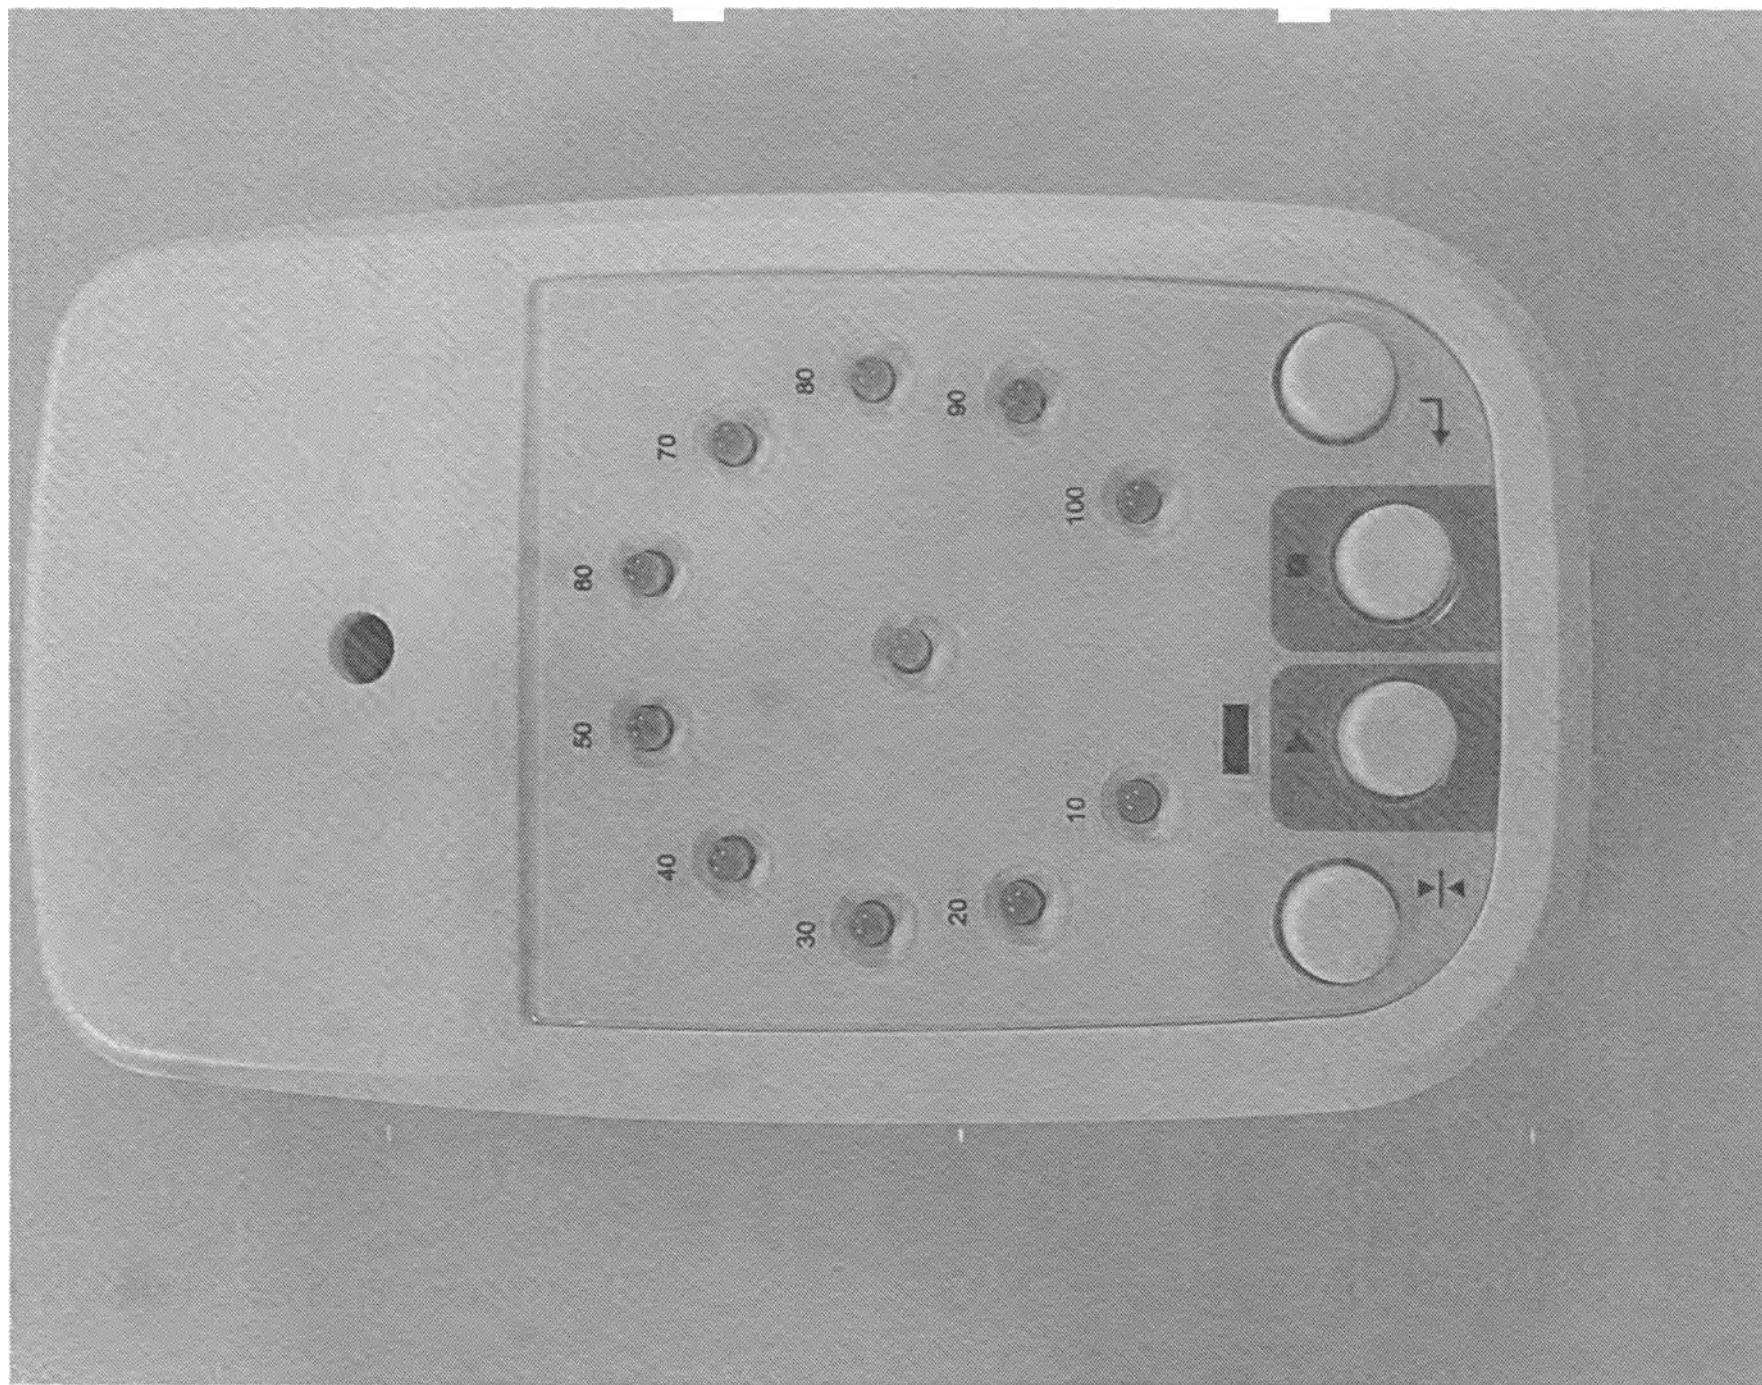


Фото 26: Пакет управления данными Р760D: пульт дистанционного управления

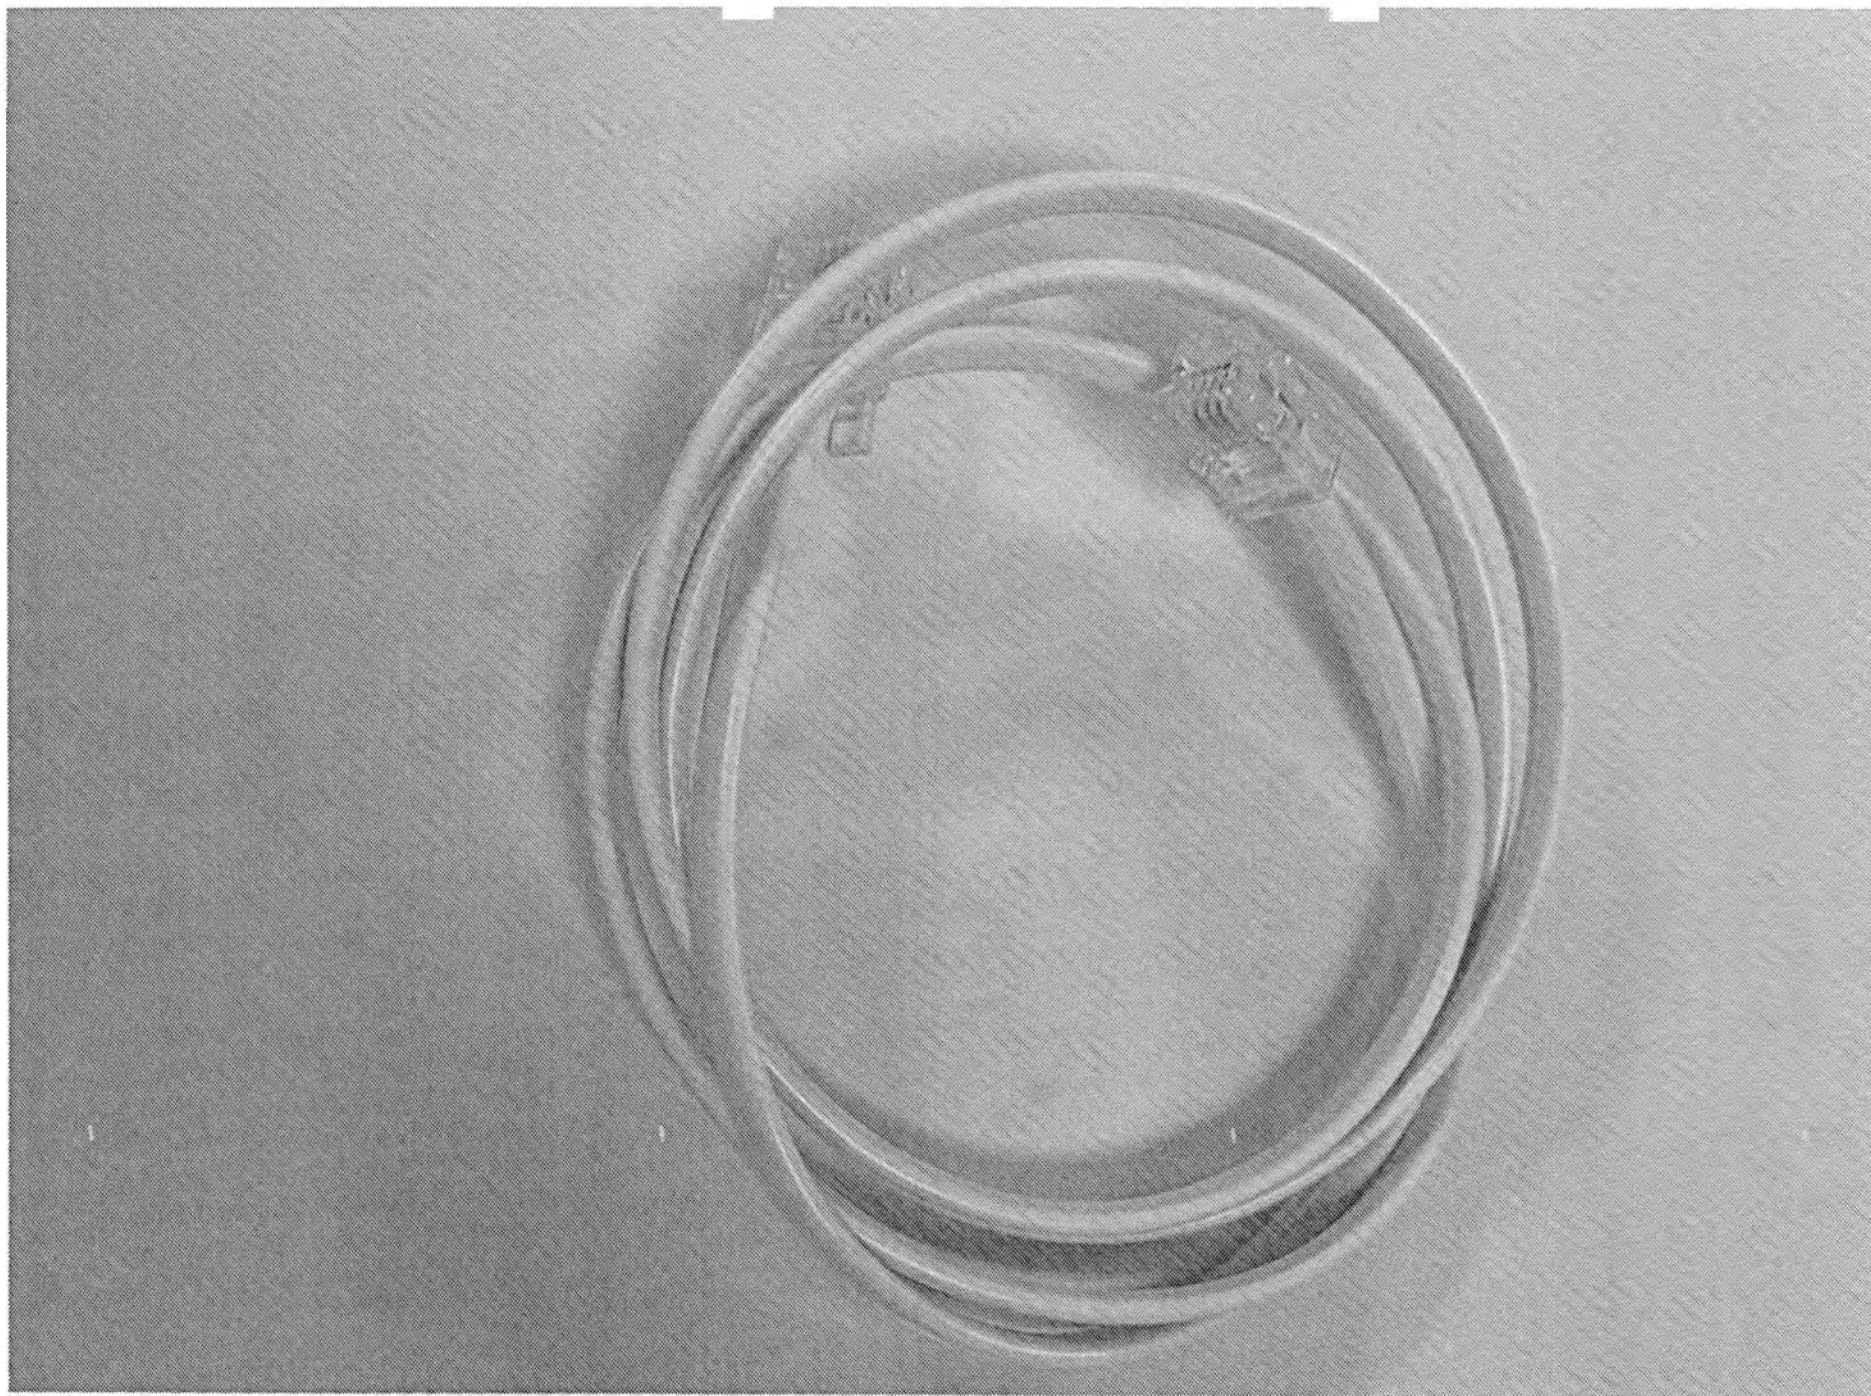


Фото 27: Пакет управления данными Р760D: кабель для подключения пульта дистанционного управления



Фото 28: Пакет управления данными Р760D: USB-накопитель


Cursor Move

[NEXT]




Blood Type

O




=%5500

B



=%7700

O



=%5100

Rh+


B



=%7300

Rh+


O



=%9500

Rh-


B



=%1700


Rh-

A




=%6600

AB



=%6800


A



=%5200

Rh+


AB



=%8400

Rh+


A



=%0600

Rh-

AB



=%2800

Rh-

Фото 29: Пакет управления данными P760D: лист этикеток со штрих-кодами

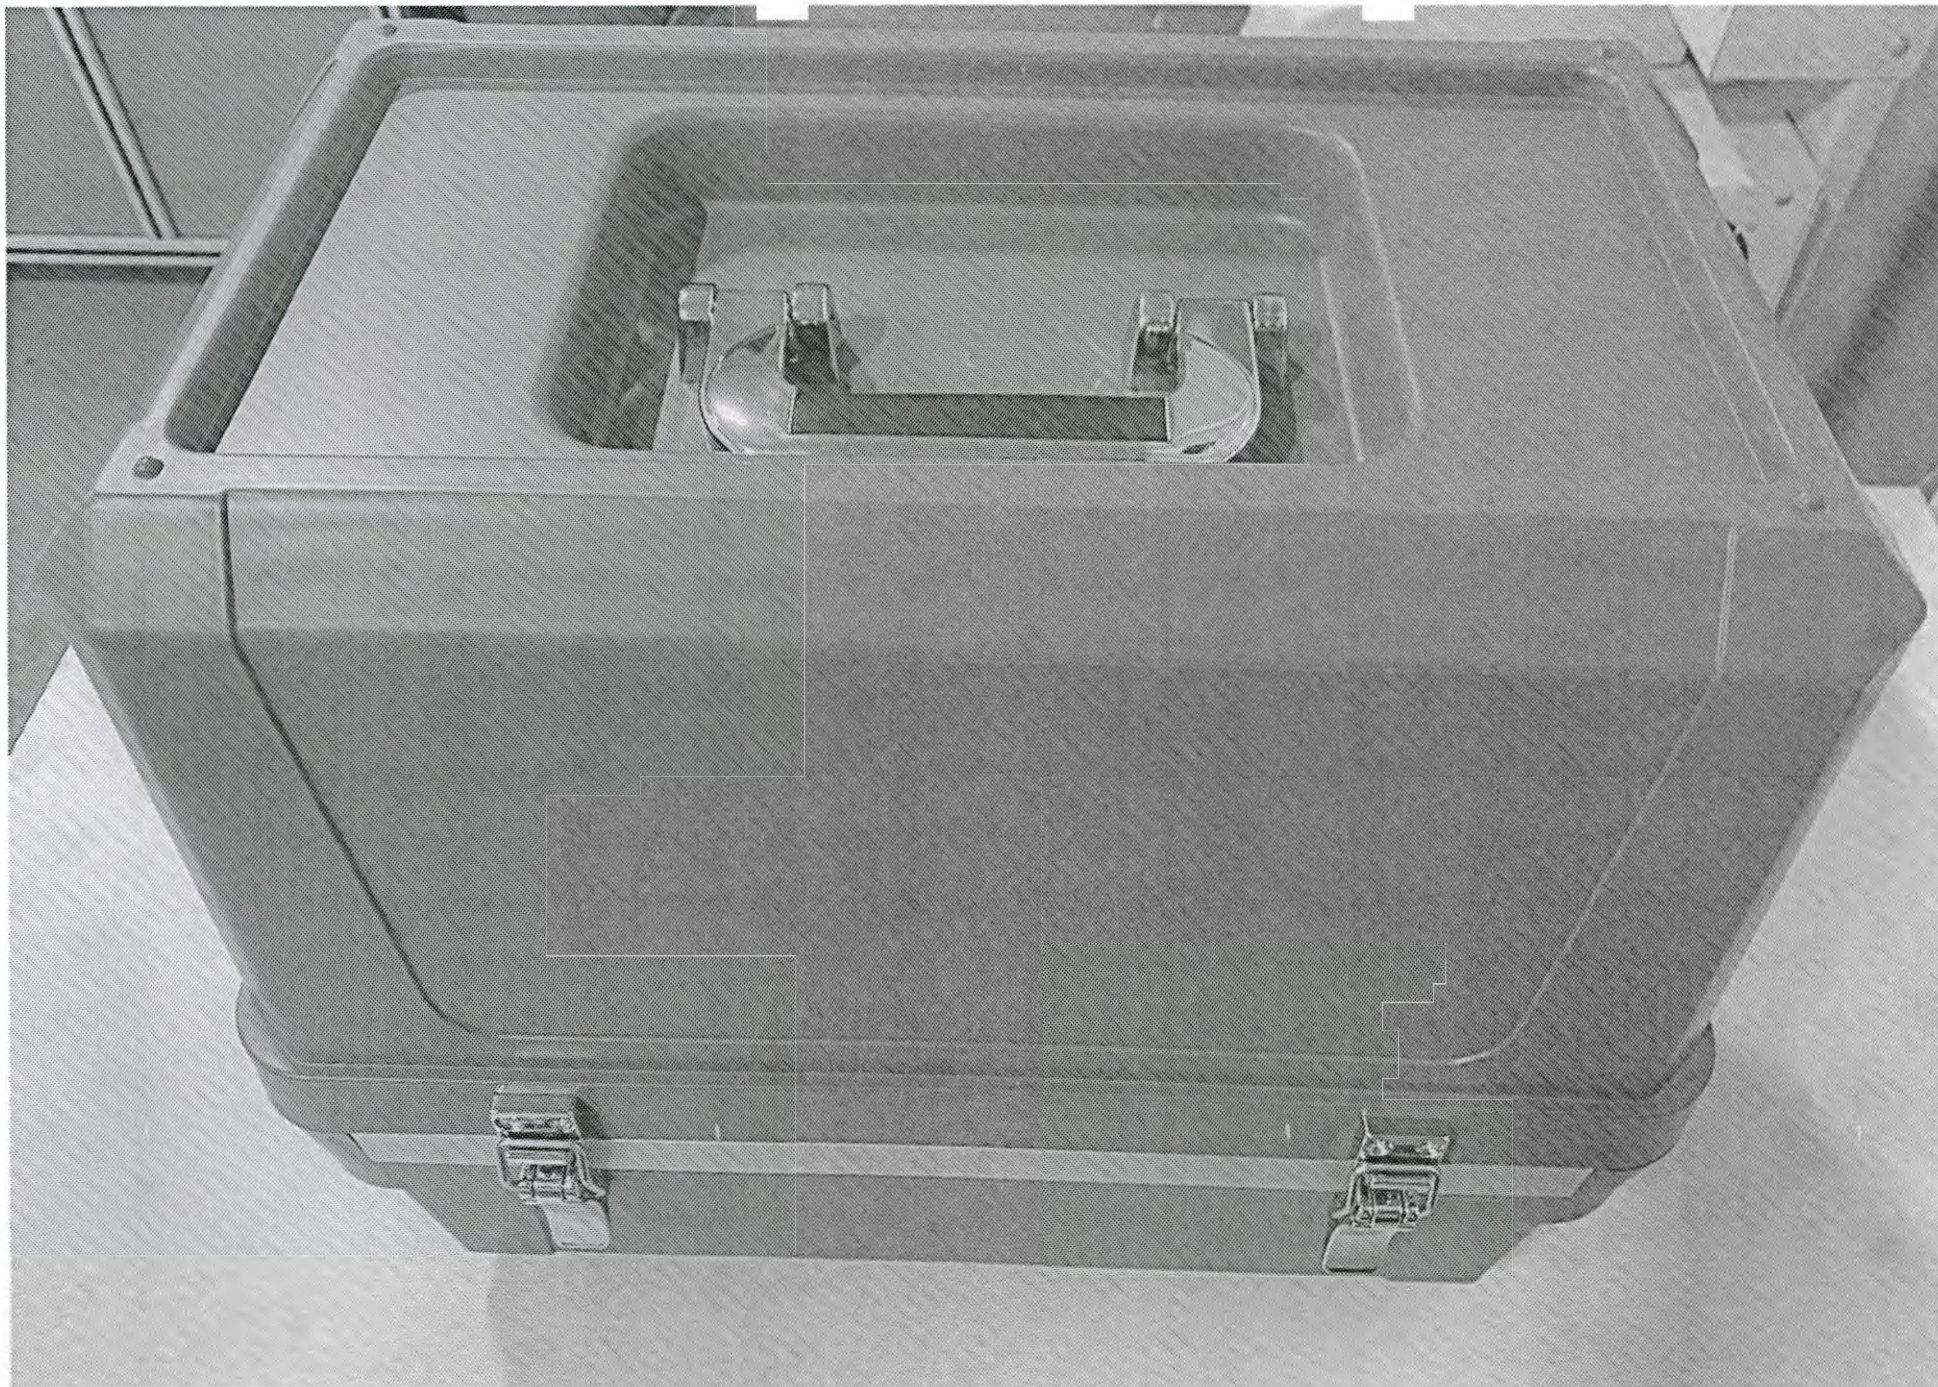


Фото 30: Пакет для переноски Р760С: кейс для переноски

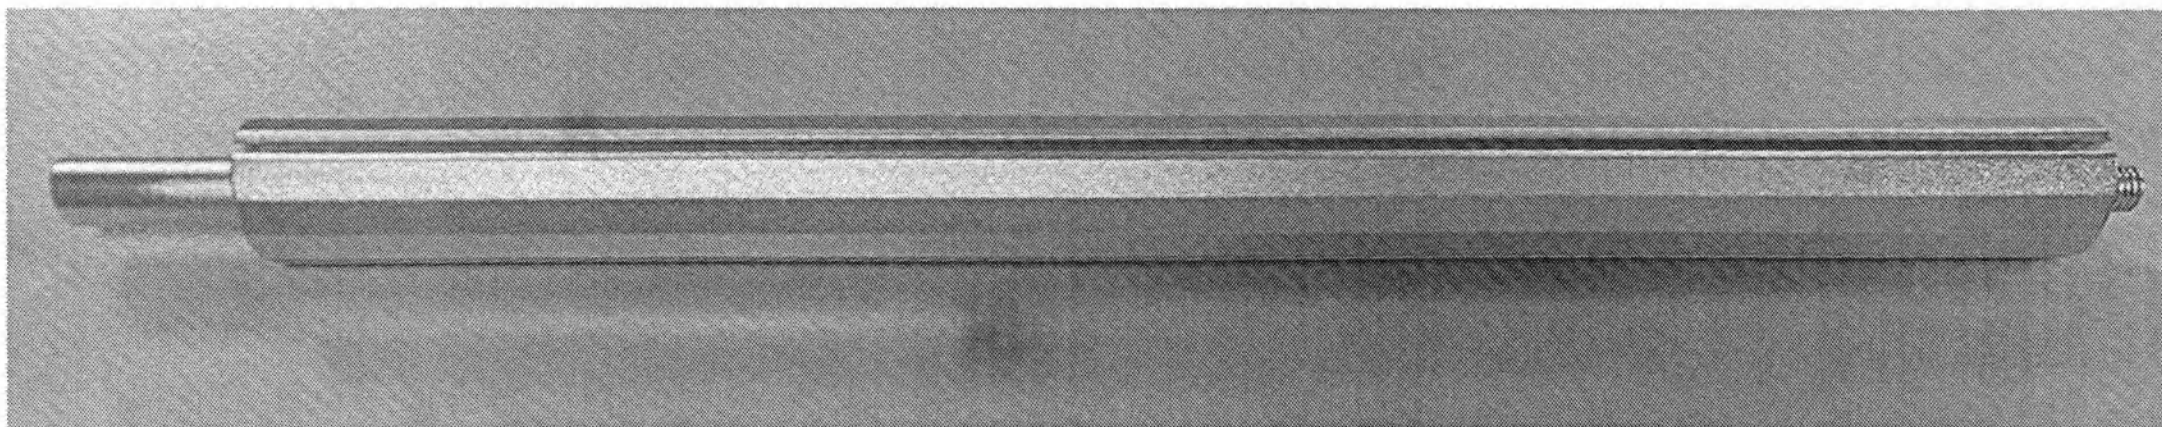


Фото 31: Пакет для переноски Р760С: Комплект для монтажа на стойку - Стойка

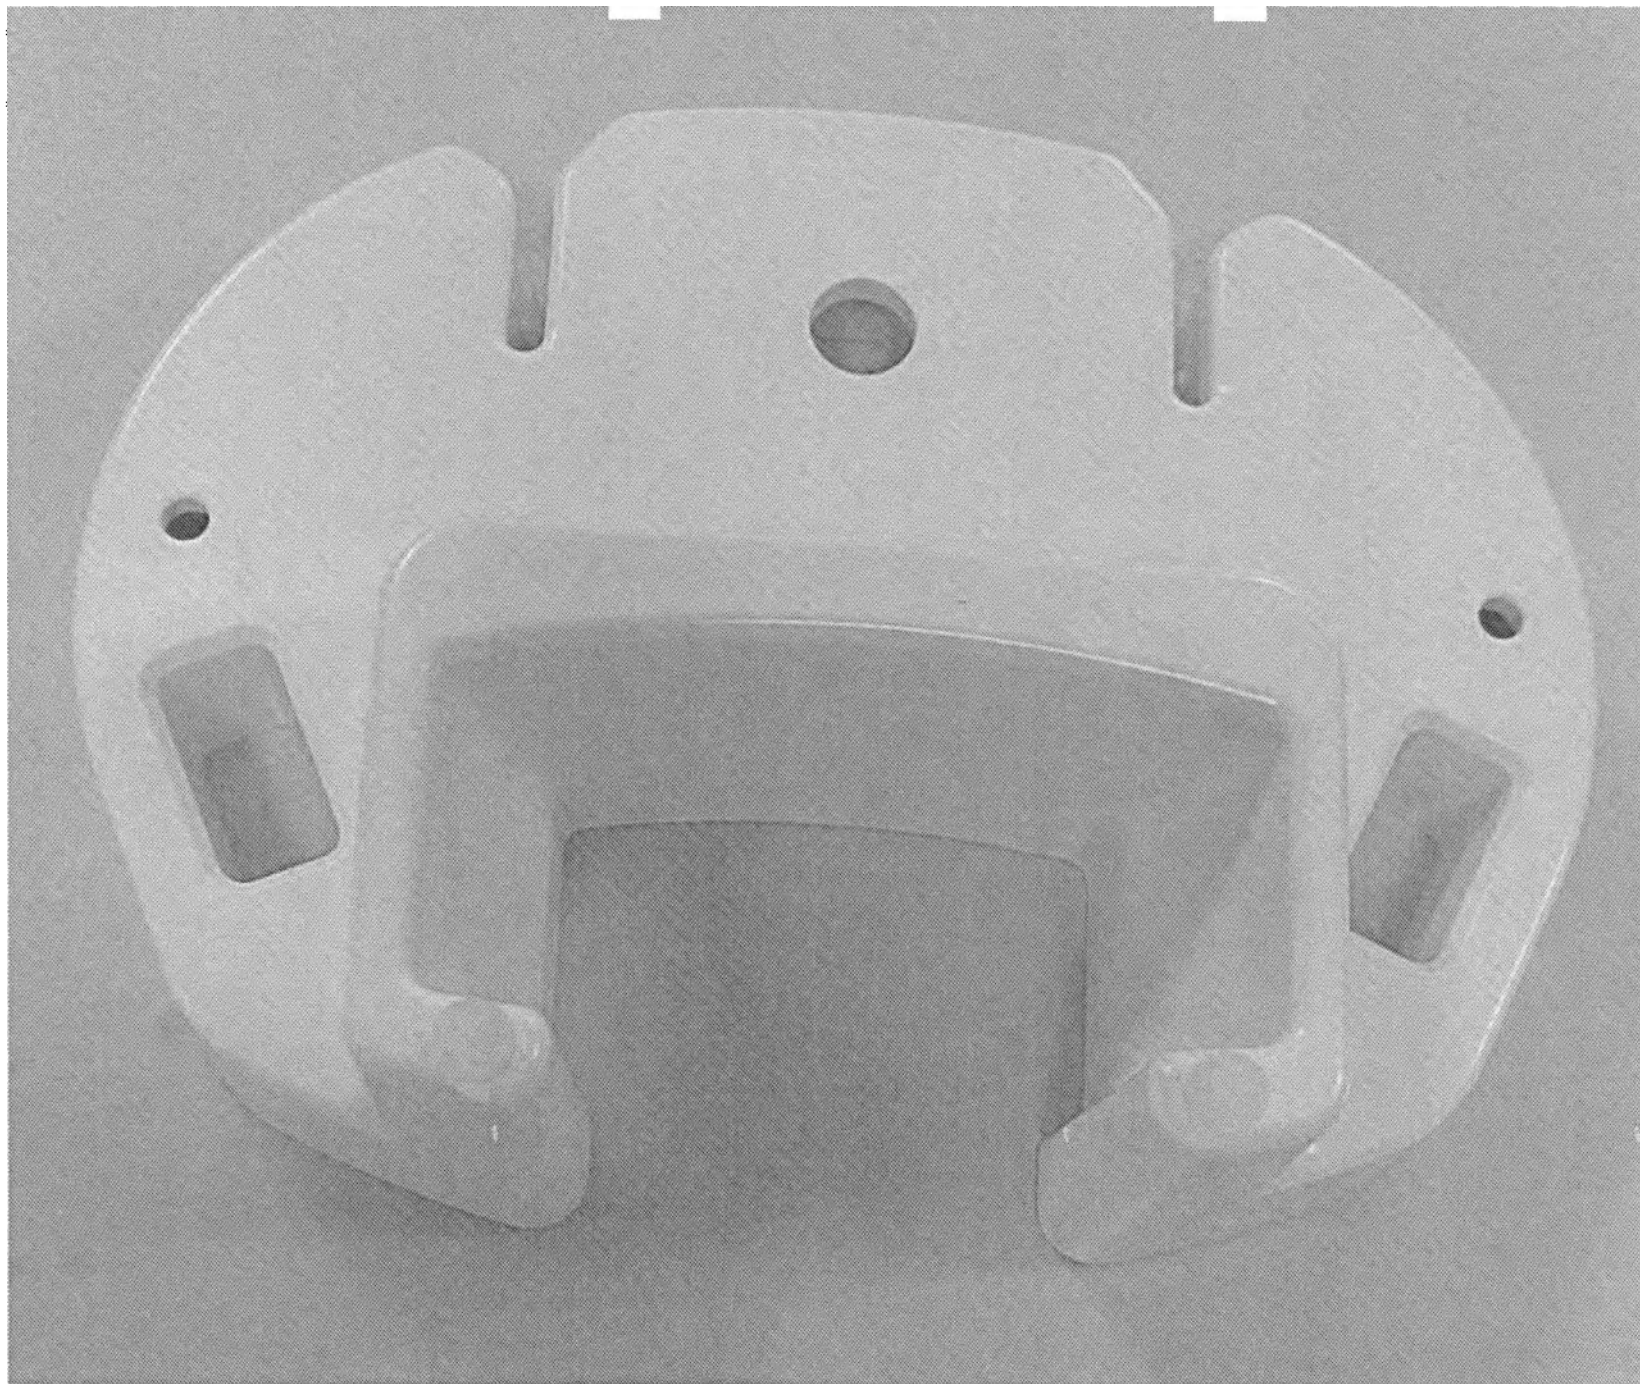


Фото 32: Пакет для переноски Р760С: Комплект для монтажа на стойку - держатель сканера штрих-кодов

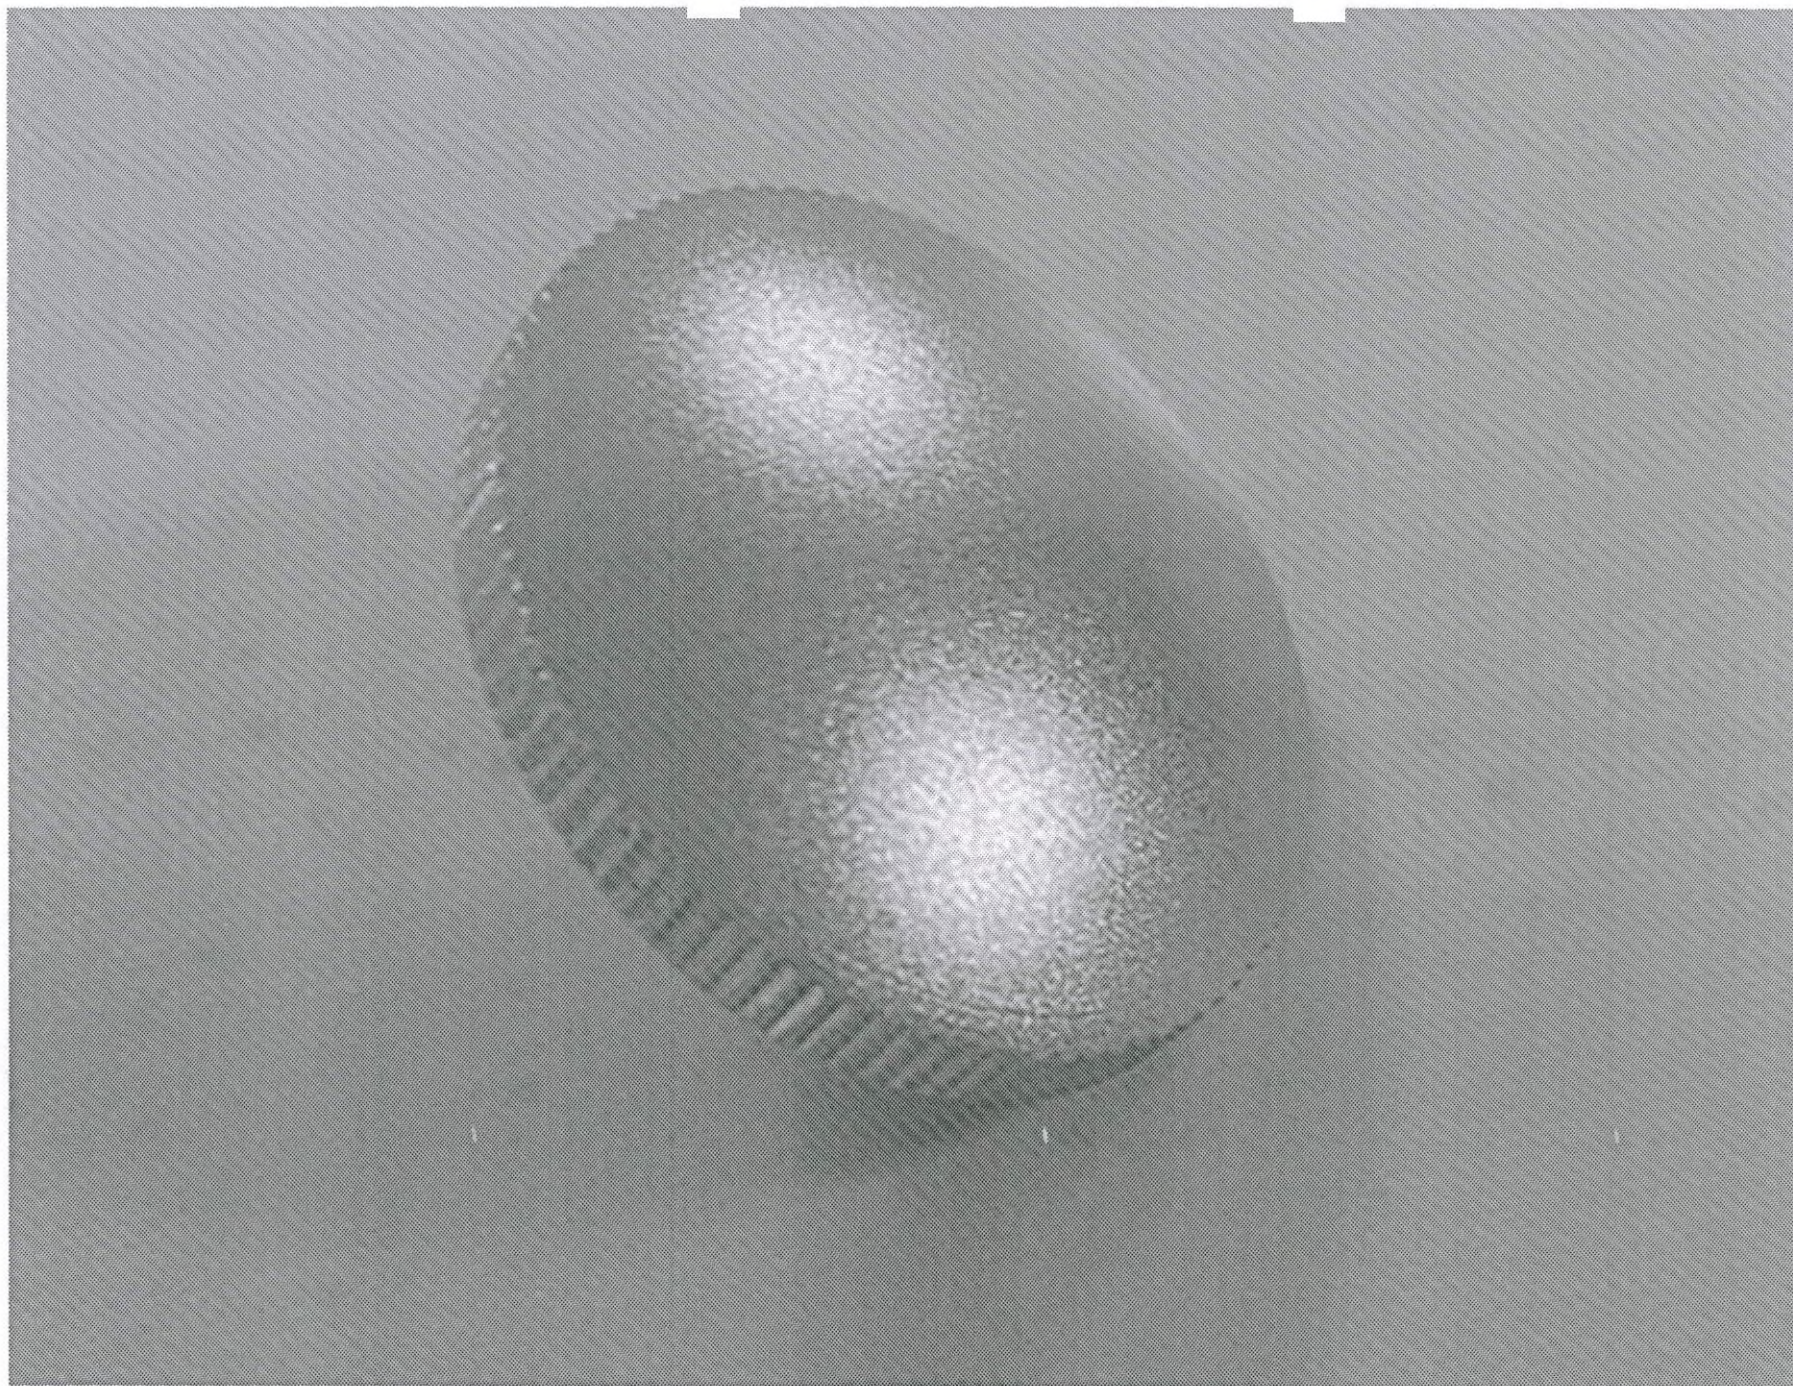


Фото 33: Пакет для переноски Р760С: Комплект для монтажа на стойку - винт с барашком

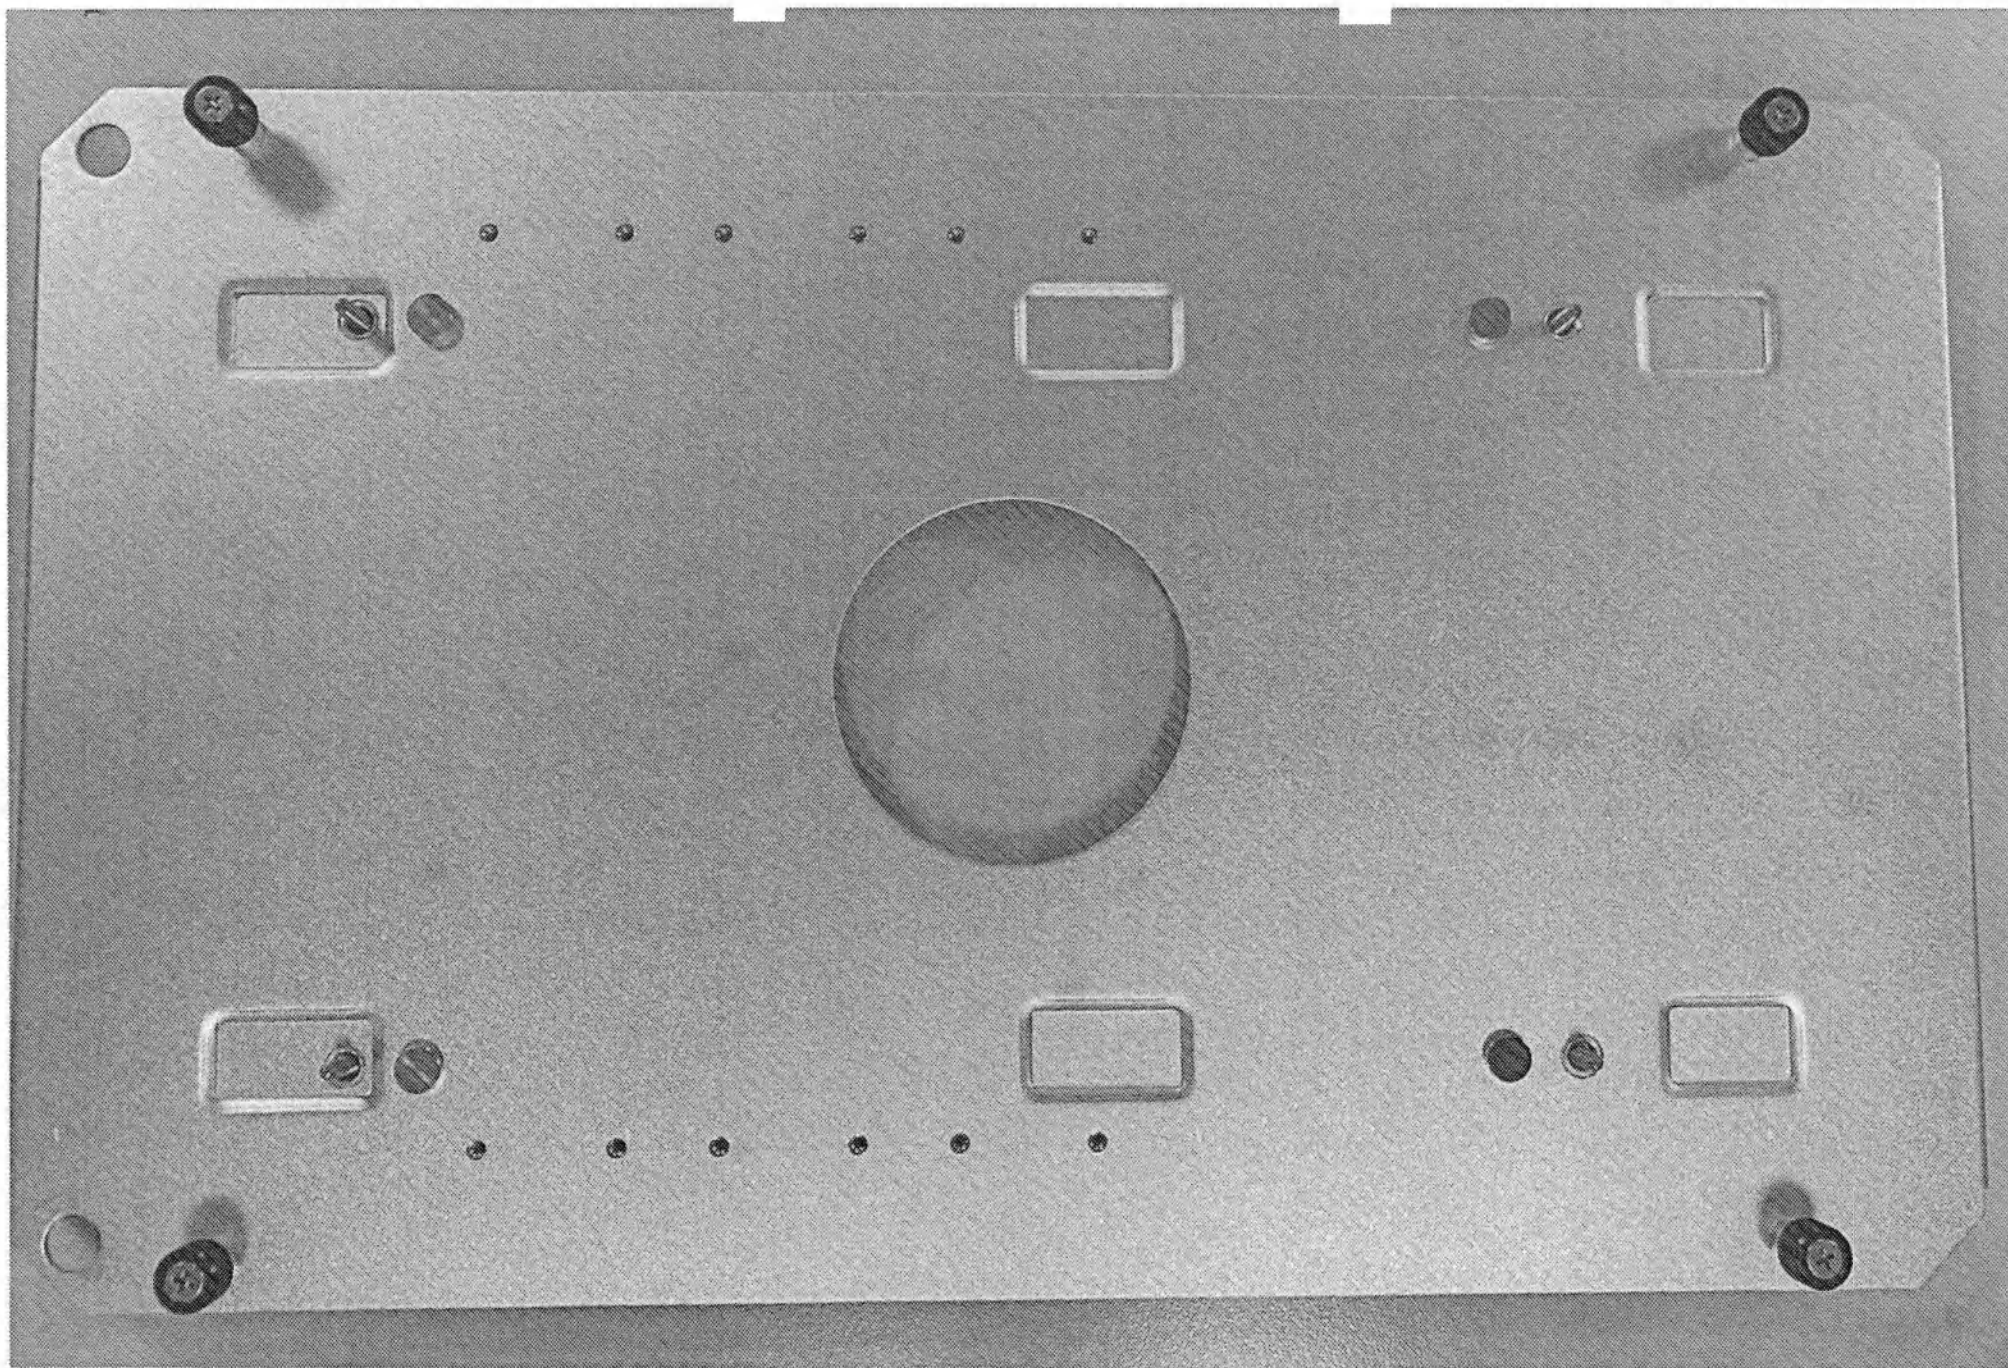


Фото 34: Пакет для переноски Р760С: платформа для установки устройства



Фото 35: Пакет для переноски Р760С: удлинительный адаптер штекера

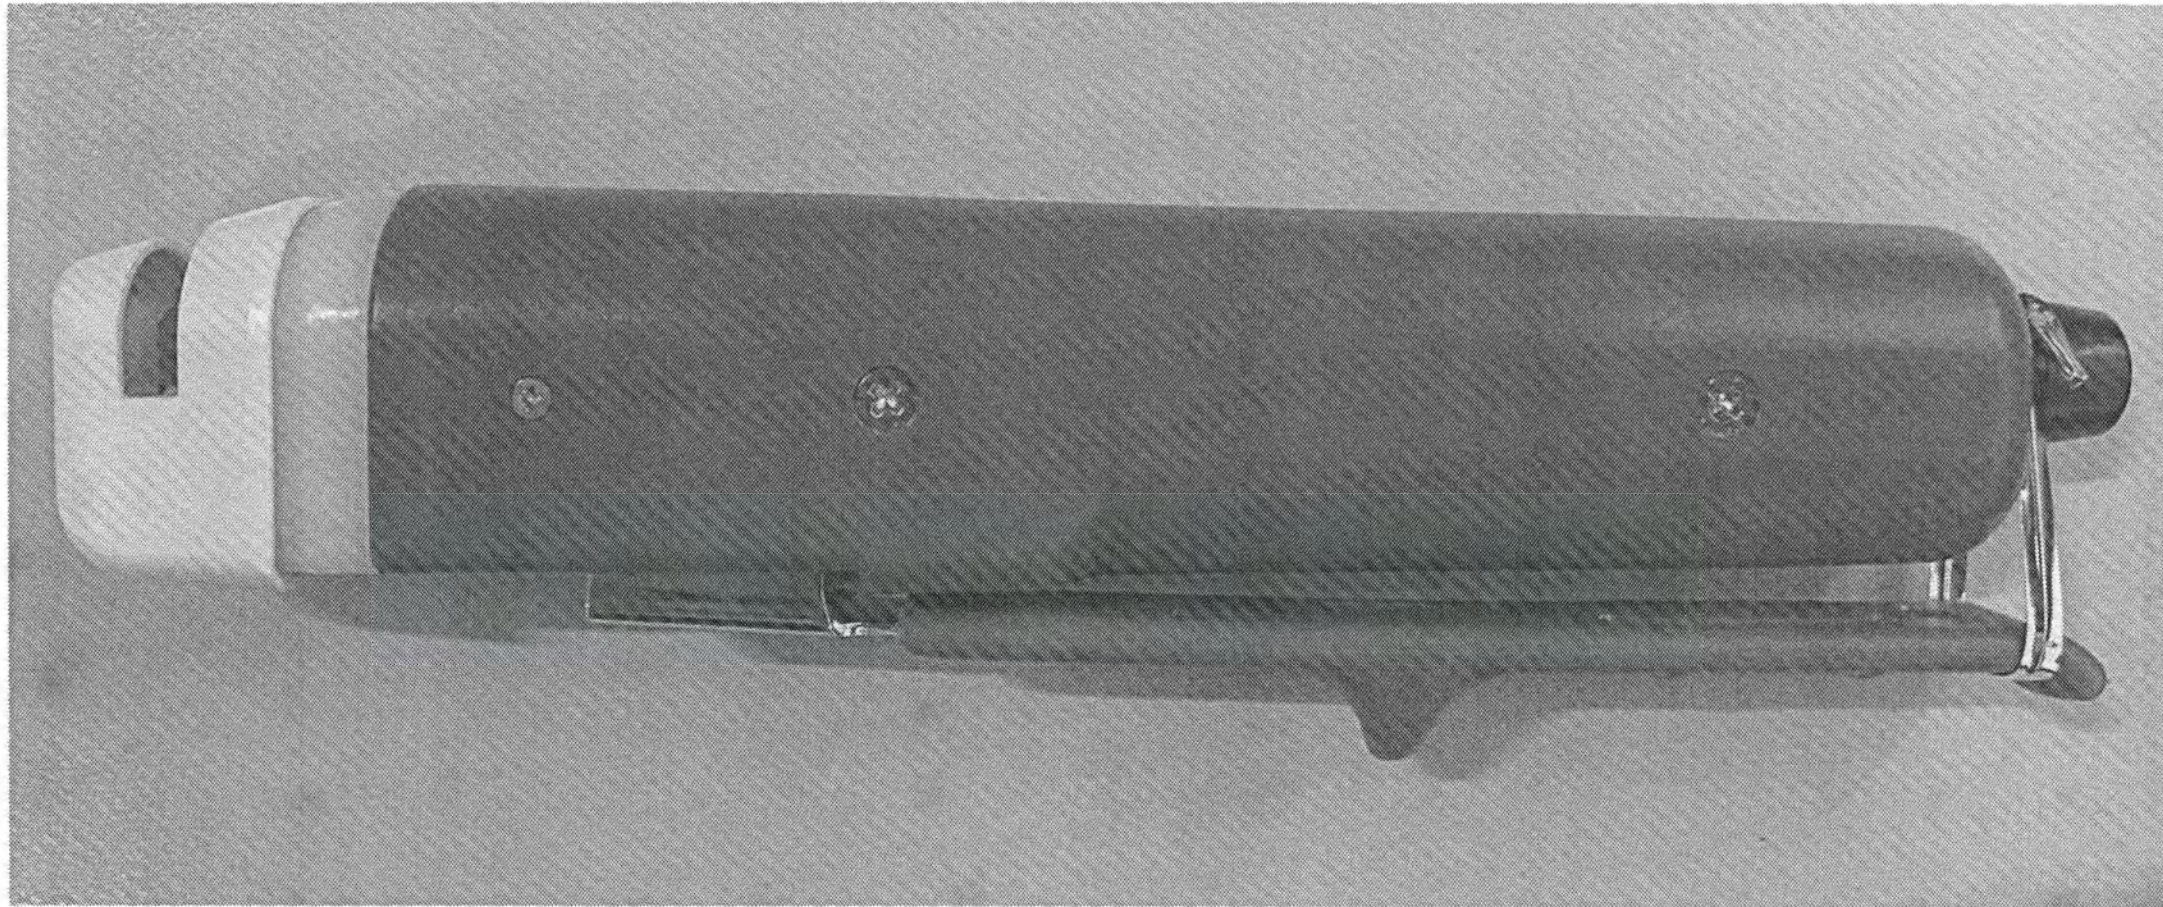


Фото 36: Пакет запаиватель магистралей Р760S: Выносное запаивающее устройство

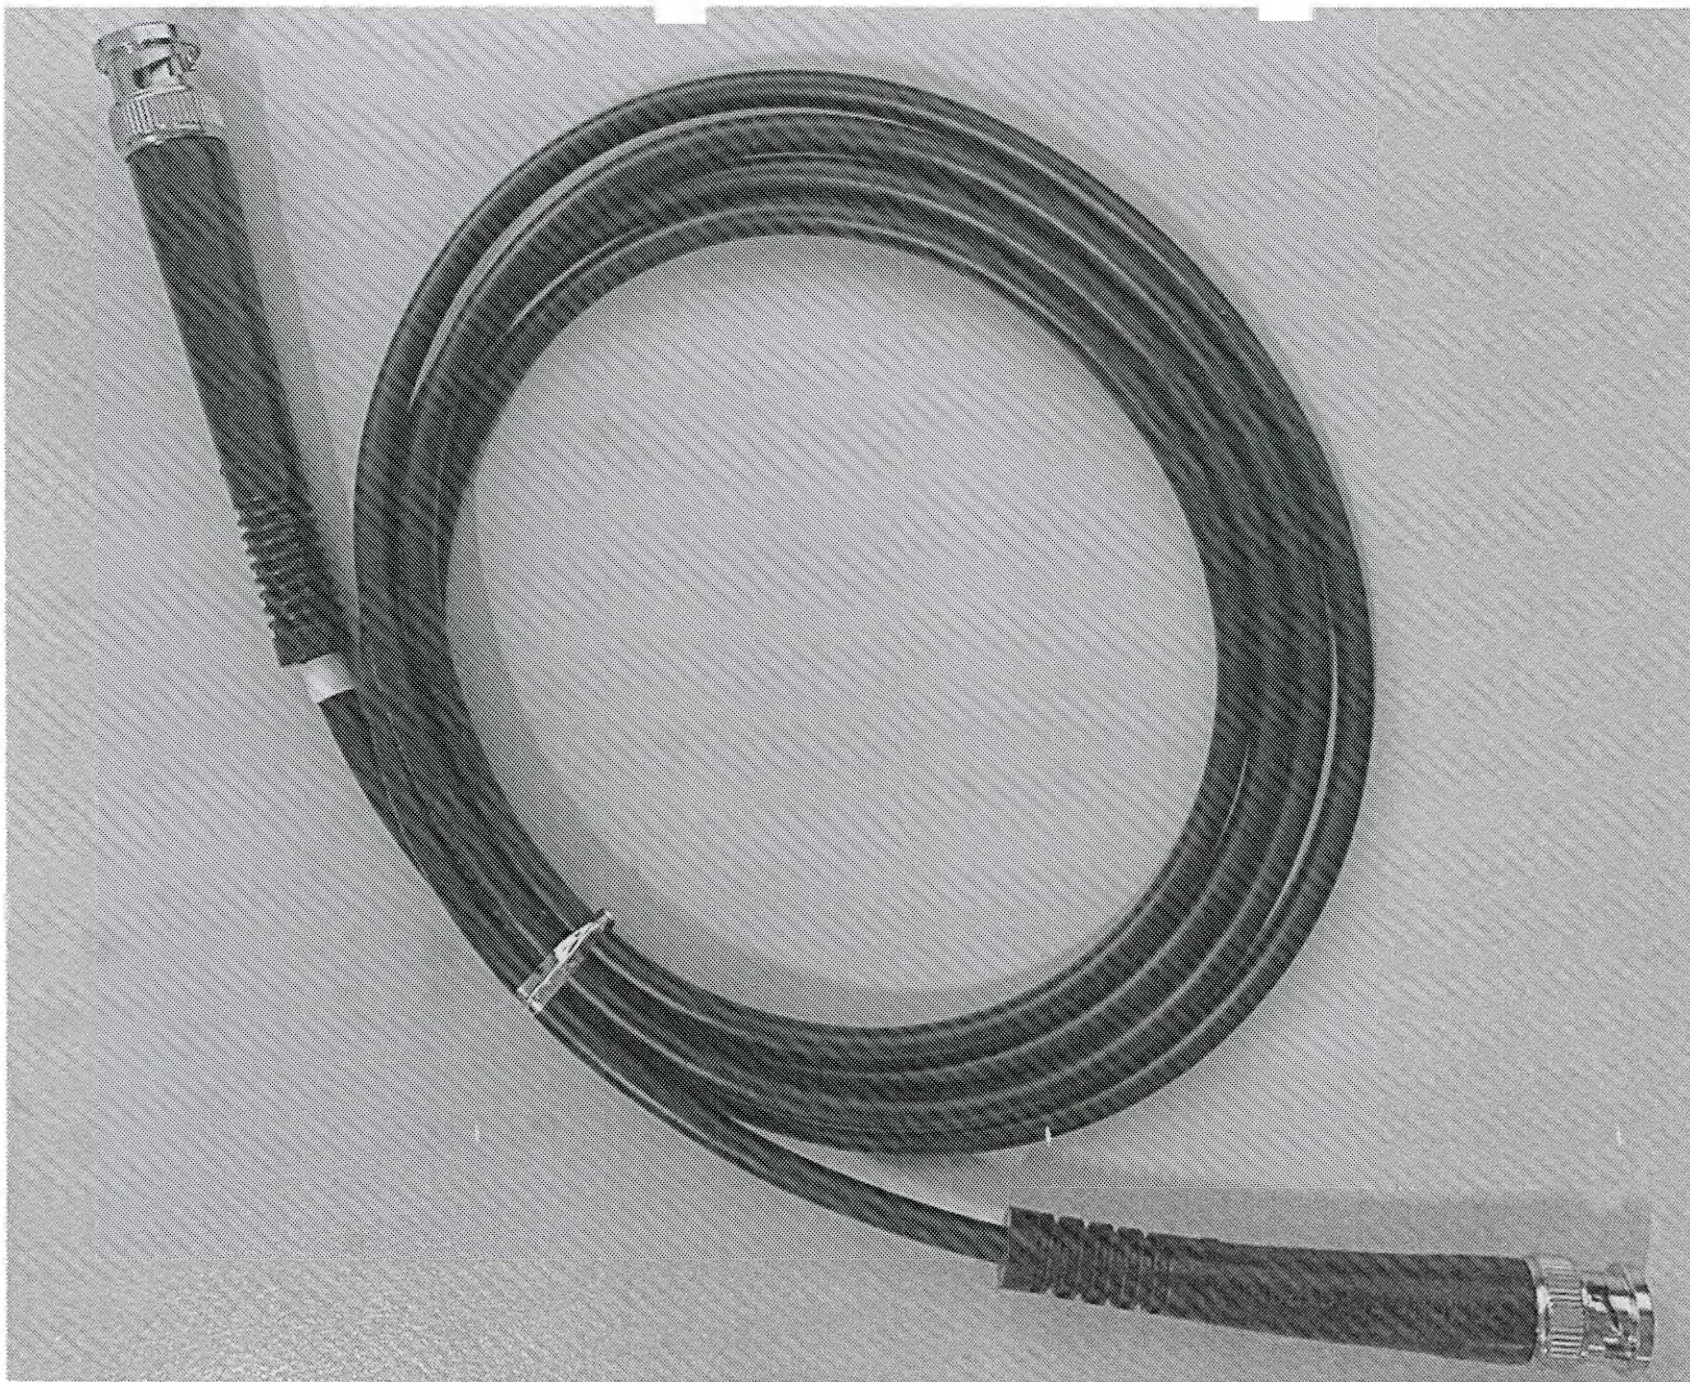


Фото 37: Пакет запаиватель магистралей P760S: ВЧ коаксиальный кабель

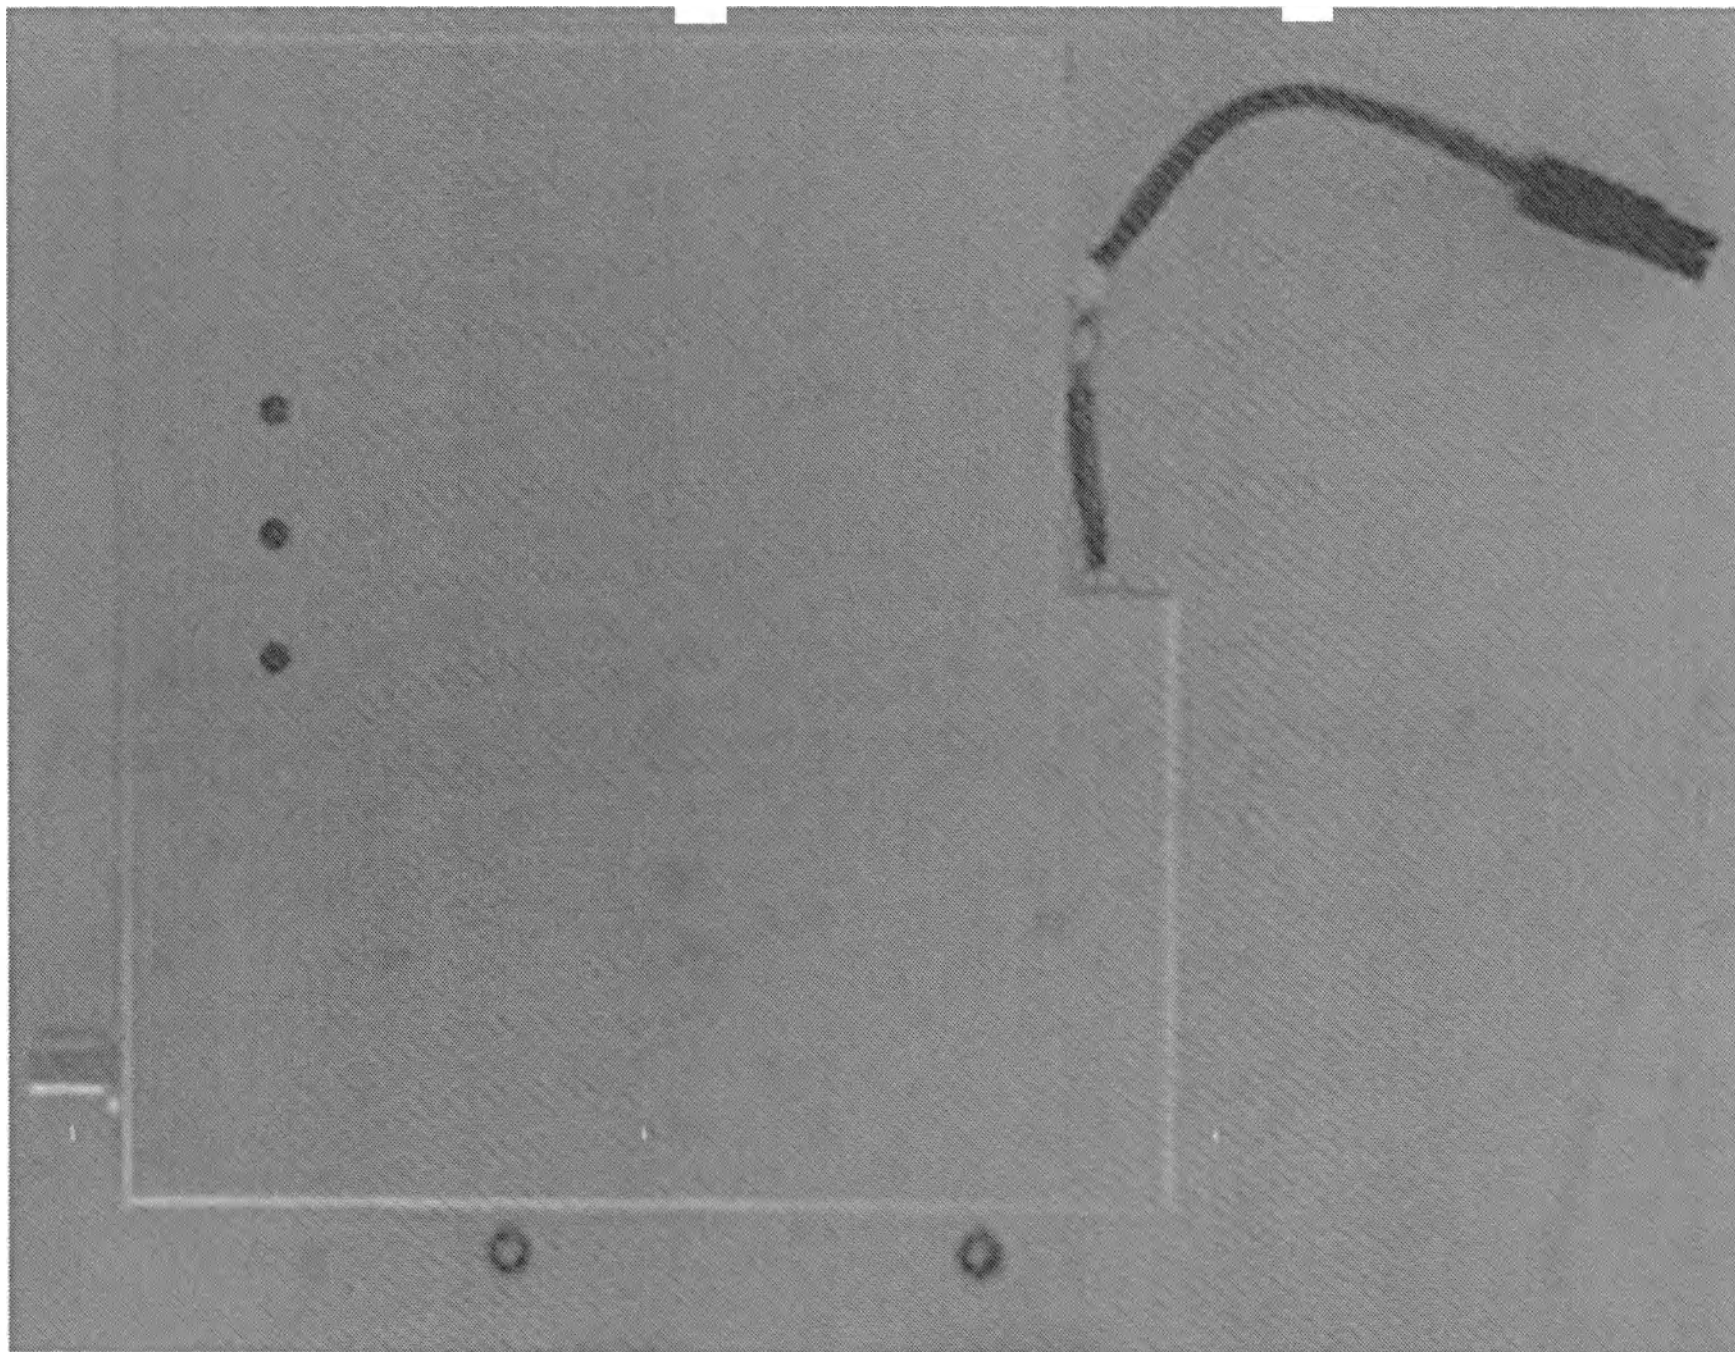


Фото 38: Пакет запаиватель магистралей P760S: Встраиваемый модуль для запаивания магистралей контейнеров для заготовки крови и ее компонентов

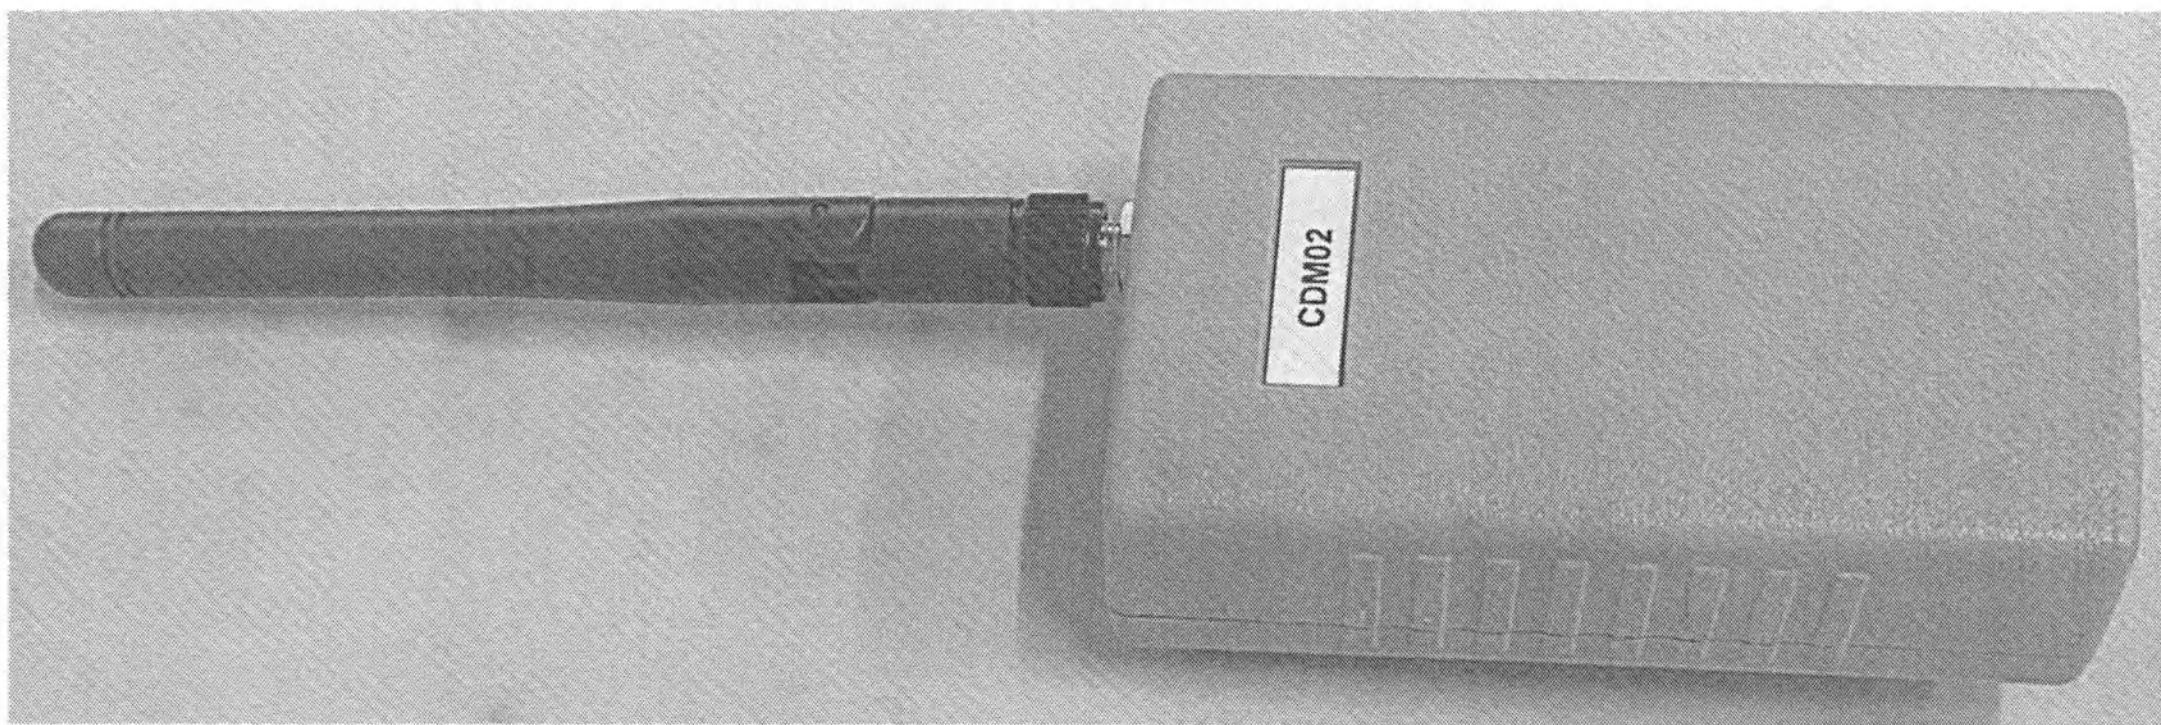


Фото 39: Менеджер сбора данных CDM02: CDM модуль

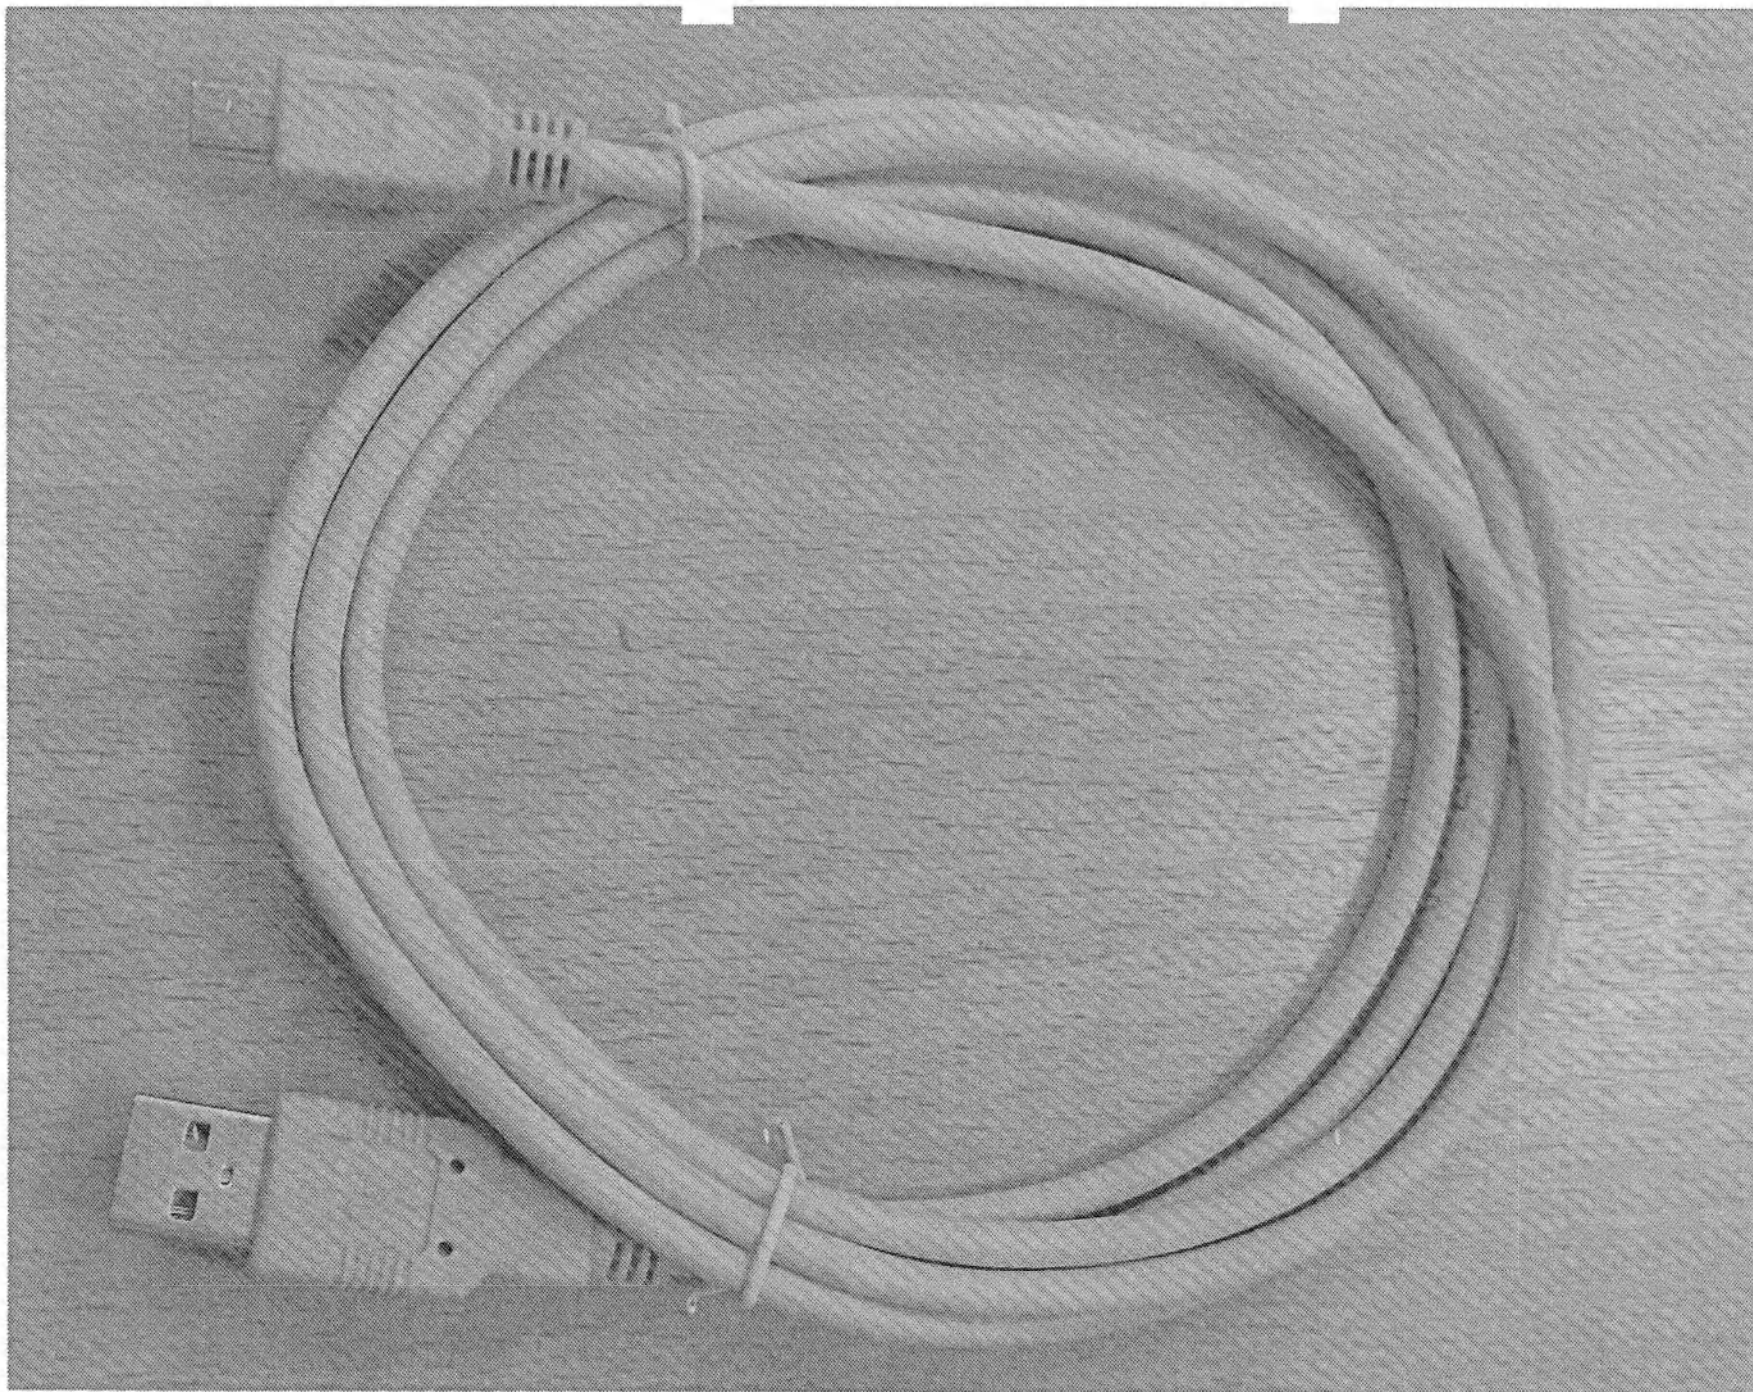


Фото 40: Менеджер сбора данных CDM02: Кабель

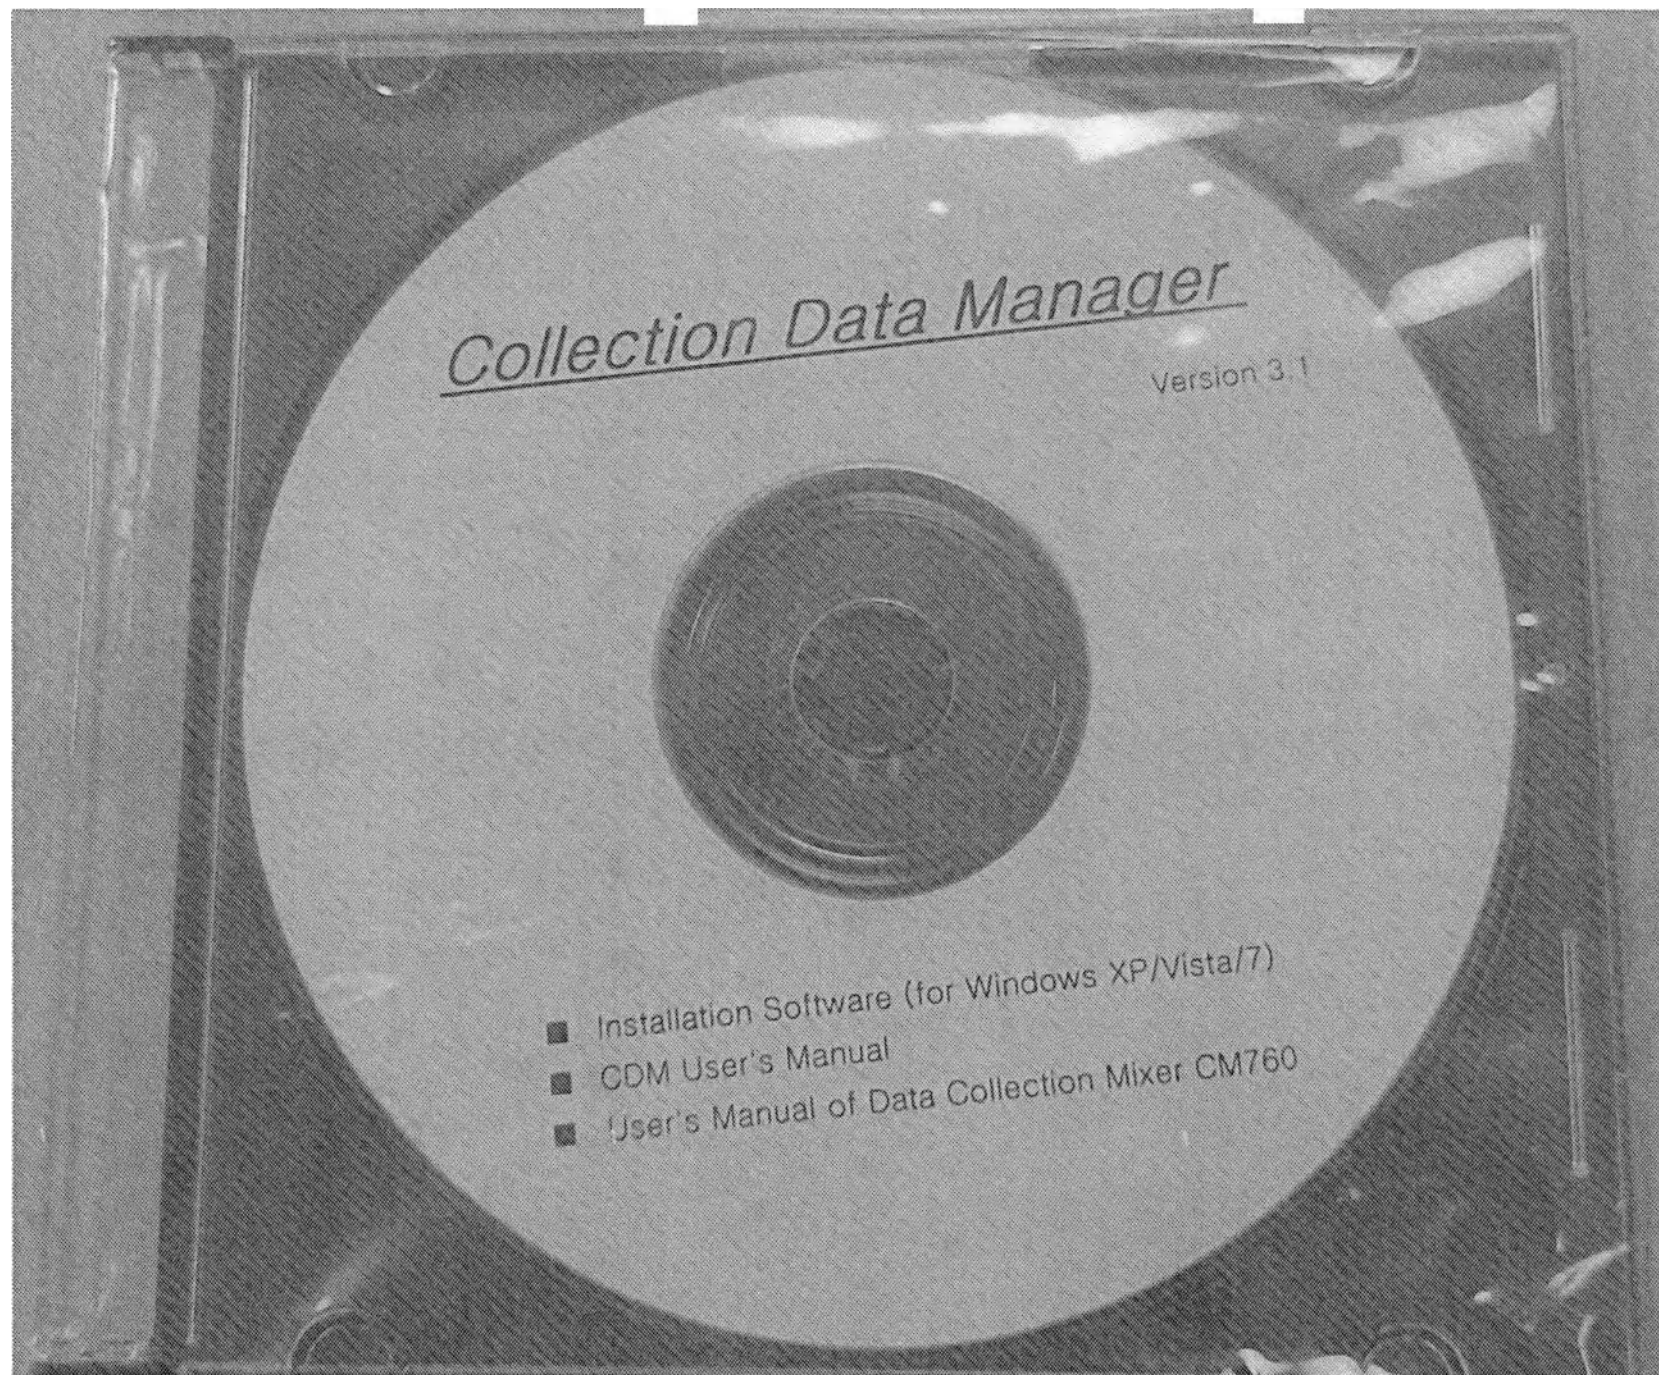


Фото 41: Менеджер сбора данных CDM02: CD диск

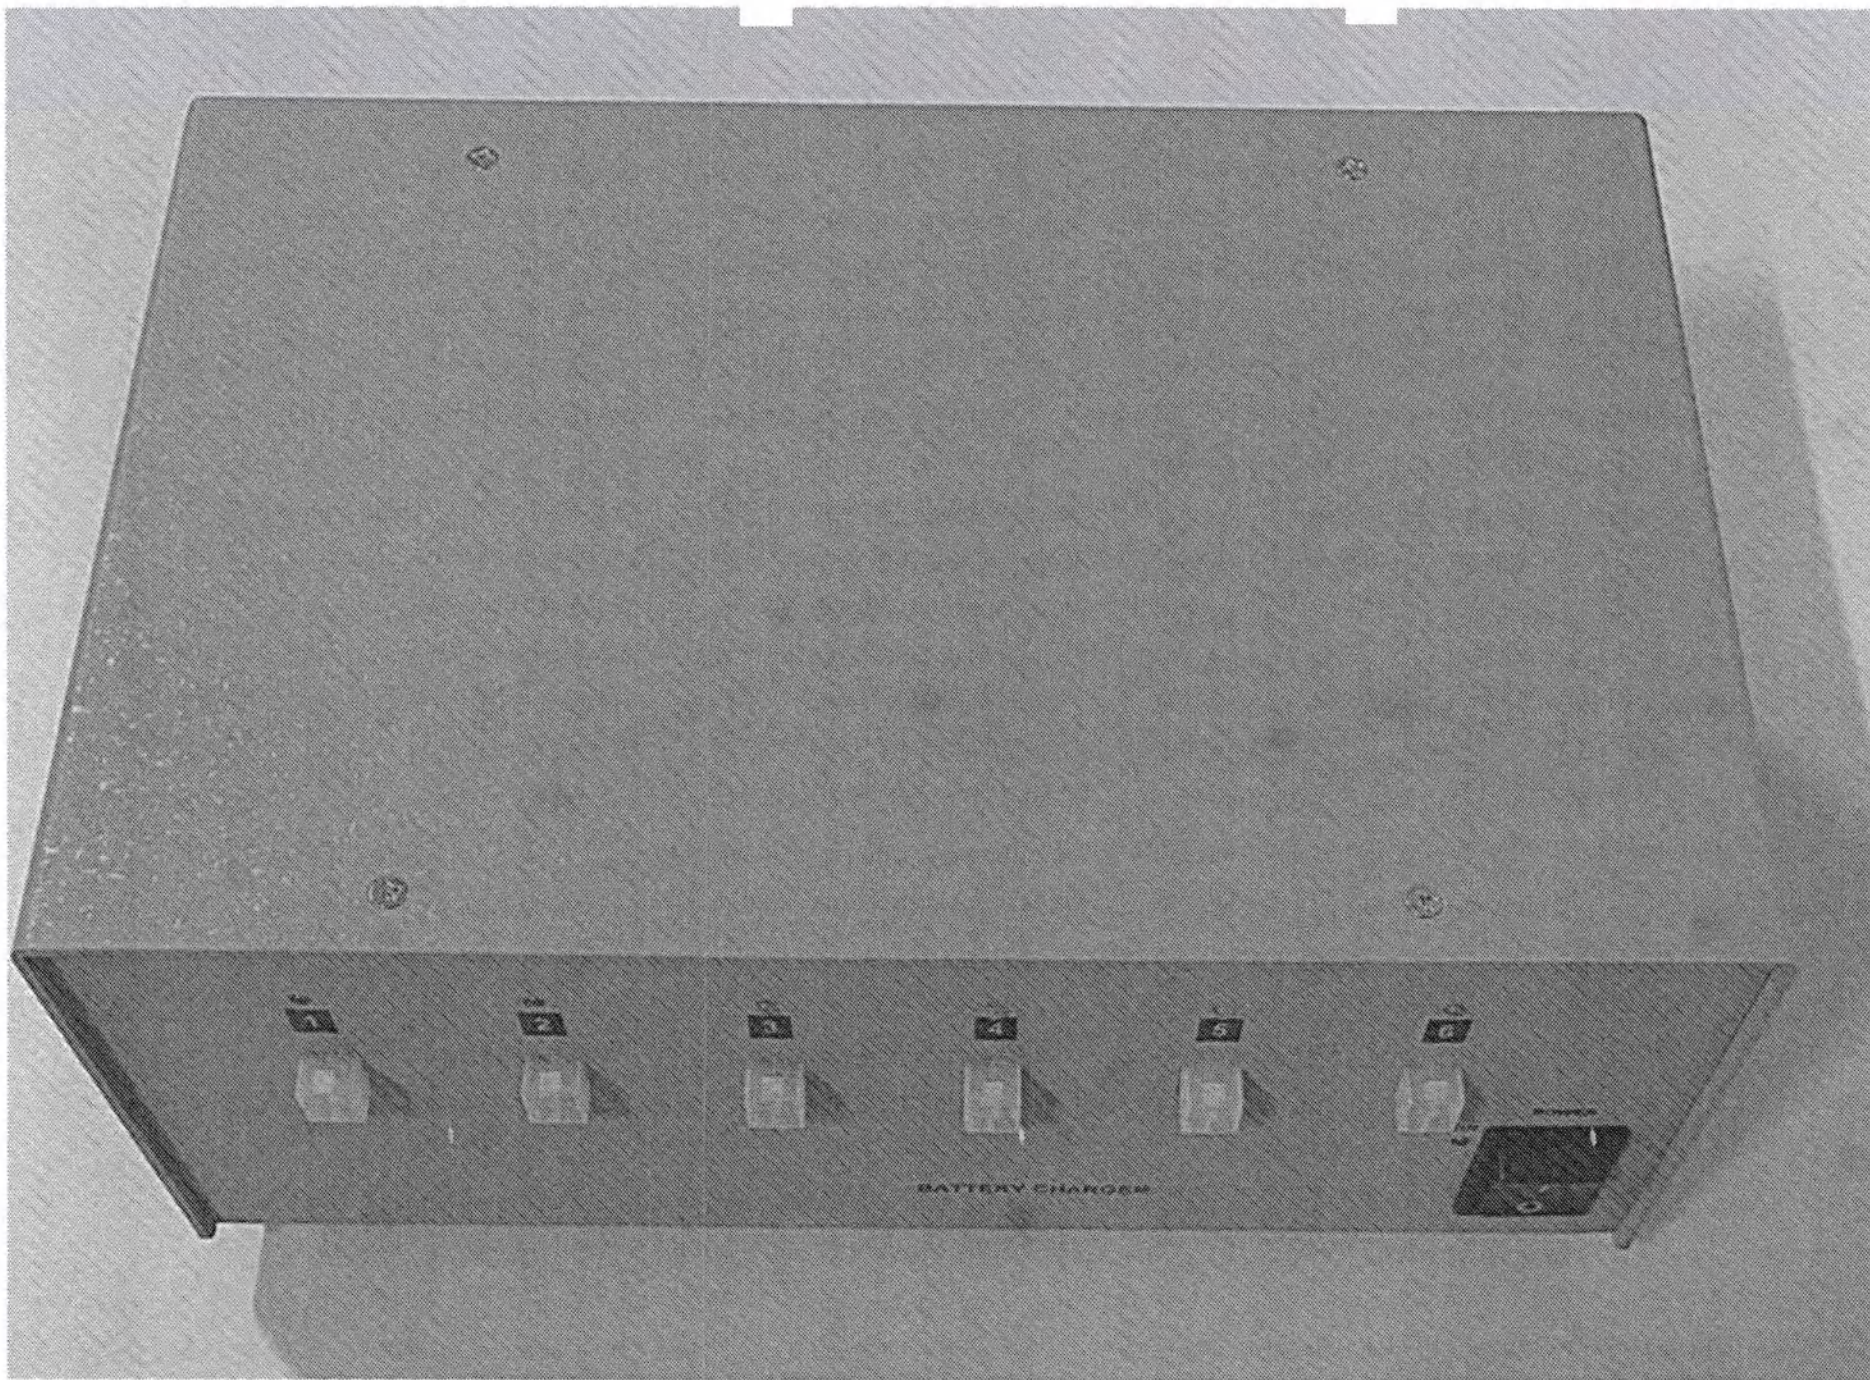


Фото 42: Зарядное устройство

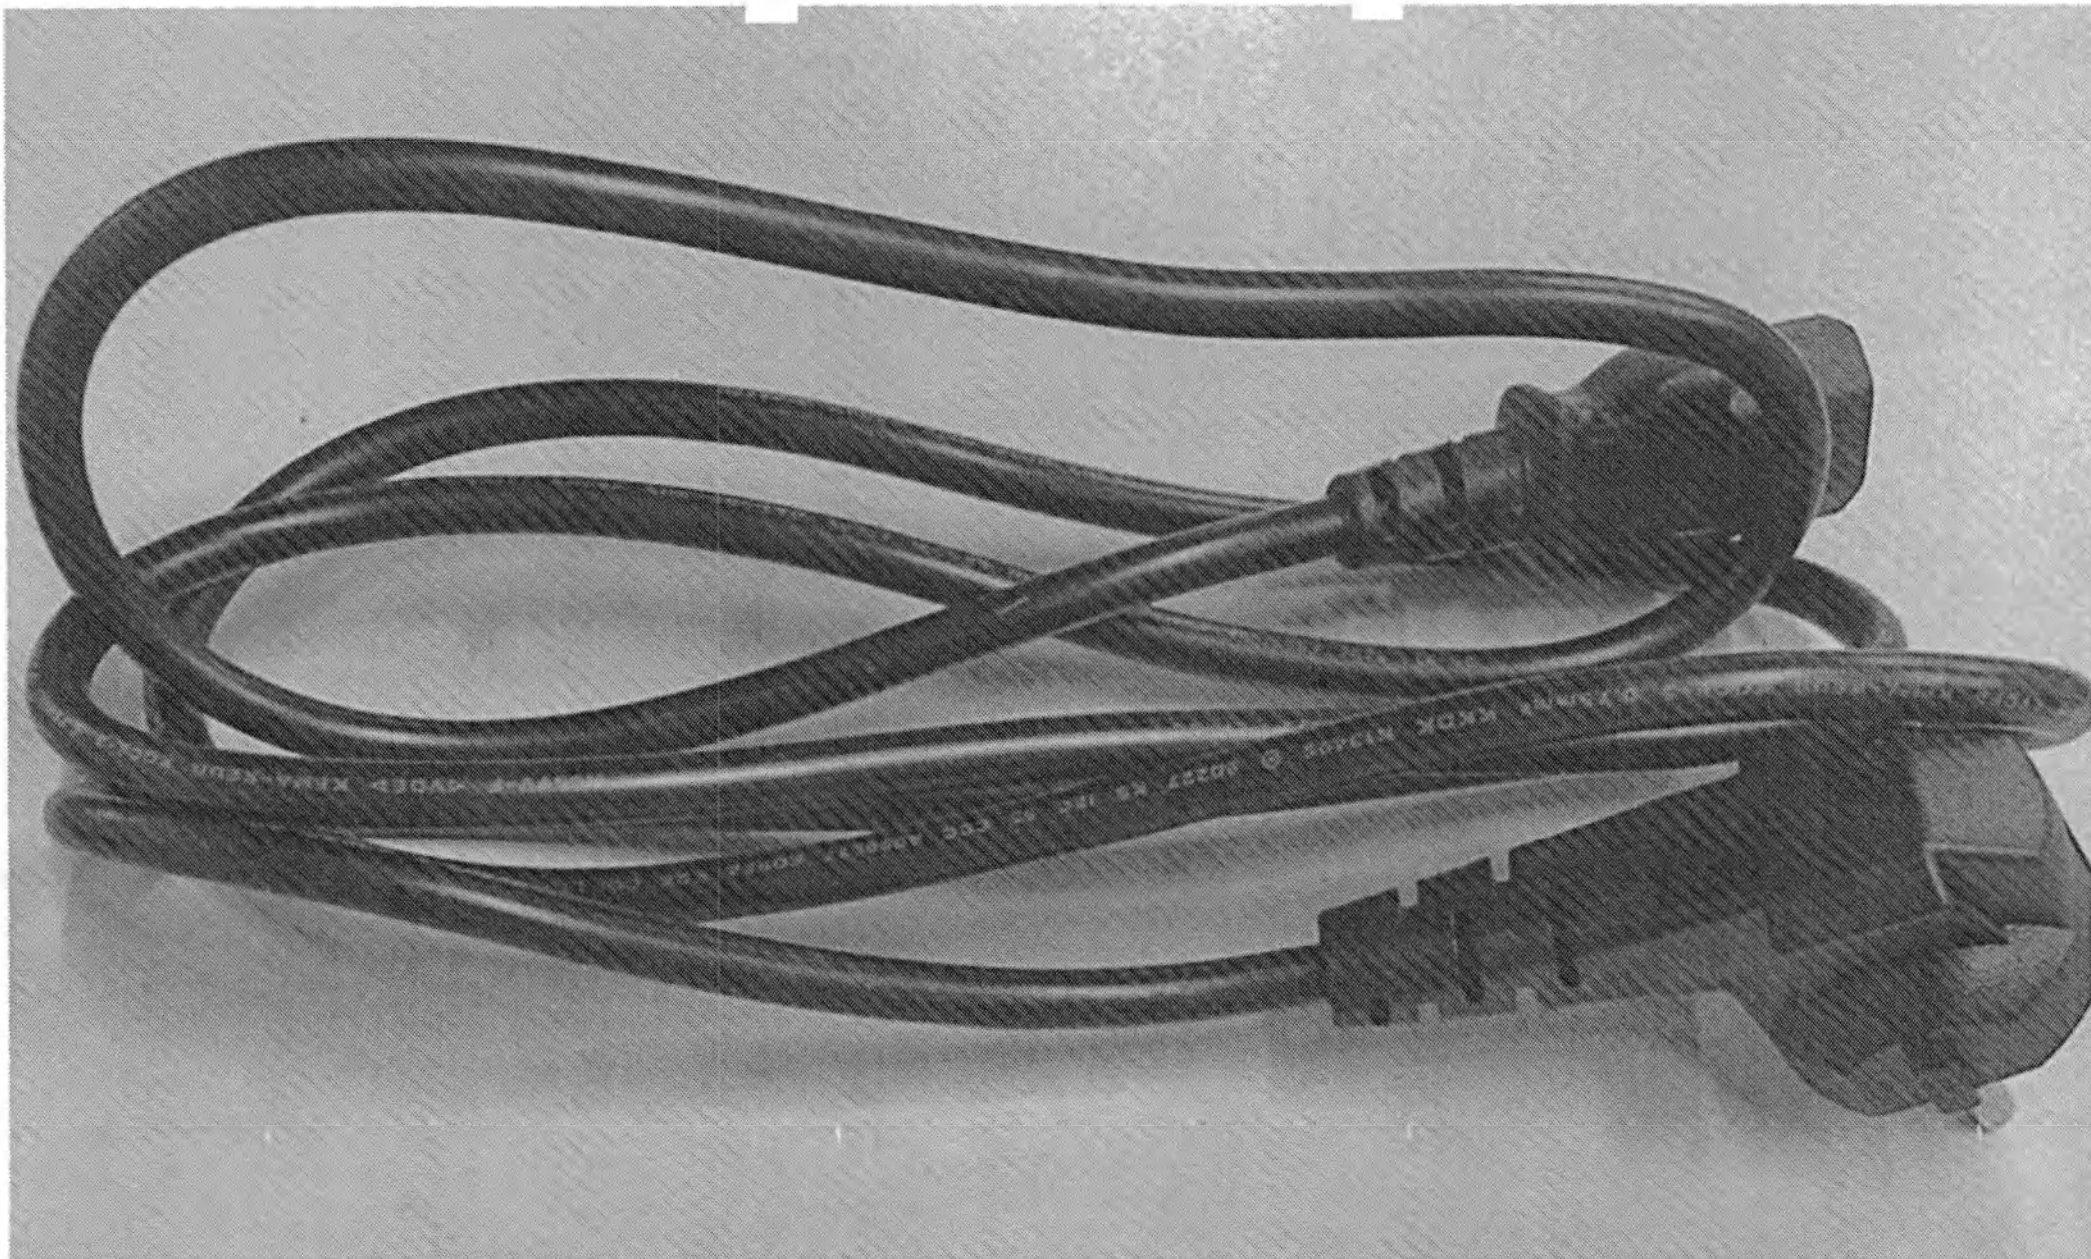


Фото 43: Зарядное устройство - кабель питания

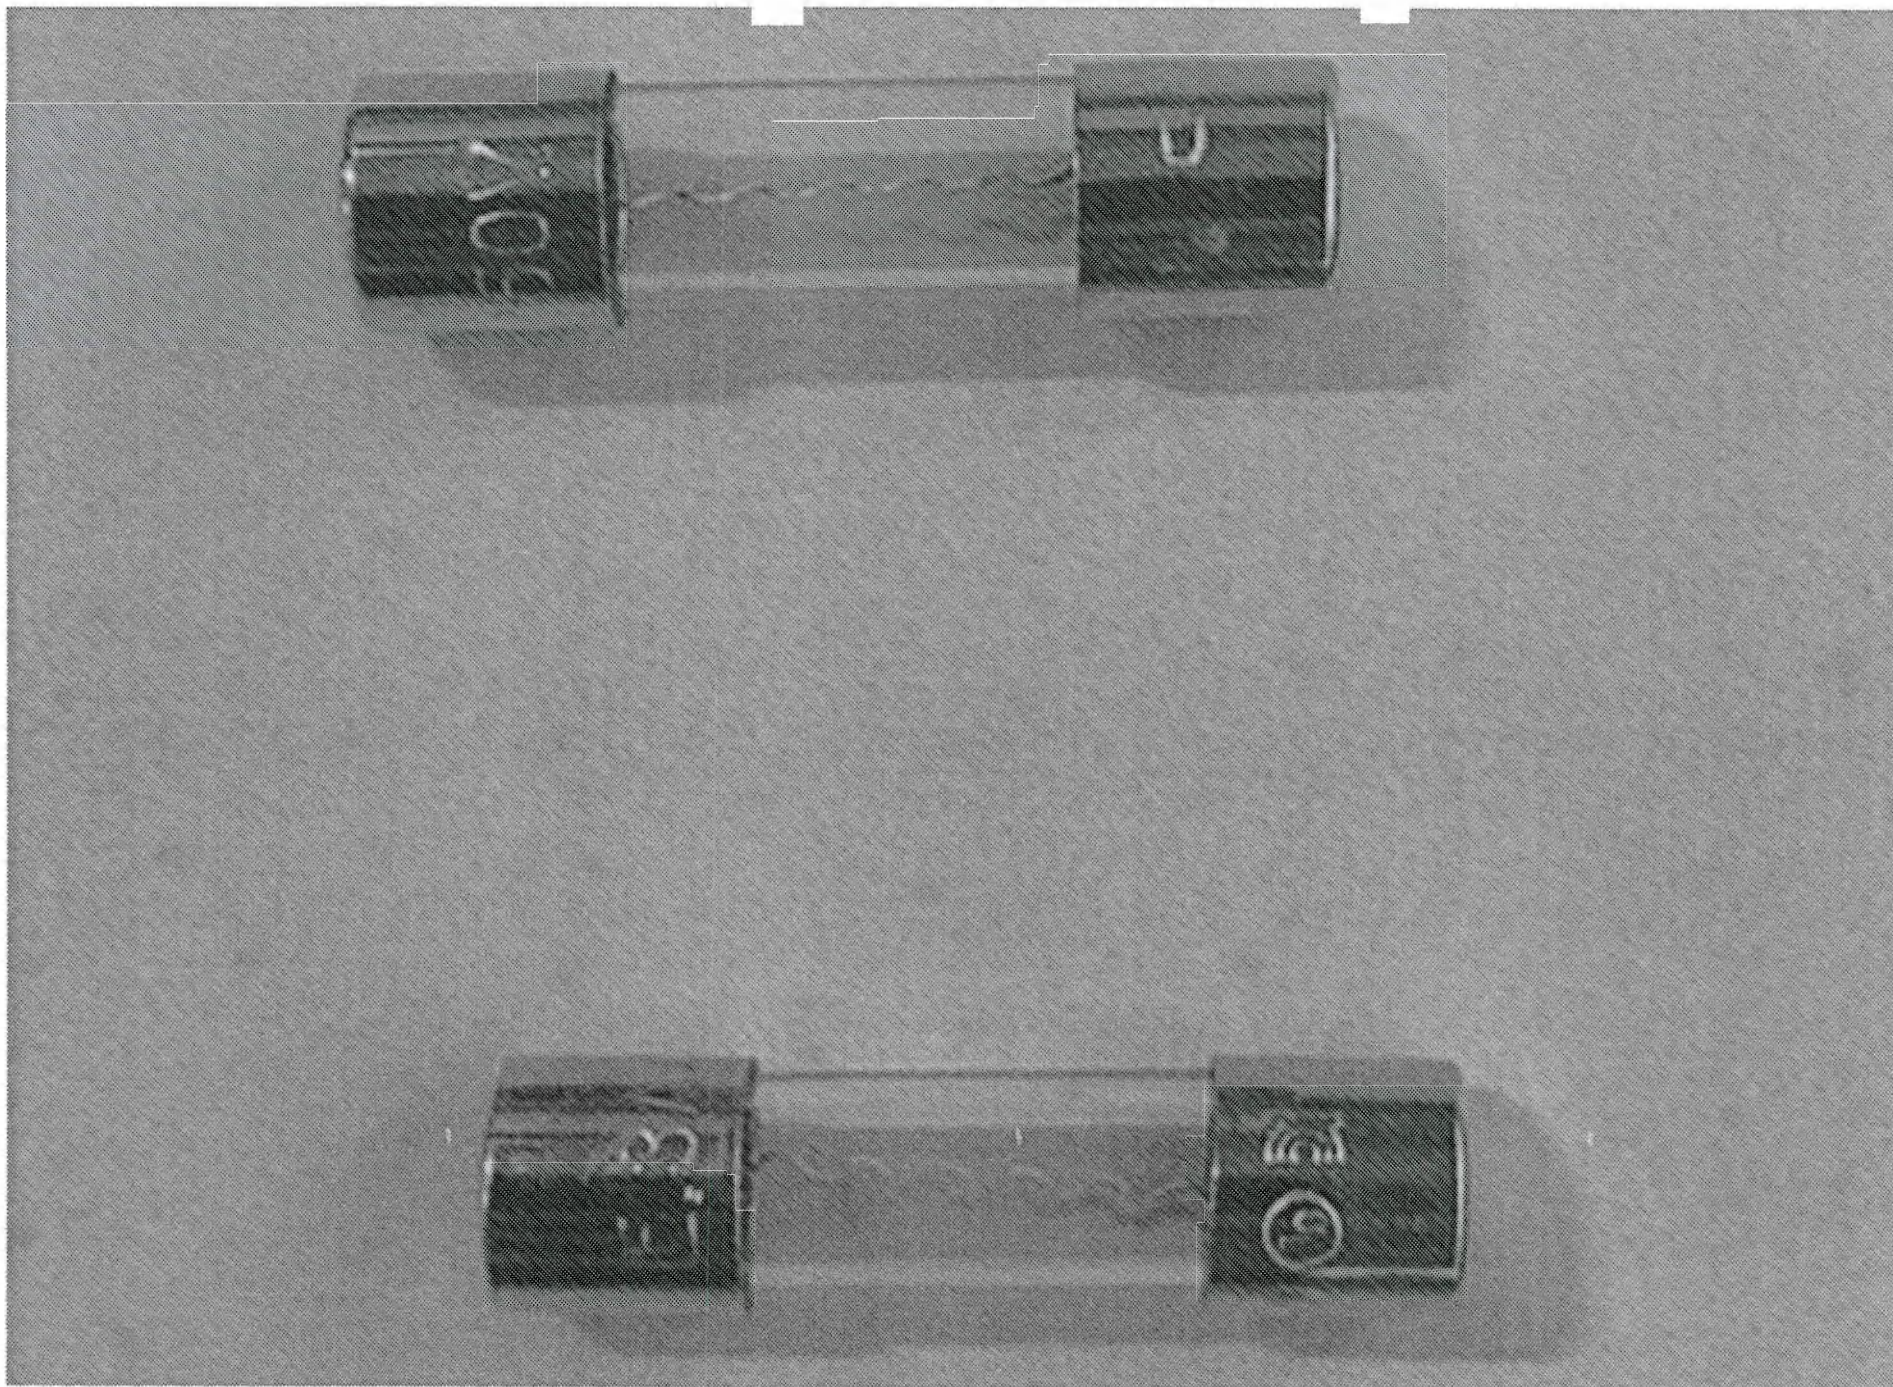


Фото 44: Зарядное устройство - Запасные предохранители

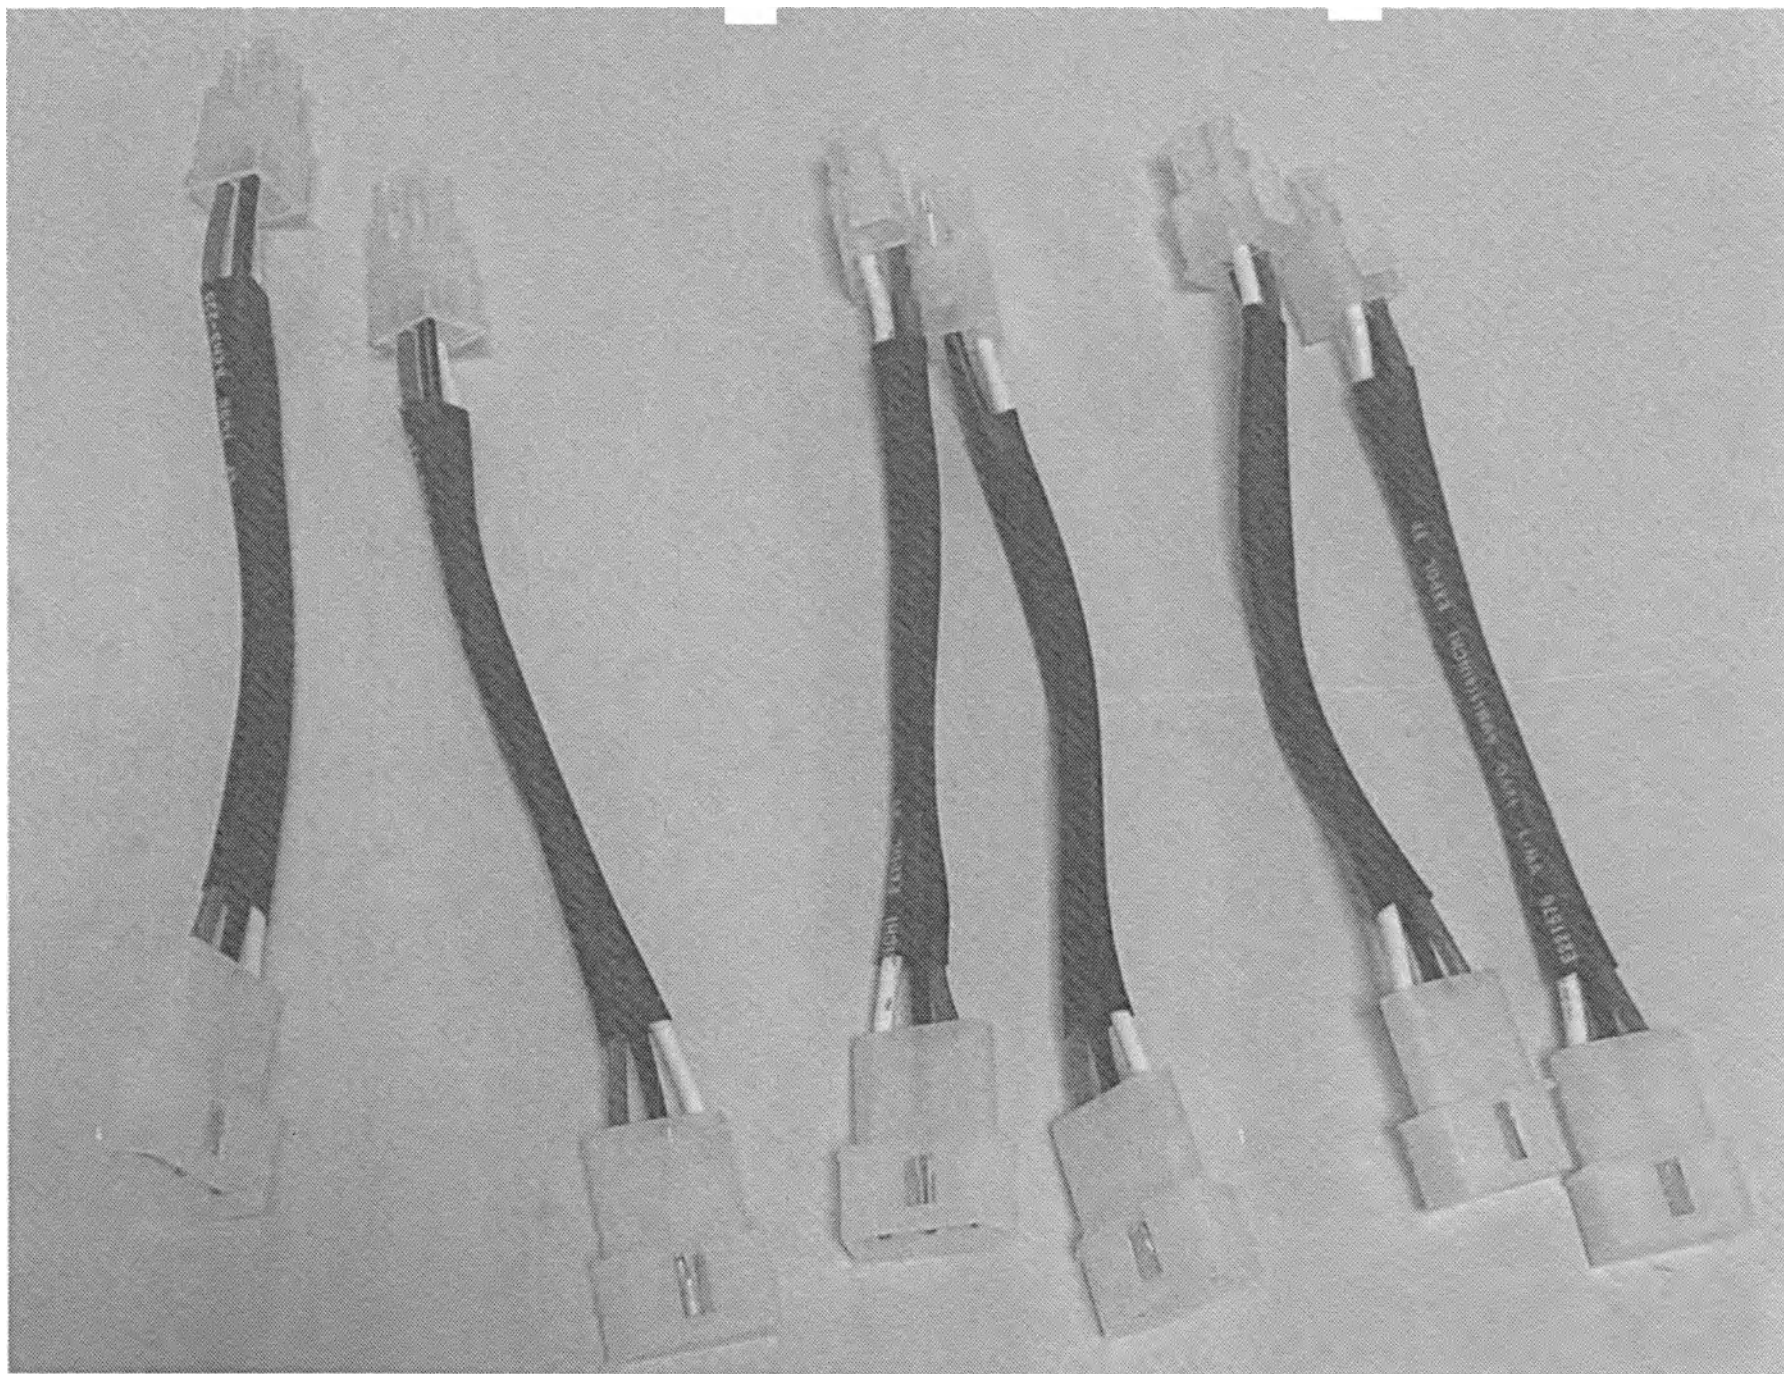


Фото 45: Зарядное устройство - Кабель зарядный- 6 шт.

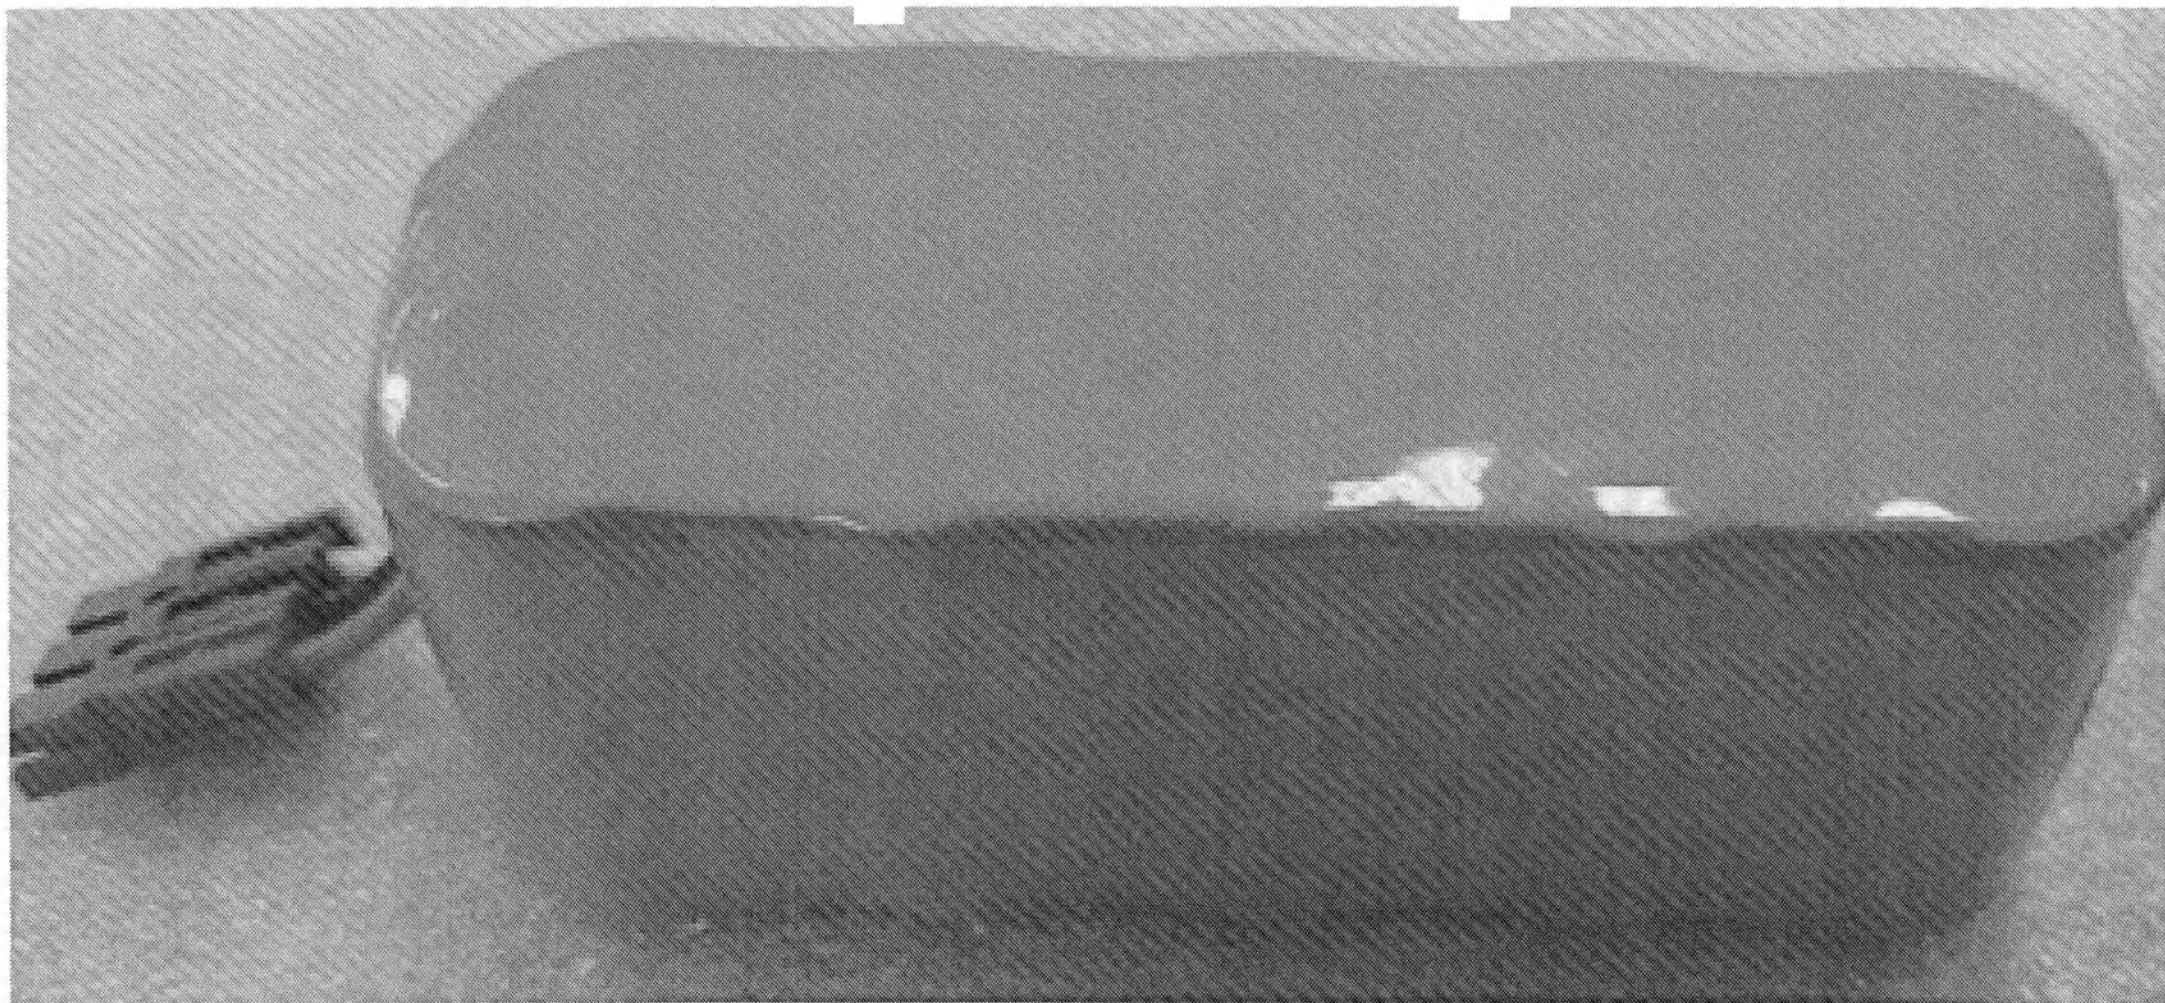


Фото 46: Аккумуляторная батарея

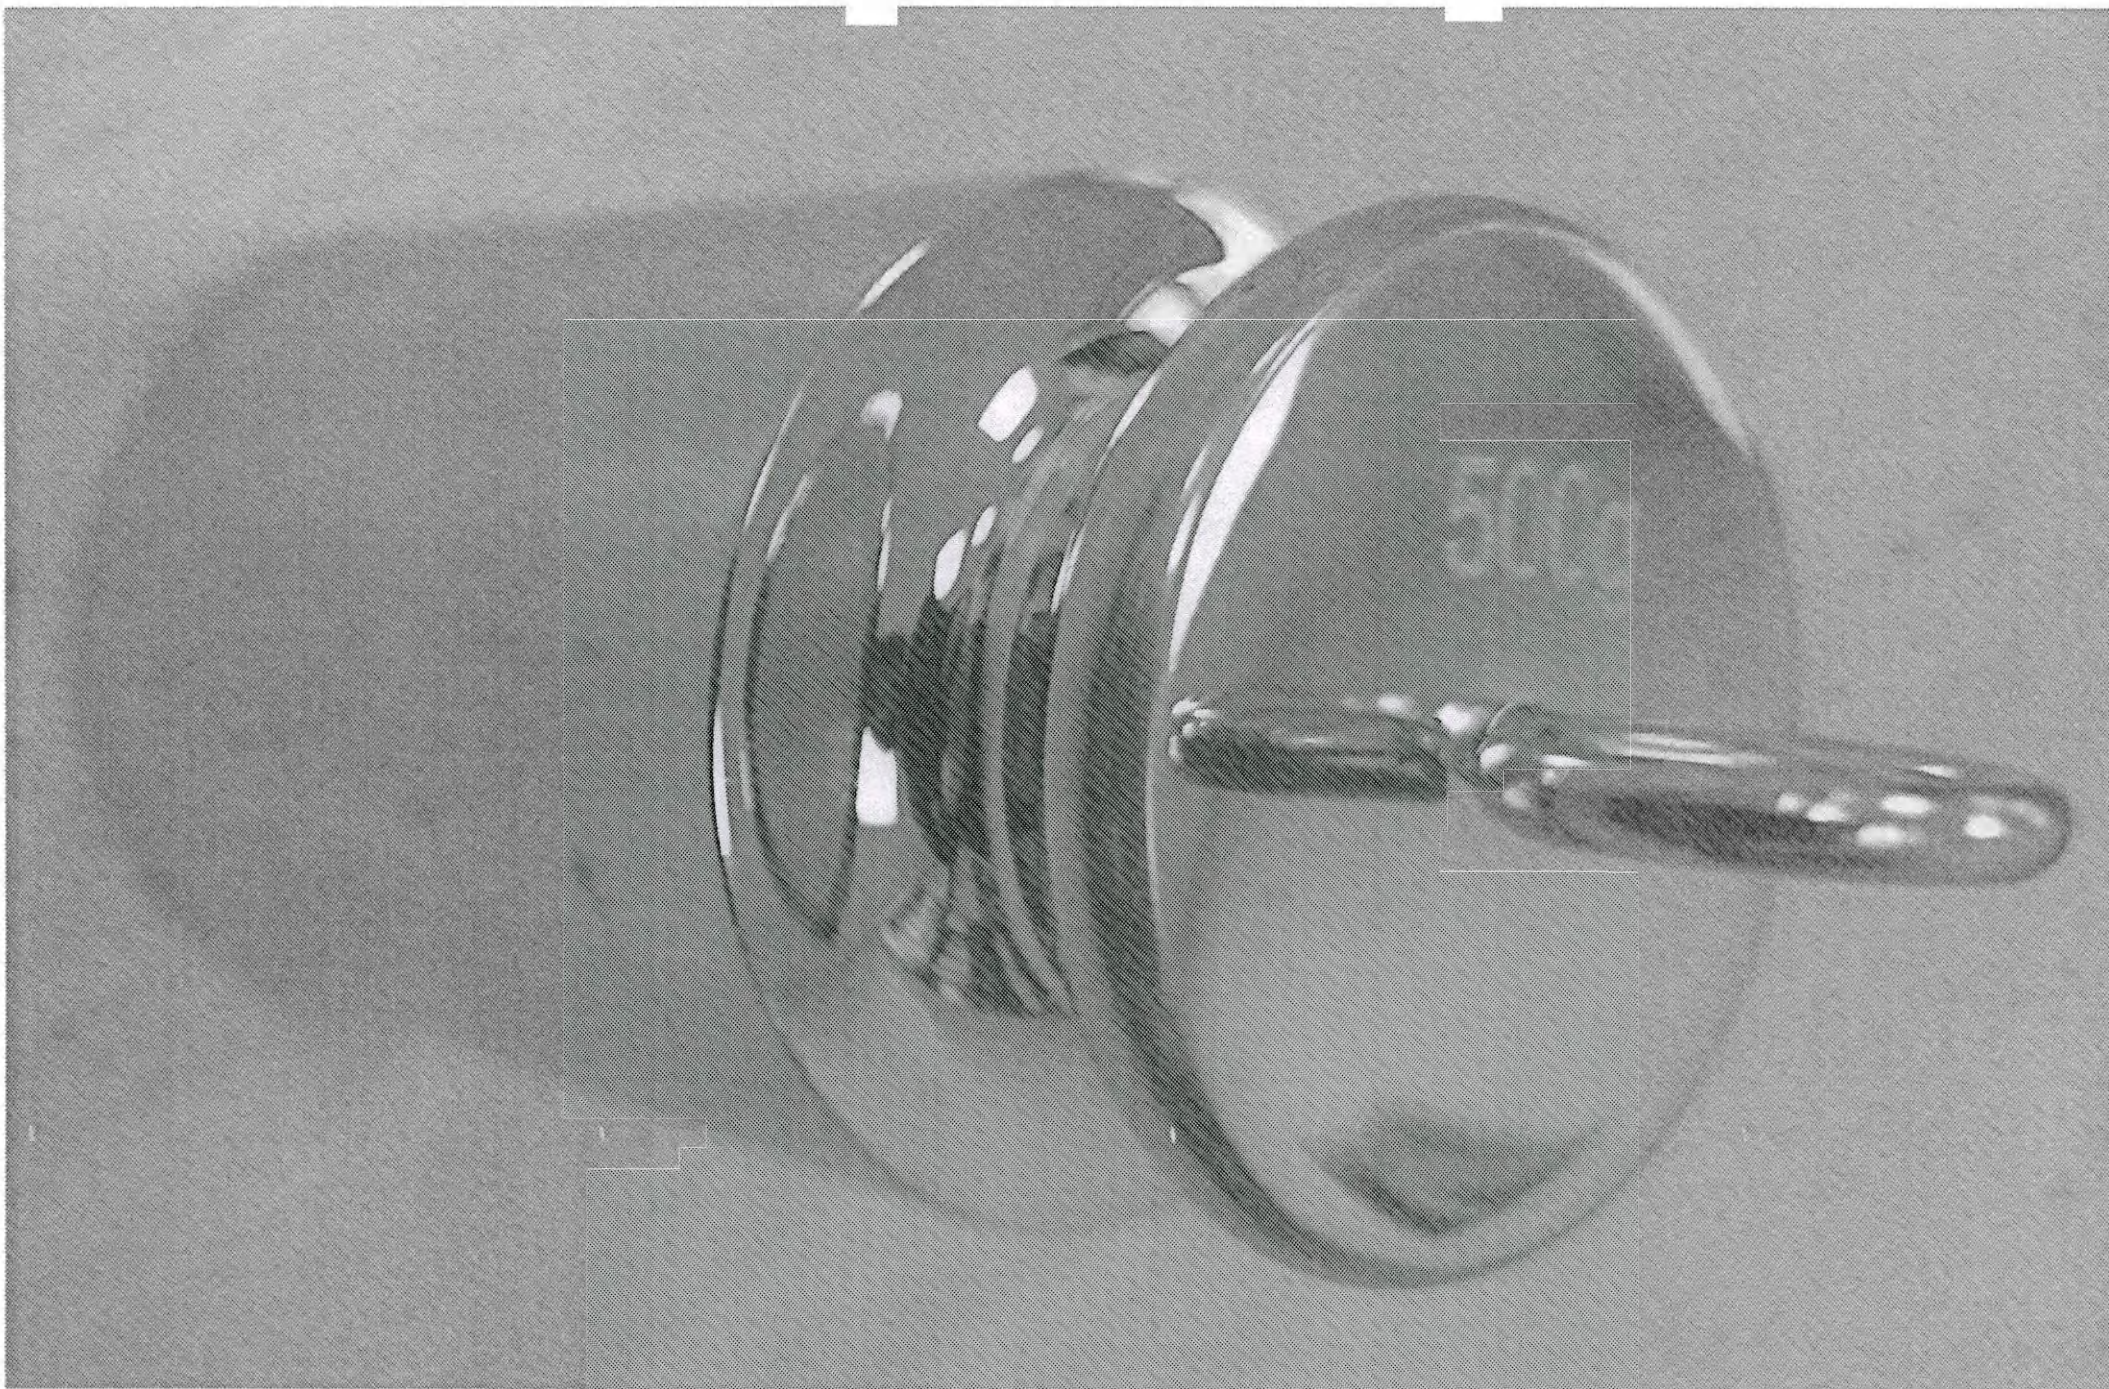


Фото 47: Гиря 500 г



Фото 48: Сумка для переноски

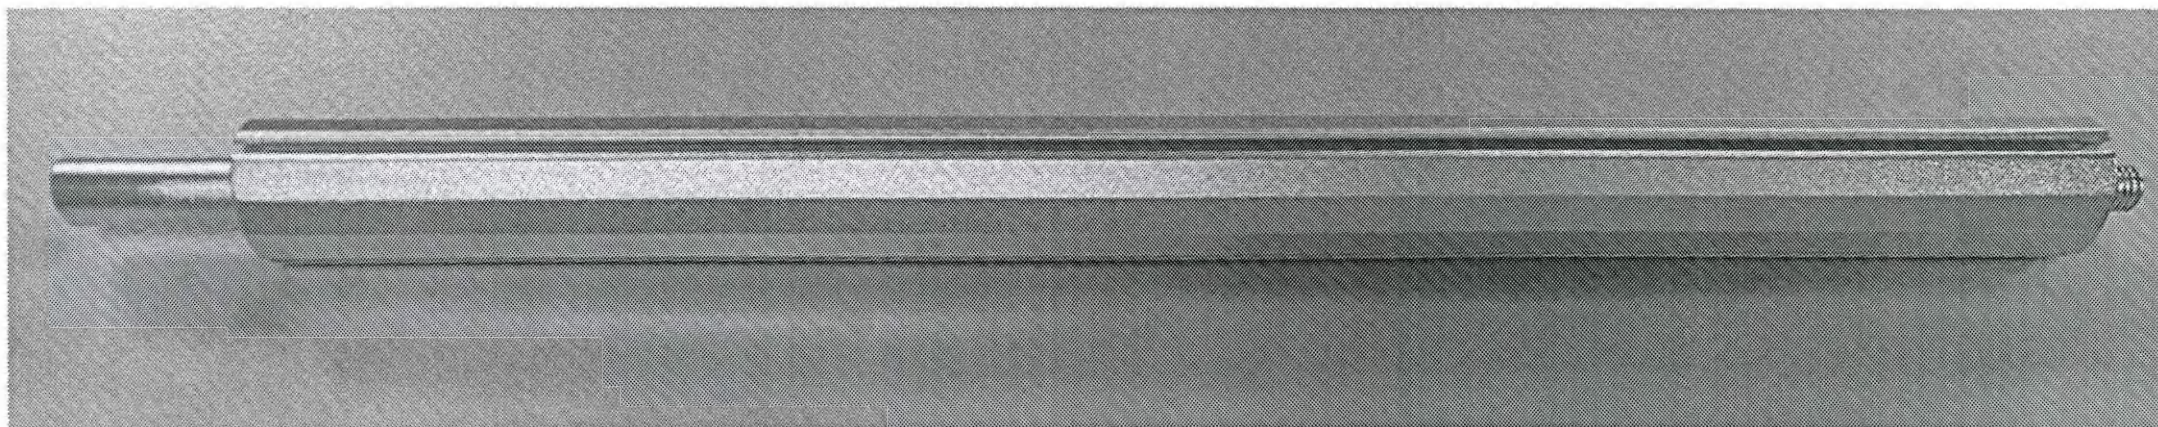


Фото 49: Комплект для монтажа на стойку - Стойка

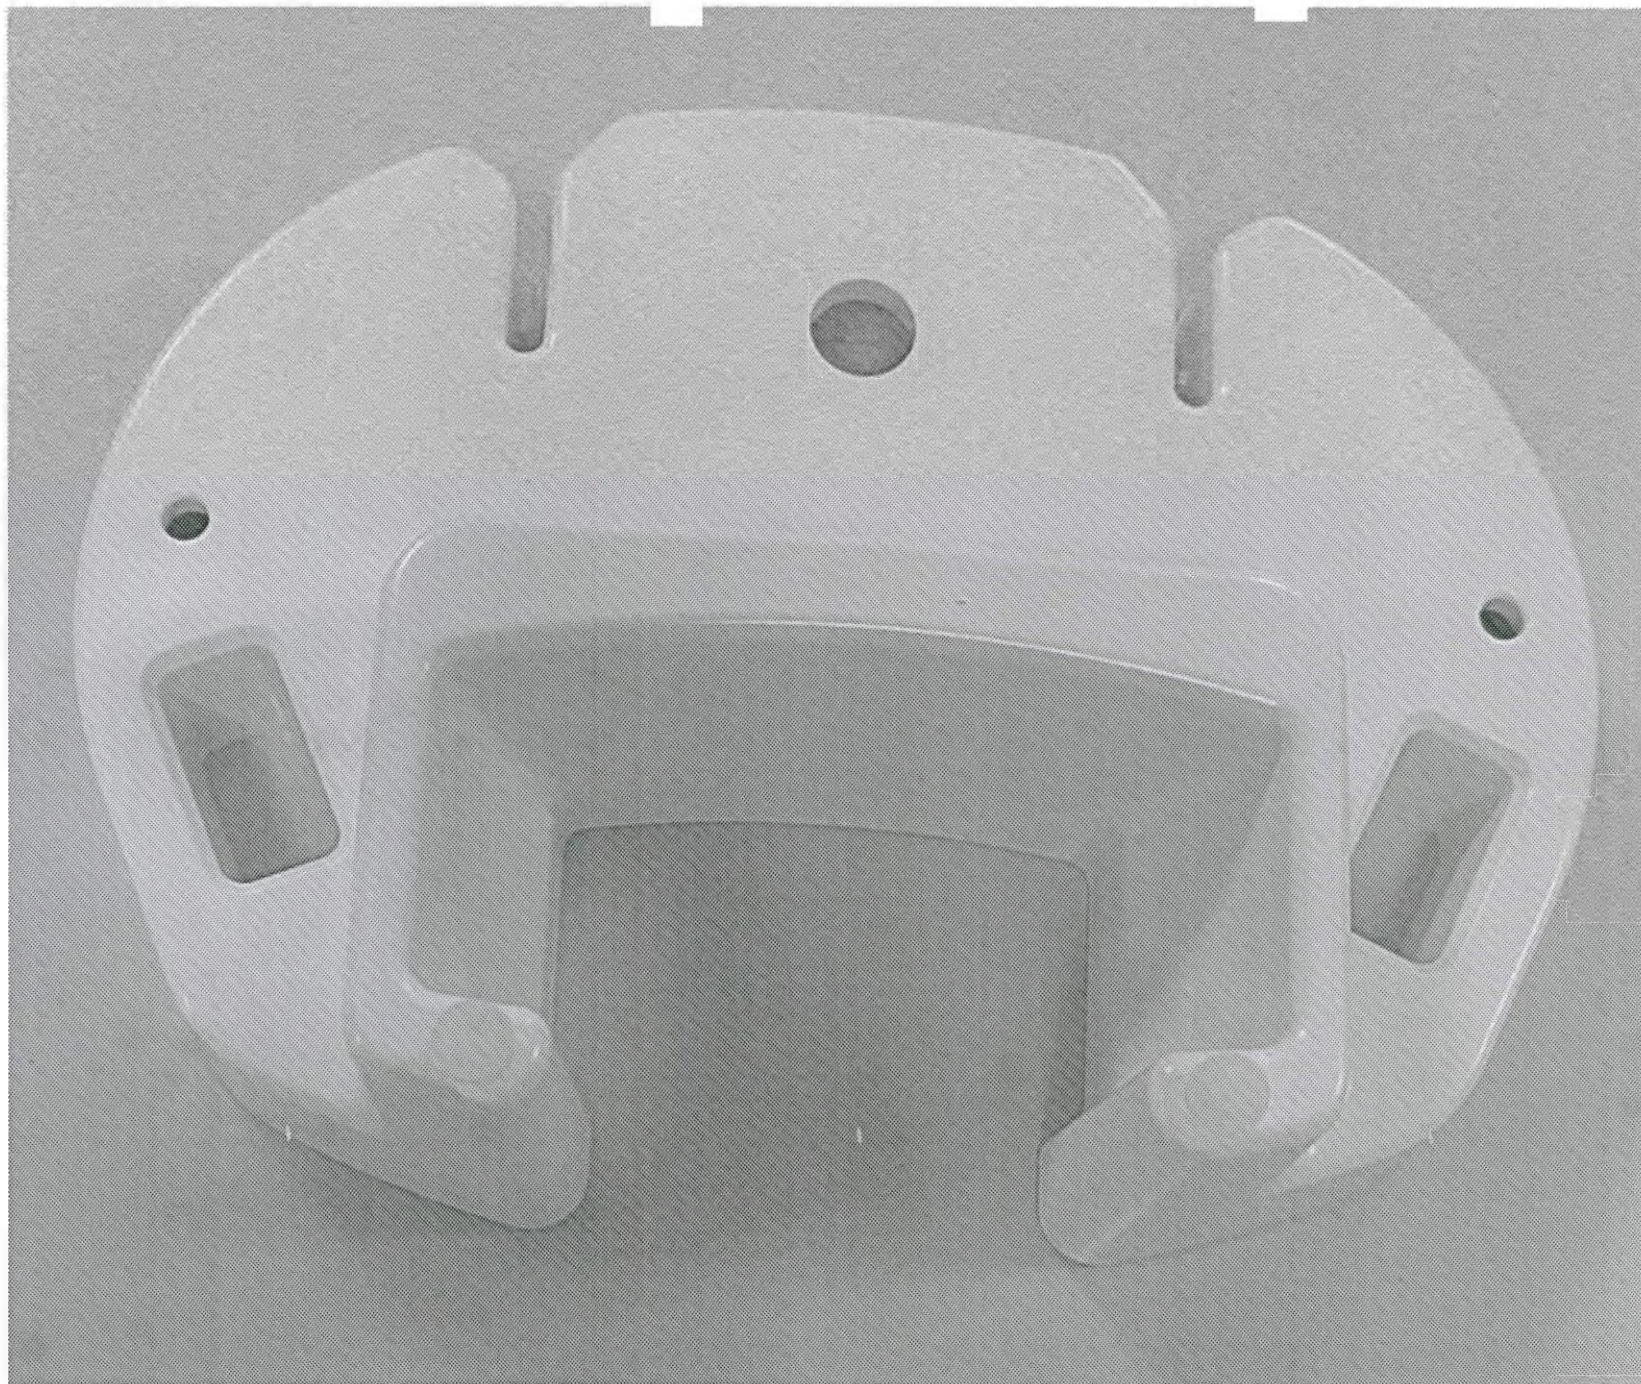


Фото 50: Комплект для монтажа на стойку - держатель сканера штрих-кодов

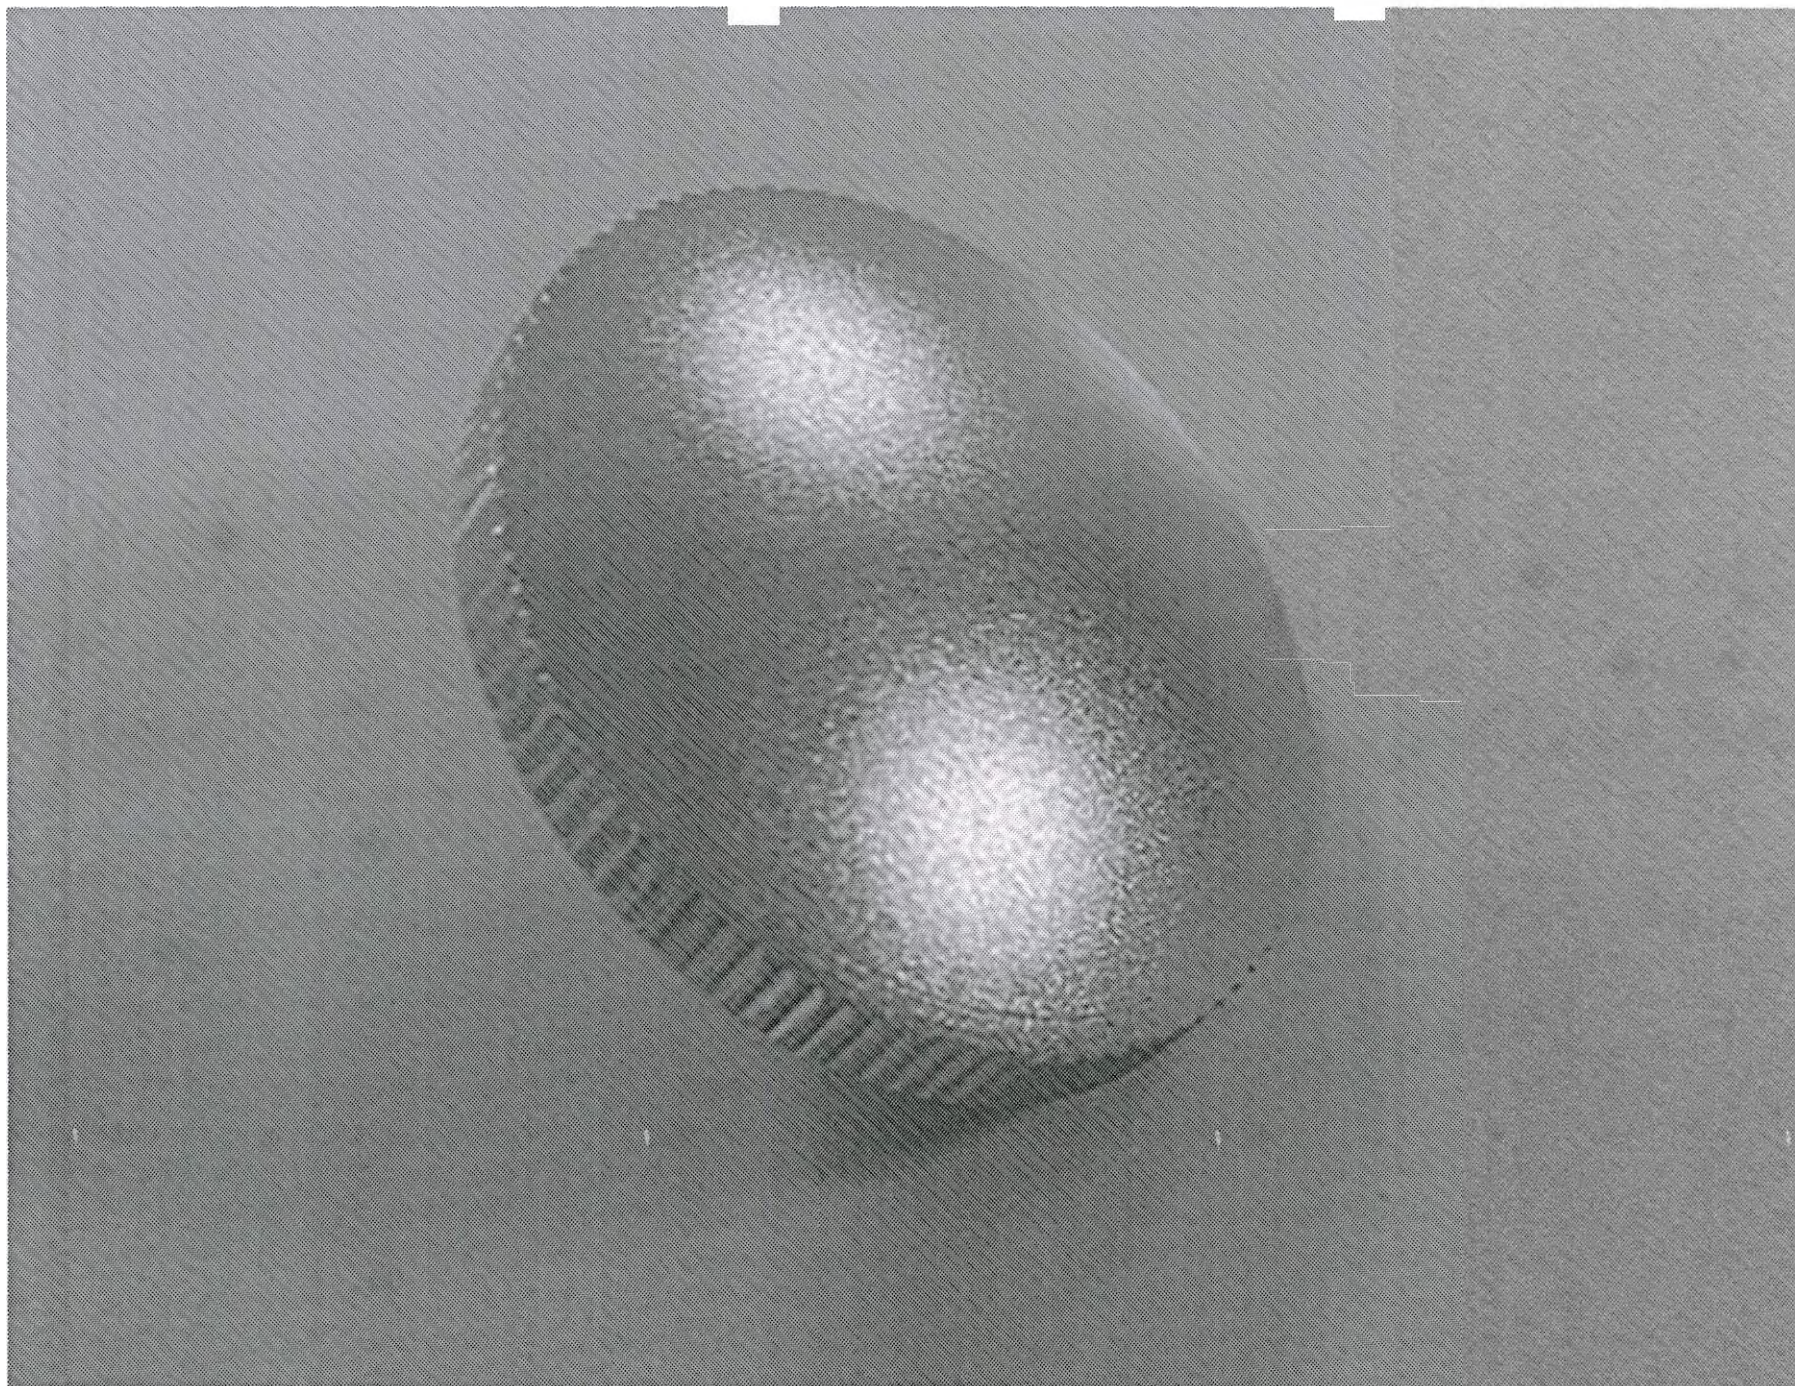


Фото 51: Комплект для монтажа на стойку - винт с барашком

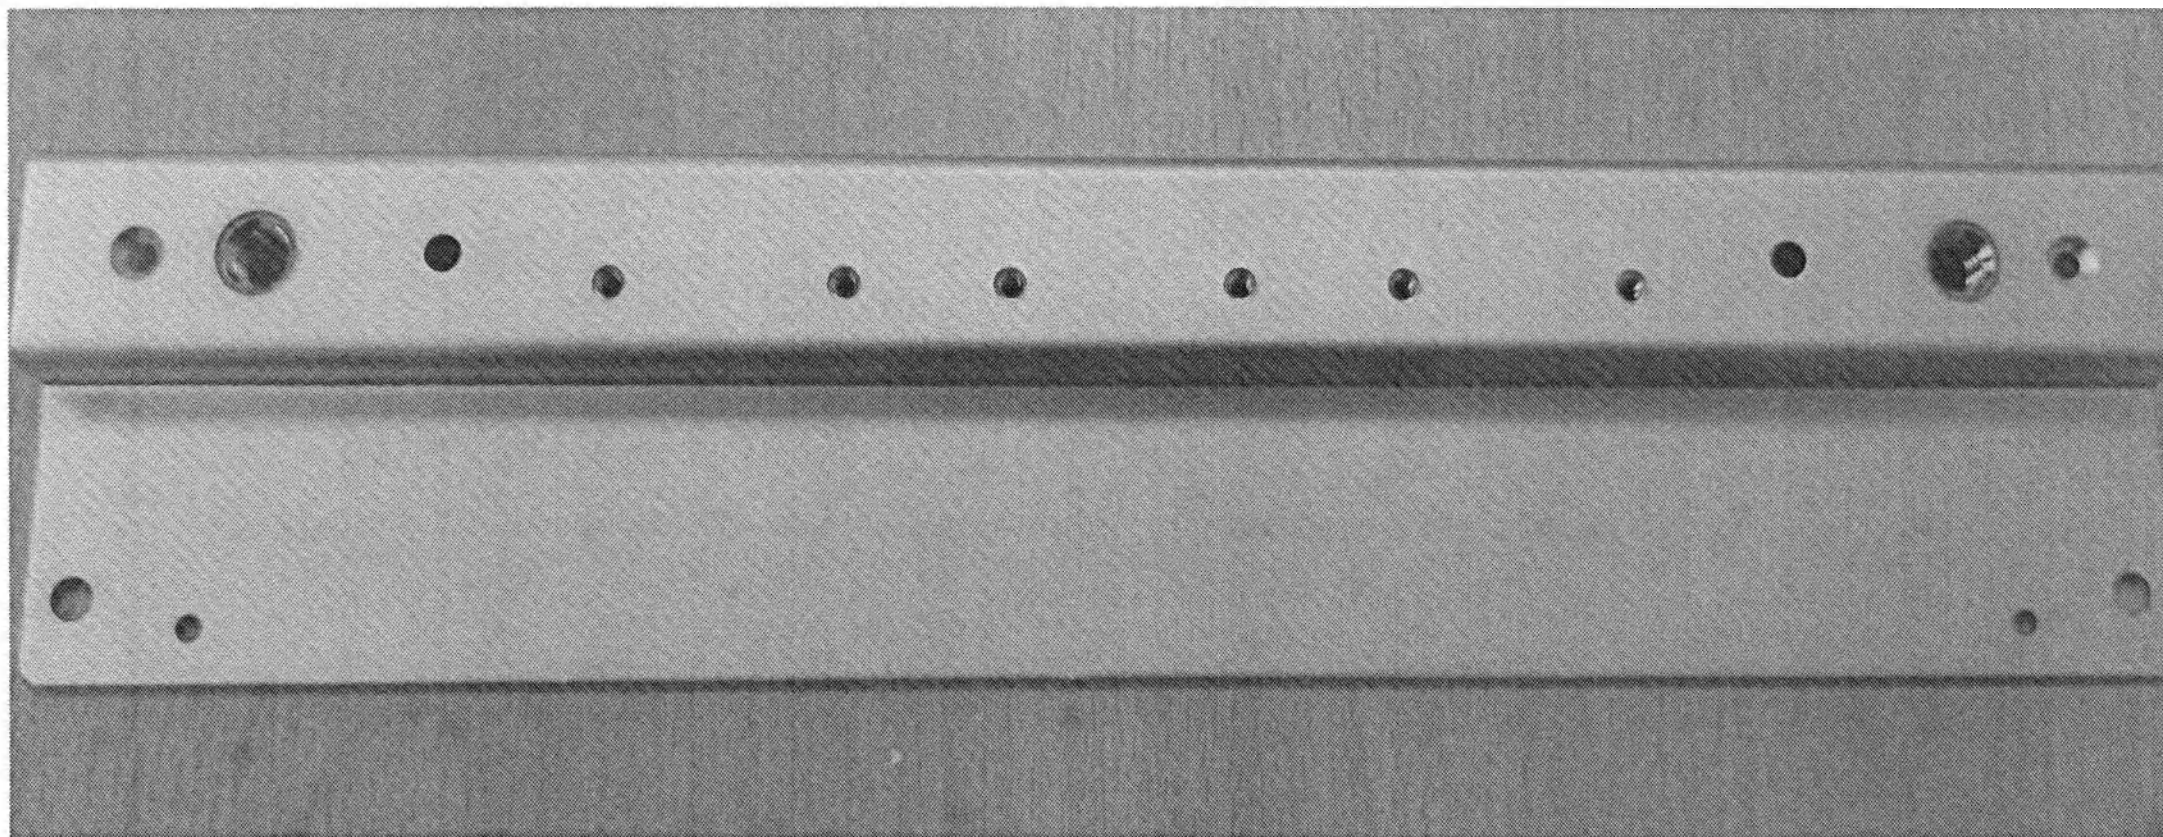


Фото 52: Комплект для монтажа на стойку - Кронштейн монтажный



Фото 53: Комплект для монтажа на стойку - винты

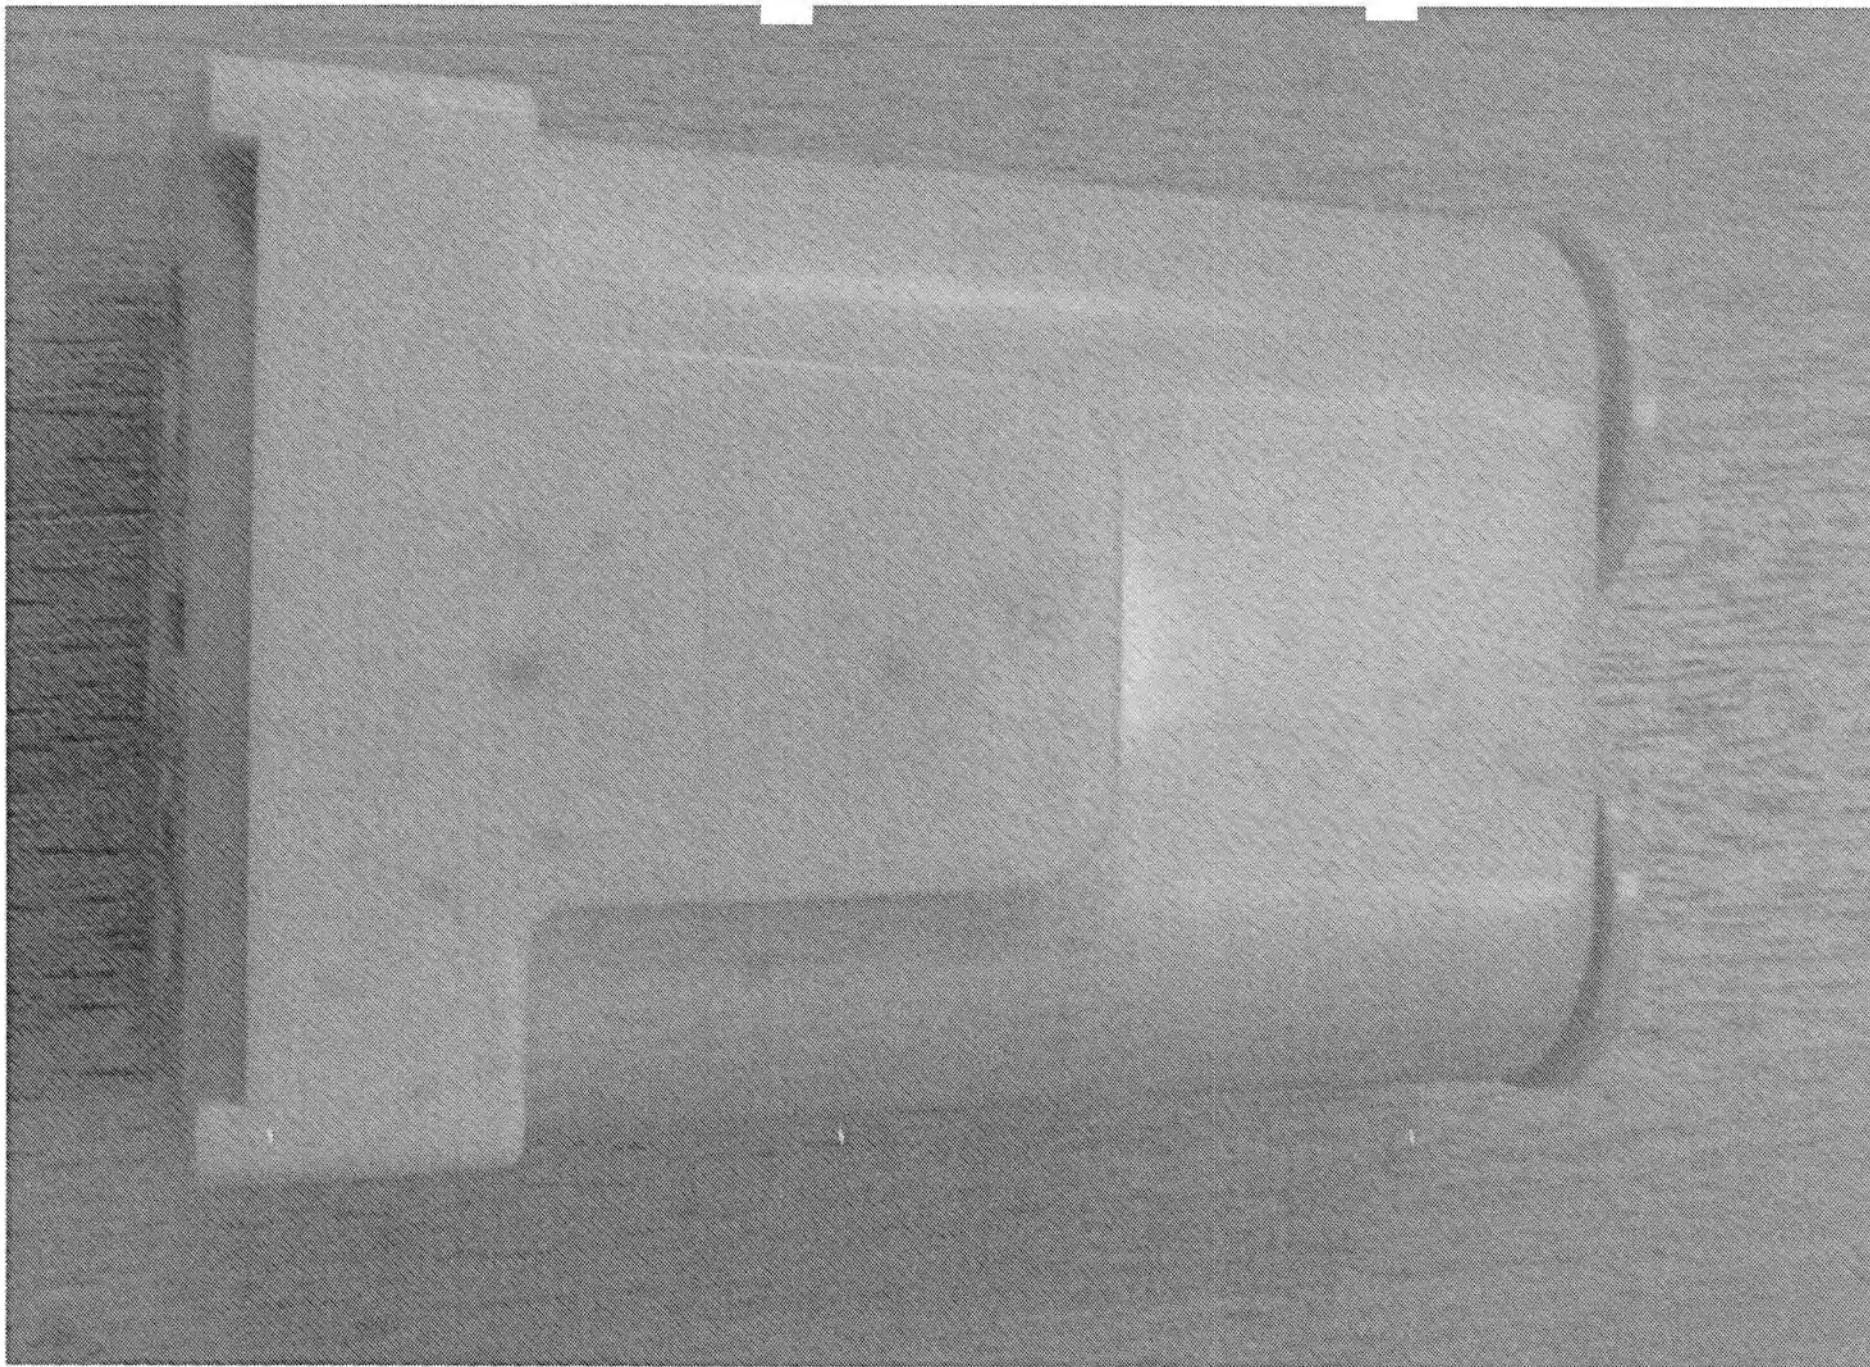


Фото 54: Комплект держателя пробирок для анализов: держатель пробирок для анализов

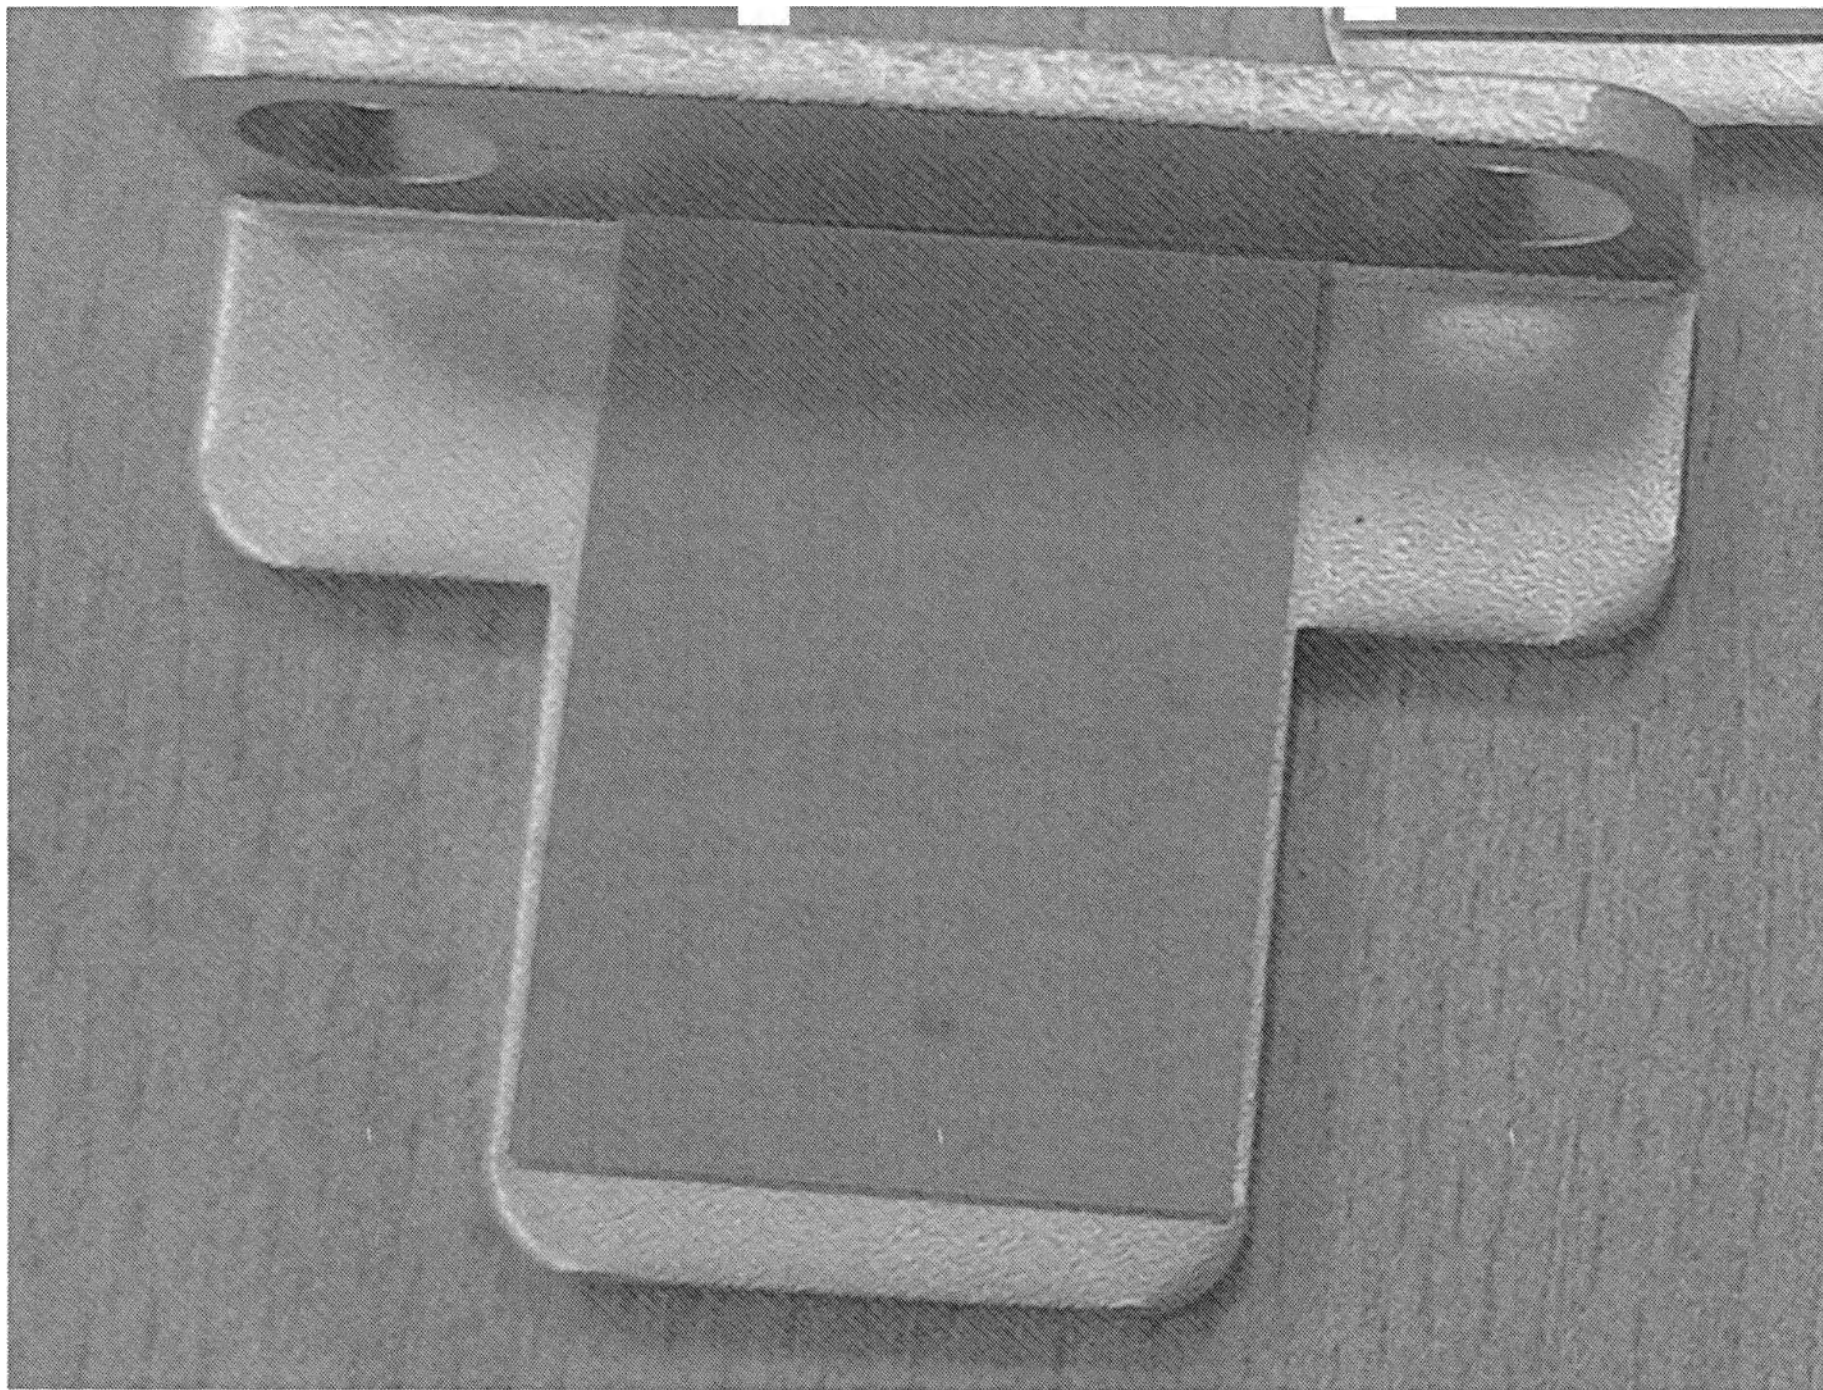


Фото 55: Комплект держателя пробирок для анализов: кронштейн держателя

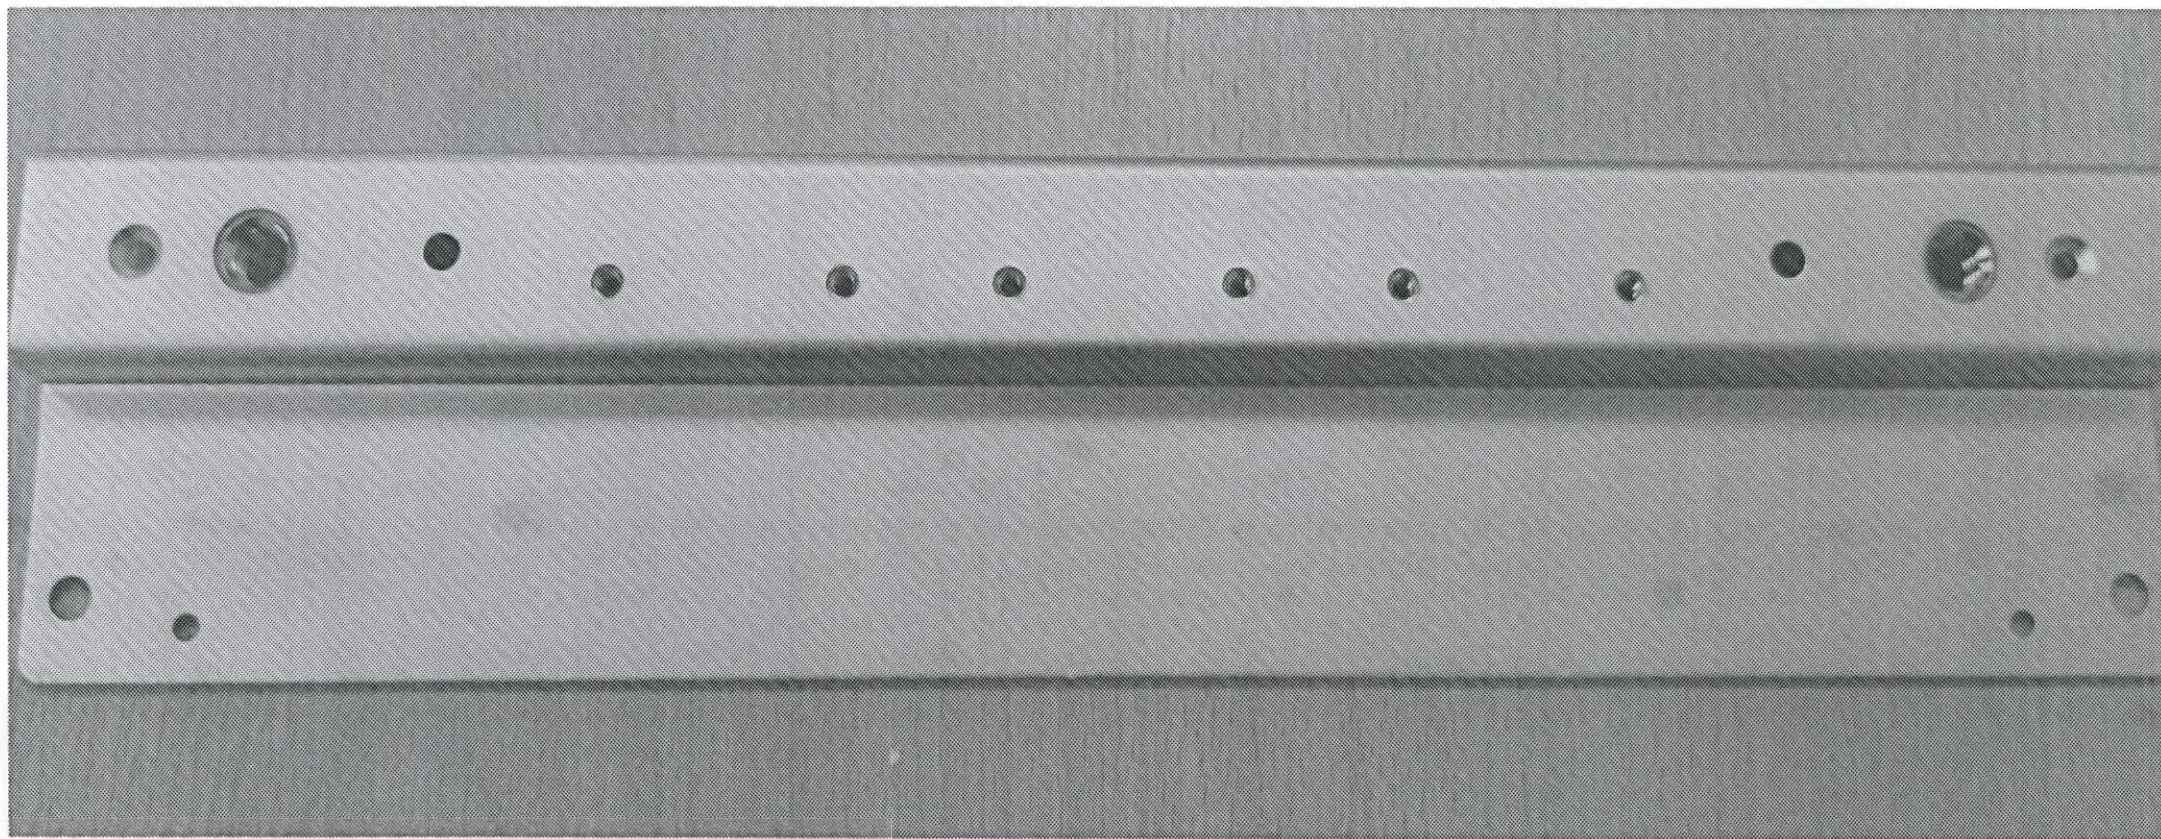


Фото 56: Комплект держателя пробирок для анализов - кронштейн монтажный



Фото 57: Комплект держателя пробирок для анализов: винты


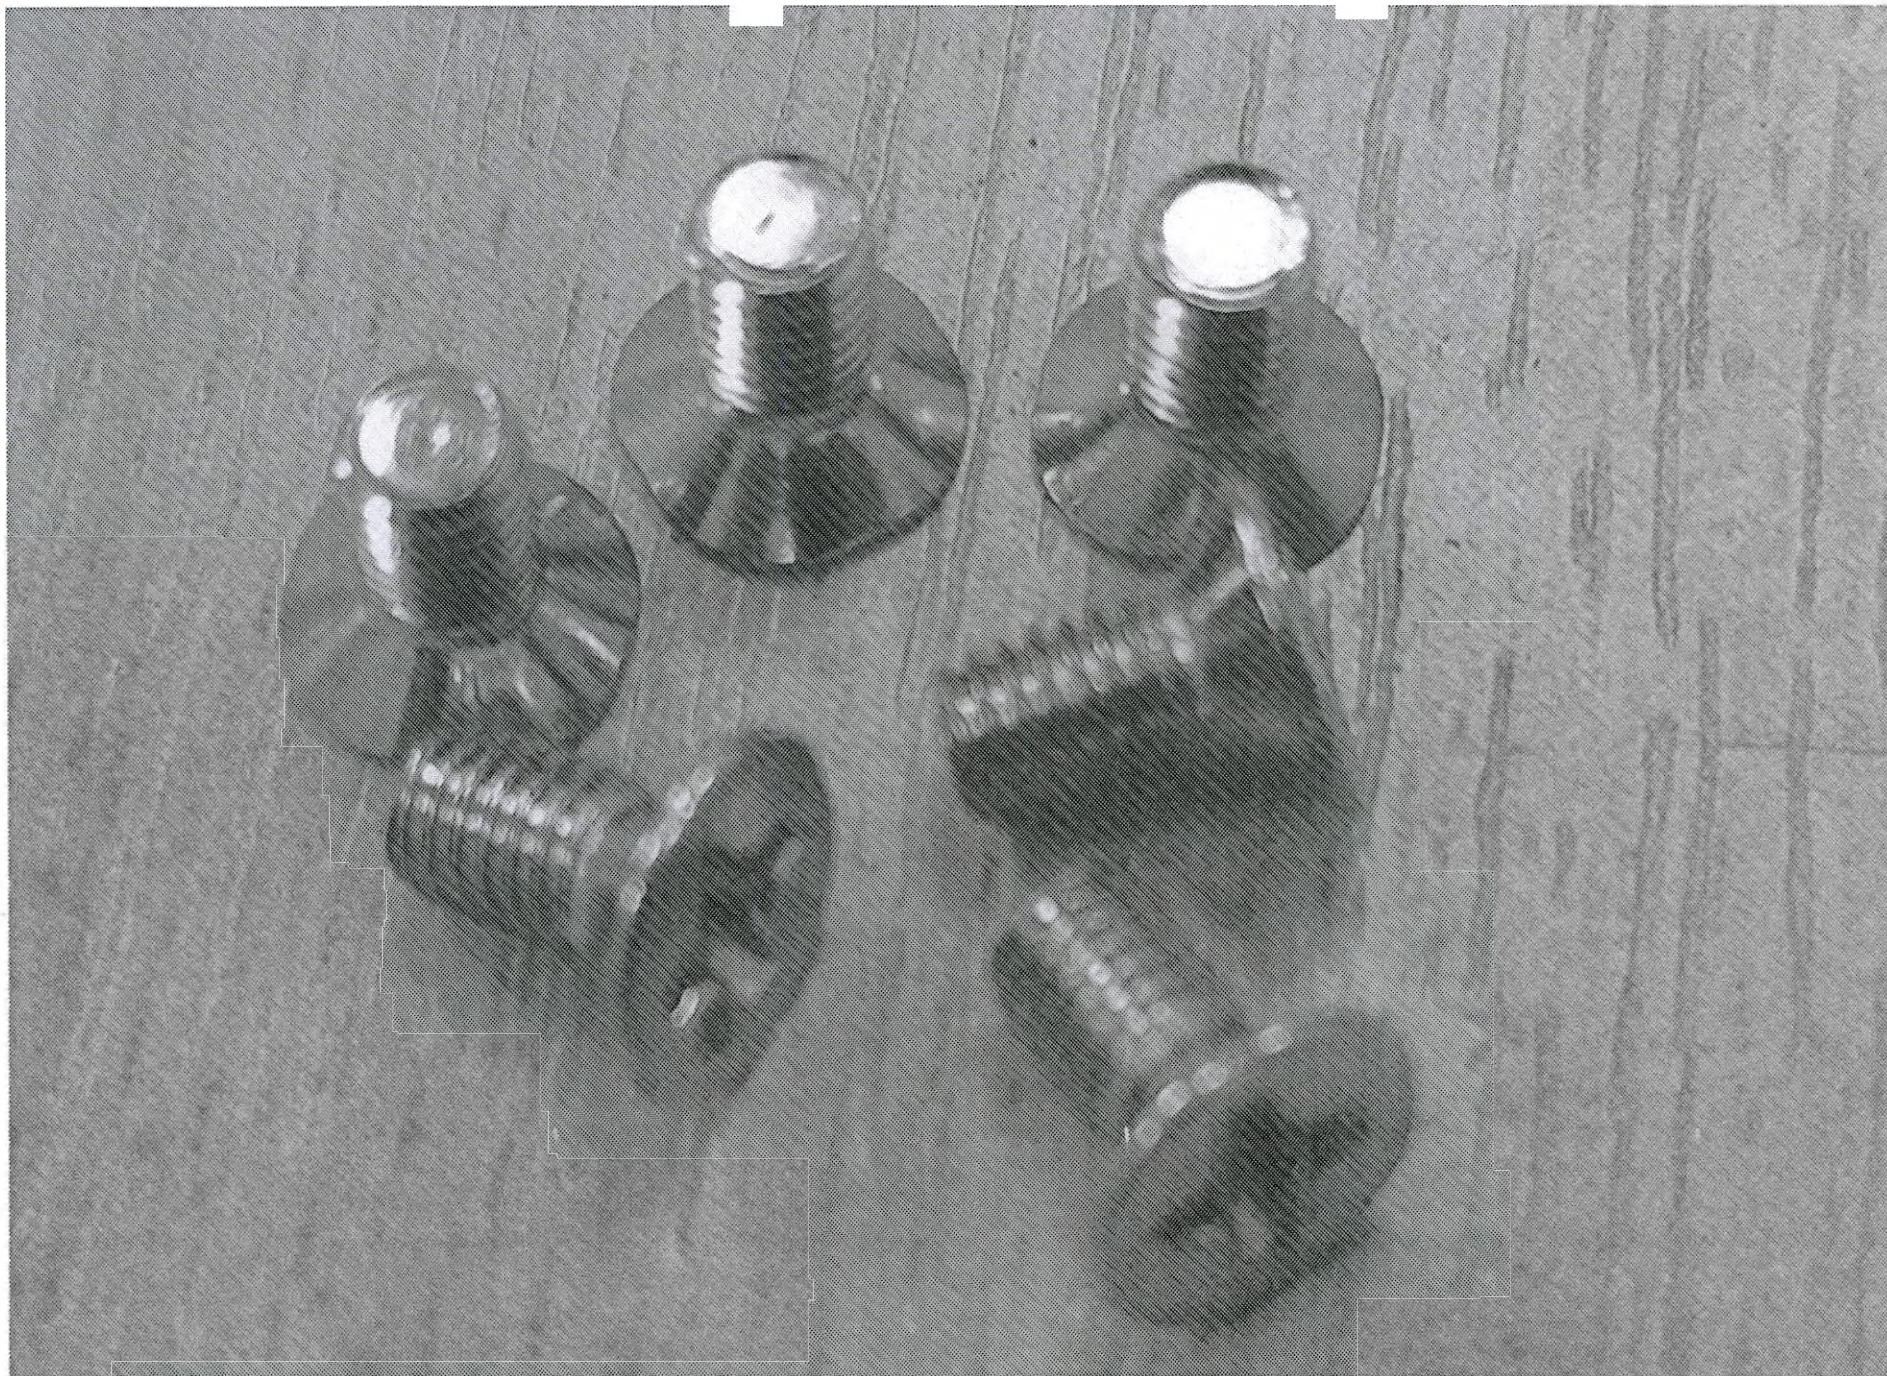


Фото 58: Комплект держателя пробирок для анализов: винты

Маркировка изделия

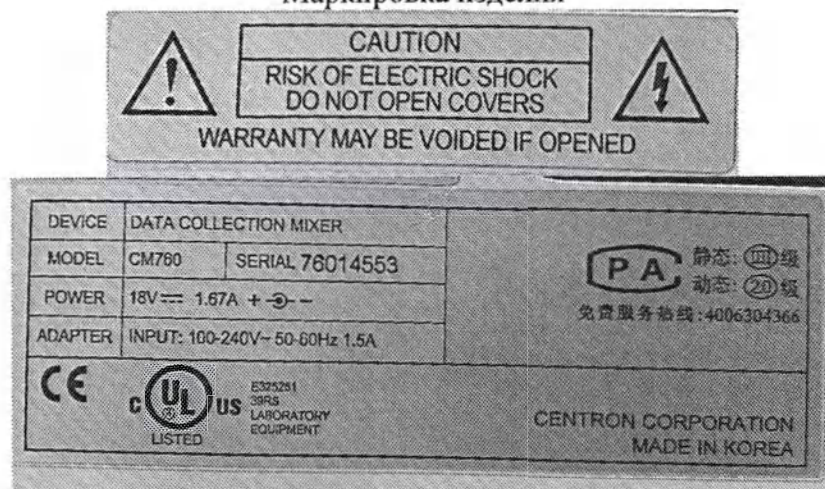

Проект маркировки для РФ

Миксер донорской крови с принадлежностями под торговой маркой Centron
Модель CMXXX



Производитель
«Центрон Корпорейшн» (Centron Corporation)
44 Beolmal-Ro, Dongan-Gu, Anyang,
Gyeonggi-Do, 14059, Корея

SN

XXXXXX



XX.XXXX

Уполномоченный представитель
производителя в РФ:

ООО «ГРУППА АЛЪЯНС»
196191, город Санкт-Петербург, проспект
Новоизмайловский, д. 46, корпус 2, литер А,
помещение 4-Н, ком. 13

Регистрационное удостоверение

№ _____ от _____

Всего пронумеровано, сшито и скреплено
печатью 60/шестьдесят листа(-ов)
Генеральный директор
ООО «Группа Альянс»
Маханова Е.А.

