


Фотографические изображения медицинского изделия

**Система рентгенохирургическая передвижная СРТ
по ТУ 9442-034-1150760-2014**

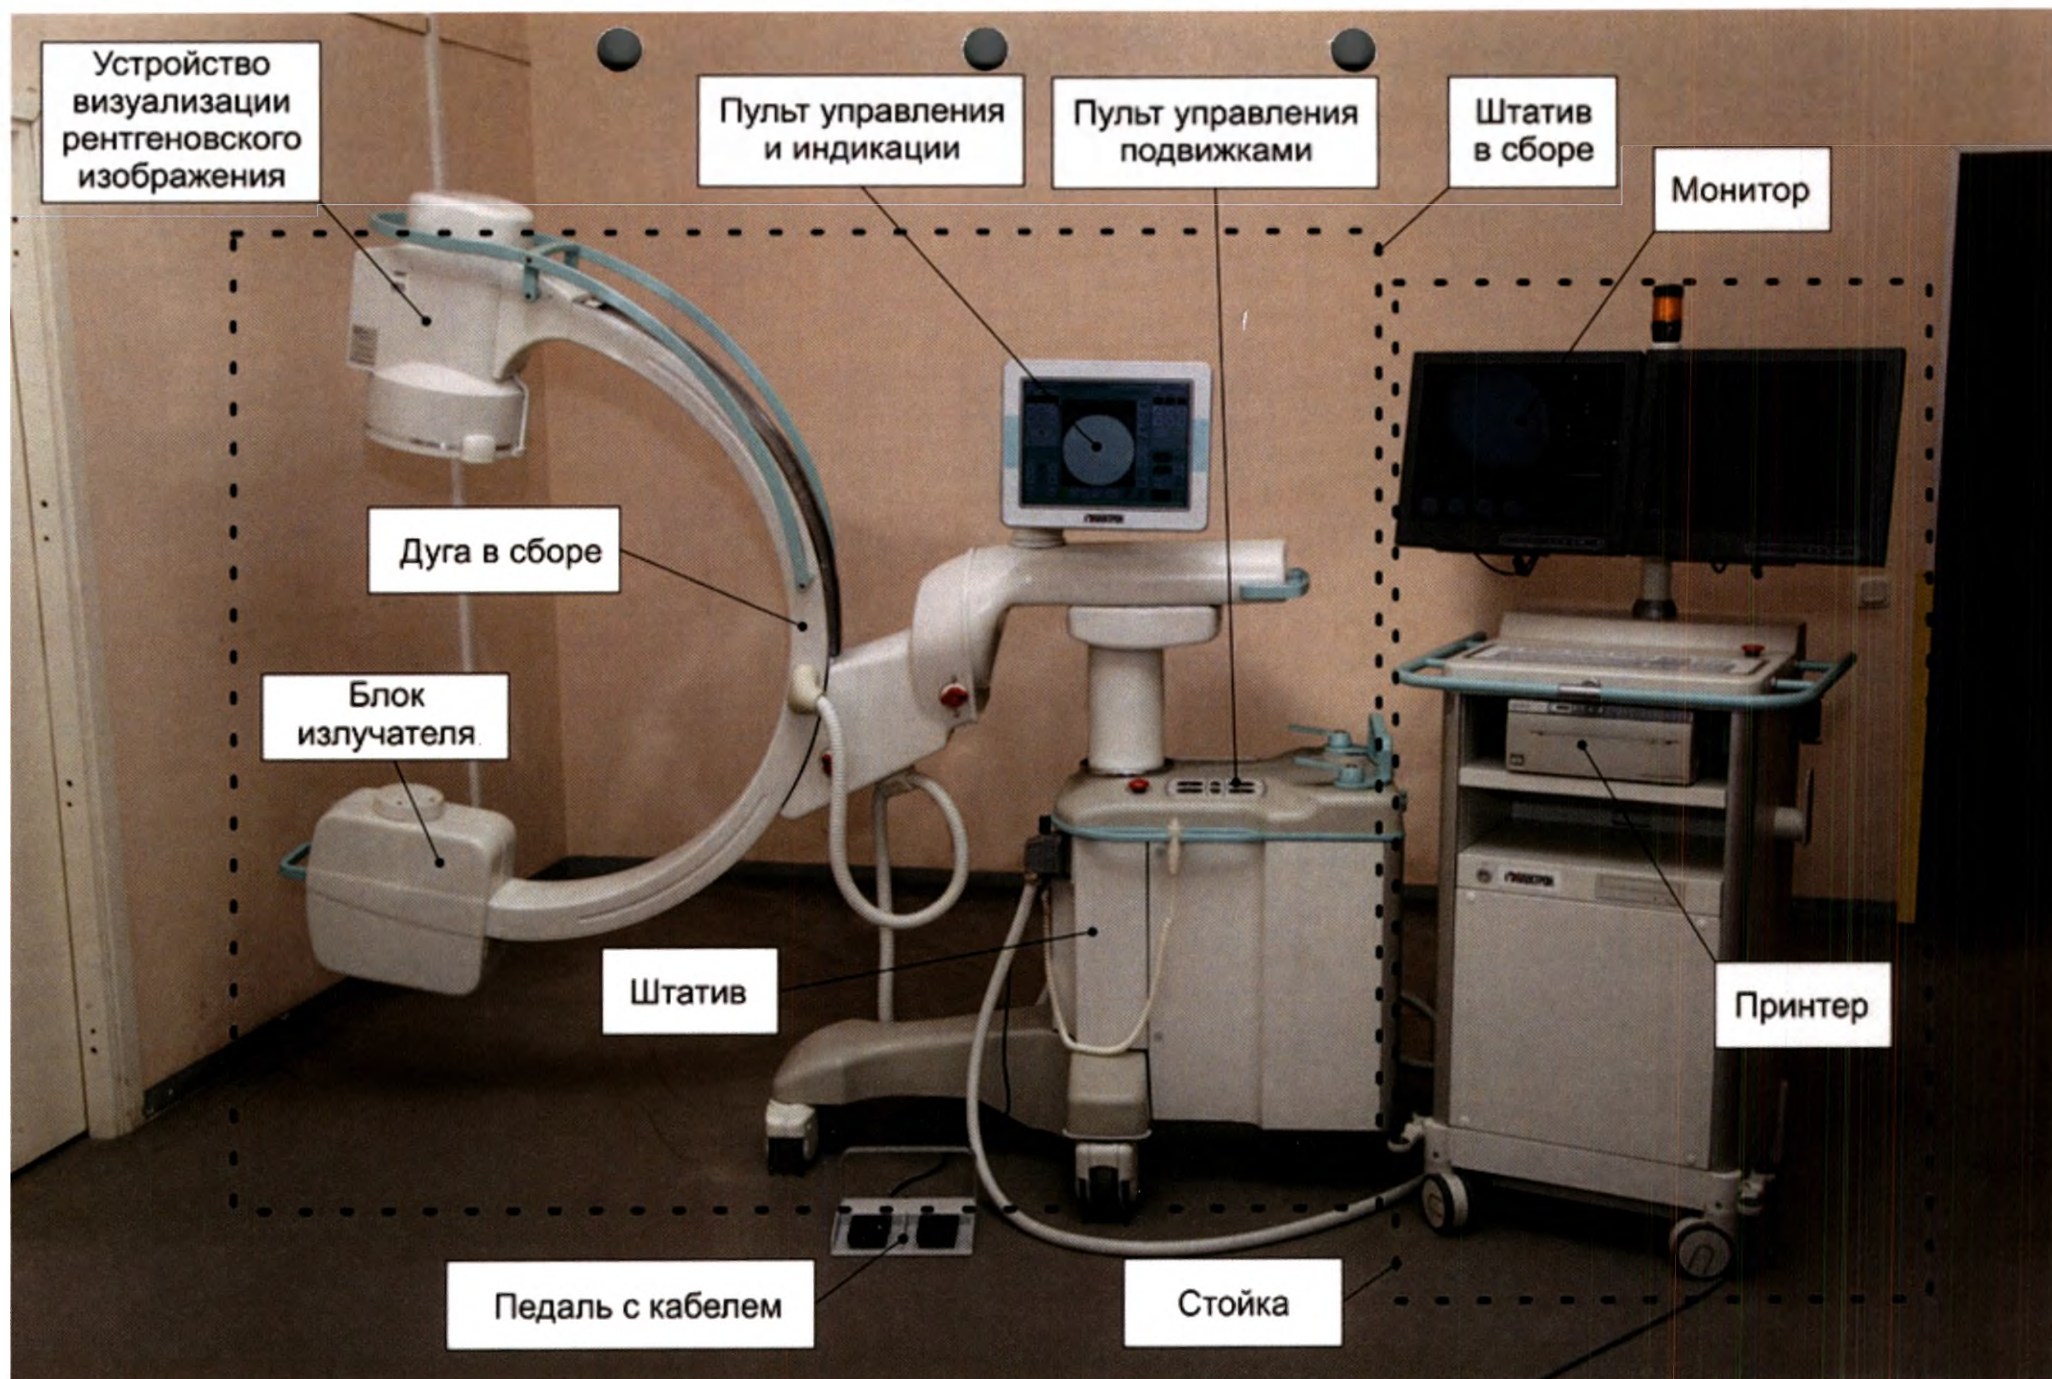

Фотография 1 – Система рентгенохирургическая передвижная СРТ по ТУ 9442-034-11150760-2014 Исполнение 1 – СРТ-МАКСИМА

ЭЛЕКТРОН

Система
рентгенохирургическая
передвижная
СРТ-"МАКСИМА"

ОБОЗНАЧЕНИЕ

SRT-00-0000:5

ТУ

9442-034-11150760-2014

СЕР. НОМЕР

GP0004927

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

2023-05

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АО "НИПК "ЭЛЕКТРОН"


NP-20-0001-01



~220 В, 50 Гц, 16 А



Фотография 2 – СРТ-МАКСИМА. Маркировка

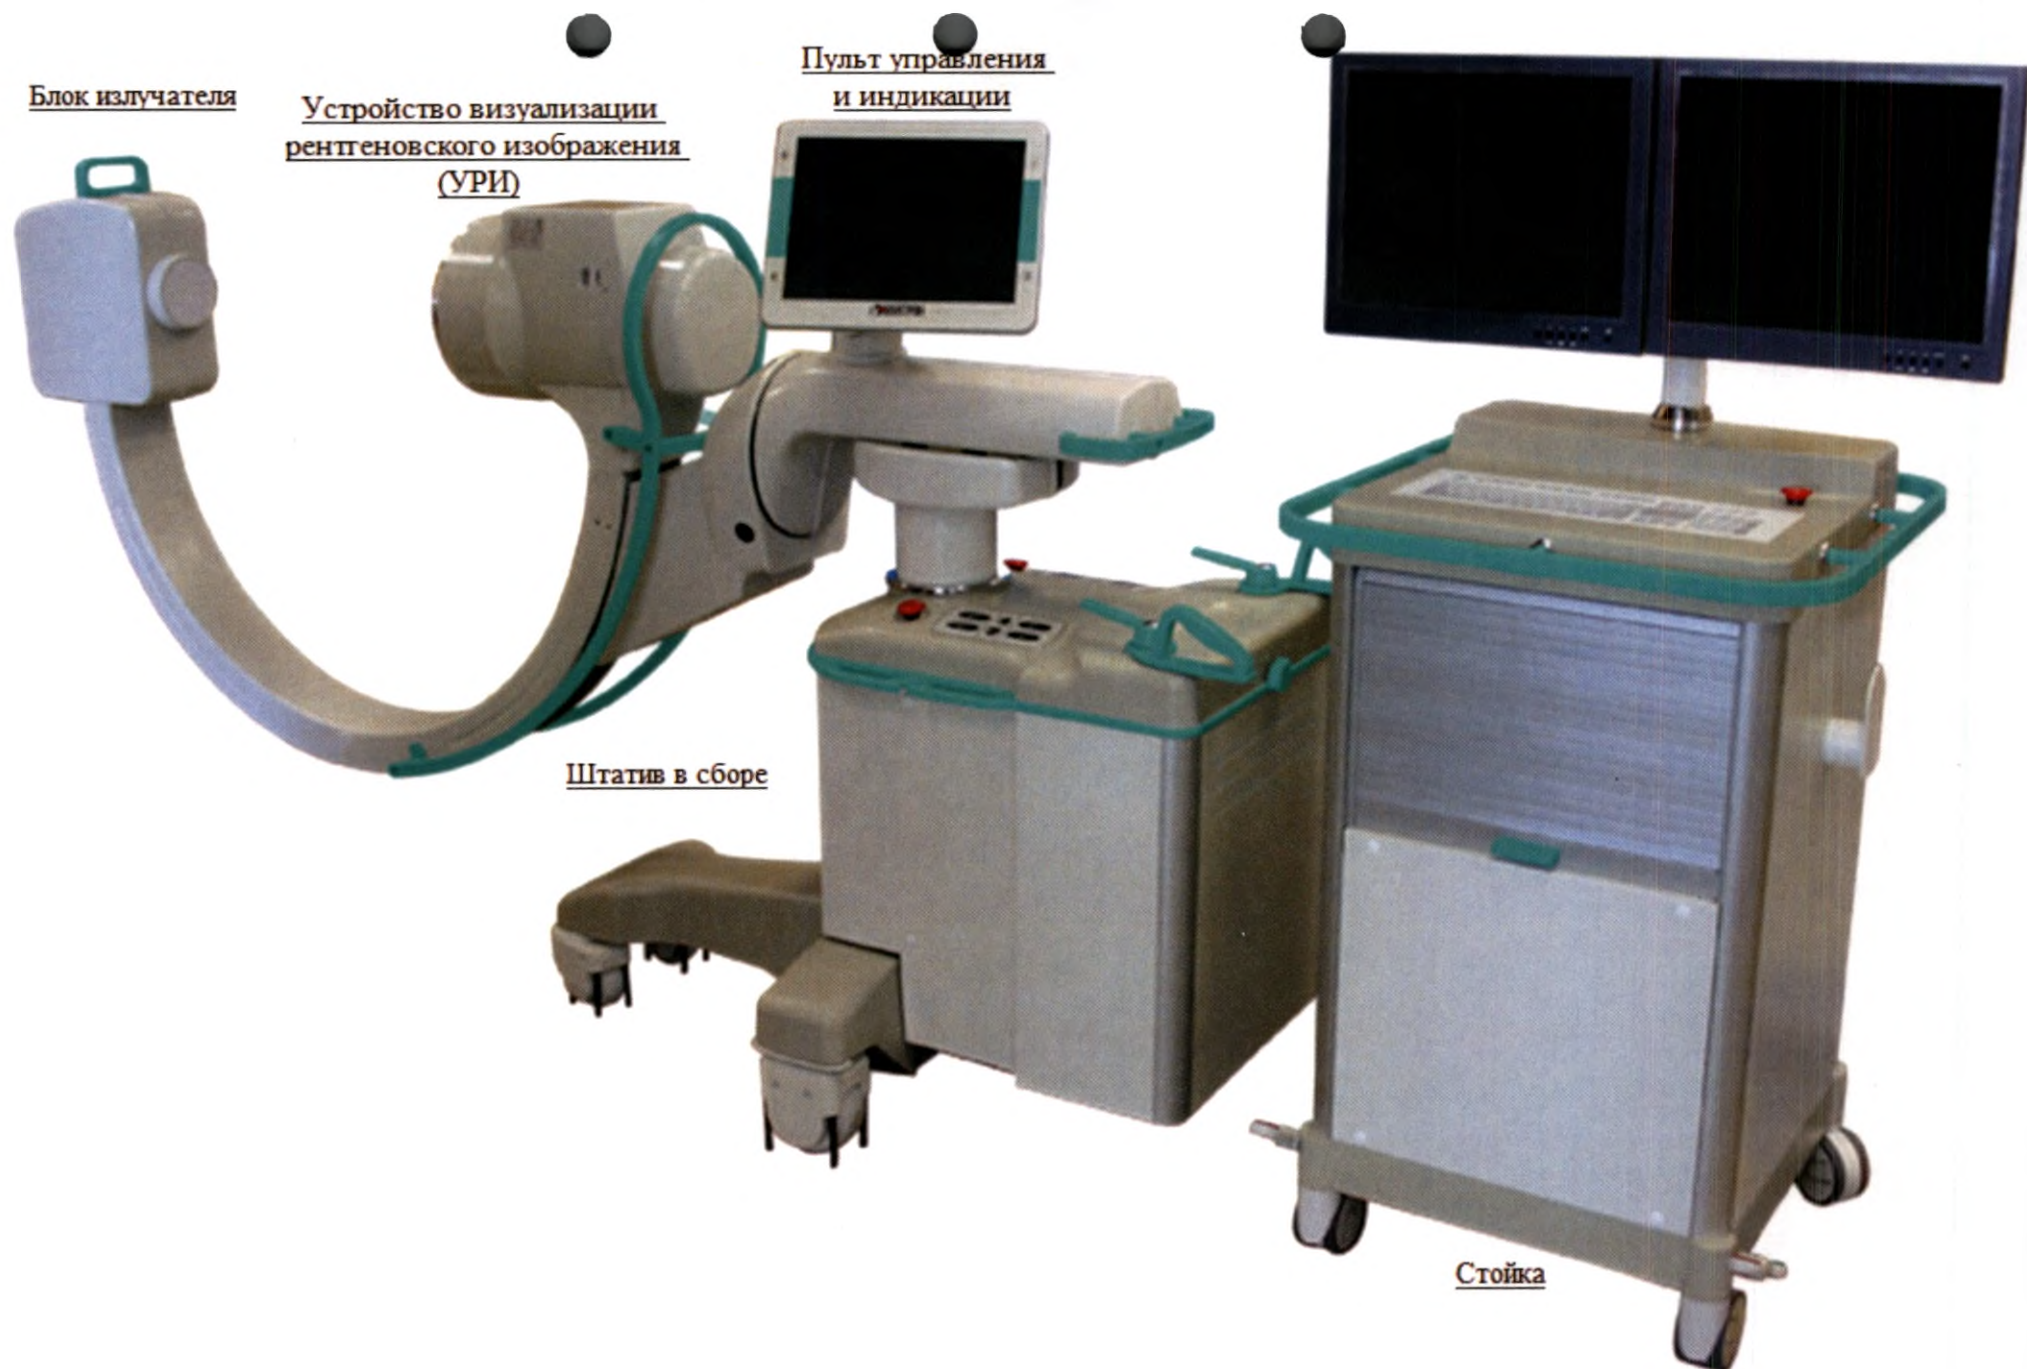

Фотография 3 – Система рентгенохирургическая передвижная СРТ по ТУ 9442-034-11150760-2014. Исполнение 2 – СРТ-ОКО

ЭЛЕКТРОН

Система
рентгенохирургическая
передвижная
СРТ-"ОКО"

ОБОЗНАЧЕНИЕ

SRT-00-0000:30

ТУ

9442-034-11150760-2014

СЕР. НОМЕР

GP0005947

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

2023-05

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АО "НИПК "ЭЛЕКТРОН"


NP-20-0001-01



~220 В. 50 Гц, 16 А



Фотография 4 – СРТ-ОКО. Маркировка

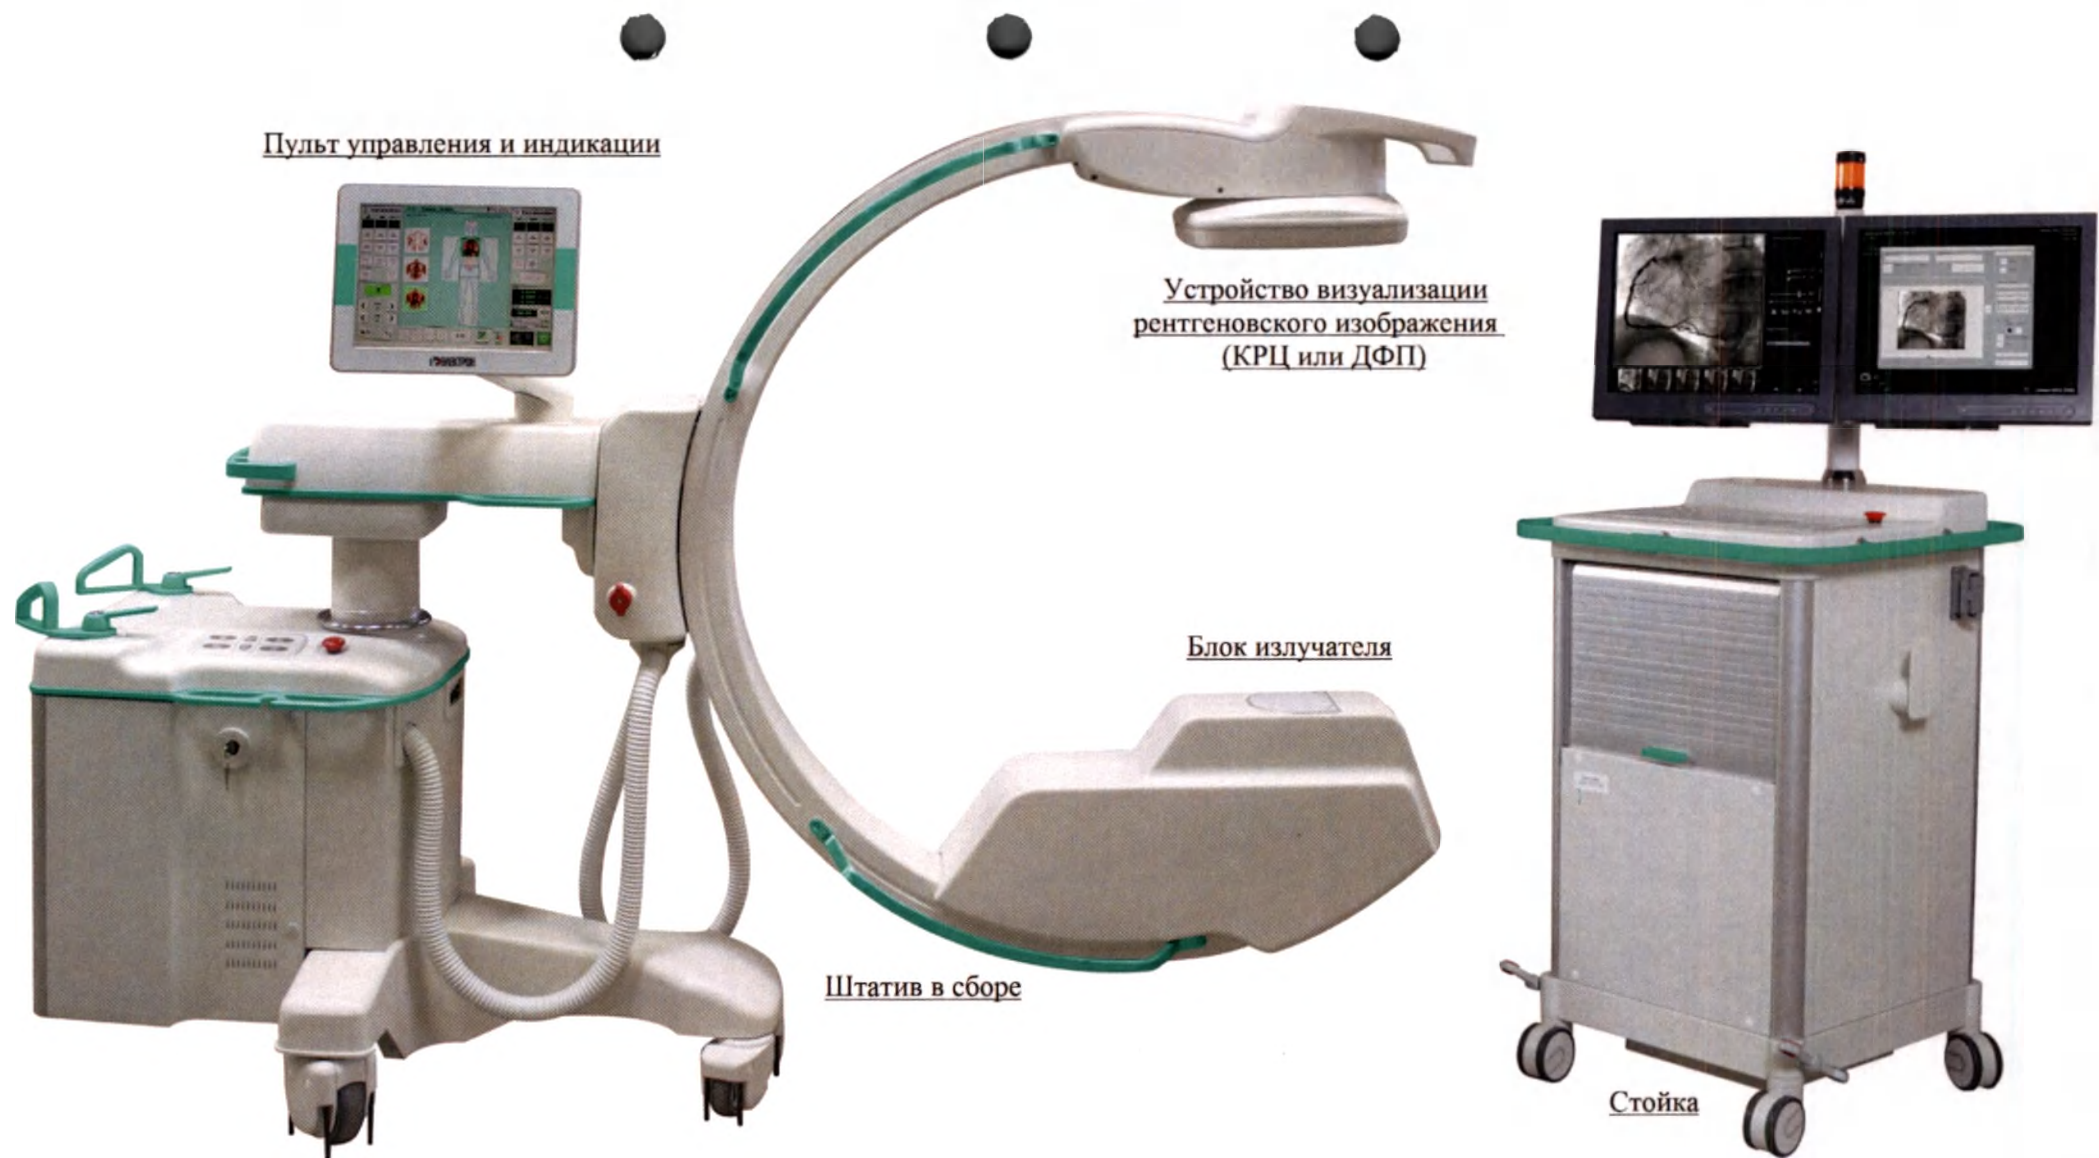

Фотография 5 – Система рентгенохирургическая передвижная СРТ по ТУ 9442-034-11150760-2014 Исполнение 3 – СРТ-ЭКСПЕРТ

ЭЛЕКТРОН

Система
рентгенохирургическая
передвижная
СРТ-"ЭКСПЕРТ"

ОБОЗНАЧЕНИЕ

SRT-00-0000:50

ТУ

9442-034-11150760-2014

СЕР. НОМЕР

GP0005948

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

2023-05

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АО "НИПК "ЭЛЕКТРОН"

NP-20-0001-01




~220 В, 50 Гц, 16 А



Фотография 6 – СРТ-ЭКСПЕРТ. Маркировка



Фотография 7 – Штатив в сборе (основание)

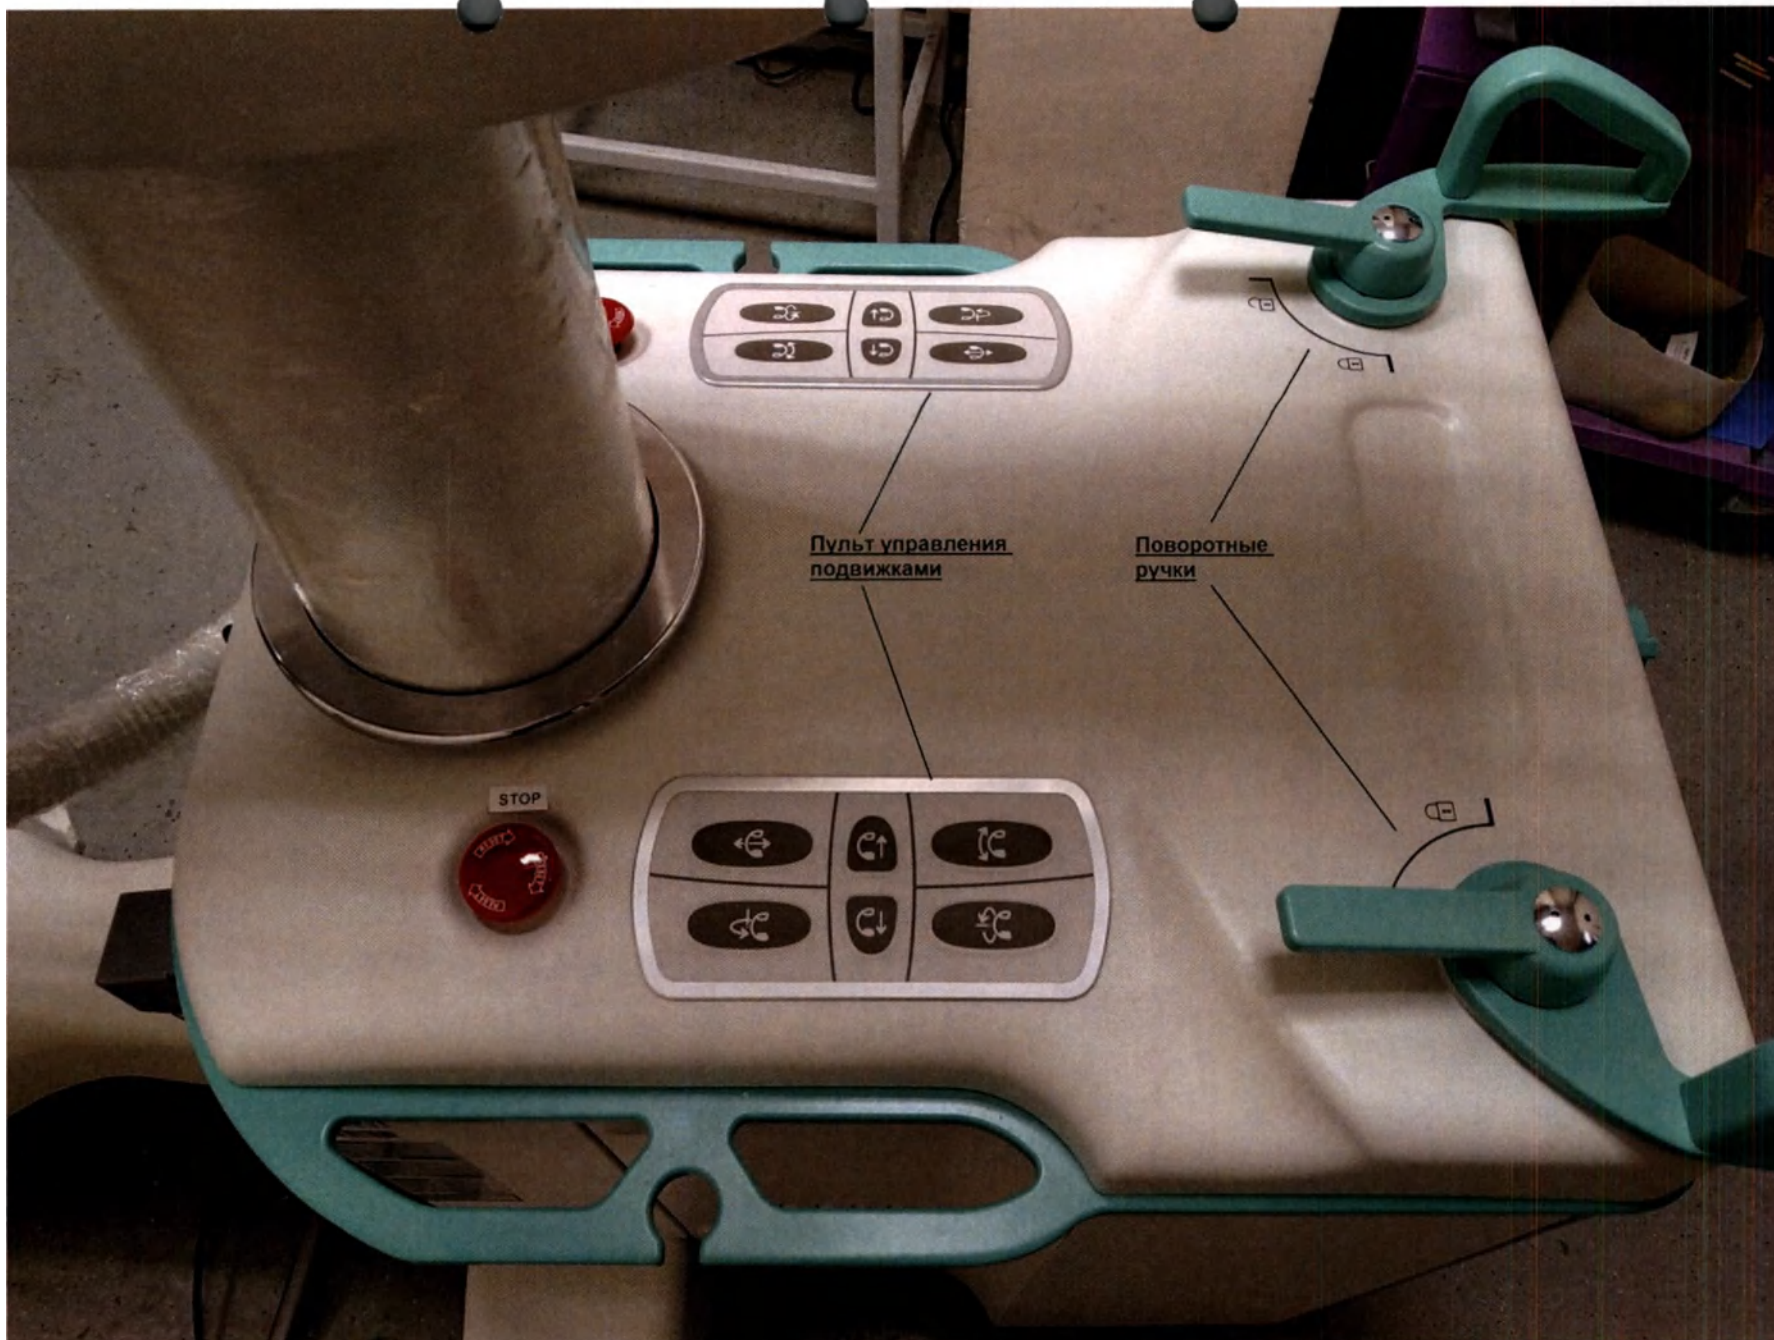

Фотография 8 – Пульт управления подвижками и поворотные ручки



Фотография 9 – Кнопка рентгеновской экспозиции

Серийный номер
Дата изготовления

PF1461230
2023-05

Обозначение

SRT-00-0800-04

Серийный номер МИ

GP0005948

Изготовитель

АО "НИПК "ЭЛЕКТРОН"

NP-20-0002-01



Фотография 10 – Штатив в сборе. Маркировка



Фотография 11 – Блок излучателя (вариант внешнего вида)

ЭЛЕКТРОН

Блок излучателя

Серийный номер
Дата изготовления

PF1461235
2023-05

Обозначение

SRT-10-7970


Серийный номер МИ

GP0005948


Изготовитель

АО "НИПК "ЭЛЕКТРОН"

NP-20-0002-01

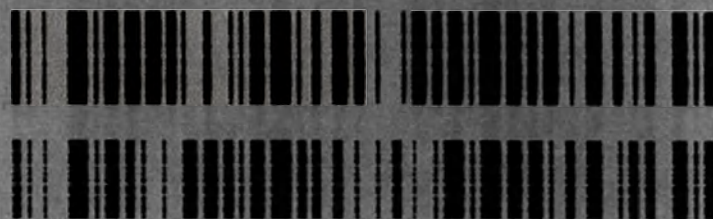

Фотография 12 – Блок излучателя. Маркировка

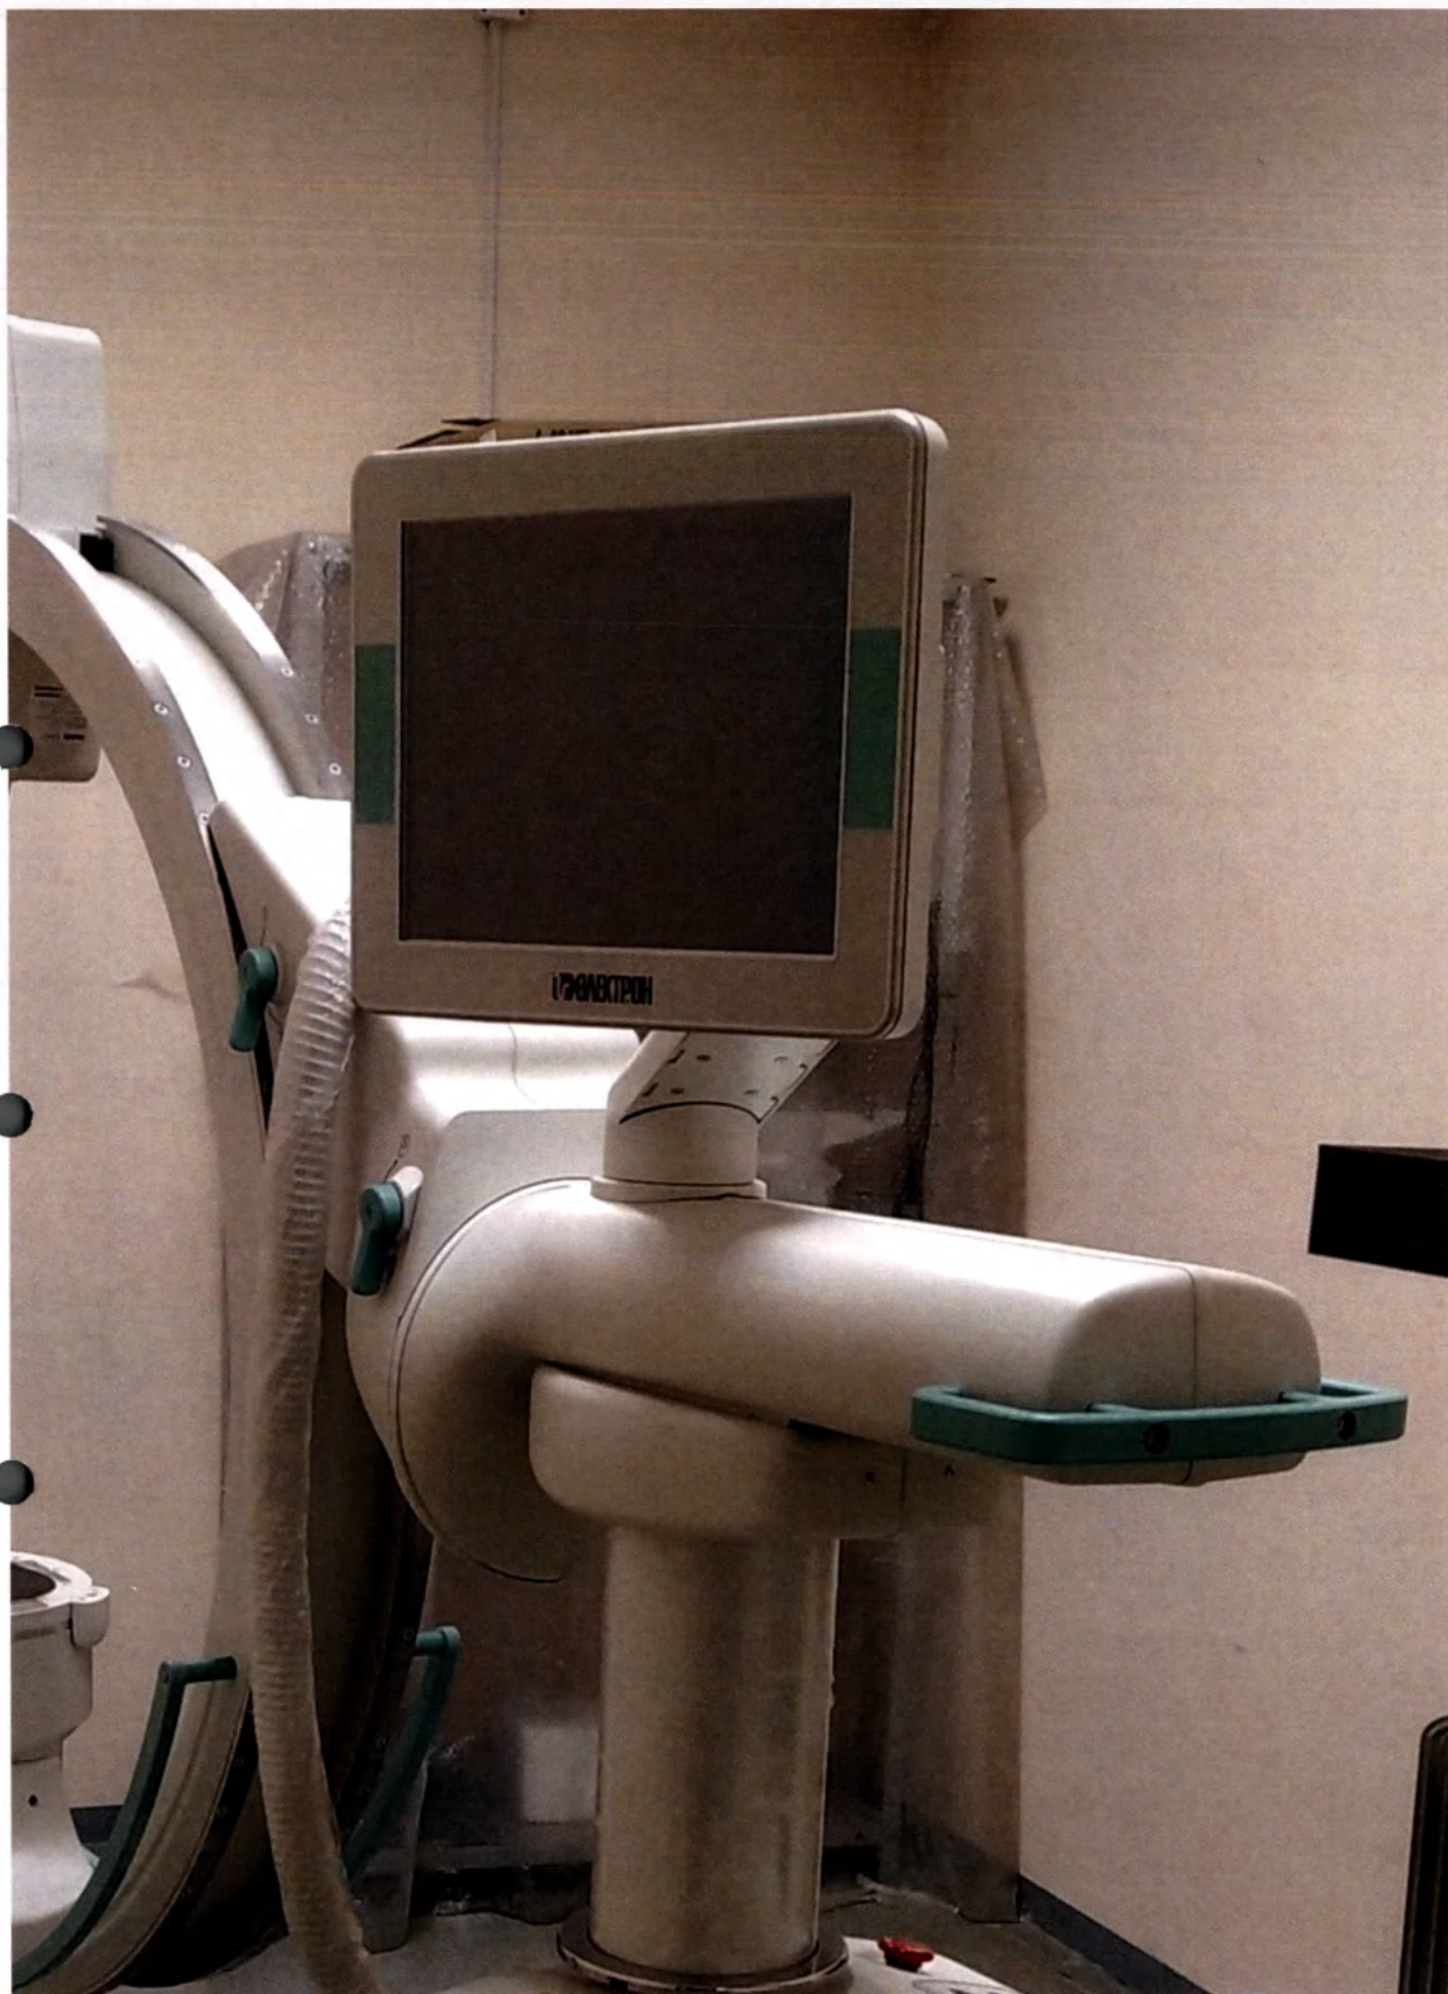

Фотография 13 – Пульт управления и индикации

ЭЛЕКТРОН

Пульт управления и
индикации

Серийный номер

PF1461260

Дата изготовления

2023-05

Обозначение

SRT-10-6210

Серийный номер МИ

GP0005948

Изготовитель

АО "НИПК "ЭЛЕКТРОН"

NP-20-0002-01



Фотография 14 – Пульт управления и индикации. Маркировка



Фотография 15 – Стойка

ЭЛЕКТРОН

Стойка

Серийный номер
Дата изготовления

PF1461265
2023-05

Обозначение

SRT-00-0500


Серийный номер МИ

GP0005948

Изготовитель

АО "НИПК "ЭЛЕКТРОН"

NP-20-0002-01

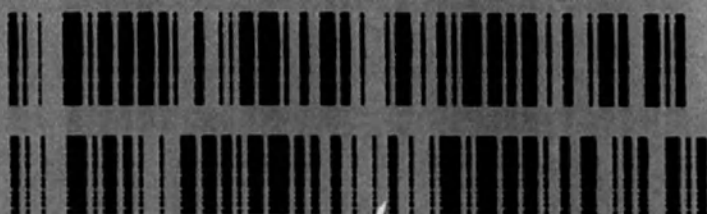

Фотография 16 – Стойка. Маркировка



Фотография 17 – Устройство визуализации рентгеновского изображения (камера КРЦ или приемник ДФП)

ЭЛЕКТРОНПриемник рентгеновский
цифровой ДФПТУ
Серийный номер
Дата изготовления9442-026-11150760-2007
PF1461257
2023-05

Обозначение

DFP-00-0000-04
(исполнение ДФП4343Ц5)


Серийный номер МИ

GP0005948

Изготовитель

АО "НИПК "ЭЛЕКТРОН"

NP-20-0002-01

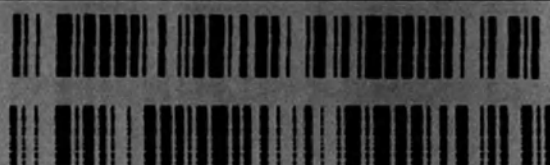

Фотография 18 – Приемник рентгеновский цифровой ДФП. Маркировка

ЭЛЕКТРОНКамера рентгеновская
цифровая КРЦТУ
Серийный номер
Дата изготовления9442-026-11150760-2007
PF1461251
2023-05

Обозначение

DFP-00-0000-04
(исполнение ДФП4343Г5)

Серийный номер МИ

GP0005948

Изготовитель

АО "НИПК "ЭЛЕКТРОН"

NP-20-0002-01



Фотография 19 – Камера рентгеновская цифровая КРЦ. Маркировка



Фотография 20 – Система визуализации для ангиографических комплексов



Фотография 21 – Усилитель рентгеновского изображения УРИ

ЭЛЕКТРОН

Усилитель рентгеновского
изображения УРИ

ТУ 9442-027-11150760-2007
Дата изготовления 2023-05

Обозначение исполнение 1 - УРИ-1.0М

Серийный номер МИ GP0005948


Изготовитель АО "НИПК "ЭЛЕКТРОН"

220 В, 50 Гц, 100 Вт


NP-20-0002-01



Фотография 22 – Усилитель рентгеновского изображения УРИ. Маркировка

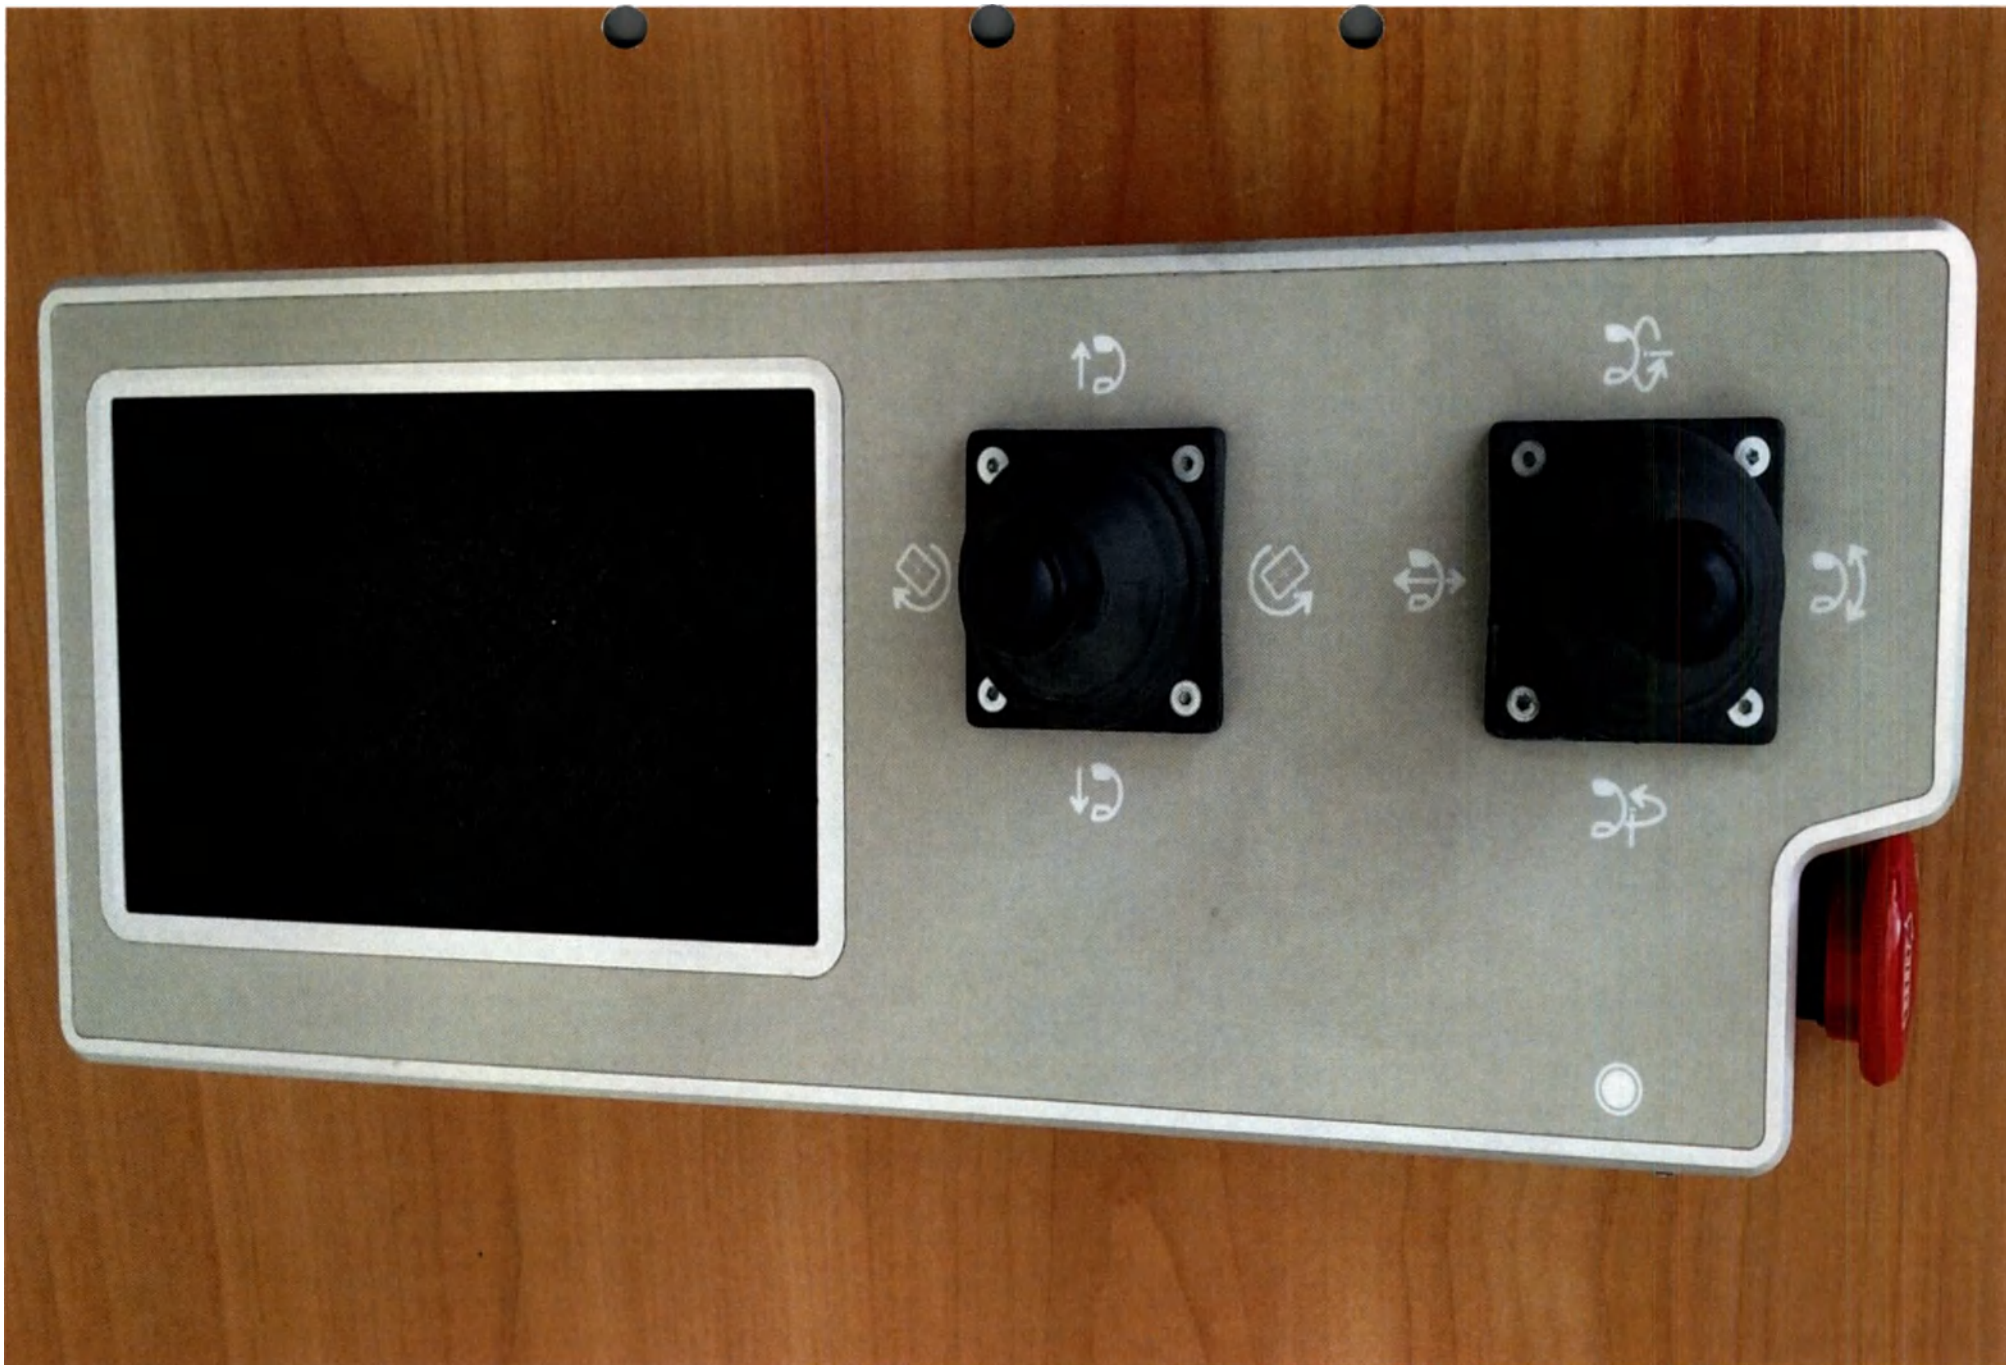

Фотография 23 – Пульт выносной

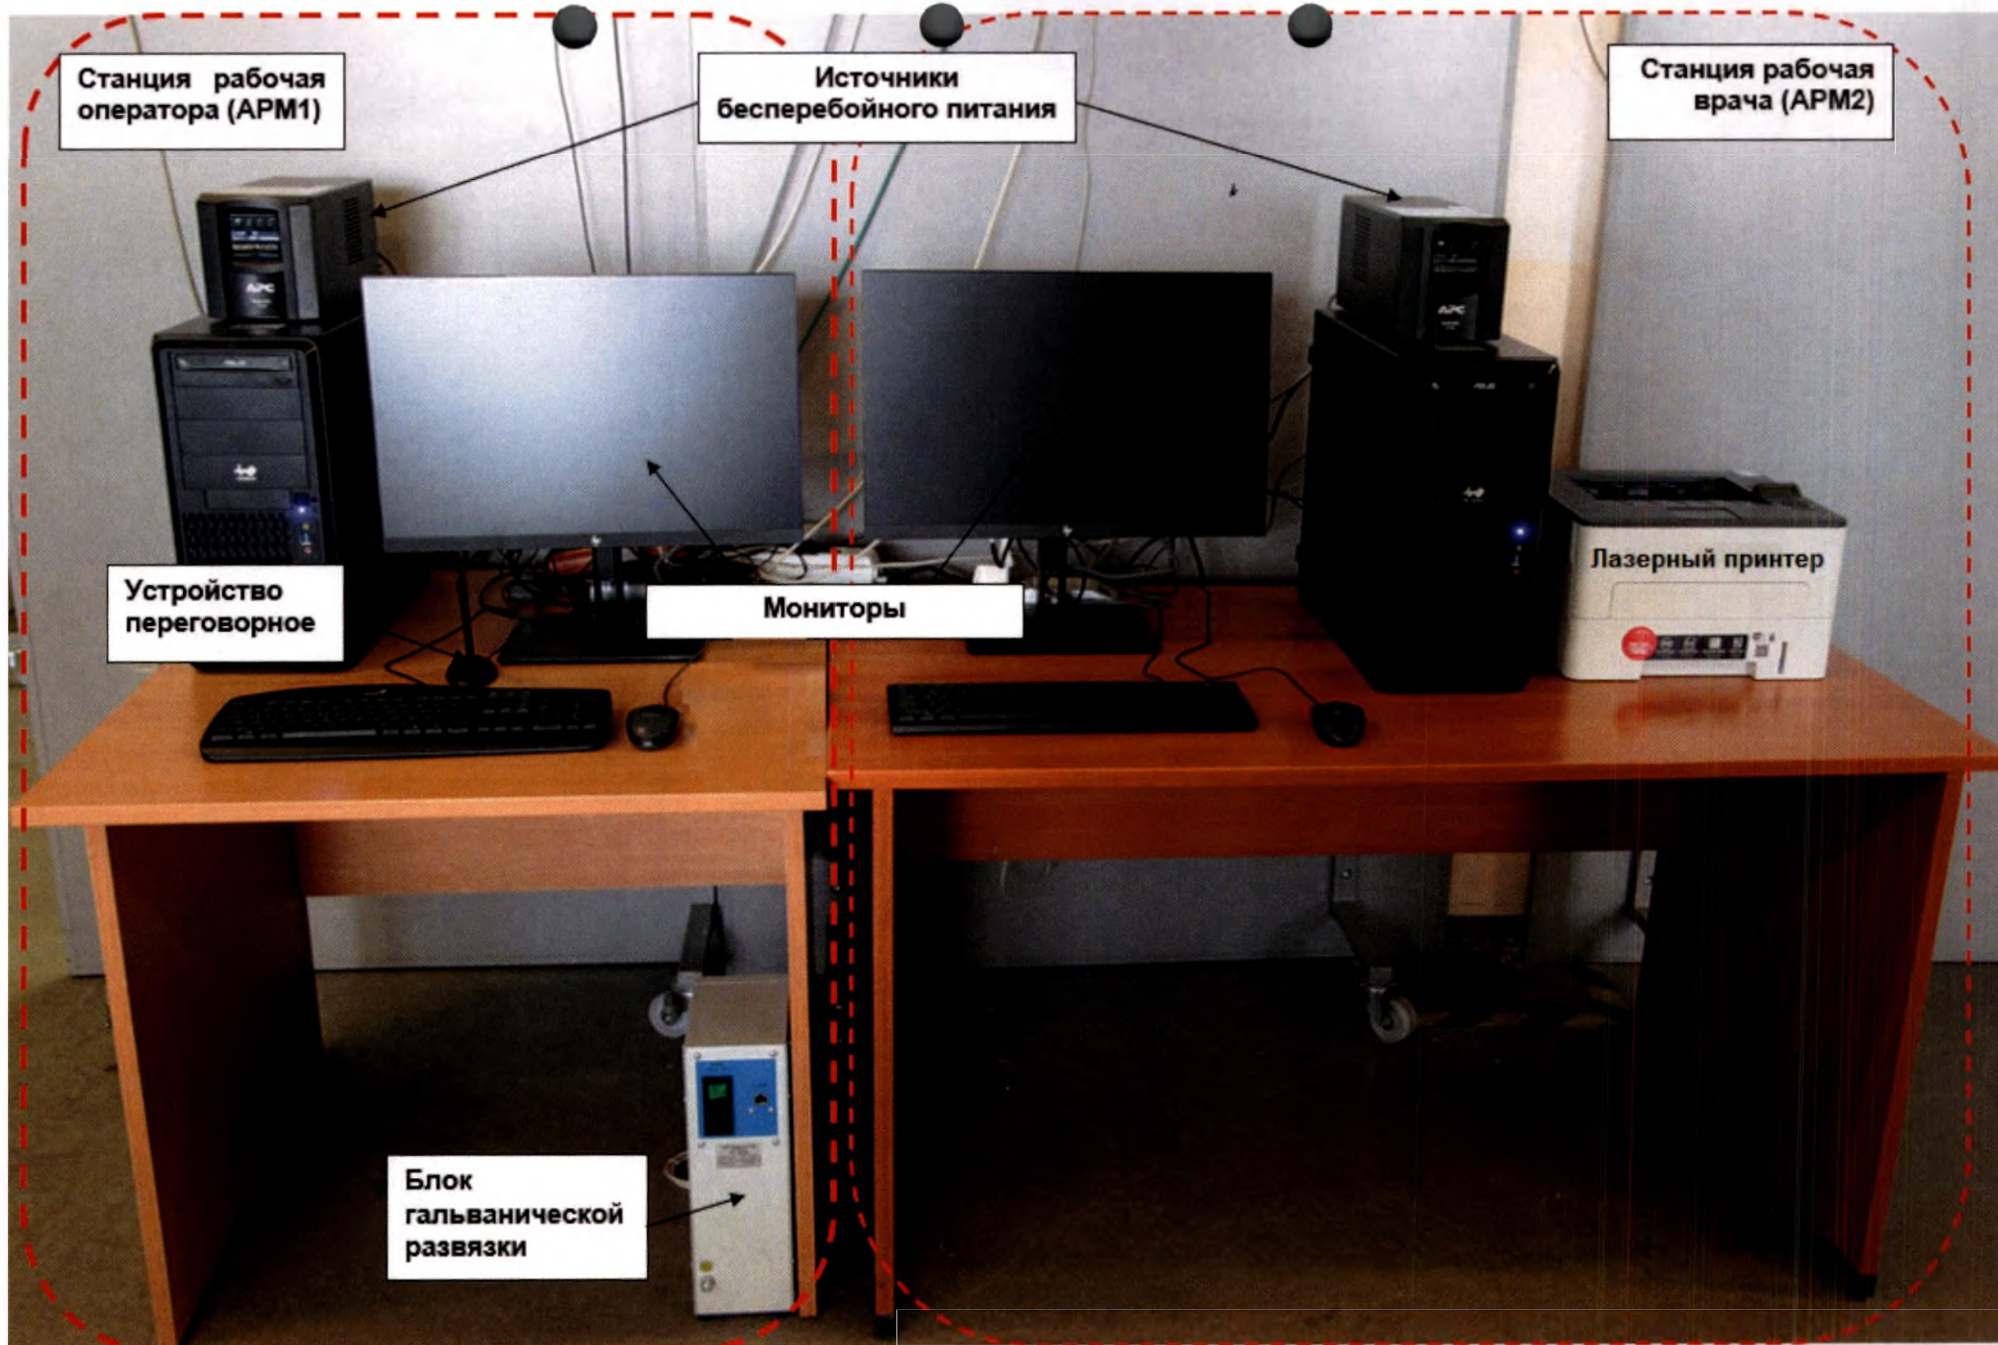

Фотография 24 – Рентгенодиагностический программно-аппаратный комплекс (РПАК) CWS-00 по спецификации АО «НИПК «Электрон». Вариант общего вида



Станция рабочая
оператора/лаборанта (APM1)

Серийный номер NN1461267
Дата изготовления 2023-05

Обозначение WST1-00-9000
(WST1-00)


Серийный номер МИ GP0005948

Изготовитель АО "НИПК "ЭЛЕКТРОН"

NP-20-0002-01



~220 В, 50 Гц, 6 А

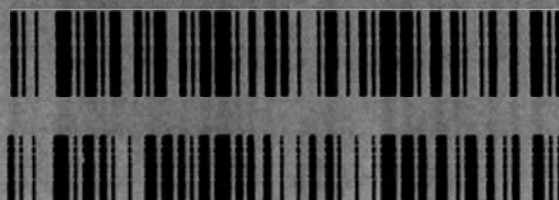

Фотография 25 – Станция рабочая оператора/лаборанта (APM1). Маркировка



Станция рабочая
врача/рентгенолога (APM2)

Серийный номер NN1461270
Дата изготовления 2023-05

Обозначение WST2-00-1600
(WST2-00)

Серийный номер МИ GP0005948

Изготовитель АО "НИПК "ЭЛЕКТРОН"

NP-20-0002-01



~220 В, 50 Гц, 6 А



Фотография 26 – Станция рабочая врача/рентгенолога (APM2)

ЭЛЕКТРОНСтанция рабочая
регистратора/WEB-доступа
(АРМЗ)

Серийный номер NN1461277
Дата изготовления 2023-05

Обозначение WST3-00-0300
(WST3-00)


Серийный номер МИ GP0005948

Изготовитель АО "НИПК "ЭЛЕКТРОН"

NP-20-0002-01



~220 В, 50 Гц, 6 А

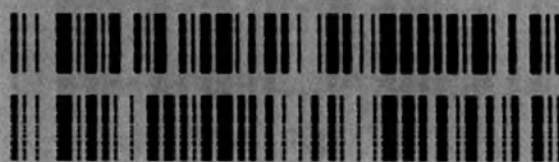

Фотография 27 – Станция рабочая регистратора/web-доступа (АРМЗ)

ЭЛЕКТРОНКомплекс программно-
аппаратный ПАК

ТУ 9442-030-11150760-2009
Серийный номер PF1461260
Дата изготовления 2023-05

Обозначение PACS-00-0000

Серийный номер МИ GP0005948

Изготовитель АО "НИПК "ЭЛЕКТРОН"


NP-20-0002-01



~220В, 50 Гц, 2,0 кВА



Фотография 28 – Комплекс программно-аппаратный ПАК

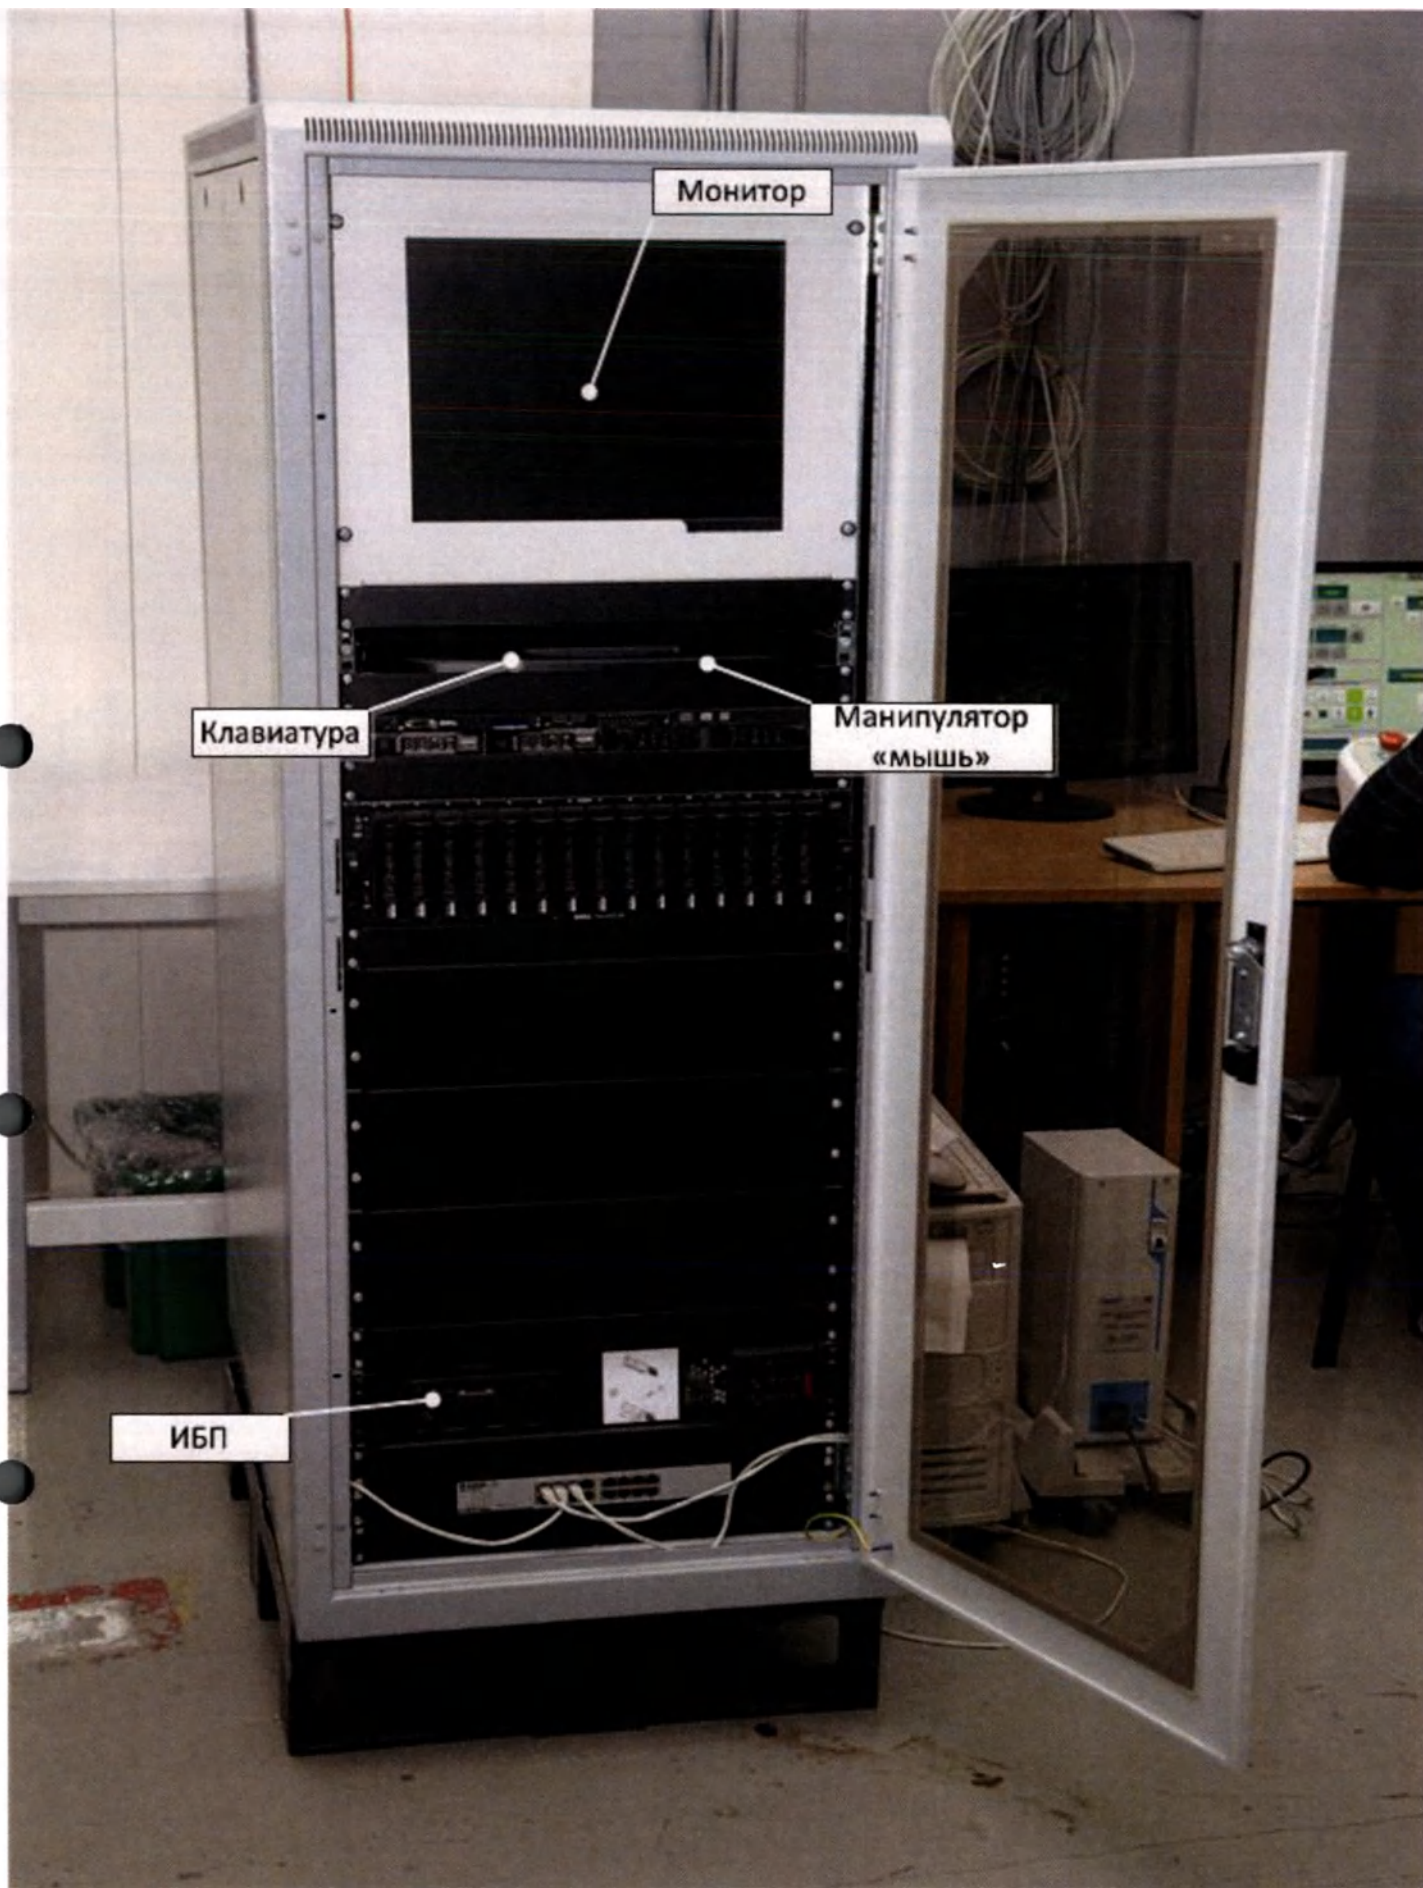

Фотография 29 – Сервер (вариант внешнего вида)

ЭЛЕКТРОН

Сервер

Серийный номер NN1461273
Дата изготовления 2023-05


Обозначение SRV-00-1200

Серийный номер МИ GP0005948


Изготовитель АО "НИПК "ЭЛЕКТРОН"

~220В, 50 Гц, 300 ВА



NIIP-20-0002-01

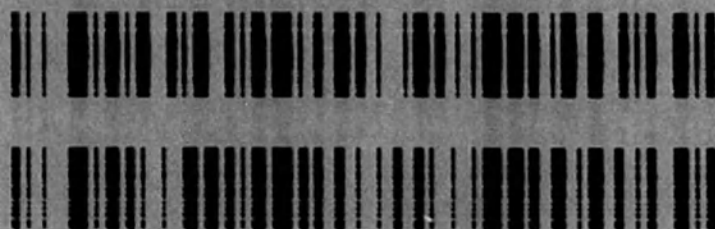


Фотография 30 – Сервер. Маркировка

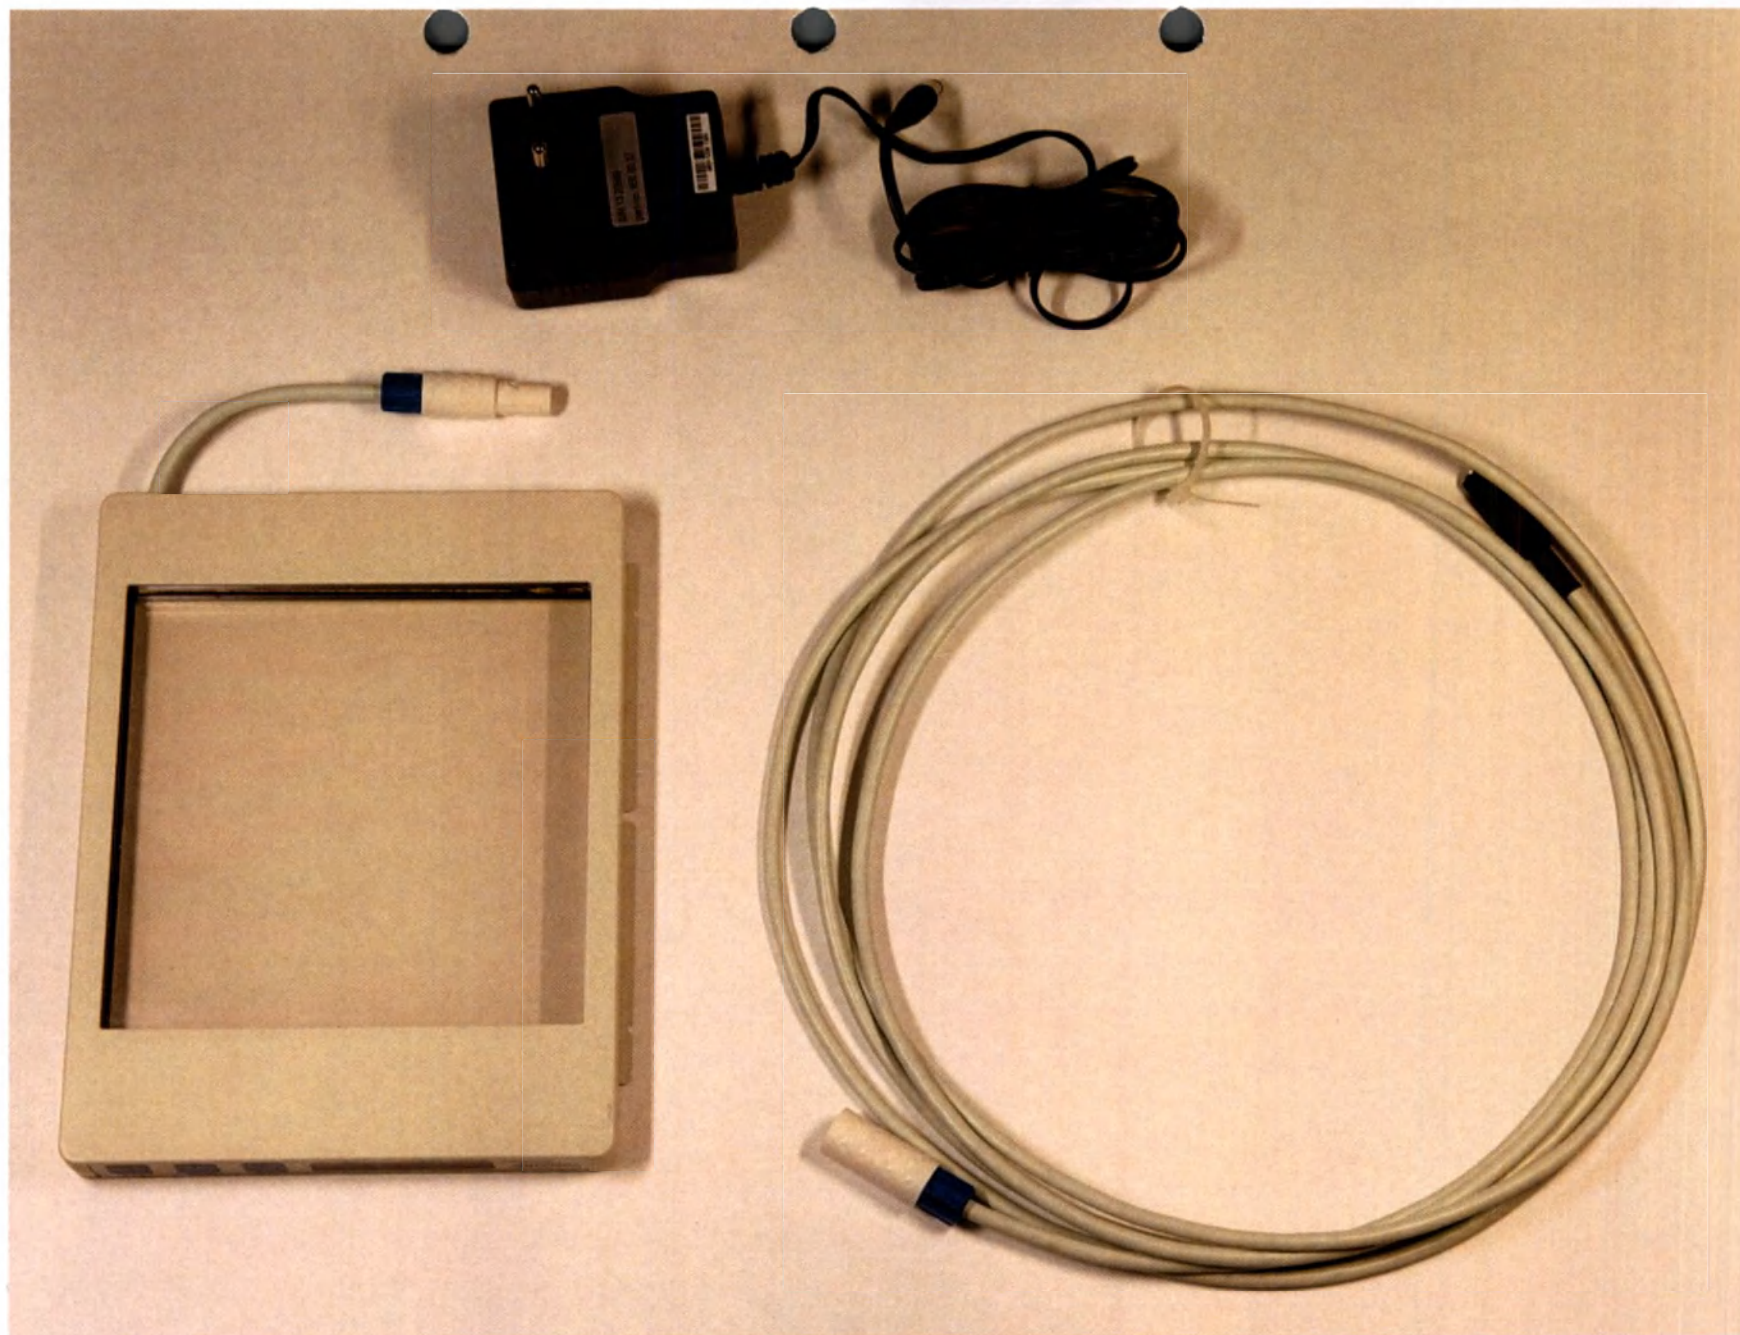


Фотография 31 – Дозиметр VacuDAP

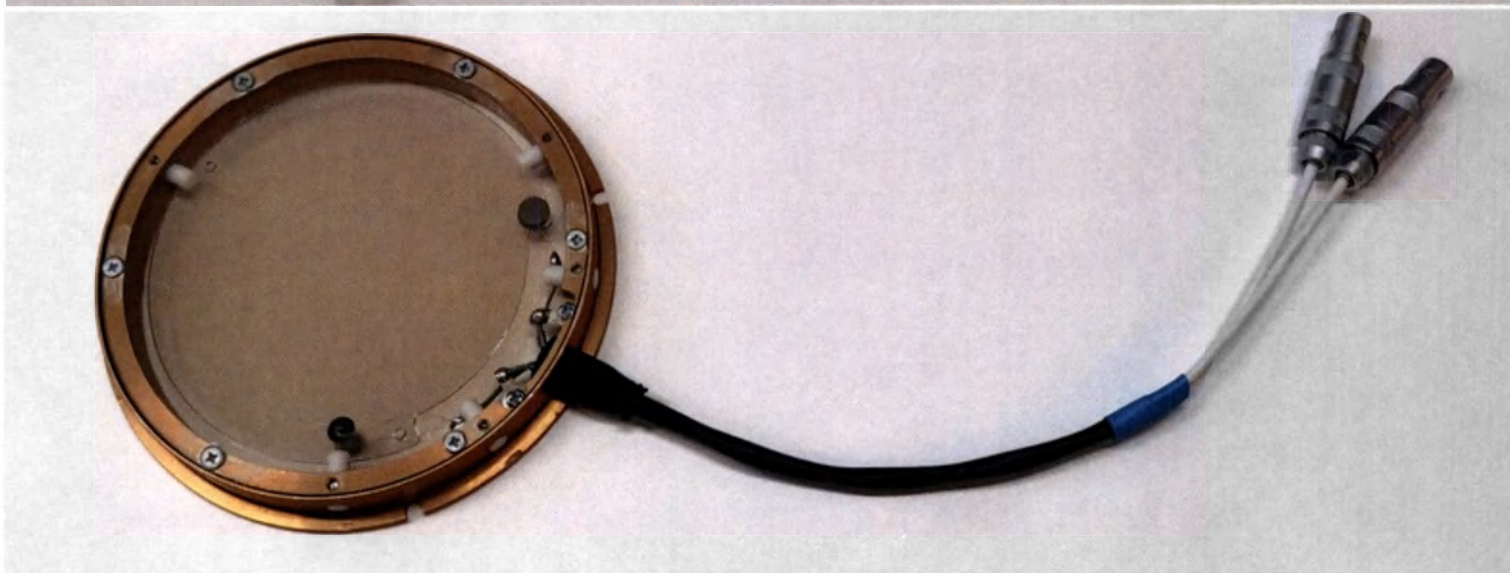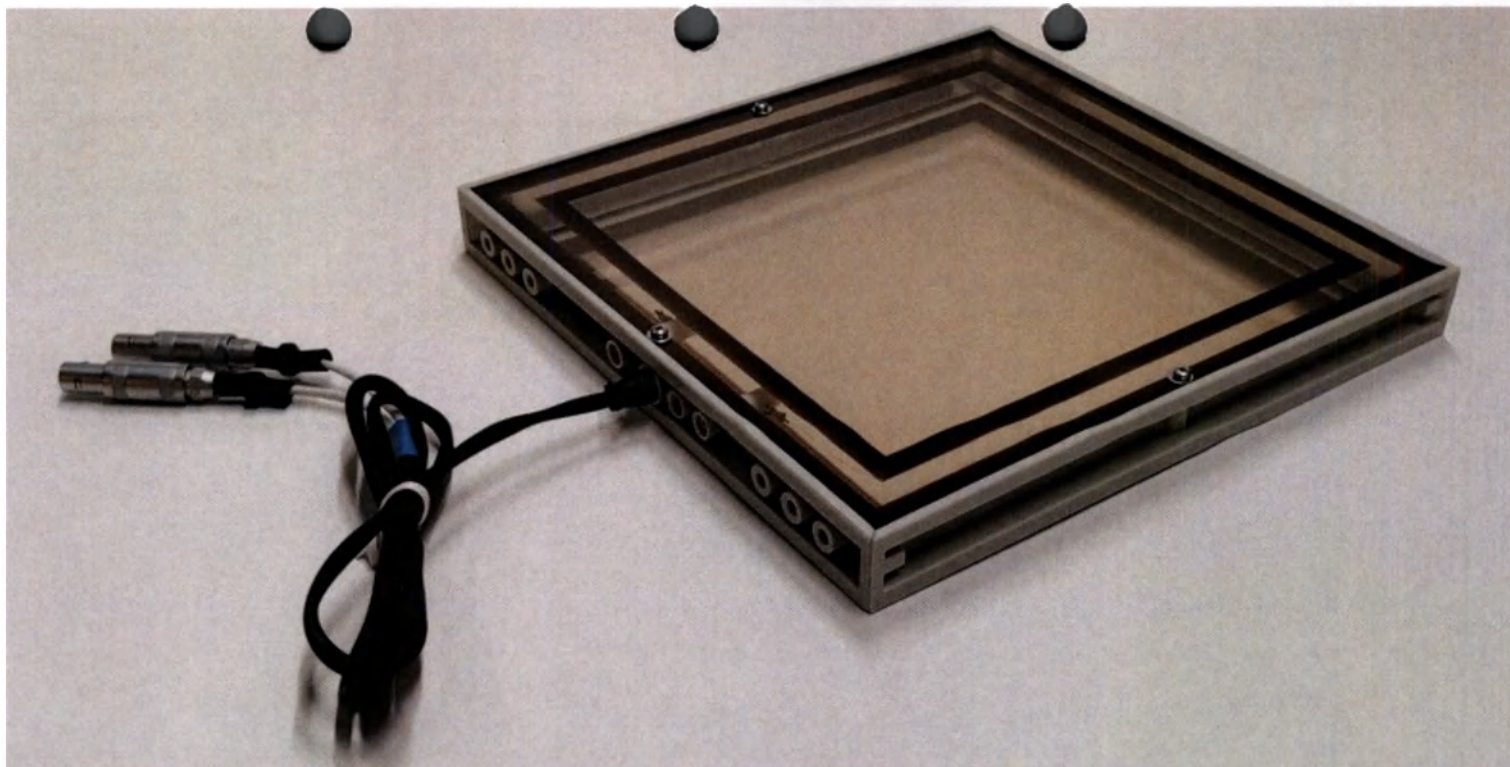


Фотография 32 – Дозиметр ДРК (внешний вид камер)

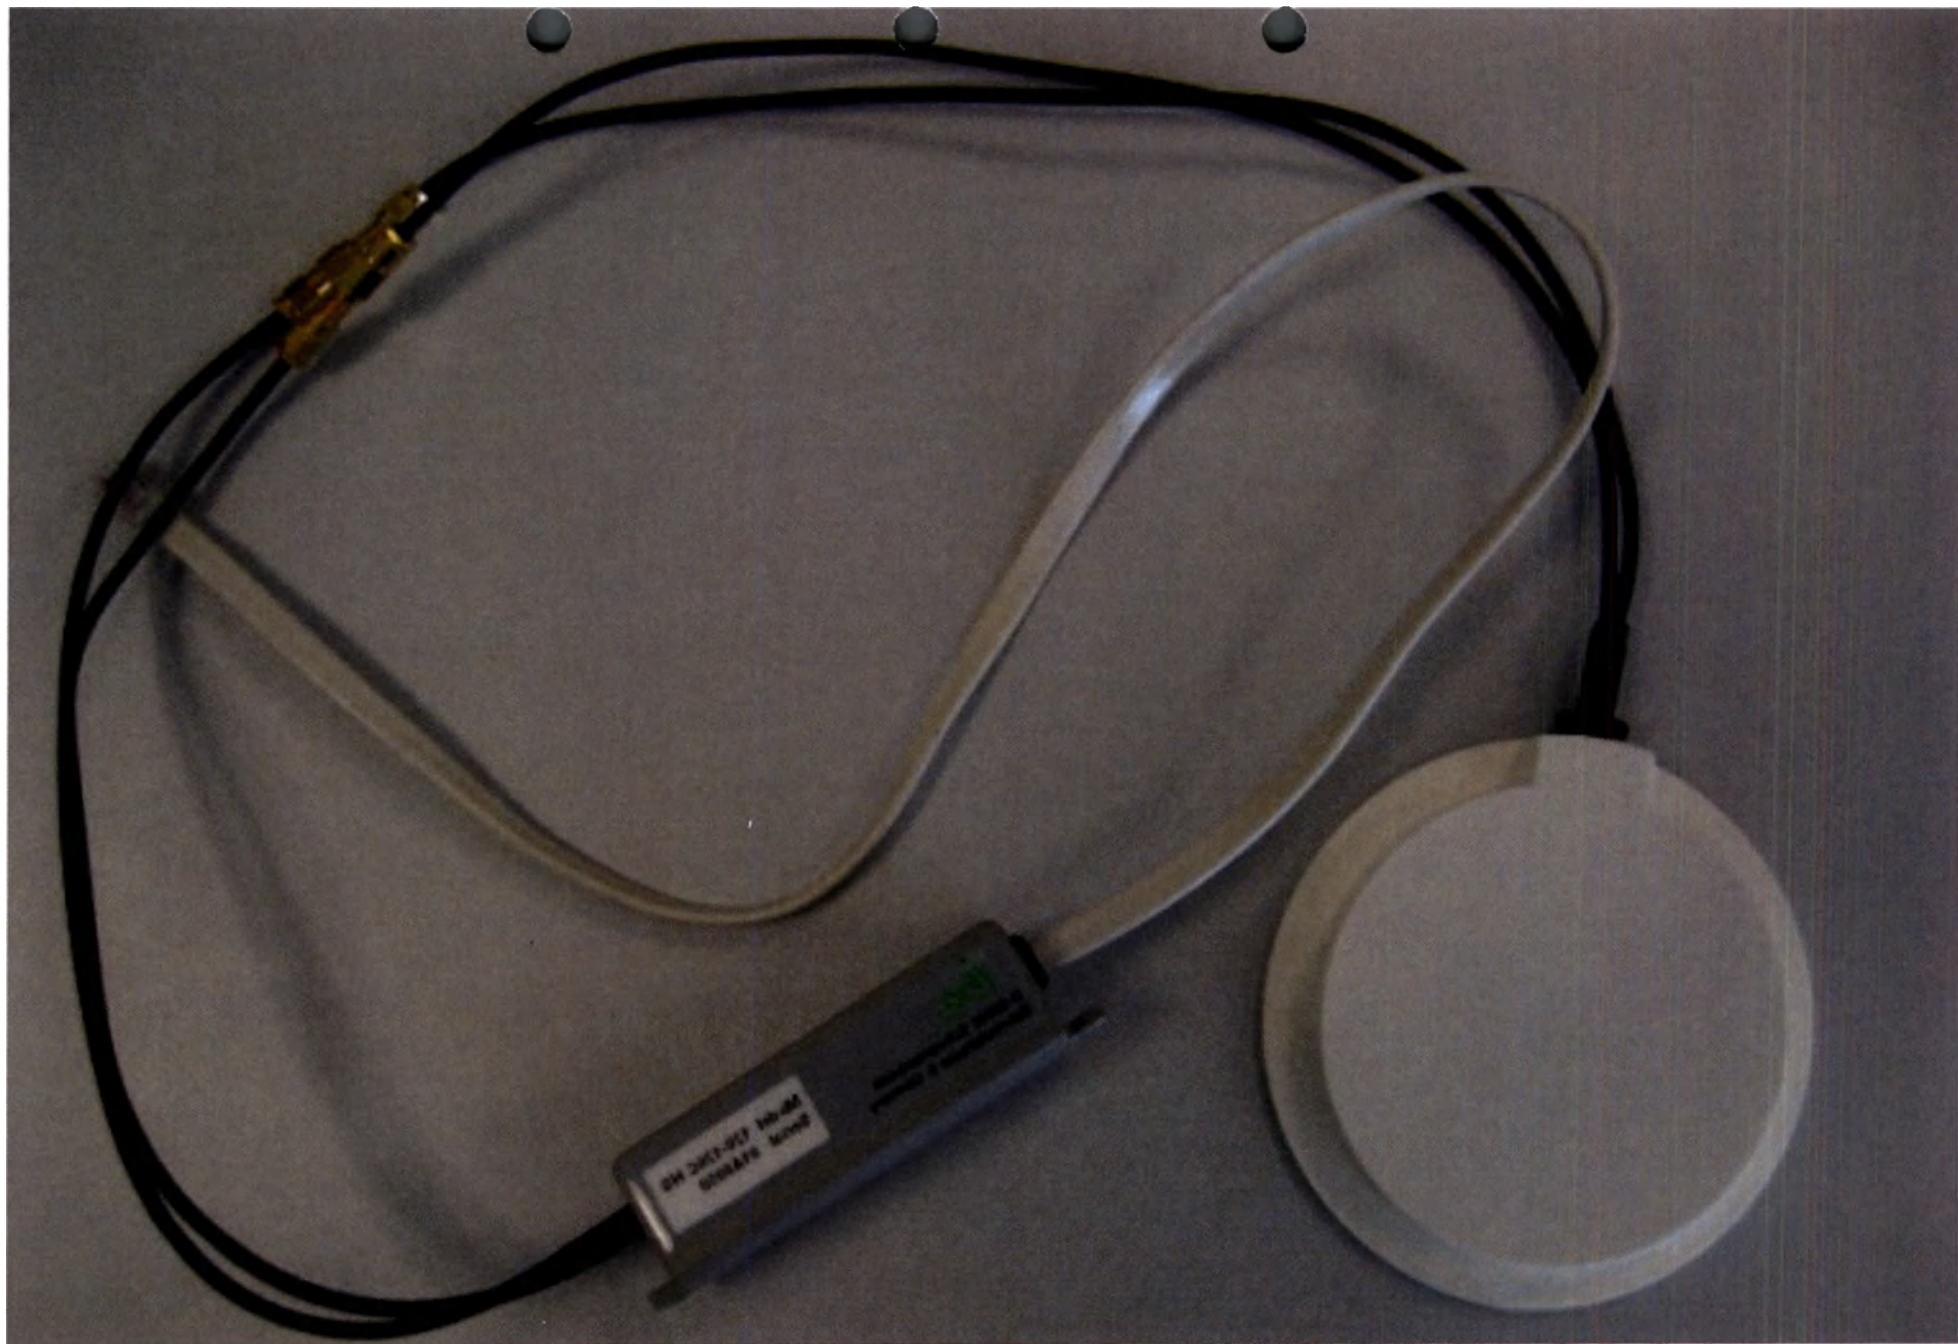

Фотография 33 – Дозиметр КертаХ

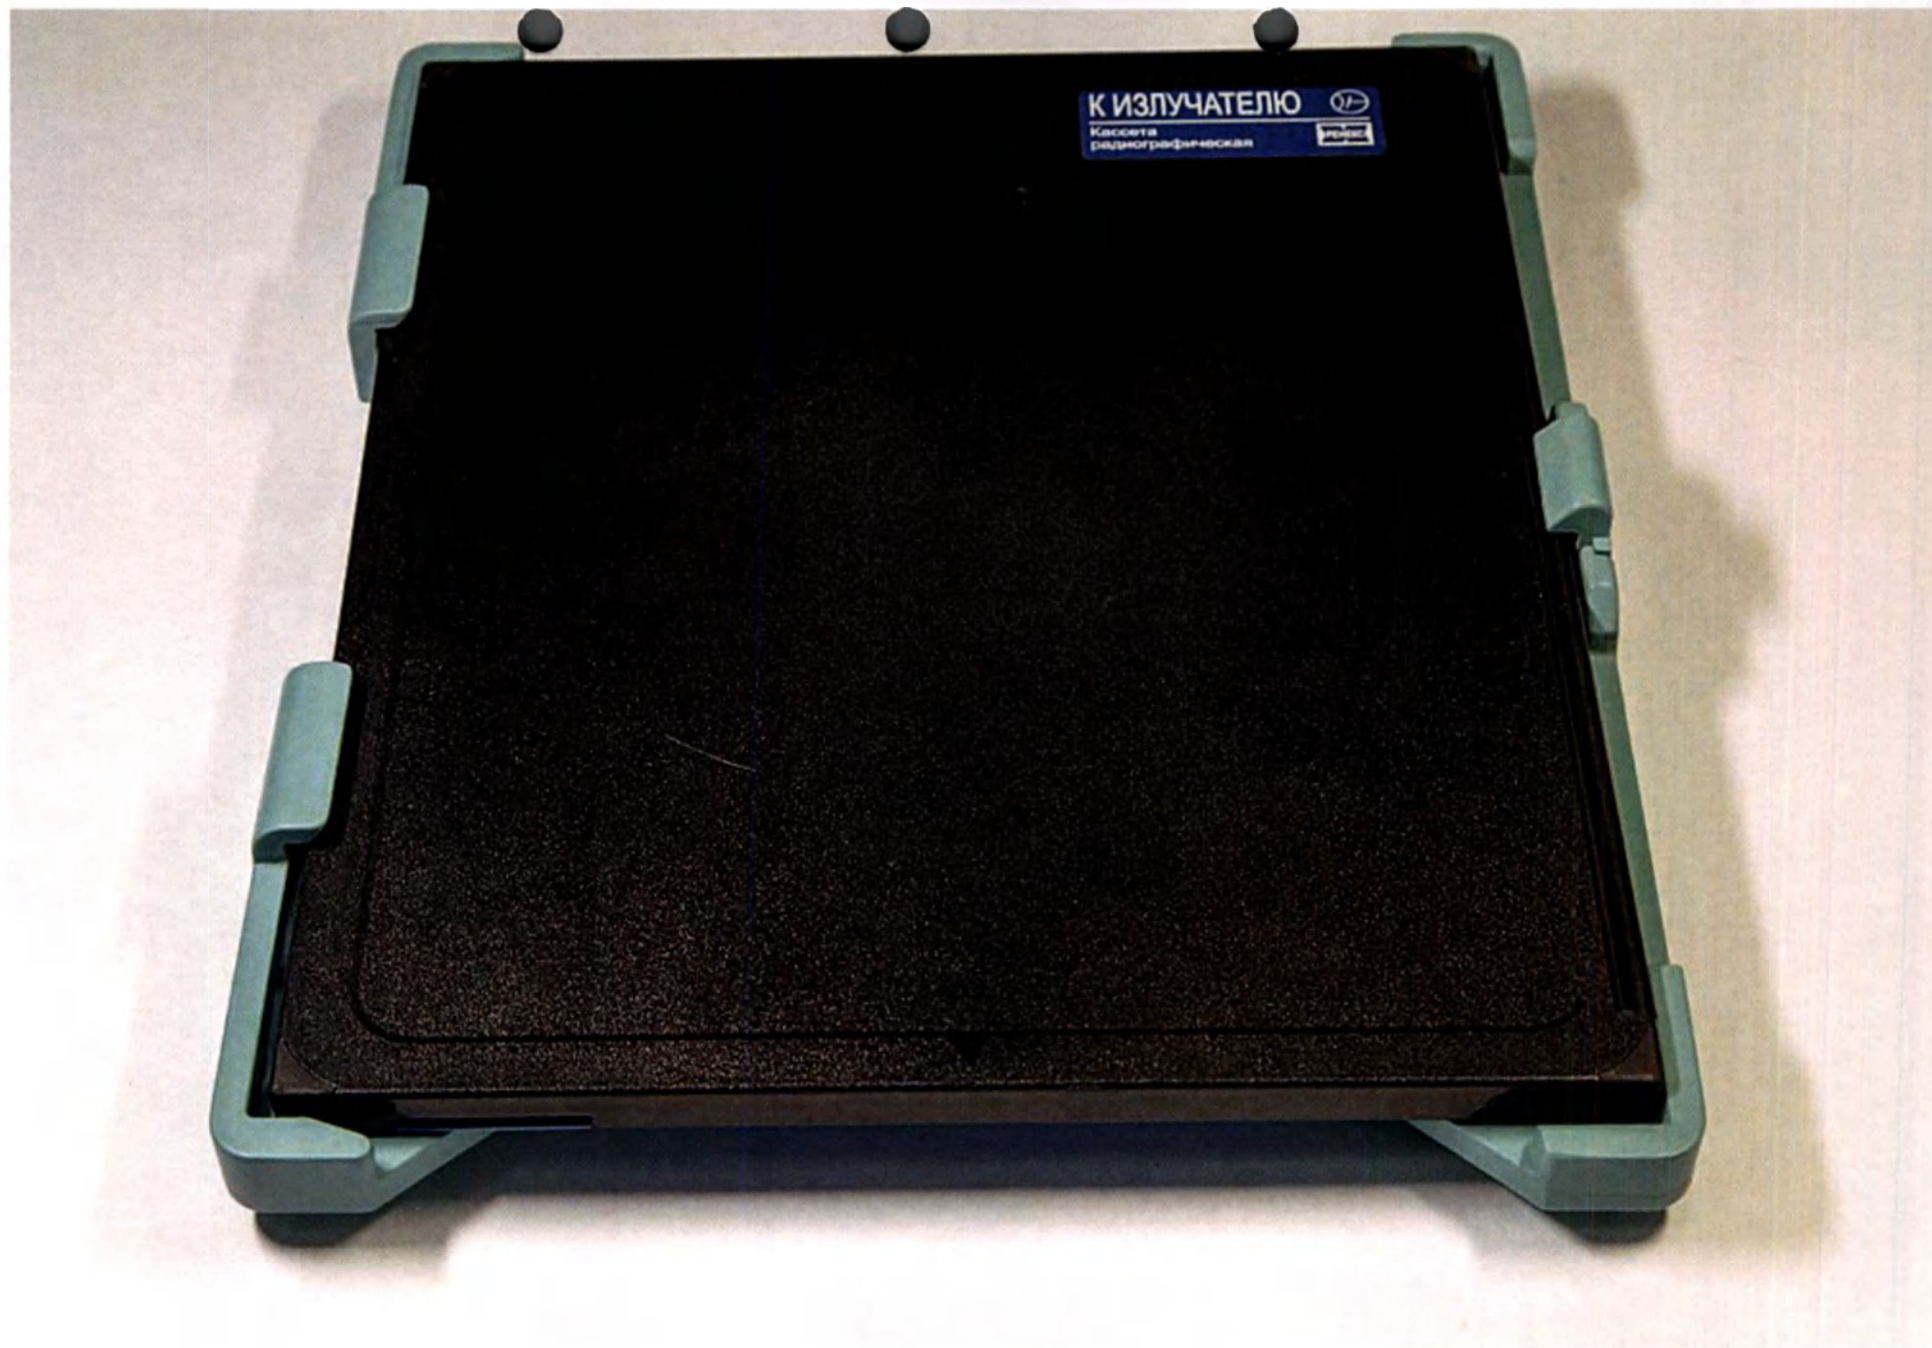

Фотография 34 – Кассетодержатель (кассета установлена)

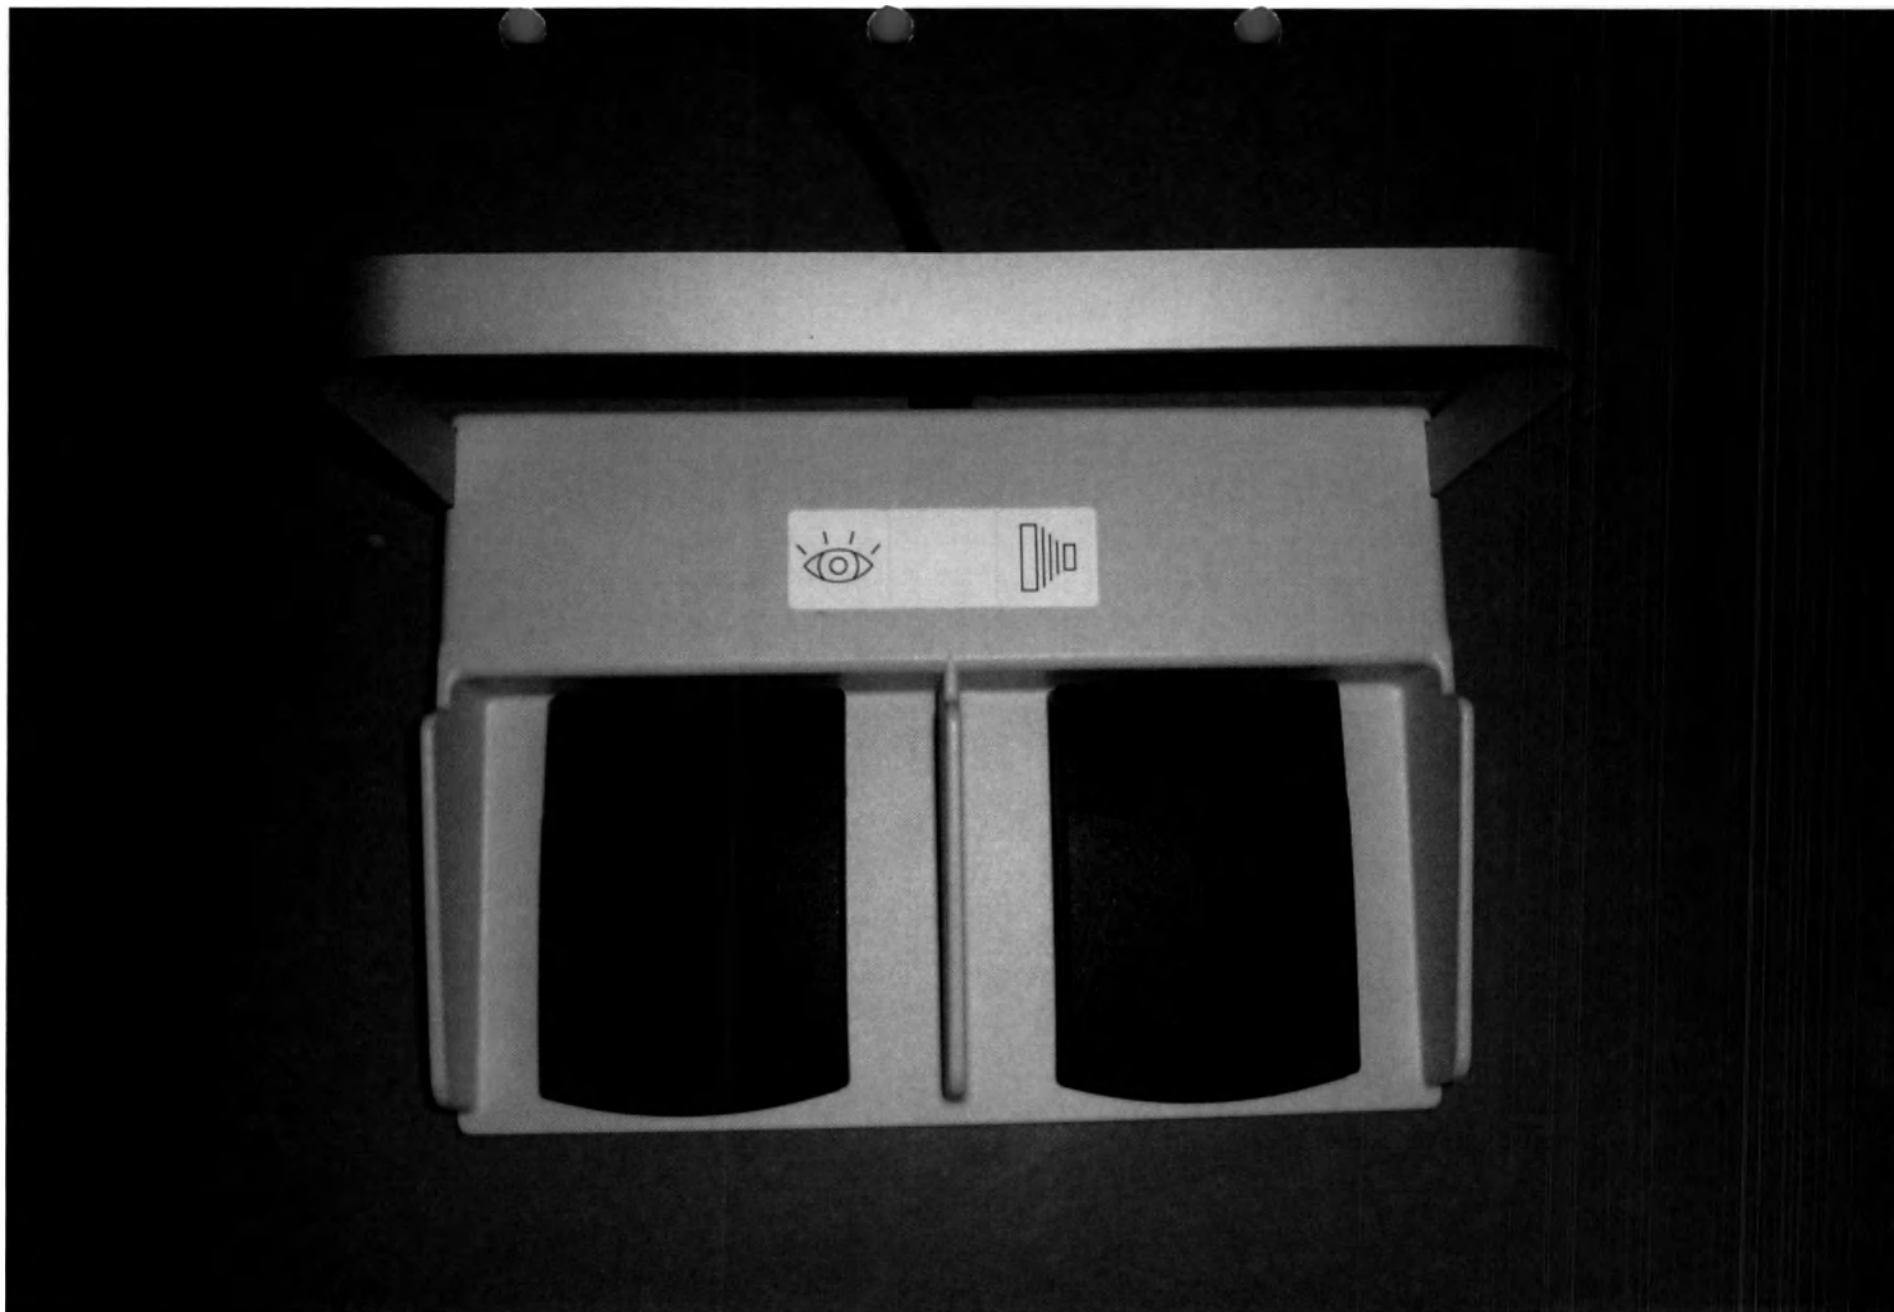

Фотография 35 – Педаль с кабелем




Фотография 36 – Индивидуальное средство защиты от рентгеновского излучения (образец)



Фотография 37 – Индивидуальное средство защиты от рентгеновского излучения (образец)



Фотография 38 – Индивидуальное средство защиты от рентгеновского излучения (образец)

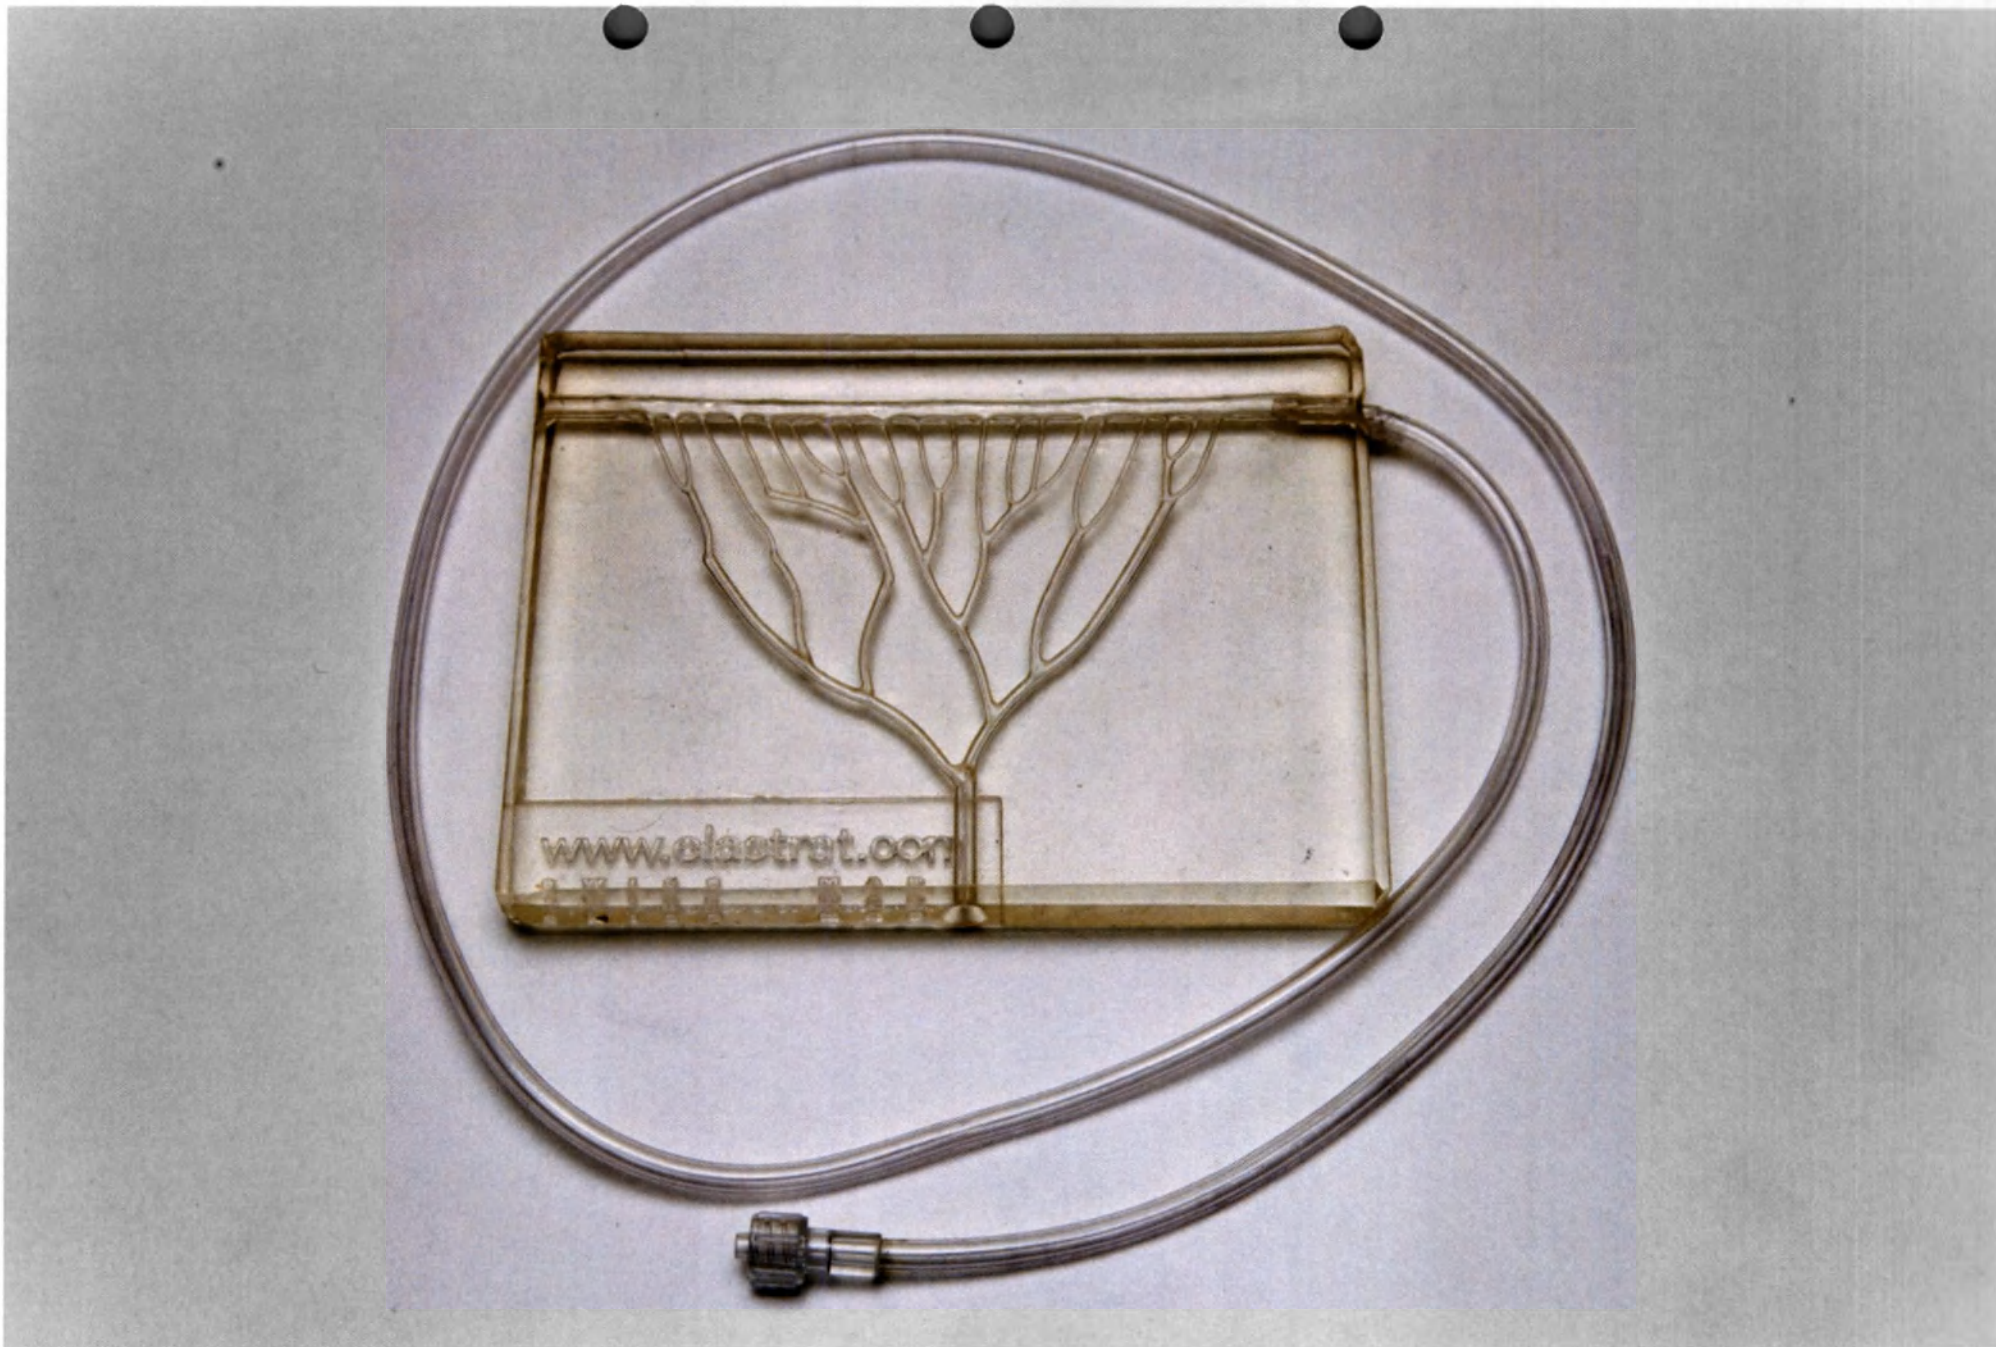

Фотография 39 – Фантом серии 101



Фотография 40 – Фантом серии ХА



Фотография 41 – Машина проявочная автоматическая, для листовых радиографических медицинских пленок серии Kodak



Фотография 42 – Машина проявочная автоматическая, для листовых радиографических медицинских пленок серии Мини-Мед



Фотография 43 – Устройство для печати медицинских изображений серии UP (вариант внешнего вида)



Фотография 44 – Рентгенозащитная дверь серии RTG



Система рентгенохирургическая передвижная СРТ № GP*****

МЕСТО № 1/X

Контракт №

Заказчик

Поставщик

Грузополучатель

Пункт назначения

БРУТТО *** Кг

НЕТТО *** Кг

*** х *** х *** CM

Грузоотправитель:

АО «НИПК «Электрон»,
197758, г. Санкт-Петербург, ВН ТЕР.
Г. Поселок Песочный, ул. Садовая, д. 88,
стр. 1, помещ. 8Н

ВНИМАНИЕ!

Вскрывать только в присутствии представителя поставщика



Фотография 45 – Упаковка. Маркировка упаковки

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 43
(Сорок три) ЛИСТ(ОВ)

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА
СЕРТИФИКАЦИЯ
ДЕНИСОВ О.А.
ПО ДОВЕРЕННОСТИ № 1260
г. Санкт-Петербург • 327012400

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
НИИПК
Электроника