

**Фотографические изображения медицинского изделия,
включая проект маркировки медицинского изделия
«Анализатор иммунохемилюминесцентный PATHFAST с
принадлежностями»,
производства «ЛСИ Медиенс Корпорейшн»
(LSI Medience Corporation), Япония**

Раздел 1. Перечень принадлежностей.

Принадлежности к анализатору иммунохемилюминесцентному PATHFAST:

1. Сетевой кабель (Power cable) - 2 шт.
2. Кассета для реагентных картриджей (Reagent Cartridge Rack2) - 1 шт.
3. Контейнер для отработанных наконечников PATHFAST (PATHFAST Waste Box) - 1 шт.
4. Термобумага для встроенного принтера PATHFAST (PATHFAST Roll Paper) - 1 шт.
5. Предохранитель (Fuse) - 1 шт.
6. Стилус (Stylus Pen) - 1 шт.
7. Ручной сканер штрих-кодов (Hand Held Barcode Reader) - 1 шт.
8. Краткое руководство по эксплуатации ручного сканера штрих-кодов (Quick Reference Guide) - 1 шт.
9. Руководство по установке анализатора PATHFAST (PATHFAST Installation Procedure) - 1 шт.
10. Руководство по эксплуатации анализатора PATHFAST с компакт-диском (PATHFAST Operator's Manual with CD) - 1 комп.
11. Гарантийный сертификат (Guarantee Certificate) - 1 шт.
12. Контрольный список PATHFAST (PATHFAST Check List) - 1 шт.

Раздел 2. Фото анализатора и принадлежностей.

Фото 2-1. Анализатор. Вид спереди.

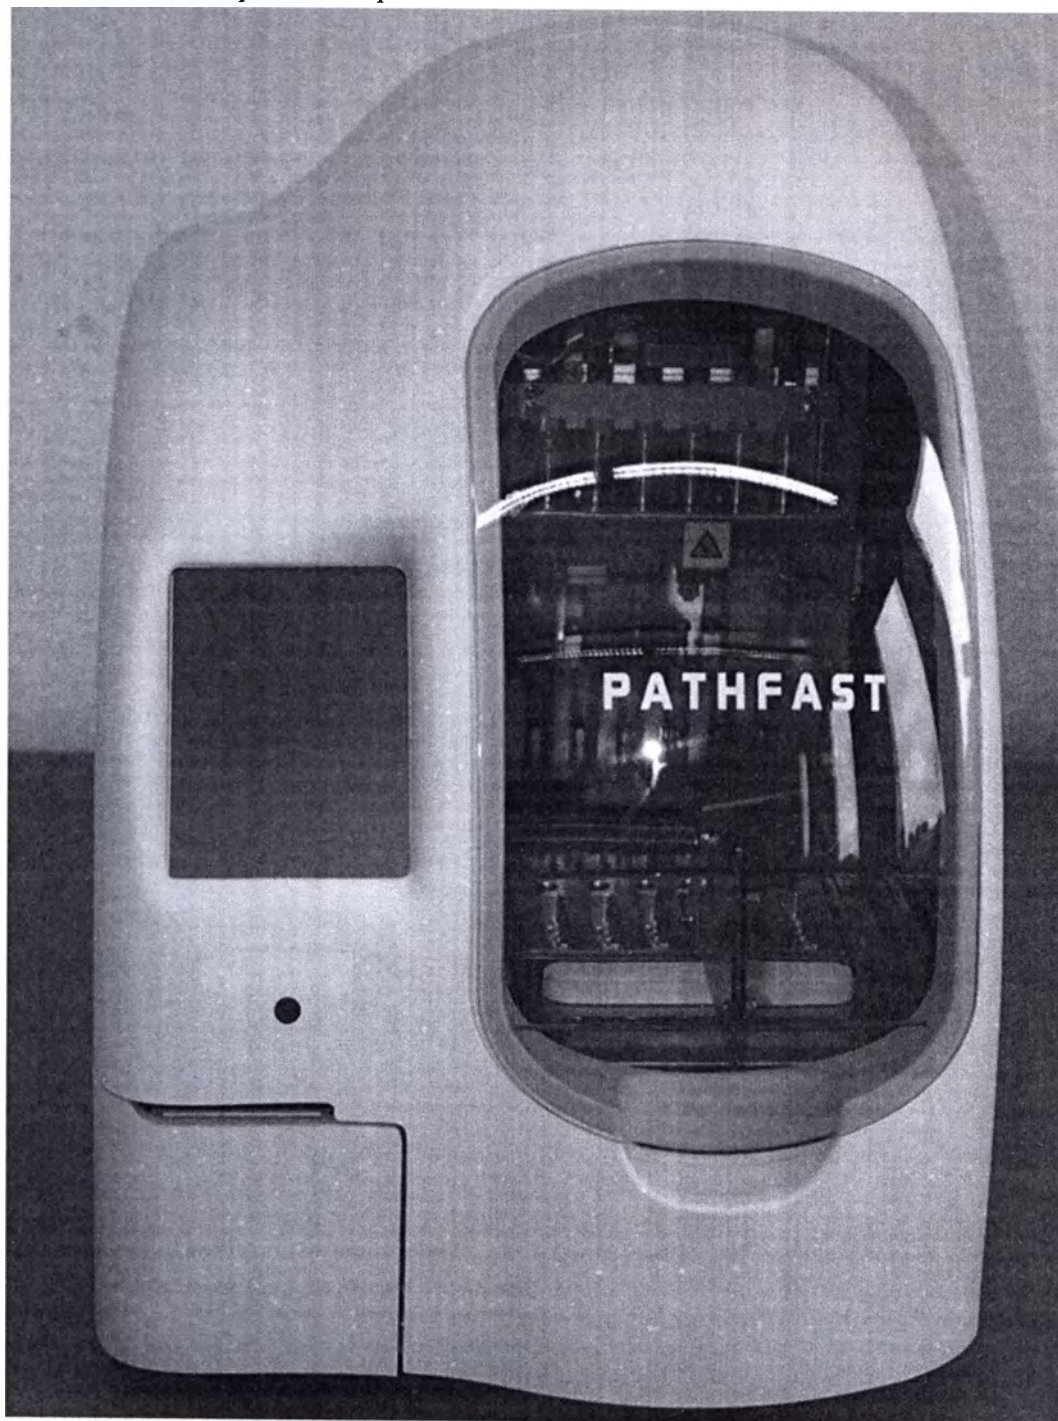


Фото 2-2. Анализатор. Вид сзади.

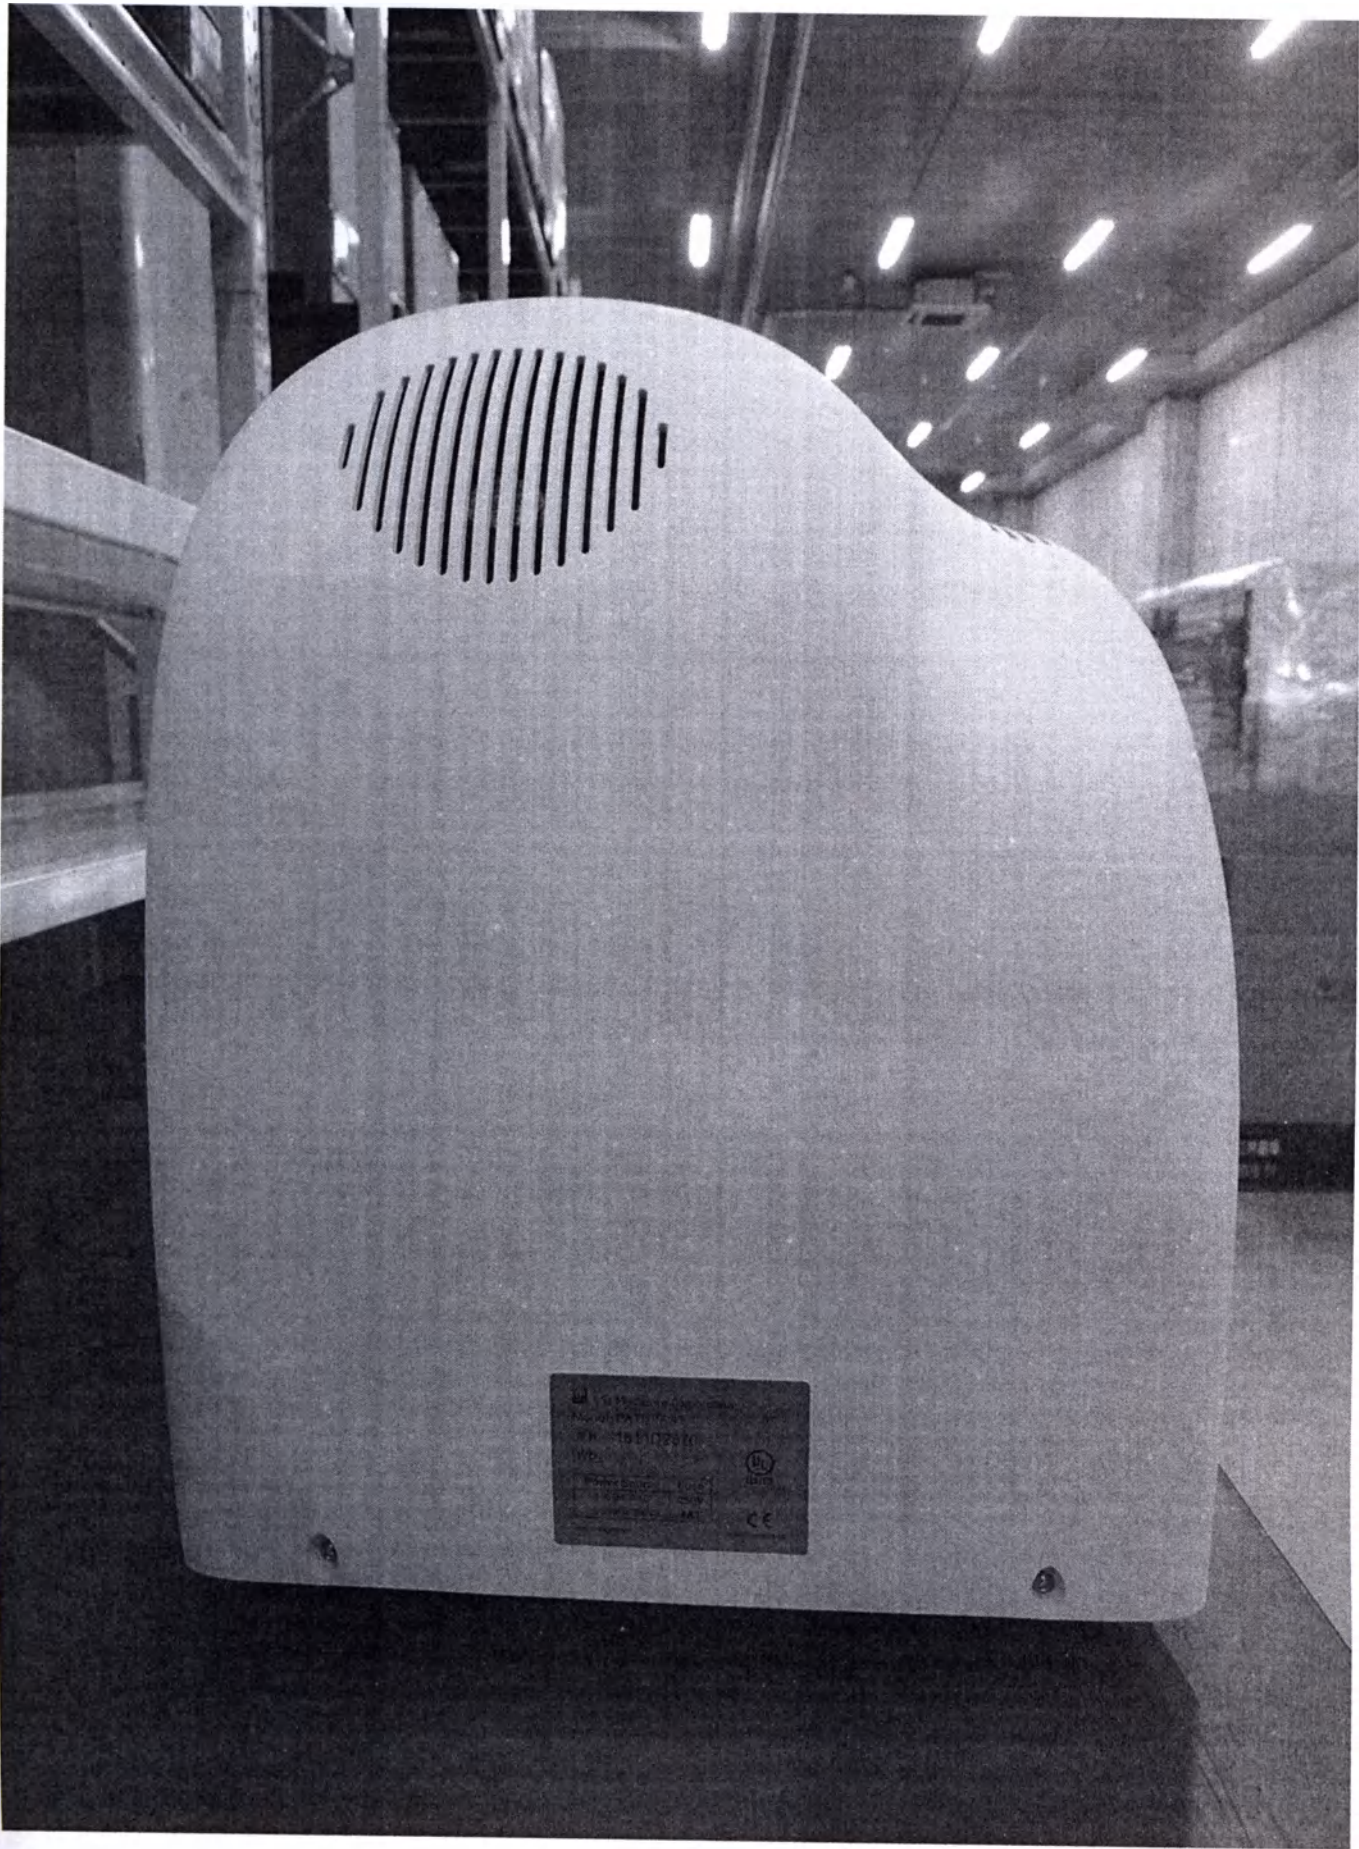


Фото 2-3 и 2-4. Анализатор. Вид сбоку.

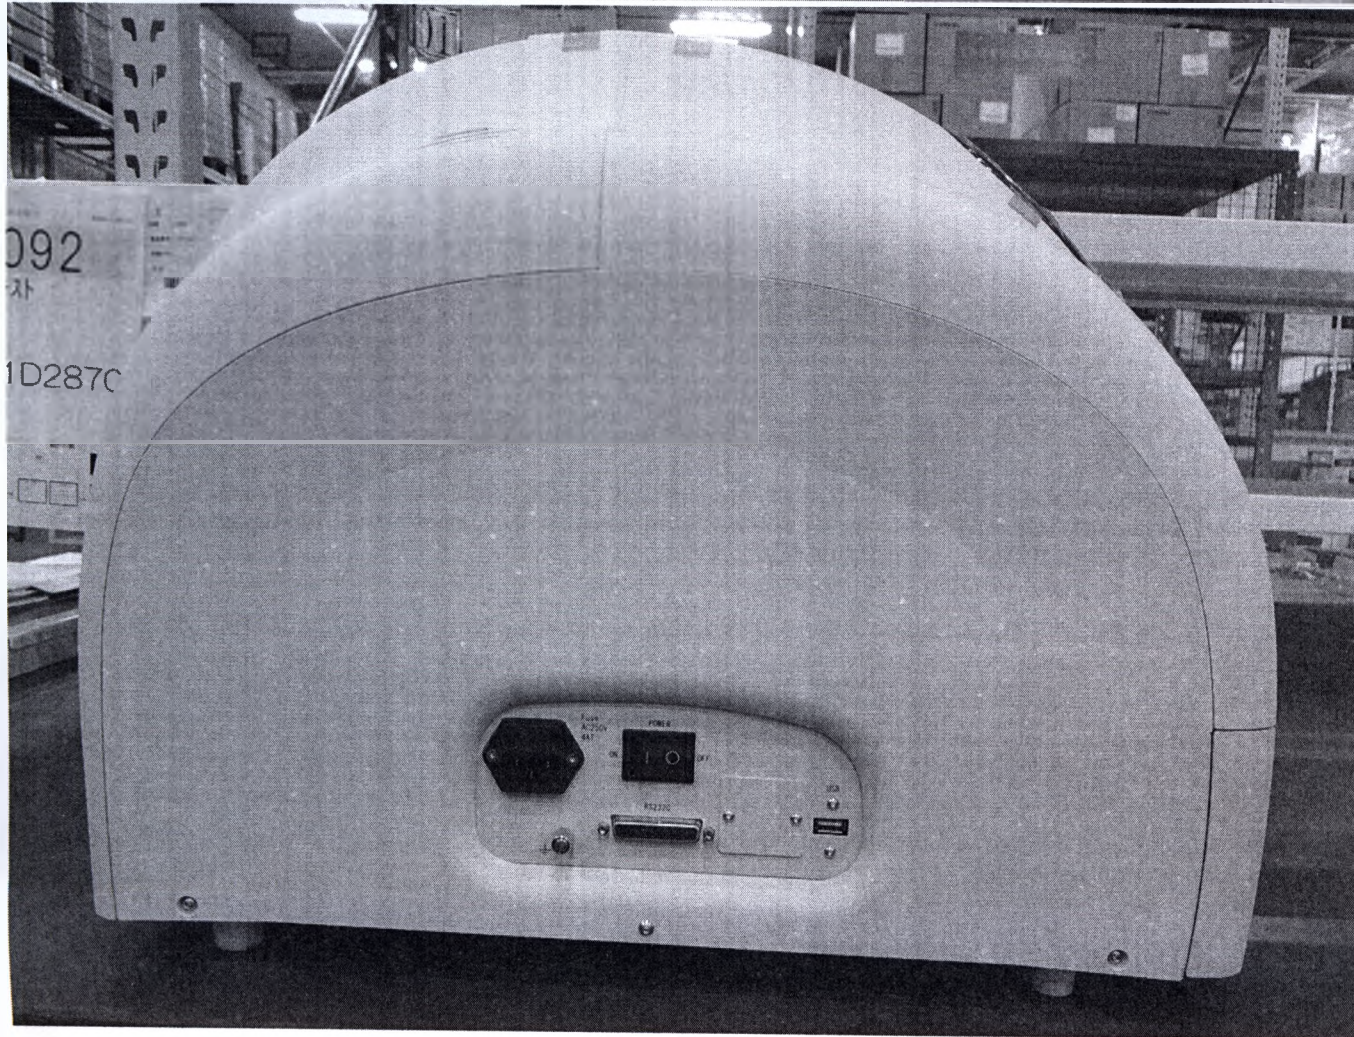
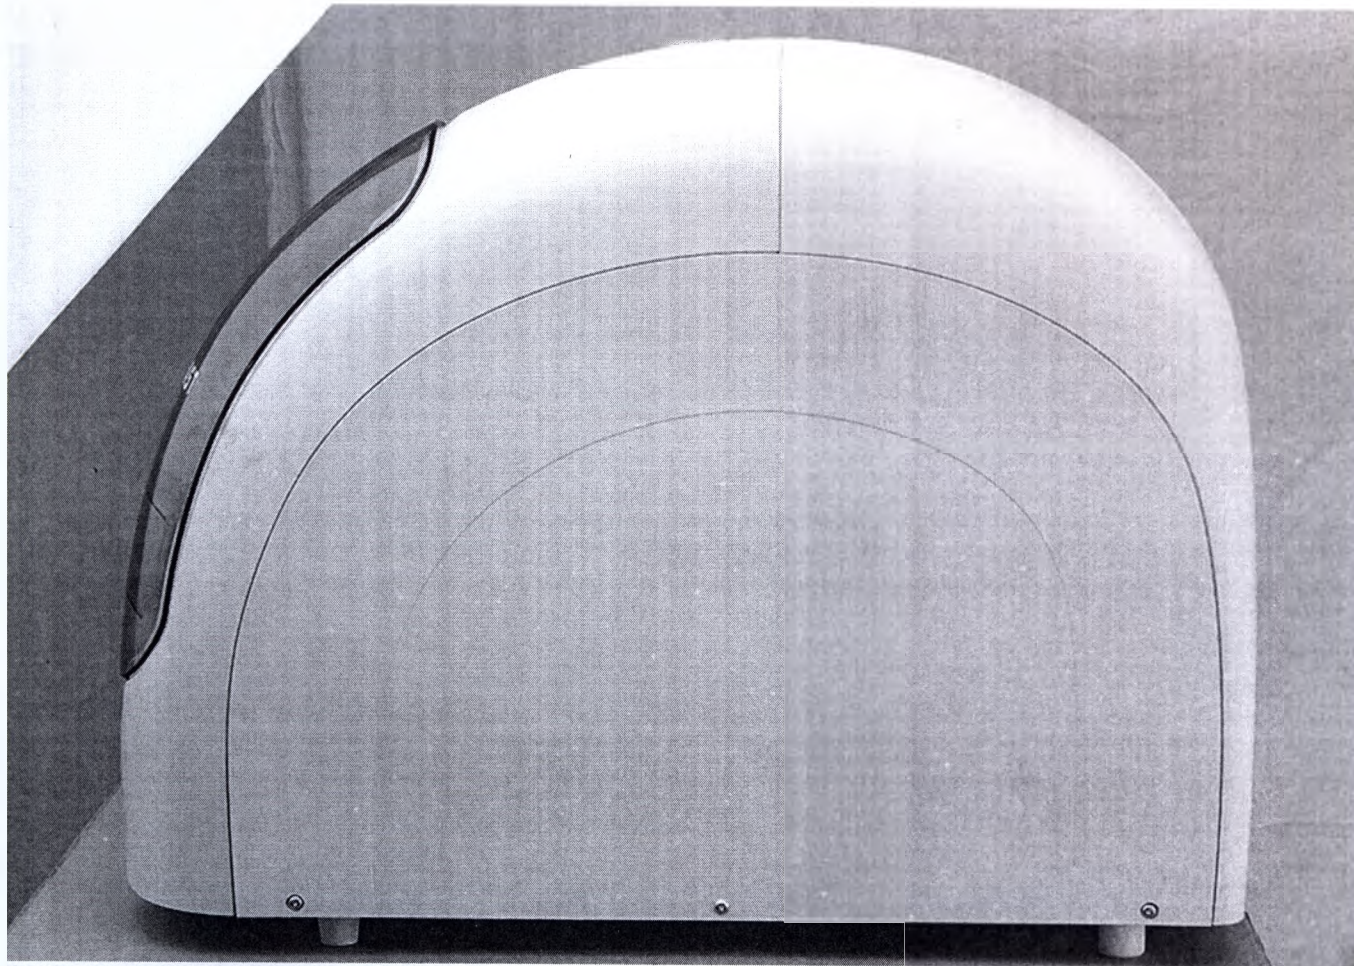


Фото 2-5. Коробка с принадлежностями.



Фото 2-6 и 2-7. Принадлежности к анализатору иммунохемилюминесцентному
PATHFAST. Сетевой кабель (Power cable) - 2 шт.


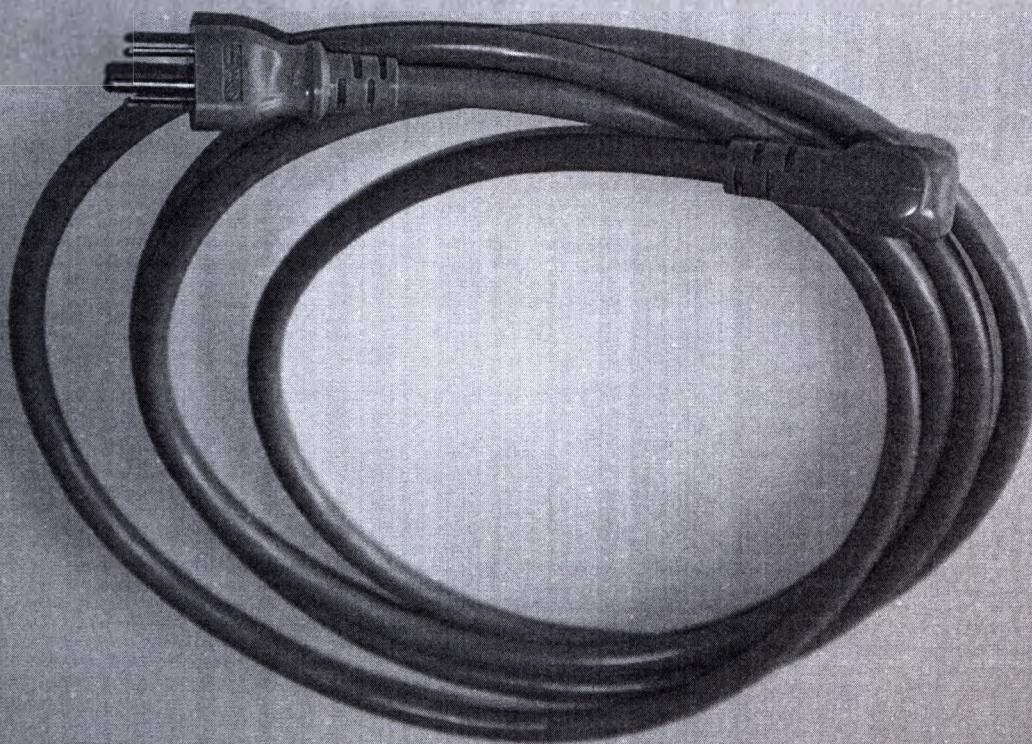


Фото 2-8 и 2-9. Принадлежности к анализатору иммунохемилюминесцентному PATHFAST.

Кассета для реagentных картриджей (Reagent Cartridge Rack2) - 1 шт.

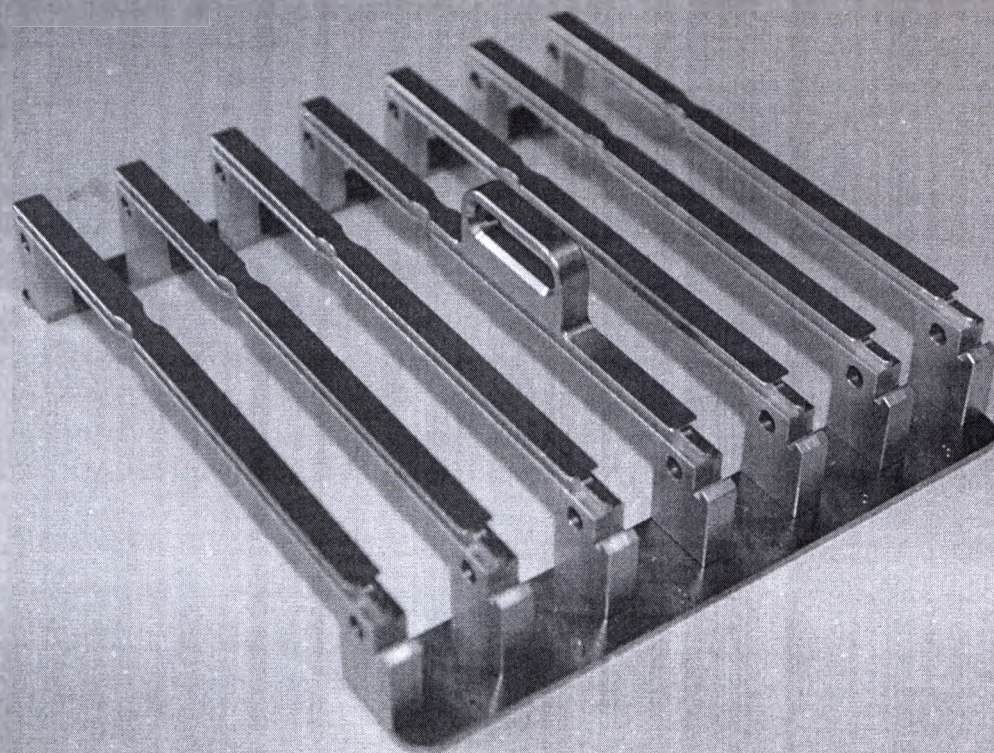

Контейнер для отработанных наконечников PATHFAST (PATHFAST Waste Box) - 1 шт.


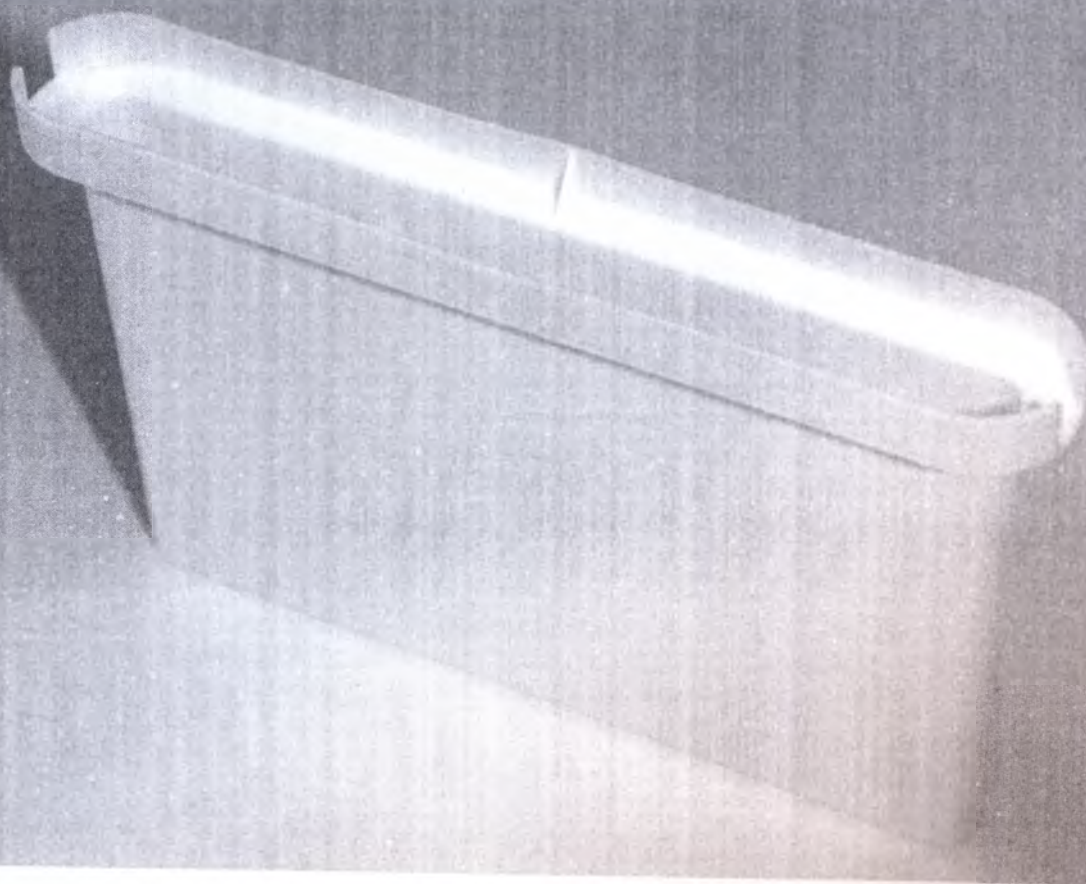


Фото 2-10 и 2-11. Принадлежности к анализатору иммунохемилюминесцентному PATHFAST.

Термобумага для встроенного принтера PATHFAST (PATHFAST Roll Paper) - 1 шт.

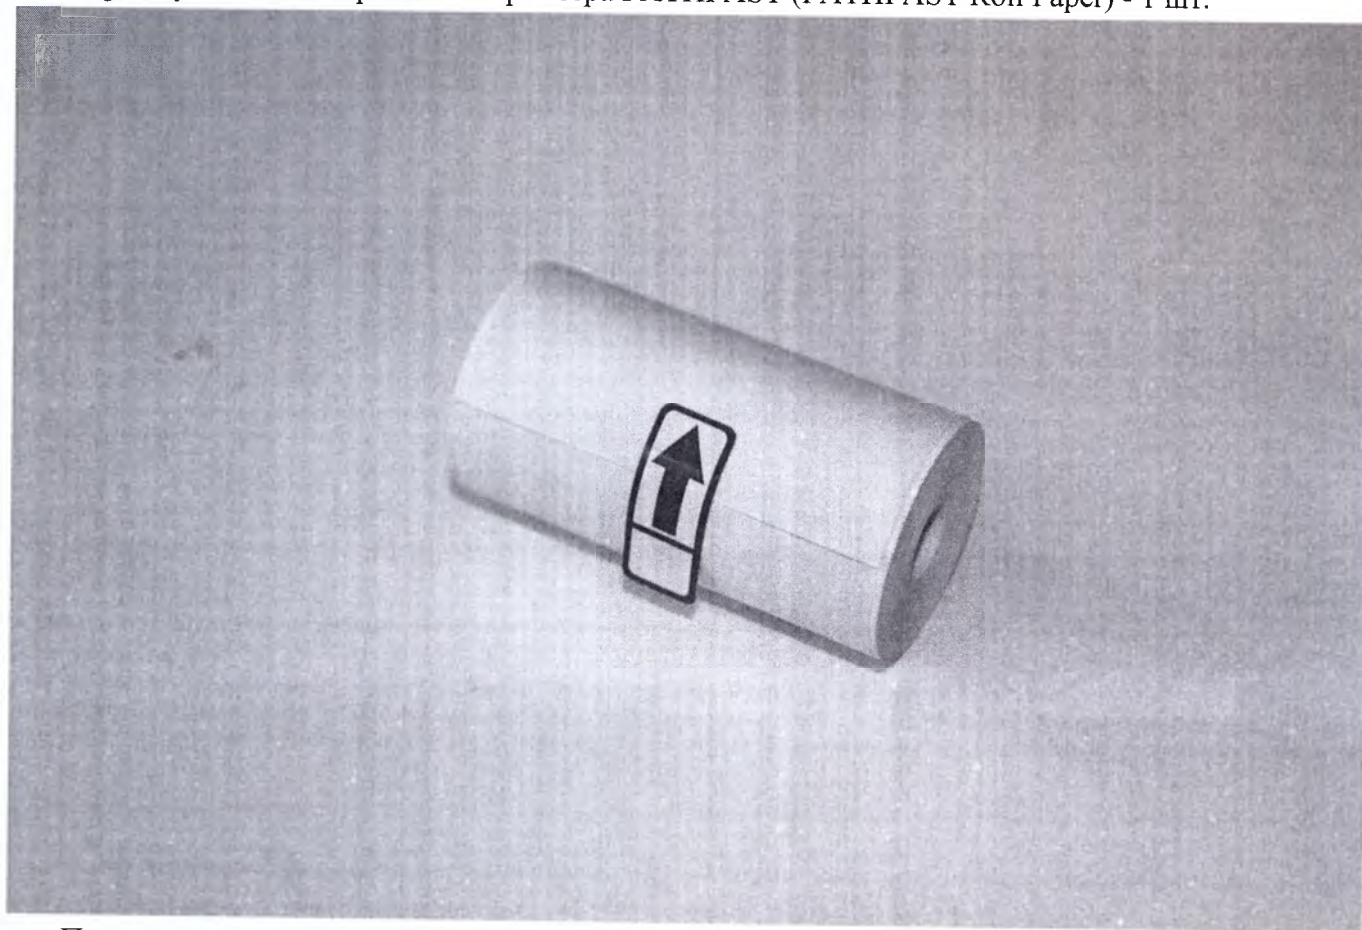

Предохранитель (Fuse) - 1 шт.



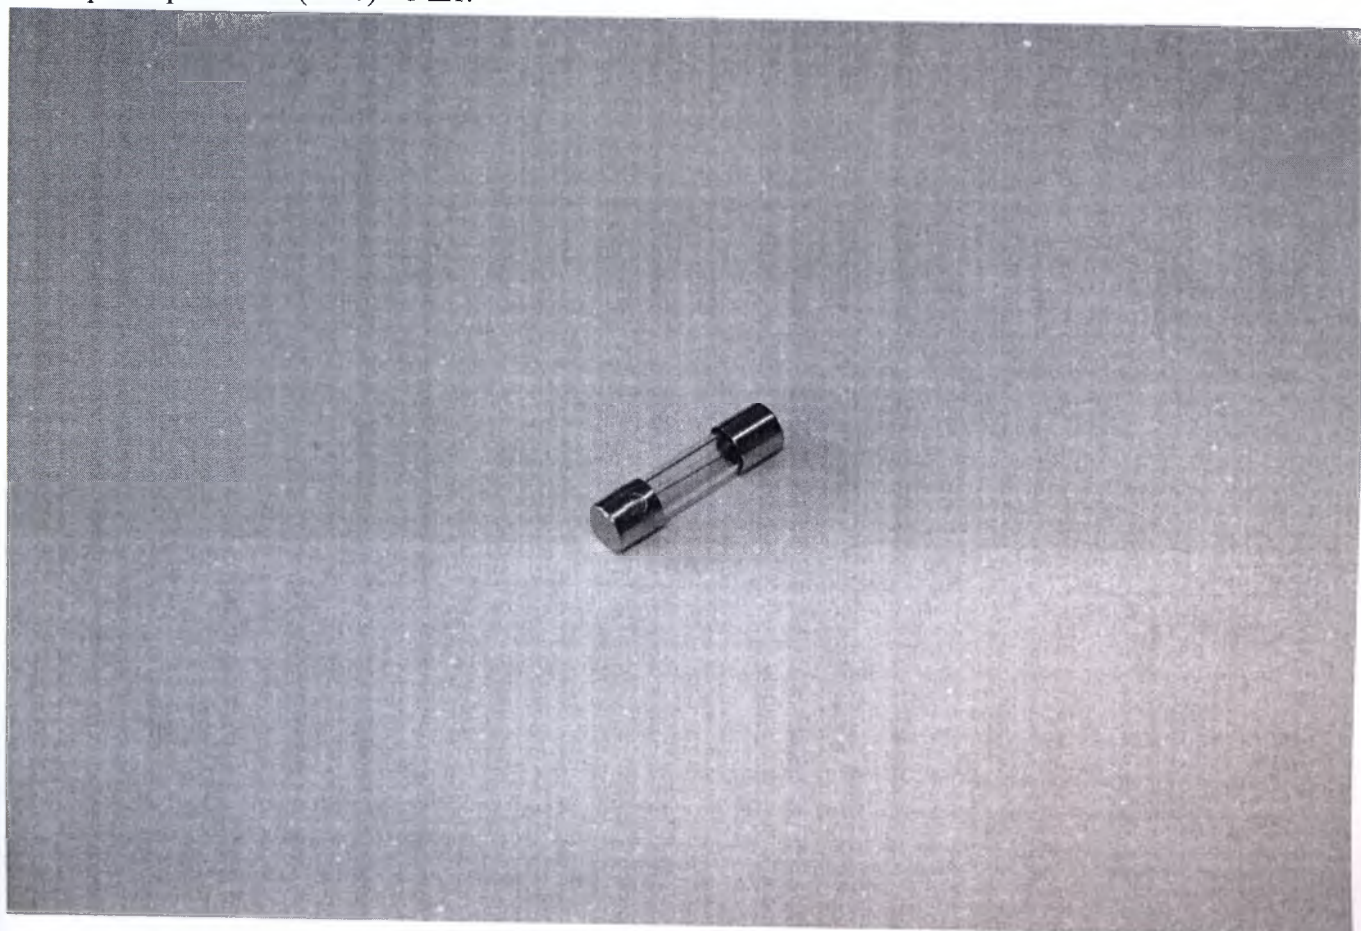


Фото 2-12 и 2-13. Принадлежности к анализатору иммунохемилюминесцентному PATHFAST.

Стилус (Stylus Pen) - 1 шт.

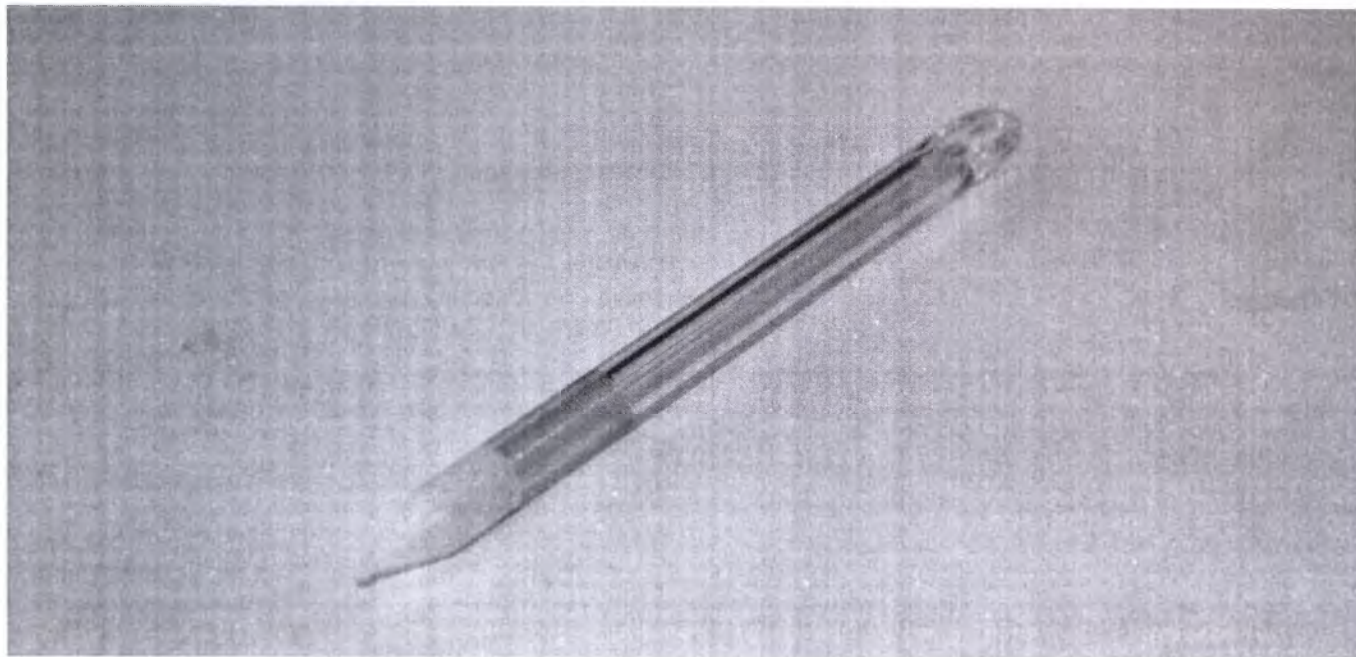

Ручной сканер штрих-кодов (Hand Held Barcode Reader) - 1 шт.

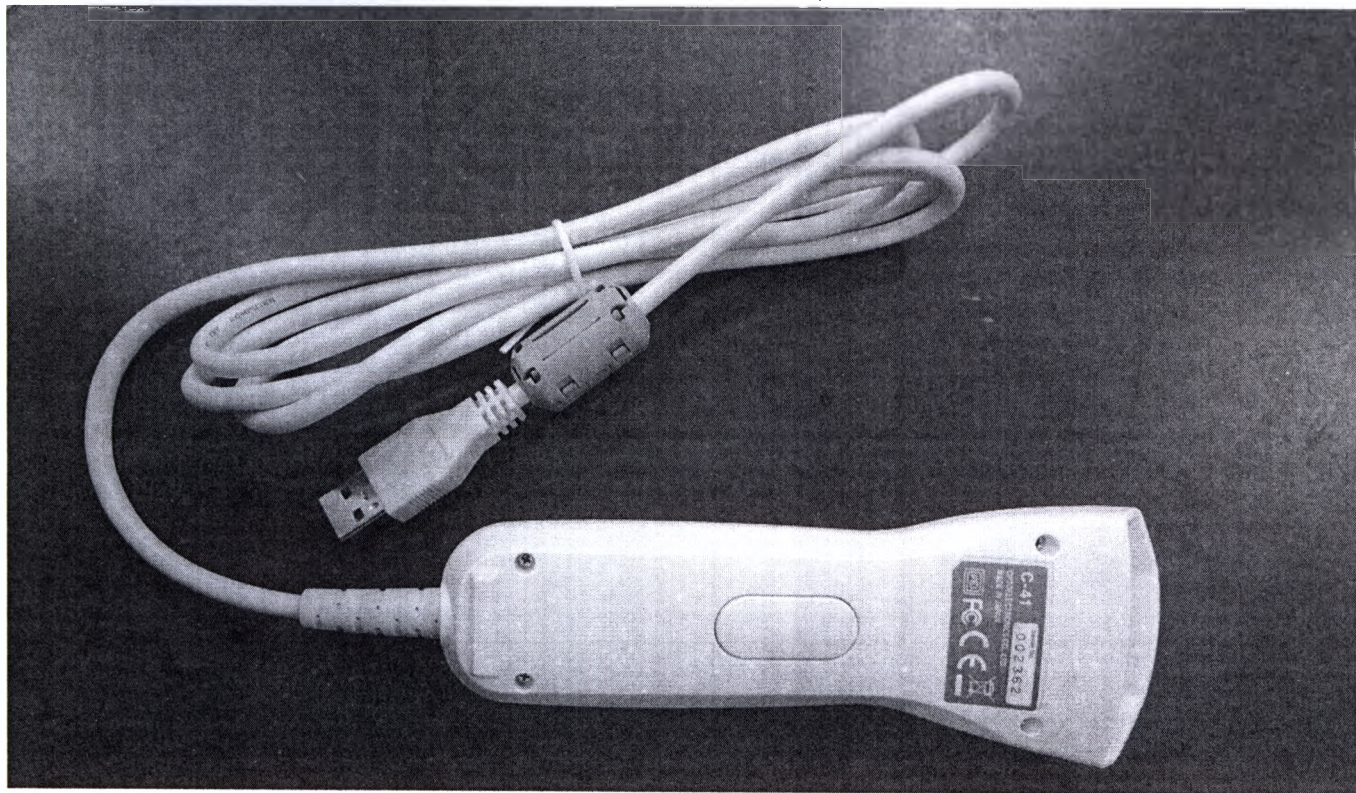

Проект маркировки для медицинского изделия

Анализатор иммунохемилюминесцентный PATHFAST с принадлежностями

Кат. № 300929

Модель: PATHFAST

Использовать до:

Хр. при темп.: 4-40°C

Напряжение питания: 100 – 240 В переменного тока 50/60 Гц

Рег. уд: ФСЗ 2011/10811

Производитель: «ЛСИ Медиенс Корпорейшн», Япония

Уполномоченный представитель в РФ: АО «ДИАКОН»

РФ, 142290, Московская обл., г. Пущино, ул. Грузовая, д. 1а

Тел.: +7 495-980-63-38, +7 495-980-63-39, Факс: +7 495-980-66-79

sale@diakonlab.ru



Сетевой кабель (Power cable)

Кат. №

Использовать до:

Хр. при темп.: 4-40°C

Рег. уд: ФСЗ 2011/10811

Производитель: «ЛСИ Медиенс Корпорейшн», Япония

Уполномоченный представитель в РФ: АО «ДИАКОН»

РФ, 142290, Московская обл., г. Пущино, ул. Грузовая, д. 1а

Тел.: +7 495-980-63-38, +7 495-980-63-39, Факс: +7 495-980-66-79

sale@diakonlab.ru

Кассета для реагентных картриджей (Reagent Cartridge Rack2)

Кат. №

Использовать до:

Хр. при темп.: 4-40°C

Рег. уд: ФСЗ 2011/10811

Производитель: «ЛСИ Медиенс Корпорейшн», Япония

Уполномоченный представитель в РФ: АО «ДИАКОН»

РФ, 142290, Московская обл., г. Пущино, ул. Грузовая, д. 1а

Тел.: +7 495-980-63-38, +7 495-980-63-39, Факс: +7 495-980-66-79

sale@diakonlab.ru

Контейнер для отработанных наконечников PATHFAST (PATHFAST Waste Box)

Кат. №

Использовать до:

Хр. при темп.: 4-40°C

Рег. уд: ФСЗ 2011/10811

Производитель: «ЛСИ Медиенс Корпорейшн», Япония

Уполномоченный представитель в РФ: АО «ДИАКОН»

РФ, 142290, Московская обл., г. Пущино, ул. Грузовая, д. 1а

Тел.: +7 495-980-63-38, +7 495-980-63-39, Факс: +7 495-980-66-79

sale@diakonlab.ru

Термобумага для встроенного принтера PATHFAST (PATHFAST Roll Paper)

Кат. №

Использовать до:

Хр. при темп.: 4-40°C

Рег. уд: ФСЗ 2011/10811

Производитель: «ЛСИ Медиенс Корпорейшн», Япония

Уполномоченный представитель в РФ: АО «ДИАКОН»

РФ, 142290, Московская обл., г. Пущино, ул. Грузовая, д. 1а

Тел.: +7 495-980-63-38, +7 495-980-63-39, Факс: +7 495-980-66-79

sale@diakonlab.ru

Предохранитель (Fuse)

Кат. №

Использовать до:

Хр. при темп.: 4-40°C

Рег. уд: ФСЗ 2011/10811

Производитель: «ЛСИ Медиенс Корпорейшн», Япония

Уполномоченный представитель в РФ: АО «ДИАКОН»

РФ, 142290, Московская обл., г. Пущино, ул. Грузовая, д. 1а

Тел.: +7 495-980-63-38, +7 495-980-63-39, Факс: +7 495-980-66-79

sale@diakonlab.ru

Стилус (Stylus Pen)

Кат. №

Использовать до:

Хр. при темп.: 4-40°C

Рег. уд: ФСЗ 2011/10811

Производитель: «ЛСИ Медиенс Корпорейшн», Япония

Уполномоченный представитель в РФ: АО «ДИАКОН»

РФ, 142290, Московская обл., г. Пущино, ул. Грузовая, д. 1а

Тел.: +7 495-980-63-38, +7 495-980-63-39, Факс: +7 495-980-66-79

sale@diakonlab.ru

Ручной сканер штрих-кодов (Hand Held Barcode Reader)

Кат. №

Использовать до:

Хр. при темп.: 4-40°C

Рег. уд: ФСЗ 2011/10811

Производитель: «ЛСИ Медиенс Корпорейшн», Япония

Уполномоченный представитель в РФ: АО «ДИАКОН»

РФ, 142290, Московская обл., г. Пущино, ул. Грузовая, д. 1а

Тел.: +7 495-980-63-38, +7 495-980-63-39, Факс: +7 495-980-66-79

sale@diakonlab.ru

Краткое руководство по эксплуатации ручного сканера штрих-кодов (Quick Reference Guide)

Кат. №

Использовать до:

Хр. при темп.: 4-40°C

Рег. уд: ФСЗ 2011/10811

Производитель: «ЛСИ Медиенс Корпорейшн», Япония

Уполномоченный представитель в РФ: АО «ДИАКОН»

РФ, 142290, Московская обл., г. Пущино, ул. Грузовая, д. 1а

Тел.: +7 495-980-63-38, +7 495-980-63-39, Факс: +7 495-980-66-79

sale@diakonlab.ru

Руководство по установке анализатора PATHFAST (PATHFAST Installation Procedure)

Кат. №

Использовать до:

Хр. при темп.: 4-40°C

Рег. уд: ФСЗ 2011/10811

Производитель: «ЛСИ Медиенс Корпорейшн», Япония

Уполномоченный представитель в РФ: АО «ДИАКОН»

РФ, 142290, Московская обл., г. Пущино, ул. Грузовая, д. 1а

Тел.: +7 495-980-63-38, +7 495-980-63-39, Факс: +7 495-980-66-79

sale@diakonlab.ru

Руководство по эксплуатации анализатора PATHFAST с компакт-диском (PATHFAST Operator's Manual with CD)

Кат. №

Использовать до:

Хр. при темп.: 4-40°C

Рег. уд: ФСЗ 2011/10811

Производитель: «ЛСИ Медиенс Корпорейшн», Япония

Уполномоченный представитель в РФ: АО «ДИАКОН»

РФ, 142290, Московская обл., г. Пущино, ул. Грузовая, д. 1а

Тел.: +7 495-980-63-38, +7 495-980-63-39, Факс: +7 495-980-66-79

sale@diakonlab.ru

Гарантийный сертификат (Guarantee Certificate)

Кат. №

Использовать до:

Хр. при темп.: 4-40°C

Рег. уд: ФСЗ 2011/10811

Производитель: «ЛСИ Медиенс Корпорейшн», Япония

Уполномоченный представитель в РФ: АО «ДИАКОН»

РФ, 142290, Московская обл., г. Пущино, ул. Грузовая, д. 1а

Тел.: +7 495-980-63-38, +7 495-980-63-39, Факс: +7 495-980-66-79

sale@diakonlab.ru

Контрольный список PATHFAST (PATHFAST Check List)

Кат. №

Использовать до:

Хр. при темп.: 4-40°C

Рег. уд: ФСЗ 2011/10811

Производитель: «ЛСИ Медиенс Корпорейшн», Япония

Уполномоченный представитель в РФ: АО «ДИАКОН»

РФ, 142290, Московская обл., г. Пущино, ул. Грузовая, д. 1а

Тел.: +7 495-980-63-38, +7 495-980-63-39, Факс: +7 495-980-66-79

sale@diakonlab.ru

Генеральный директор
АО «ДИАКОН»



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "И. Е. Карпова".

И. Е. Карпова

14 листов