

Фотографические изображения медицинского изделия

**Комплекс рентгенодиагностический
телеуправляемый КРТ-«МАКСИМА»
по ТУ 9442-028-11150760-2008**

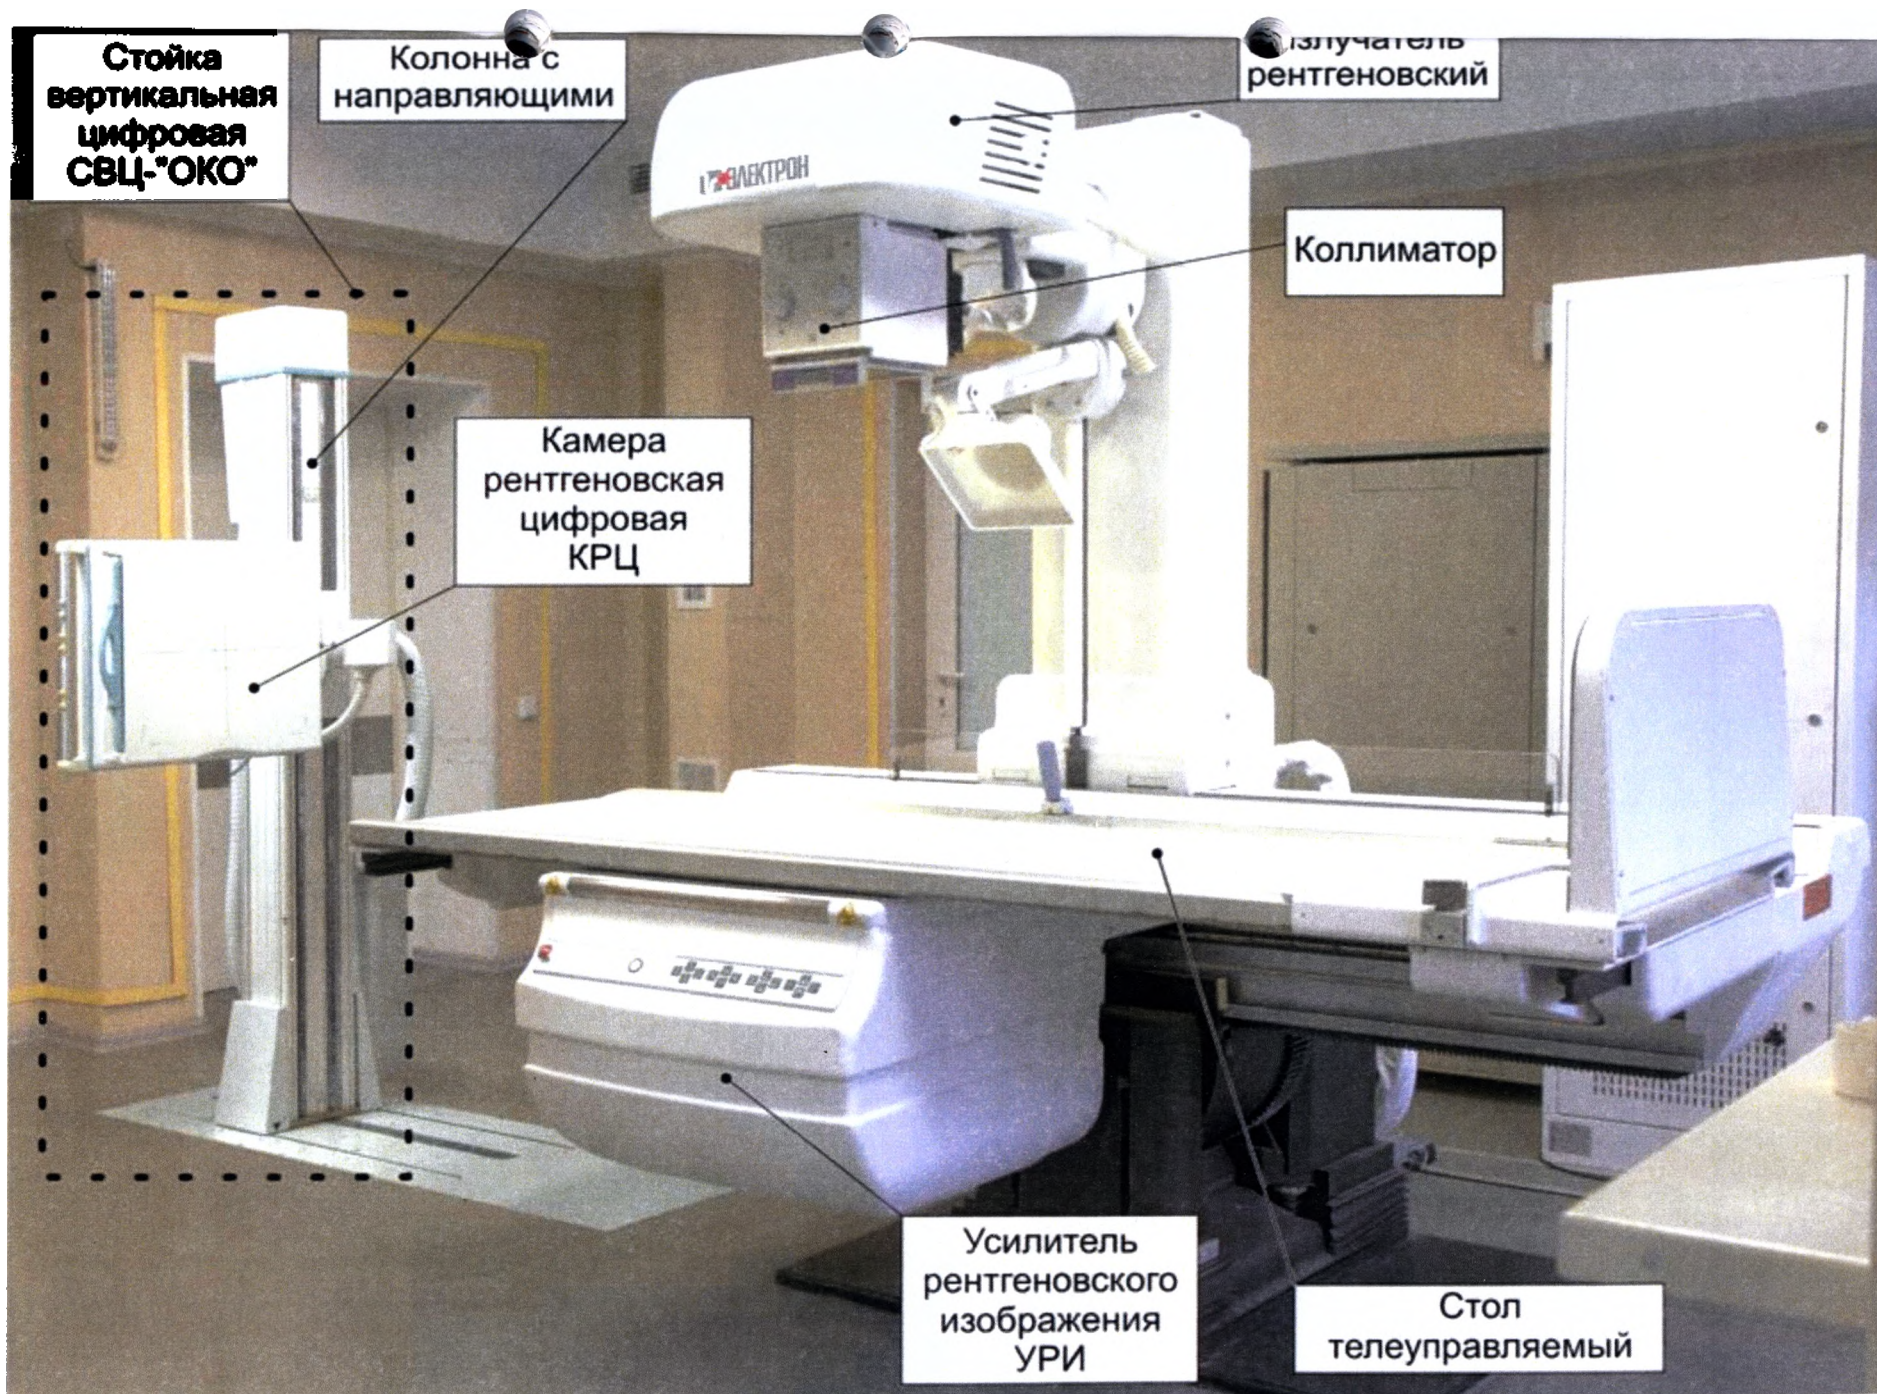


Рисунок 1 – Комплекс рентгенодиагностический телеуправляемый КРТ, исполнение 1 КРТ-«МАКСИМА»

ЭЛЕКТРОН

Комплекс
рентгенодиагностический
телеуправляемый КРТ-
"МАКСИМА"

ОБОЗНАЧЕНИЕ

KRT-00-0000-21.3.220813
(KRT- 000)

ТУ

9442-028-11150760-2008

Серийный номер

GP0005796

Дата изготовления

2023-06

Изготовитель

АО "НИПК "ЭЛЕКТРОН"



3N~380 В, 50 Гц, 70 кВА



NP-20-0001

Фотография 2 – КРТ-МАКСИМА. Образец внешнего вида маркировки

ЭЛЕКТРОН**Штатив****Серийный номер**

NN0004113

Дата изготовления

2023-06

Обозначение

KRT-00-4000 (KRT- 020)

Серийный номер МИ

GP0005796

Изготовитель

АО "НИПК "ЭЛЕКТРОН"




~220 В, 50 Гц, 16 А




NP-20-0002-01

Фотография 3 – Штатив. Образец внешнего вида варианта маркировки

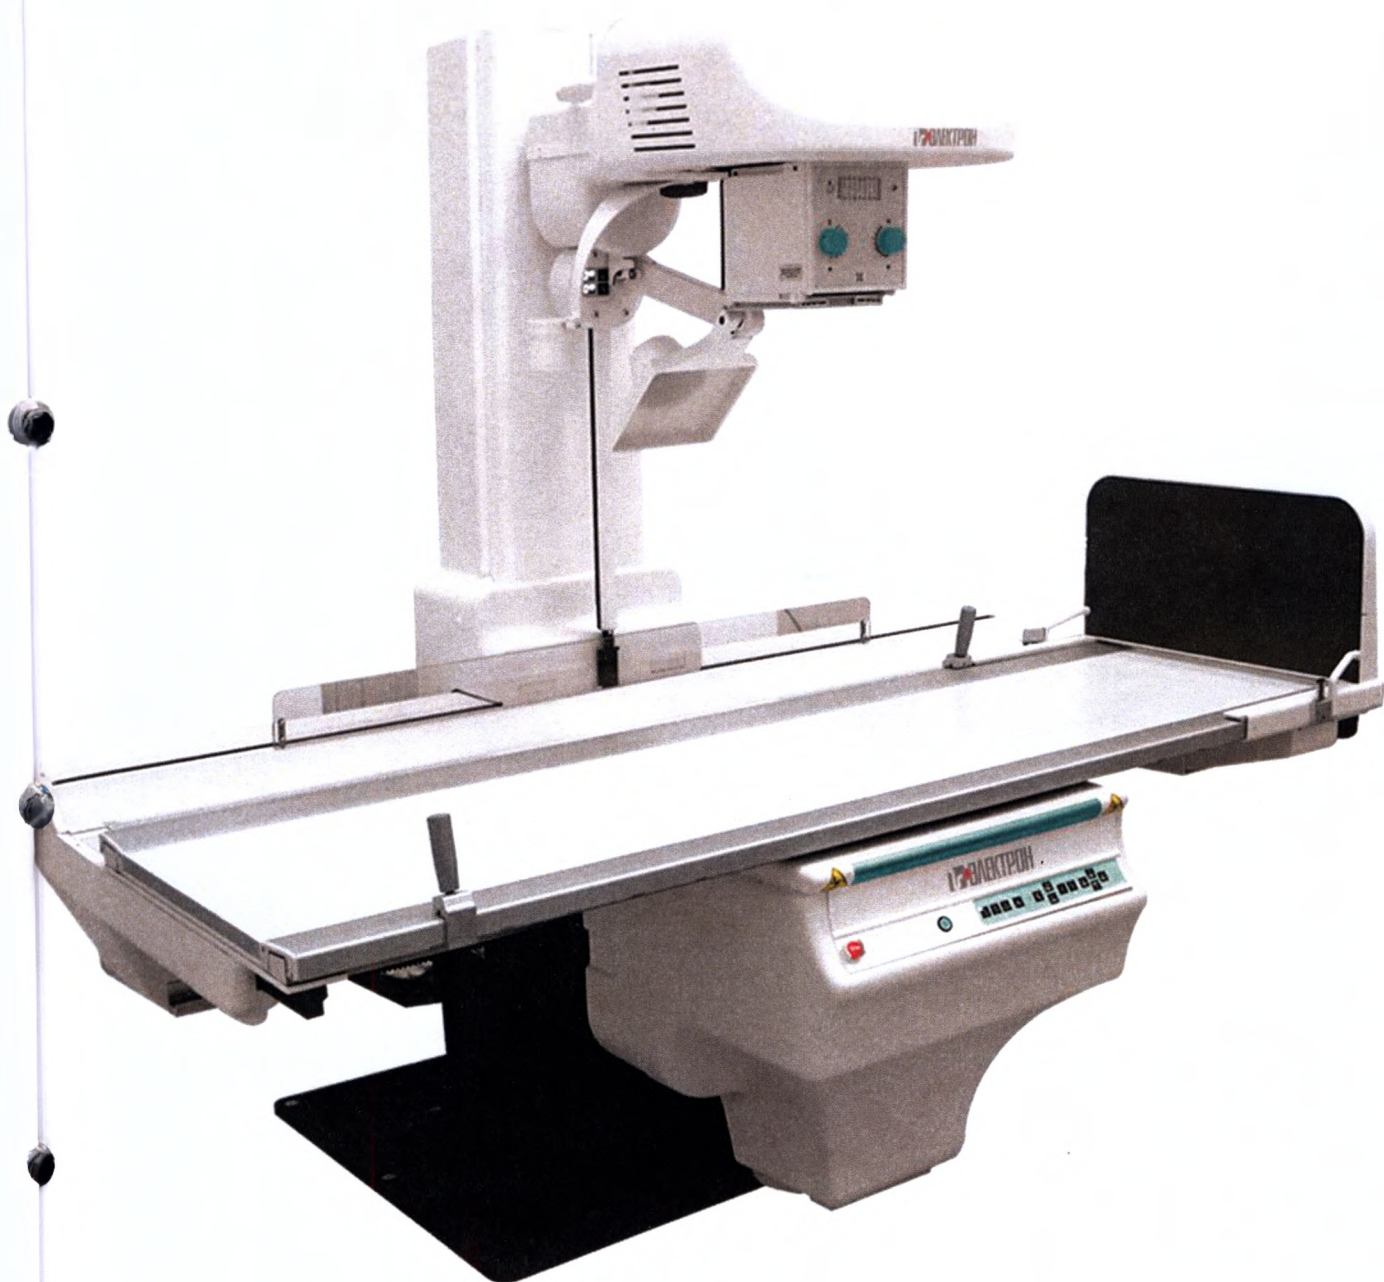


Фотография 4 – Стол телеуправляемый (вариант внешнего вида) с УРИ

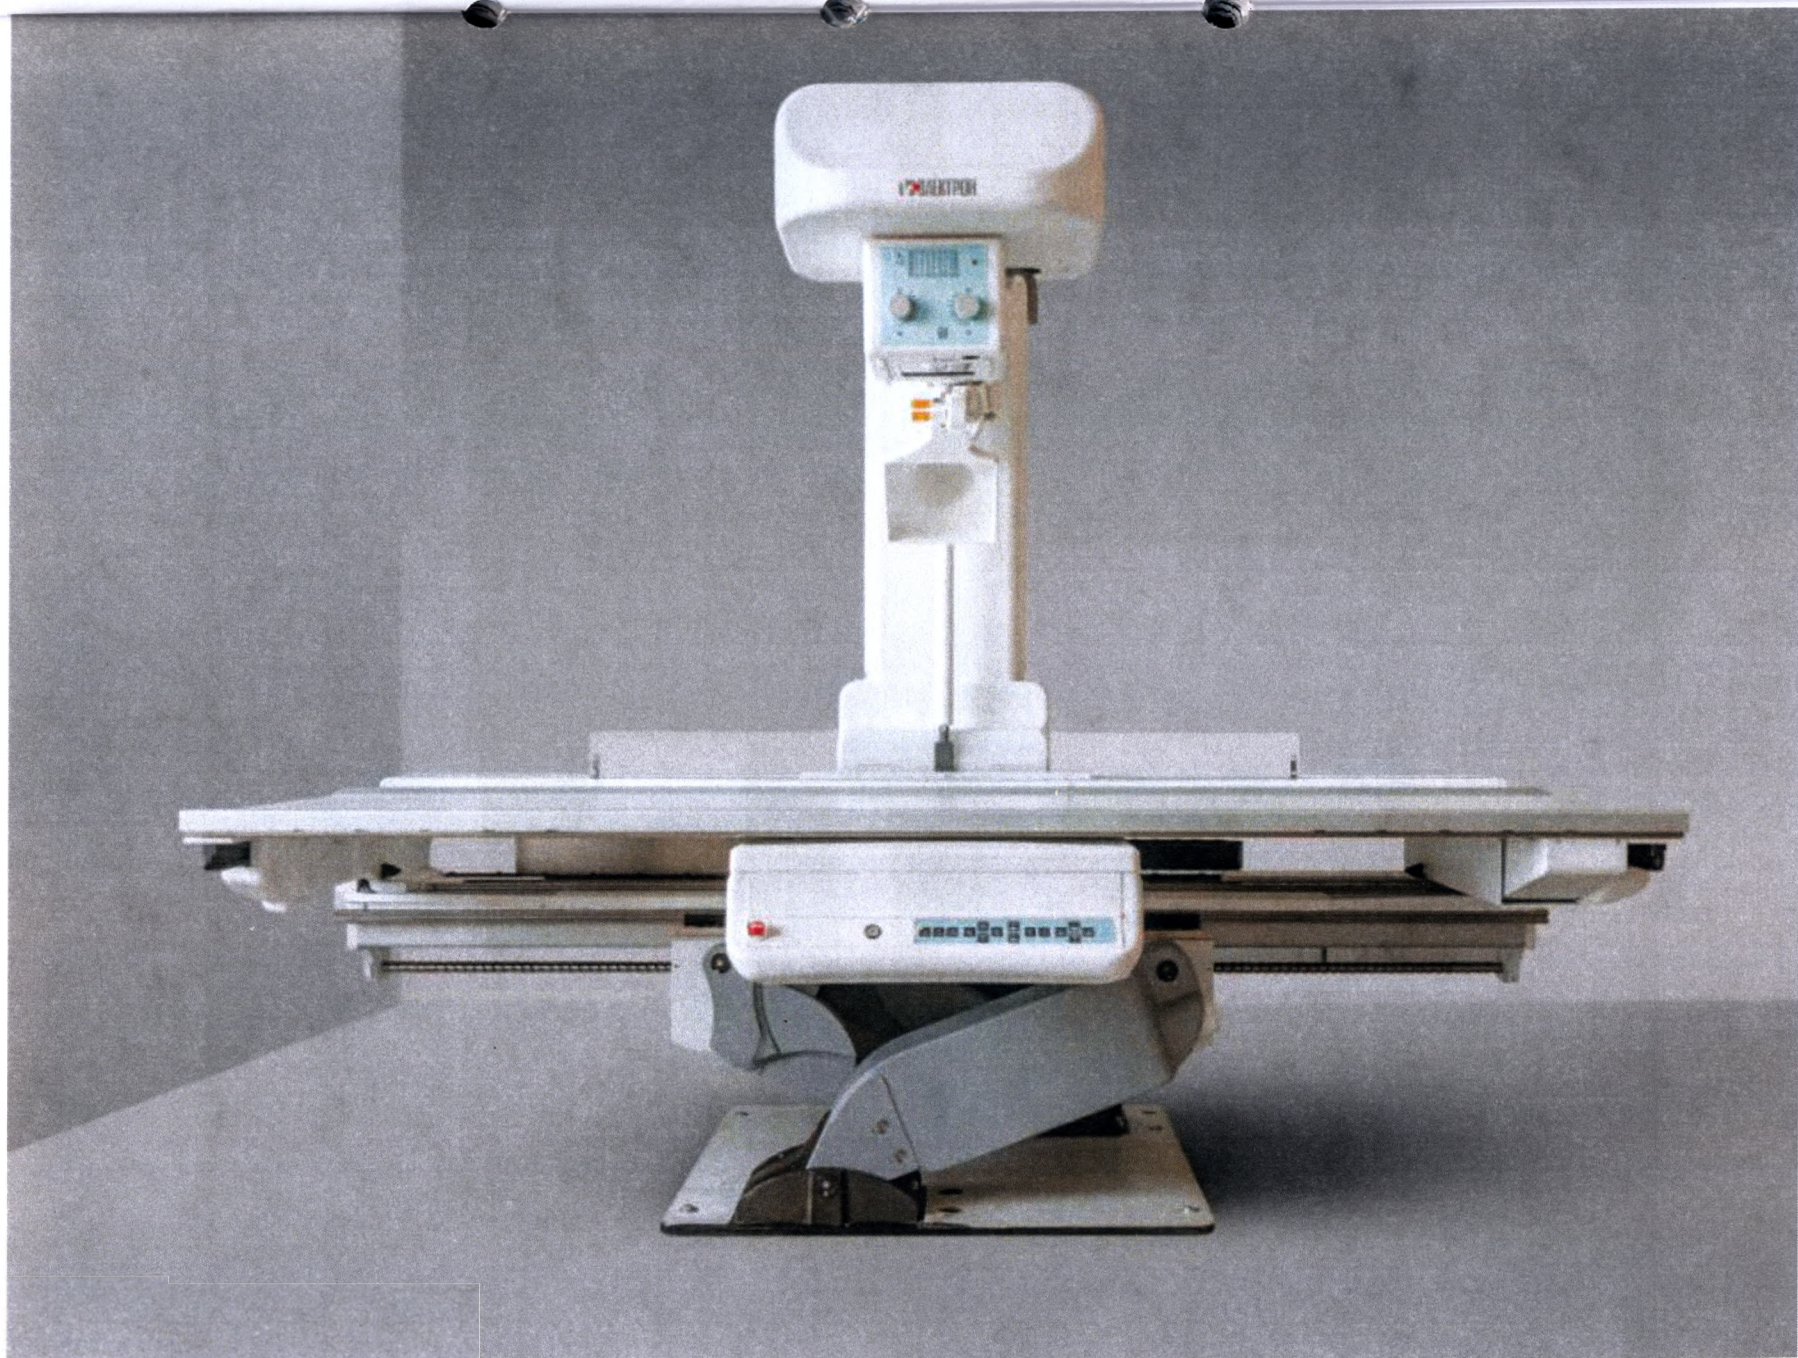

Фотография 5 – Стол телеуправляемый (вариант внешнего вида) с КРЦ



Фотография 6 – Стол телеуправляемый (вариант внешнего вида) с КРЦ

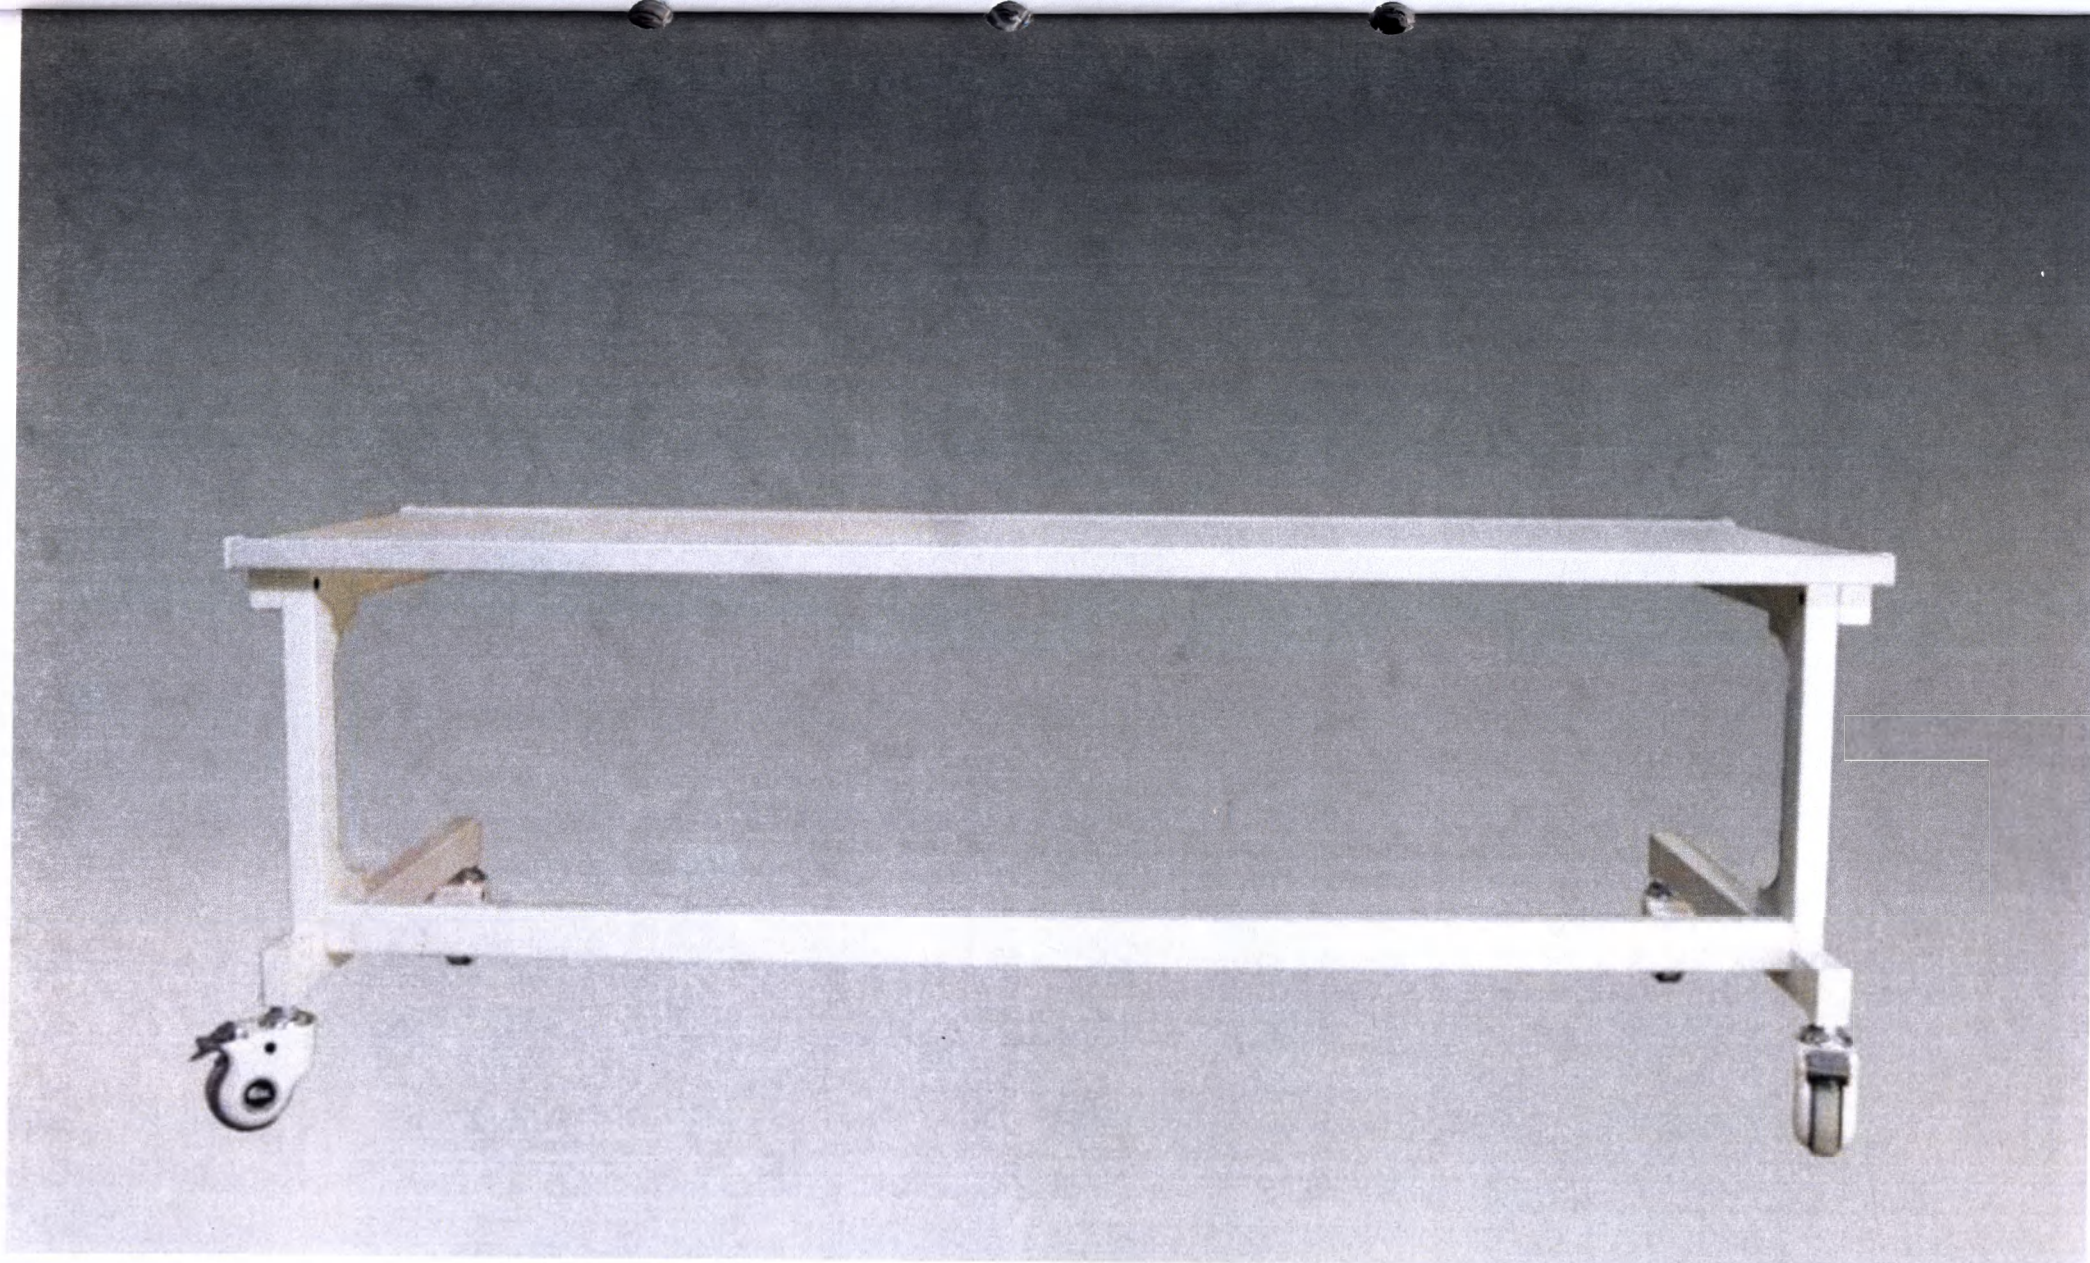

Фотография 7 – Стол-каталка

ЭЛЕКТРОН

Стол пациента

Серийный номер NN0004213
Дата изготовления 2023-06

Обозначение RTOMO-1100

Серийный номер МИ GP0005796

Изготовитель АО "НИПК "ЭЛЕКТРОН"


NP-20-0002-01




~220 В, 50 Гц, 1 кВА



Фотография 8 – Стол пациента. Образец внешнего вида варианта маркировки

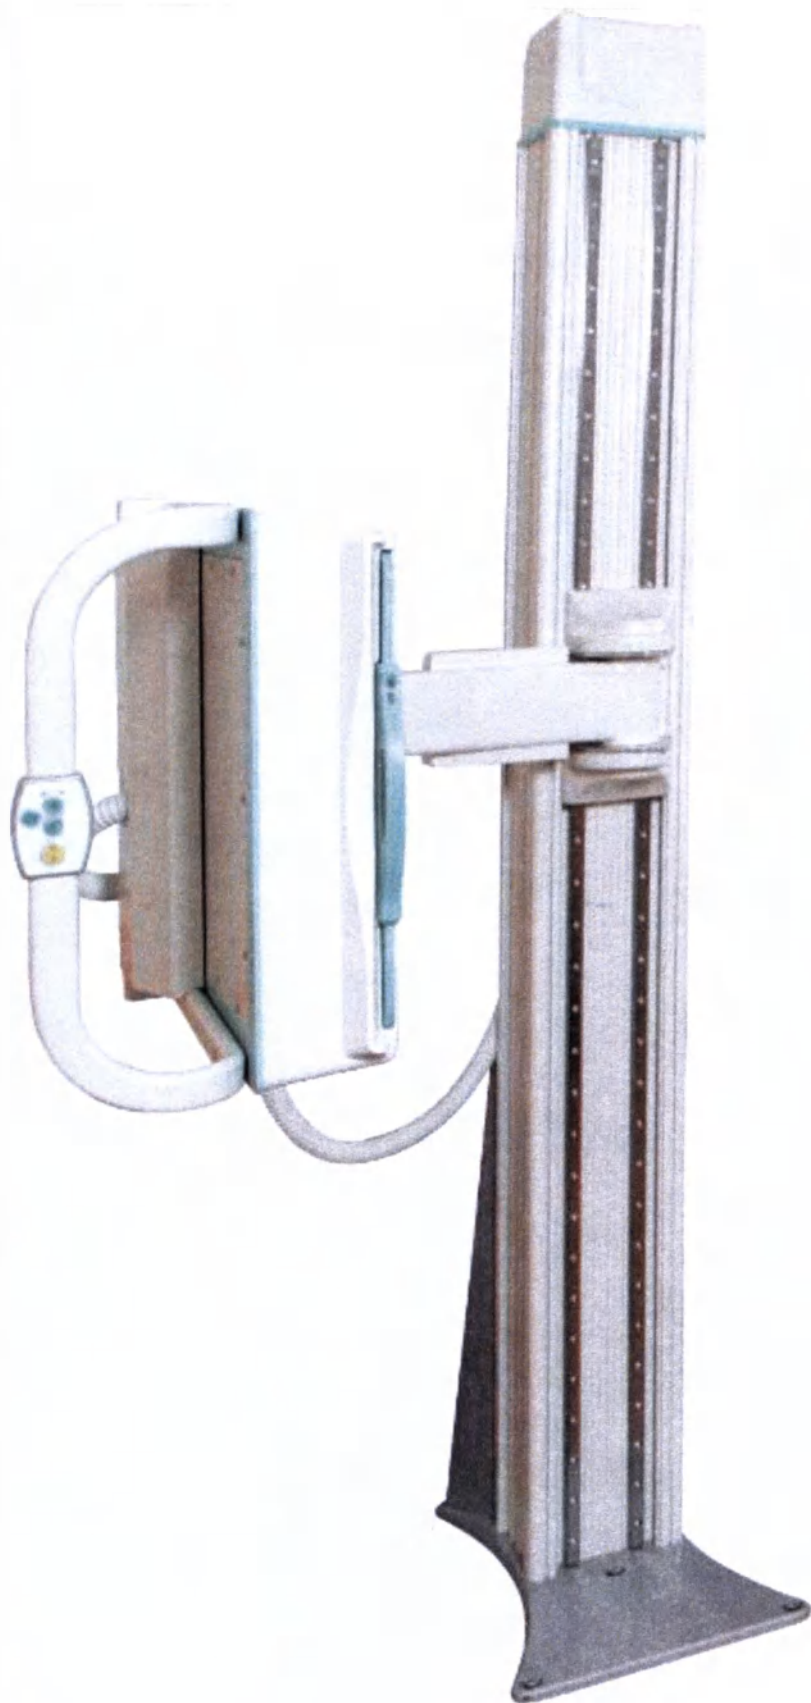

Фотография 9 – Стойка (вариант внешнего вида) с КРЦ

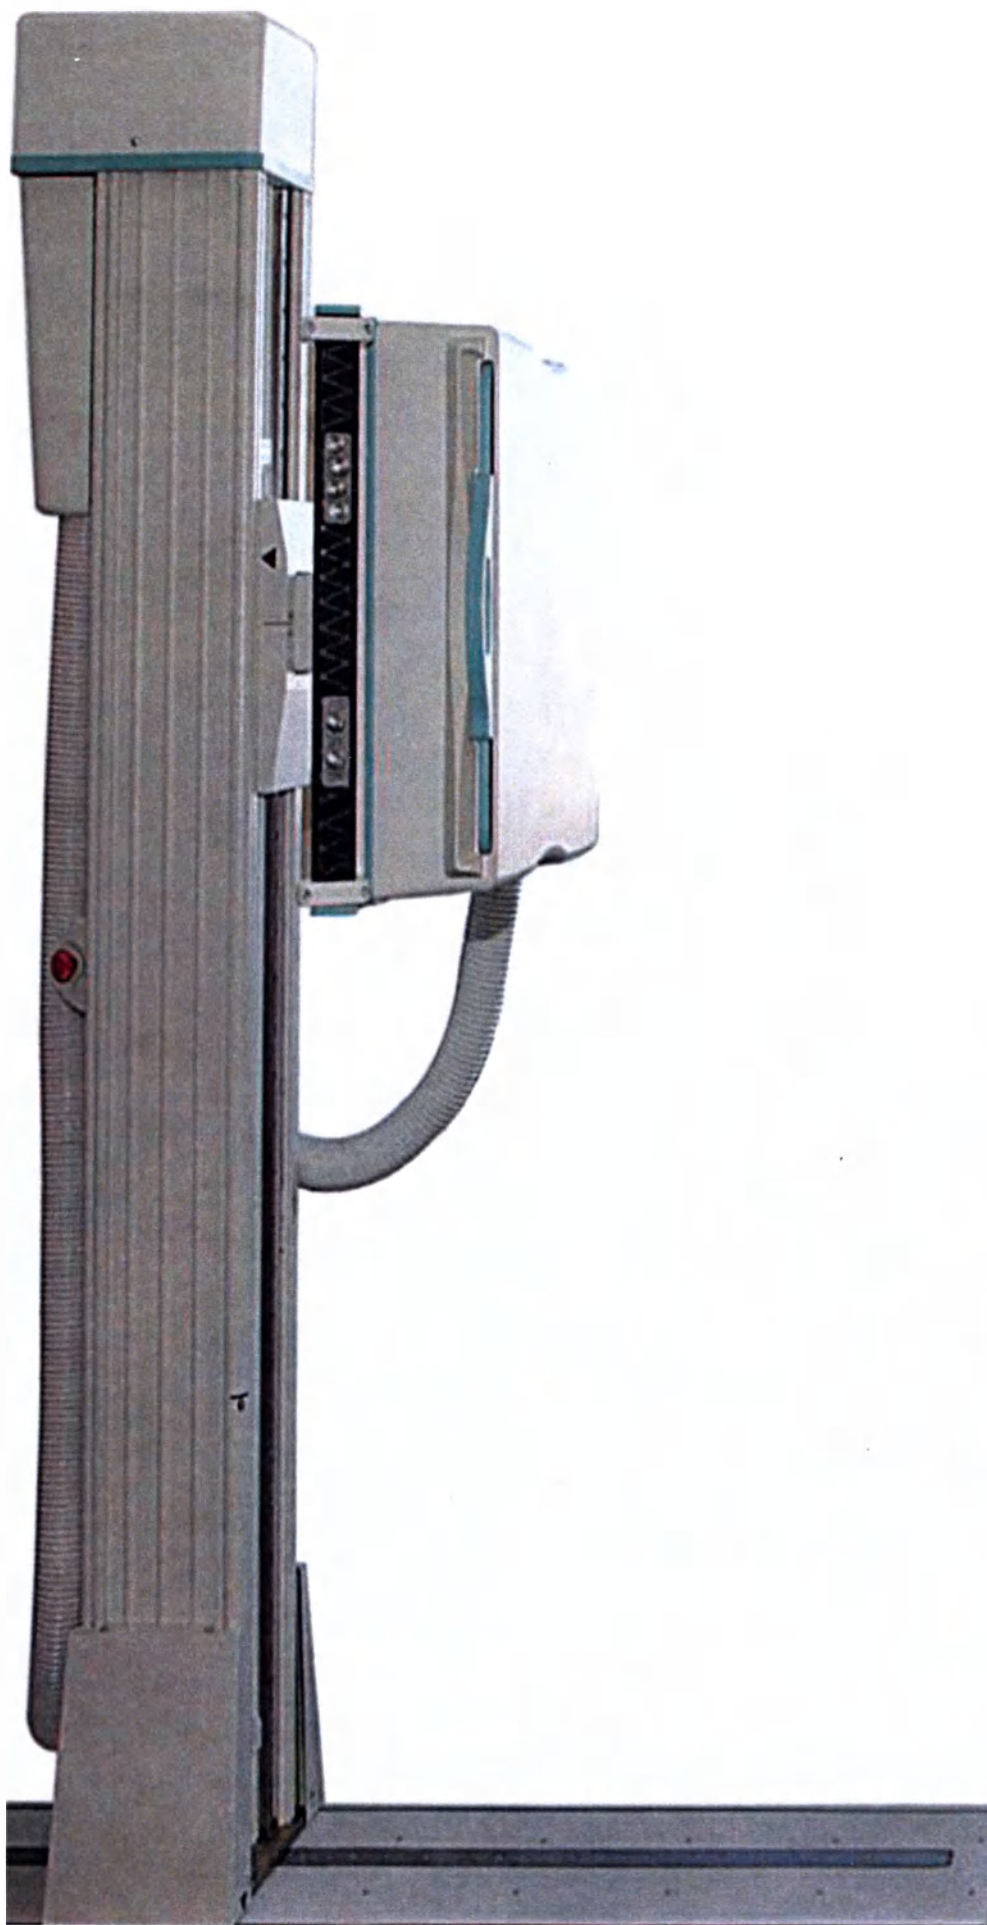

Фотография 10 – Стойка (вариант внешнего вида) с КРЦ

ЭЛЕКТРОН

Стойка вертикальная цифровая

ТУ	9442-028-11150760-2008
Серийный номер	NN0004115
Дата изготовления	2023-06

Обозначение	RTOMO-1500-20:22R
-------------	-------------------

Серийный номер МИ	GP0005796
-------------------	-----------

Изготовитель	АО "НИПК "ЭЛЕКТРОН"
--------------	---------------------

NR-20-0006



~220В, 50Гц, 200 ВА




Фотография 11 – Стойка. Образец внешнего вида варианта маркировки




Фотография 12 – Система позиционирования рентгеновская серии Roesys XRS (из состава Стойки)



Фотография 13 – Решетка фокусирующая (растр рентгеновский)

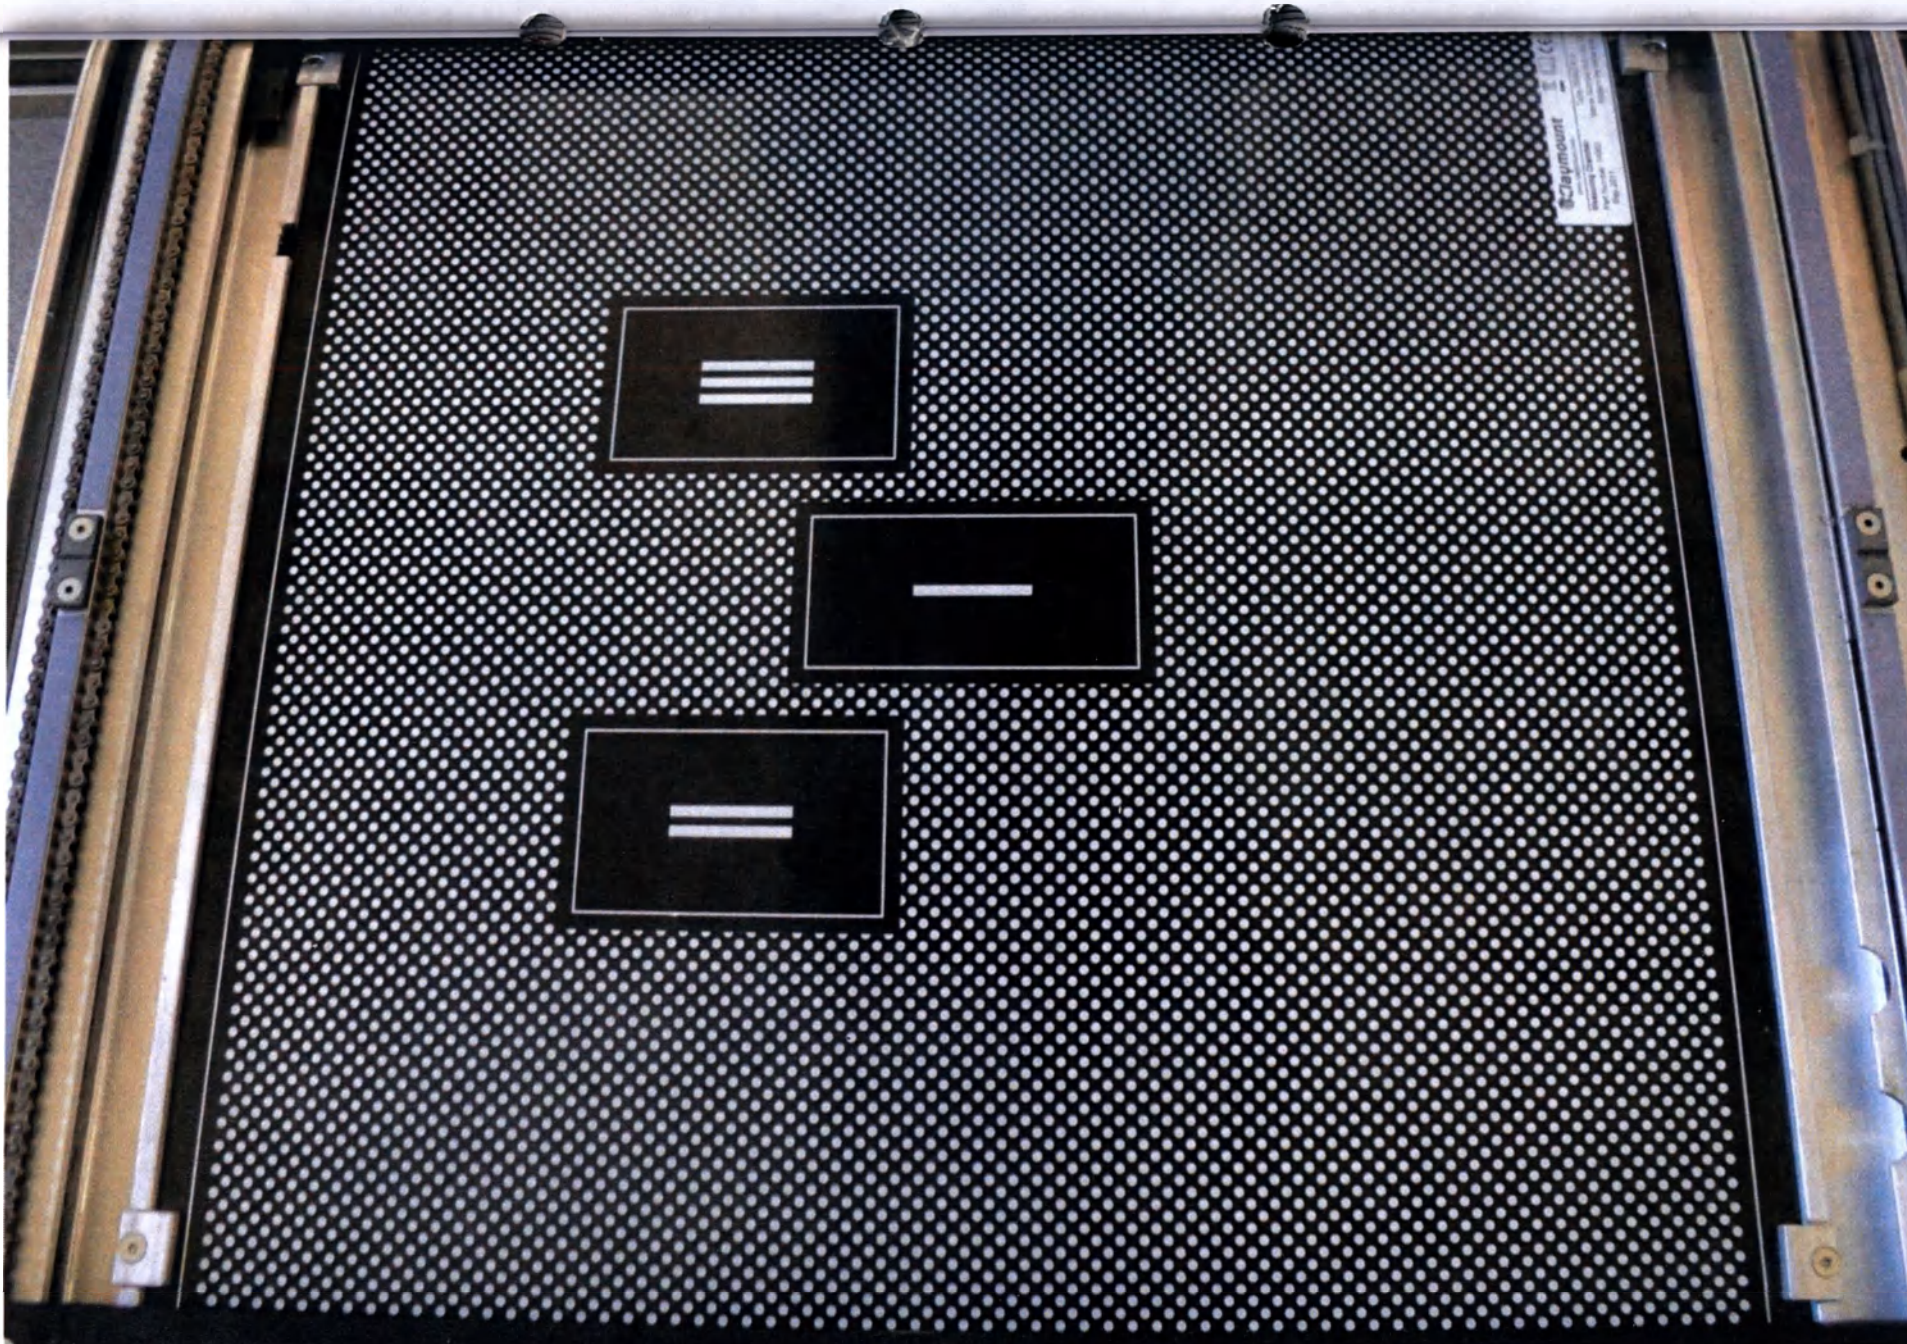

Фотография 14 – Камера ионизационная

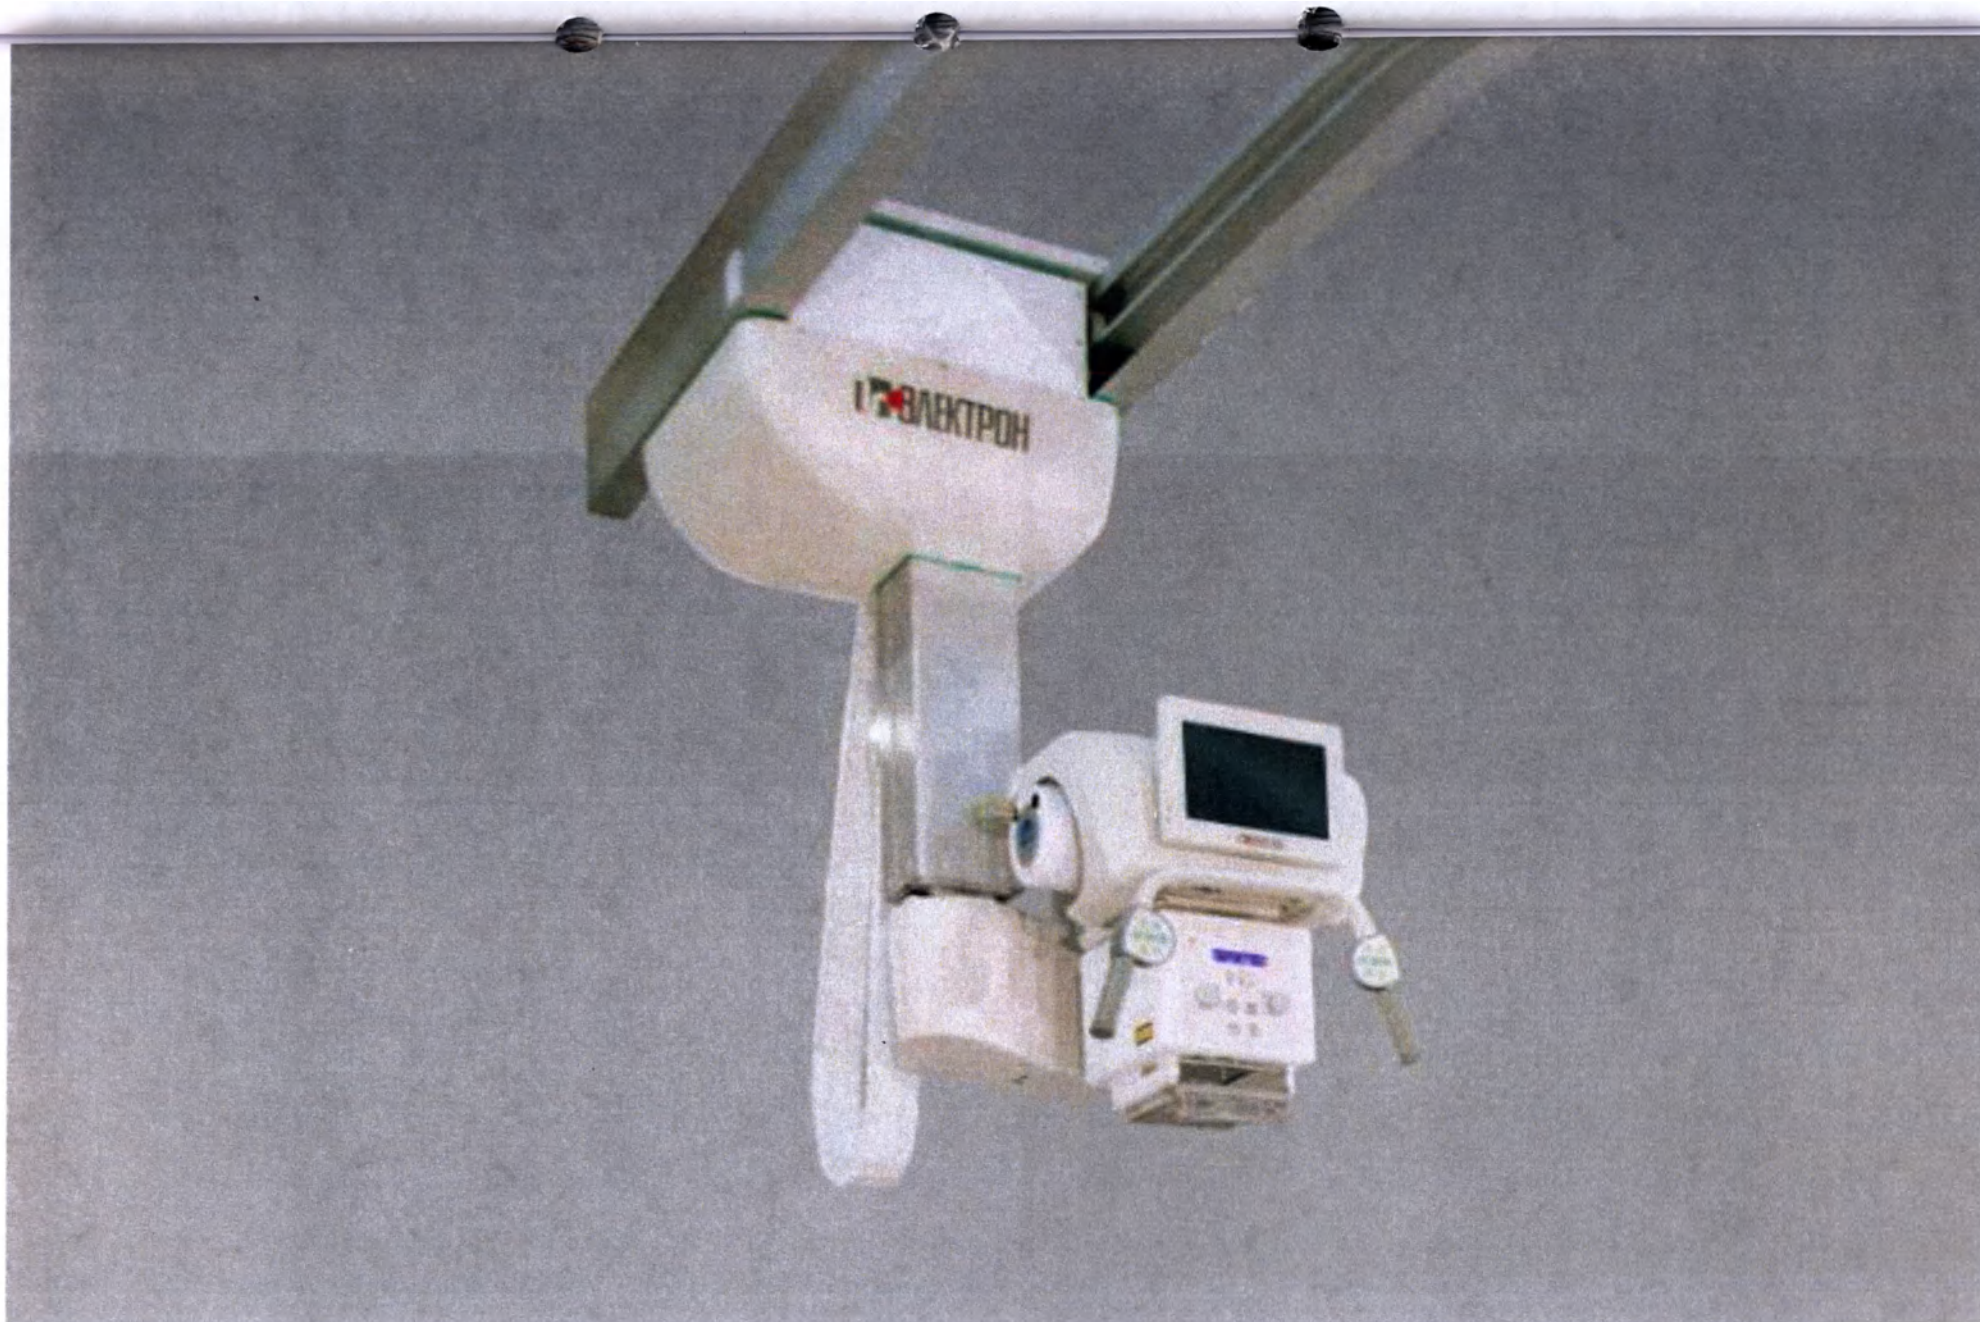

Фотография 15 – Кронштейн с излучателем в сборе

ЭЛЕКТРОН

**Кронштейн с излучателем
в сборе**

Серийный номер NN0005115
Дата изготовления 2023-05

Обозначение RTOMO-1200-18R

Серийный номер МИ GP0006108
АО "НИПК "ЭЛЕКТРОН"

Изготовитель

NP-20-0006



~220В, 50Гц, 500 ВА



Фотография 16 – Кронштейн с излучателем в сборе. Образец внешнего вида варианта маркировки



Фотография 17 – Устройство рентгеновское питающее РПУ-«ОКО», ТУ 9442-022-11150760-2006

ЭЛЕКТРОН

Устройство рентгеновское
питающее РПУ-"ОКО"

ТУ	9442-022-11150760-2006
Серийный номер	NN0004117
Дата изготовления	2023-06

Обозначение	RPU50E-00-0010-41 (РПУ50Е- 000)
-------------	------------------------------------

Серийный номер МИ	GP0005796
-------------------	-----------

Изготовитель	АО "НИПК "ЭЛЕКТРОН"
--------------	---------------------

NP-20-0006




3N~380В, 50Гц, 60 кВА



Фотография 18 – Устройство рентгеновское питающее РПУ-ОКО. Образец внешнего вида варианта маркировки



Фотография 19 – Кабель высоковольтный с комплектом монтажных частей

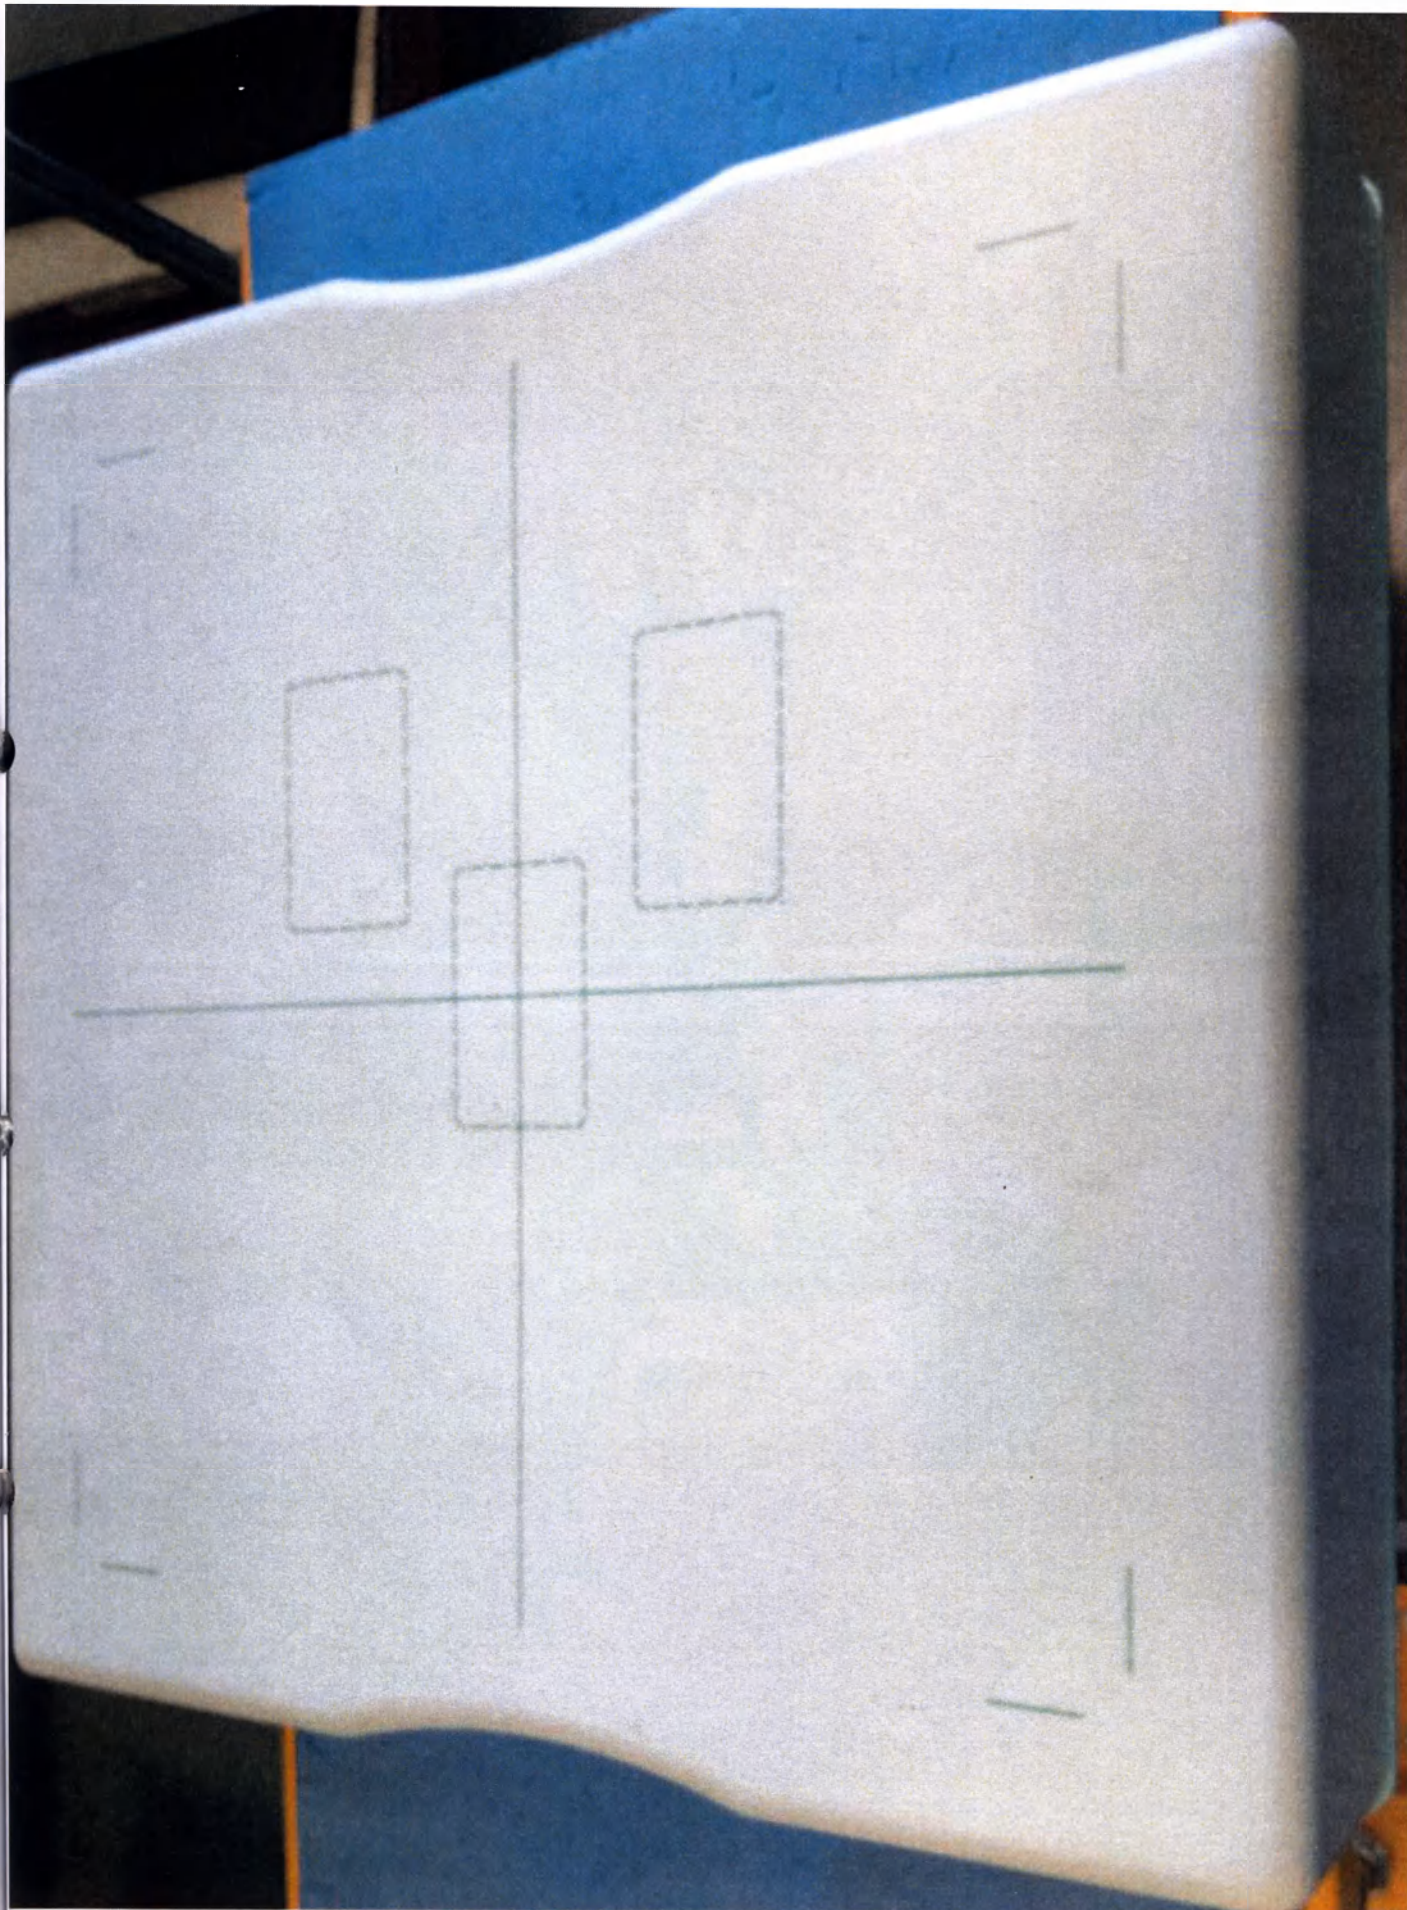

Фотография 20 – Камера. Камера рентгеновская цифровая КРЦ, ТУ 9442-026-11150760-2007
(вариант внешнего вида для комплектования на Стойку)

ЭЛЕКТРОН**Камера рентгеновская
цифровая КРЦ**

ТУ 9442-022-11150760-2007
Серийный номер NN0004121
Дата изготовления 2023-06

Обозначение KRC5-00-0000-01.52
(КРЦ9НЦ)
Серийный номер МИ GP0005796

Изготовитель АО "НИПК "ЭЛЕКТРОН"

NP-20-0006



Фотография 21 – Камера рентгеновская цифровая КРЦ. Образец внешнего вида варианта маркировки

ЭЛЕКТРОН**Усилитель рентгеновского
изображения УРИ**

ТУ 9442-027-11150760-2007
Серийный номер NN0005321
Дата изготовления 2023-06

Обозначение URI1018-00-0000-11 (УРИ-1.0М)
Серийный номер МИ GP0005796
Изготовитель АО "НИПК "ЭЛЕКТРОН"

NP-20-0001-02




~220 В, 50 Гц, 100 Вт



Фотография 22 – Усилитель рентгеновского изображения УРИ. Образец внешнего вида маркировки



Фотография 23 – УРИ. Усилитель рентгеновского изображения УРИ. ТУ 9442-027-11150760-2007
(в условиях эксплуатации закрыт кожухом)

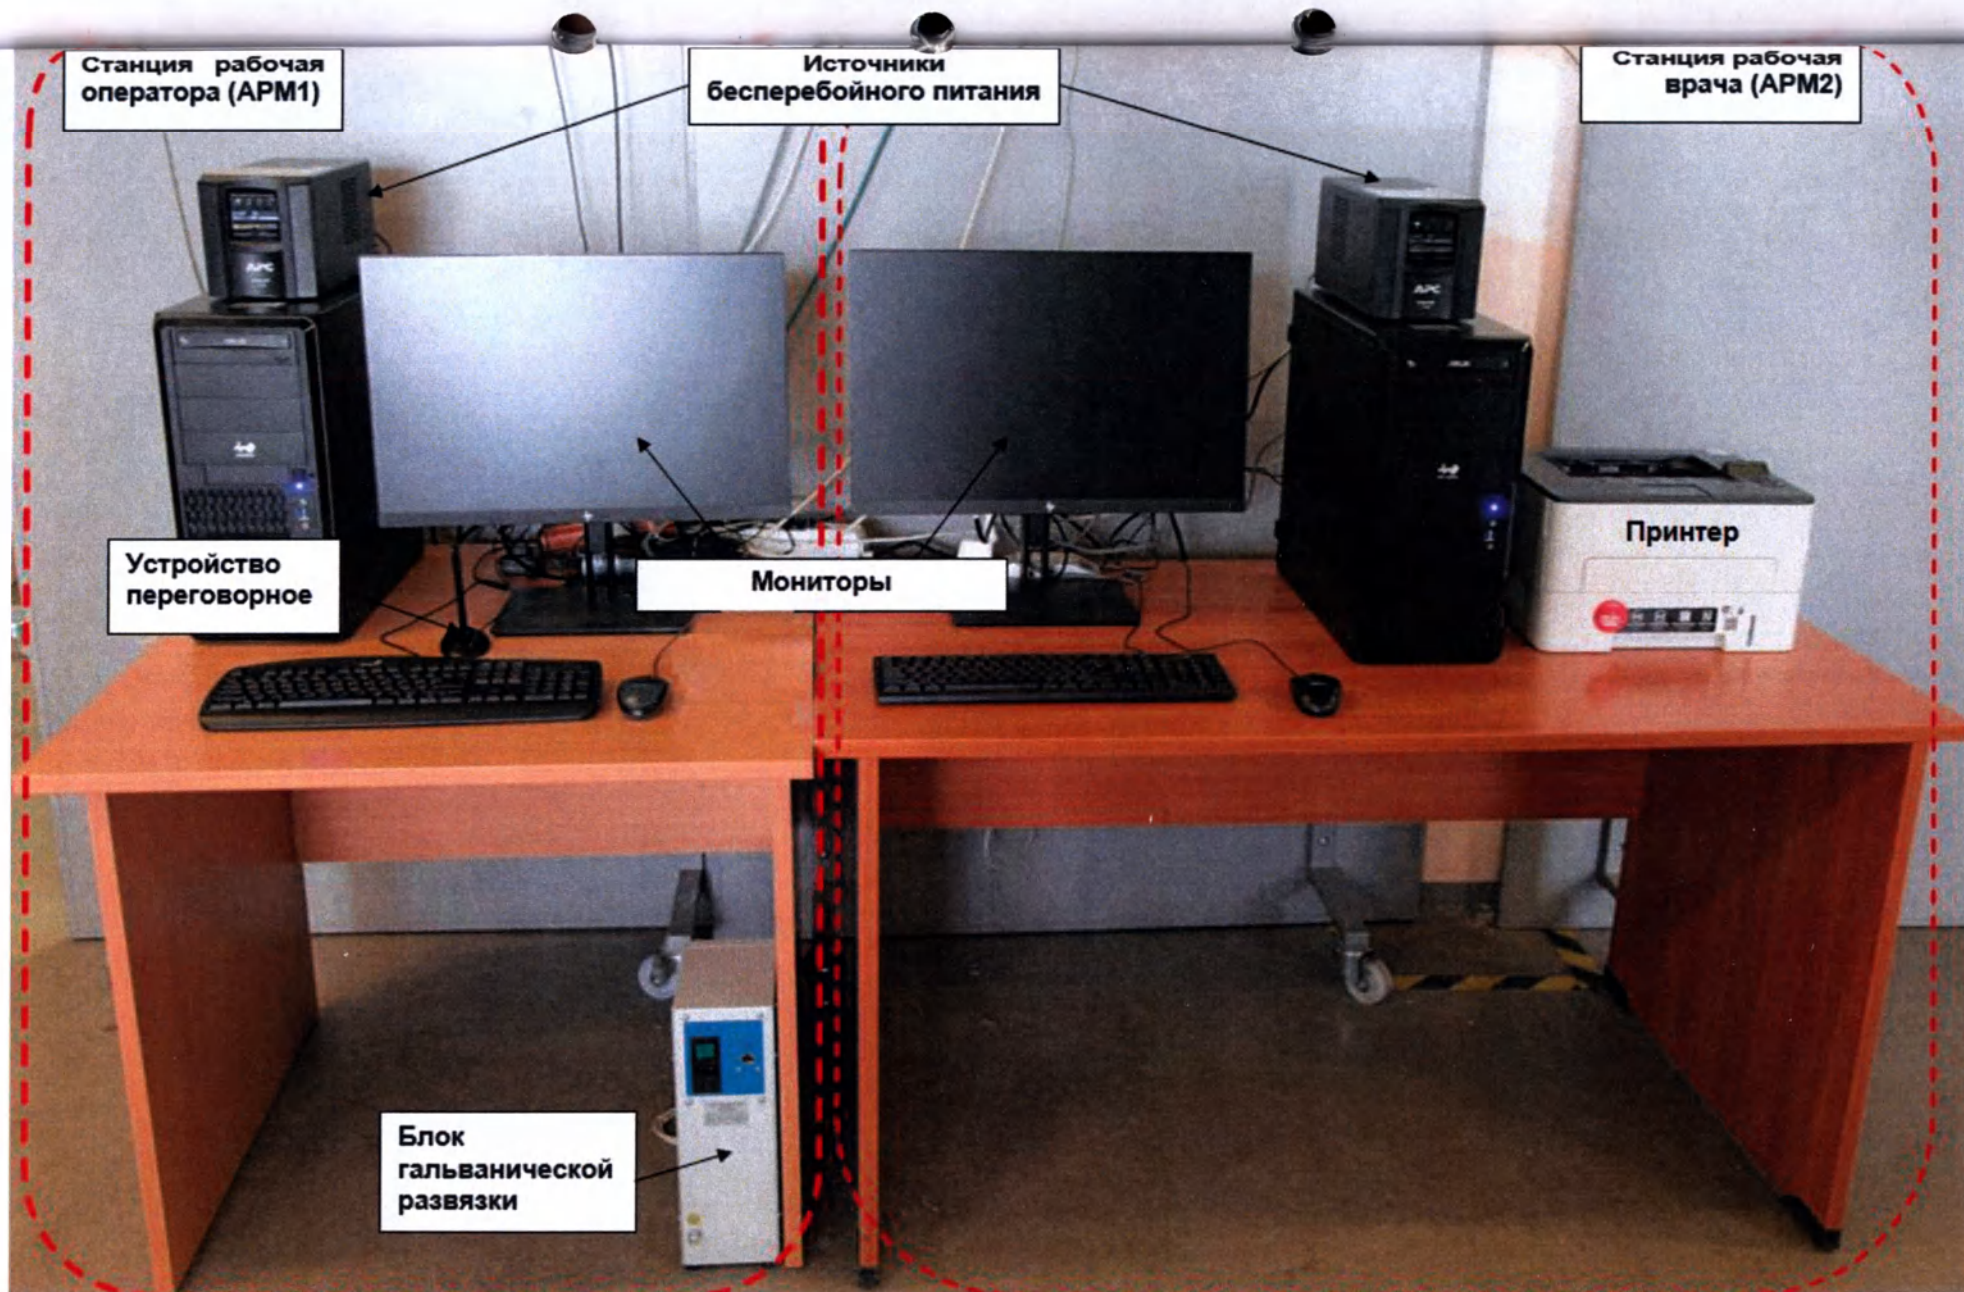

Фотография 24 – РПАК. Станция рабочая оператора/рентгенлаборанта (АРМ1) и станция рабочая врача-рентгенолога (АРМ2)

ЭЛЕКТРОН**Рентгенодиагностический
программно-аппаратный
комплекс РПАК****Серийный номер
Дата изготовления**NN0012561
2023-06**Обозначение**

CWS-00-2700

Серийный номер МИ

GP0005796

Изготовитель

АО "НИПК "ЭЛЕКТРОН"

NP-20-0002-01



~220В, 50Гц, 2500 ВА



Фотография 25 – РПАК. Образец внешнего вида варианта маркировки

ЭЛЕКТРОН**Станция рабочая АРМ1****Серийный номер
Дата изготовления**NN0004135
2023-06**Обозначение**

WST1-00-5700 (WST1- 000)

Серийный номер МИ

GP0005796

Изготовитель

АО "НИПК "ЭЛЕКТРОН"

NP-20-0002-01



~220В, 50Гц, 6 А



Фотография 26 – АРМ1. Образец внешнего вида варианта маркировки

ЭЛЕКТРОН**Станция рабочая АРМ2****Серийный номер**
Дата изготовленияNN0004139
2022-06**Обозначение**

WST2-00-1600 (WST12- 000)

Серийный номер МИ

GP0005796

Изготовитель

АО "НИПК "ЭЛЕКТРОН"

NP-20-0002-01



~220В, 50Гц, 6 А



Фотография 27 – АРМ2. Образец внешнего вида варианта маркировки

ЭЛЕКТРОН**Станция рабочая АРМ3****Серийный номер**
Дата изготовленияNN0005141
2023-06**Обозначение**

WST3-00-0300 (WST13- 000)

Серийный номер МИ

GP0005796

Изготовитель

АО "НИПК "ЭЛЕКТРОН"

NP-20-0002-01



~220В, 50Гц, 6 А



Фотография 28 – АРМ3. Образец внешнего вида варианта маркировки



Фотография 29 – Станция рабочая регистратора (АРМ3)



Фотография 30 – Сервер

ЭЛЕКТРОН

Сервер

Серийный номер
Дата изготовления

NN0005531
2023-06

Обозначение

SRV-00-1300 (SRV- 000)

Серийный номер МИ

GP0005796

Изготовитель

АО "НИПК "ЭЛЕКТРОН"

NP-20-0002-01




~220В, 50Гц, 6 А



Фотография 31 – Сервер. Образец внешнего вида маркировки



Фотография 32 – Окно рентгенозащитное

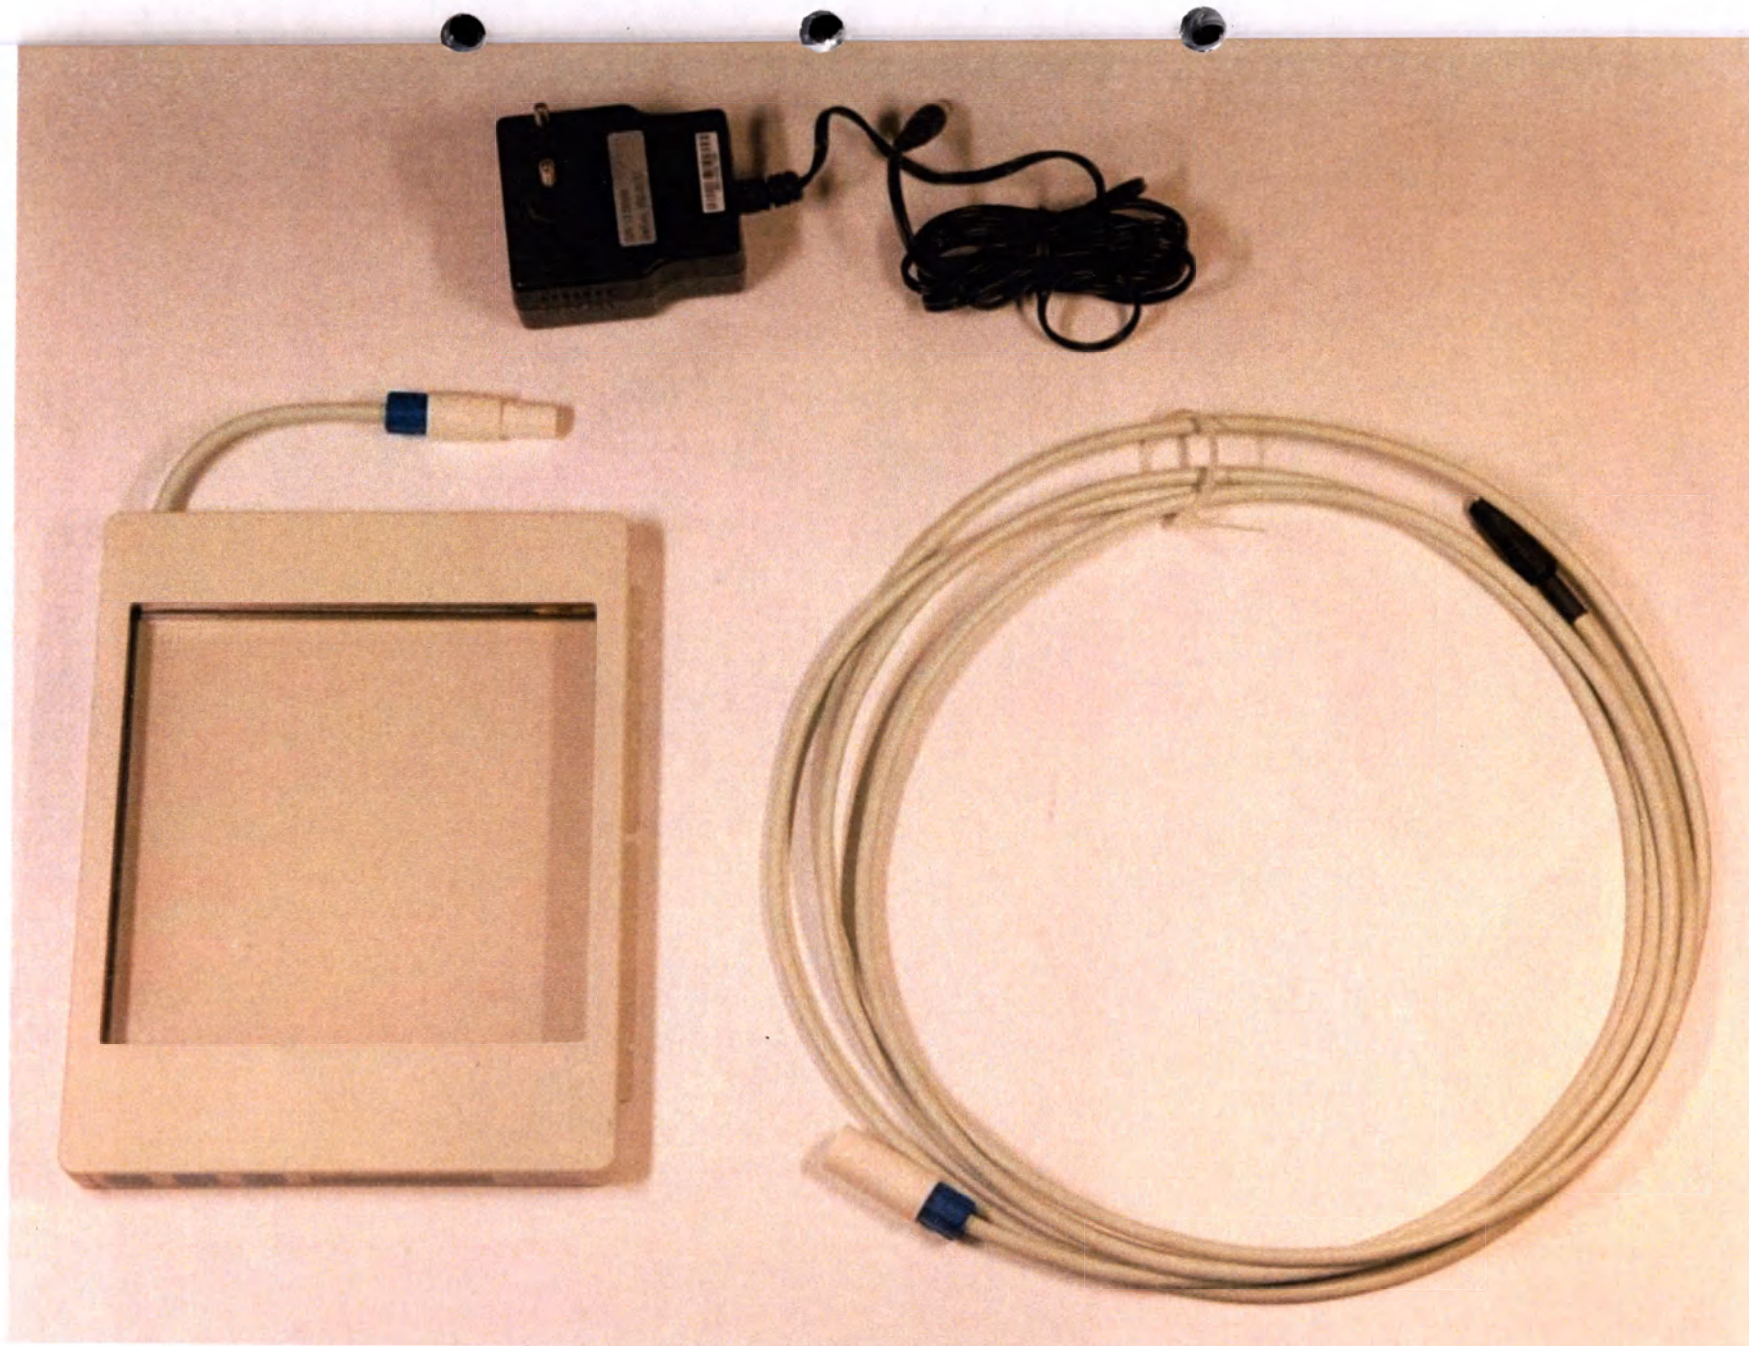

Фотография 33 – Дозиметр VacuDAp

59349
24.07.2023



Фотография 34 – Дозиметр серии ДРК, НПП «Доза»



Фотография 35 – Стойка приборная (варианты внешнего вида)



Комплекс рентгенодиагностический телеуправляемый КРТ
№ GP*****

МЕСТО №	1/X
Контракт №	*****
Заказчик	*****
Поставщик	*****
Грузополучатель	*****
Пункт назначения	*****
БРУТТО *** кг	<u>Грузоотправитель</u>
НЕТТО *** кг	АО «НИПК «Электрон»
хх*** см	197758, г. Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.
	Г. Поселок Песочный,
	ул. Садовая, д.88, стр.1, помещ. 8Н

ВНИМАНИЕ!

Вскрывать только в присутствии представителя поставщика



Фотография 36 – КРТ. Упаковка и маркировка упаковки

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 33
(Тридцать три) лист(ов)

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА
СЕРТИФИКАЦИИ
ДЕНИСОВА О.А.
по доверенности № 1264/ТК

