

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Сигма Полис»

Мазырко В.А.

«26» мая 2023 г.

(М.П.)



Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия

Средство перевязочное гемостатическое на основе хитозана Абсорба

по ТУ 21.20.24-001-47717001-2022

производства ООО «Сигма Полис», Россия

Москва, 2023

Средство перевязочное гемостатическое на основе хитозана Абсорба: бинт однослойный стерильный из нетканого материала в складчатой форме размером 7,5x150 см

МАРКИРОВКА ПЕРВИЧНОЙ ТАРЫ (ЭТИКЕТКА) – ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА

ЛИНИЯ РАЗРЫВА

ЛИНИЯ РАЗРЫВА

Абсорба

**СРЕДСТВО ПЕРЕВЯЗОЧНОЕ ГЕМОСТАТИЧЕСКОЕ
НА ОСНОВЕ ХИТОЗАНА**

**ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ
ДЛЯ ОСТАНОВКИ НАРУЖНОГО
КРОВОТЕЧЕНИЯ РАЗЛИЧНОЙ
ИНТЕНСИВНОСТИ**

**БИНТ ОДНОСЛОЙНЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ
ИЗ НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА
В СКЛАДЧАТОЙ ФОРМЕ
РАЗМЕРОМ 7,5 x 150 см.**

STERILE R

**СПОСОБСТВУЕТ БЫСТРОМУ
СВЁРТЫВАНИЮ КРОВИ**

**ТУ: 21.20.24-001-47717001-2022
РУ № РЗН XXXX от XX.XX.XXX**



Полная версия инструкции по применению доступна по QR-коду



СТЕРИЛЬНО

Состав: хитозан 25%, карбоксиметилкрахмал 75%, нанесенные на нетканый материал.



1. Очистите рану
от загрязнений



2. Нанесите несколько
слоев изделия на рану



3. Наложите
марлевую повязку



4. Прижмите
и зафиксируйте

5. После применения изделия не следует наносить на область раны жидкие препараты, мази и другие вещества.

6. После остановки кровотечения удалите средство из области кровотечения и, при необходимости, наложите марлевую повязку.


7. Обратитесь в медицинское учреждение для оказания квалифицированной врачебной помощи (при необходимости).

Противопоказания к применению: аллергические реакции в связи с индивидуальной непереносимостью компонентов.

 ООО «Сигма Полис», 109316, г. Москва,
вн.тер.г. Муниципальный Округ Печат-
ники, пр-кт Волгоградский, д.42, к.5,
эт/пом. 2/1, ком. 229.
Тел. +7 (495) 255-00-21.

LOT

REF

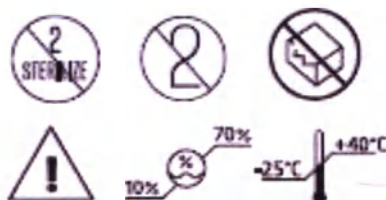

СТЕРИЛЬНО

хитозан 25%, карбоксиметилкрахмал 75%, непереносимости на нетканый



Очистите рану
от загрязнений

Нанесите несколько
слоев изделия на рану

Наложите
марлевую повязку

Прижмите
и зафиксируйте

При применении изделия не следует наносить на область раны
мази, мази и другие вещества.

После остановки кровотечения удалите средство из области кровоте-
чения. При необходимости, наложите марлевую повязку.

Обратитесь в медицинское учреждение для оказания квалифициро-
ванной помощи (при необходимости).



Противопоказания к применению: аллергические реакции в связи с ин-
дивидуальной непереносимостью компонентов.

100 «Сигма Полис», 109316, г. Москва,
г. Муниципальный Округ Печат-
ный, пр-кт Волгоградский, д.42, к.5,
этаж. 2/1, ком. 229.
т +7 (495) 255-00-21.


LOT 540203


REF 001

12.2027

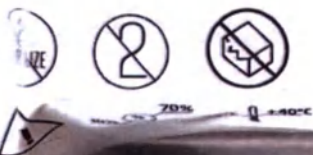

Бинт однослойный стерильный из нетканого материала в складчатой форме размером 7,5х150 см

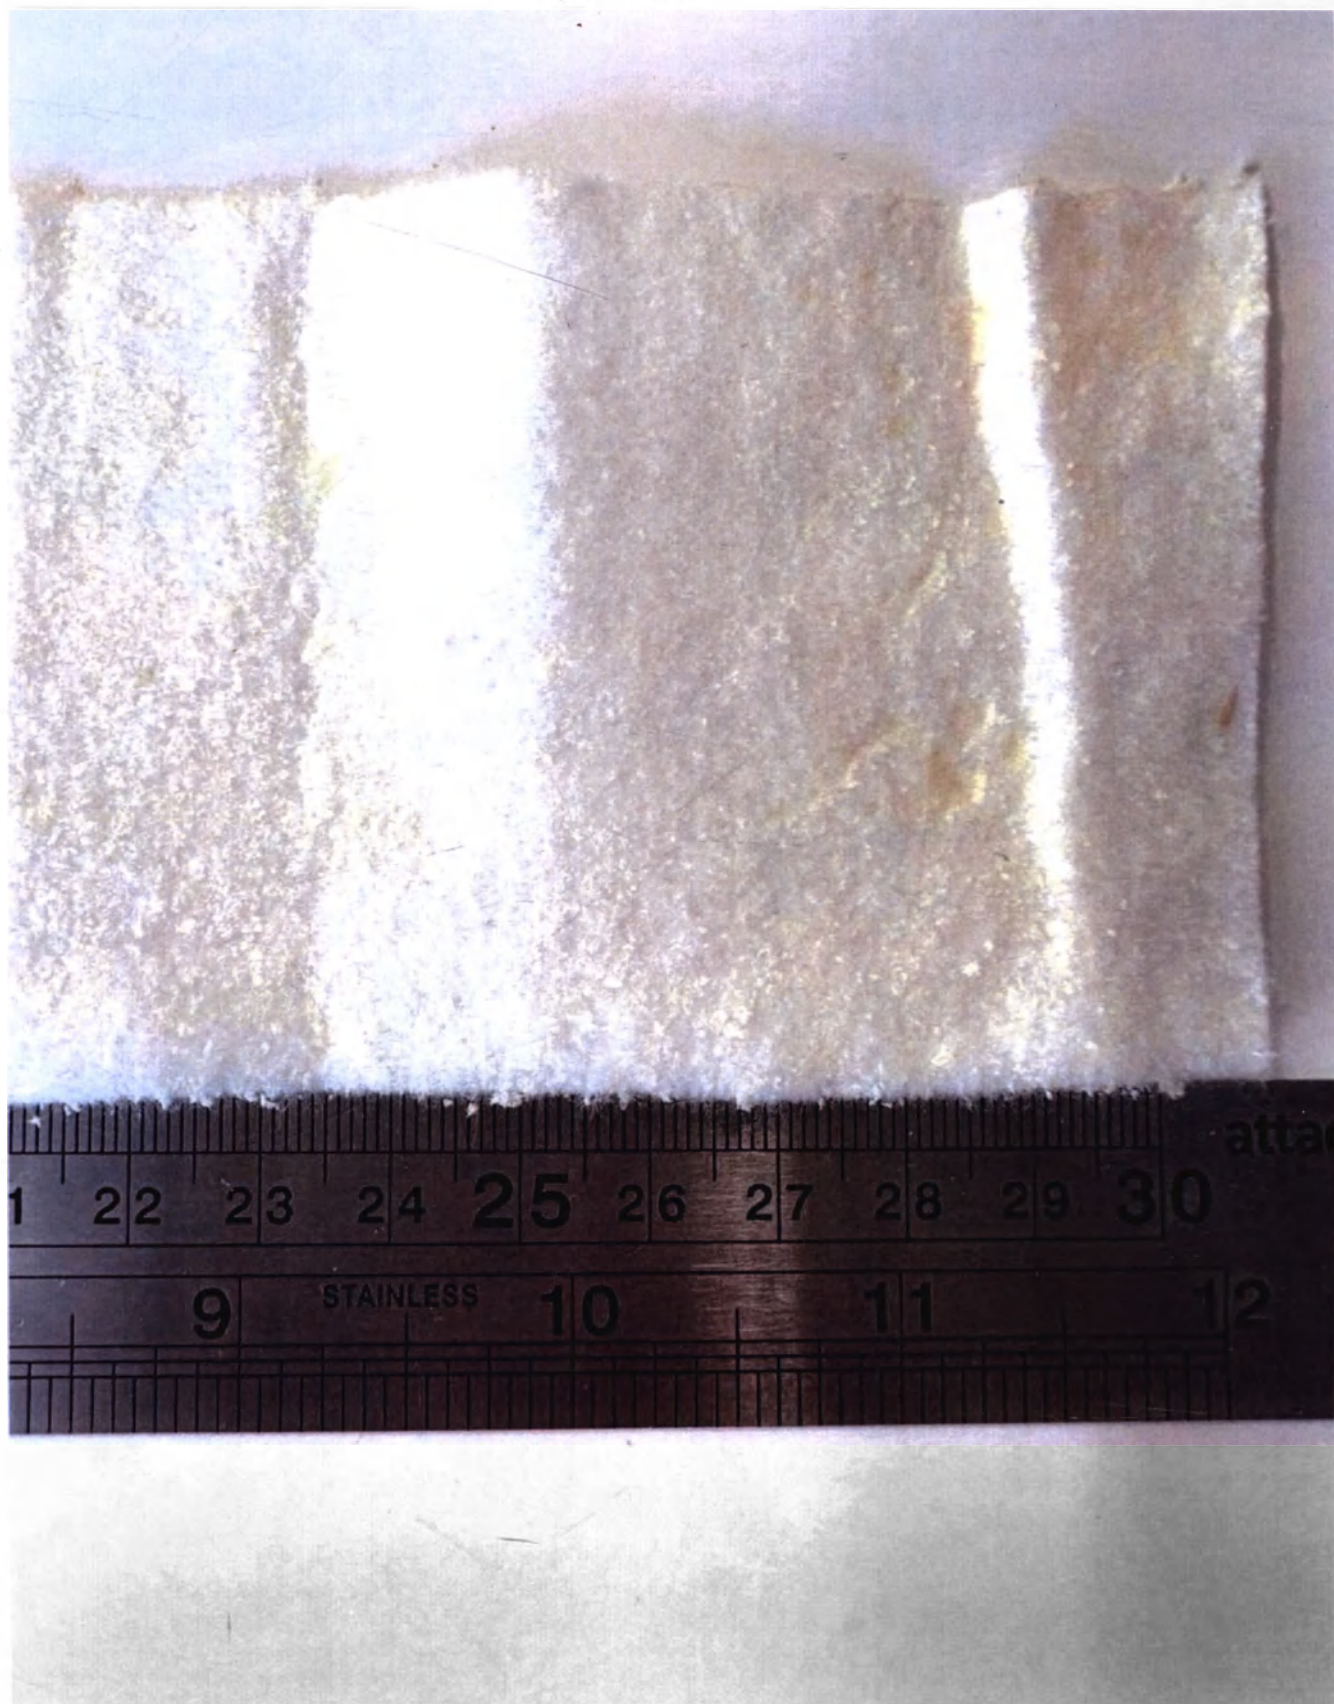

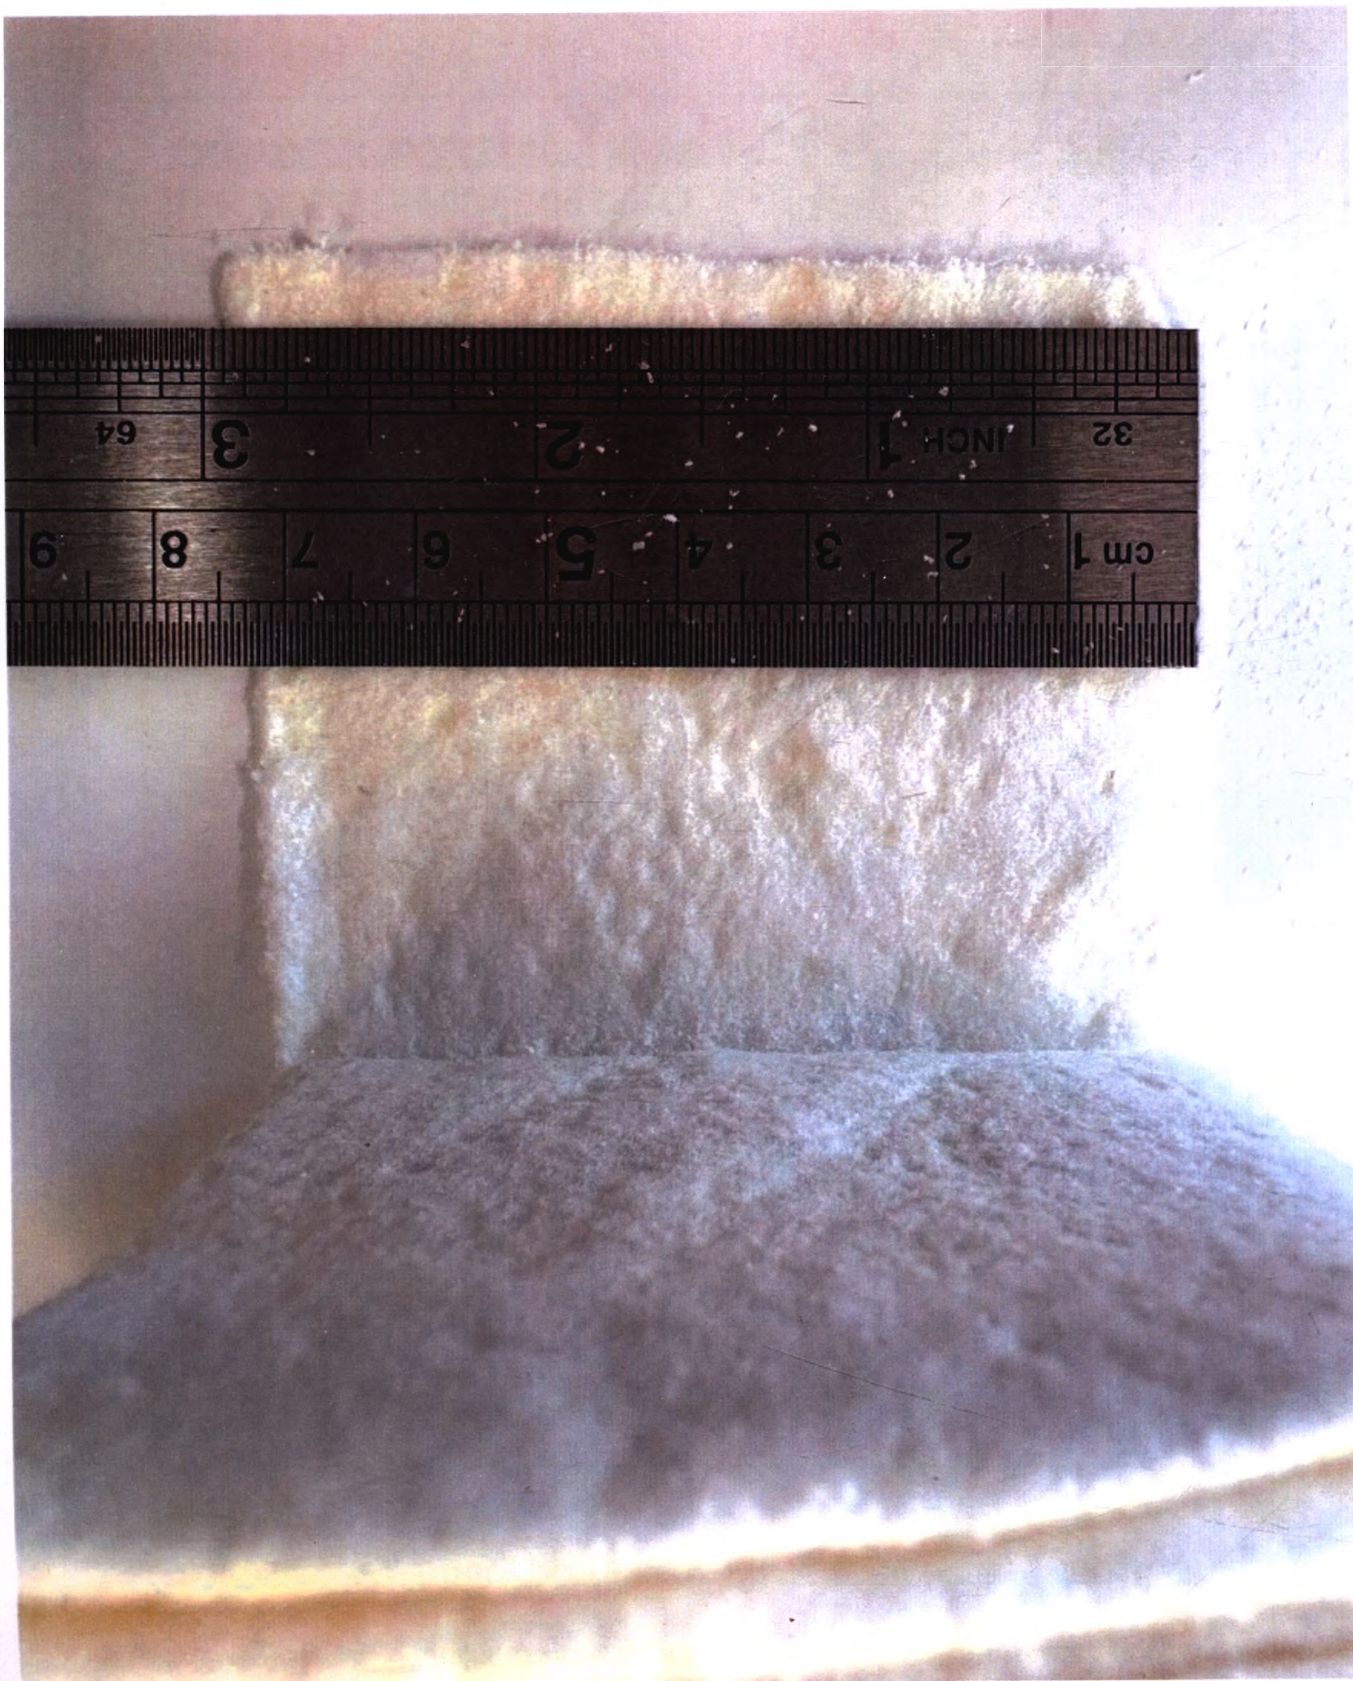

Средство перевязочное гемостатическое на основе хитозана Абсорба: бинт однослойный стерильный из нетканого материала в складчатой форме размером 7,5x180 см

МАРКИРОВКА ПЕРВИЧНОЙ ТАРЫ (ЭТИКЕТКА) – ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА

ЛИНИЯ РАЗРЫВА

ЛИНИЯ РАЗРЫВА

Абсорба

**СРЕДСТВО ПЕРЕВЯЗОЧНОЕ ГЕМОСТАТИЧЕСКОЕ
НА ОСНОВЕ ХИТОЗАНА**

**ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ
ДЛЯ ОСТАНОВКИ НАРУЖНОГО
КРОВОТЕЧЕНИЯ РАЗЛИЧНОЙ
ИНТЕНСИВНОСТИ**

**БИНТ ОДНОСЛОЙНЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ
ИЗ НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА
В СКЛАДЧАТОЙ ФОРМЕ
РАЗМЕРОМ 7,5 x 180 см.**

**СПОСОБСТВУЕТ БЫСТРОМУ
СВЁРТЫВАНИЮ КРОВИ**

STERILE R

**ТУ: 21.20.24-001-47717001-2022
РУ № РЗН XXXX от XX.XX.XXX**



Полная версия инструкции по применению доступна по QR-коду




СТЕРИЛЬНО

Состав: хитозан 25%, карбоксиметилкрахмал 75%, нанесенные на нетканый материал.



Очистите рану
от загрязнений



Нанесите несколько
слоев изделия на рану



Наложите
марлевую повязку



Прижмите
и зафиксируйте

5. После применения изделия не следует наносить на область раны жидкие препараты, мази и другие вещества.

6. После остановки кровотечения удалите средство из области кровотечения и, при необходимости, наложите марлевую повязку.




7. Обратитесь в медицинское учреждение для оказания квалифицированной врачебной помощи (при необходимости).

Противопоказания к применению: аллергические реакции в связи с индивидуальной непереносимостью компонентов.

 ООО «Сигма Полис», 109316,
г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный
Округ Печатники, пр-кт Волгоград-
ский, д. 42, к.5, эт/пом. 2/1, ком. 229.
Тел. +7 (495) 255-00-21.

LOT

REF

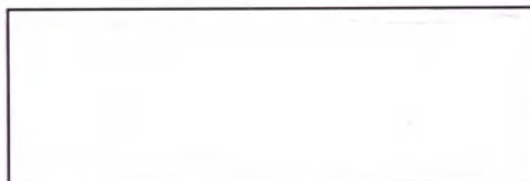

СТЕРИЛЬНО

Состав: хитозан 25%, карбоксиметилкрахмал 75% нанесенные на нетканый материал



Очистите рану
от загрязнений



Нанесите несколько
слоев изделия на рану



Наложите
марлевую повязку



Прижмите
и зафиксируйте

После применения изделия не следует наносить на область раны
порошки, мази и другие вещества.

После остановки кровотечения удалите средство из области кровотечения.
При необходимости, наложите марлевую повязку.

Обратитесь в медицинское учреждение для оказания квалифицированной
медицинской помощи (при необходимости).

Противопоказания к применению: аллергические реакции в связи с индивидуальной
непереносимостью компонентов.

ООО «Сигма Полис», 109316, г. Москва,
вн.тер.г. Муниципальный Округ Печати-
ники, пр-кт Волгоградский, д.42, к.5,
эт/пом. 2/1, ком. 229.
Тел. +7 (495) 255-00-21.

LOT 540101

REF 002

12.2027




70%

40°C




Бинт однослойный стерильный из нетканого материала в складчатой форме размером
7,5x180 см

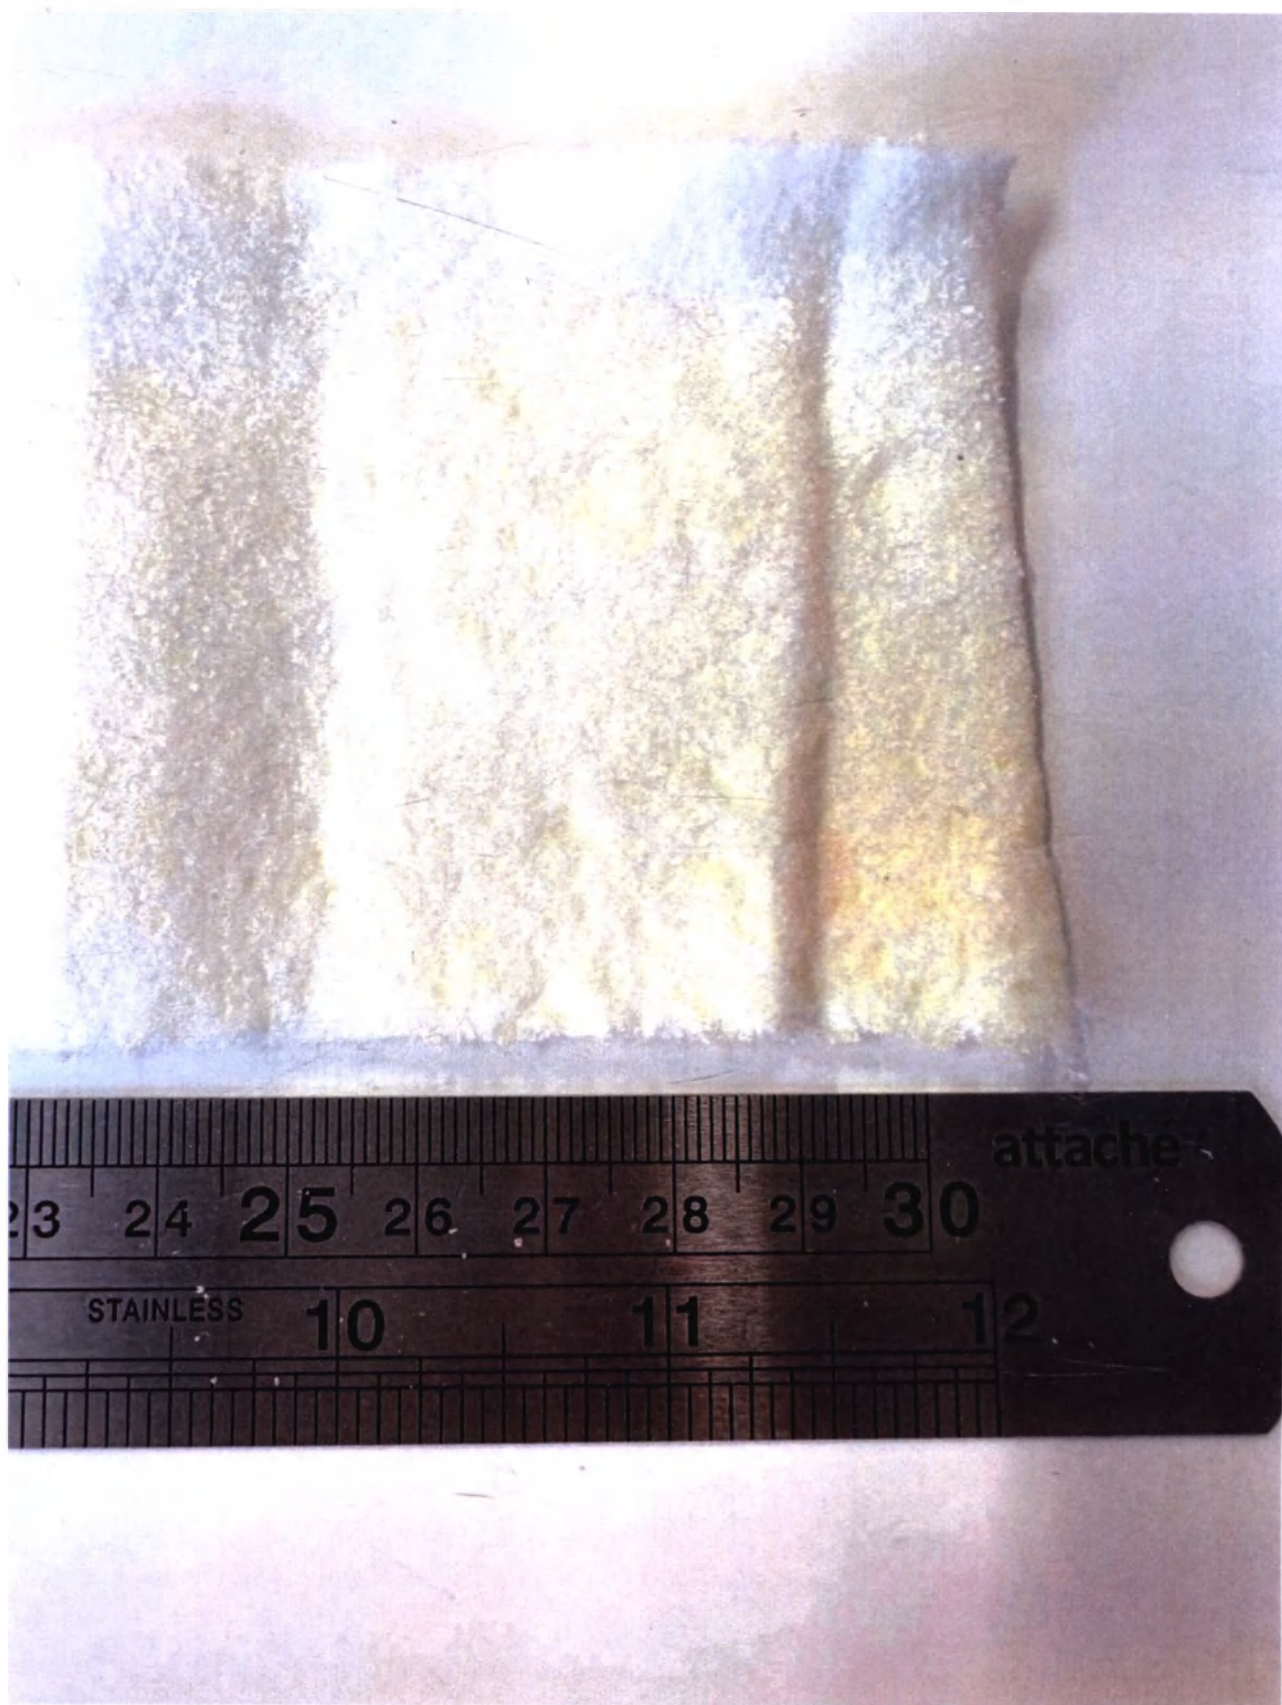



МАРКИРОВКА, НАНОСИМАЯ НА ТРАНСПОРТНУЮ УПАКОВКУ

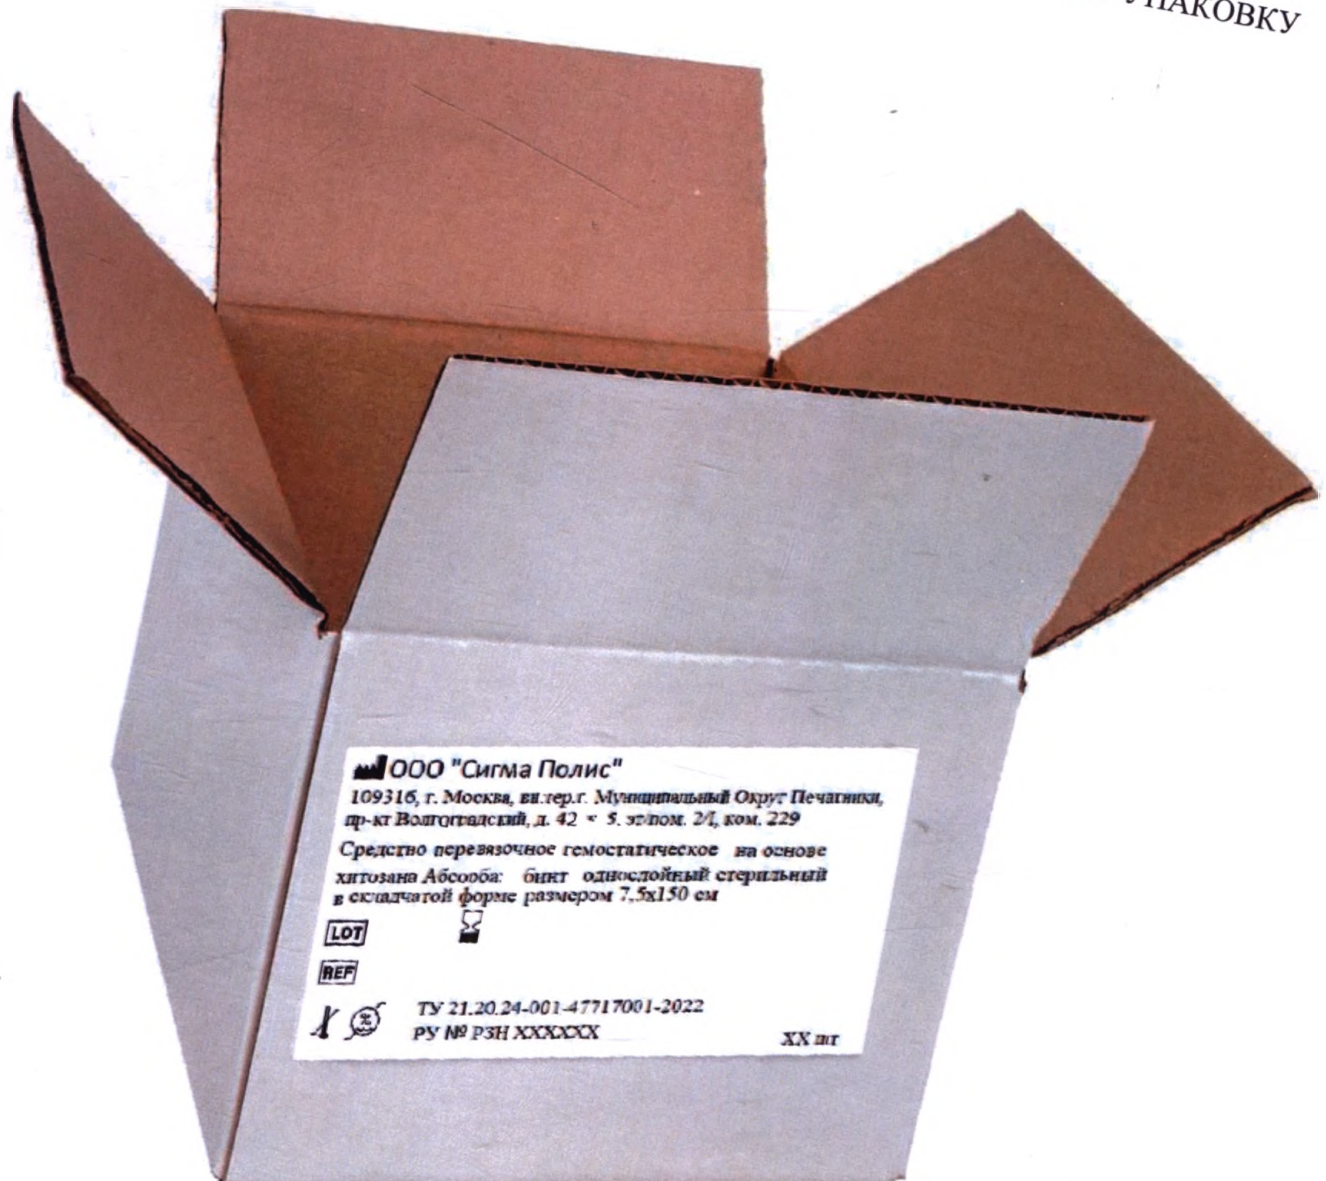

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
14 листа(ов)
Генеральный директор
ООО «Сигма Полис»
Мазырко В. А.

