



ООО «ФЛОГИСТОН-МЕД»

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор

ООО «Флогистон-МЕД»

 Сердюков С.П.
«15» мая 2019 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Флюороскопическая рентгеновская установка
С-дуга КМС-950 с принадлежностями

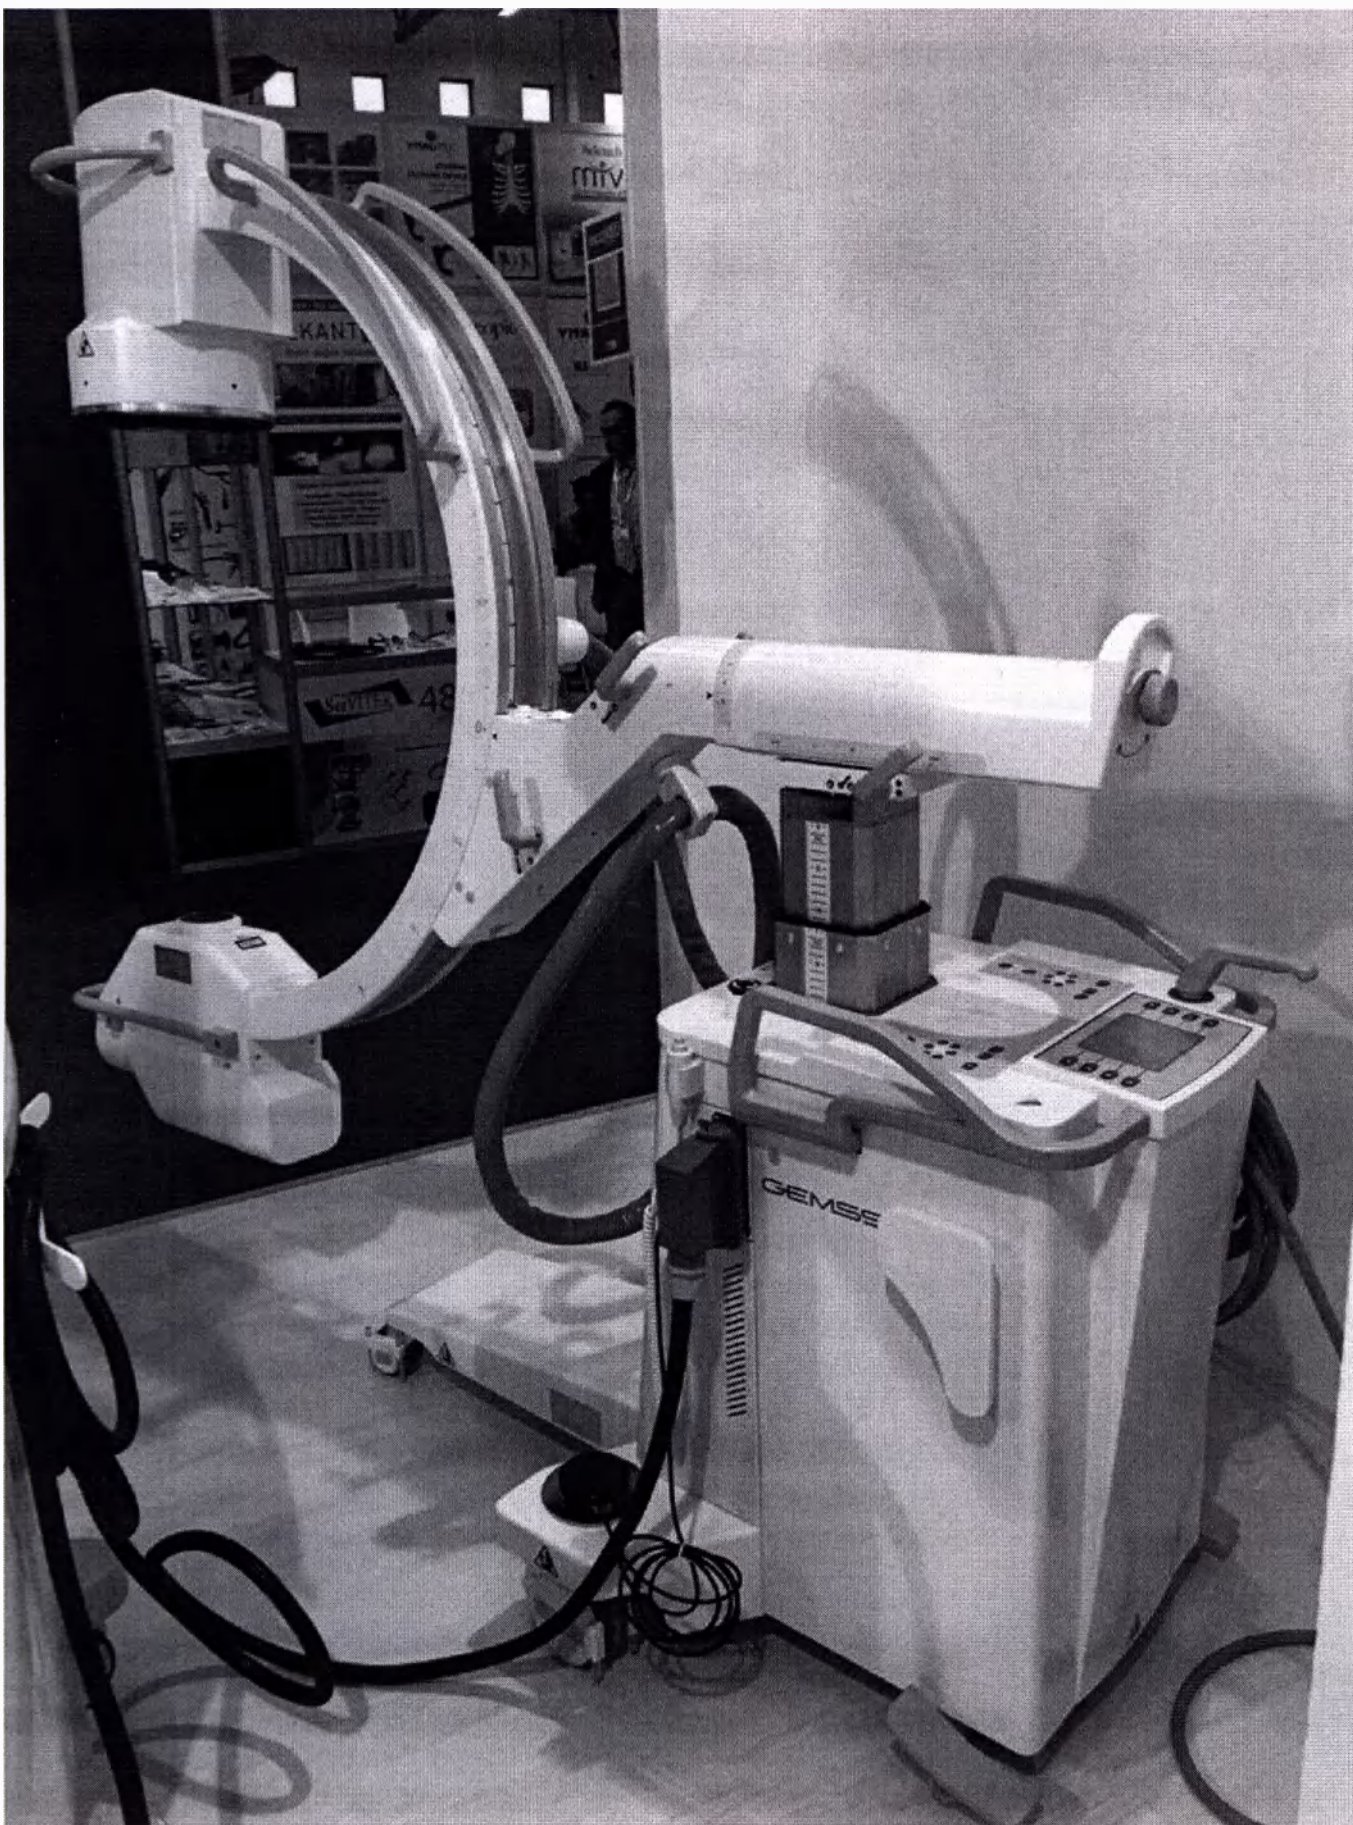


Рис. 1 - Штатив типа С-ДУГА на тележке с пультом управления, рентгеновским генератором и коллиматором

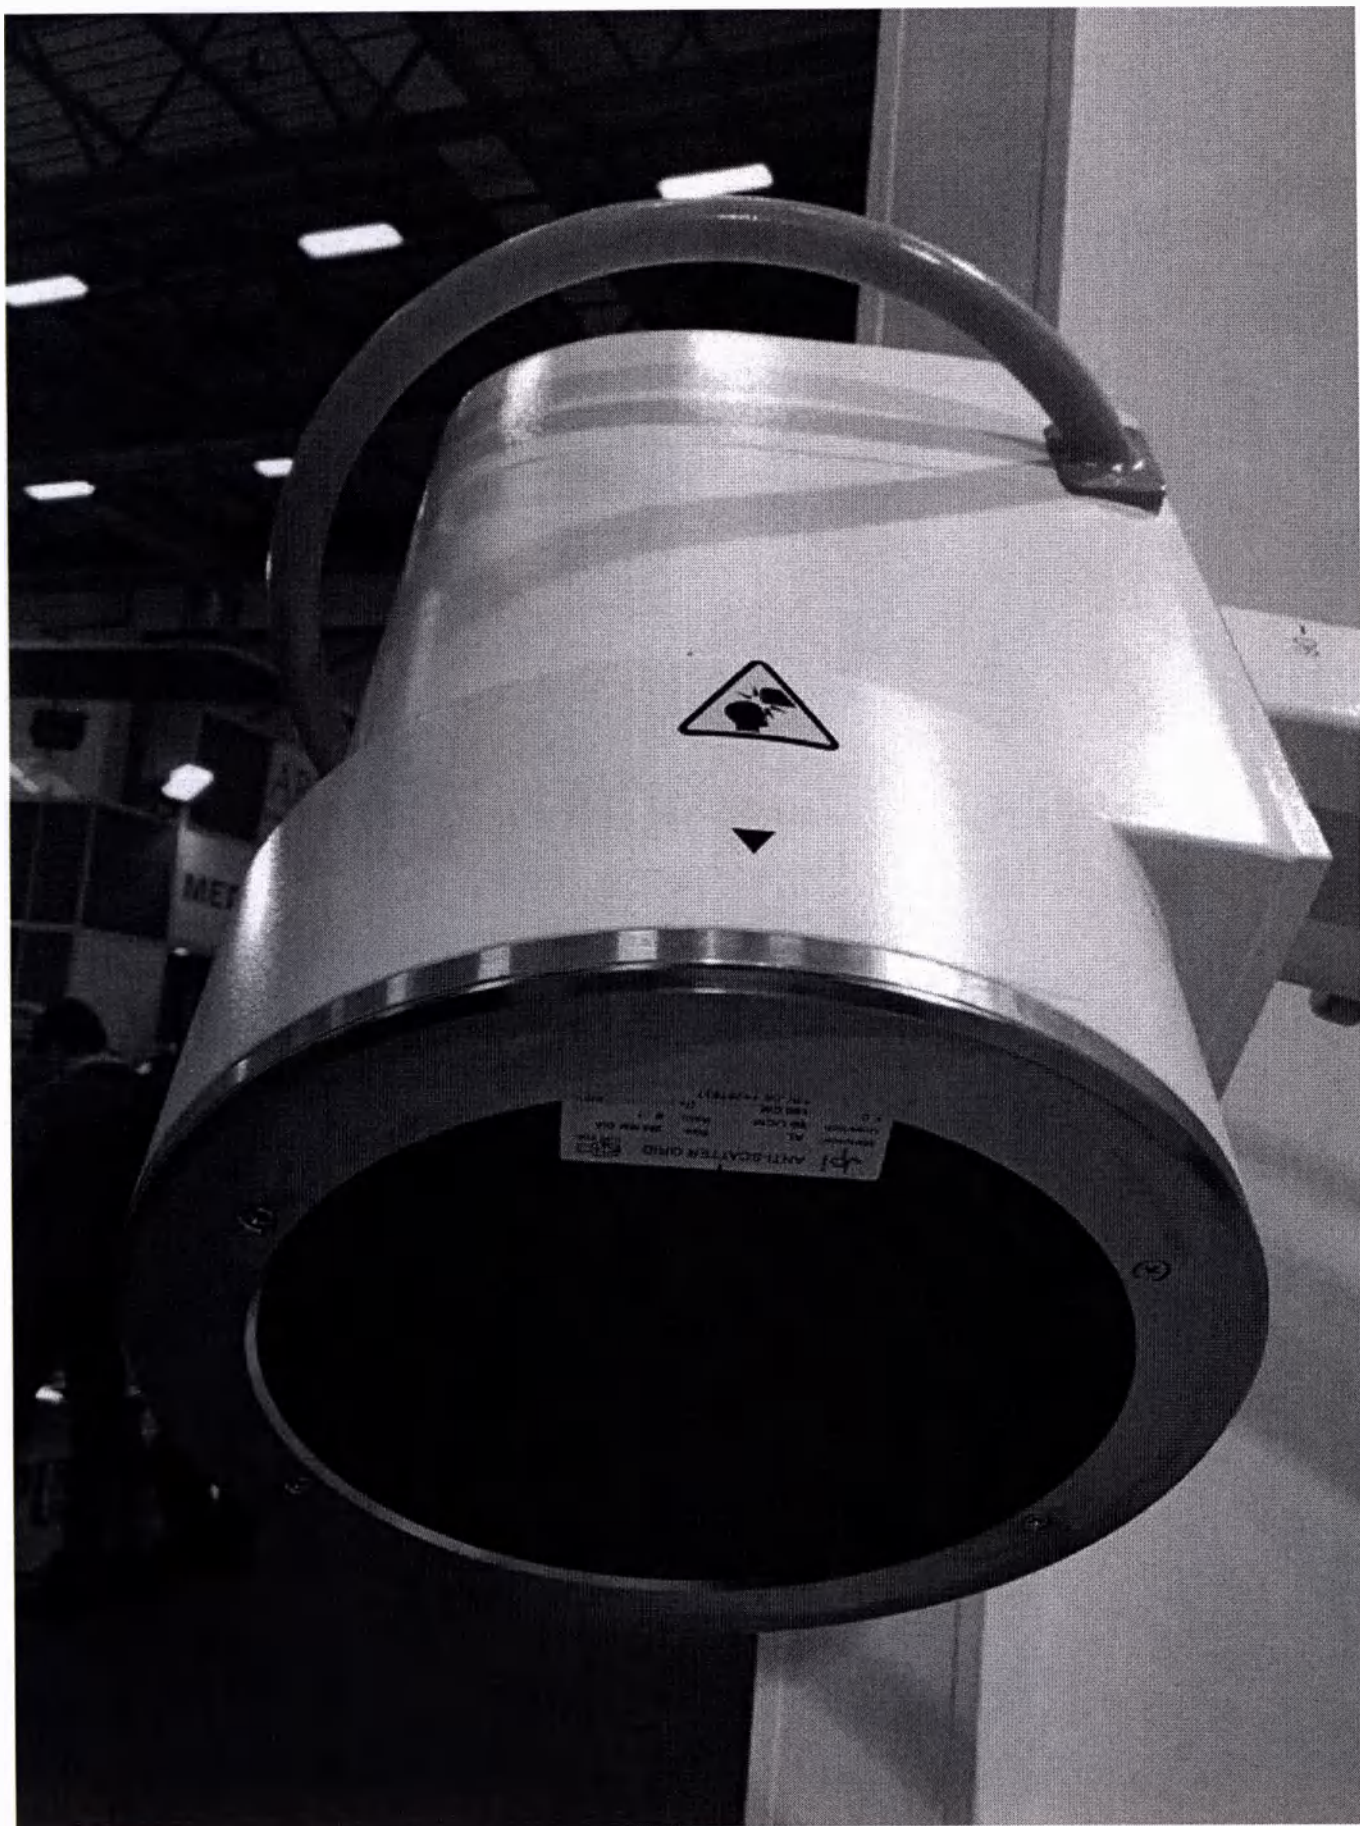


Рис.2 - Усилитель рентгеновского изображения

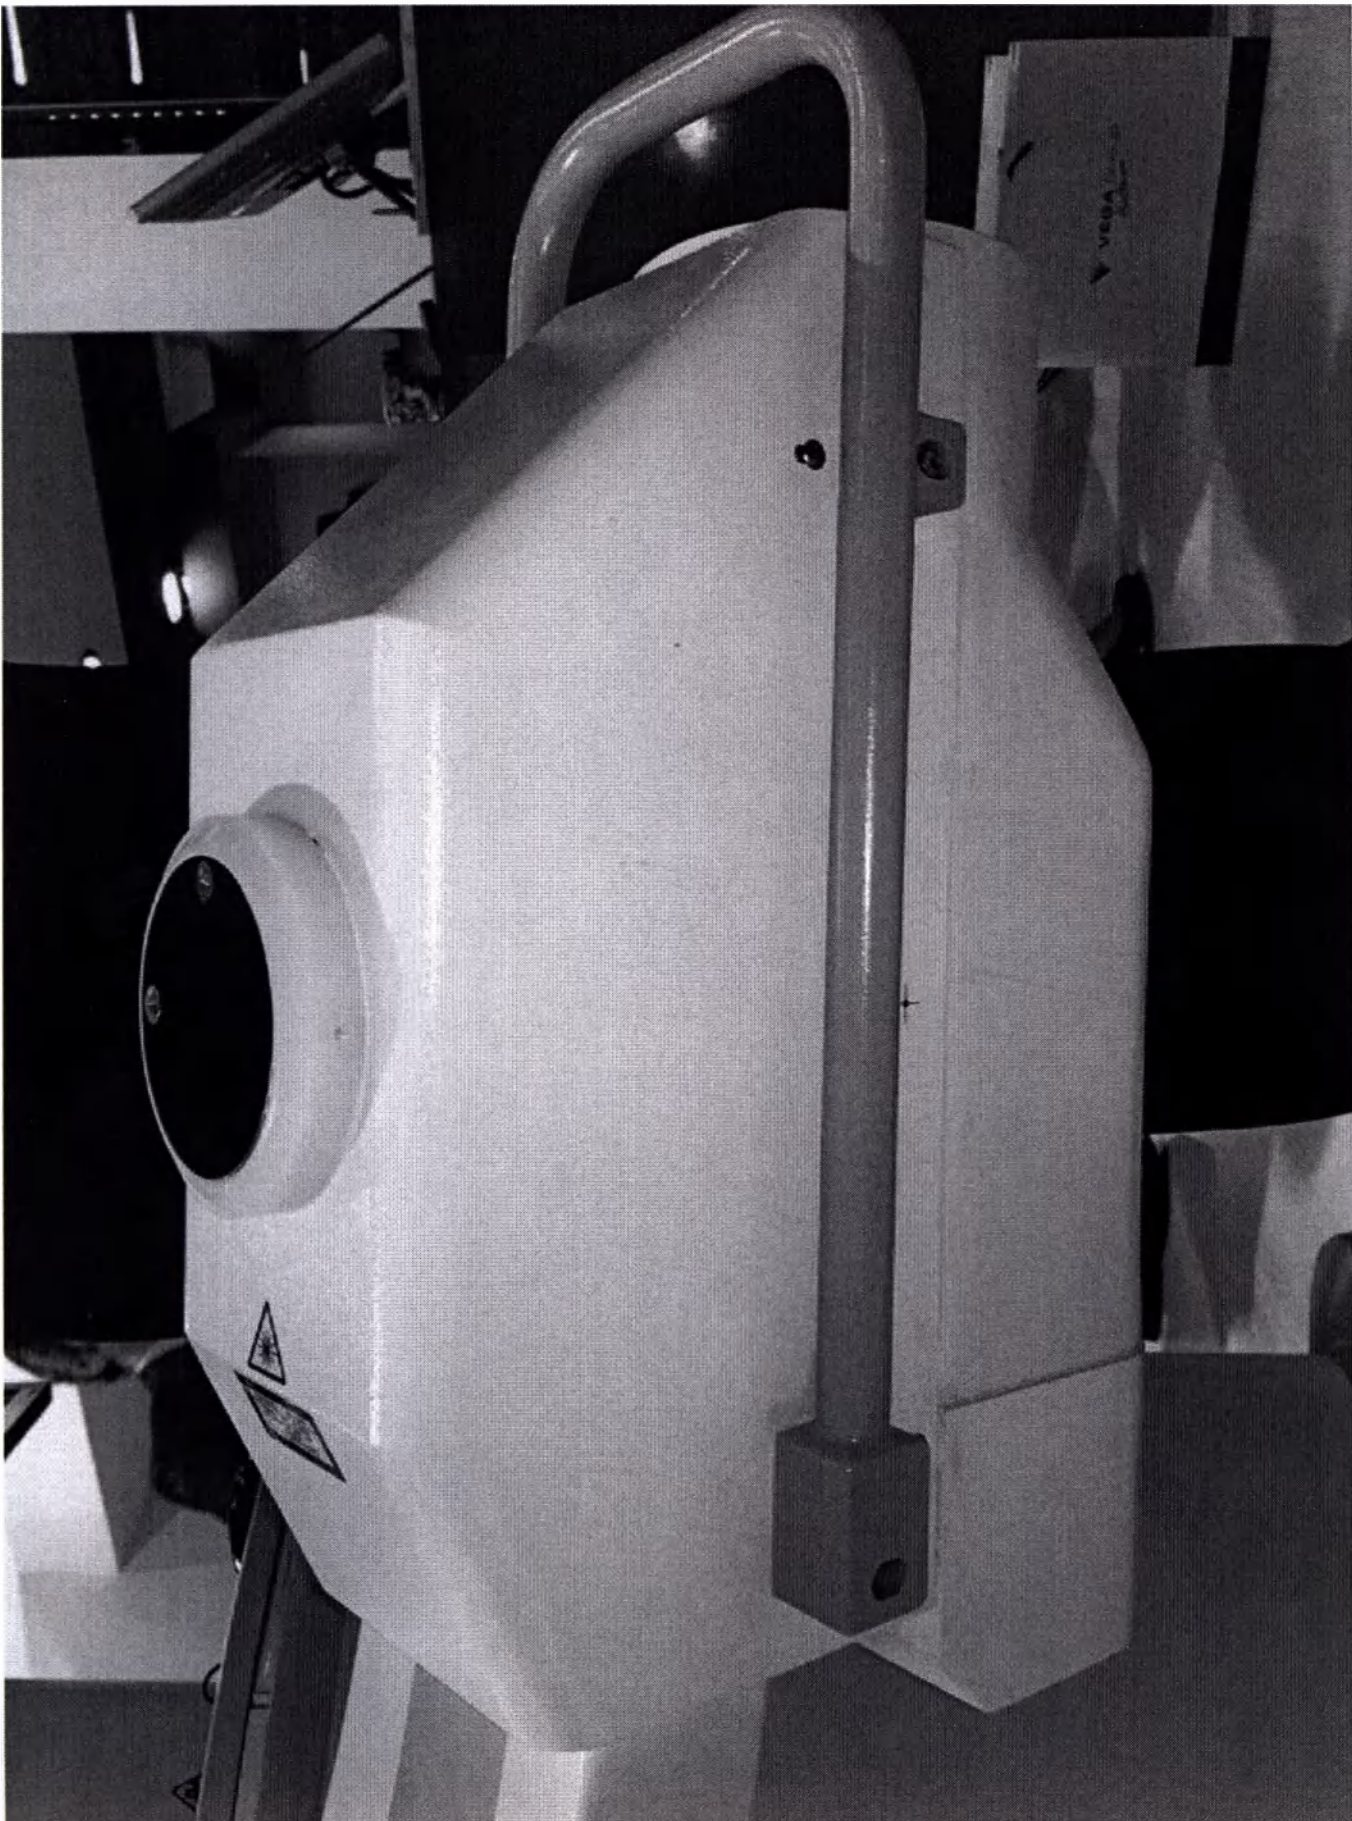


Рис.3 – Рентгеновский излучатель

адлежности:



Рис.4 - Цифровое устройство обработки изображения на тележке



Рис.5 - Монитор к цифровому устройству обработки изображения - 2 шт

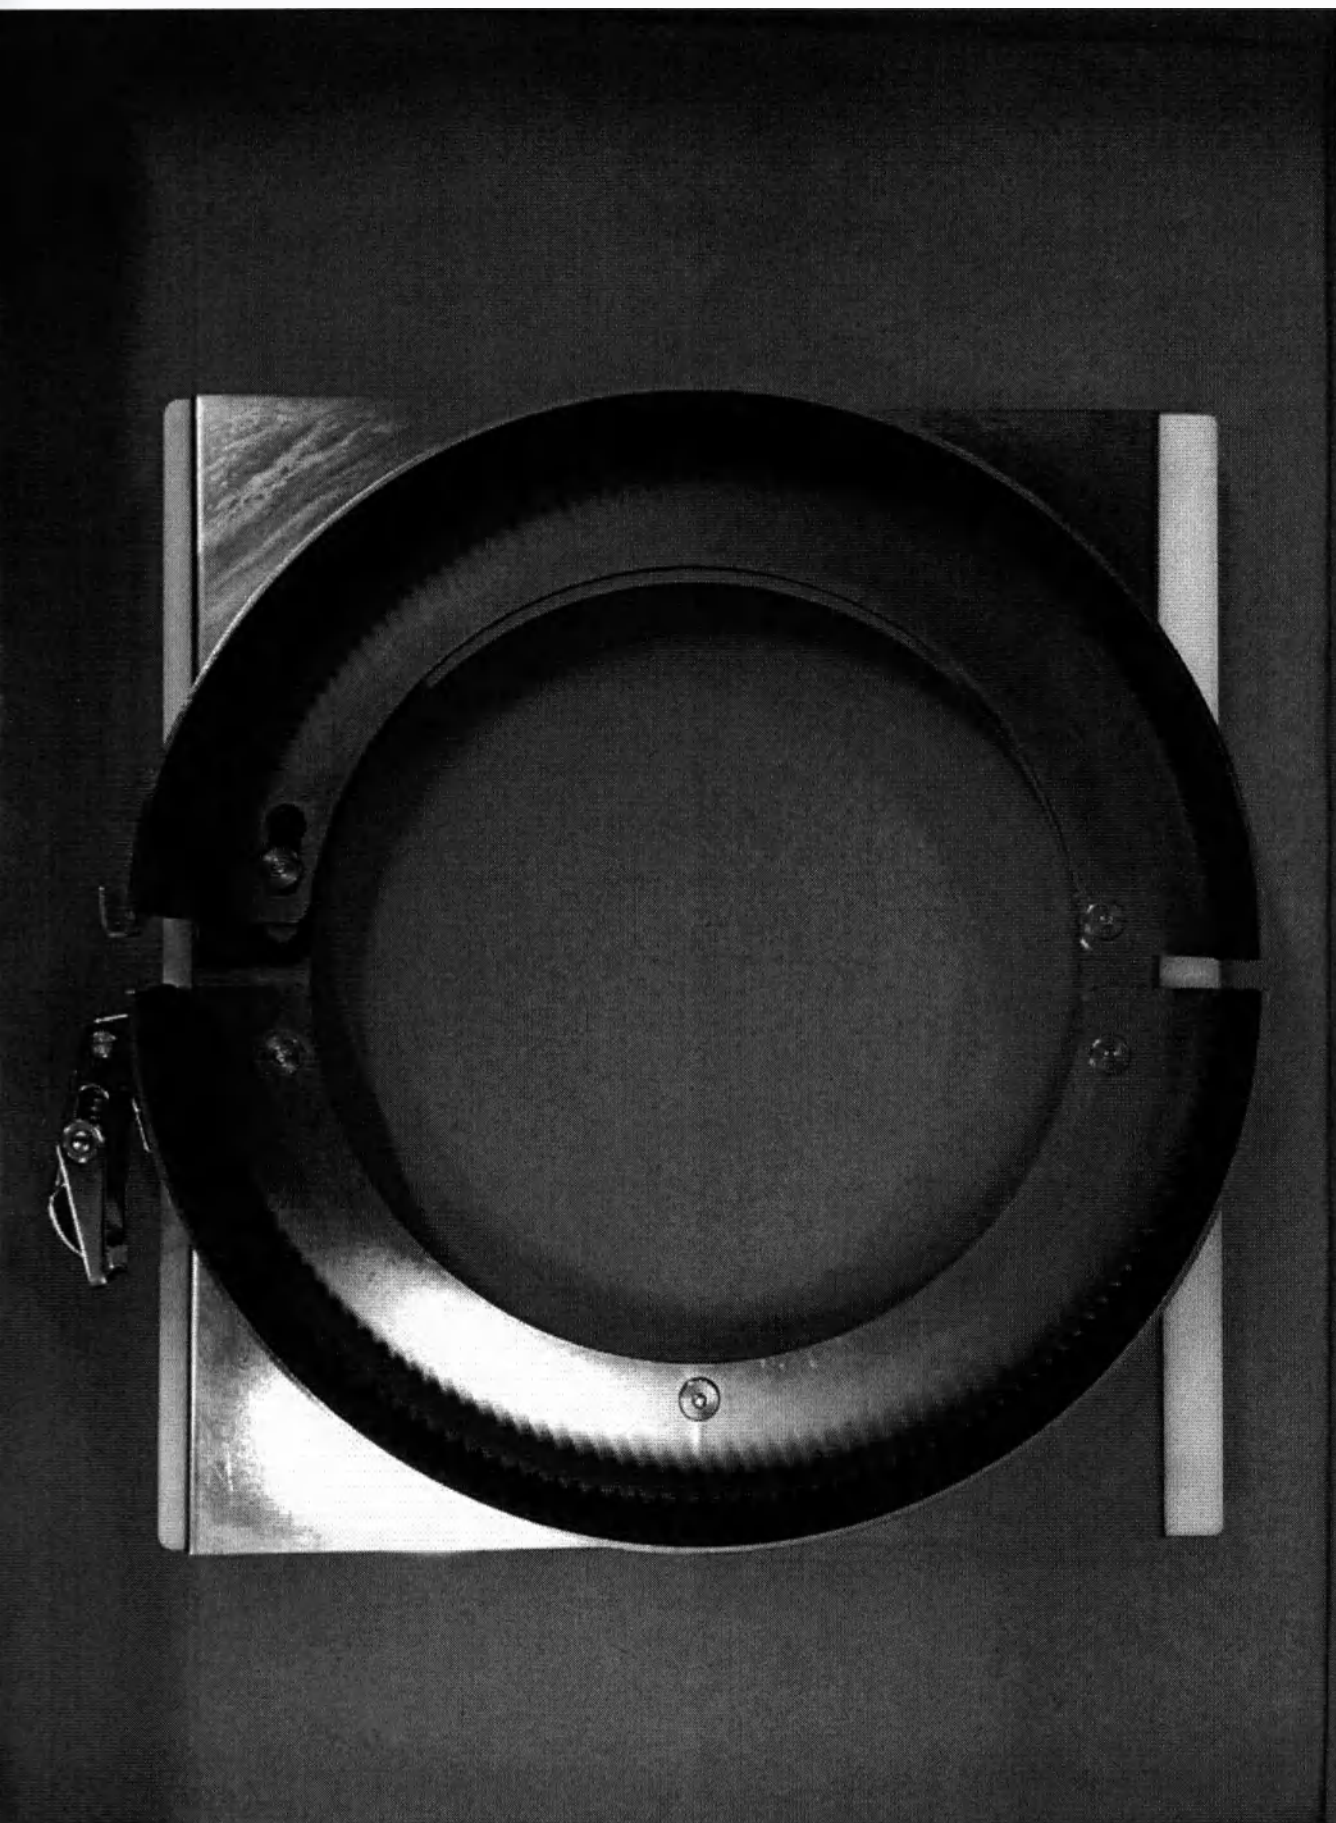


Рис.6 - Держатель рентгеновской кассеты



Рис.8 - Ножной переключатель

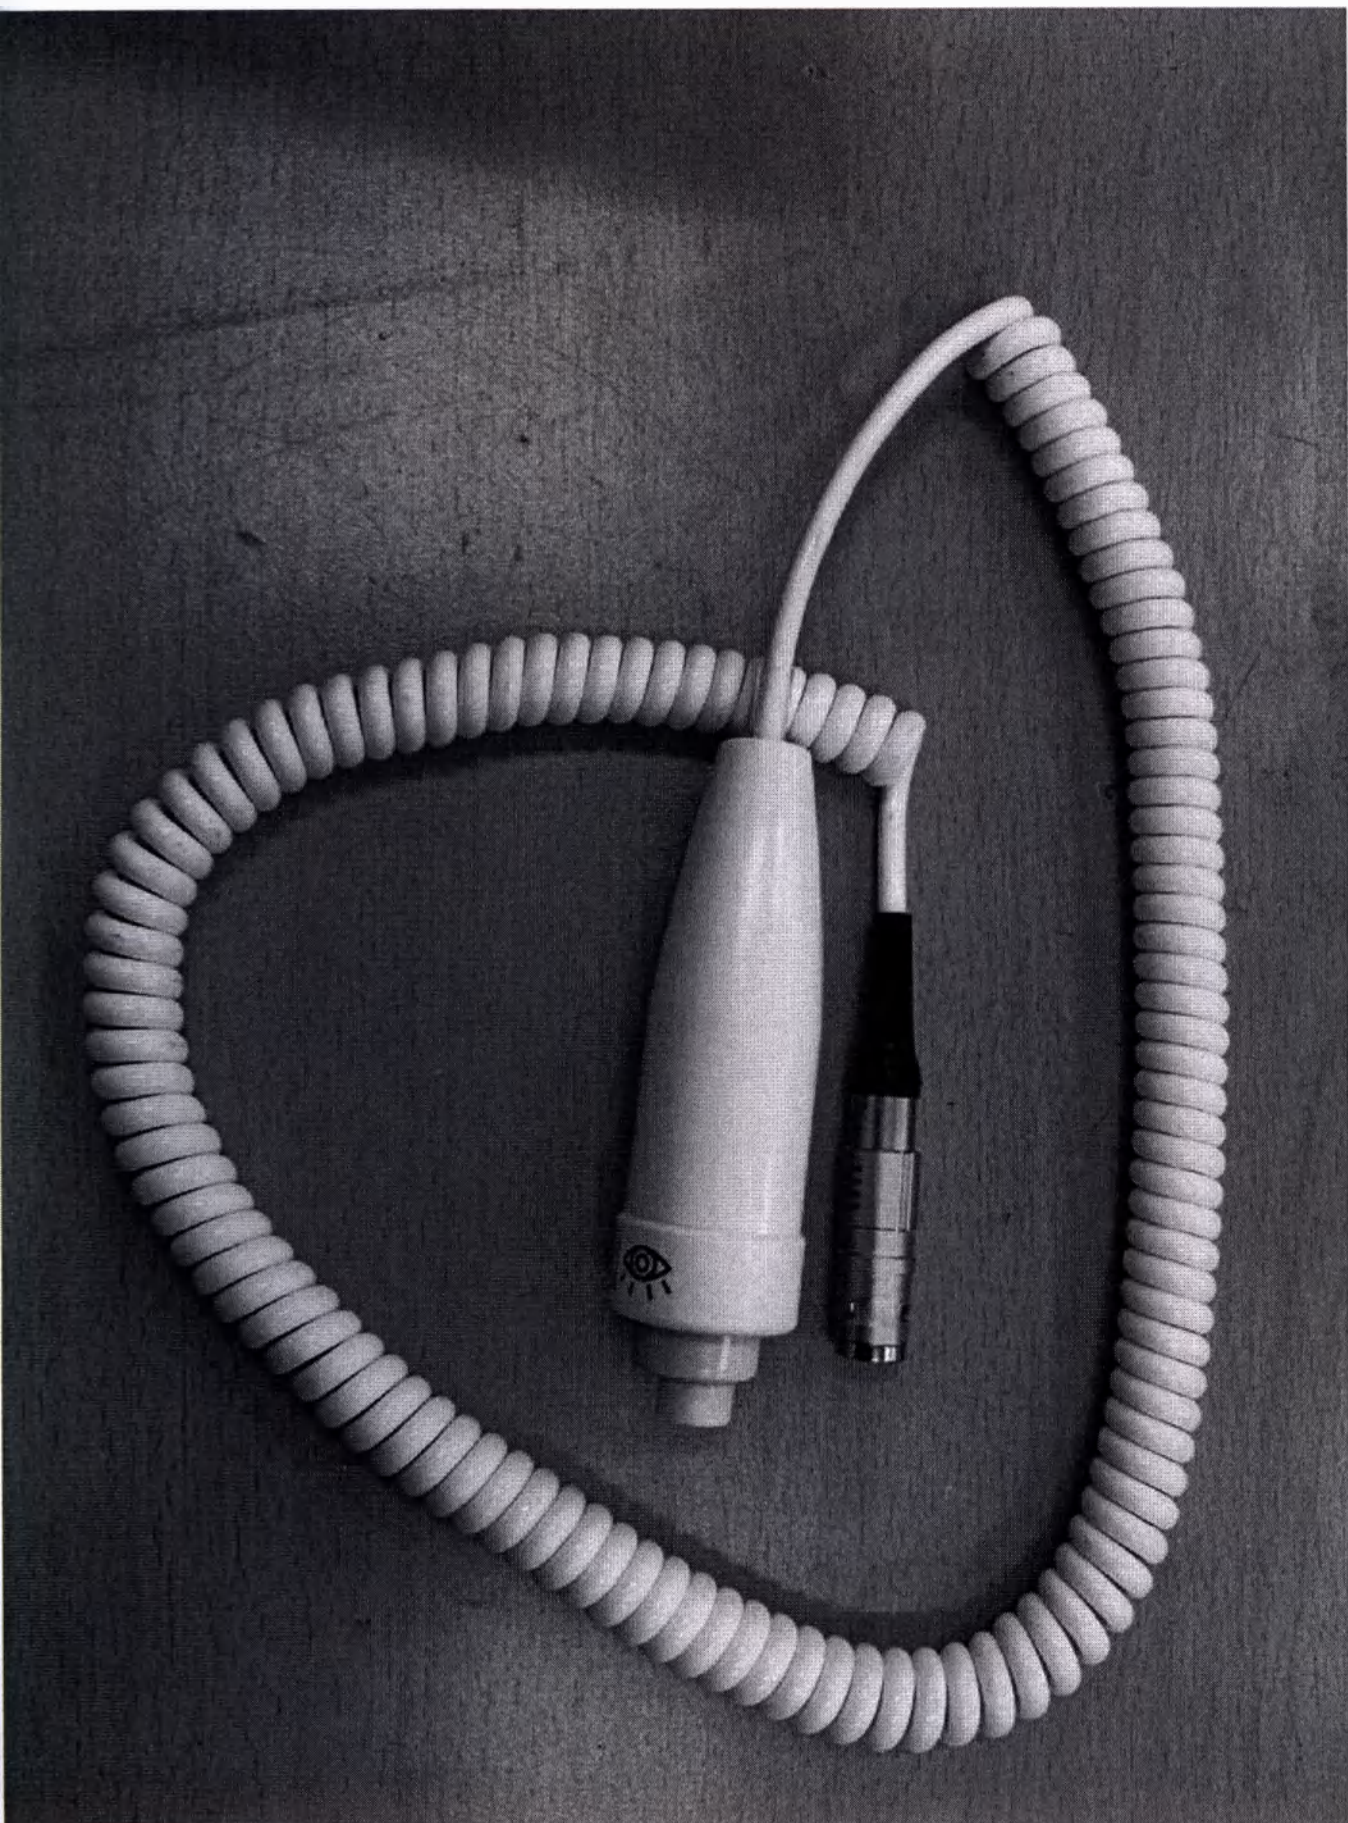


Рис.9 - Ручной выключатель



Рис.10 - Шнур питания

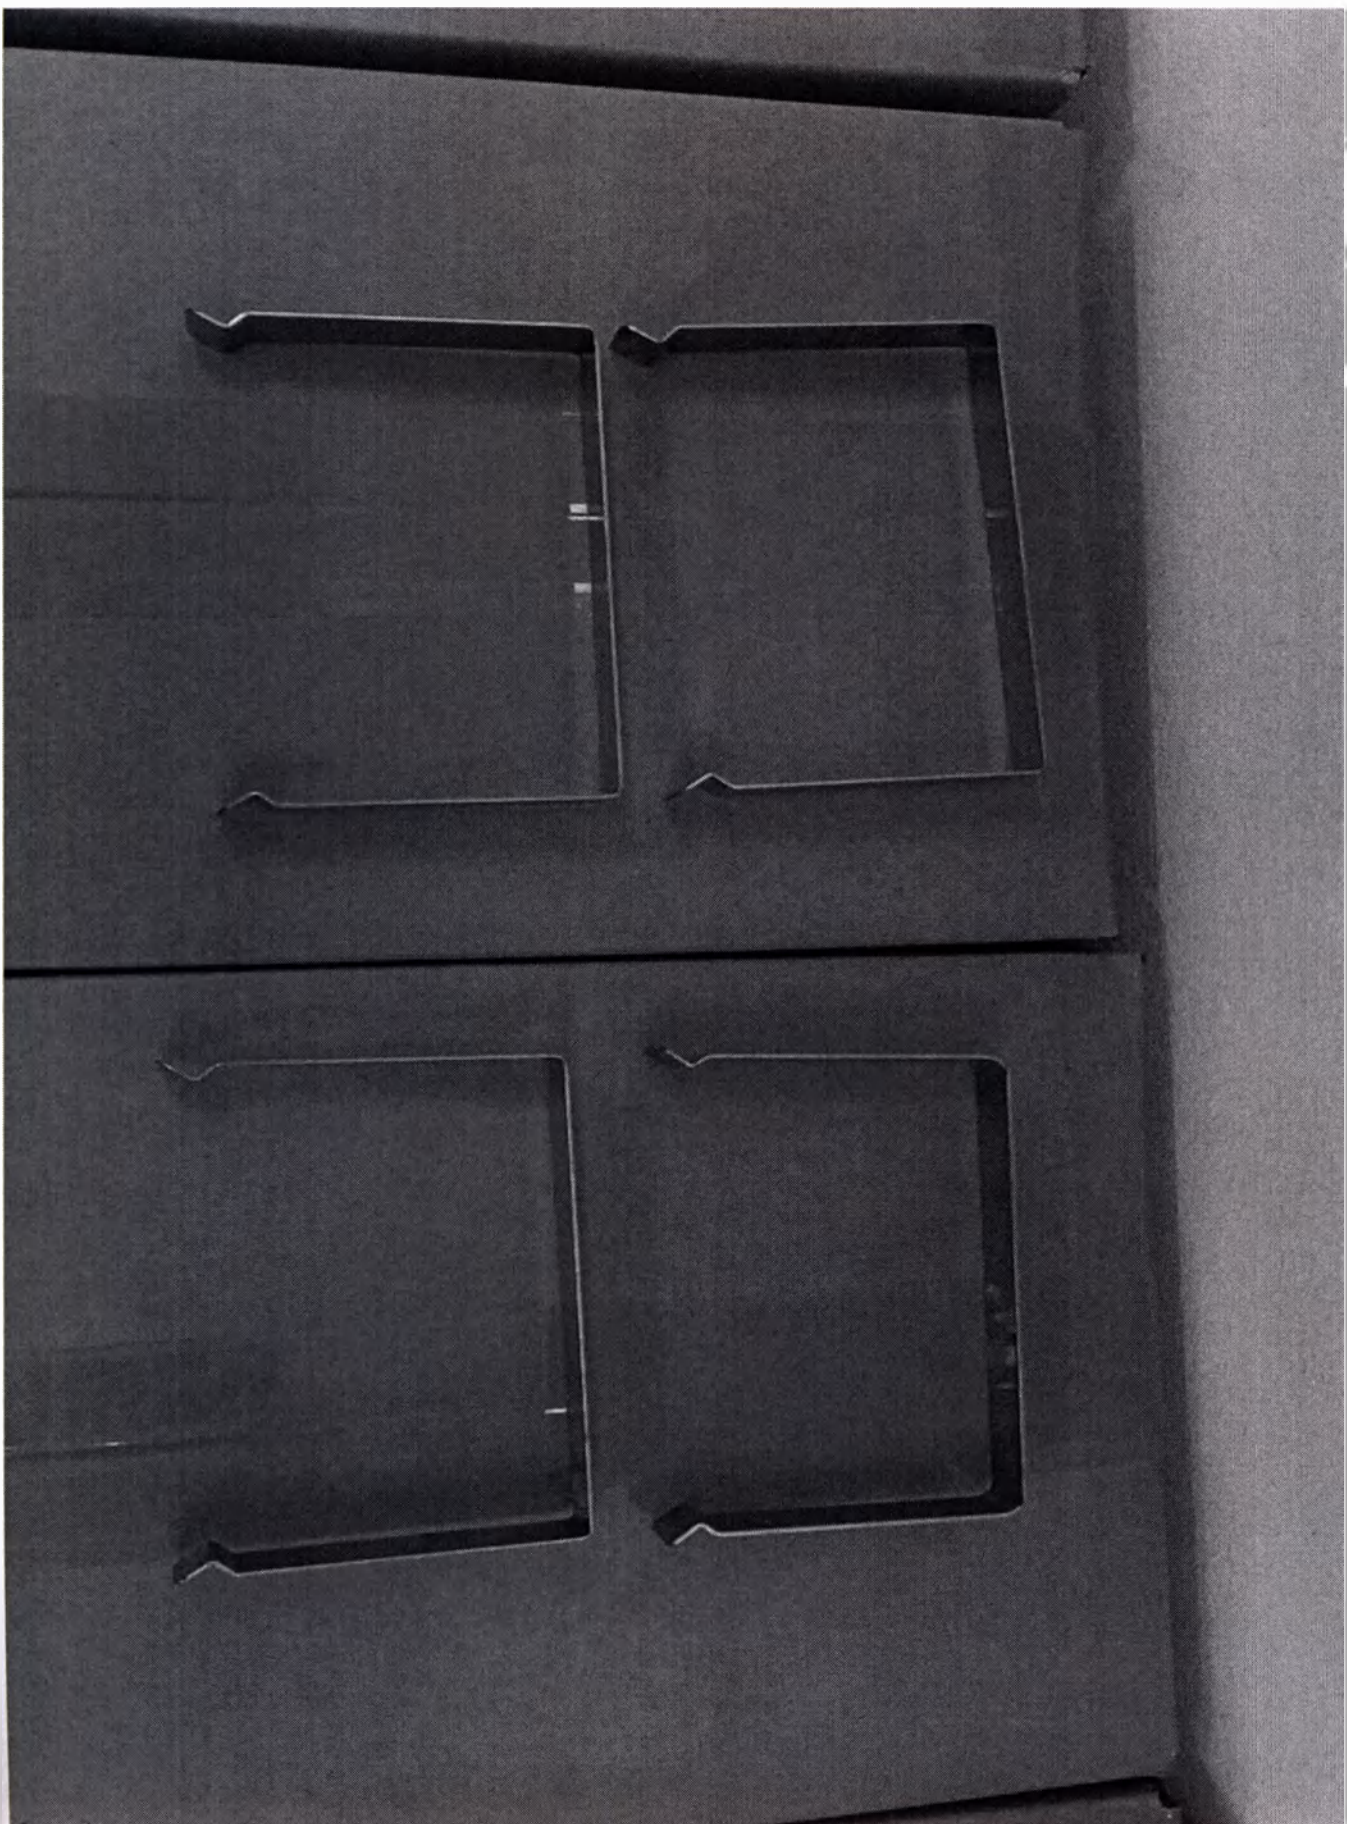


Рис.11 - Крепления штатива - 4 шт

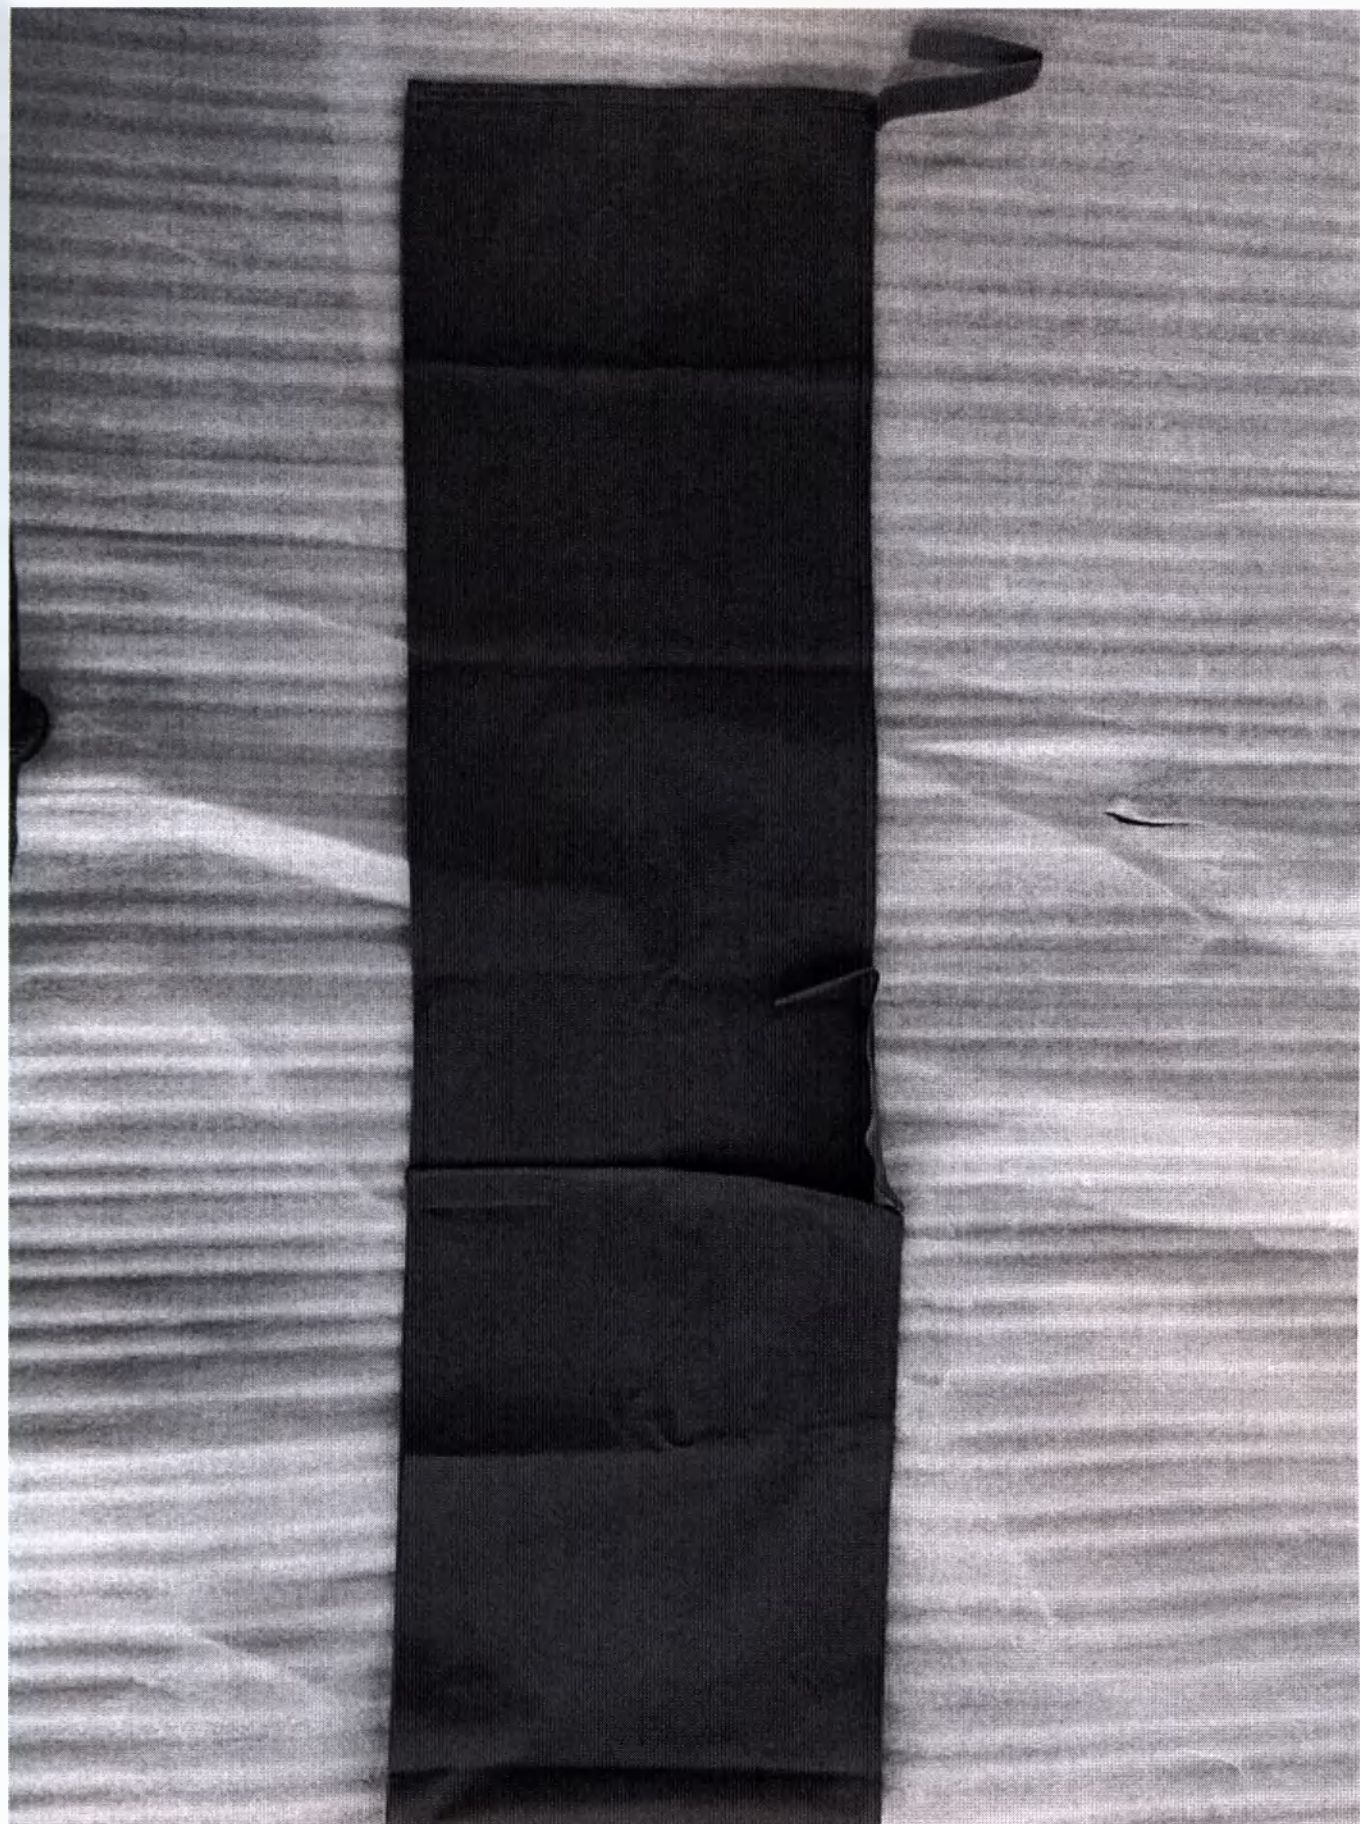


Рис.12 - Покровная ткань для штатива типа С-ДУГА стерилизуемая



Рис.13 - Покровная ткань для усилителя рентгеновского изображения стерилизуемая



Рис.14 - Покровная ткань для рентгеновского излучателя стерилизуемая

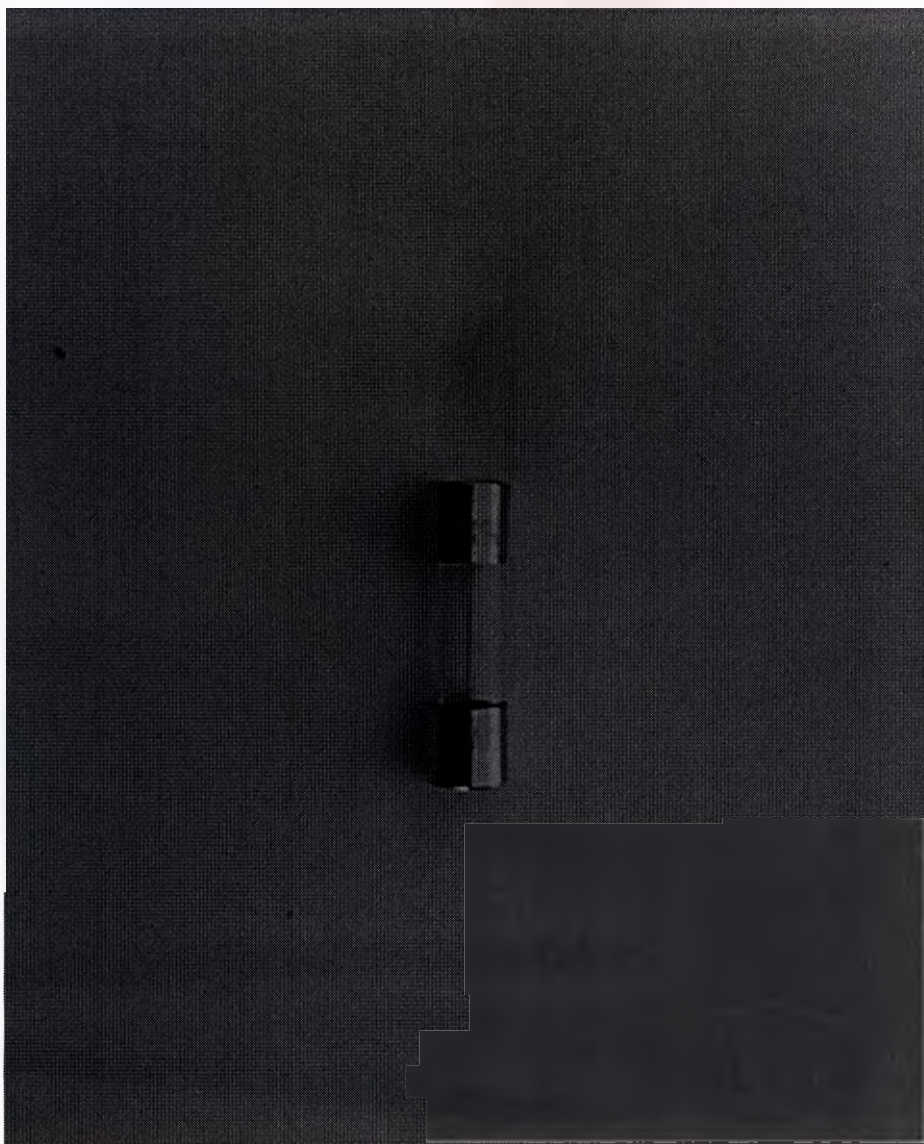


Рис.15 - Предохранитель 3,15 Амп

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

16 (шестнадцать) листов
цифрами прописью

Должность Генеральный директор

Подпись Нердюков С.П.

20 19 г. М.П.