

Согласовано

Общество с ограниченной ответственностью КАРЛ ШТОРЦ –
Эндоскопы ВОСТОК (ООО КШТЭ ВОСТОК)

Организация

Россия, 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, 7, стр. 4
Адрес

Генеральный директор
Должность

Мартин Пьер Колас
Фамилия, Имя

08.08.2023
Дата ДД.ММ.ГГГГ

Подпись/Signature



Фотографические изображения

Эзофагоскоп жесткий HOPKINS с принадлежностями

2023



Рис. 1. Эзофагоскоп жесткий HOPKINS с принадлежностями. Транспортная упаковка.



Рис. 2. Эзофагоскоп жесткий HOPKINS с принадлежностями Маркировка на транспортной упаковке.



Рис. 3. Эзофагоскоп жесткий HOPKINS (вид 144970), направление наблюдения 0°, диаметр 5,5 мм, длина 53 см. Упаковка.



Рис. 4. Эзофагоскоп жесткий HOPKINS (вид 144970), направление наблюдения 0°, диаметр 5,5 мм, длина 53 см. Маркировка на упаковке.

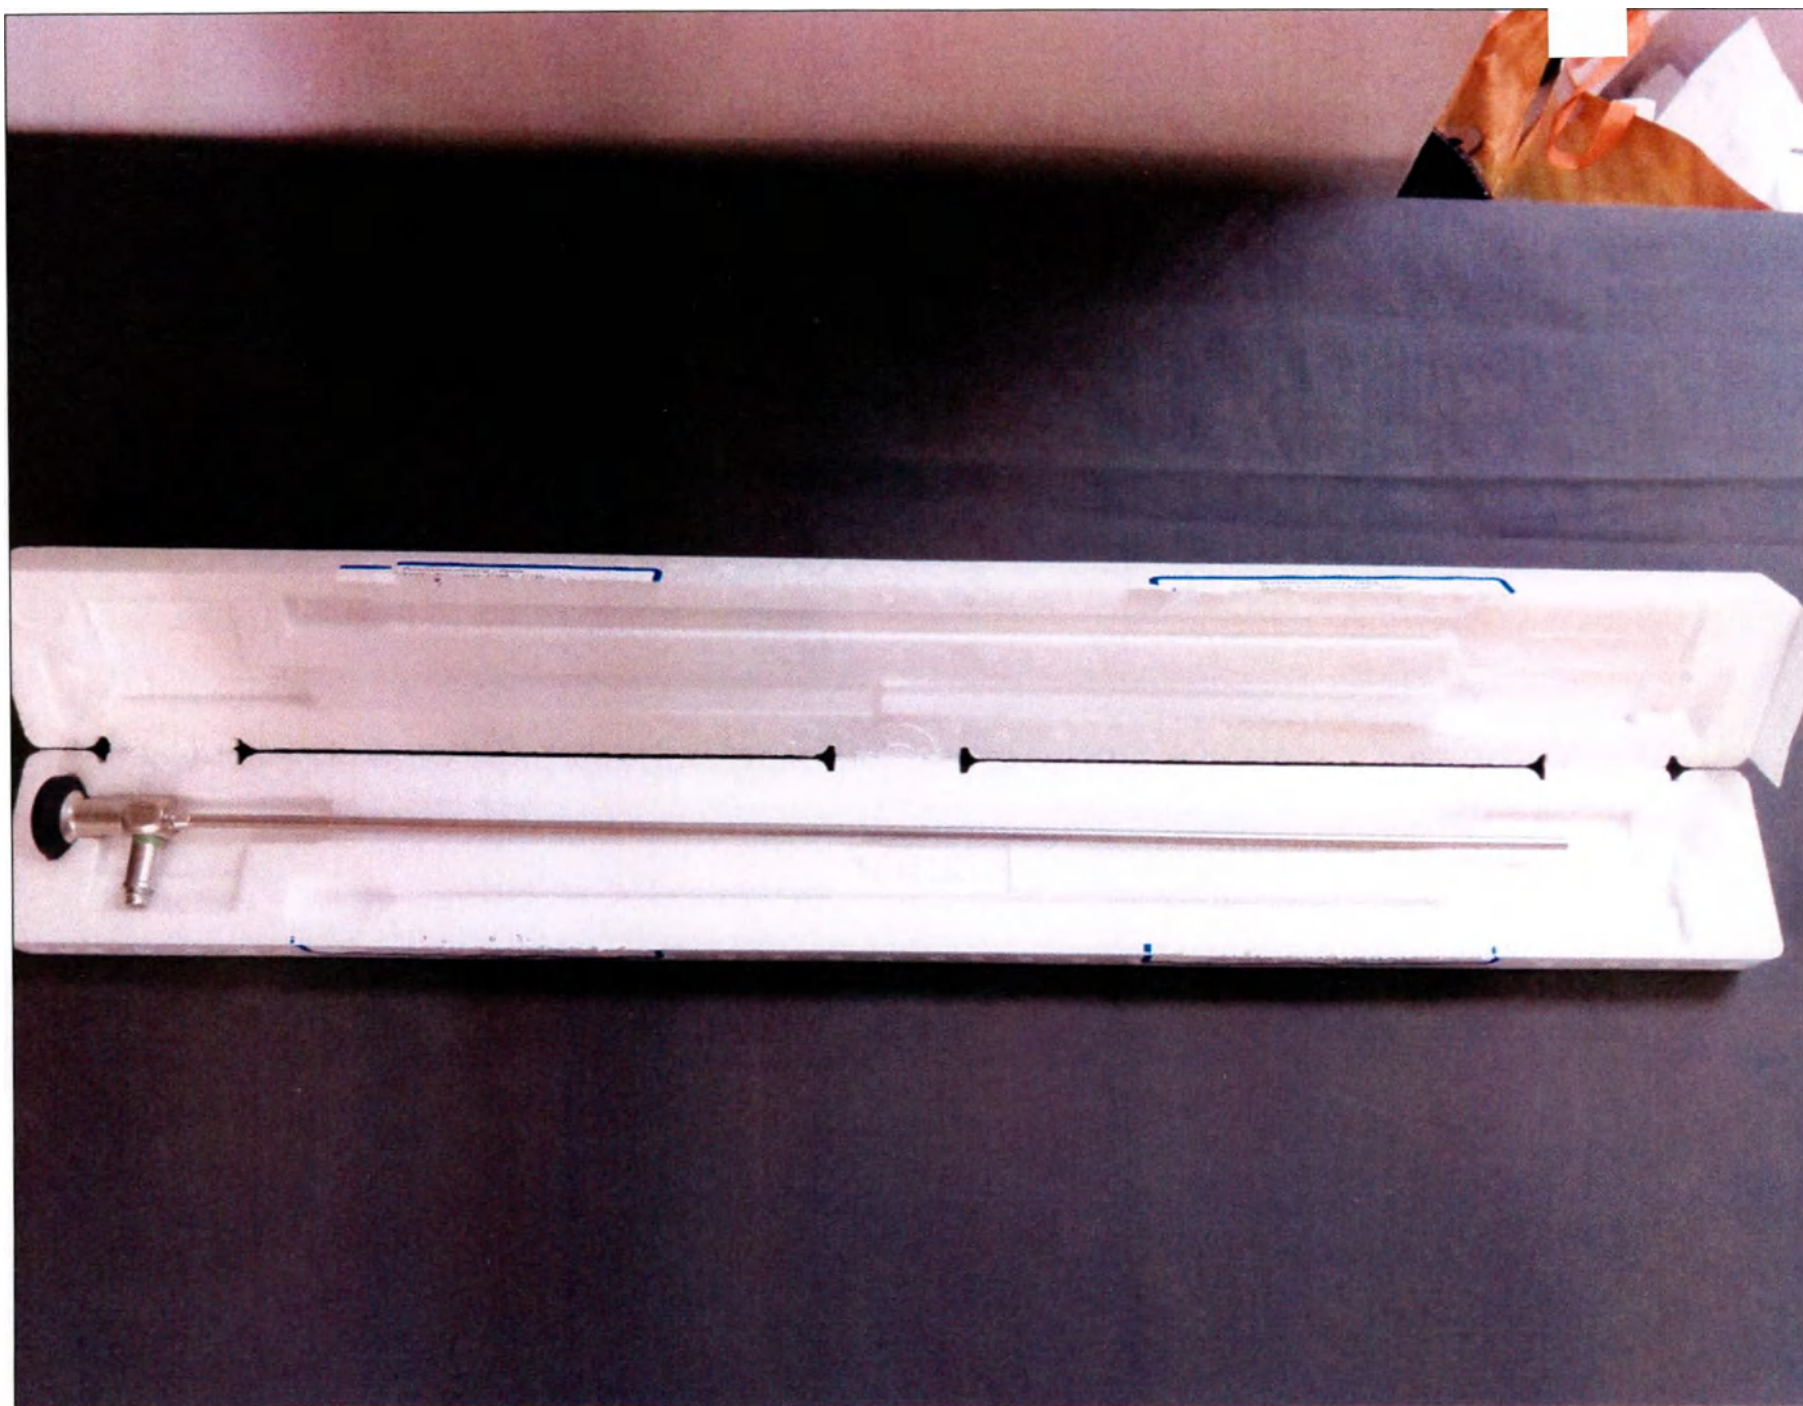


Рис. 5. Эзофагоскоп жесткий НОРКИНС (вид 144970), направление наблюдения 0° , диаметр 5,5 мм, длина 53 см.

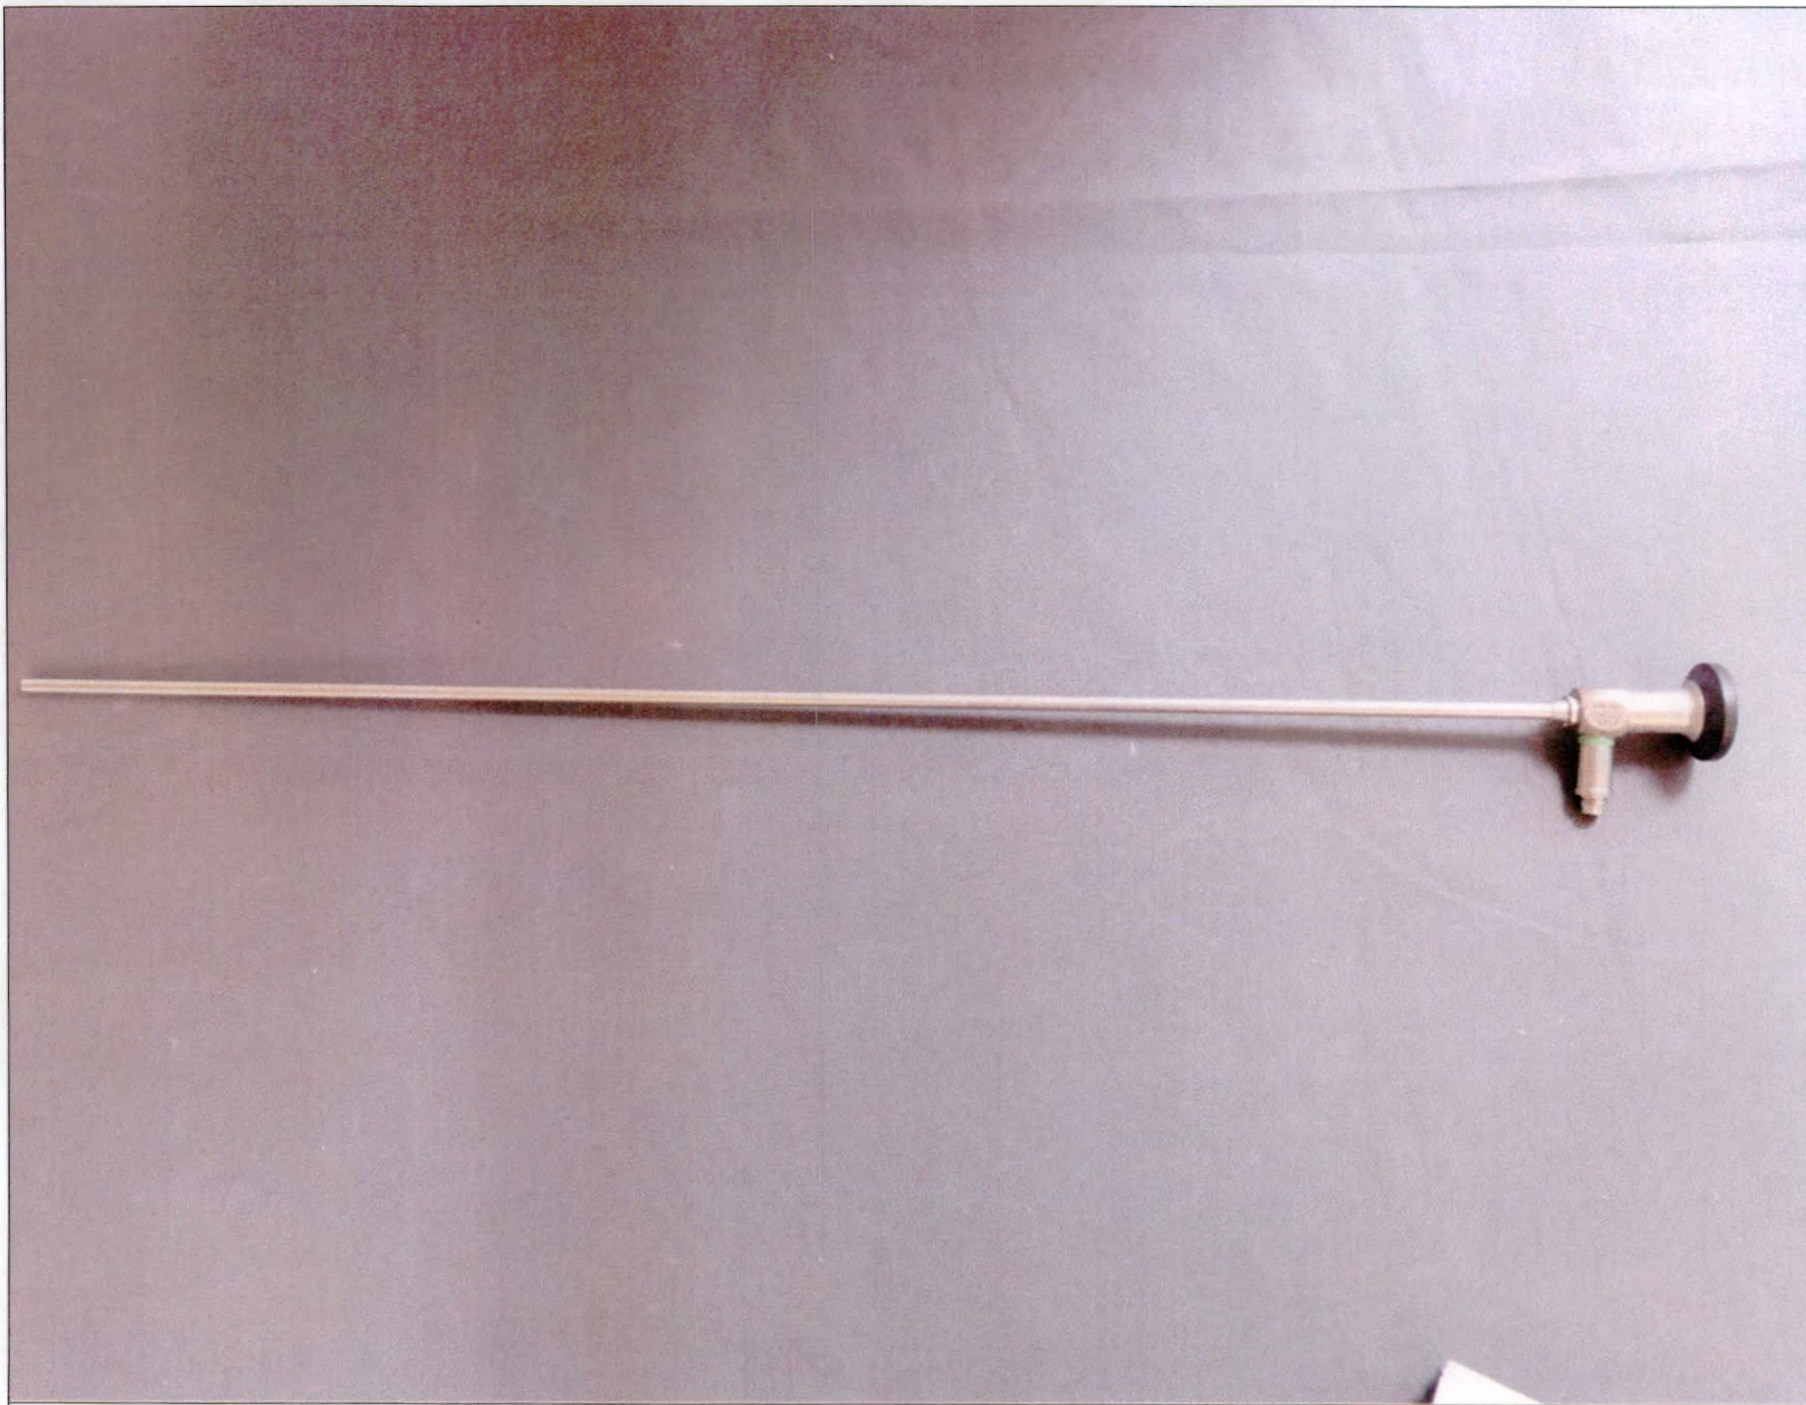


Рис. 6. Эзофагоскоп

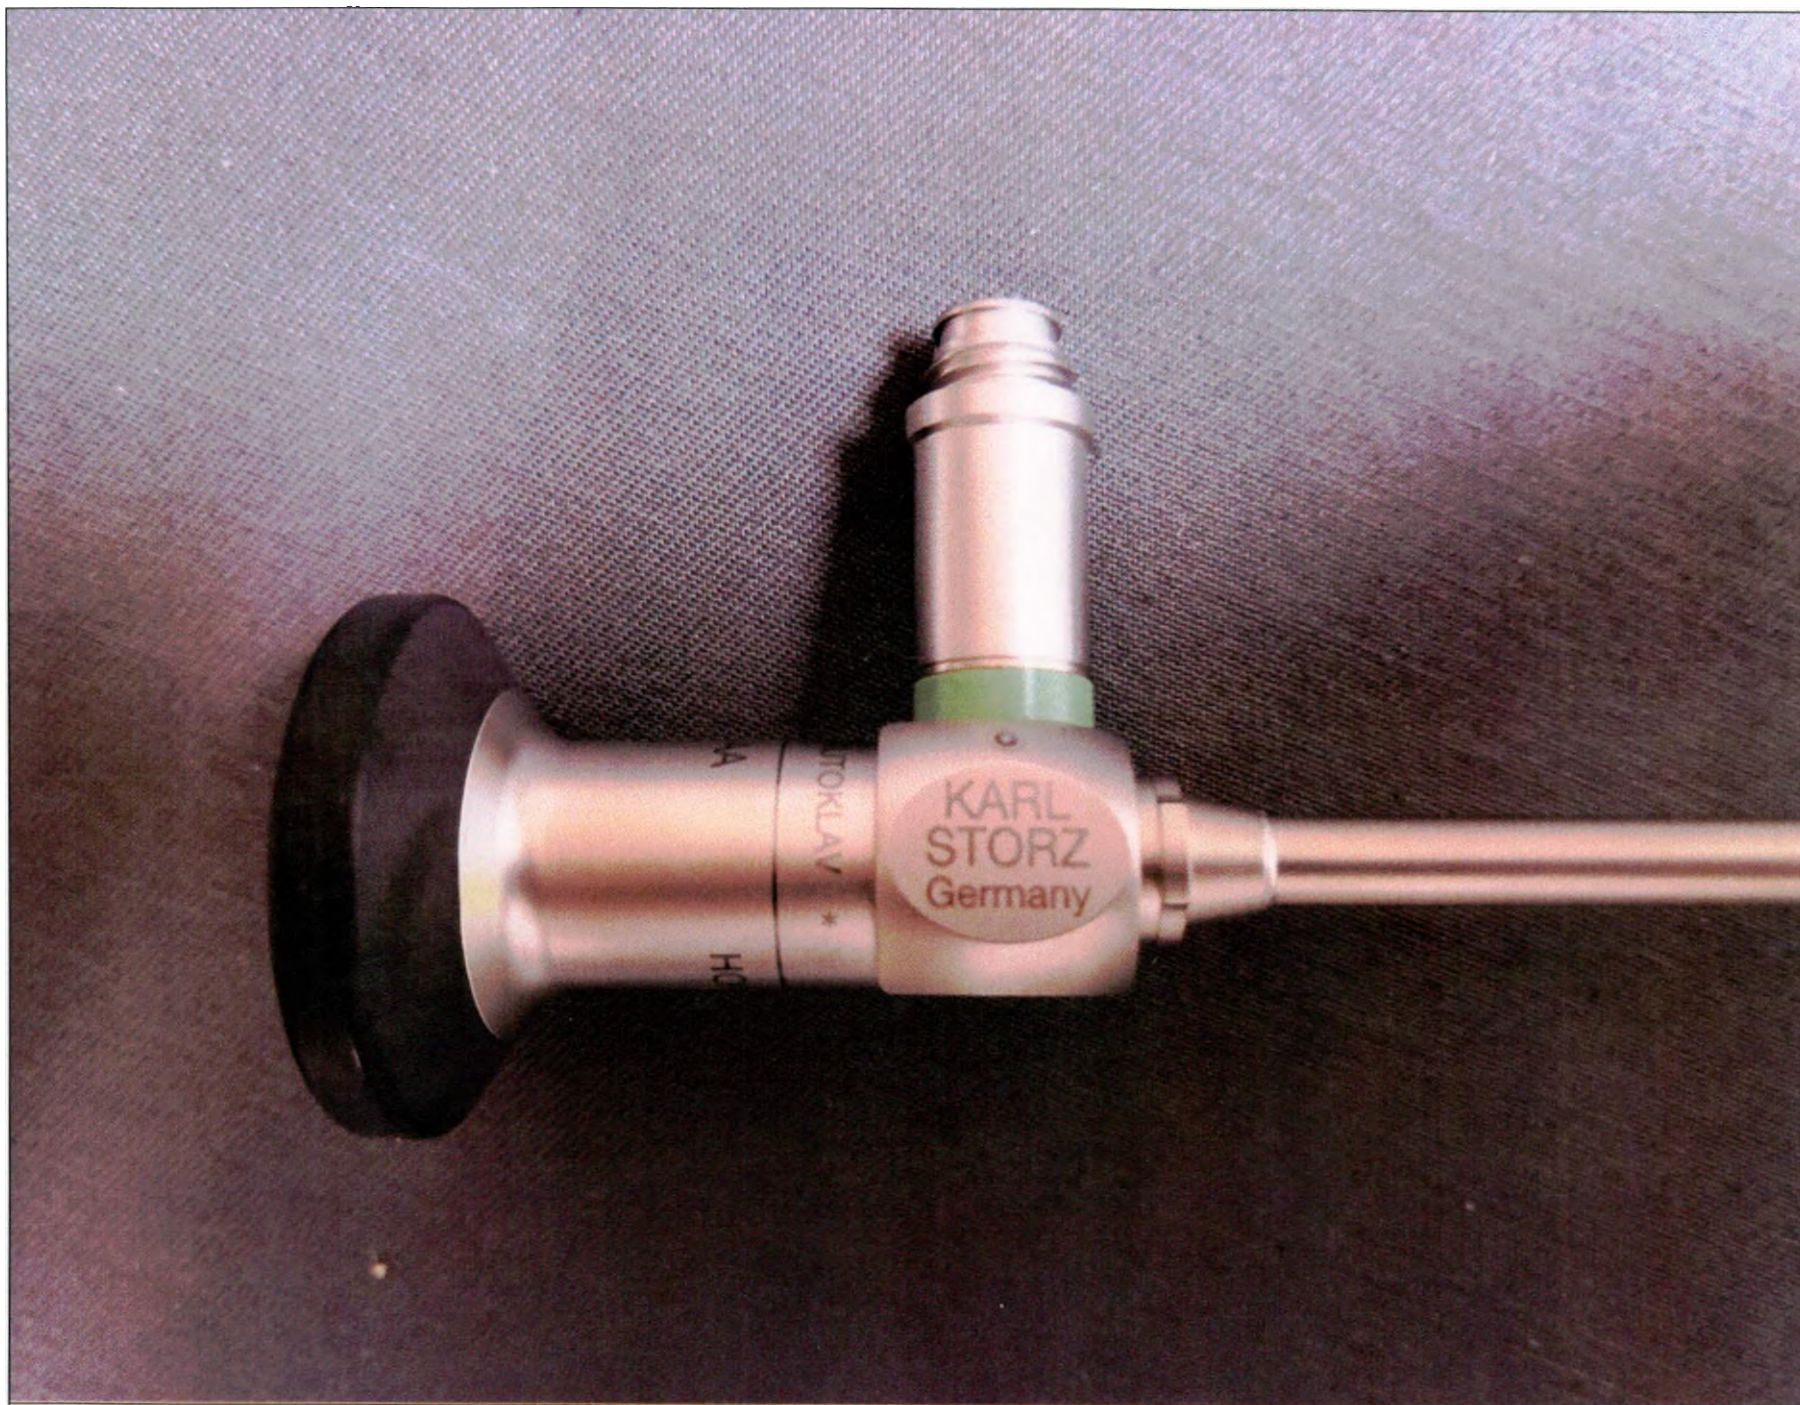


Рис. 7. Эзофагоскоп



Рис. 8. Эзофагоскоп



Рис. 9. Эзофагоскоп

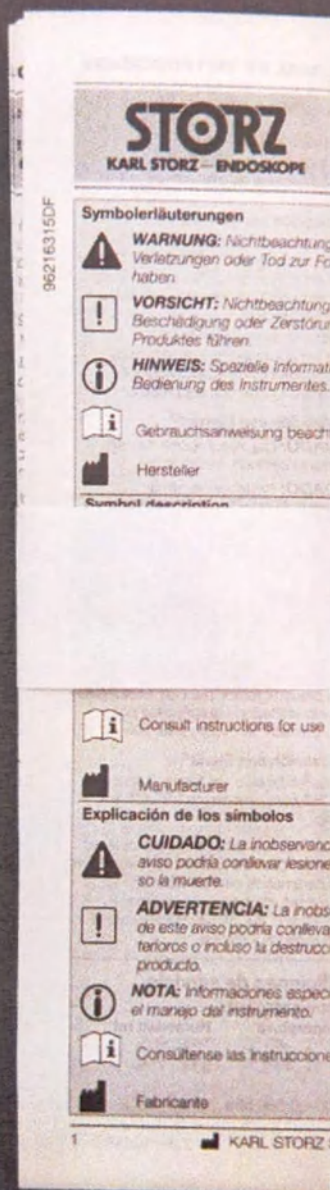


Рис. 10. Инструкция по эксплуатации. Конечный вид может быть изменен, содержание будет приведено в соответствие с документом в регистрационном досье.

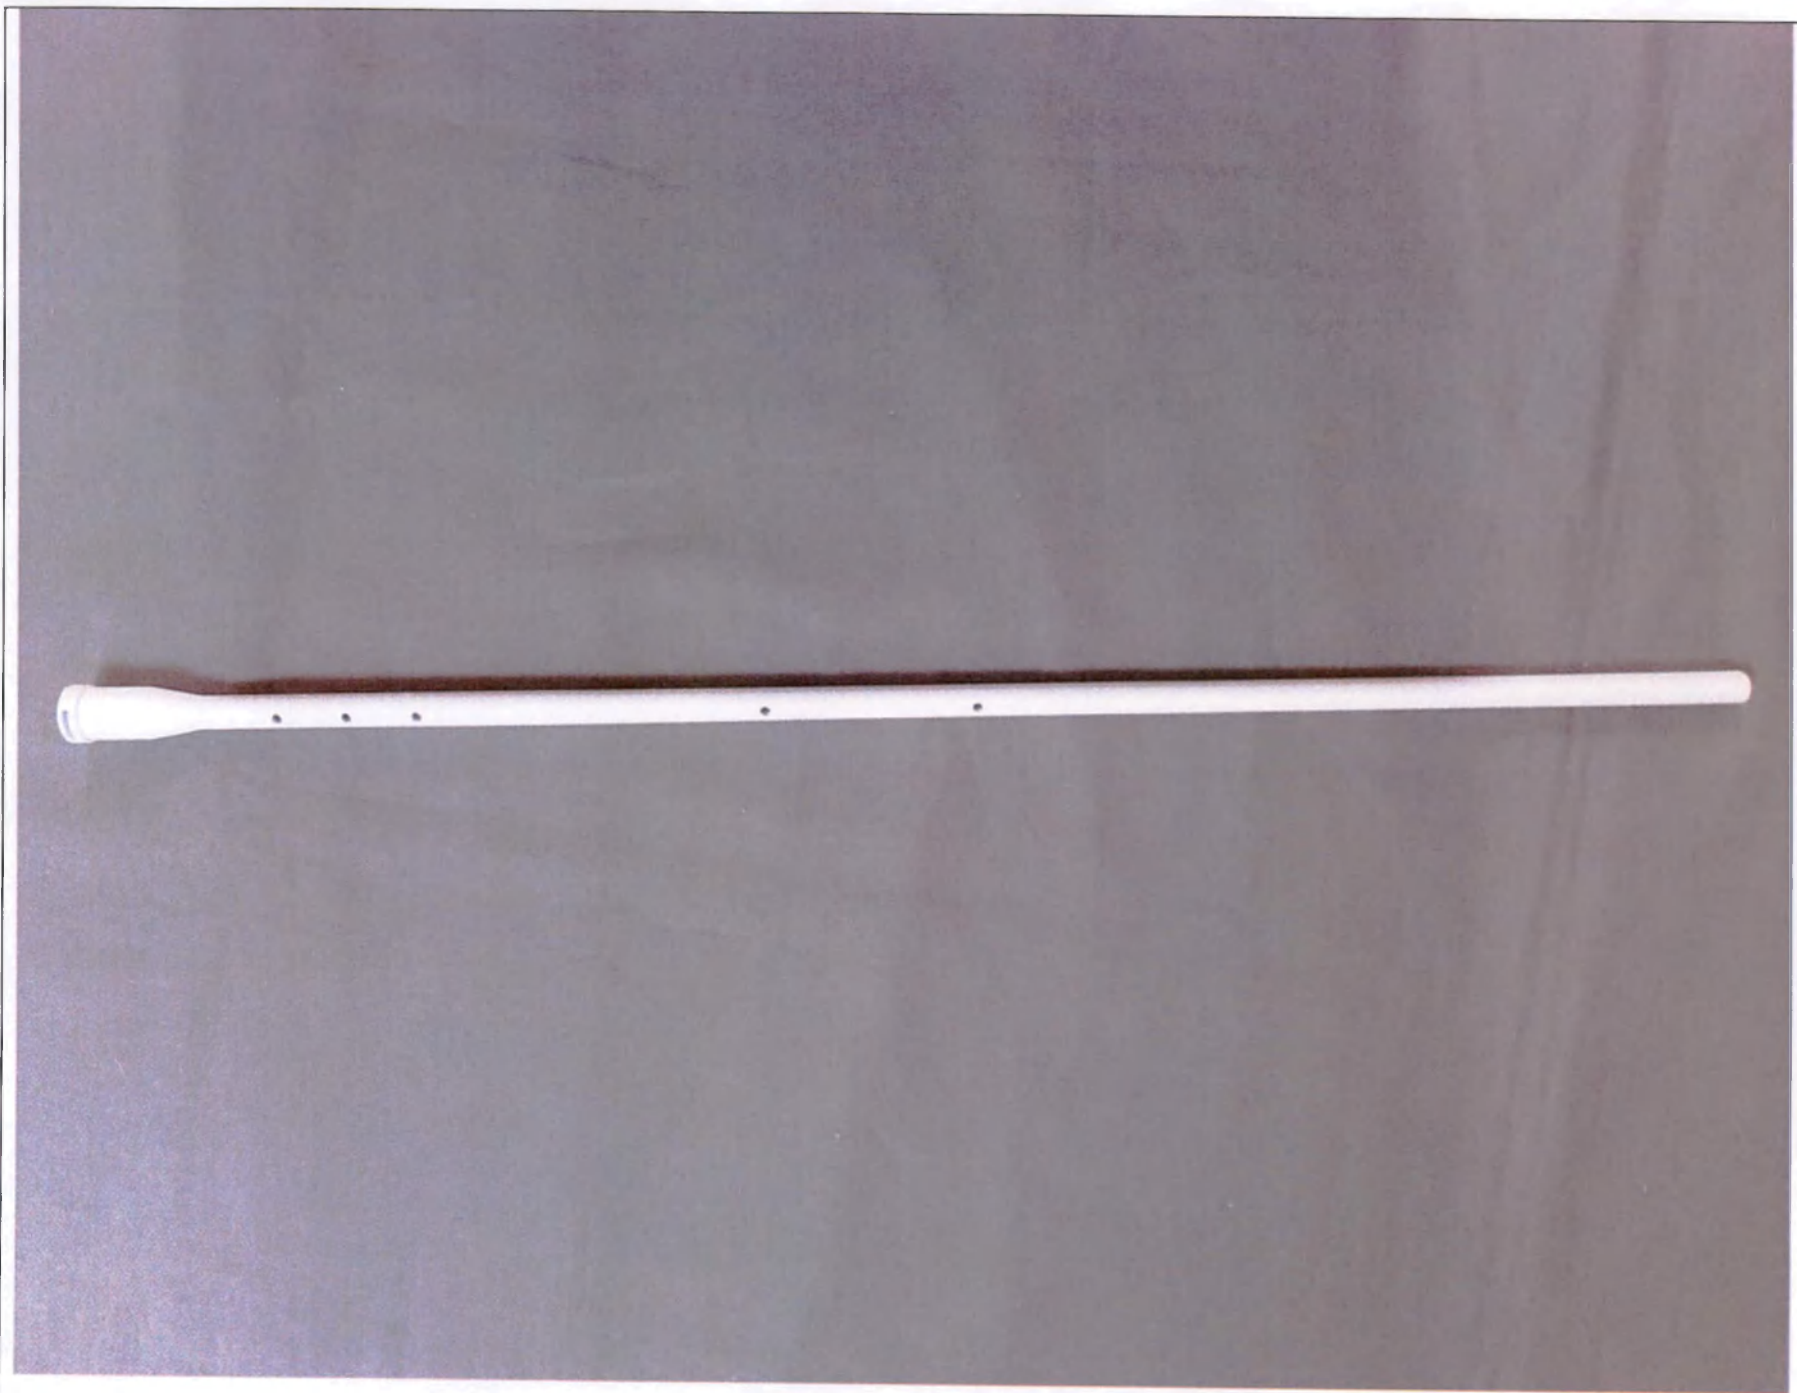


Рис. 11. Гильза защитная, для эндоскопов длиной 55 см.

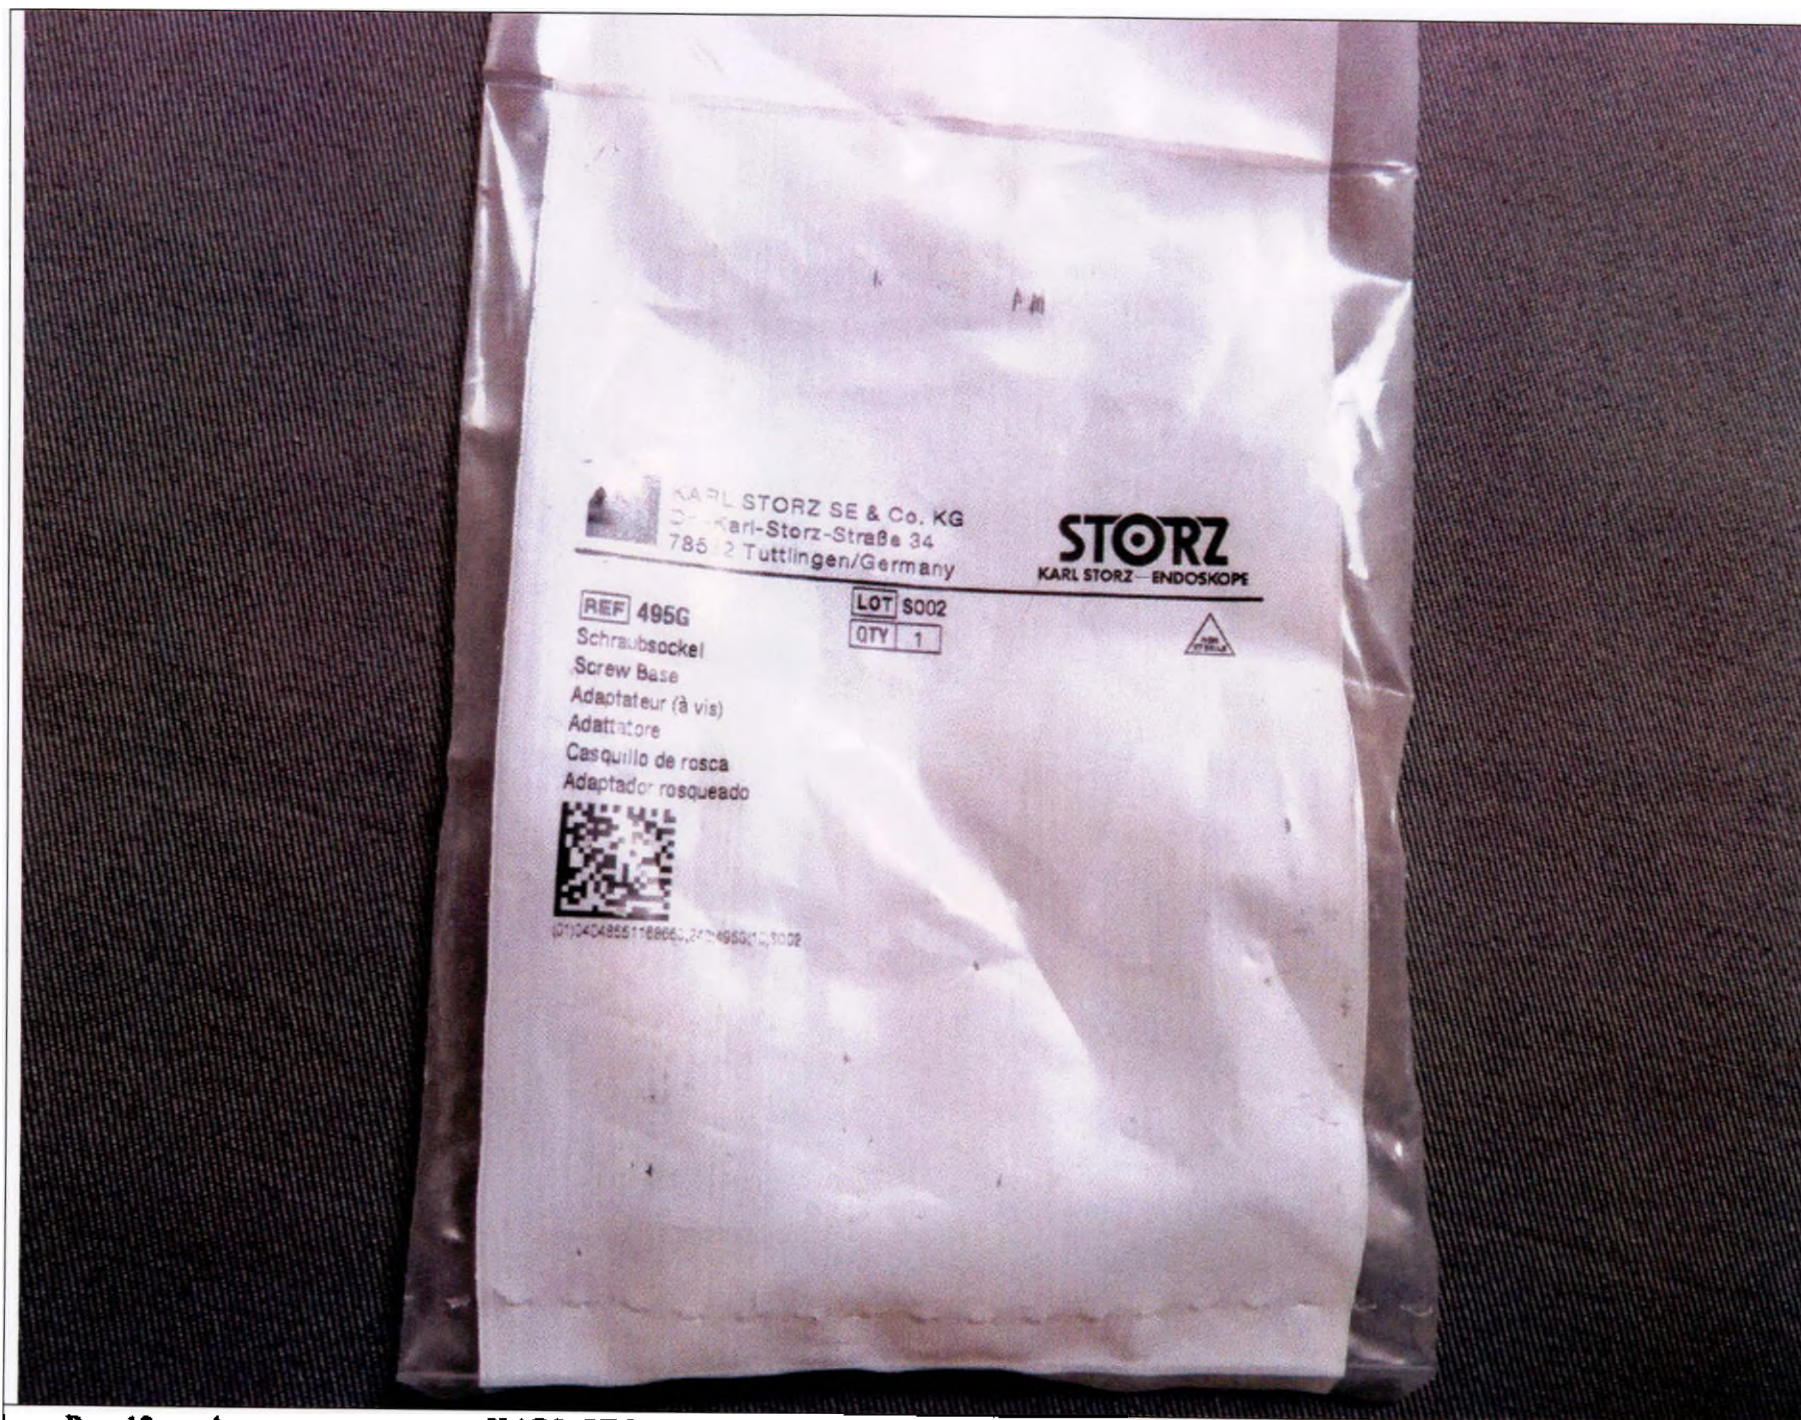


Рис. 12. Адаптер световодов KARL STORZ и Olympus. Первичная упаковка.



Рис. 13. Адаптер световодов KARL STORZ и Olympus.

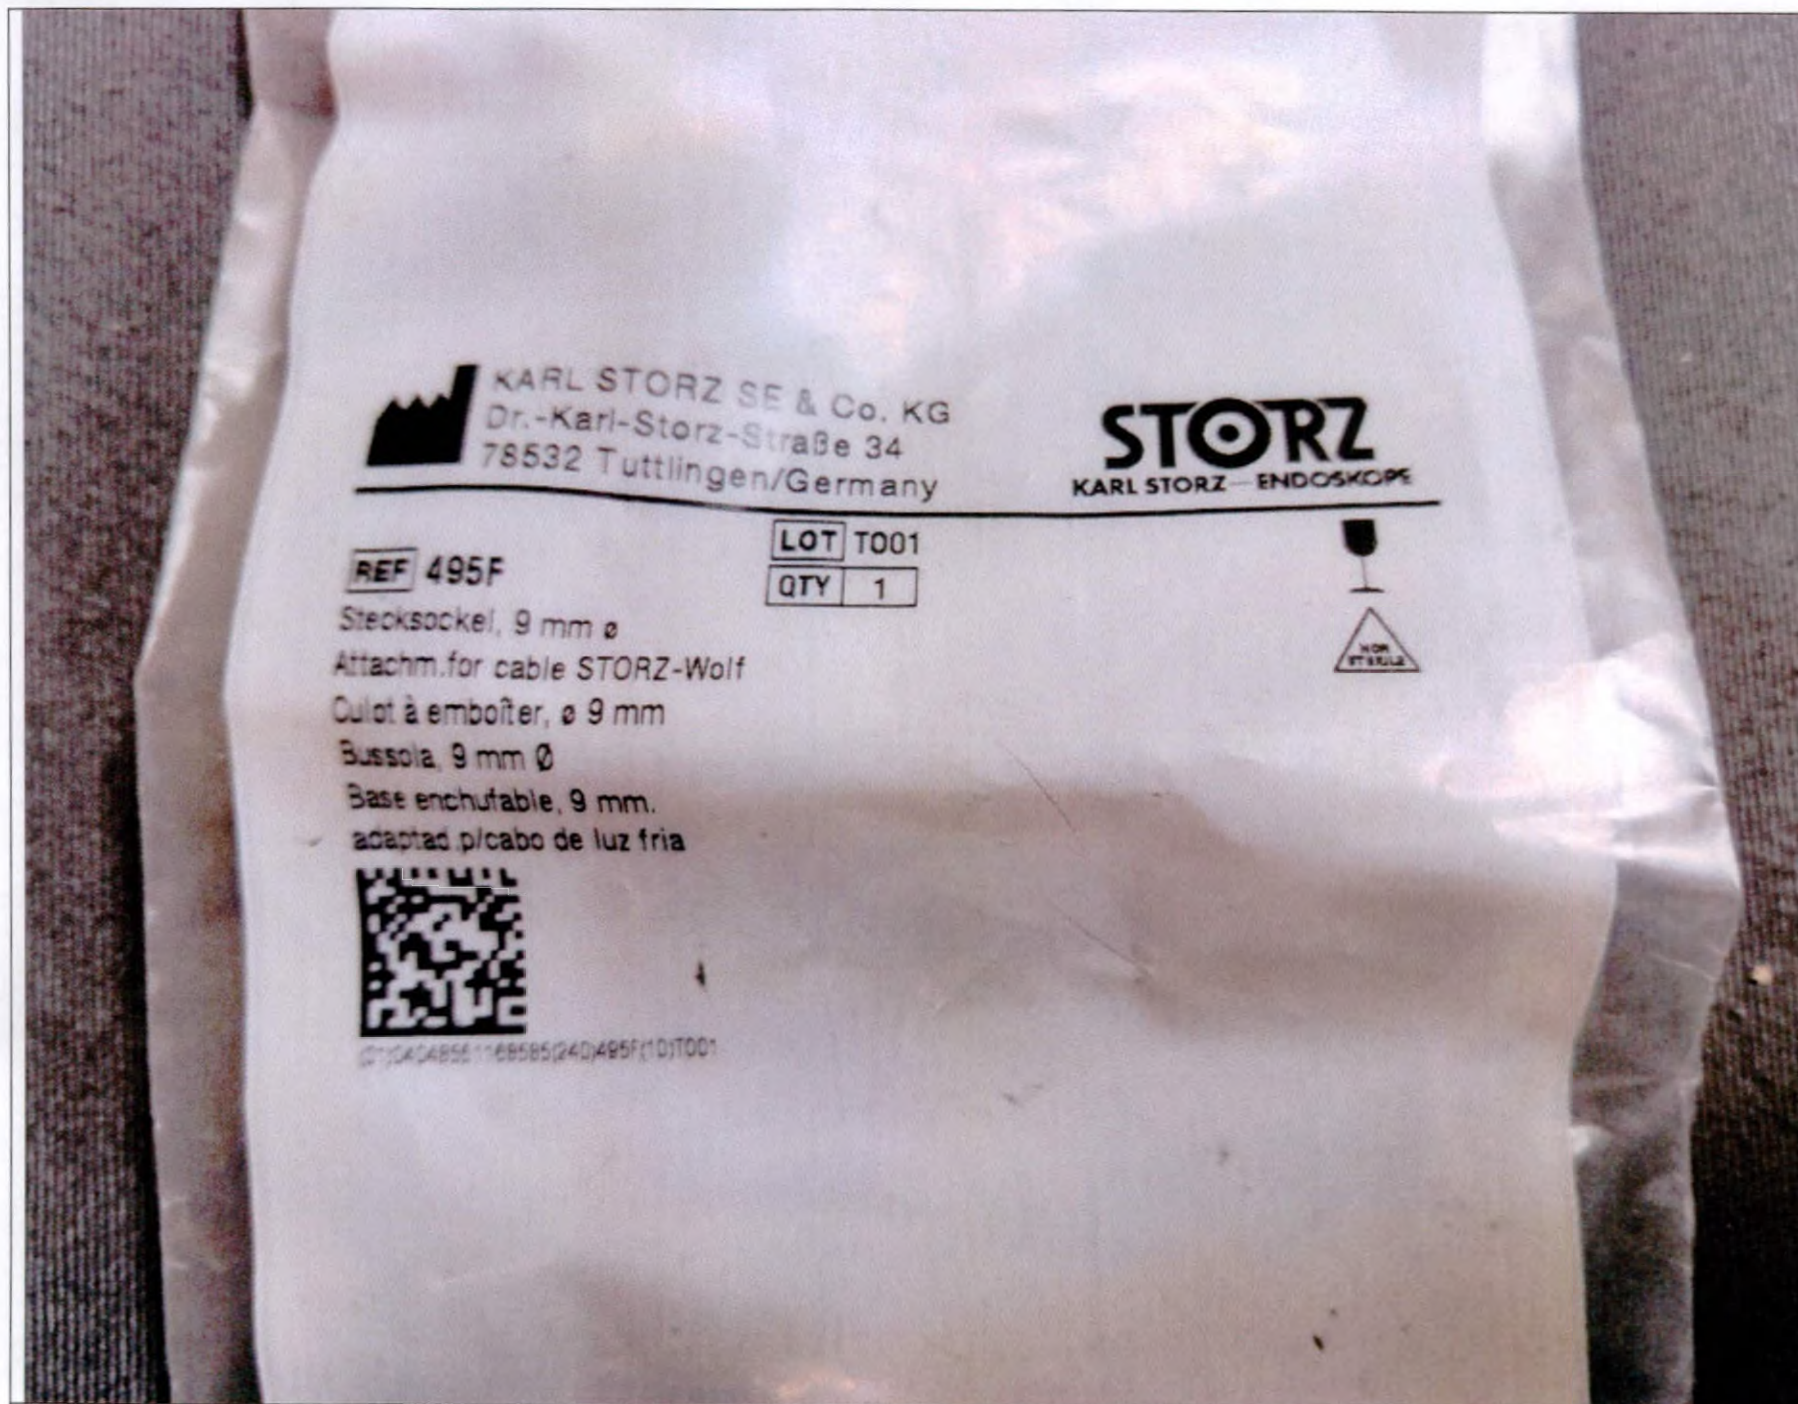


Рис. 14. Адаптер световодов Richard Wolf. Первичная упаковка.



Рис. 15. Адаптер световодов Richard Wolf



Рис. 17. Щетка плоская для очистки - 5 шт./уп.

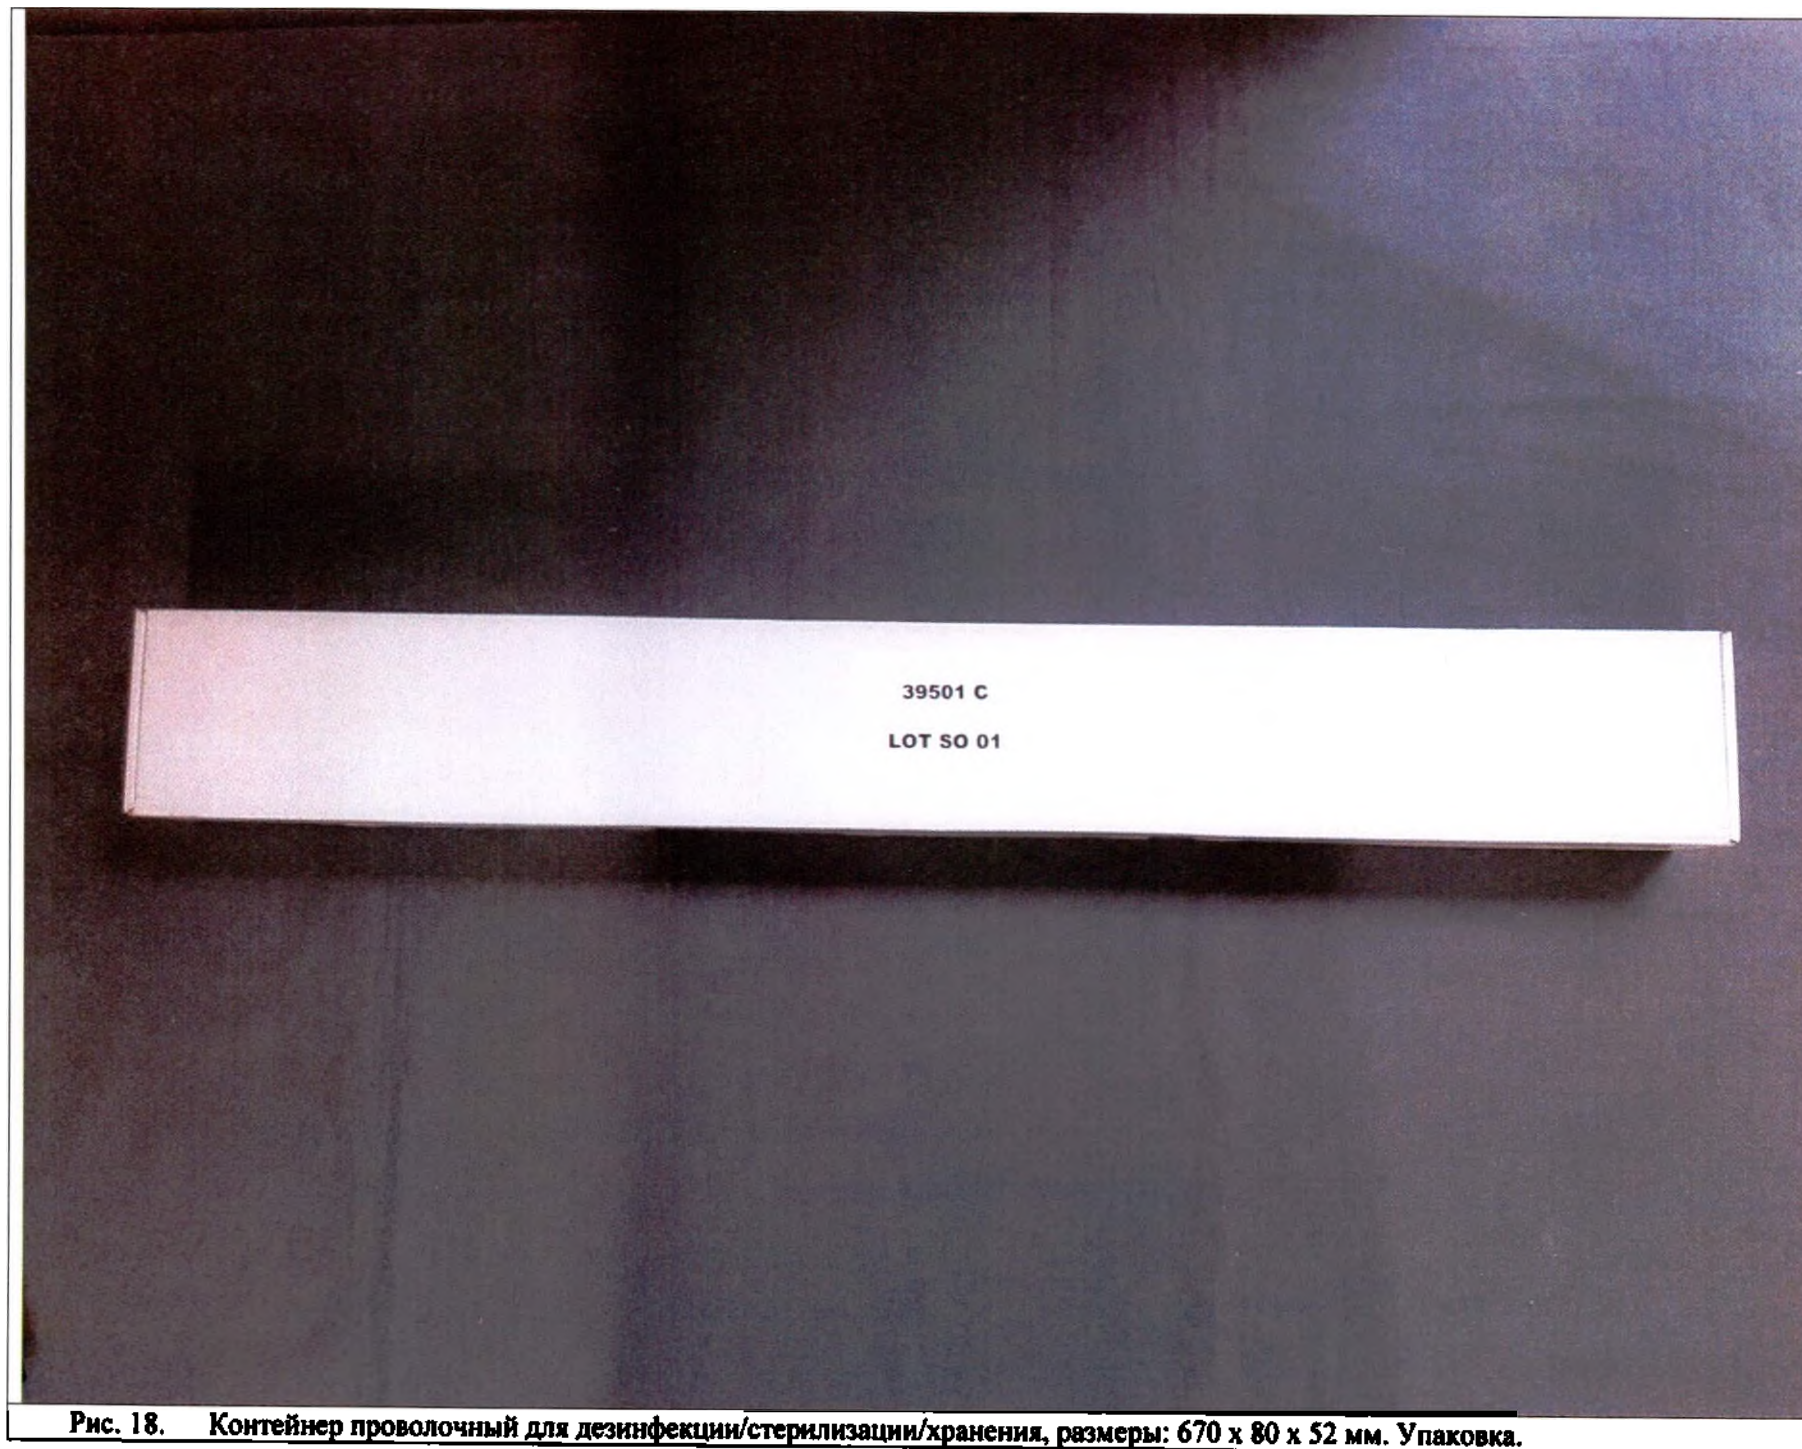


Рис. 18. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 670 x 80 x 52 мм. Упаковка.

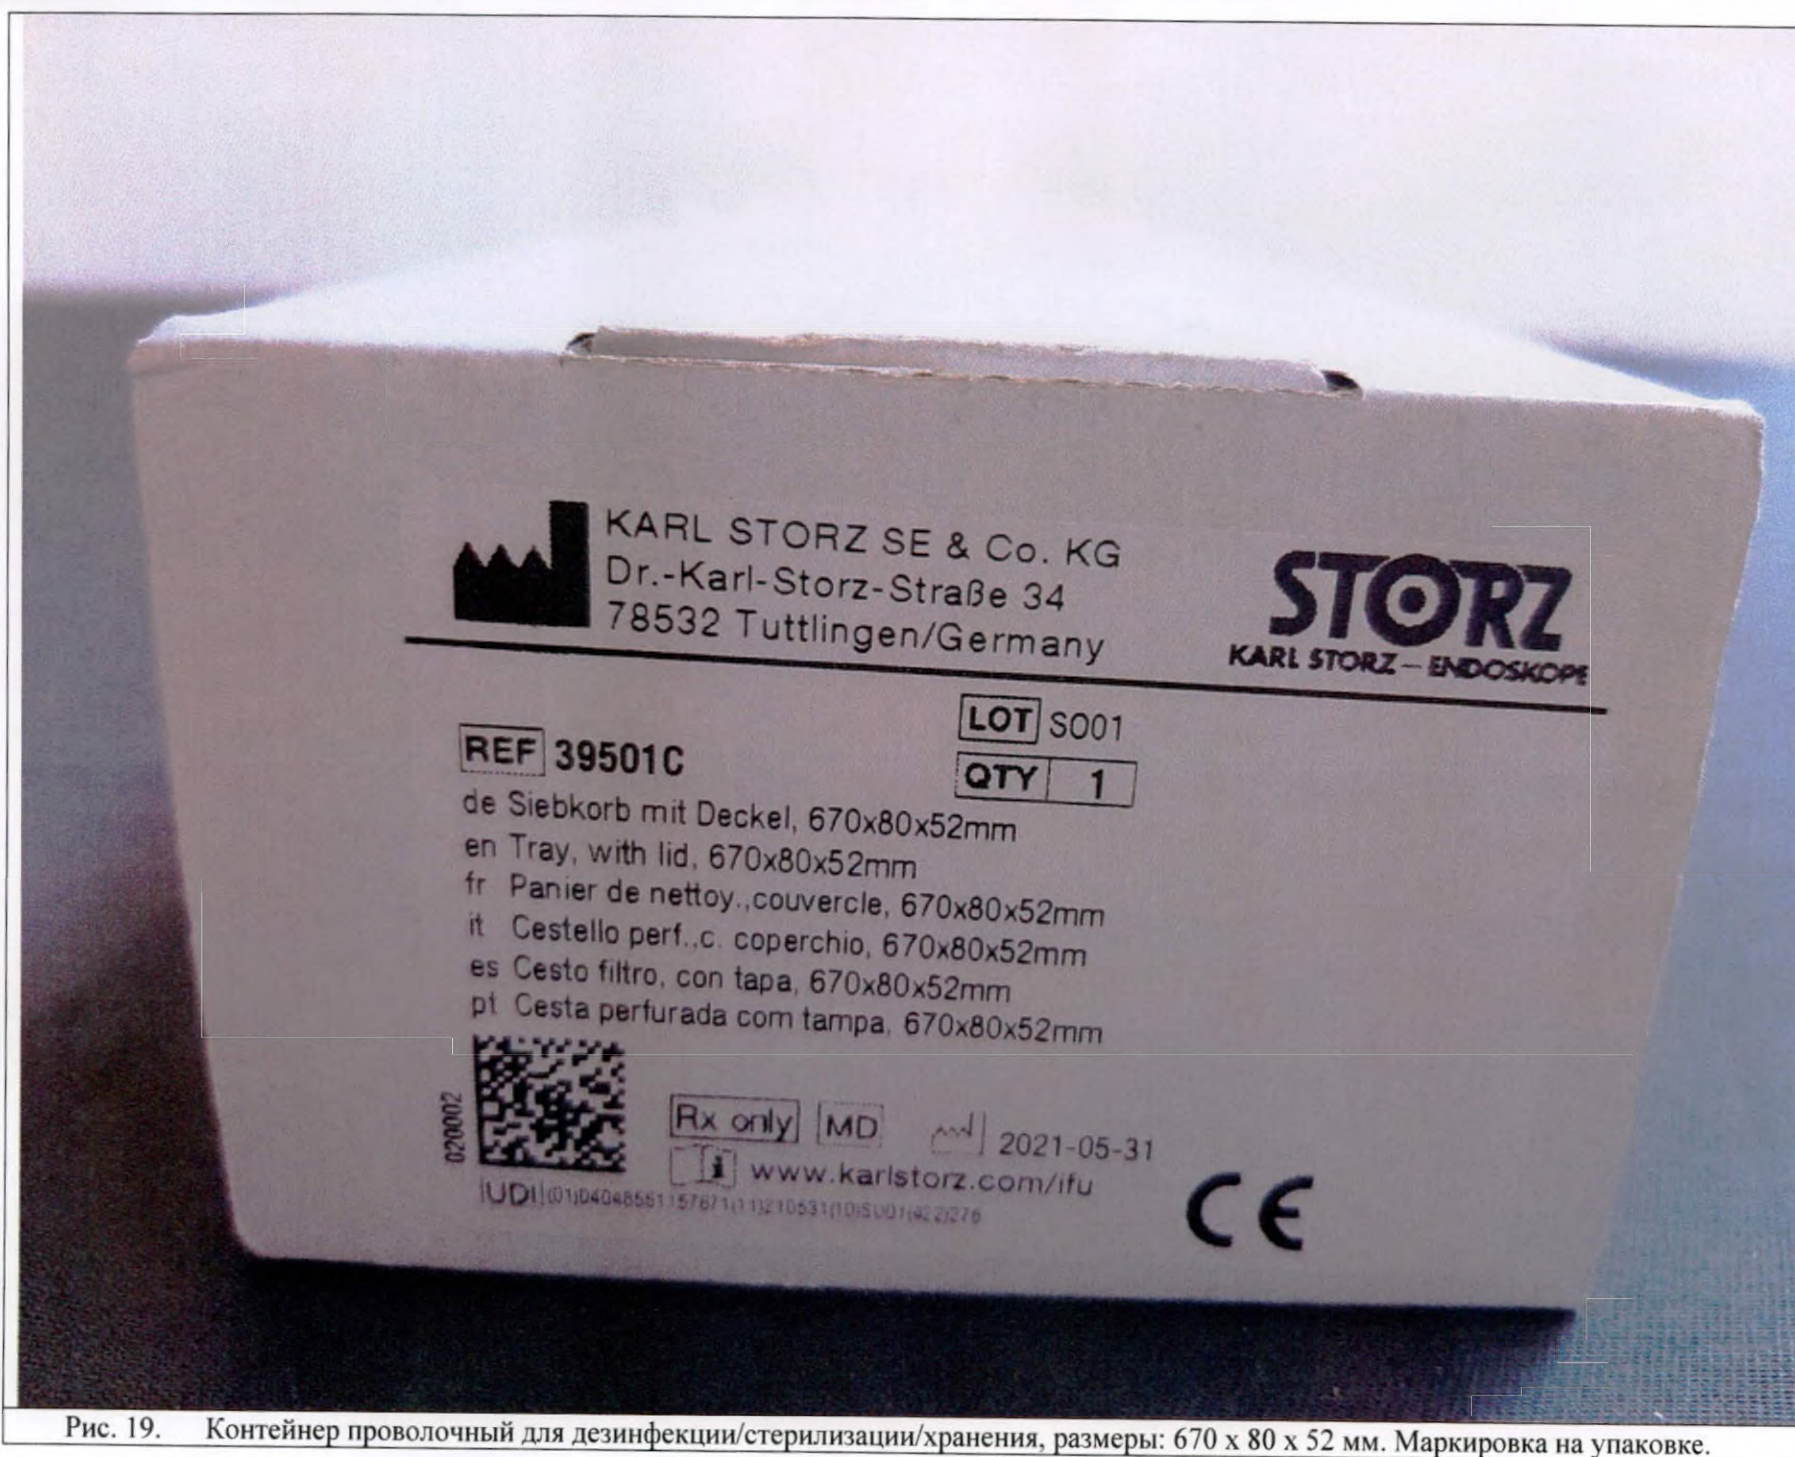


Рис. 19. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 670 x 80 x 52 мм. Маркировка на упаковке.



Рис. 20. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 670 x 80 x 52 мм.



Рис. 21. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 670 x 80 x 52 мм.

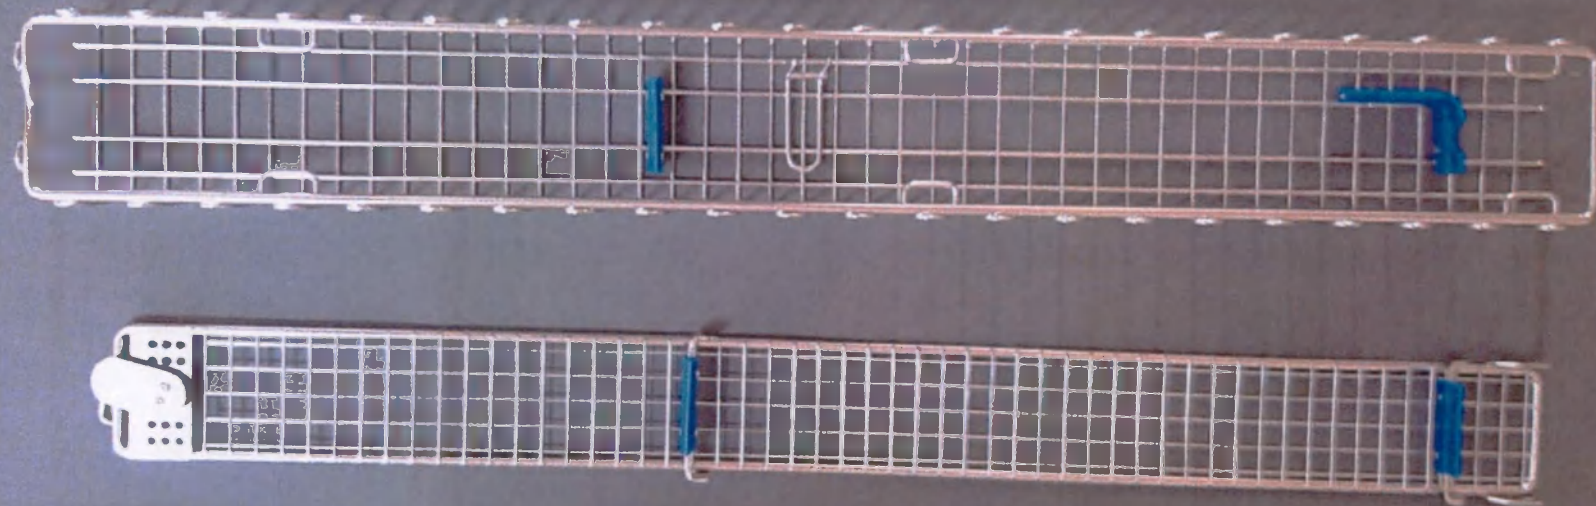


Рис. 22. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 670 x 80 x 52 мм.

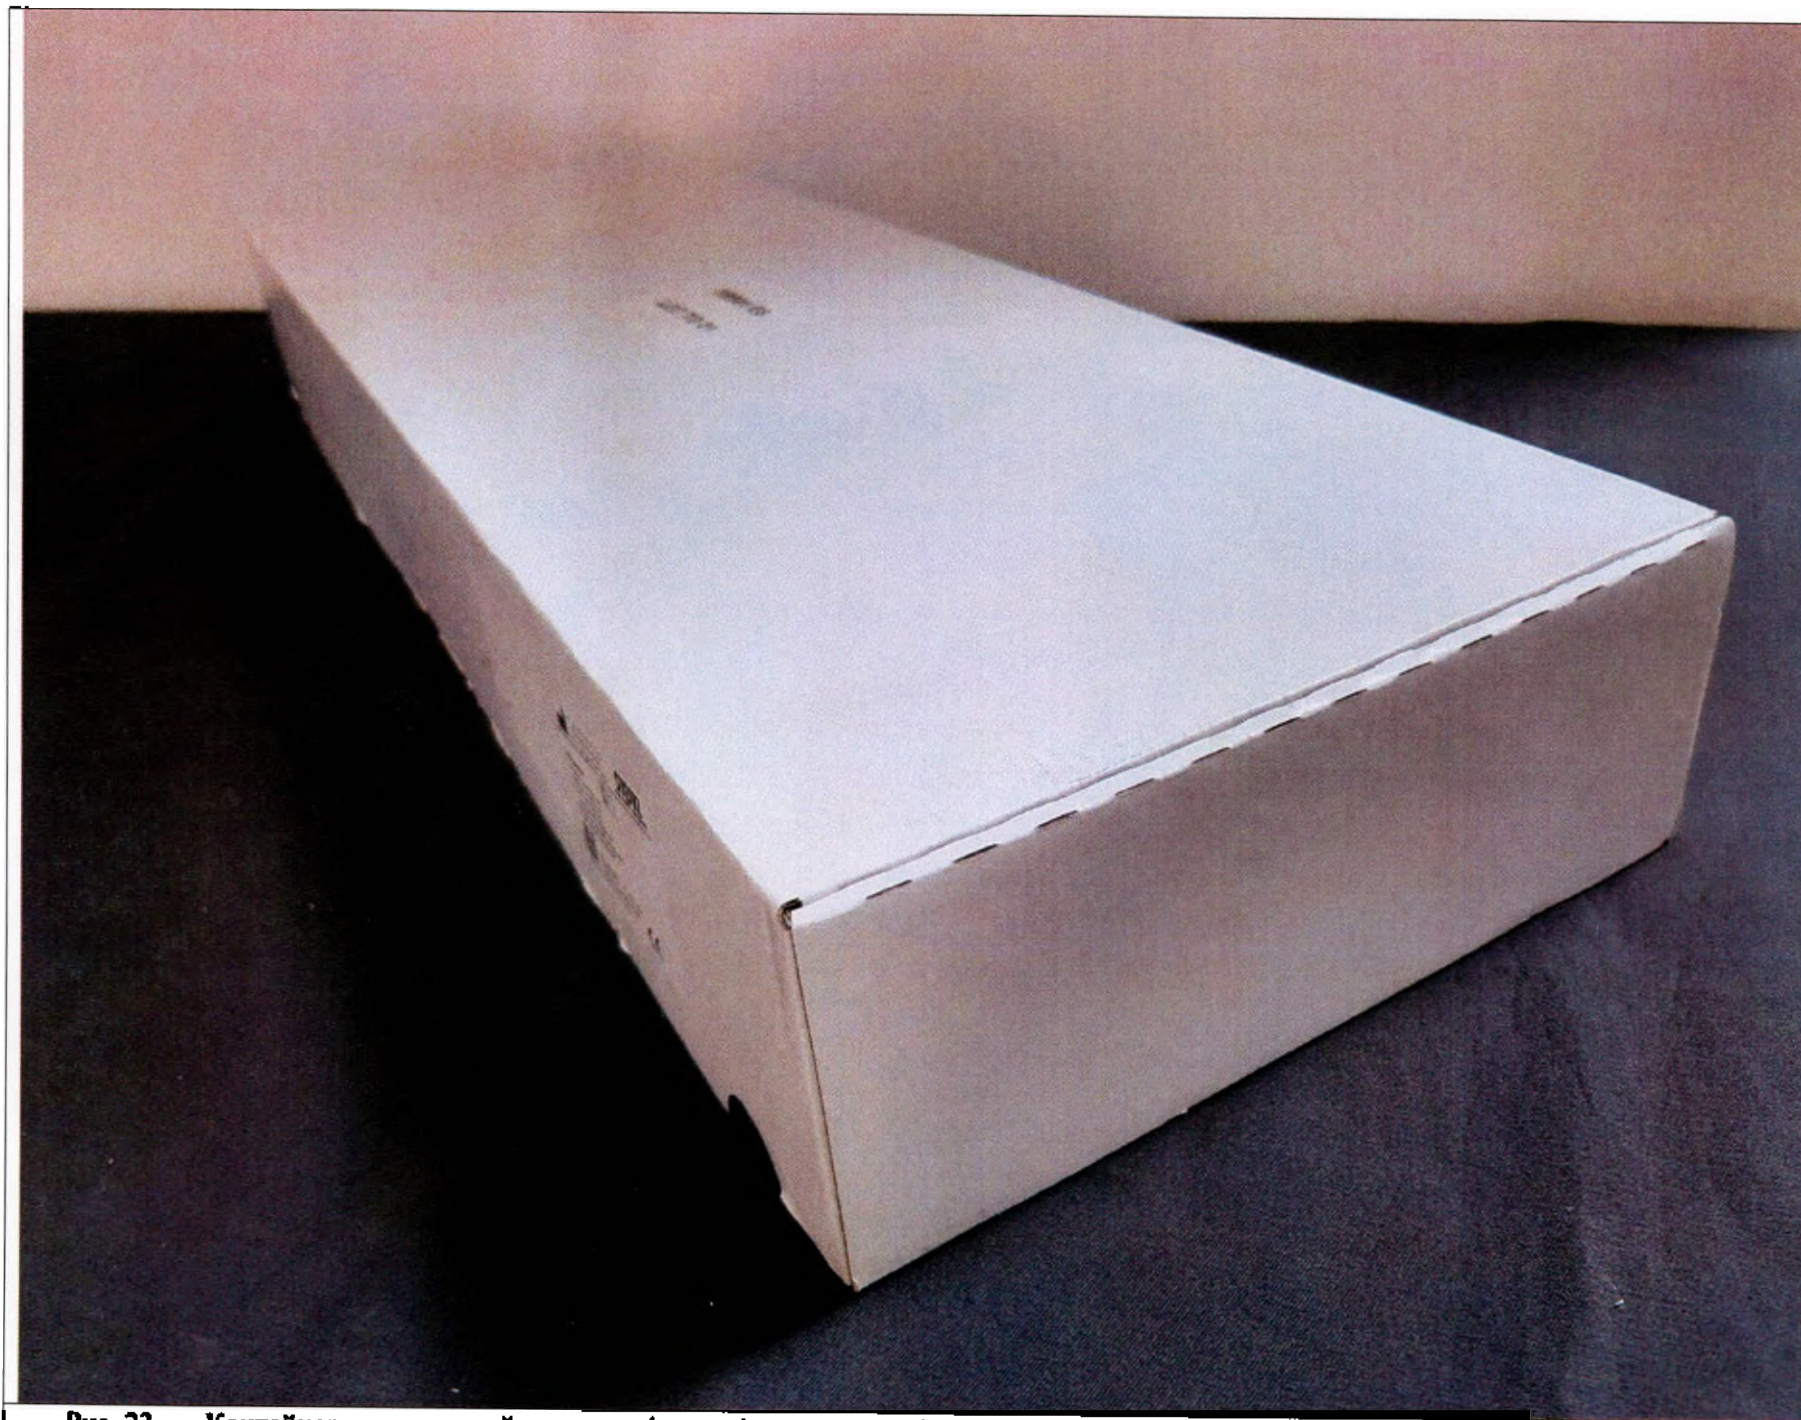


Рис. 23. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 640 x 216 x 78 мм. Упаковка.

 **KARL STORZ SE & Co. KG**
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE

LOT T001

QTY 1

REF 39501ES

de Siebkorb, Oesophagoskopie
en Wire Tray, Esophagoscopia
fr Panier, oesophagoscopia
it Cestello perforato, esofagoscopia
es Bandeja quirúrgica perf., esofagoscopia
pt Cesto aramado, esofagoscopia



1020002

Rx only

MD



2021-06-01



www.karlstorz.com/ifu

UDI 01 01 04048551157688(11)210601(10)T001(422)276



Рис. 24. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 640 x 216 x 78 мм. Маркировка на упаковке.



Рис. 25. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 640 x 216 x 78 мм.



Рис. 26. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 640 x 216 x 78 мм.



Рис. 27. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 640 x 216 x 78 мм.

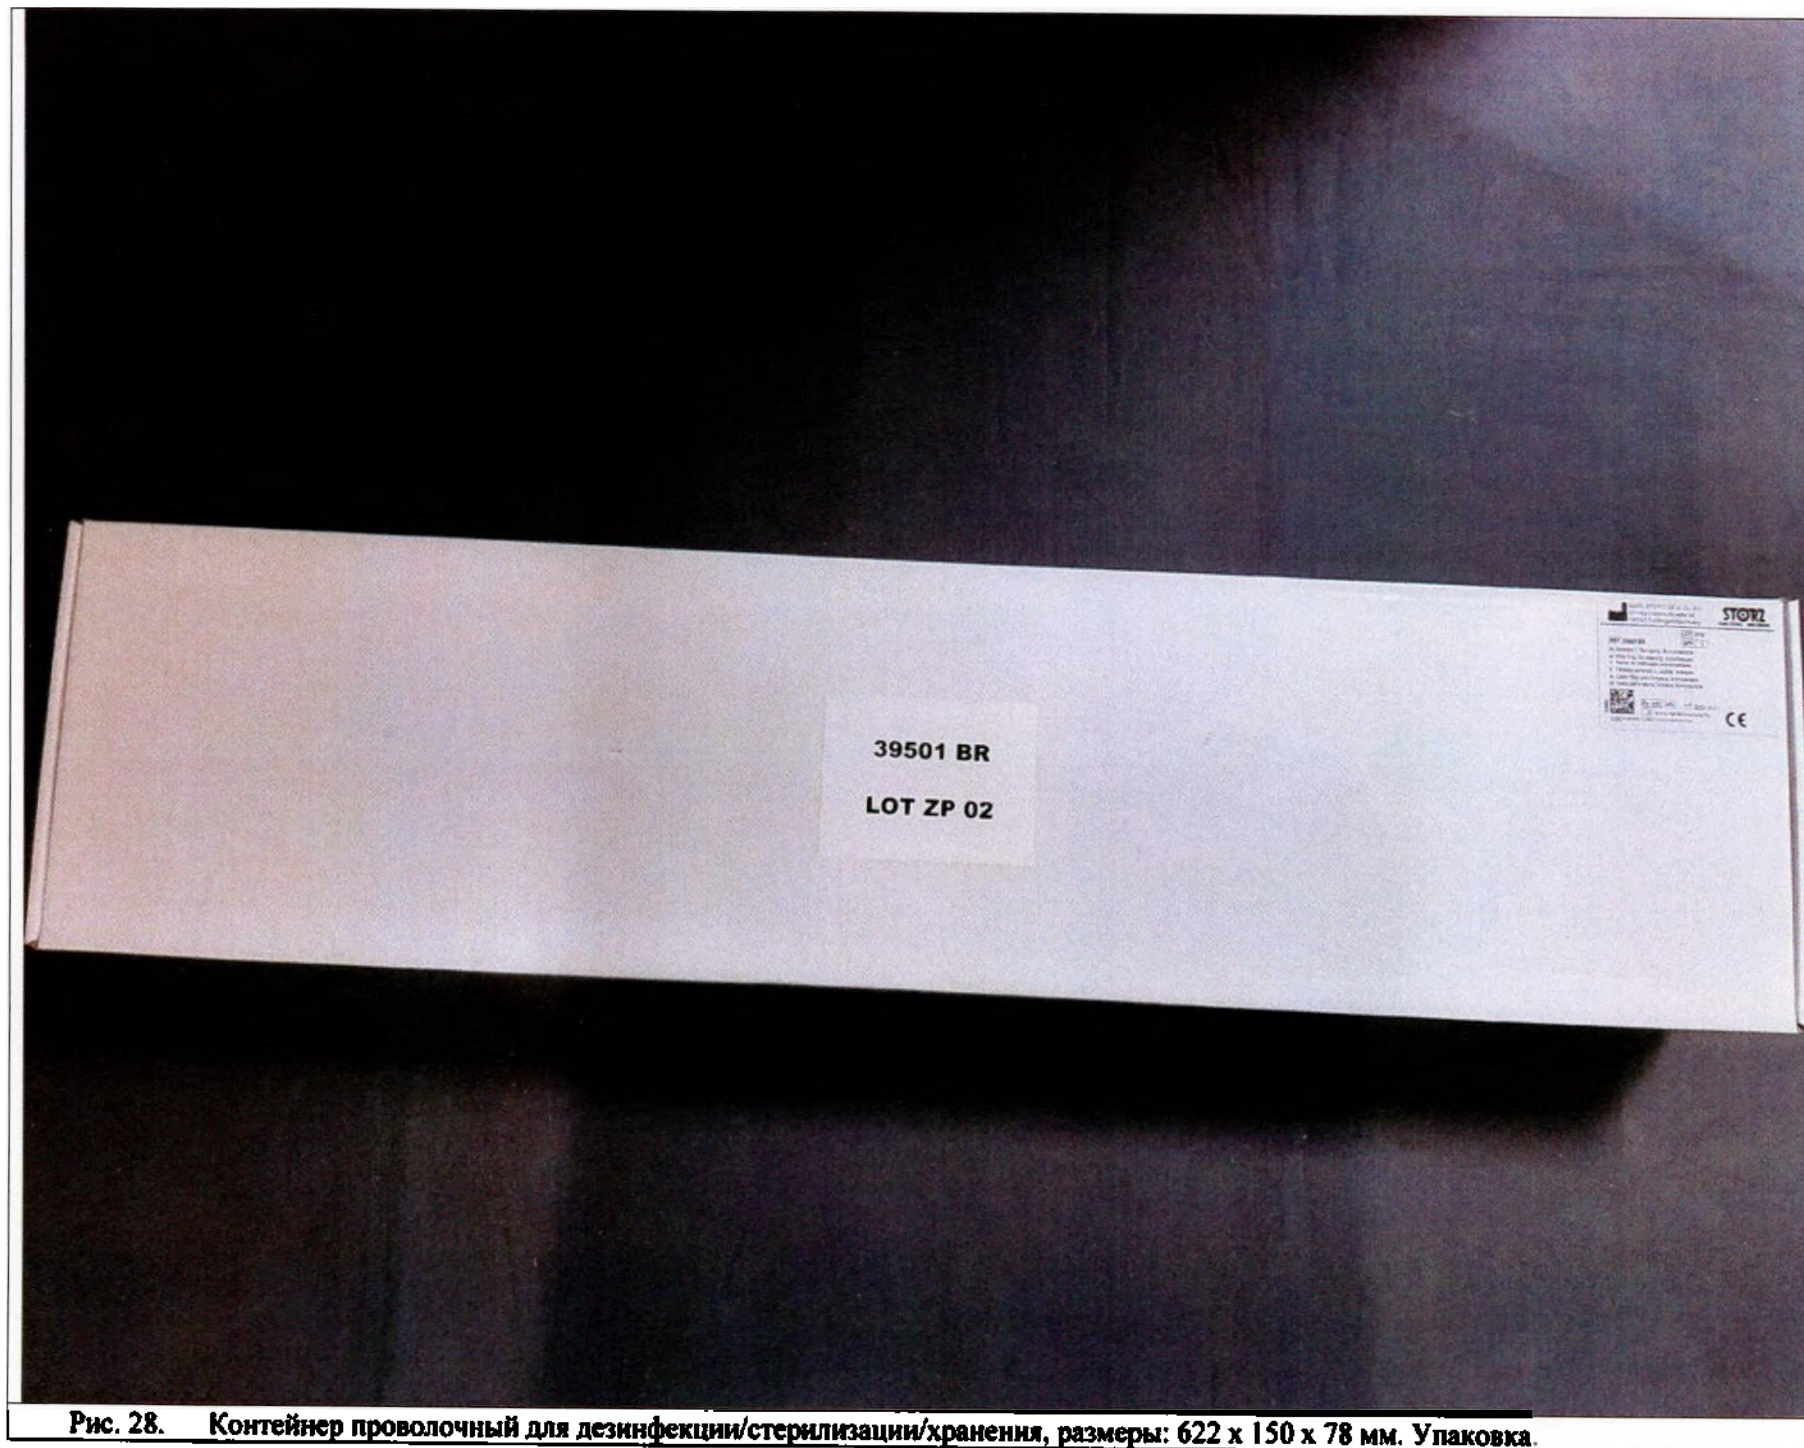


Рис. 28. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 622 x 150 x 78 мм. Упаковка.



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ – ENDOSKOPE

LOT ZP02

REF 39501BR

QTY 1

de Siebkorb f. Reinigung, Bronchoskopie
en Wire Tray, for cleaning, bronchoscopy
fr Panier de nettoyage, bronchoscopie
it Cestello perforato p. pulizia, broncosc.
es Cesto filtro para limpieza, broncoscopia
pt Cesta perfurada p/ limpeza, broncoscopia

020002



Rx only

MD



2020-12-01



www.karlstorz.com/ifu

UDI (01)04048551157664(11)201201(10)ZP02(422)276

CE

Рис. 29. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 622 x 150 x 78 мм. Маркировка на упаковке.



Рис. 30. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 622 x 150 x 78 мм.



Рис. 31. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 622 x 150 x 78 мм.

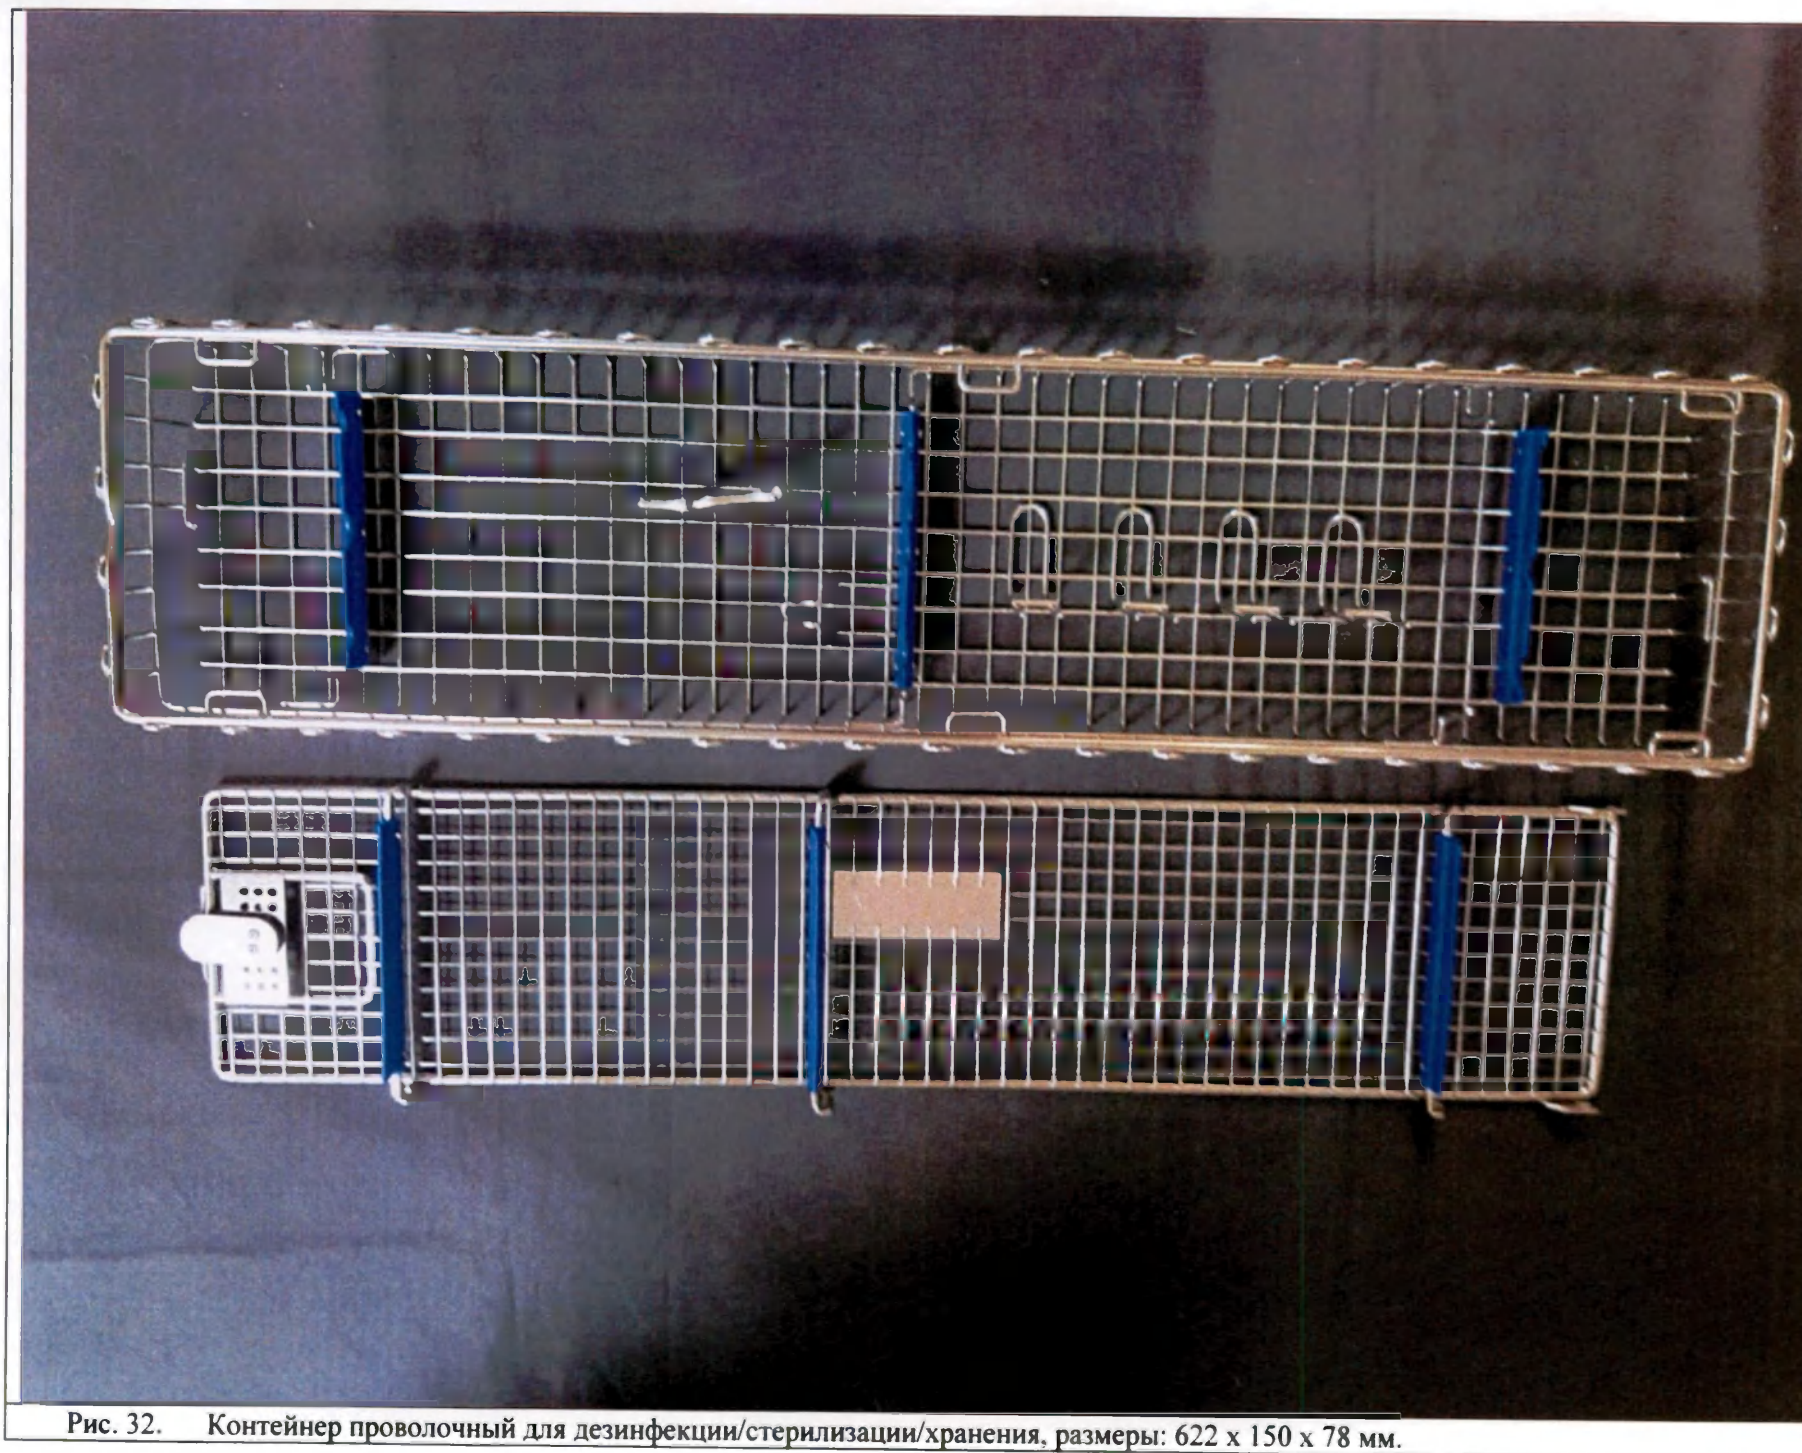


Рис. 32. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 622 x 150 x 78 мм.

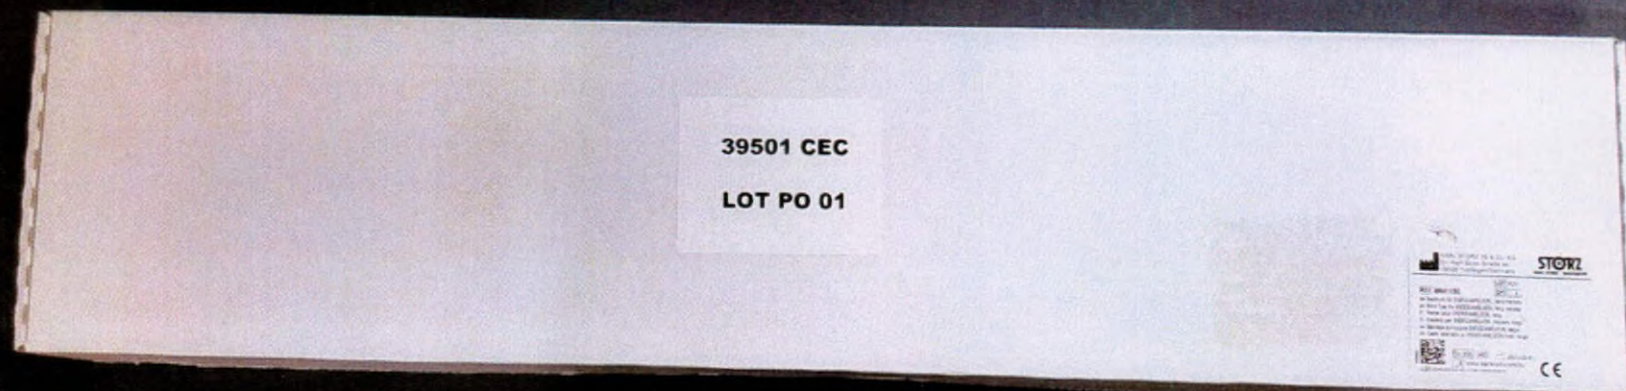


Рис. 33. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 604 x 125 x 54 мм. Упаковка.



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE

LOT P001

REF 39501CEC

QTY 1

de Siebkorb für ENDOCAMELEON, Lang-Version
en Wire Tray for ENDOCAMELEON, long version
fr Panier pour ENDOCAMELEON, long
it Cestello per ENDOCAMELEON, modello lungo
es Bandeja quirúrgica ENDOCAMELEON, larga
pt Cesto aramado p/ ENDOCAMELEON, mod. longo

020002



Rx only

MD



2021-03-01



www.karlstorz.com/ifu

UDI (01)04048551254158(11)210301(10)P001(422)276



Рис. 34. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 604 x 125 x 54 мм. Маркировка на упаковке.

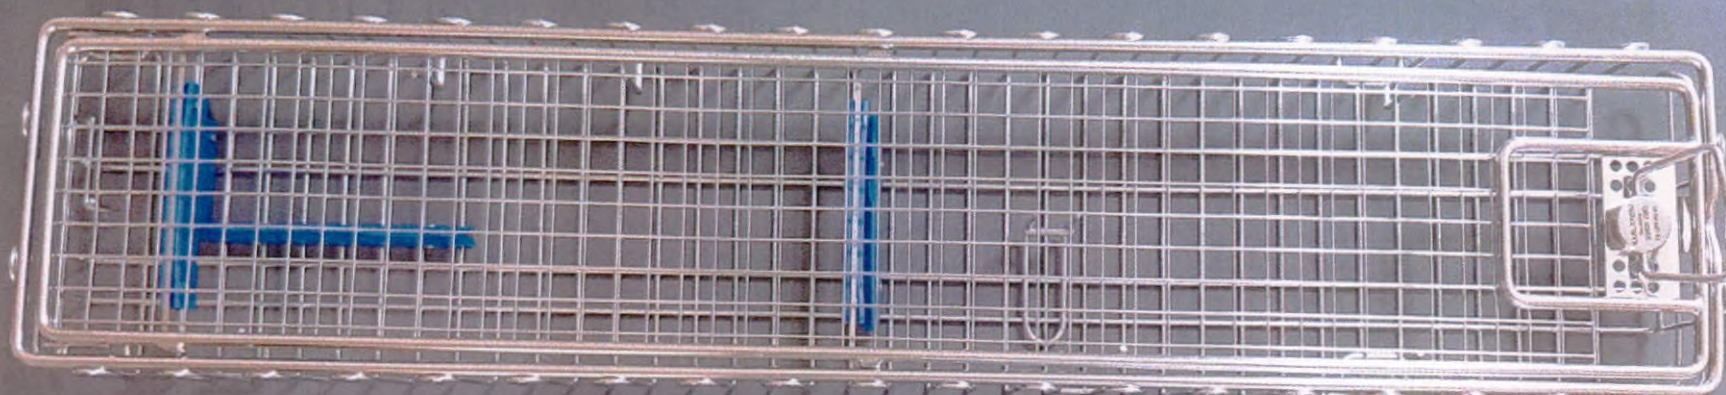


Рис. 35. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 604 x 125 x 54 мм.



Рис. 36. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 604 x 125 x 54 мм.

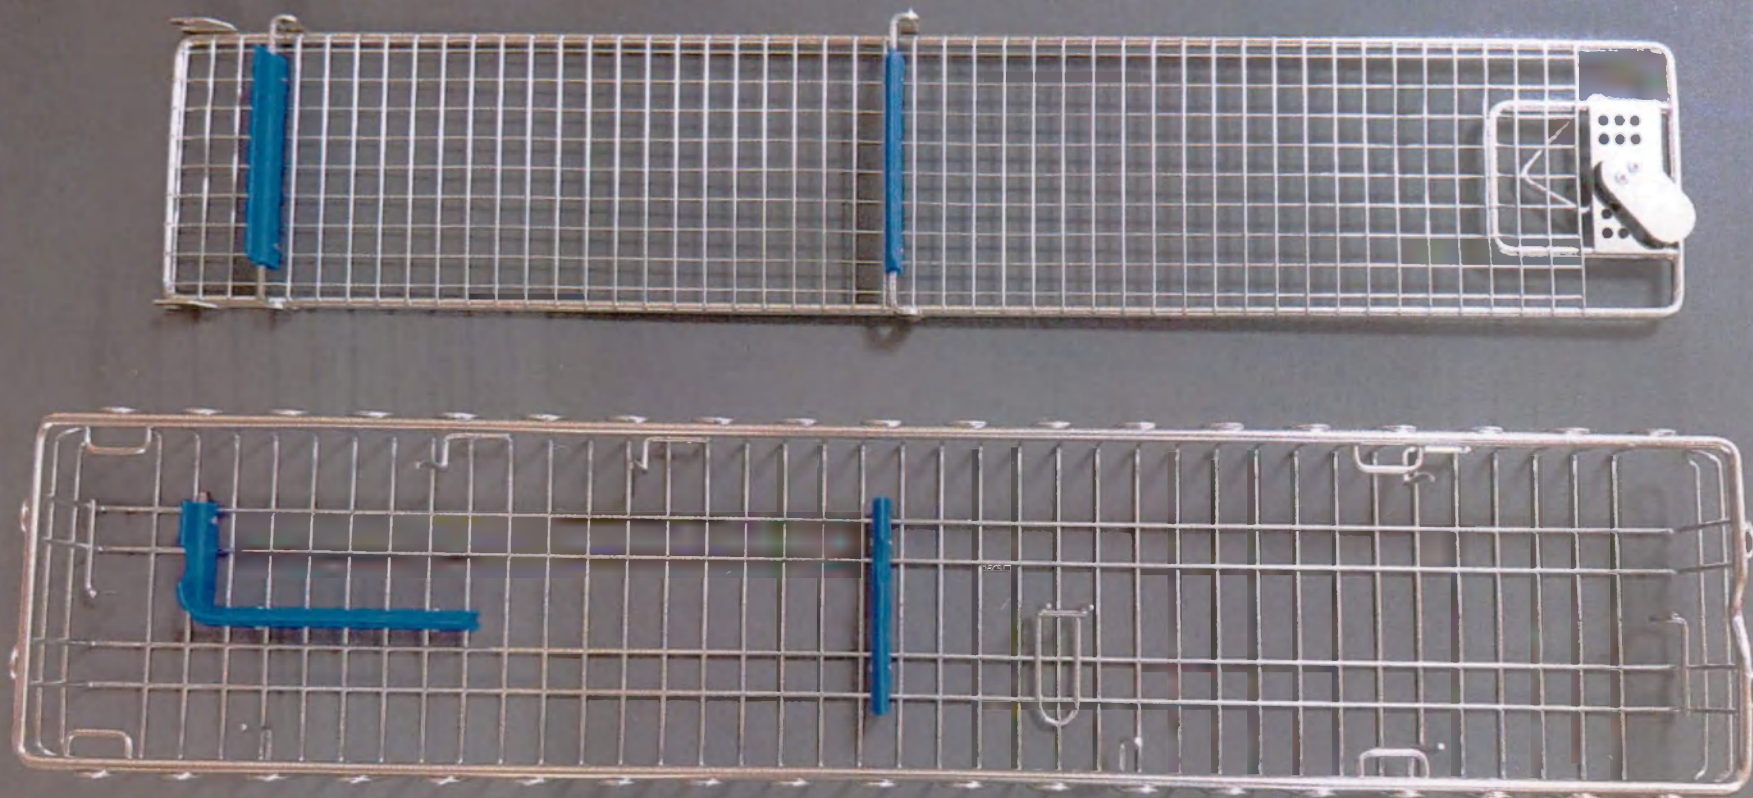


Рис. 37. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 604 x 125 x 54 мм.

12015AA		STORZ KARL STORZ – ENDOSKOPIE
Эзофагоскоп жесткий HOPKINS с принадлежностями. Эзофагоскоп жесткий HOPKINS, направление наблюдения 0°, диаметр 5,5 мм, длина 53 см		
РУ № _____ от _____ Информация о сроке службы – см. инструкцию по эксплуатации		
Производитель	KARL STORZ SE & Co. KG Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen / Germany (Германия)	
Уполномоченный представитель на территории РФ	Общество с ограниченной ответственностью КАРЛ ШТОРЦ – Эндоскопы ВОСТОК (ООО КШТЭ ВОСТОК) Россия, 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, 7, стр. 4	

Рис. 38. Пример макета русскоязычной маркировки, на примере варианта исполнения: Эзофагоскоп жесткий HOPKINS, направление наблюдения 0°, диаметр 5,5 мм, длина 53 см.



Прнумеровано, прошито и
скреплено печатью на _____
39 листах

