

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «ИМБИАН»




Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения гемоглобина, трансферрина, кальпротектина в образцах кала «Hb/Tf/Calp-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-057-39271034-2023

2023 г.

В состав медицинского изделия входят следующие компоненты:

1. Тест-кассета

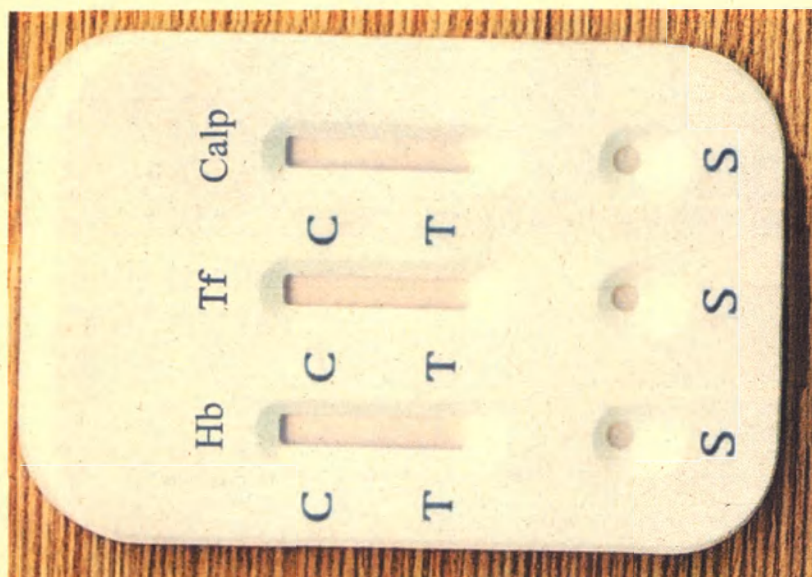


2. Фольгированный пакет с тест-кассетой



3. Буферный раствор, 2,0 мл



4. Пипетка Пастера

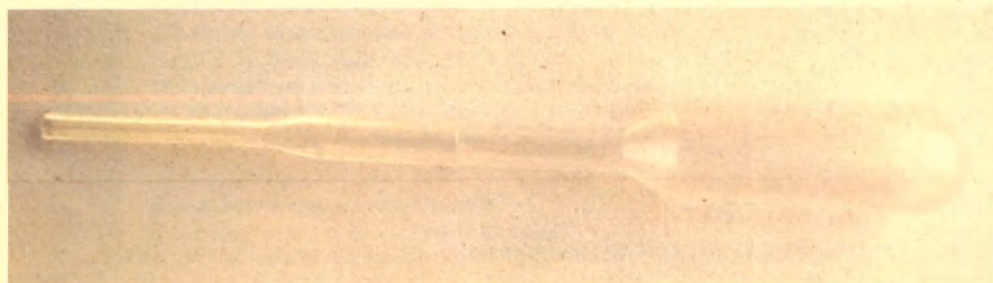

5. Наклейка для маркировки пробирки



Потребительская упаковка. Комплект 1. Сторона 1.

Нб/Тf/Саlp- ИМБИАН-ИХА

Комплект № 1

- Тест-кассета
- Буферный раствор, 2,0 мл
- Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019:
- Пипетки для переноса жидкостей (Пастера), 0,25 мл (РУ № РЗН 2019/8912)
- Инструкция по применению

Замораживание не допускается.
Для профессионального применения.


Экспресс-тест для качественного
иммунохроматографического определения
гемоглобина, трансферрина, кальпротектина
в образцах кала «Нб/Тf/Саlp-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-057-39271034-2023

РУ № XXX XXXX/XXXXX Imbian

1 шт.
1 пр.

LOT 230214
REF iBR-013/1
2023-02-14
2025-02-14

1 шт.
1 шт.



Потребительская упаковка. Комплект 1. Сторона 2.



ООО «ИМБИАН», 630554, Новосибирская область,
м.р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с. Барышево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1.



+7 (383) 209-34-54

IMBIAN LLC, Lenin street 247, building 4, room 1,
village Baryshevo, rural settlement Baryshevsky selsovet,
Novosibirsky microdistrict, Novosibirsk Region, 630554.


www.imbian.ru

info@imbian.ru


Потребительская упаковка. Комплект 2. Сторона 1.



Потребительская упаковка. Комплект 2. Сторона 2.

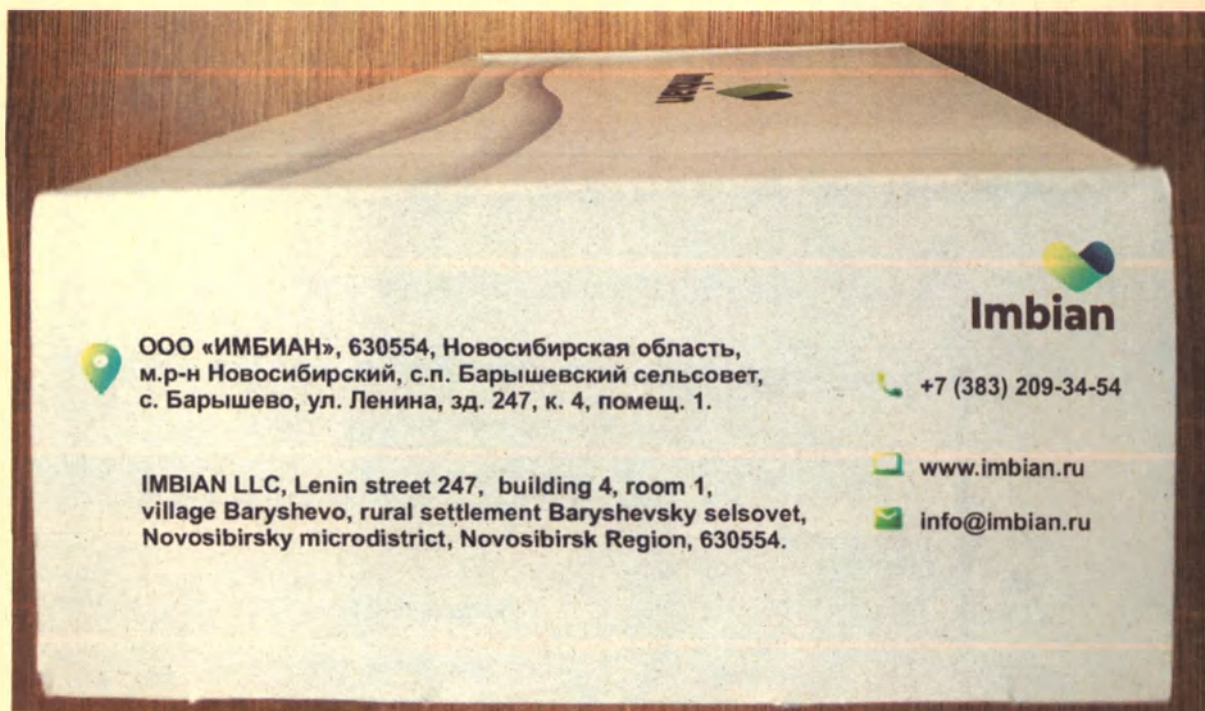

Общий вид медицинского изделия Комплект 1

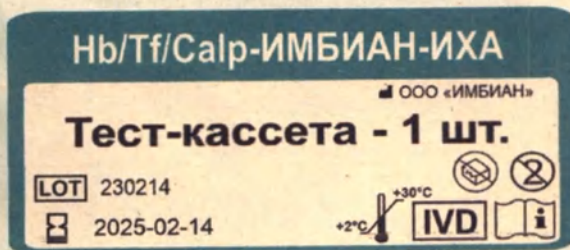

ИНСТРУКЦИЯ

по применению на медицинское изделие

Экспресс-тест для качественного
иммунохроматографического определения
гемоглобина, трансферрина, кальпротектина в
образцах кала «Hb/Tf/Calp-ИМБИАН-ИХА» по
ТУ 21.20.23-057-39271034-2023
(Разработана и введена впервые)



Hb/Tf/Calp-ИМБИАН-ИХА


Комплект № 1

- Тест-кассета
- Буферный раствор, 2,0 мл
- Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019: Пипетки для переноса жидкостей (Пастера), 0,25 мл (ПУ № РЗН 2019/8912)
- Инструкция по применению

Замораживание не допускается.
Для профессионального применения.

Экспресс-тест для качественного
иммунохроматографического определения
гемоглобина, трансферрина, кальпротектина
в образцах кала «Hb/Tf/Calp-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-057-39271034-2023

ПУ № XXX XXXX/XXXXX Imbian
1 шт. LOT 230214
1 пр. REF IBR-013/1
2023-02-14
2025-02-14
1 шт.
1 шт.



Общий вид медицинского изделия Комплект 2



Транспортная упаковка. Комплект 1

Нб/Tf/Calp- ИМБИАН-ИХА		Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения гемоглобина, трансферрина, кальпротектина в образцах кала «Нб/Tf/Calp-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-057-39271034-2023	
РУ № XXX XXXX/XXXXX			
Количество	ШТ.		
Масса нетто	КГ		
Масса брутто	КГ		
LOT 230214	2023-02-14	 ООО «ИМБИАН» 630554, Новосибирская область, м.р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет, с. Барышево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1 +7 (383) 209-34-54 info@imbian.ru	
REF iBR-013/1	2025-02-14		
Замораживание не допускается.		+2°C	

Транспортная упаковка. Комплект 2

Нб/Tf/Calp- ИМБИАН-ИХА		Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения гемоглобина, трансферрина, кальпротектина в образцах кала «Нб/Tf/Calp-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-057-39271034-2023	
РУ № XXX XXXX/XXXXX			
Количество	ШТ.		
Масса нетто	КГ		
Масса брутто	КГ		
LOT 230214	2023-02-14	 ООО «ИМБИАН» 630554, Новосибирская область, м.р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет, с. Барышево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1 +7 (383) 209-34-54 info@imbian.ru	
REF iBR-013/2	2025-02-14		
Замораживание не допускается.		+2°C	

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью.

8 лист 8

Директор ООО «ИМБИАН»

С.А. Иванов "11.08" 2022 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «ИМБИАН»



Ю.А. Иванов/


МП

МАКЕТ МАРКИРОВКИ


Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения
гемоглобина, трансферрина, кальпротектина в образцах кала «Нб/Tf/Calp-ИМБИАН-
ИХА» по ТУ 21.20.23-057-39271034-2023

2023 г.


1. Маркировка фольгированного пакета с тест-кассетой:

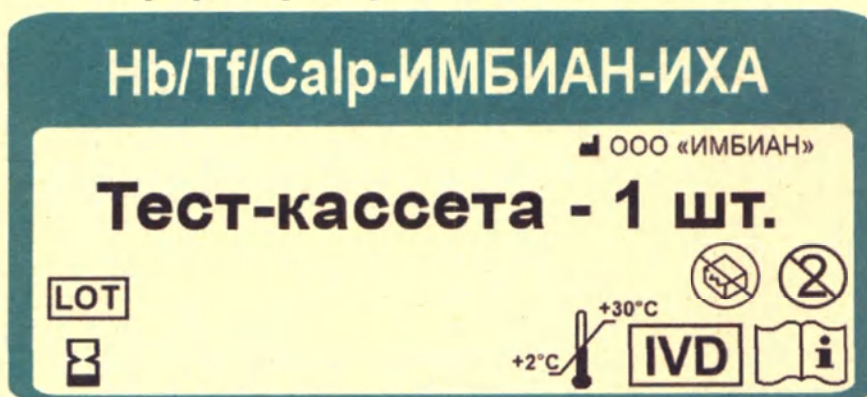

2. Маркировка буферного раствора, 2,0 мл (Комплект 1):

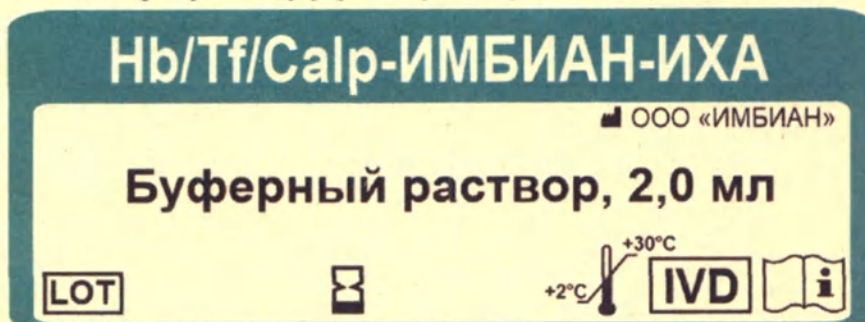

3. Маркировка буферного раствора, 2,0 мл (Комплект 2):

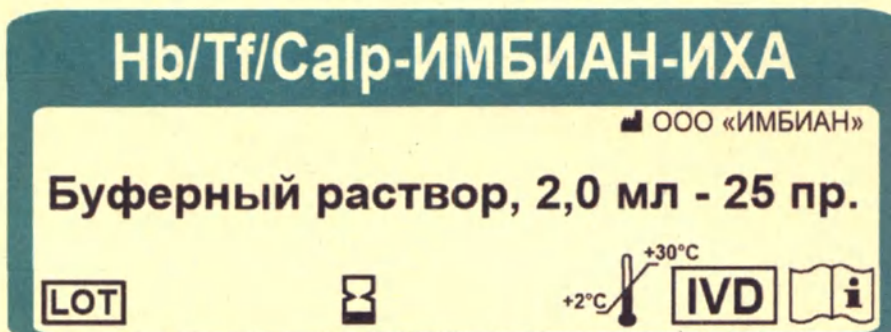

4. Наклейка для маркировки пробирки:

Label for the test tube. The label is rectangular with a dark blue header containing the text "ООО «ИМБИАН»". Below the header, there are three lines for text entry: "ФИО: _____", "№ образца: _____", and "Дата: _____".

5. Маркировка коробки (потребительской упаковки). Комплект 1:
сторона 1

Hb/Tf/Calp- ИМБИАН-ИХА

Комплект № 1

Экспресс-тест для качественного
иммунохроматографического определения
гемоглобина, трансферрина, кальпротектина
в образцах кала «Hb/Tf/Calp-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-057-39271034-2023

- Тест-кассета
- Буферный раствор, 2,0 мл
- Пипетки медицинские полимерные МиниМед
по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019:
Пипетки для переноса жидкостей (Пастера),
0,25 мл (ПУ № РЗН 2019/8912)
- Инструкция по применению

1 шт.

1 пр.

ПУ № XXX XXXX/XXXXX Imbian

LOT

ГТММДД

REF

iBR-013/1


ГТГГ-ММ-ДД

ГТГГ-ММ-ДД

1 шт.

1 шт.

Замораживание не допускается.
Для профессионального применения.



сторона 2



ООО «ИМБИАН», 630554, Новосибирская область,
м.р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с. Барышево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1.

IMBIAN LLC, Lenin street 247, building 4, room 1,
village Baryshevo, rural settlement Baryshevsky selsovet,
Novosibirsky microdistrict, Novosibirsk Region, 630554.


Imbian

+7 (383) 209-34-54

 www.imbian.ru

 info@imbian.ru

6. Маркировка коробки (потребительской упаковки). Комплект 2:
сторона 1

Нб/Тf/Саlp- ИМБИАН-ИХА

Комплект № 2

Экспресс-тест для качественного
иммунохроматографического определения
гемоглобина, трансферрина, кальпротектина в
образцах кала «Нб/Тf/Саlp-ИМБИАН-ИХА» по
ТУ 21.20.23-057-39271034-2023

- Тест-кассета
- Буферный раствор, 2,0 мл
- Пипетки медицинские полимерные МиниМед
по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019:
Пипетки для переноса жидкостей (Пастера),
0,25 мл (ПУ № РЗН 2019/8912)
- Наклейка для маркировки пробирки
- Инструкция по применению

25 шт.

25 пр.

ПУ № XXX XXXX/XXXXX

Imbian

LOT

ГГММДД

REF

iBR-013/2



ГГГГ-ММ-ДД



ГГГГ-ММ-ДД


25 шт.

25 шт.

1 шт.

Замораживание не допускается.

Для профессионального применения.



сторона 2



ООО «ИМБИАН», 630554, Новосибирская область,
м.р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с. Барышево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1.

IMBIAN LLC, Lenin street 247, building 4, room 1,
village Baryshevo, rural settlement Baryshevsky selsovet,
Novosibirsky microdistrict, Novosibirsk Region, 630554.



Imbian



+7 (383) 209-34-54



www.imbian.ru



info@imbian.ru

7. Маркировка транспортной тары:

**Нб/Tf/Calp-
ИМБИАН-ИХА**

Экспресс-тест для качественного
иммунохроматографического
определения гемоглобина, трансферрина,
кальпротектина в образцах кала
«Нб/Tf/Calp-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-057-39271034-2023

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Количество
Масса нетто
Масса брутто

шт.
кг
кг

LOT ГГММДД

 ГГГГ-ММ-ДД


REF iBR-013/1

 ГГГГ-ММ-ДД


Imbian

ООО «ИМБИАН»
630554, Новосибирская область,
м. р-н Новосибирский,
с.п. Барышевский сельсовет,
с. Барышево, ул. Ленина,
зд. 247, к. 4, помещ. 1
+7 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Замораживание не допускается.



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

лист 8
Директор ООО «ИМБИАН»

С.А. Иванов "10" 07 2023г

