

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Компания «БиВи»

Т.А. Носова

«24» апреля 2023 г.



ПО ДОВЕРЕННОСТИ
77 АД 1754197

КУСАЙЛО Р. В.

Фотографические изображения изделия:

Разбавитель образца (Sample Diluent) для автоматических электрохемилюминесцентных анализаторов ECL для диагностики in vitro


«Shenzhen Lifotronic Technology Co., Ltd.»
(«Шэньчжэнь Лайфотроник Технолоджи Ко., Лтд.»), Китай



Общий вид МИ «Разбавитель образца (Sample Diluent) для автоматических электрохемилюминесцентных анализаторов ECL для диагностики in vitro»



Потребительская упаковка МИ «Разбавитель образца (Sample Diluent) для автоматических электрохемилюминесцентных анализаторов ECL для диагностики in vitro»

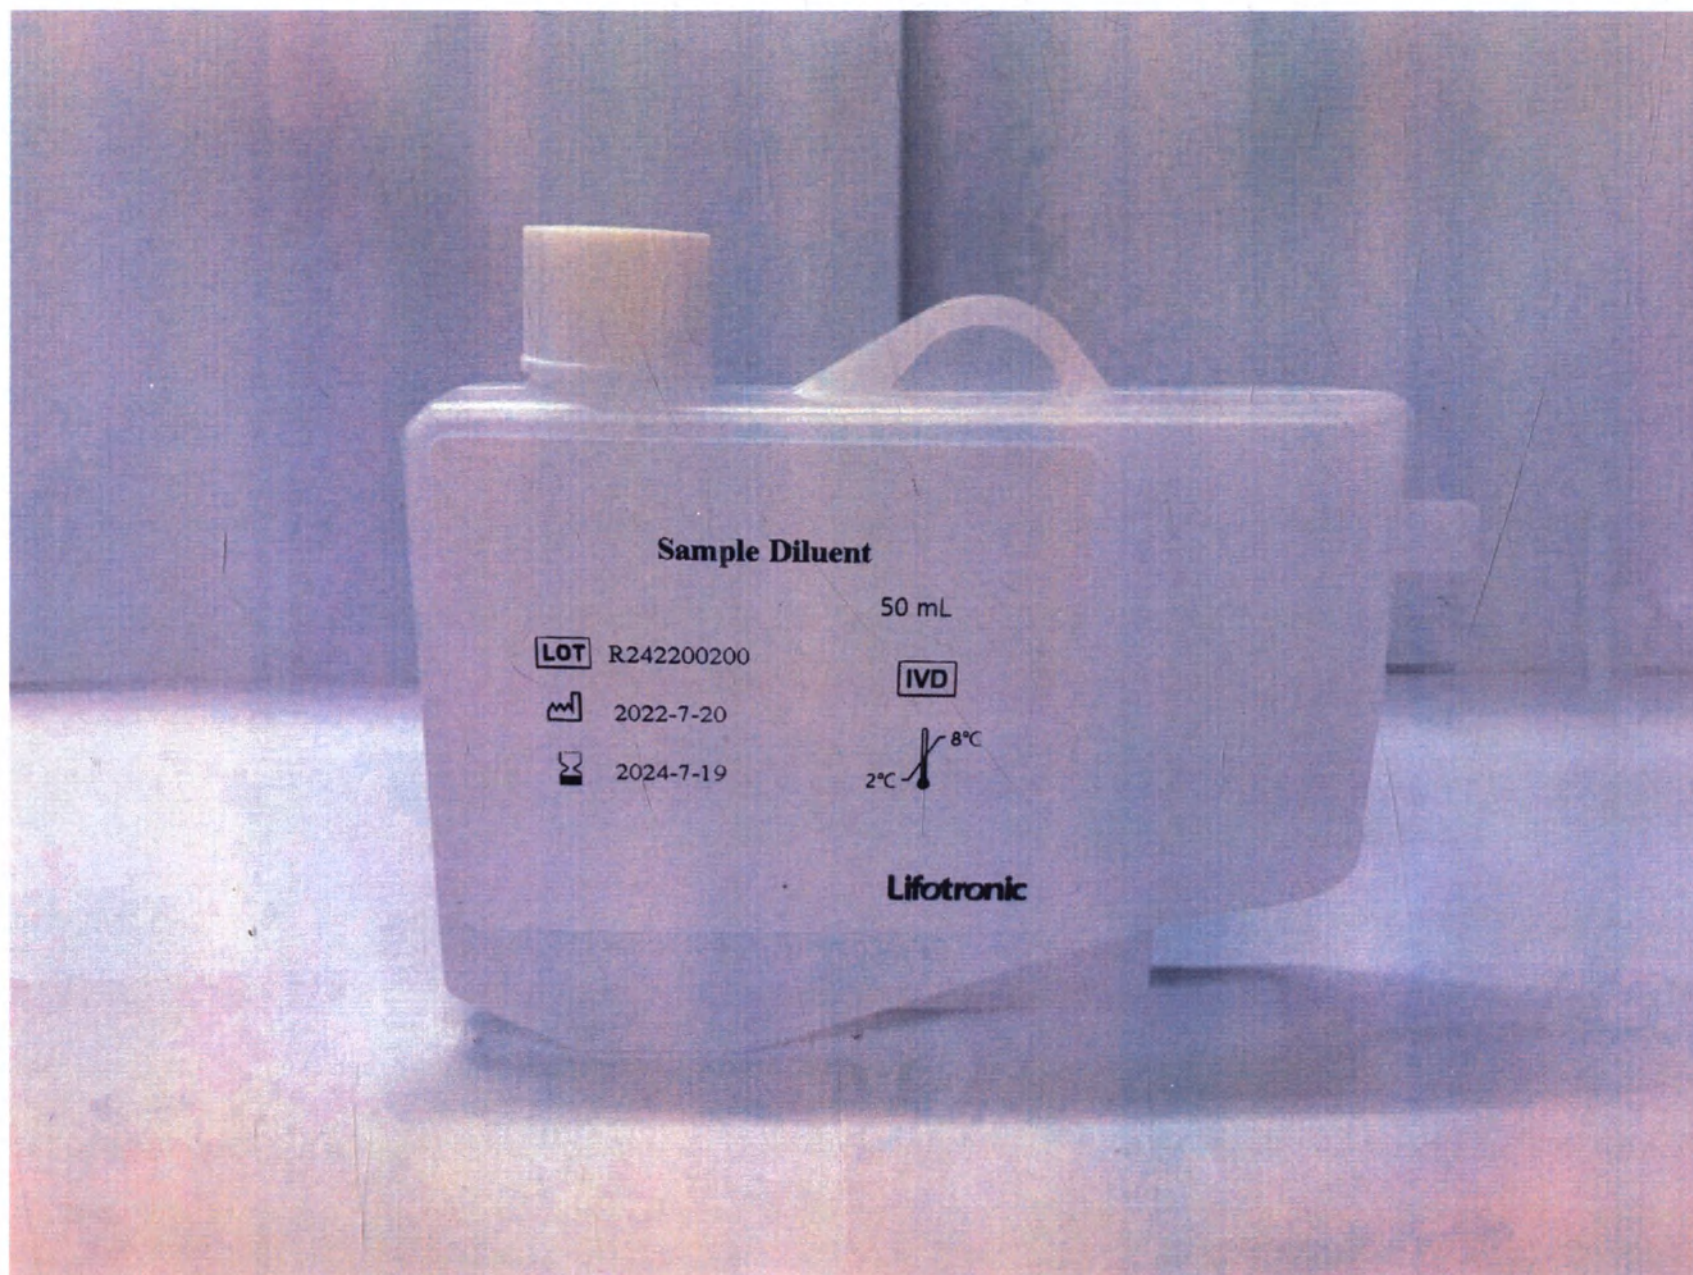

Общий вид флакона с маркировкой

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 4 листа (-ов)

Генеральный директор _____ / Носова Т.А
М.П.

ПО ДОВЕРЕННОСТИ
77АД 1754197
КУСАНДОВ В.

