
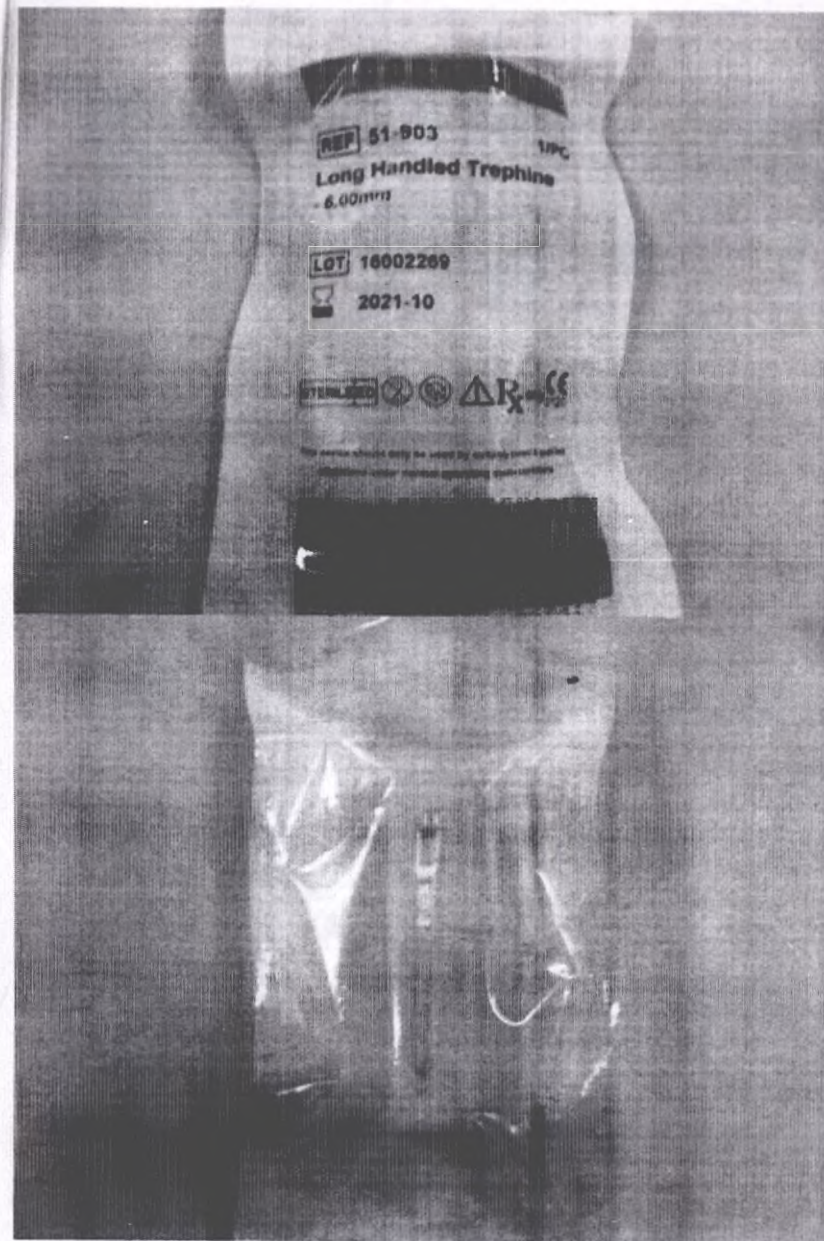


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Инструменты для кератопластики CORONET



Инструменты для кератопластики CORONET

1. Трепан роговичный с рукояткой, варианты исполнения: 6,00 мм, 6,25 мм, 6,50 мм, 6,75 мм, 7,00 мм, 7,25 мм, 7,50 мм, 7,75 мм, 8,00 мм, 8,25 мм, 8,50 мм, 8,75 мм, 9,00 мм, 9,25 мм, 9,50 мм, 9,75 мм, 10,00 мм, 10,50 мм;

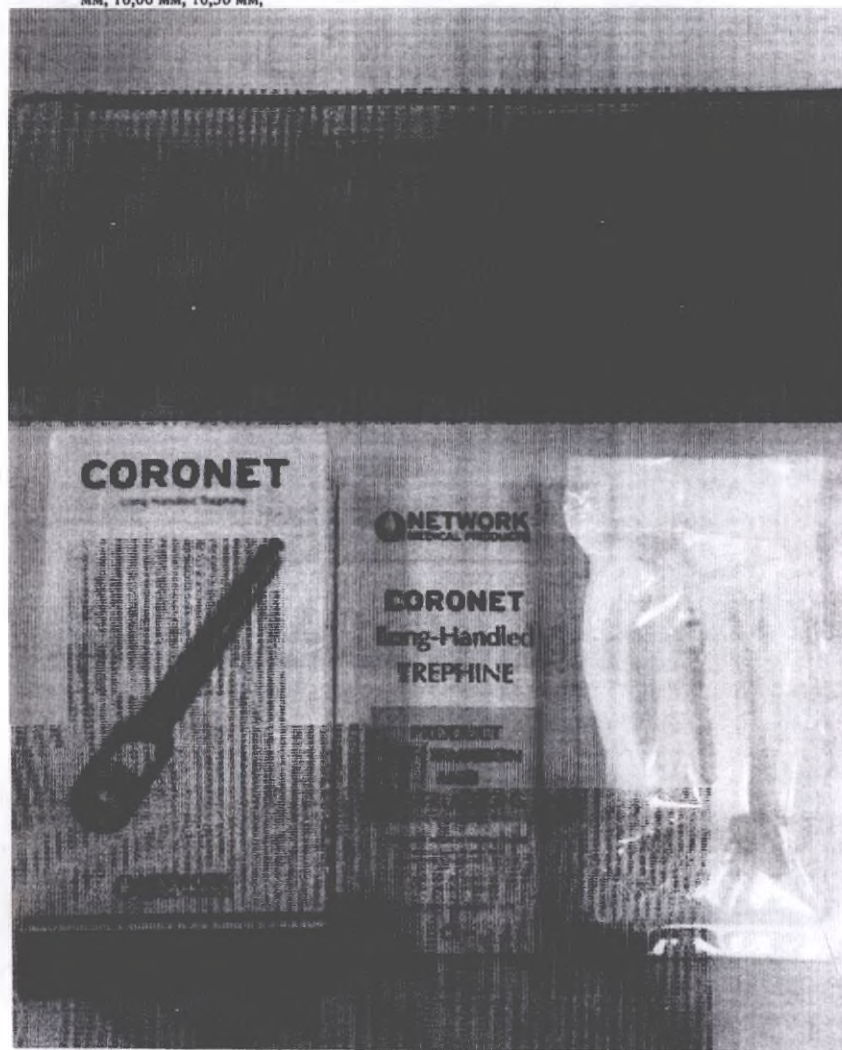

2. Трепан роговичный стандартный, варианты исполнения:

- без координатной сетки: 6,00 мм, 6,25 мм, 6,50 мм, 6,75 мм, 7,00 мм, 7,25 мм, 7,50 мм, 7,75 мм, 8,00 мм, 8,25 мм, 8,50 мм, 8,75 мм, 9,00 мм, 9,25 мм, 9,50 мм, 9,75 мм;

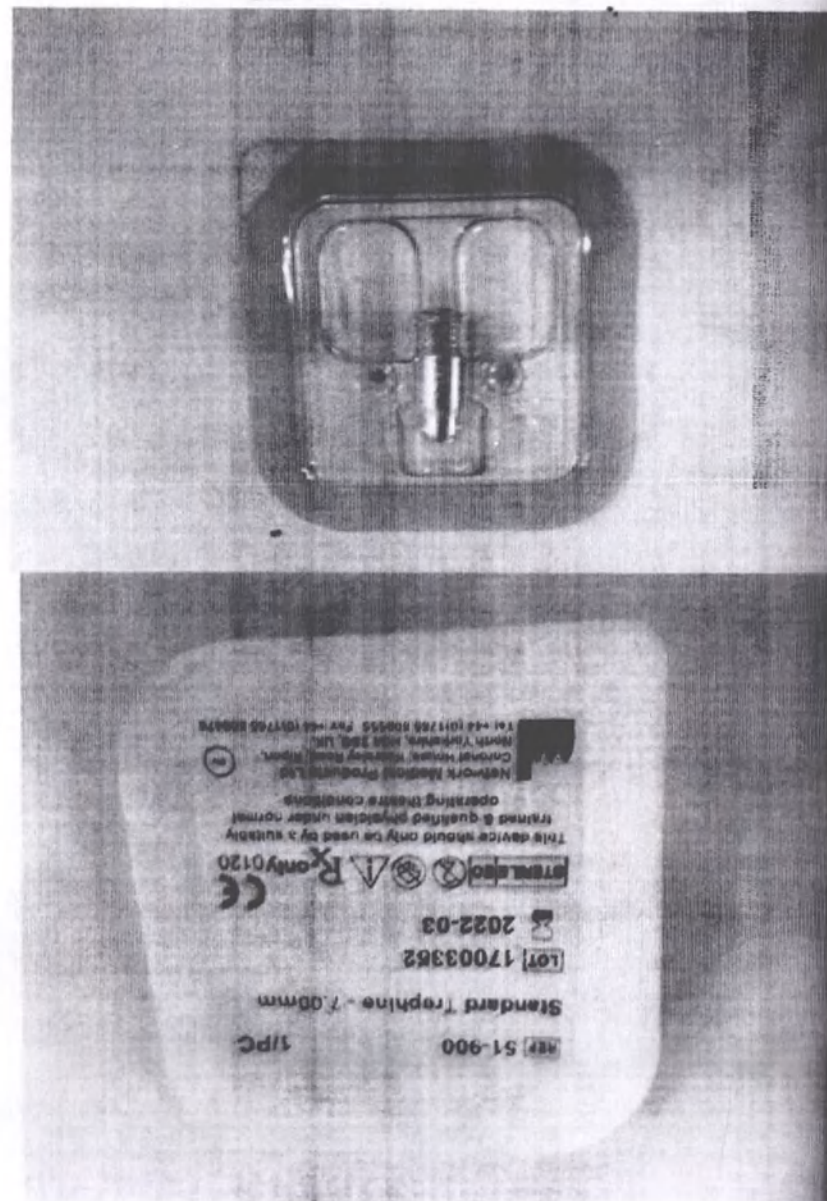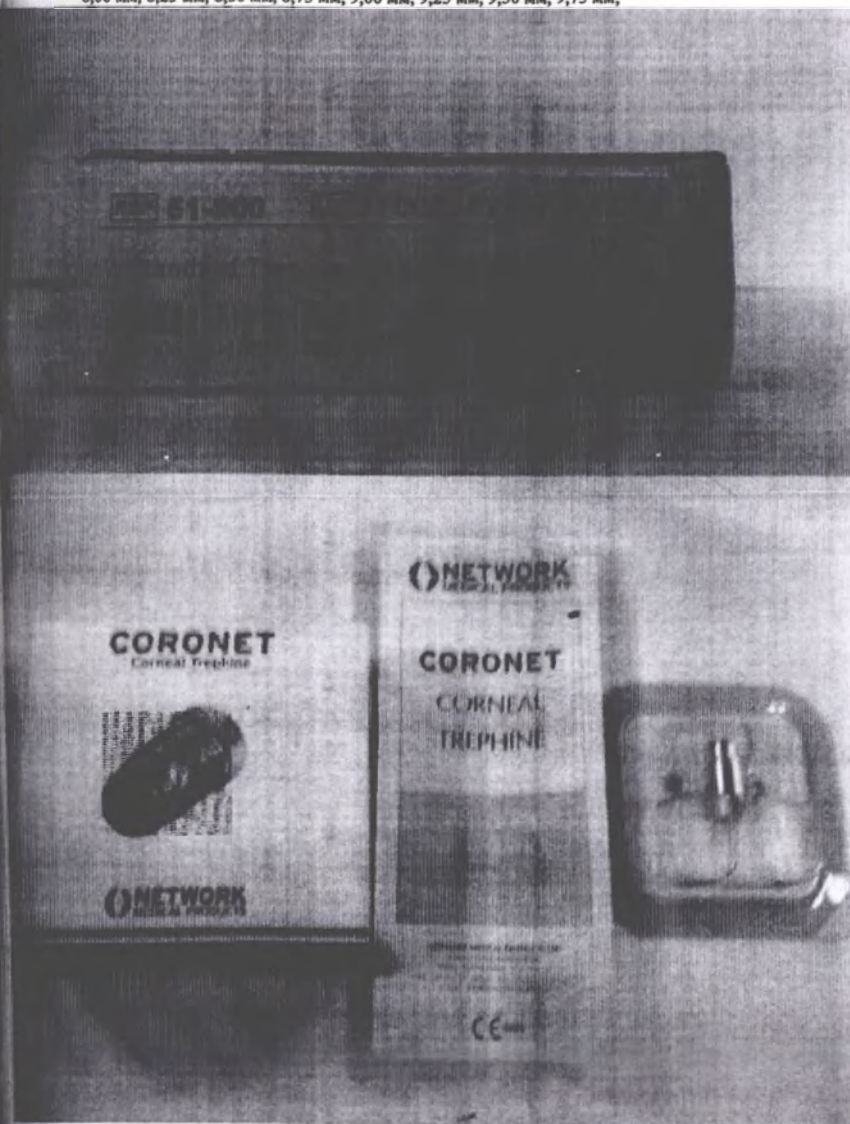

- без координатной сетки, в комплекте с высекателем донорской роговицы: 6,00 мм, 6,25 мм, 6,50 мм, 6,75 мм, 7,00 мм, 7,25 мм, 7,50 мм, 7,75 мм, 8,00 мм, 8,25 мм, 8,50 мм, 8,75 мм, 9,00 мм, 9,25 мм, 9,50 мм, 9,75 мм;

без координатной сетки, в комплекте с высекателем донорской роговицы вакуумным: 6,00 мм, 6,25 мм, 6,50 мм, 6,75 мм, 7,00 мм, 7,25 мм, 7,50 мм, 7,75 мм, 8,00 мм, 8,25 мм, 8,50 мм, 8,75 мм, 9,00 мм, 9,25 мм, 9,50 мм, 9,75 мм;

REF 51-835 LOT 16002419 2021-11

Donor Trophine Vacuum Punch - 6.25mm  0120



(01)05090155011162(17)211130(10)16002419 **R_o only**


CORONET



NETWORK
MULTIMEDIA AND TELEVISION

CORONET
DONOR TRIPHENYL
VACUUM PLINCH

PRODUCT INFORMATION AND INSTRUCTIONS


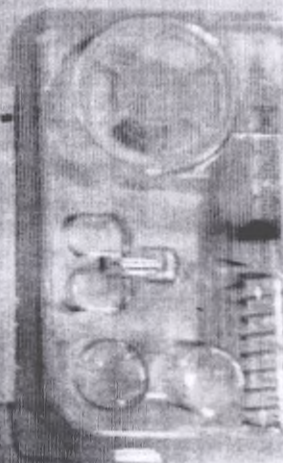


REF 61-838 1/PC




Donor Trepiline
Vacuum Punch - 6.25mm

LOT 16002419

2021-11

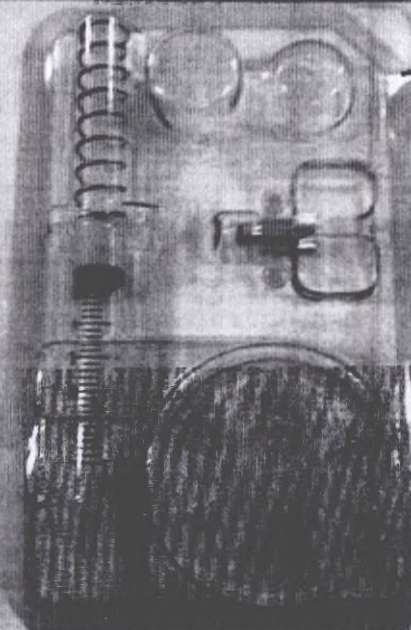



- с координатной сеткой: 6,00 мм, 6,25 мм, 6,50 мм, 6,75 мм, 7,00 мм, 7,25 мм, 7,50 мм, 7,75 мм, 8,00 мм, 8,25 мм, 8,50 мм, 8,75 мм, 9,00 мм, 9,25 мм, 9,50 мм;

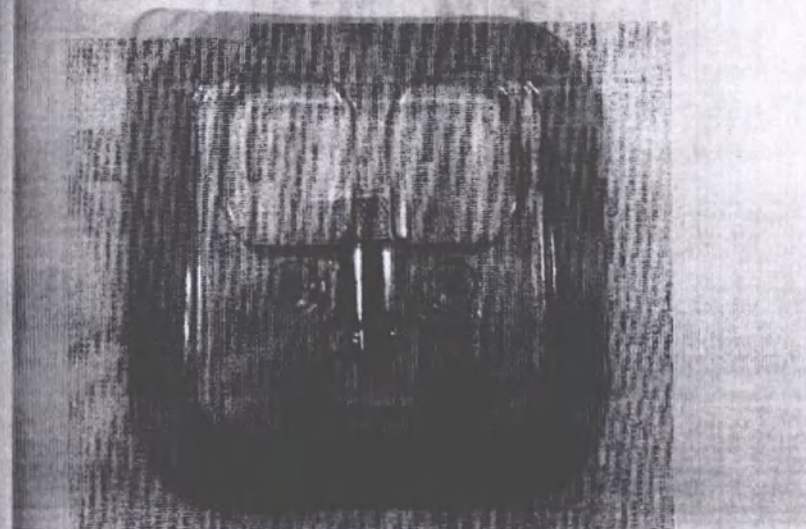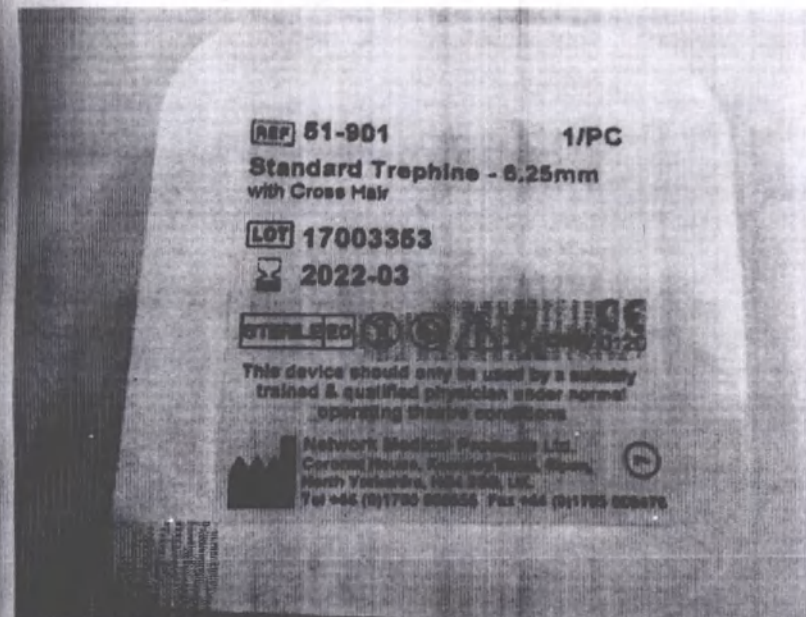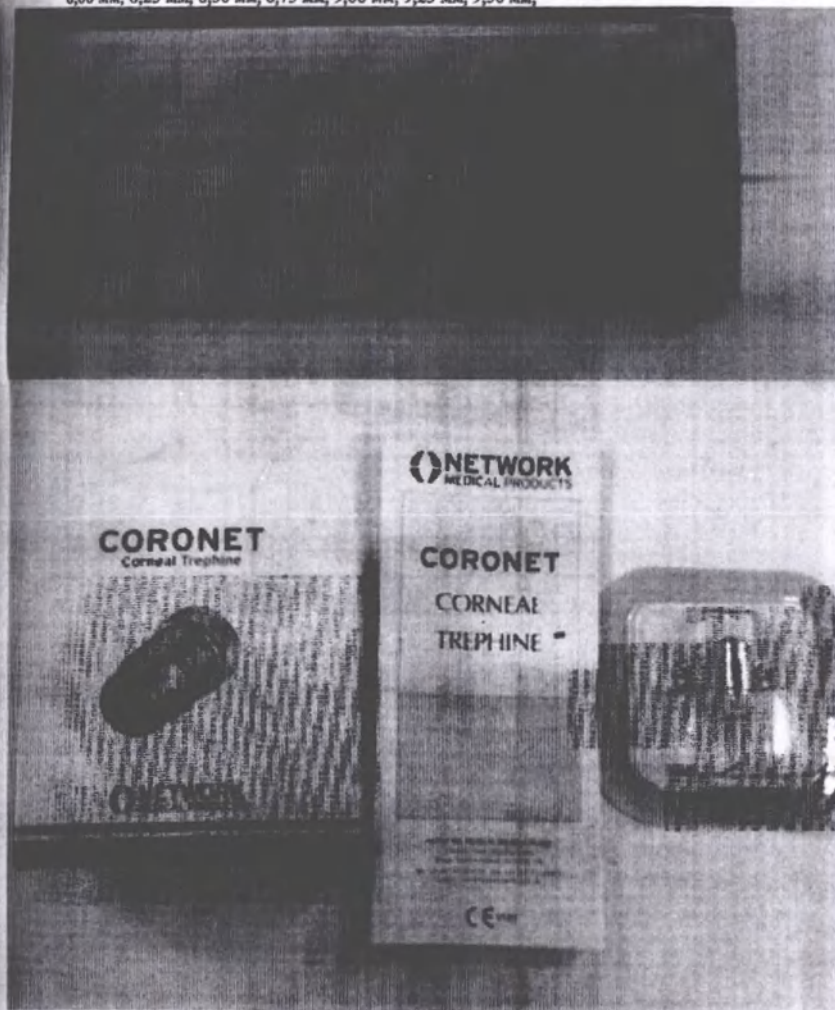


3. Трепан роговичный с заданной глубиной высекания, варианты исполнения:

- 300мкм: 7,00 мм, 7,50 мм, 8,00 мм, 8,50 мм;
- 400 мкм: 7,00 мм, 7,50 мм, 8,00 мм, 8,50 мм;



4. Трепан для ДМЕК процедуры в комплекте с высекателем донорской роговицы вакуумным: 7,00 мм, 7,50 мм, 8,00 мм, 8,50 мм; 9,00; 9,50; 9,75

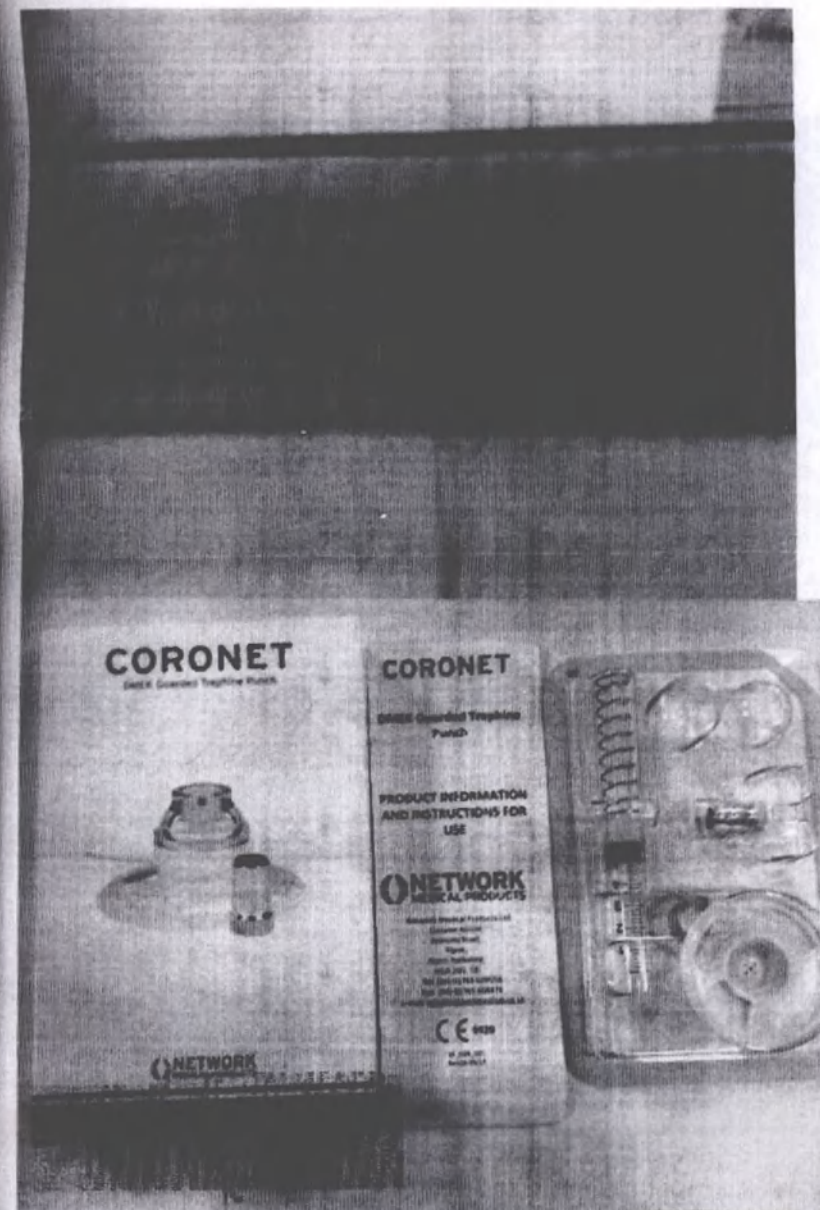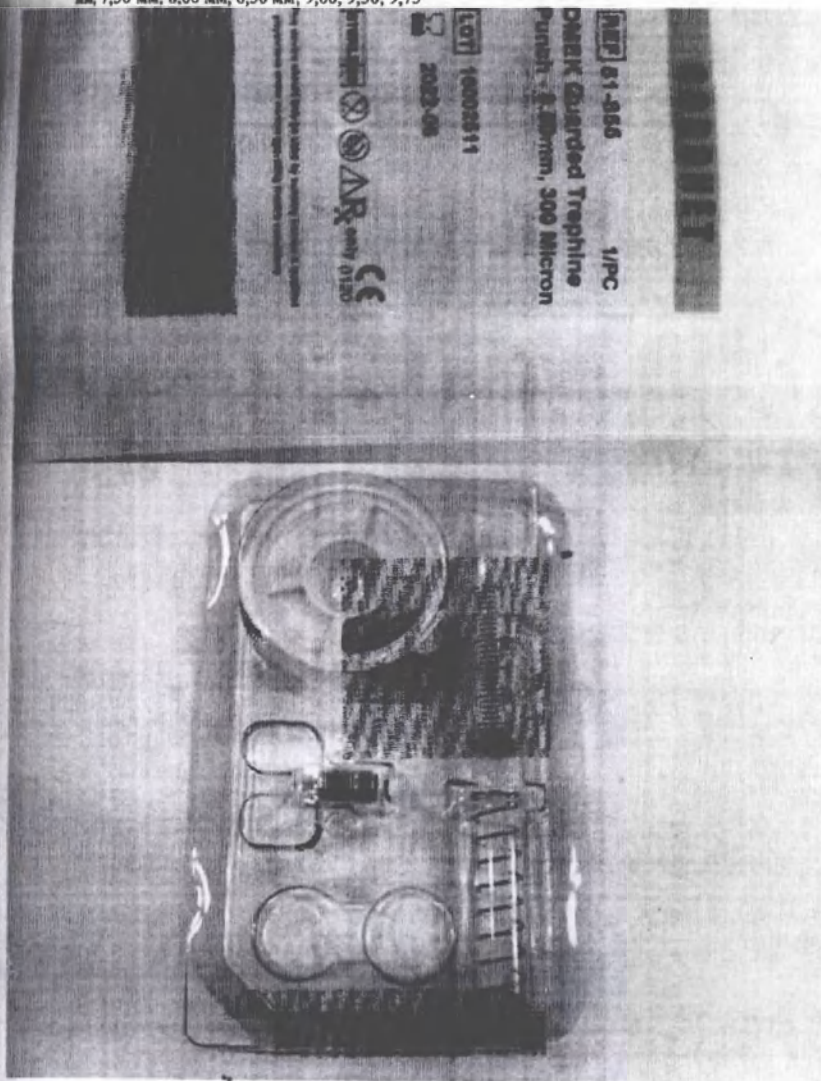

5. Трепан роговичный вакуумный: 6,50 мм, 6,75 мм, 7,00 мм, 7,25 мм, 7,50 мм, 7,75 мм, 8,00 мм, 8,25 мм, 8,50 мм, 8,75 мм, 9,00 мм, 9,50 мм;

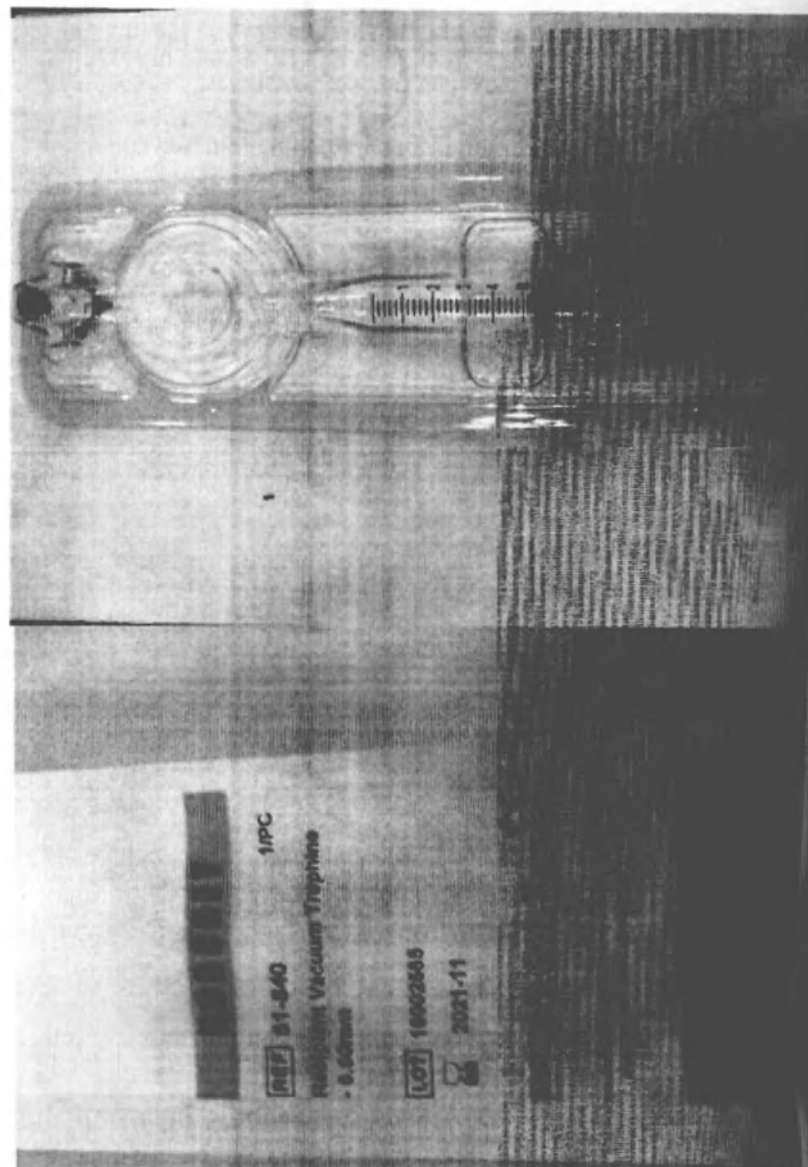

6. Трепан роговичный вакуумный Clear-Vue: 6,50 мм, 6,75 мм, 7,00 мм, 7,25 мм, 7,50 мм, 7,75 мм, 8,00 мм, 8,25 мм, 8,50 мм, 8,75 мм, 9,00 мм, 9,50 мм;

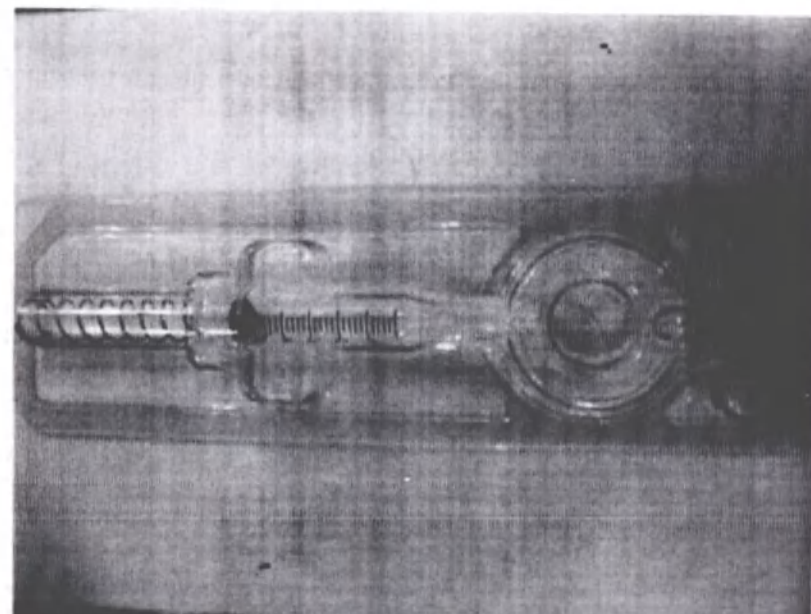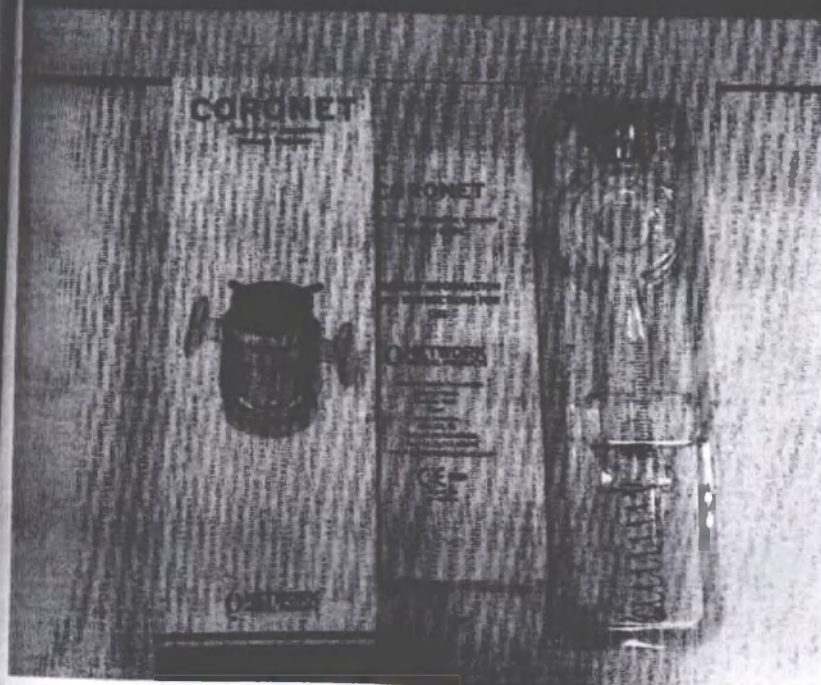

CORONET

REF 51-842 1/PC

Clear-Vue™ Recipient Vacuum
Trephine for P.K. - 7.00mm


LOT 17005303

2020-04

CE
R_{only} 0120

This device must only be used by suitably trained & qualified
personnel under strict operating conditions

7. Трепан-экстрактор для донорской роговицы: 15 мм, 17 мм, 18 мм, 20 мм.

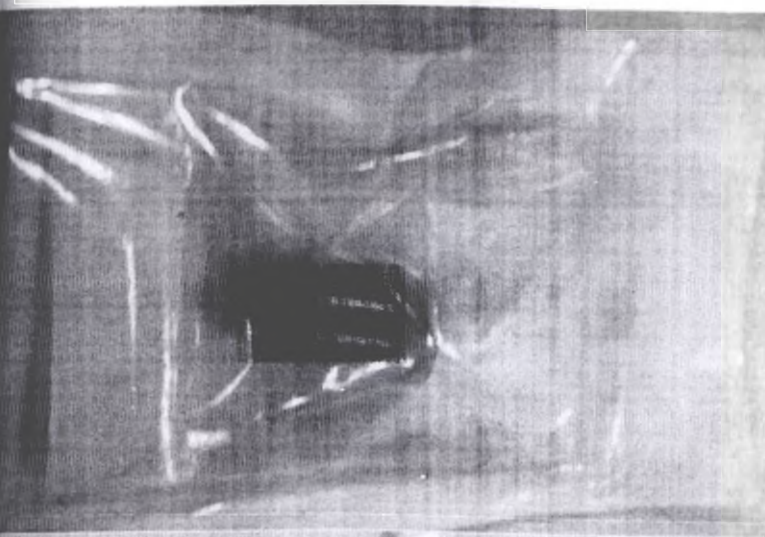

CORONET

REF 51-905 1/PC


Extractor Trephine
Extractor Trepano
- 16mm

LOT 16001753

2021-08

STERILISO CE 0123

www.networkmedica.com

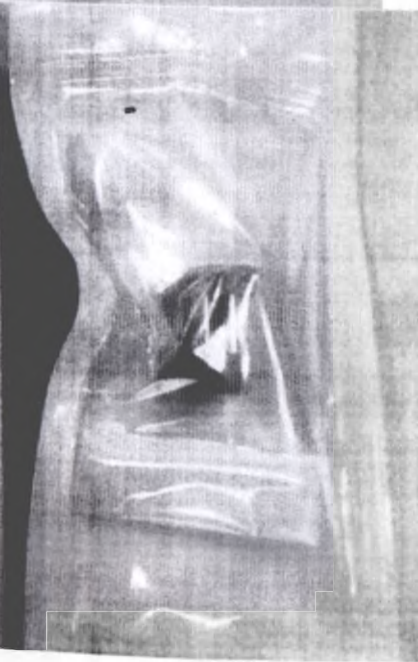

дуственная передняя камера;

51-935 LOT 17003725 2022-08


Artificial Anterior Chamber

CE 0120



1700050155012160117120052110117003725

R_x only

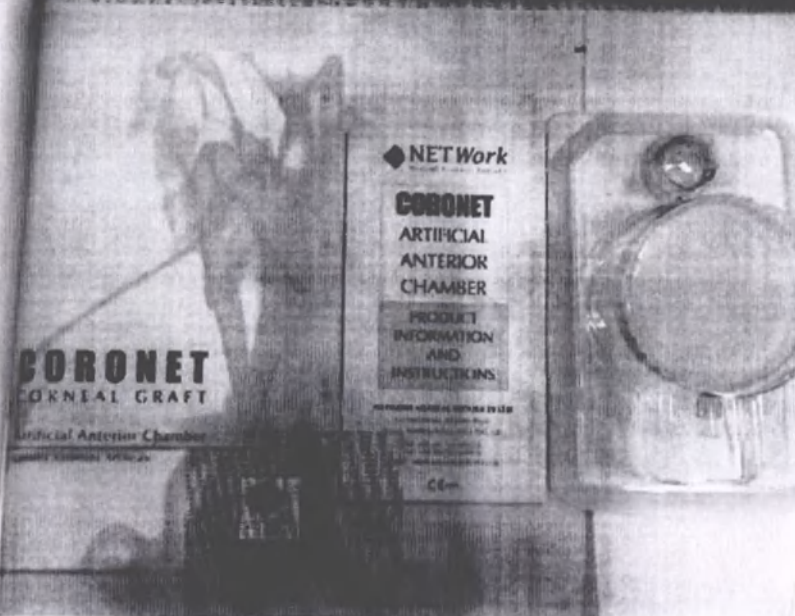


NETWork

CORONET
ARTIFICIAL
ANTERIOR
CHAMBER

PRODUCT
INFORMATION
AND
INSTRUCTIONS

www.networkmedica.com

CE

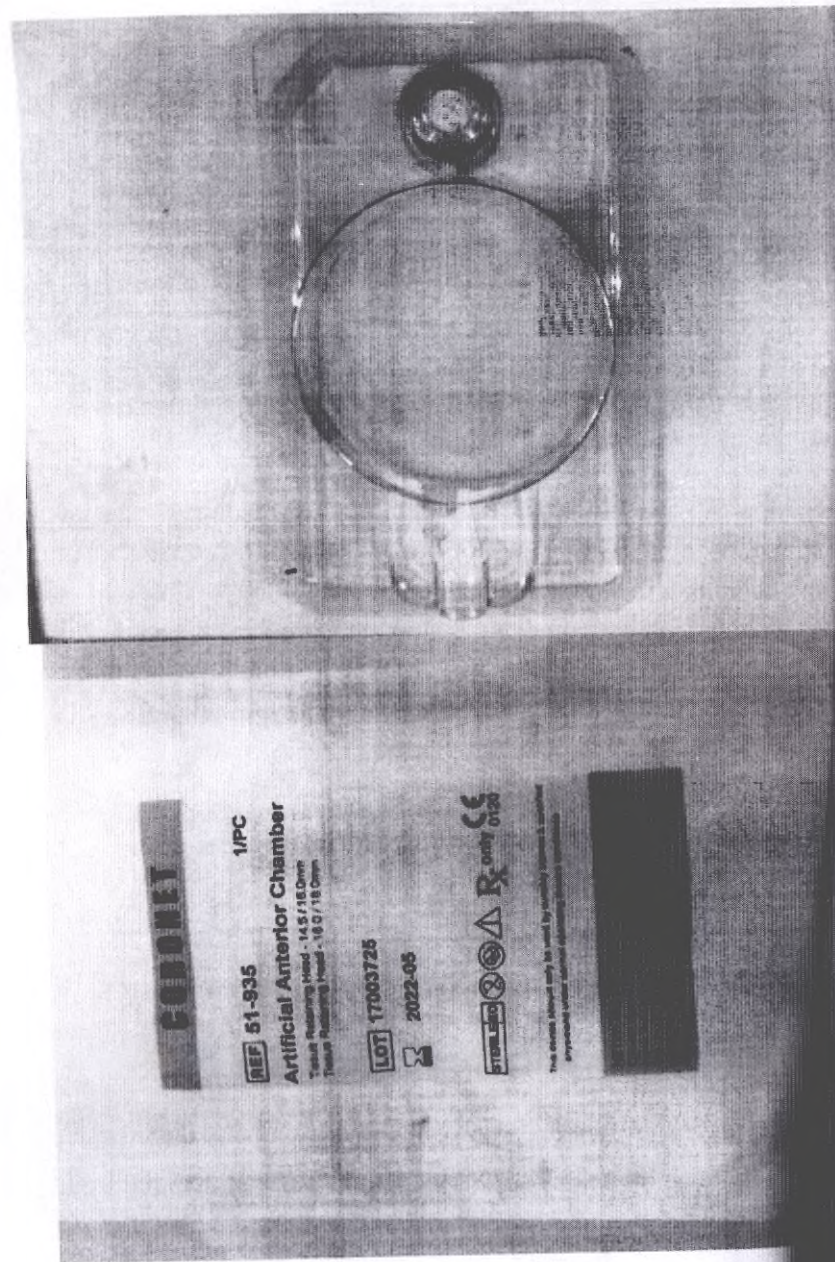

Всероссийский научно-исследовательский институт
и клинический госпиталь им. Н.И. Пирогова
г. Москва
Директор
И.И. Пирогов
1. Копия
2.

1/PC

REF 51-823

EndoGlide Ultrathin

Preparation Base, Intercut, Slicing & Curvature
Base de preparation, Intercut, Slicing & Curvature

LGT 17003315

2022-04

STERILE
CE 0120

Do not use inside of pouch in operating room
Do not use inside of pouch in operating room
Do not use inside of pouch in operating room
Do not use inside of pouch in operating room
Do not use inside of pouch in operating room