

Фотографические изображения медицинского изделия


Среда с адсорбентом для культивирования аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов на системе автоматической микробиологической серии ВС для *in vitro* диагностики, в вариантах исполнения


УТВЕРЖДАЮ

Руководитель департамента регистрации ООО «ИЛС»


Стариковская И.А.


« 21 » августа 2023 г.

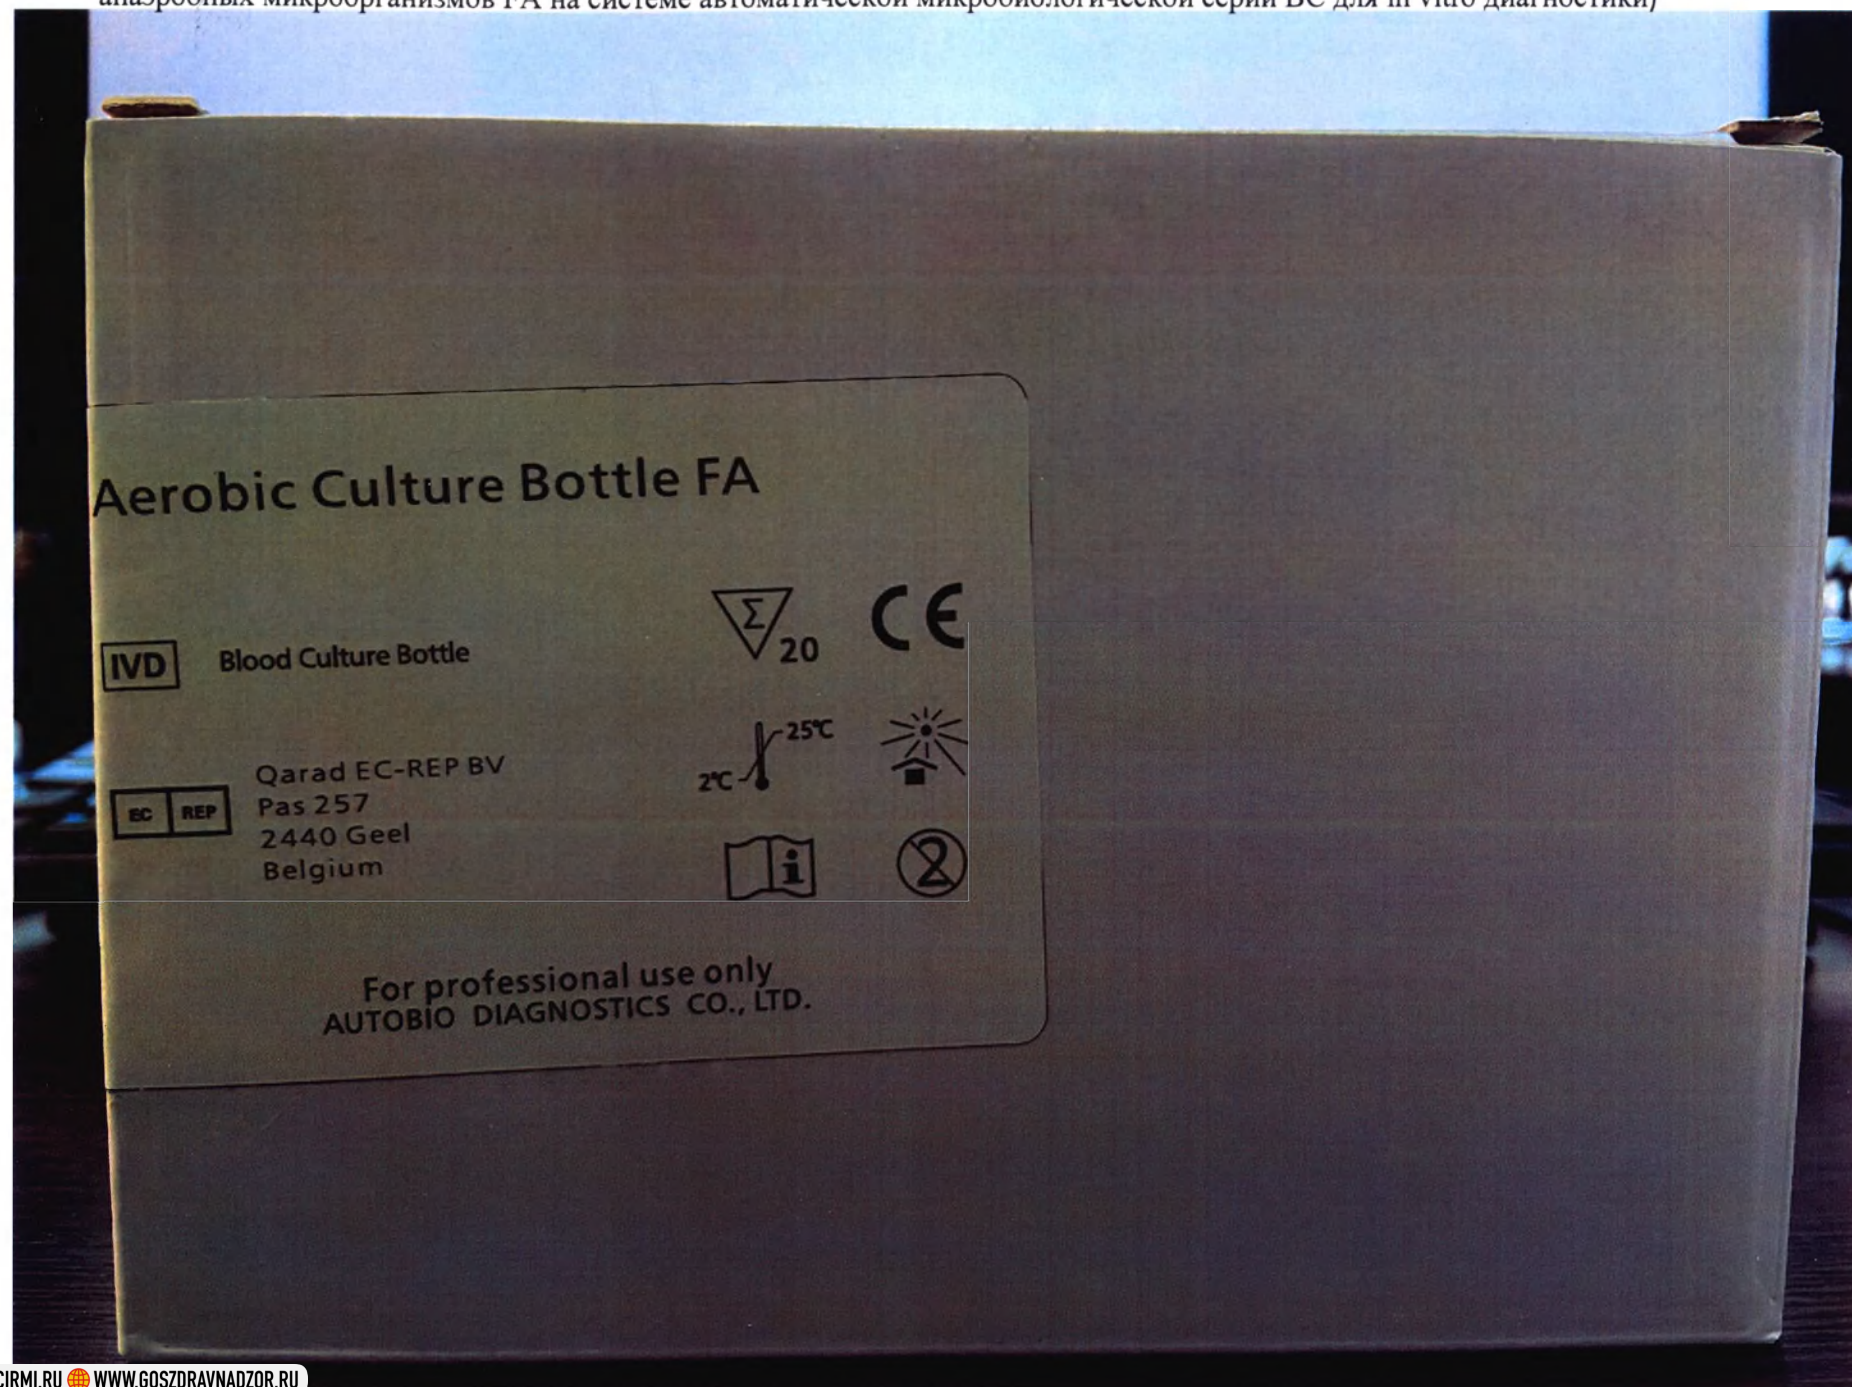

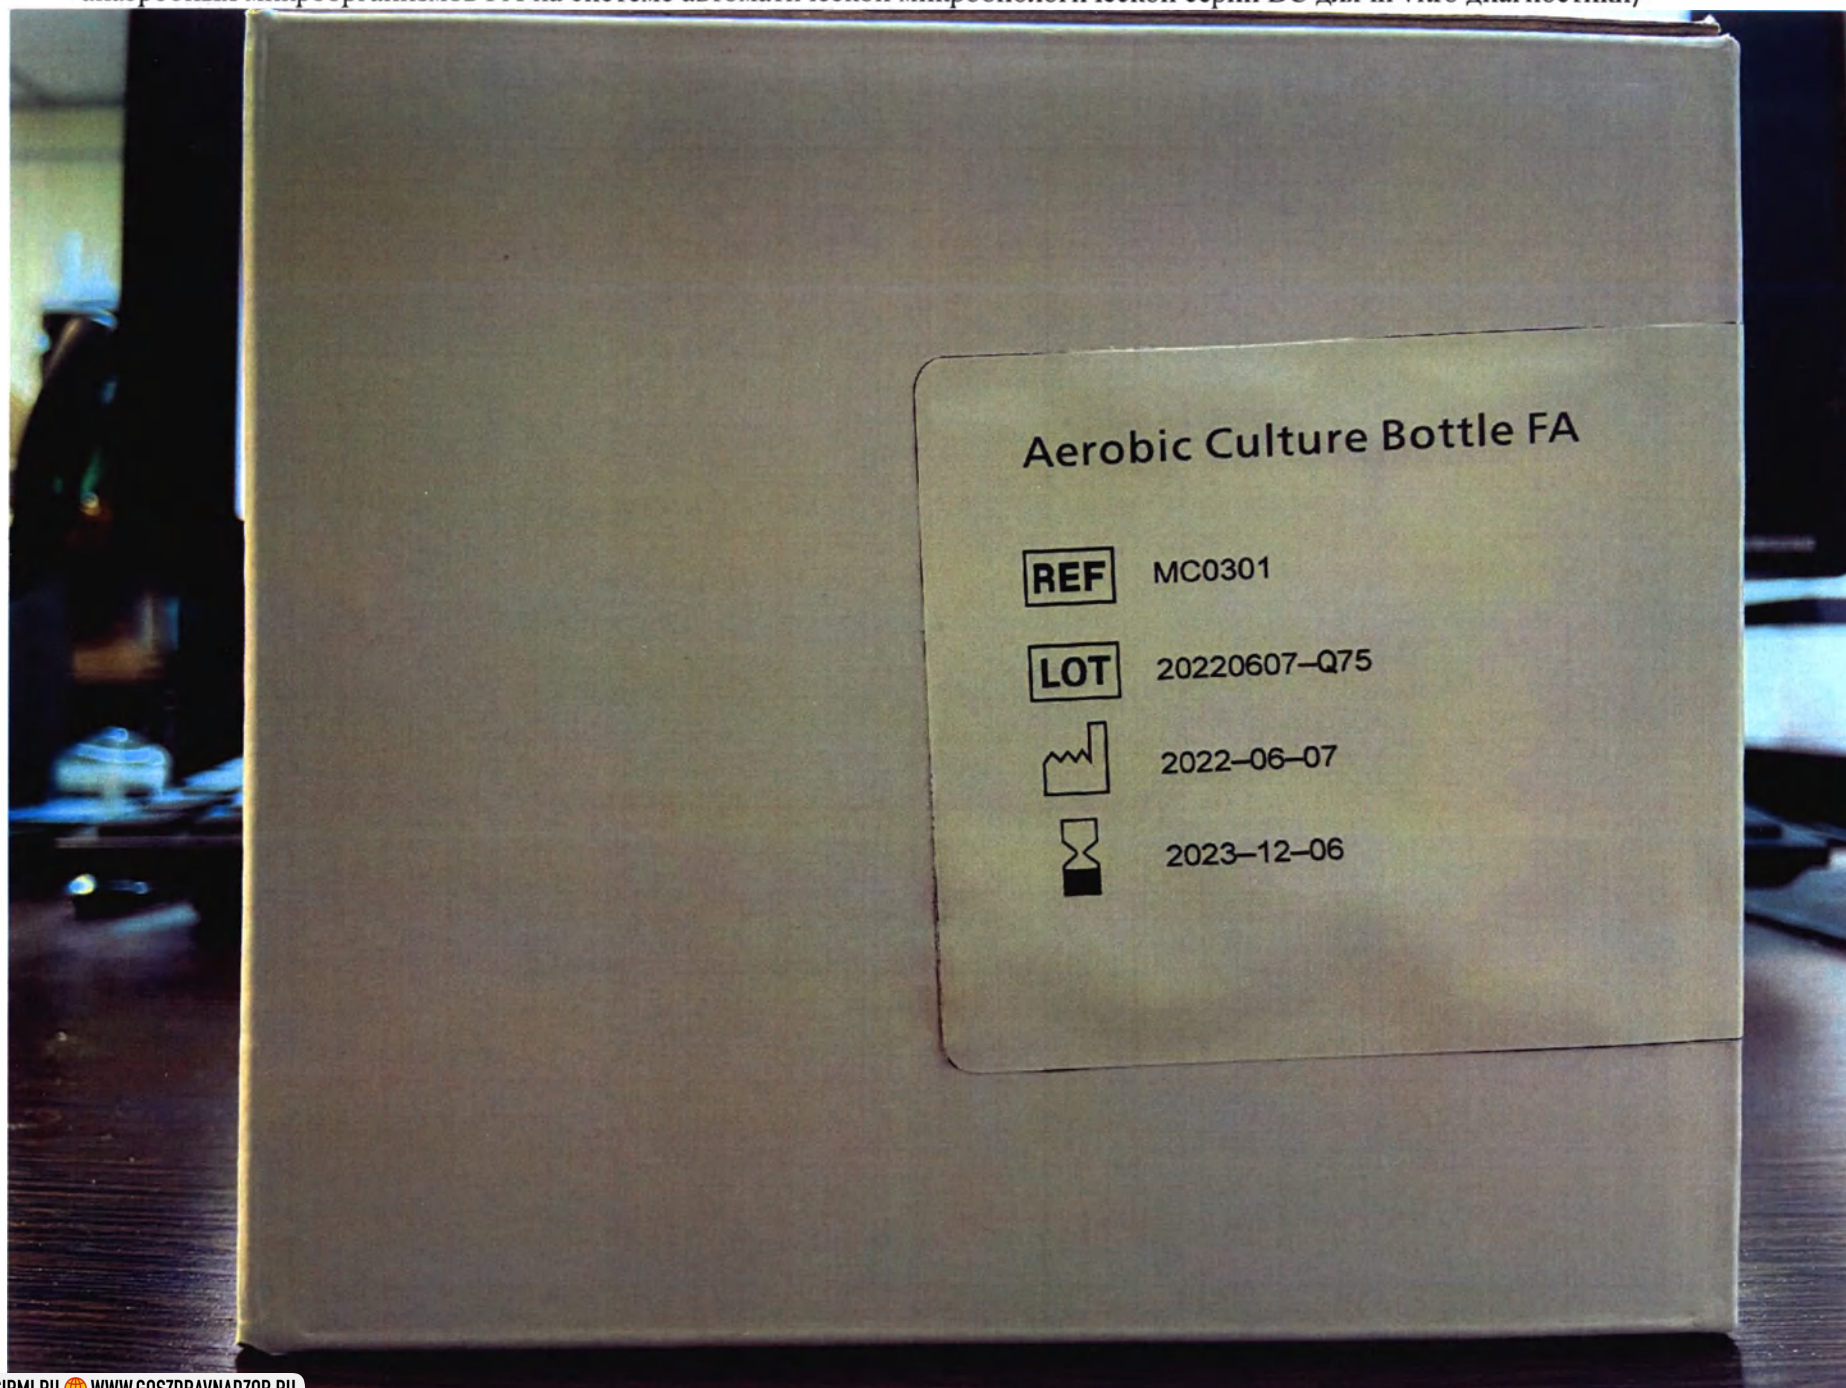



AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD.
No.87 Jingbei Yi Road, National Eco &
Tech Development Area, Zhengzhou,
China 450016
Tel: +86-371-67985313
Fax: +86-371-67985804
Web: www.autobio.com.cn


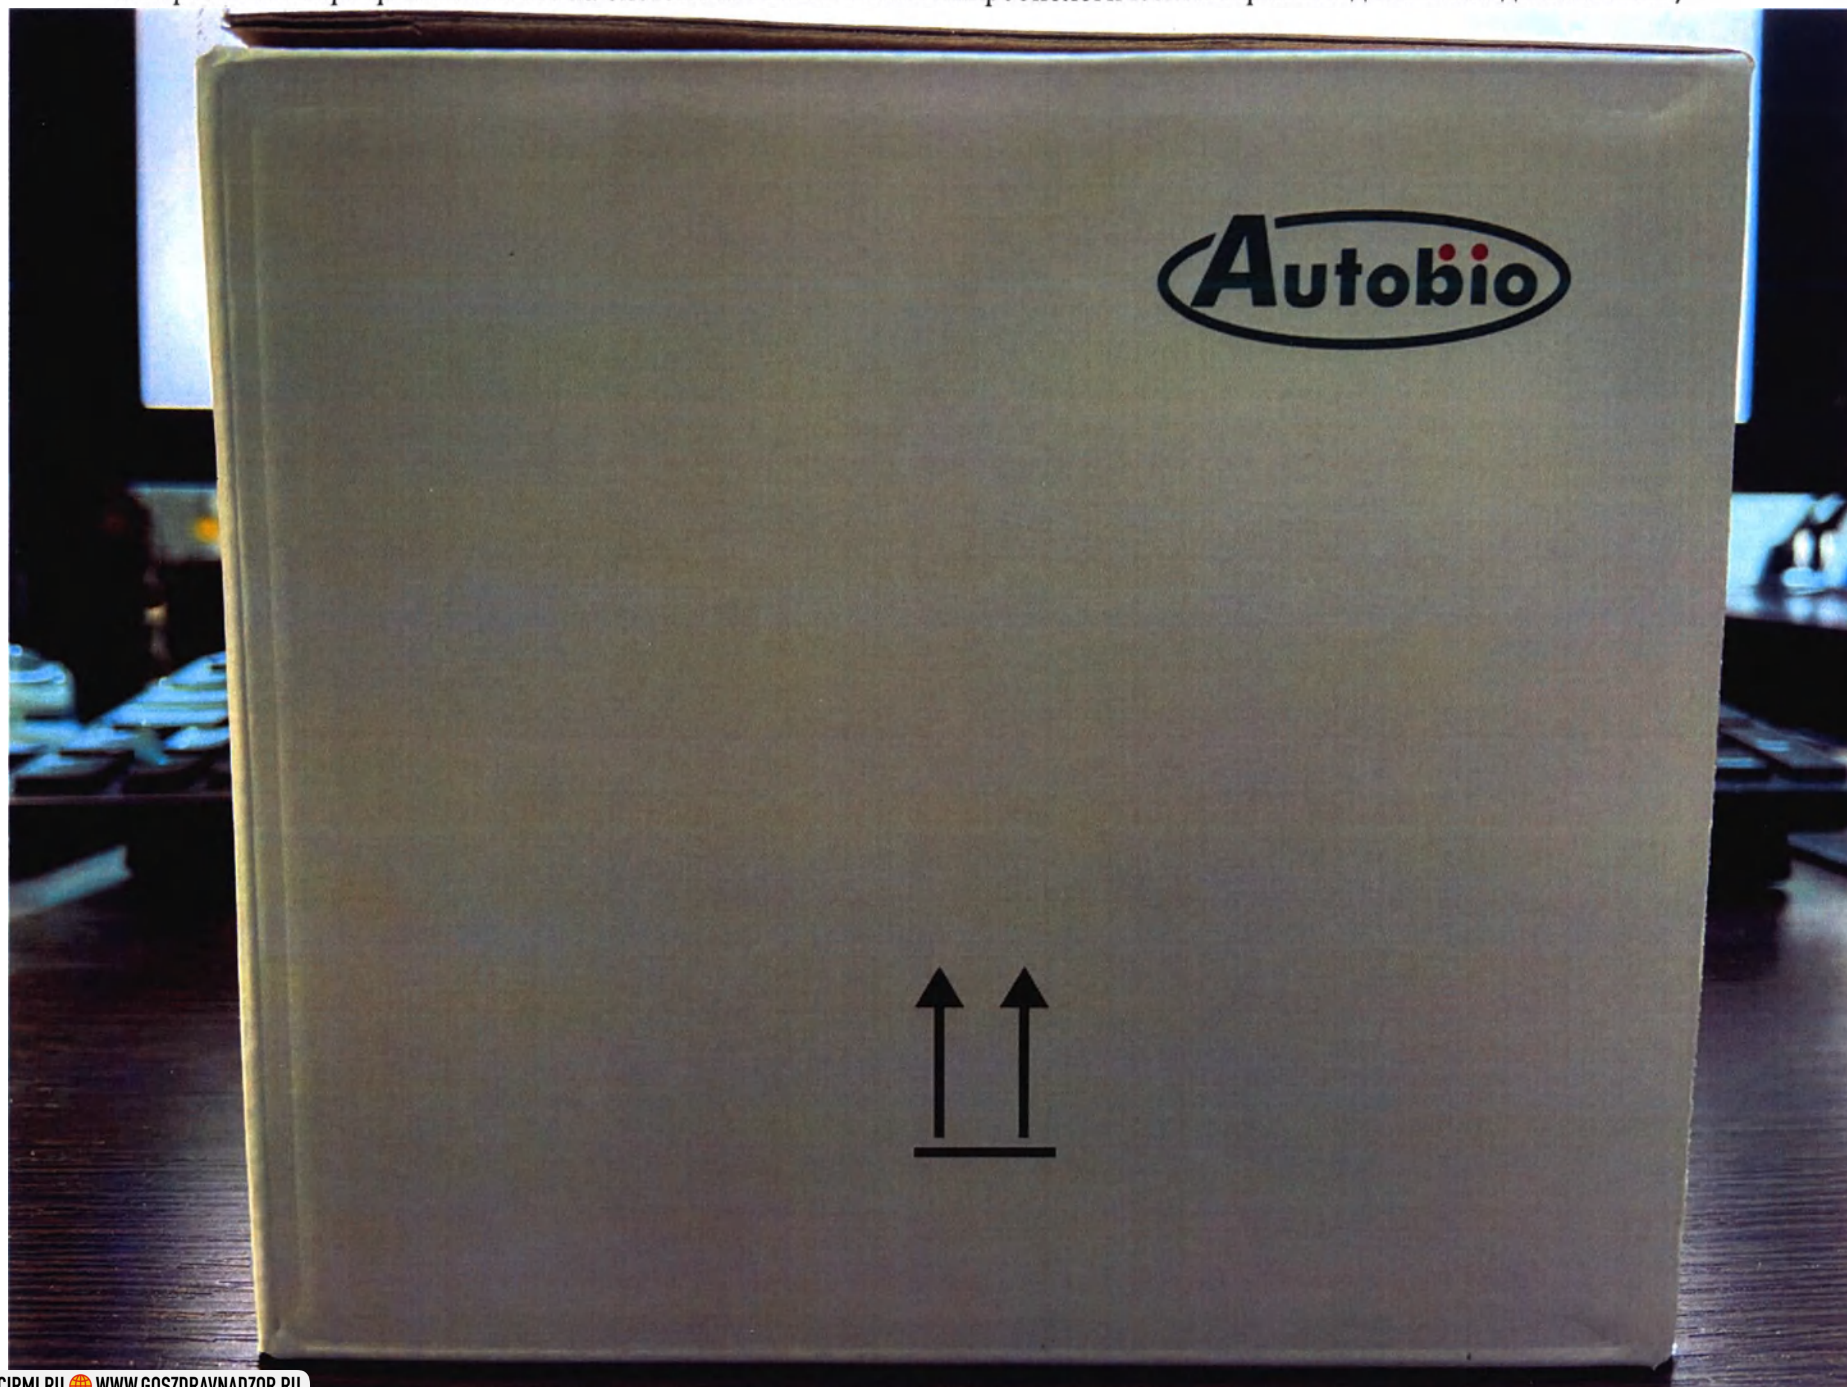


Aerobic Culture Bottle PF

IVD Blood Culture Bottle

EC REP

Qarad EC-REP BV
Pas 257
2440 Geel
Belgium



For professional use only
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD.

Aerobic Culture Bottle PF

REF MC0303

LOT 20220609-Q77


 2022-06-09

 2023-12-08





AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD.
No.87 Jingbei Yi Road,National Eco &
Tech Development Area,Zhengzhou,
China 450016
Tel:+86-371-67985313
Fax: +86-371-67985804
Web:www.autobio.com.cn




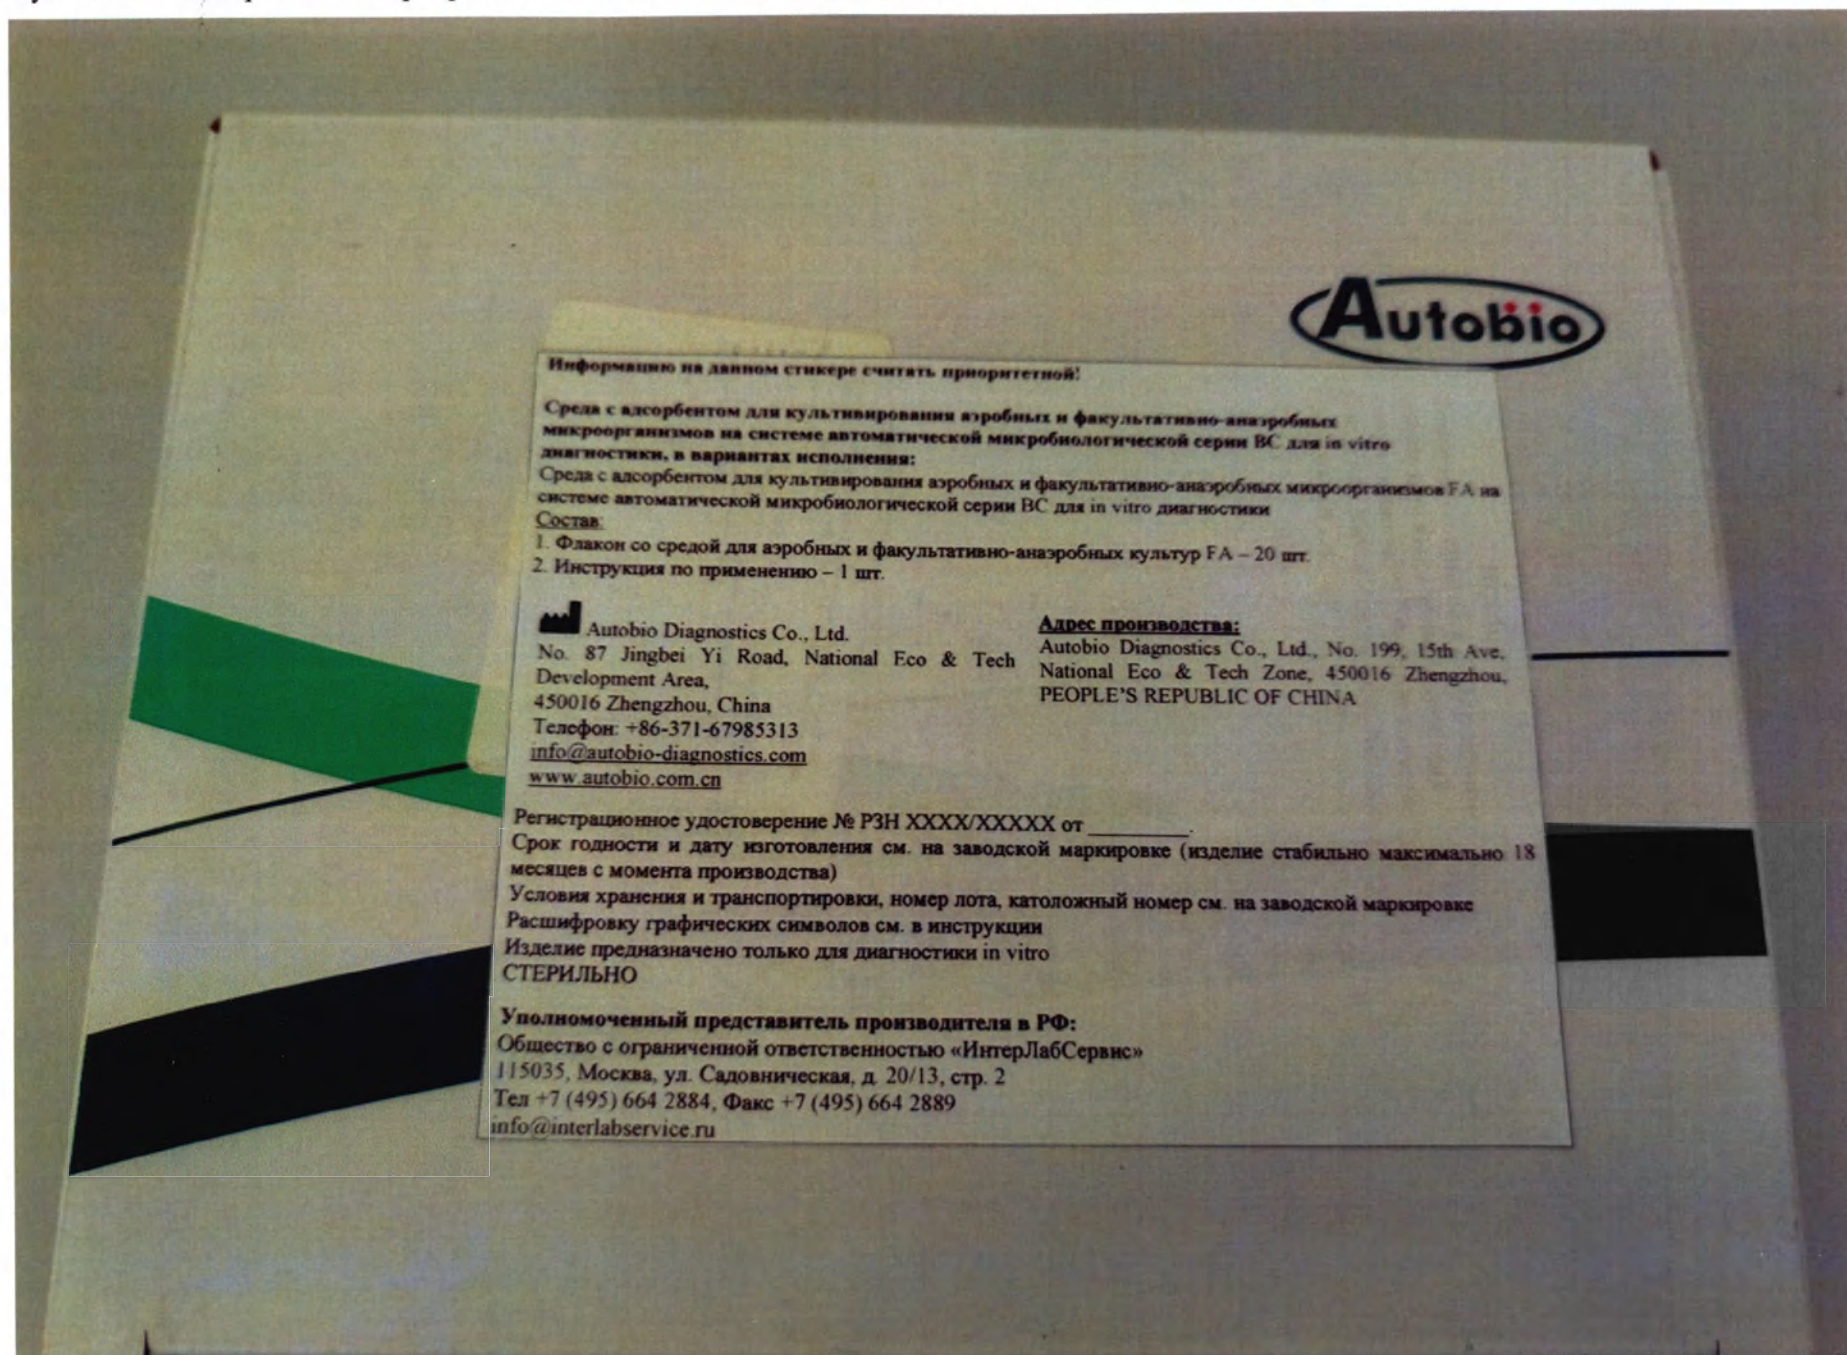

Пример маркировки на потребительской упаковке для обращения в РФ (Среда с адсорбентом для культивирования аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов PF на системе автоматической микробиологической серии ВС для in vitro диагностики)

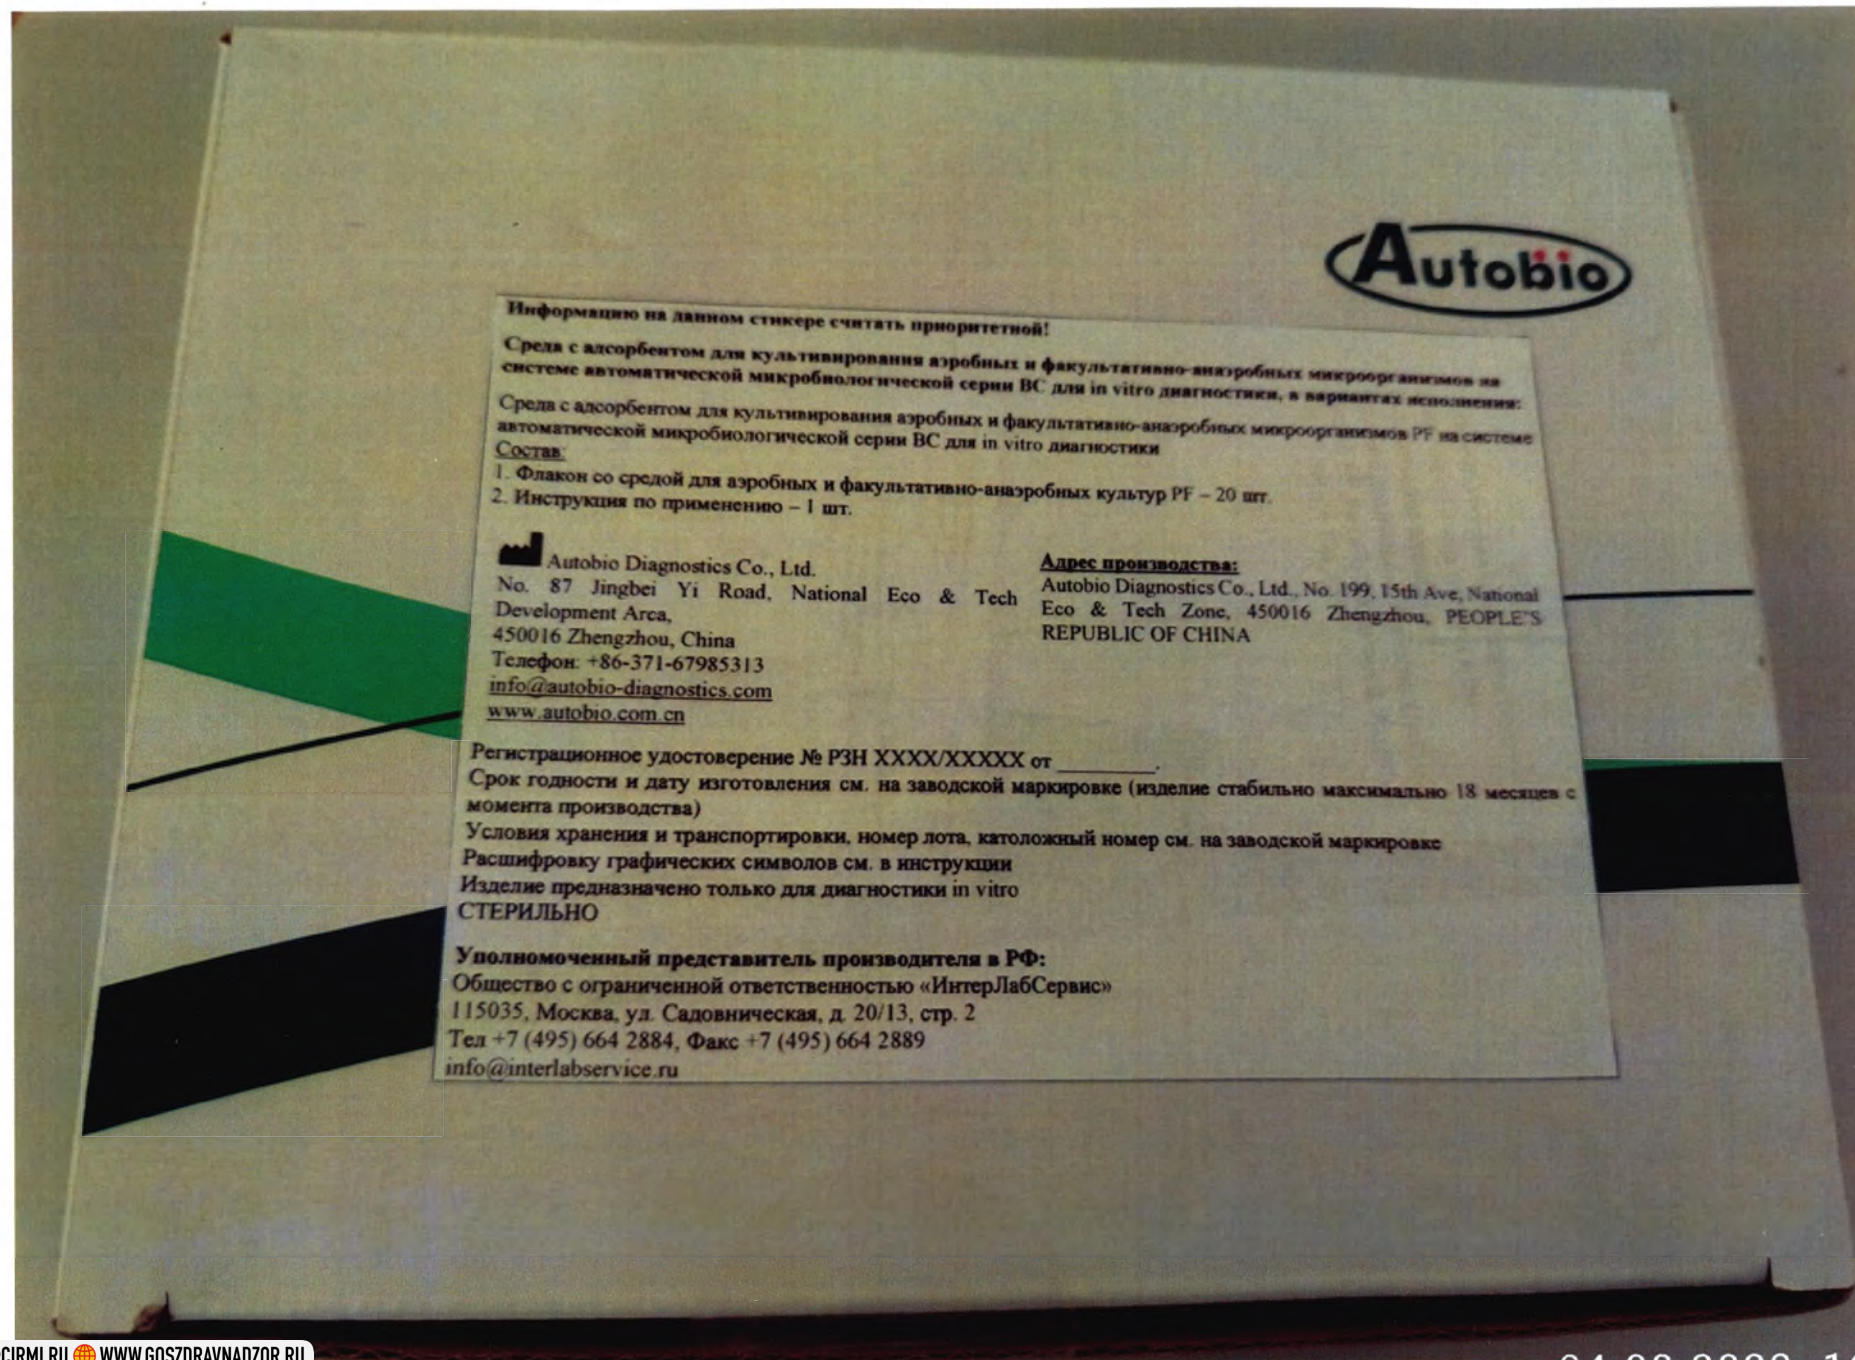

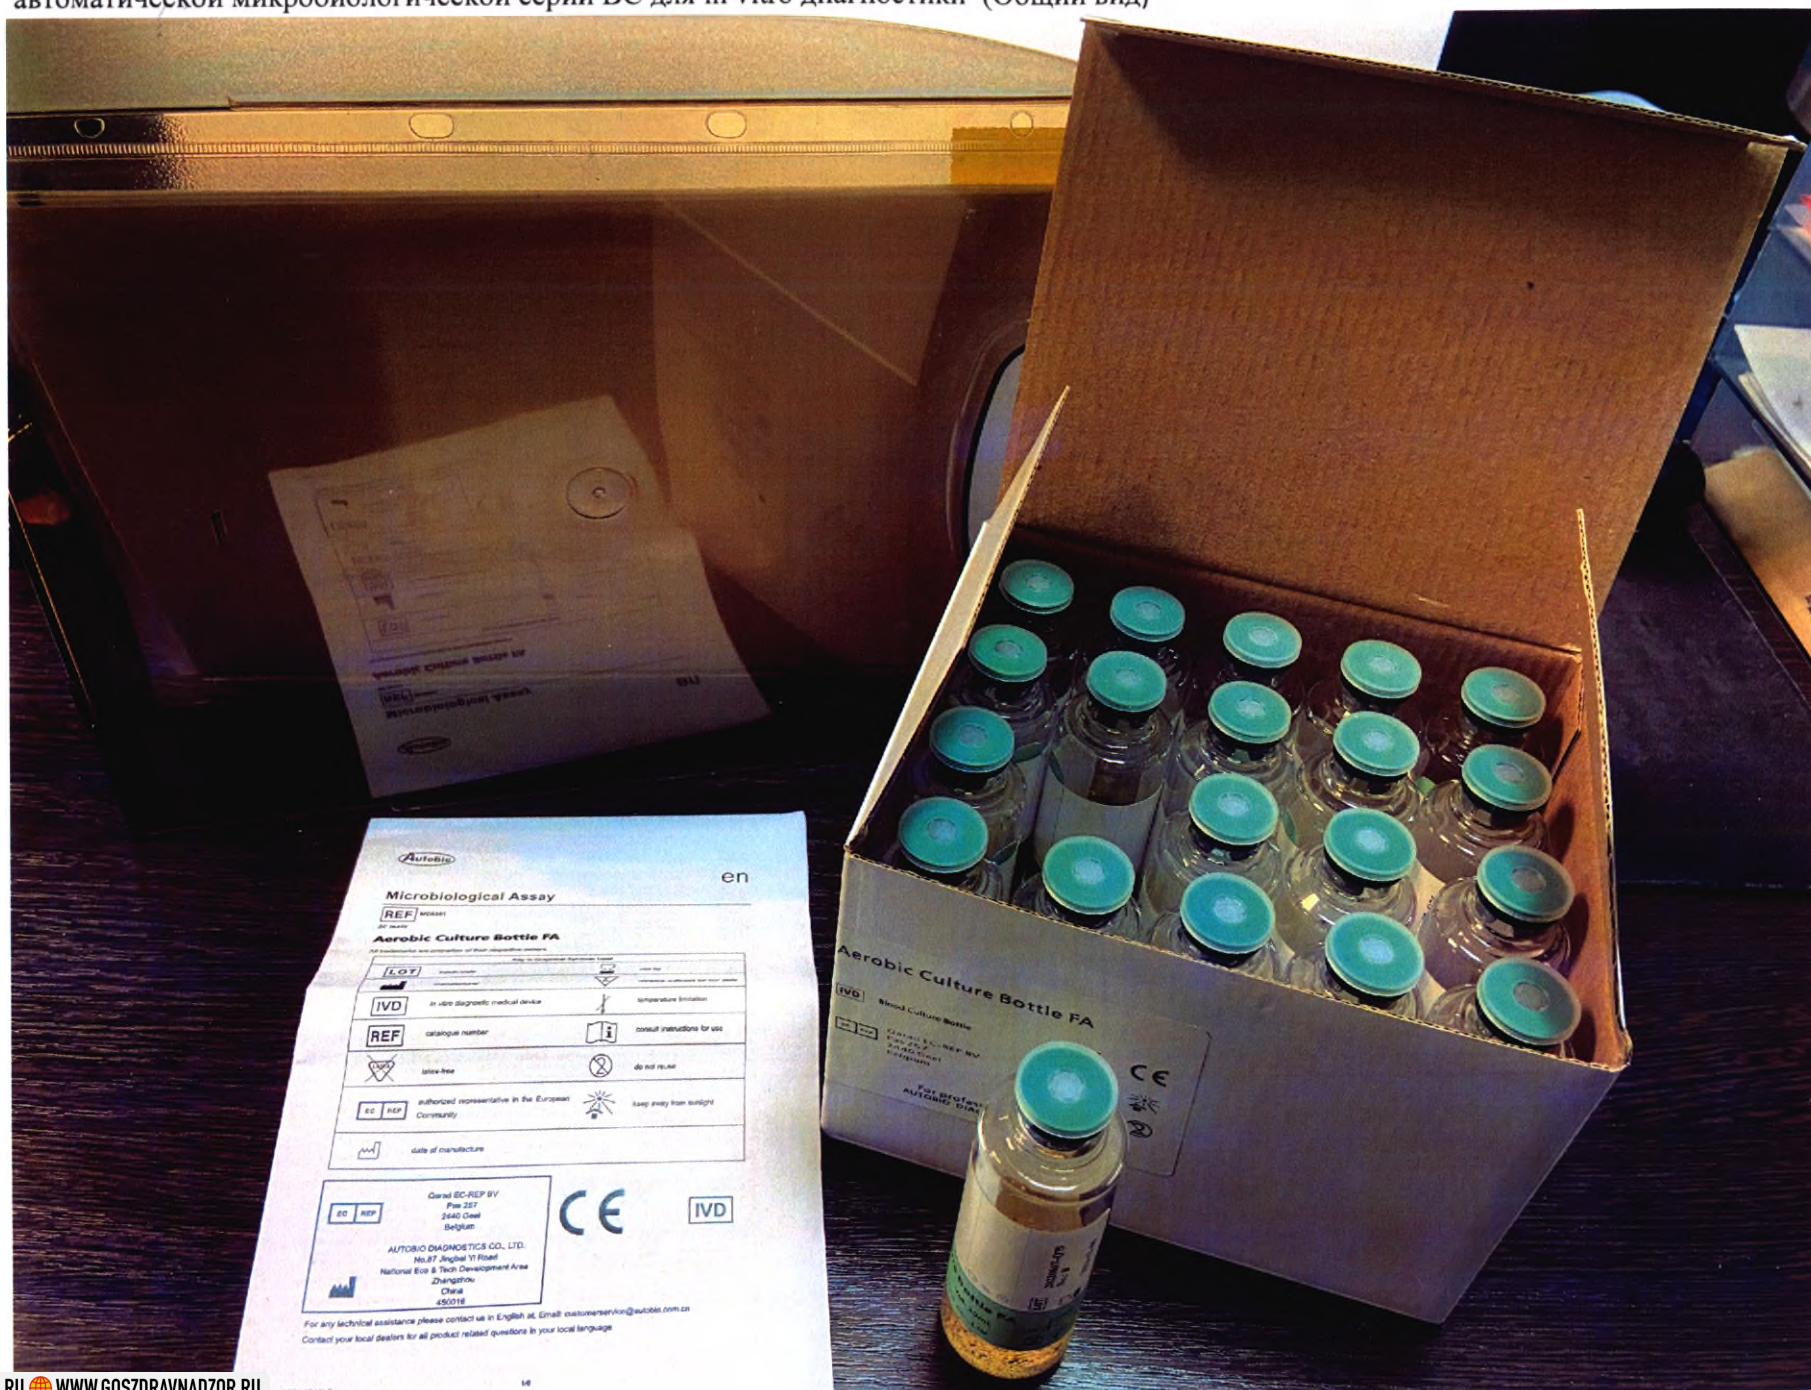

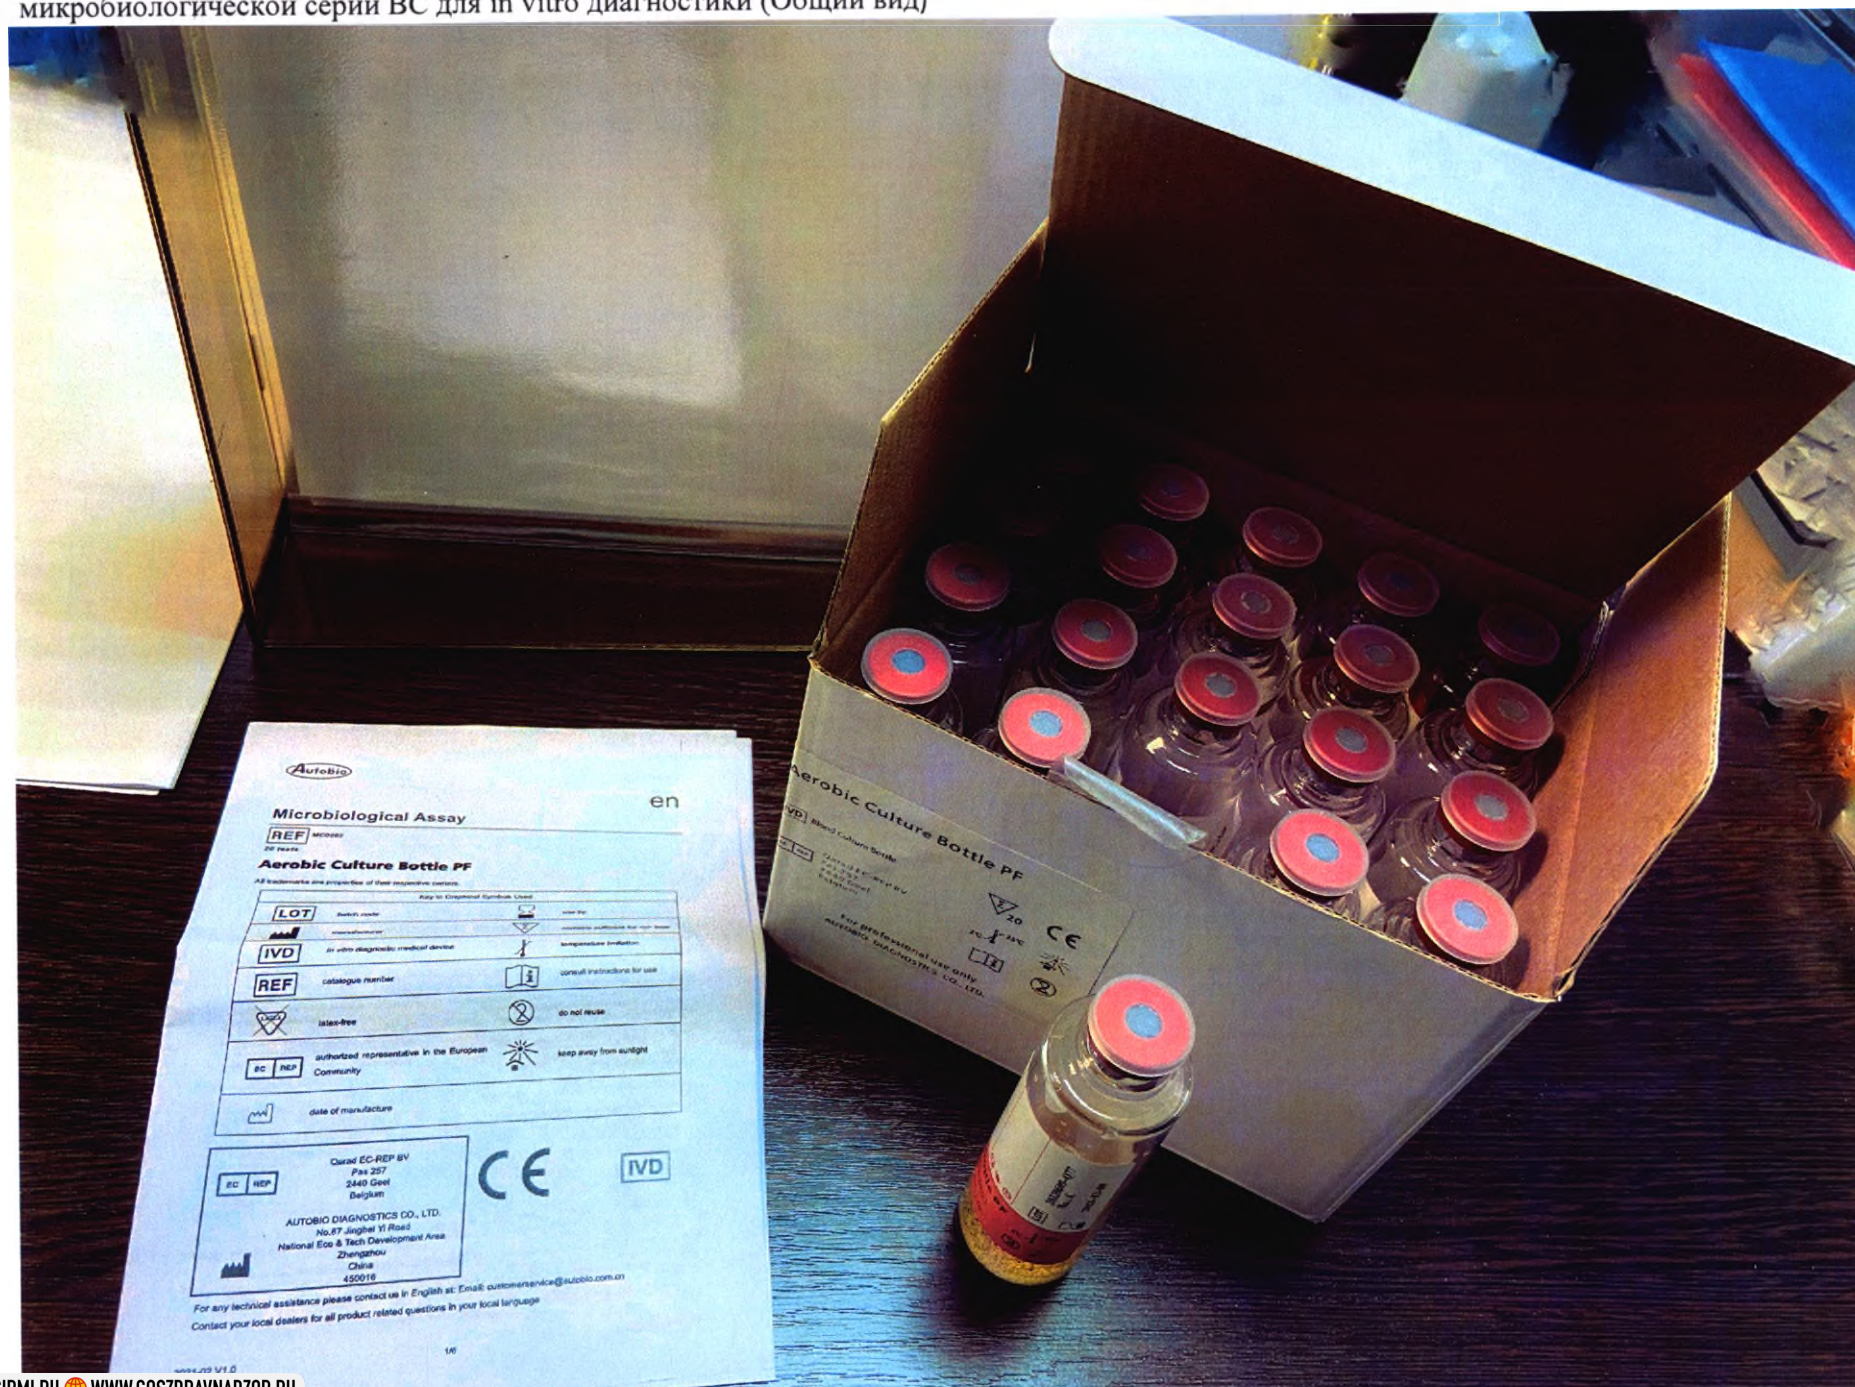

Среда с адсорбентом для культивирования аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов FA на системе автоматической микробиологической серии ВС для in vitro диагностики (Флакон со средой для аэробных и факультативно-анаэробных культур FA)



Среда с адсорбентом для культивирования аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов PF на системе автоматической микробиологической серии ВС для in vitro диагностики (Флакон со средой для аэробных и факультативно-анаэробных культур PF)



Среда с адсорбентом для культивирования аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов FA на системе автоматической микробиологической серии ВС для in vitro диагностики (Инструкция по применению – 1 шт.)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Среда с адсорбентом для культивирования аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов на системе автоматической микробиологической серии ВС для in vitro диагностики, в вариантах исполнения

Среда с адсорбентом для культивирования аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов FA на системе автоматической микробиологической серии ВС для in vitro диагностики

Среда с адсорбентом для культивирования аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов PF на системе автоматической микробиологической серии ВС для *in vitro* диагностики (Инструкция по применению – 1 шт.)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Среда с адсорбентом для культивирования аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов на системе автоматической микробиологической серии ВС для *in vitro* диагностики, в вариантах исполнения

Среда с адсорбентом для культивирования аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов PF на системе автоматической микробиологической серии ВС для *in vitro* диагностики

Пронумеровано, прошито и скреплено
печатью 47 лист (а/ов)
Руководитель департамента регистрации
ООО «ИЛС»



И. А. Стариковская