

Фотографические изображения медицинского изделия

Среда с адсорбентом для культивирования анаэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов FN на системе автоматической микробиологической серии ВС для in vitro диагностики

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель департамента регистрации ООО «ИЛС»


Стариковская И.А.

« 21 » августа 2023 г.

Anaerobic Culture Bottle FN


IVD

Blood Culture Bottle



EC REP

Qarad EC-REP BV
Pas 257
2440 Geel
Belgium



For professional use only
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD.

Anaerobic Culture Bottle FN

REF

MC0302

LOT

20220726-Q76



2022-07-26



2024-01-25



AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD.
No.87 Jingbei Yi Road, National Eco &
Tech Development Area, Zhengzhou,
China 450016
Tel: +86-371-67985313
Fax: +86-371-67985804
Web: www.autobio.com.cn

Пример маркировки на потребительской упаковке (среда для культивирования анаэробных микроорганизмов FN на системе автоматической микробиологической серии ВС для in vitro диагностики)





Информацию на данном стикере считать приоритетной!

Среда с адсорбентом для культивирования анаэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов FN на системе автоматической микробиологической серии ВС для in vitro диагностики

Состав:

1. Флакон со средой для анаэробных и факультативно-анаэробных культур FN – 20 шт.
2. Инструкция по применению – 1 шт.

 Autobio Diagnostics Co., Ltd.
No. 87 Jingbei Yi Road, National Eco & Tech
Development Area,
450016 Zhengzhou, China
Телефон: +86-371-67985313
Факс: +86-371-67985879
info@autobio-diagnostics.com
www.autobio.com.cn

Адрес производства:

Autobio Diagnostics Co., Ltd., No. 199, 15th Ave,
National Eco & Tech Zone, 450016 Zhengzhou,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Регистрационное удостоверение № XXX XXXX/XXXXX от _____

Срок годности и дату изготовления см. на заводской маркировке (изделие стабильно 18 месяцев с момента производства)

Условия хранения и транспортировки, номер лота, каталожный номер см. на заводской маркировке

Расшифровку графических символов см. в инструкции

Изделие предназначено только для диагностики in vitro
СТЕРИЛЬНО

Уполномоченный представитель производителя в РФ:


Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерЛабСервис»

115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 20/13, стр. 2

Тел +7 (495) 664 2884, Факс +7 (495) 664 2889

info@interlabservice.ru

Среда с адсорбентом для культивирования анаэробных микроорганизмов (Общий вид)

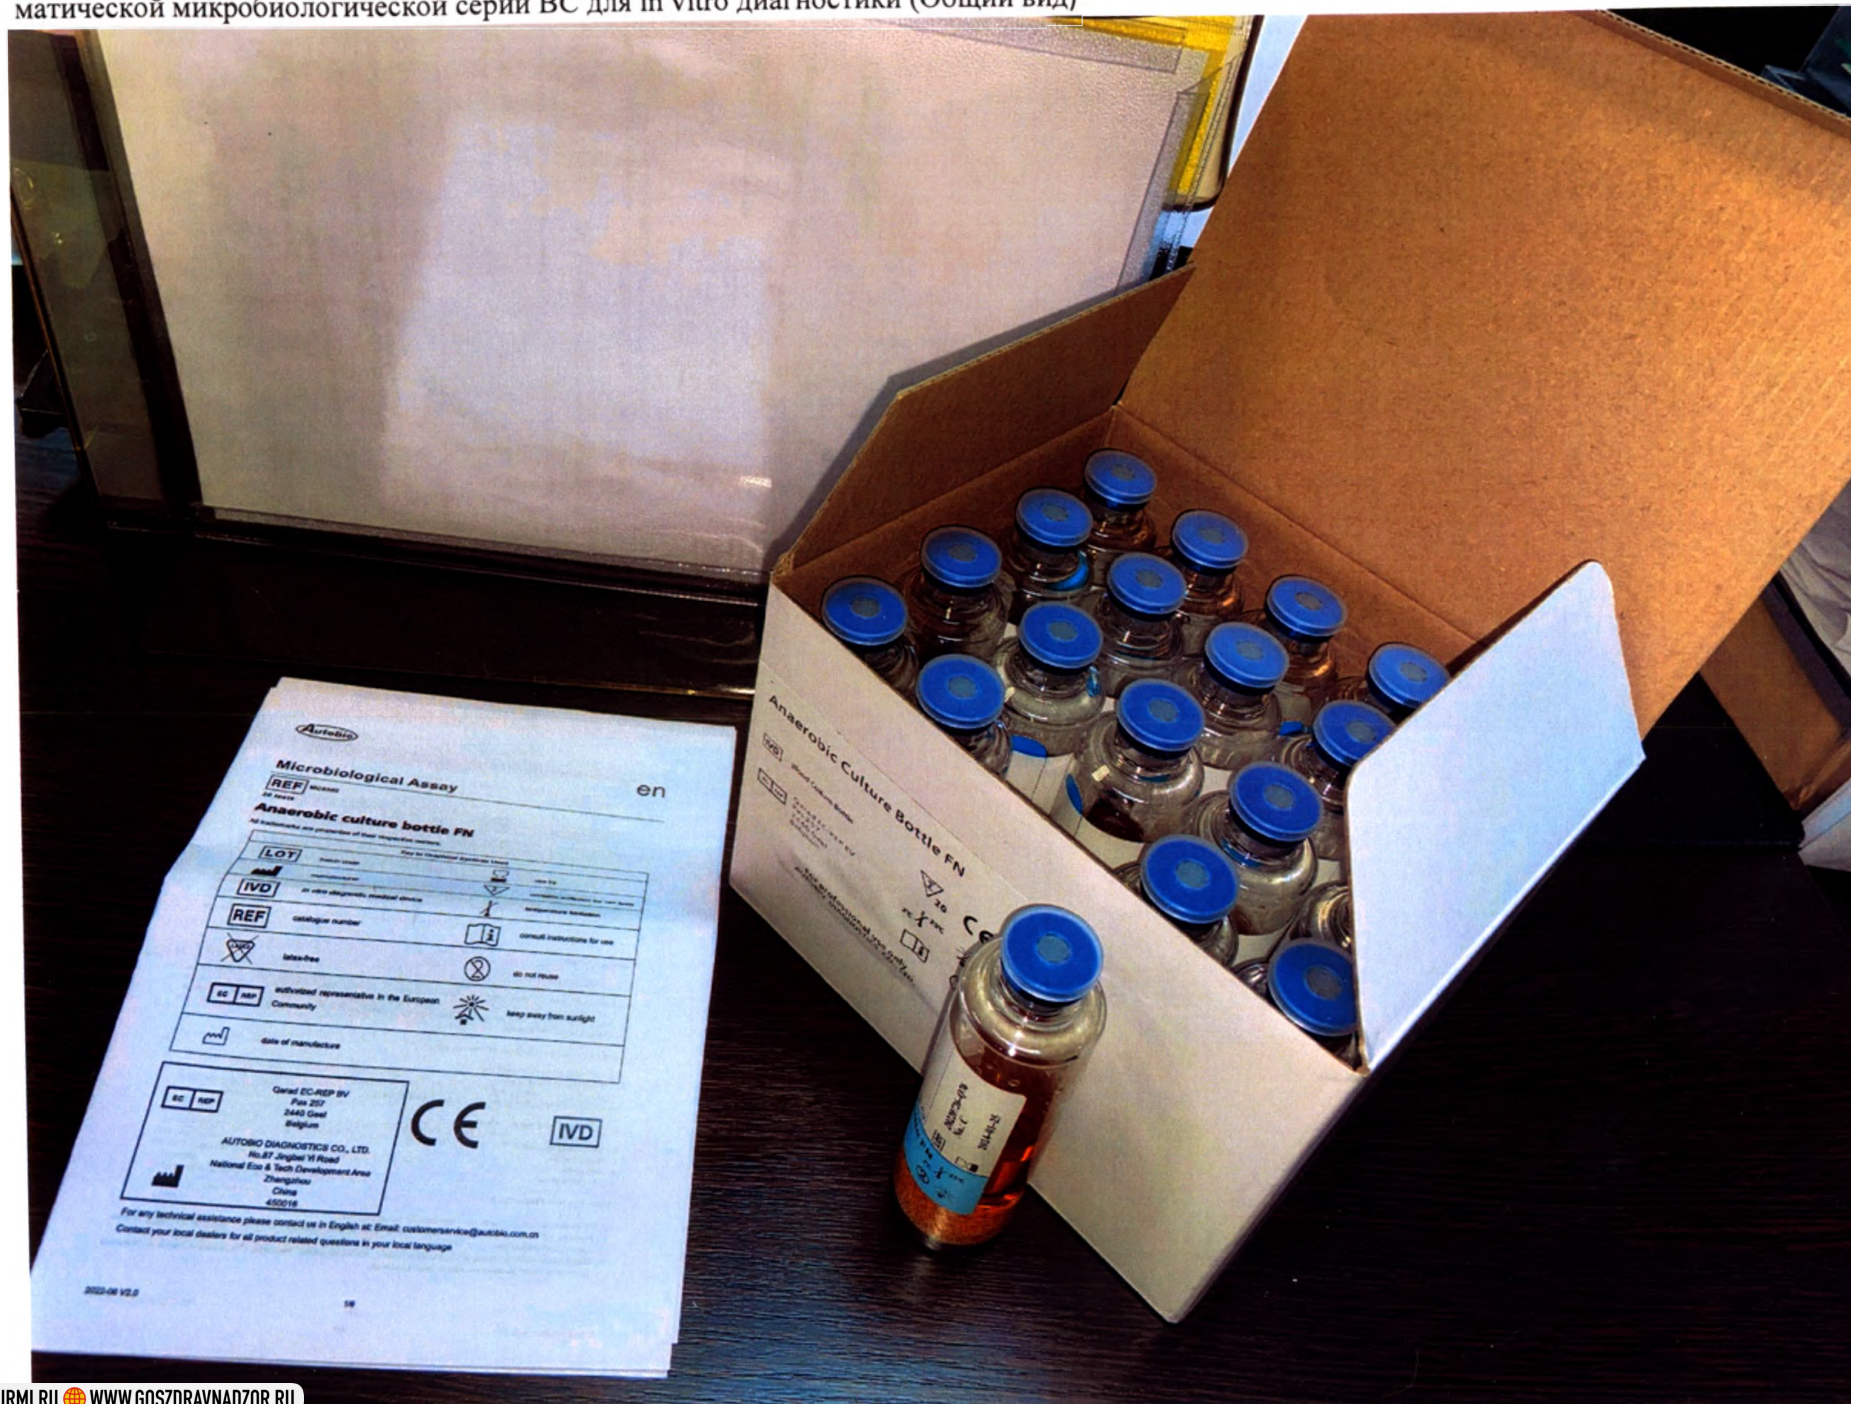

Среда с адсорбентом для культивирования анаэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов FN на системе автоматической микробиологической серии ВС для in vitro диагностики (Флакон со средой для анаэробных и факультативно-анаэробных культур FN)



Среда с адсорбентом для культивирования анаэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов FN на системе автоматической микробиологической серии ВС для in vitro диагностики (Инструкция по применению – 1 шт.)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**Среда с адсорбентом для культивирования анаэробных и
факультативно-анаэробных микроорганизмов FN на системе
автоматической микробиологической серии ВС для in vitro диагностики**

Пронумеровано, прошито и скреплено
печатью 9 лист (а/ов)
Руководитель департамента регистрации
ООО «ИЛС»



И. А. Стариковская