



Фотографические изображения медицинского изделия

**Аппарат рентгенодиагностический телеуправляемый
АРТ по ТУ 9442-039-1150760-2015 с принадлежностями**

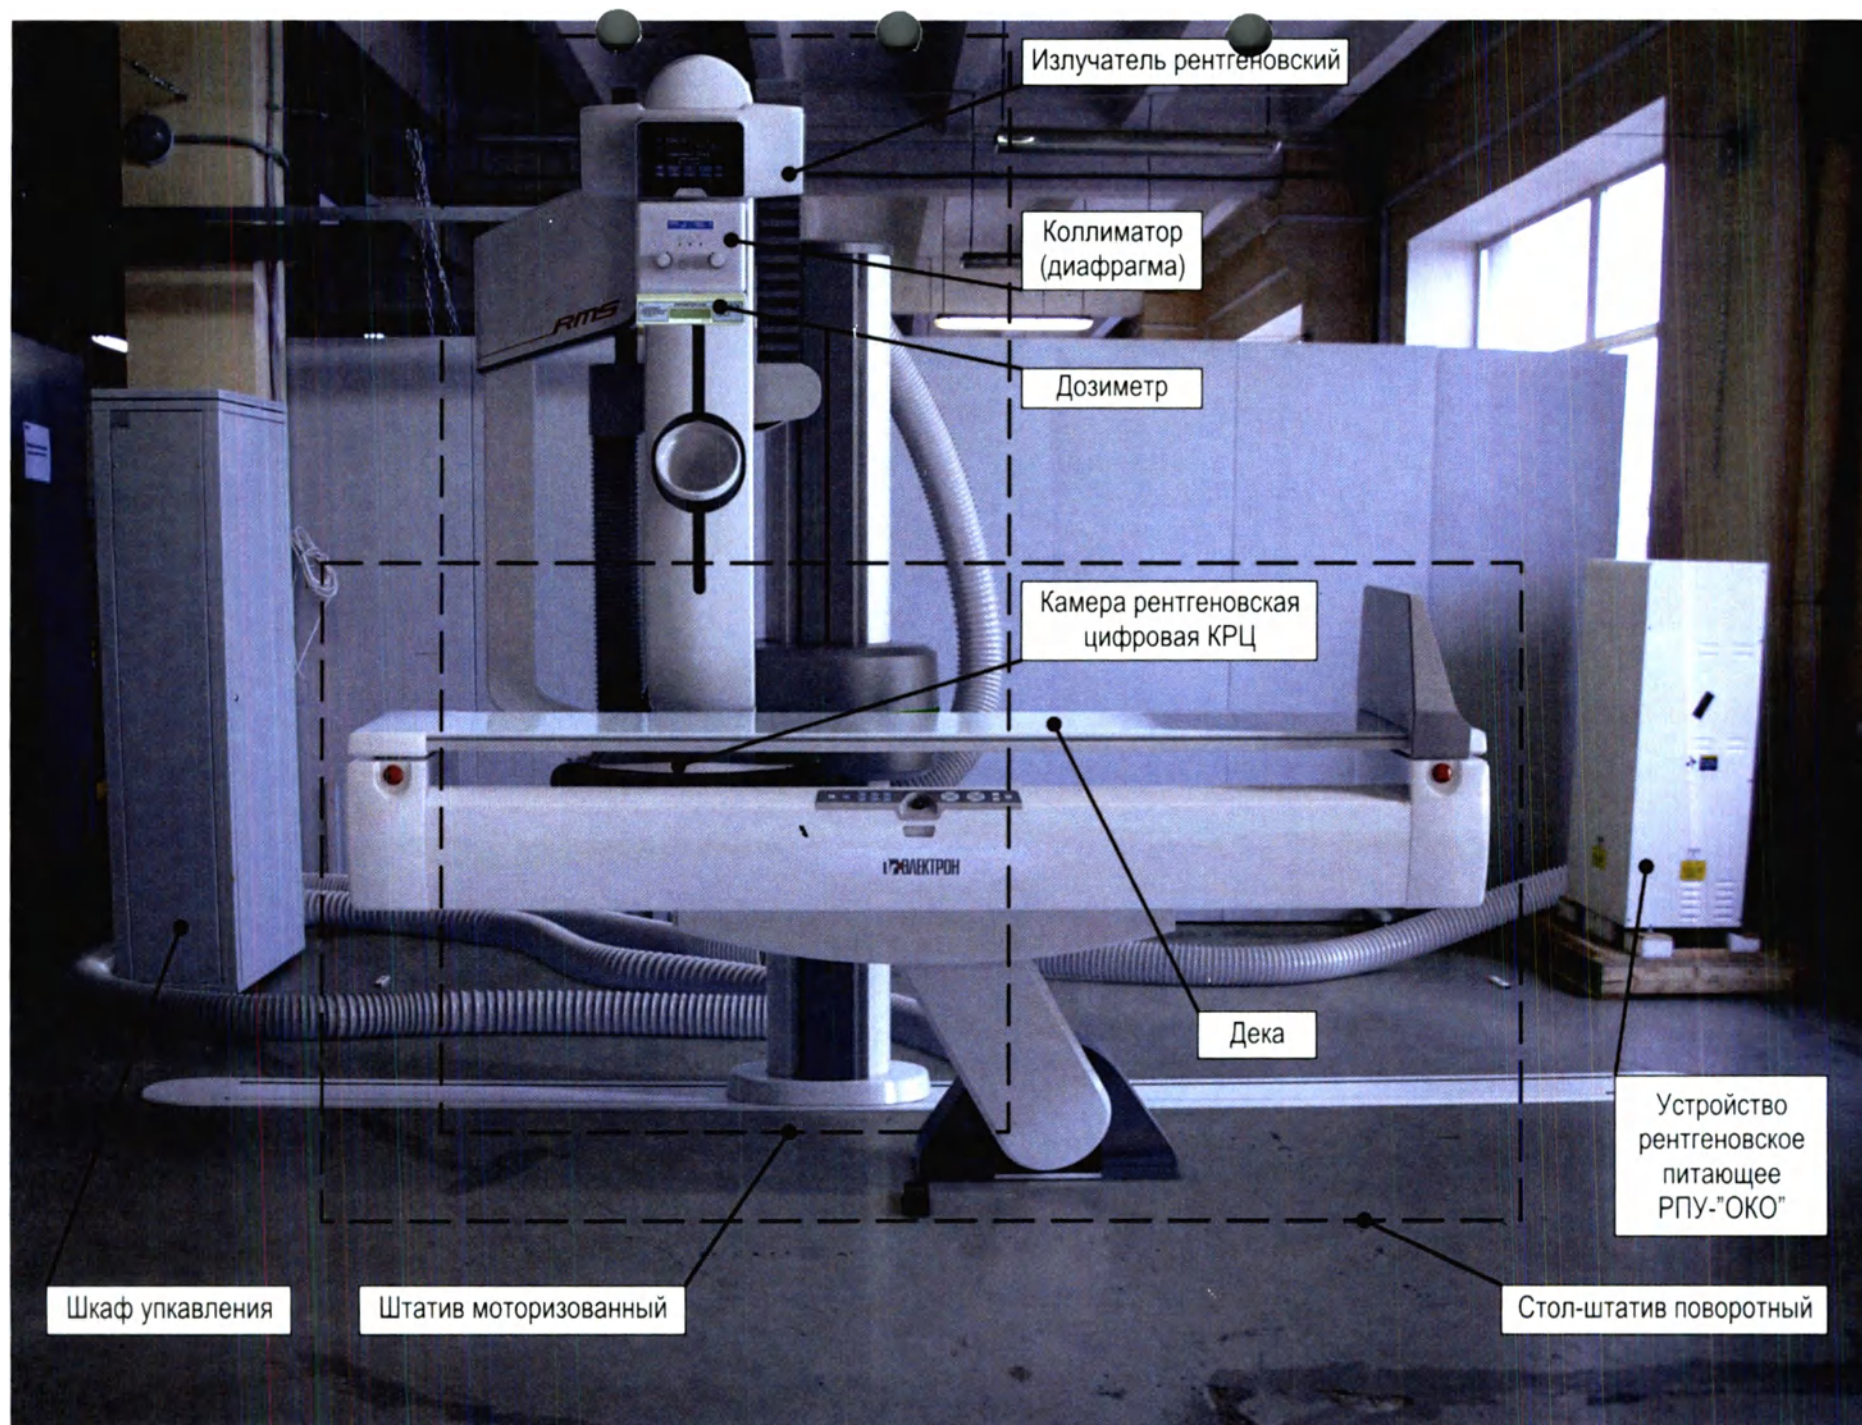

Фотография 1 – Аппарат рентгенодиагностический телеуправляемый АРТ (общий вид и указание элементов)

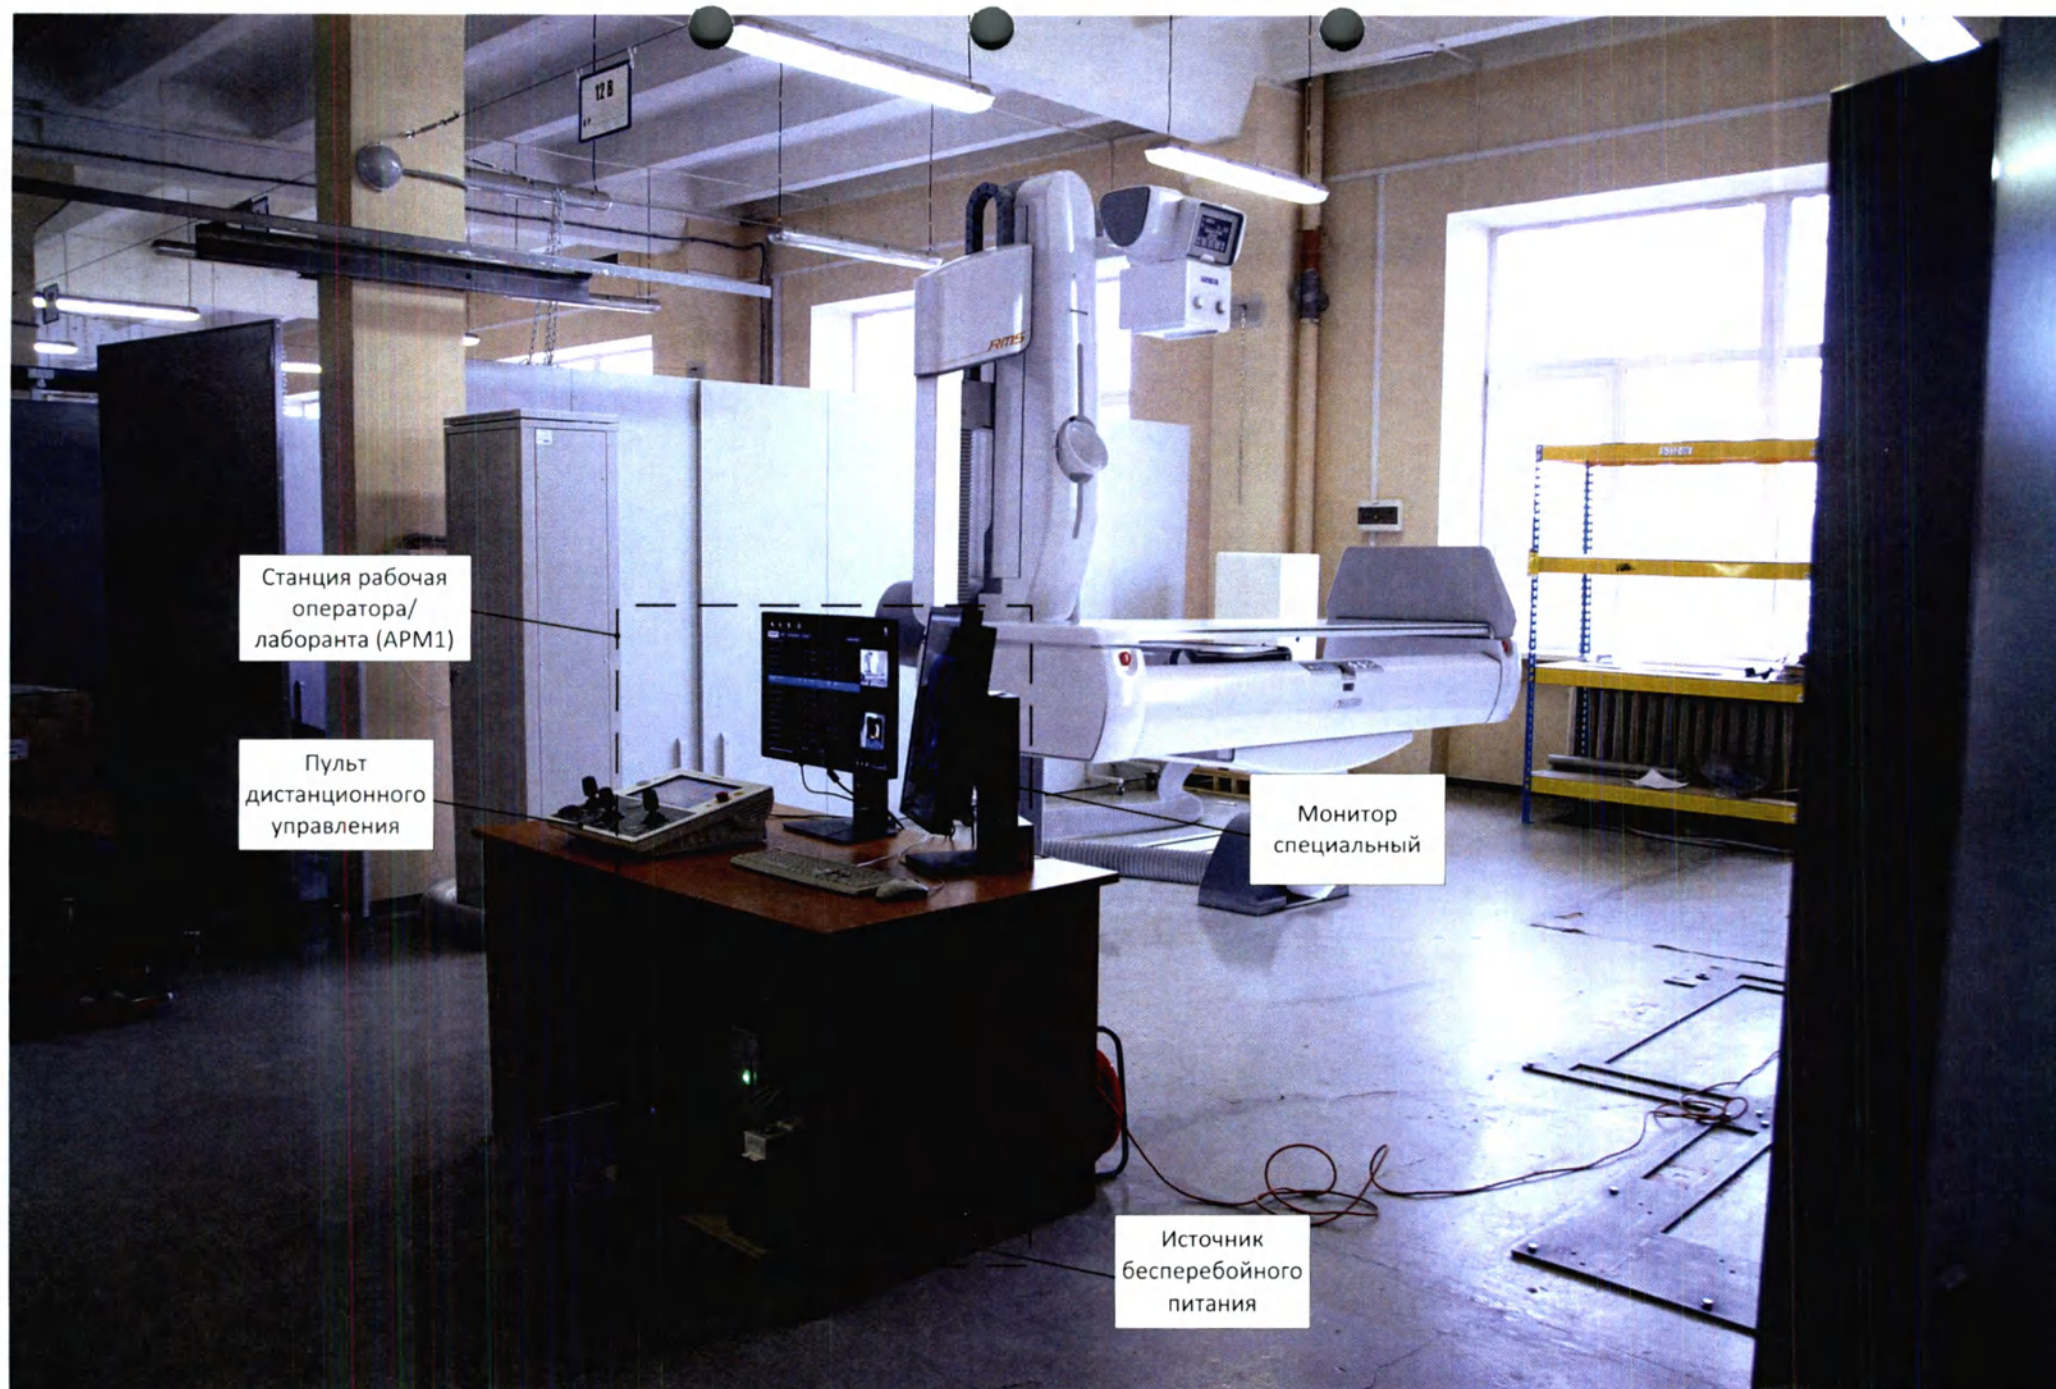

Станция рабочая
оператора/
лаборанта (АРМ1)

Пульт
дистанционного
управления

Монитор
специальный

Источник
бесперебойного
питания

Фотография 2 – Аппарат рентгенодиагностический телеуправляемый АРТ (общий вид и указание элементов)

ЭЛЕКТРОН

Аппарат
рентгенодиагностический
телеуправляемый АРТ

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ВРАЕ.941211.020

ТУ

9442-038-11150760-2015

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

GP0005799

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

2023-05


ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АО "НИПК "ЭЛЕКТРОН"

NP-20-0001



3N~400 В, 50 Гц, 80 кВА

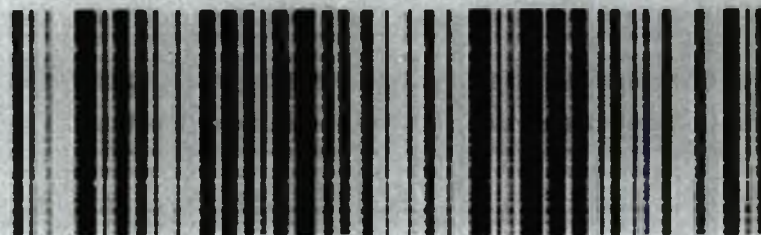

Фотография 3 – Аппарат рентгенодиагностический телеуправляемый АРТ. Маркировка

ЭЛЕКТРОН

Стол-штатив
поворотный

Серийный номер
Дата изготовления

NN0027812
2023-05

Обозначение

ВРАЕ.943229.001

Серийный номер МИ

GP0005799

Изготовитель

АО "НИПК "Электрон"

NP-20-0002-01



4/N/PE DC 24/40 B 10/60 A



ЭЛЕКТРОН

Штатив
моторизированный

Серийный номер
Дата изготовления

NN0027813
2023-05

Обозначение

ВРАЕ.943152.001

Серийный номер МИ

GP0005799

Изготовитель

АО "НИПК "Электрон"

NP-20-0002-01



4/N/PE DC 24/40 В 10/60 А



Фотография 5 – Штатив моторизованный. Маркировка

НИПЭК ЭЛЕКТРОН

Устройство рентгеновское
питающее РПУ-"ОКО"

ТУ

9442-022-11150760-2006

Серийный номер

PF0006901

Дата изготовления

2023-05

Обозначение

RPU50E-00-0000-45

(РПУ50Е- 000)


Серийный номер МИ

GP0005799


Изготовитель

АО "НИПК "ЭЛЕКТРОН"

NP-20-0006




3/N/PE AC 400/230 В 50 Гц 60 кВА

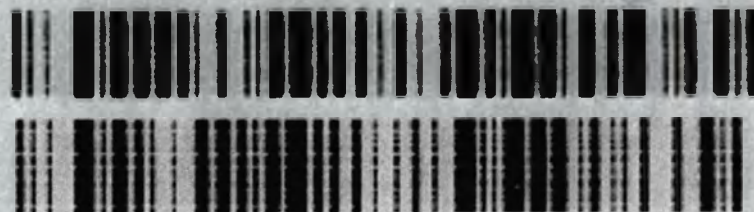

Фотография 6 – Устройство рентгеновское питающее РПУ-ОКО. Маркировка



Фотография 7 – Кабель высоковольтный с комплектом монтажных частей

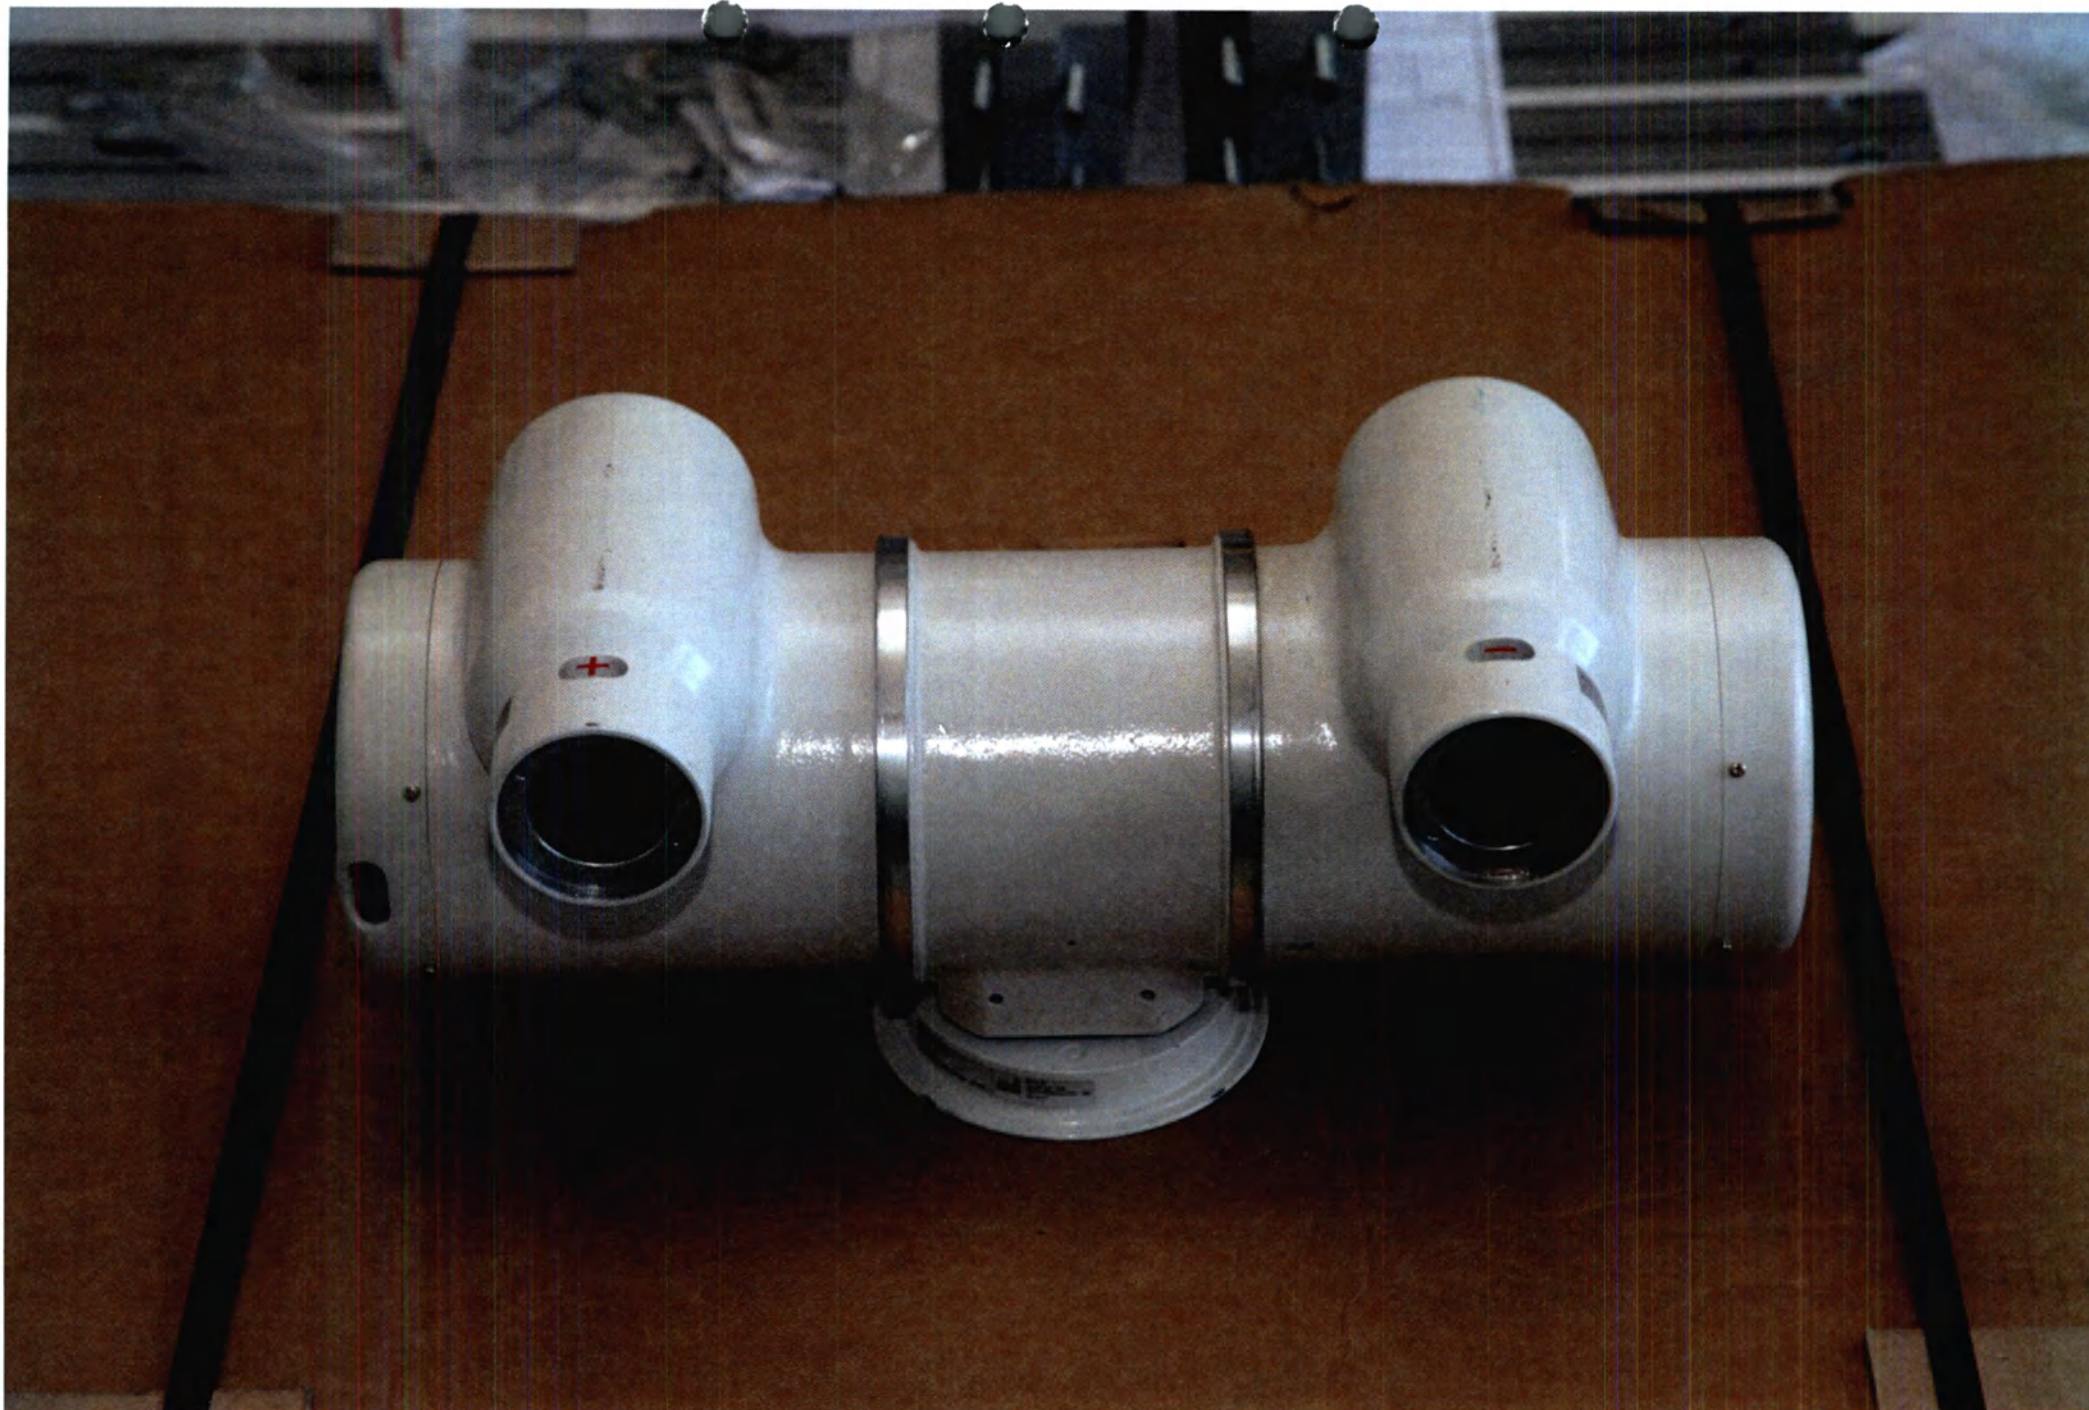

Фотография 8 – Излучатель рентгеновский



TOSHIBA ROTANODE™

MANUFACTURED: September 2015 / 2015-09

医療機器の種類: 管理医療機器, 特定保守管理医療機器

承認番号: 22000BZX00662000

一般的名称: X線管装置

ロータノード

UNIT MODEL: E7252X

SER NO.: 15J1023

INSERT MODEL: E7252

SER. NO.: 5J346

SUP. SYMBOL: COM

MAX. VOLTAGE: 150 kV

STATOR: XS-AL

FOCAL SPOT: 1.2/0.6

PERMANENT FILTRATION: 0.9 AL/ 75

東芝電子管デバイス株式会社

〒324-8550 栃木県大田原市下石上1385番地

TOSHIBA ELECTRON TUBES & DEVICES CO., LTD.

1385, Shimoishigami, Ohtawara-shi, Tochigi 324-8550 Japan

MADE IN JAPAN

MZF-RT02

火気厳禁


品名 (日本語): X線管装置 (回転ノード)

品名 (英語): X-ray tube

品名 (中国語): X光管

This part is not for sale separately. It is a part of the X-ray tube assembly.

Фотография 9 – Излучатель рентгеновский. Маркировка

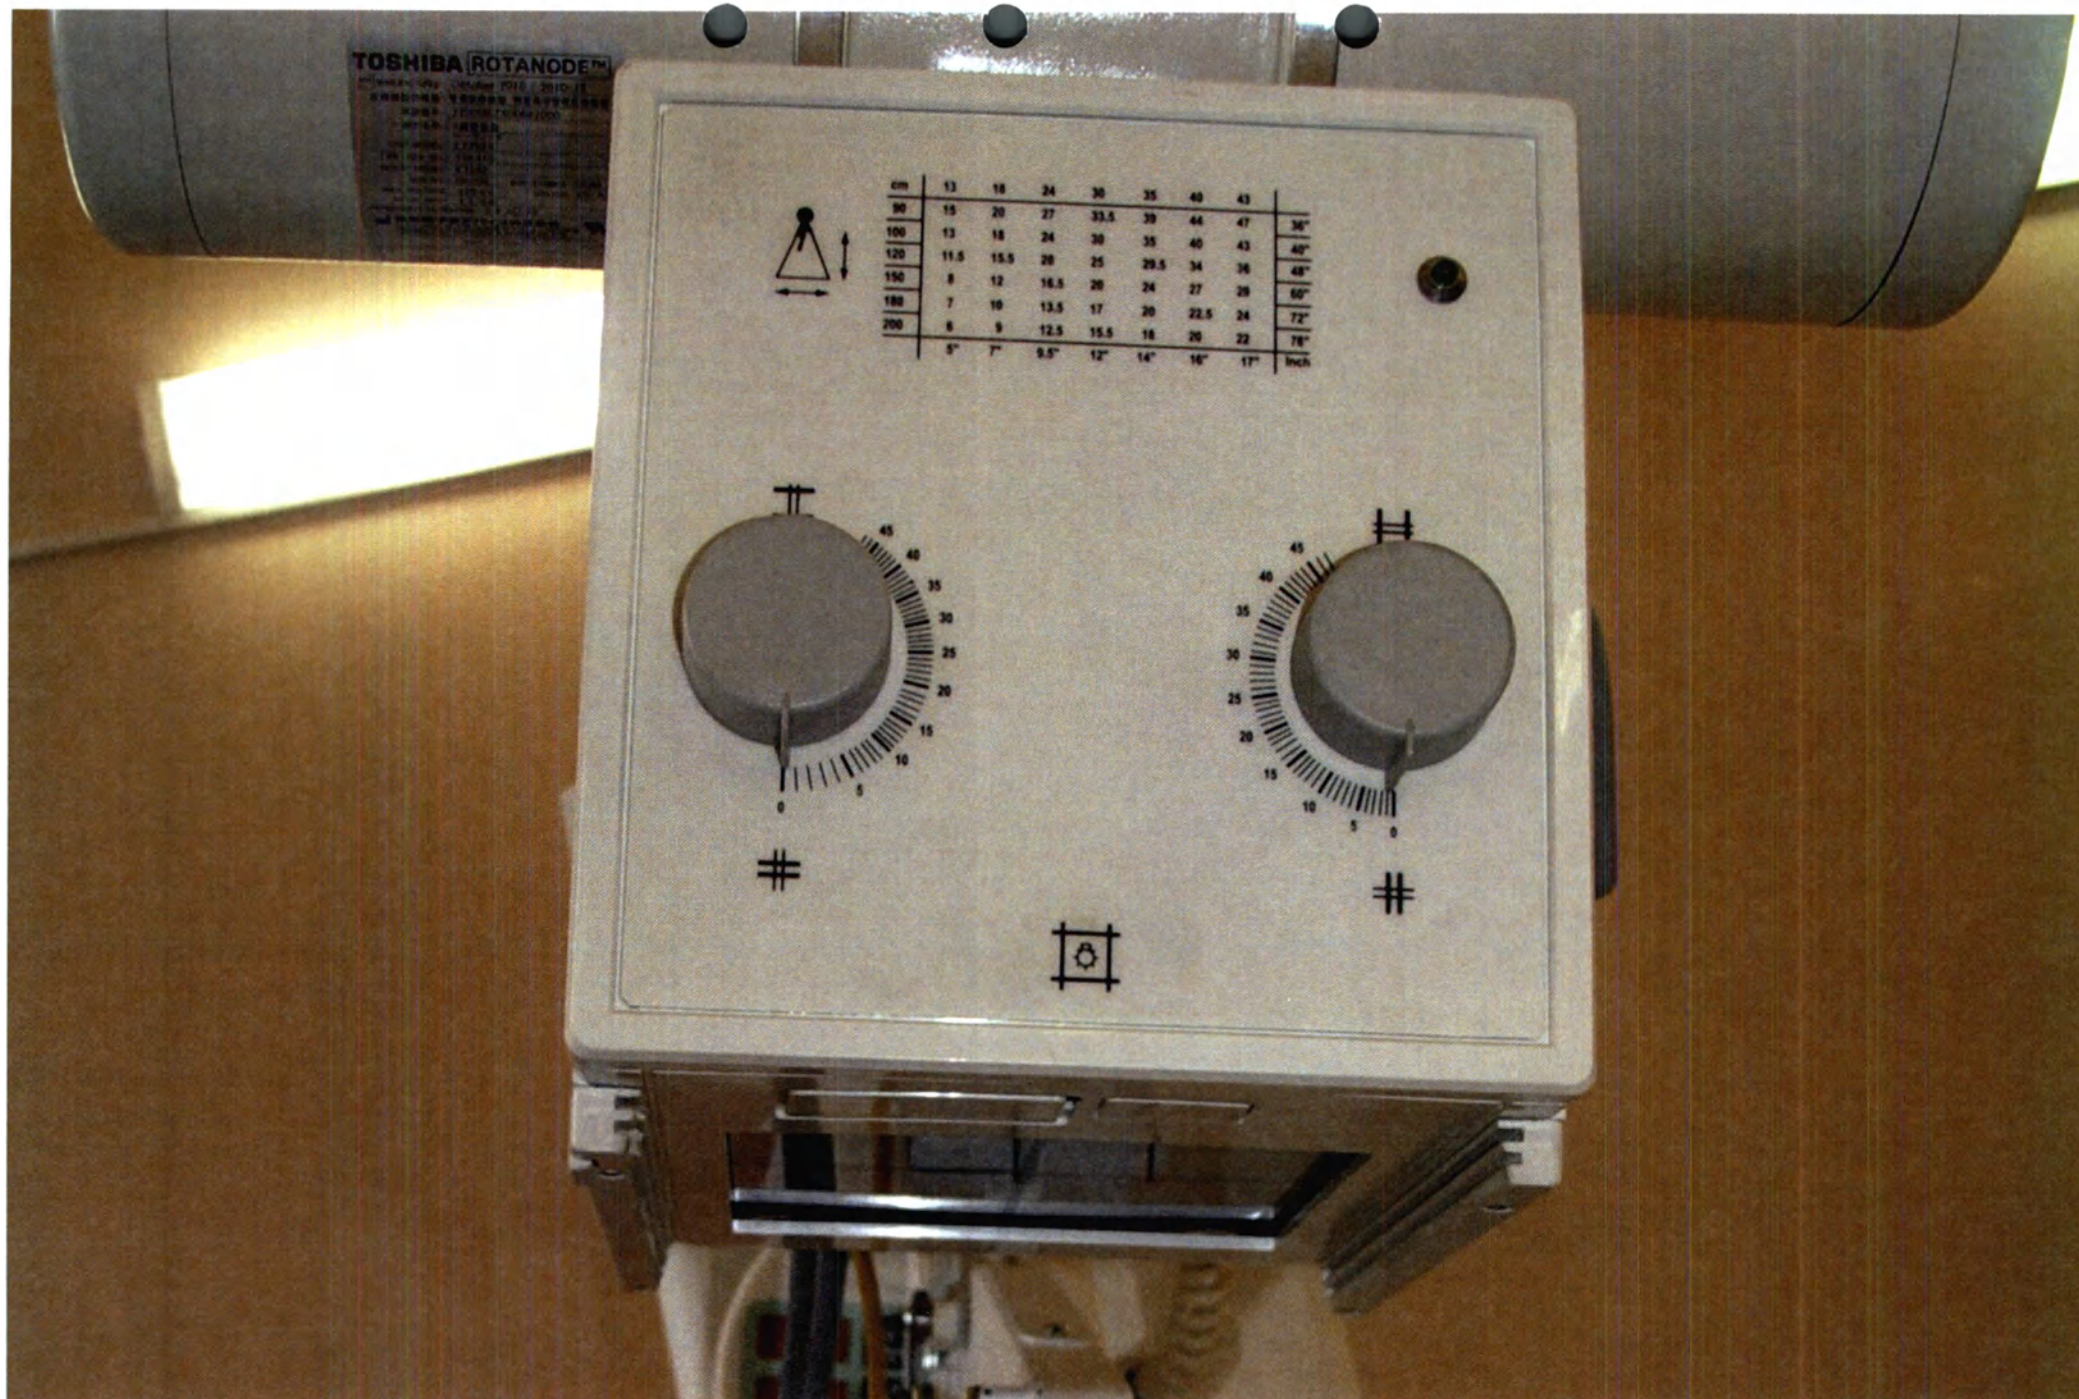

Фотография 10 – Коллиматор (диафрагма)

Ralco

s.r.l.



Ralco srl
Via del Tiglio 15/O
20853 Binasco (MI) - Italy
2019-02

BEAM LIMITING DEVICE
Series **R 225 ACS DHHS**


Model: **R 225 ACS**
Customization: **080A**

SN **1901695**

Min. inherent filtration Al equiv.
2 mm Al/75 IEC 60522/1998
X-Ray rating up to: 150kVp
Supply: 24V AC/DC, 2A, 50/60Hz



Фотография 11 – Коллиматор (диафрагма). Маркировка

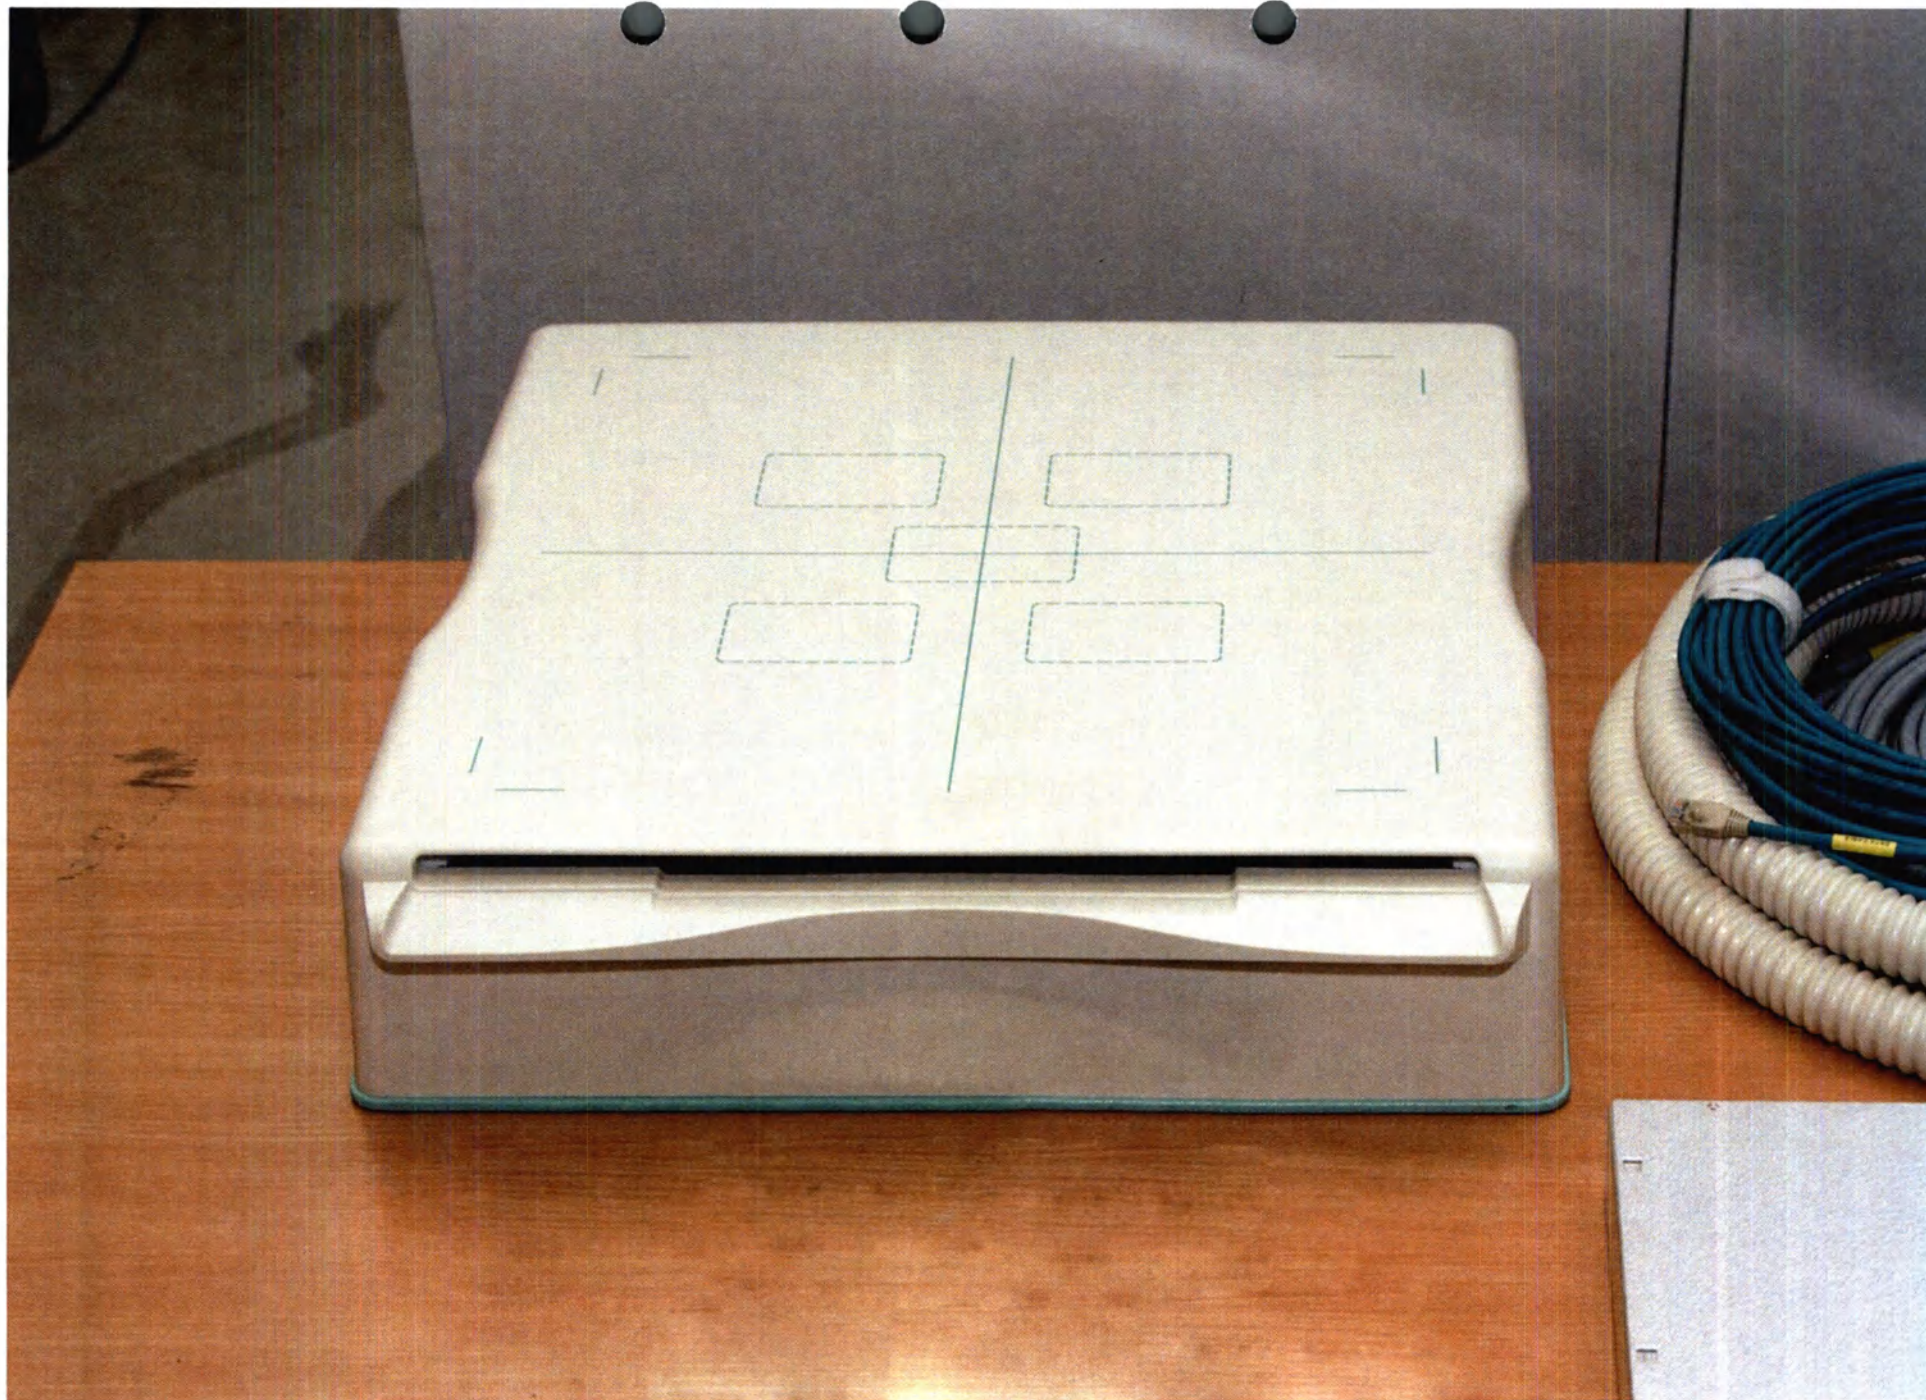

Фотография 12 – Камера рентгеновская цифровая КРЦ (все исполнения не имеют внешних отличий)

ЭЛЕКТРОН

**Камера рентгеновская
цифровая КРЦ**

ТУ

9442-026-11150760-2007

Серийный номер

NN0027823

Дата изготовления

2023-05

Обозначение

ДФП4343Ц7

Серийный номер МИ

GP0005799


Изготовитель

АО "НИПК "ЭЛЕКТРОН"

NP-20-0006




Фотография 13 – Камера рентгеновская цифровая КРЦ. Маркировка

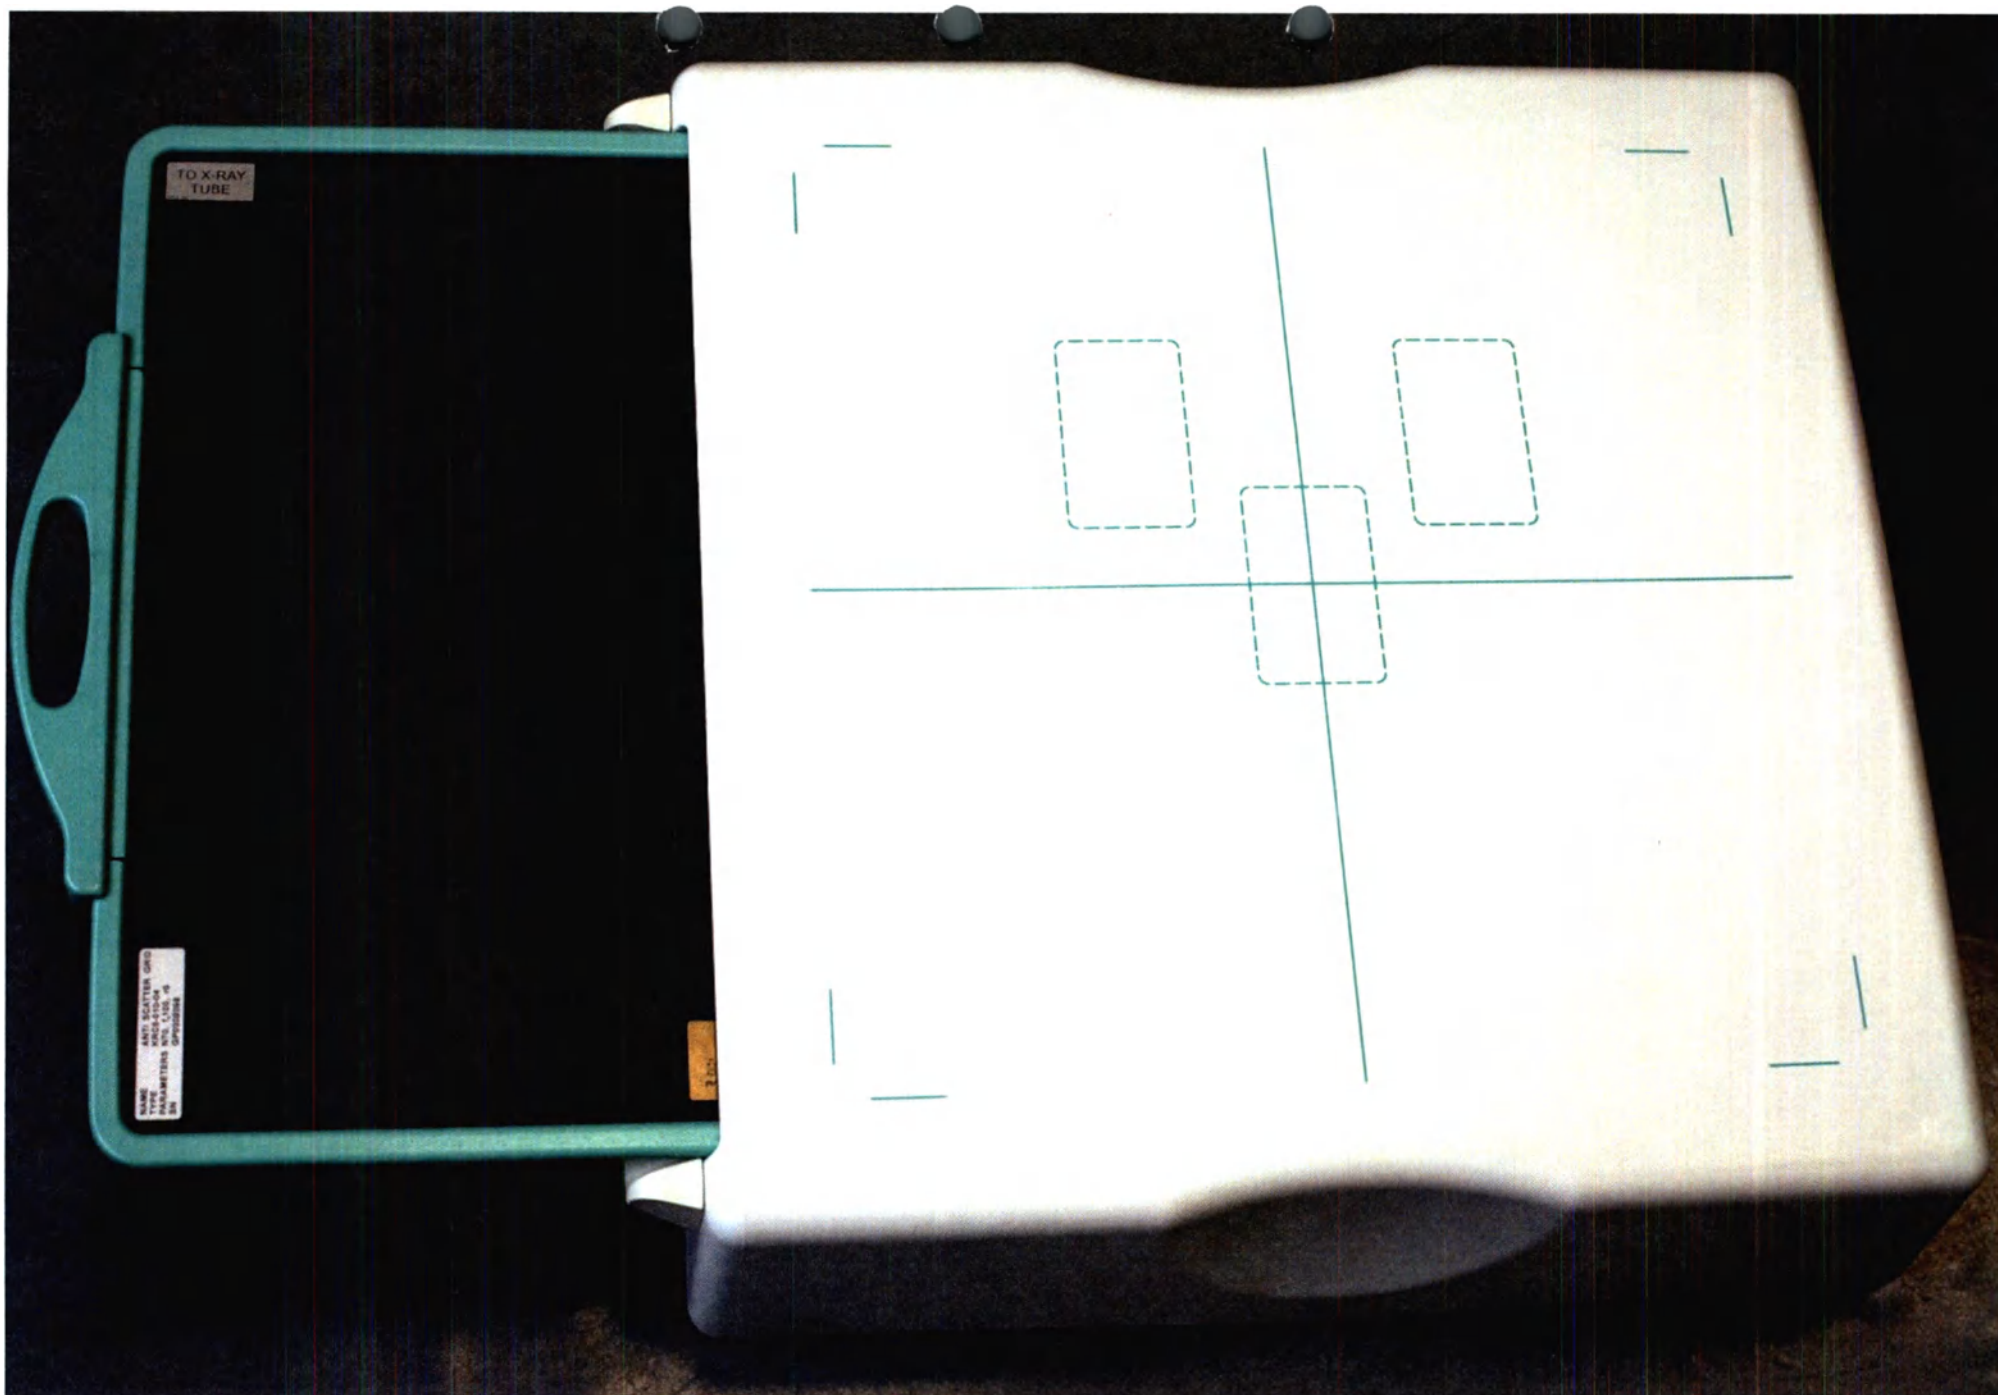

Фотография 14 – Приемник рентгеновский цифровой ДФП, установка решётки фокусирующей (растра) (все исполнения не имеют внешних отличий)





Фотография 15 – Блок сопряжения системы визуализации

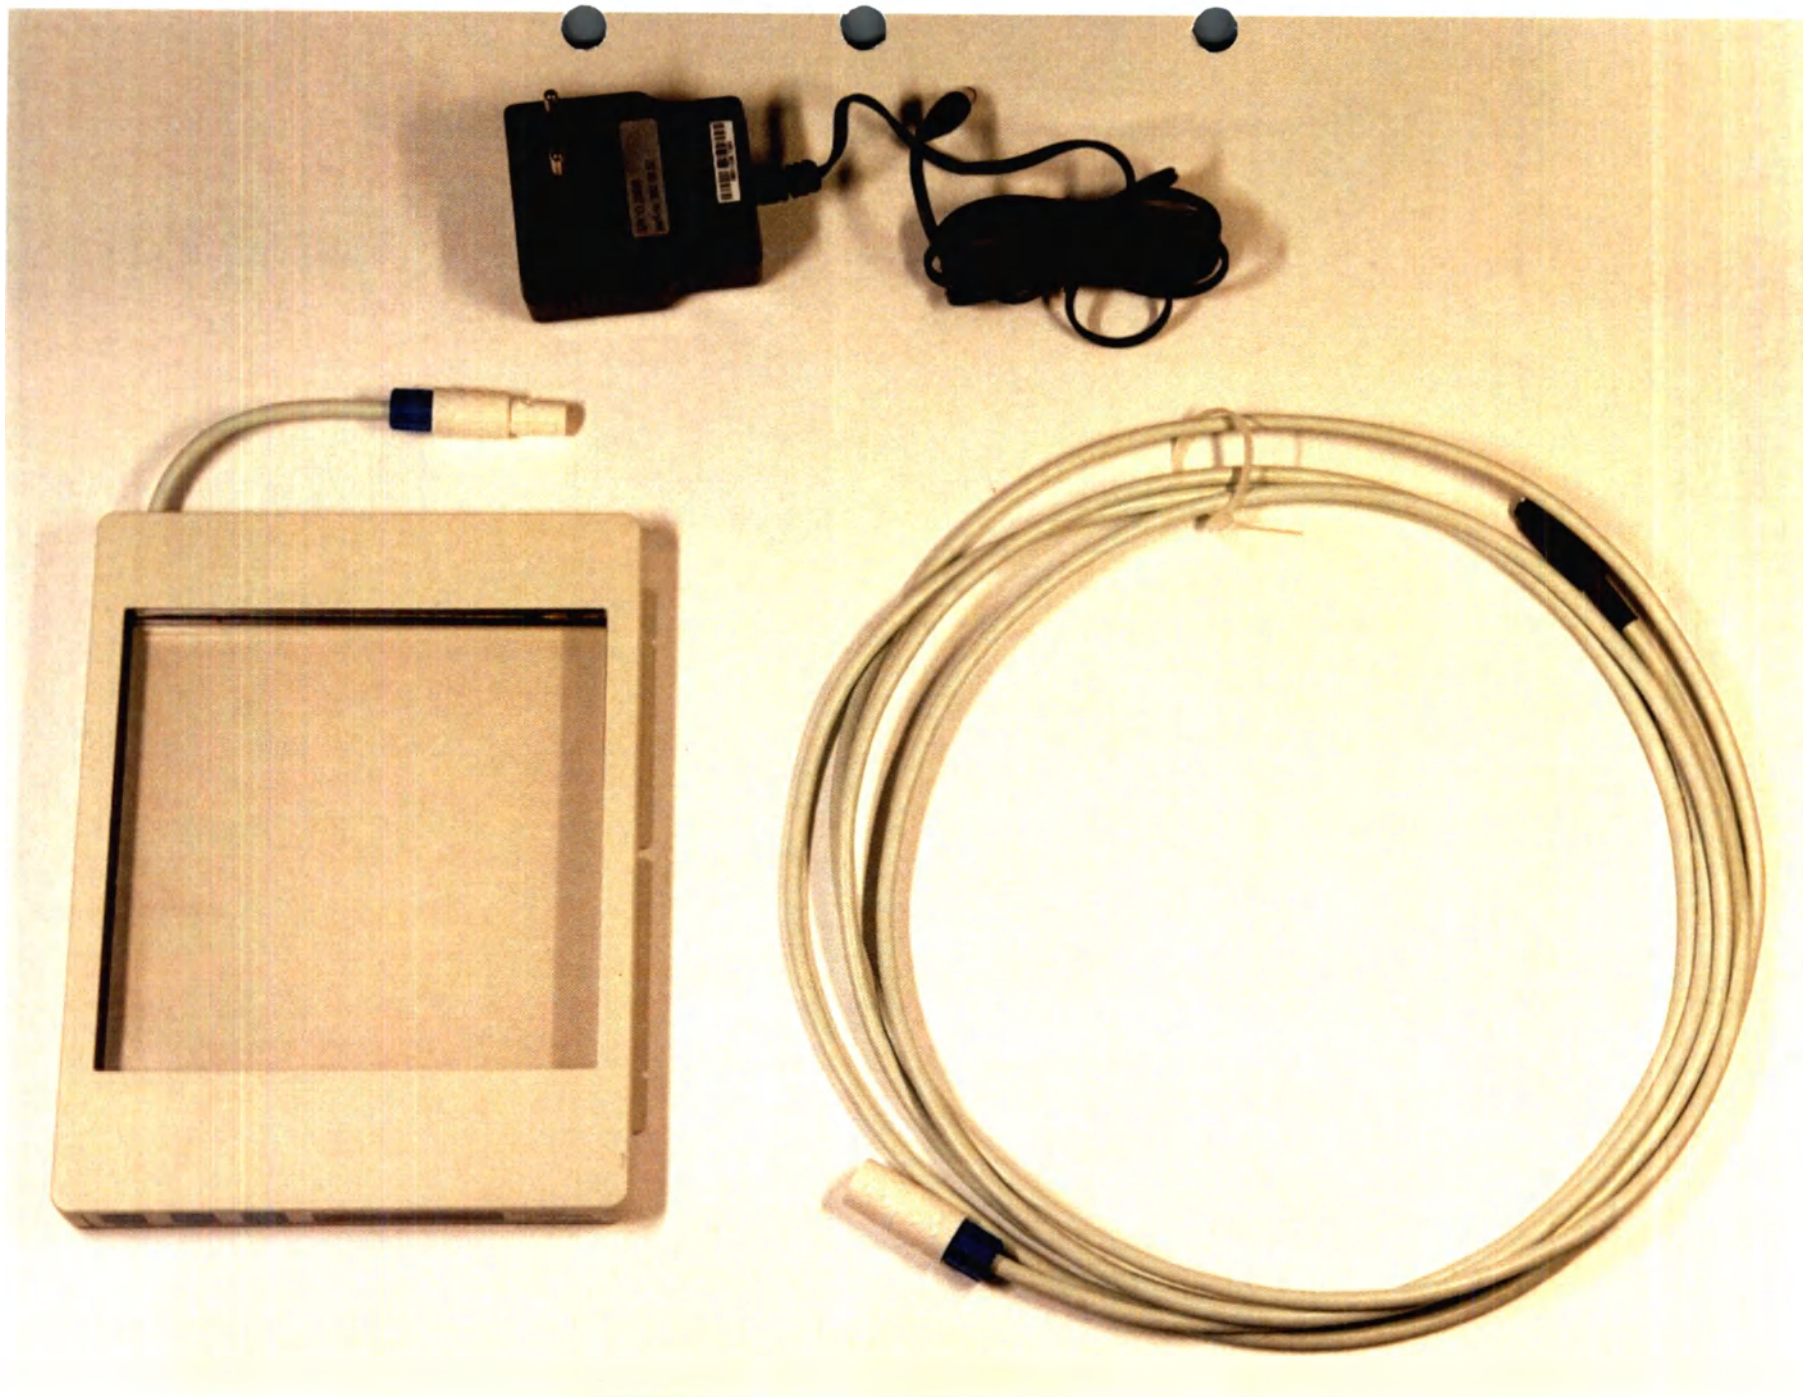

Фотография 16 – Дозиметр VacuDAР

Фотография 17 – Дозиметр ДРК-1

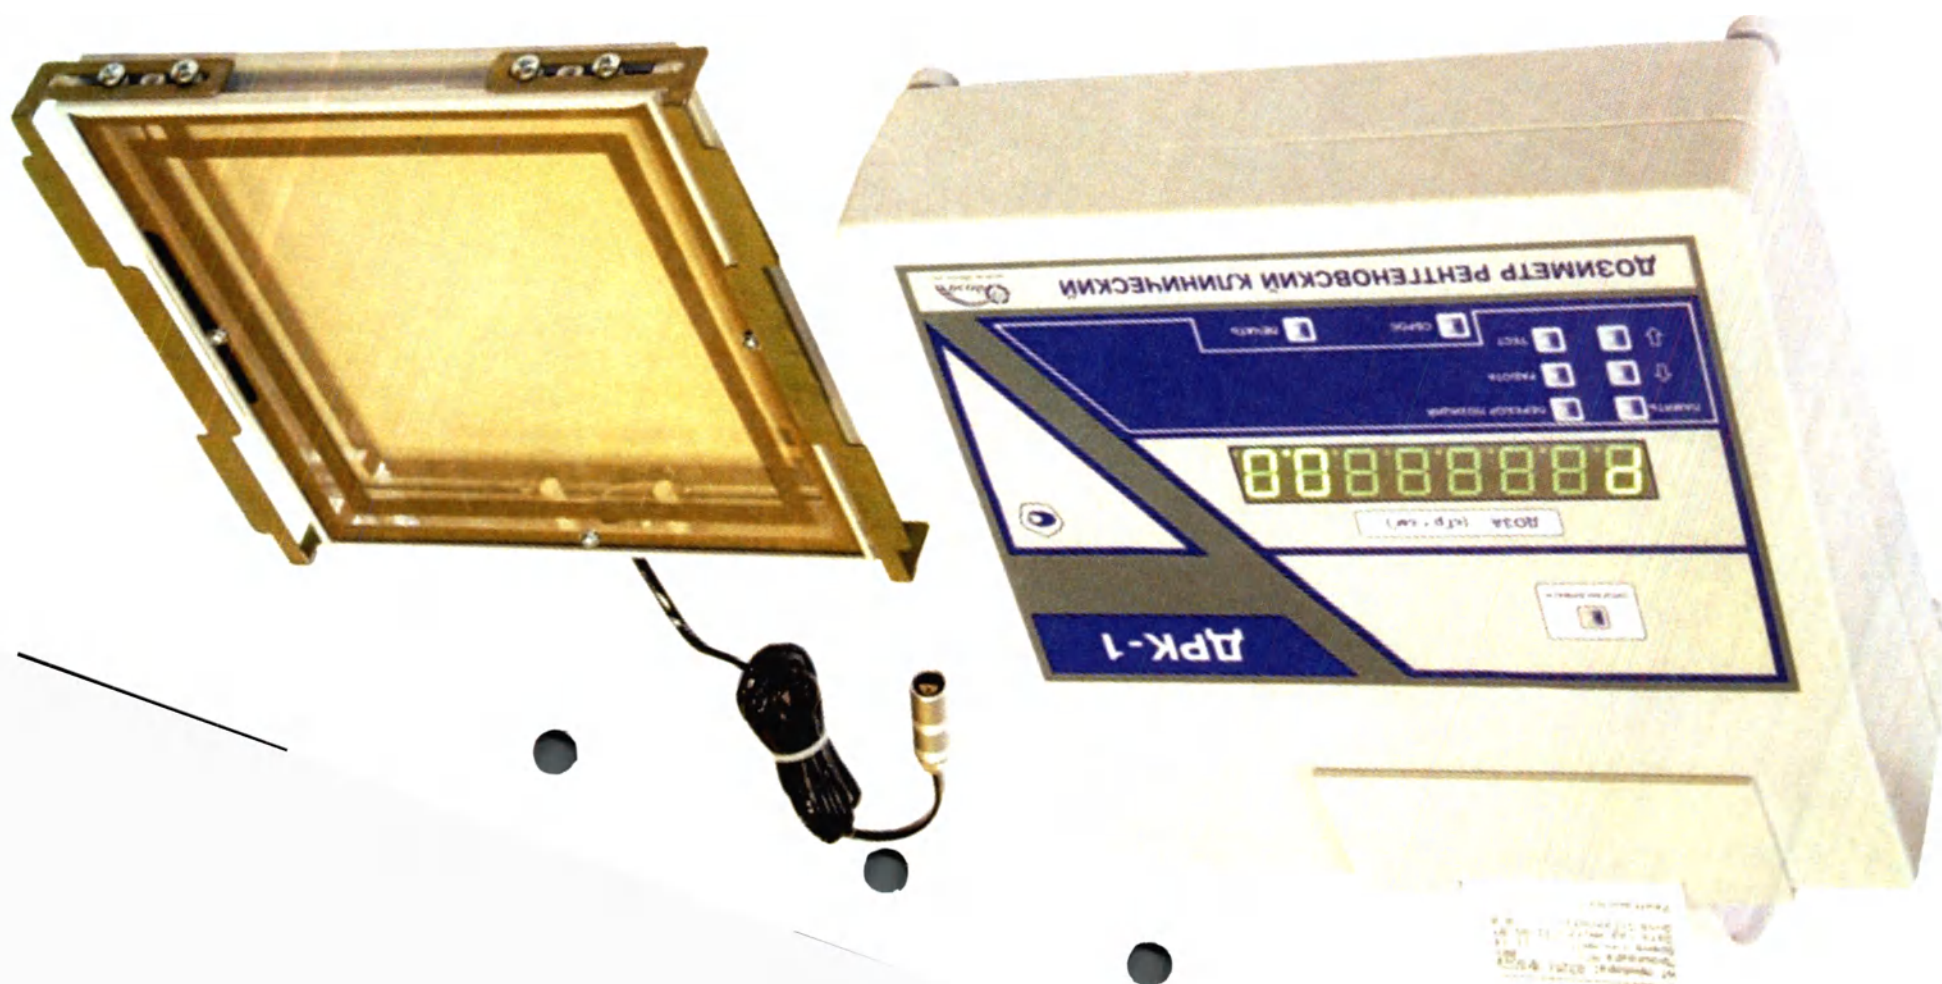

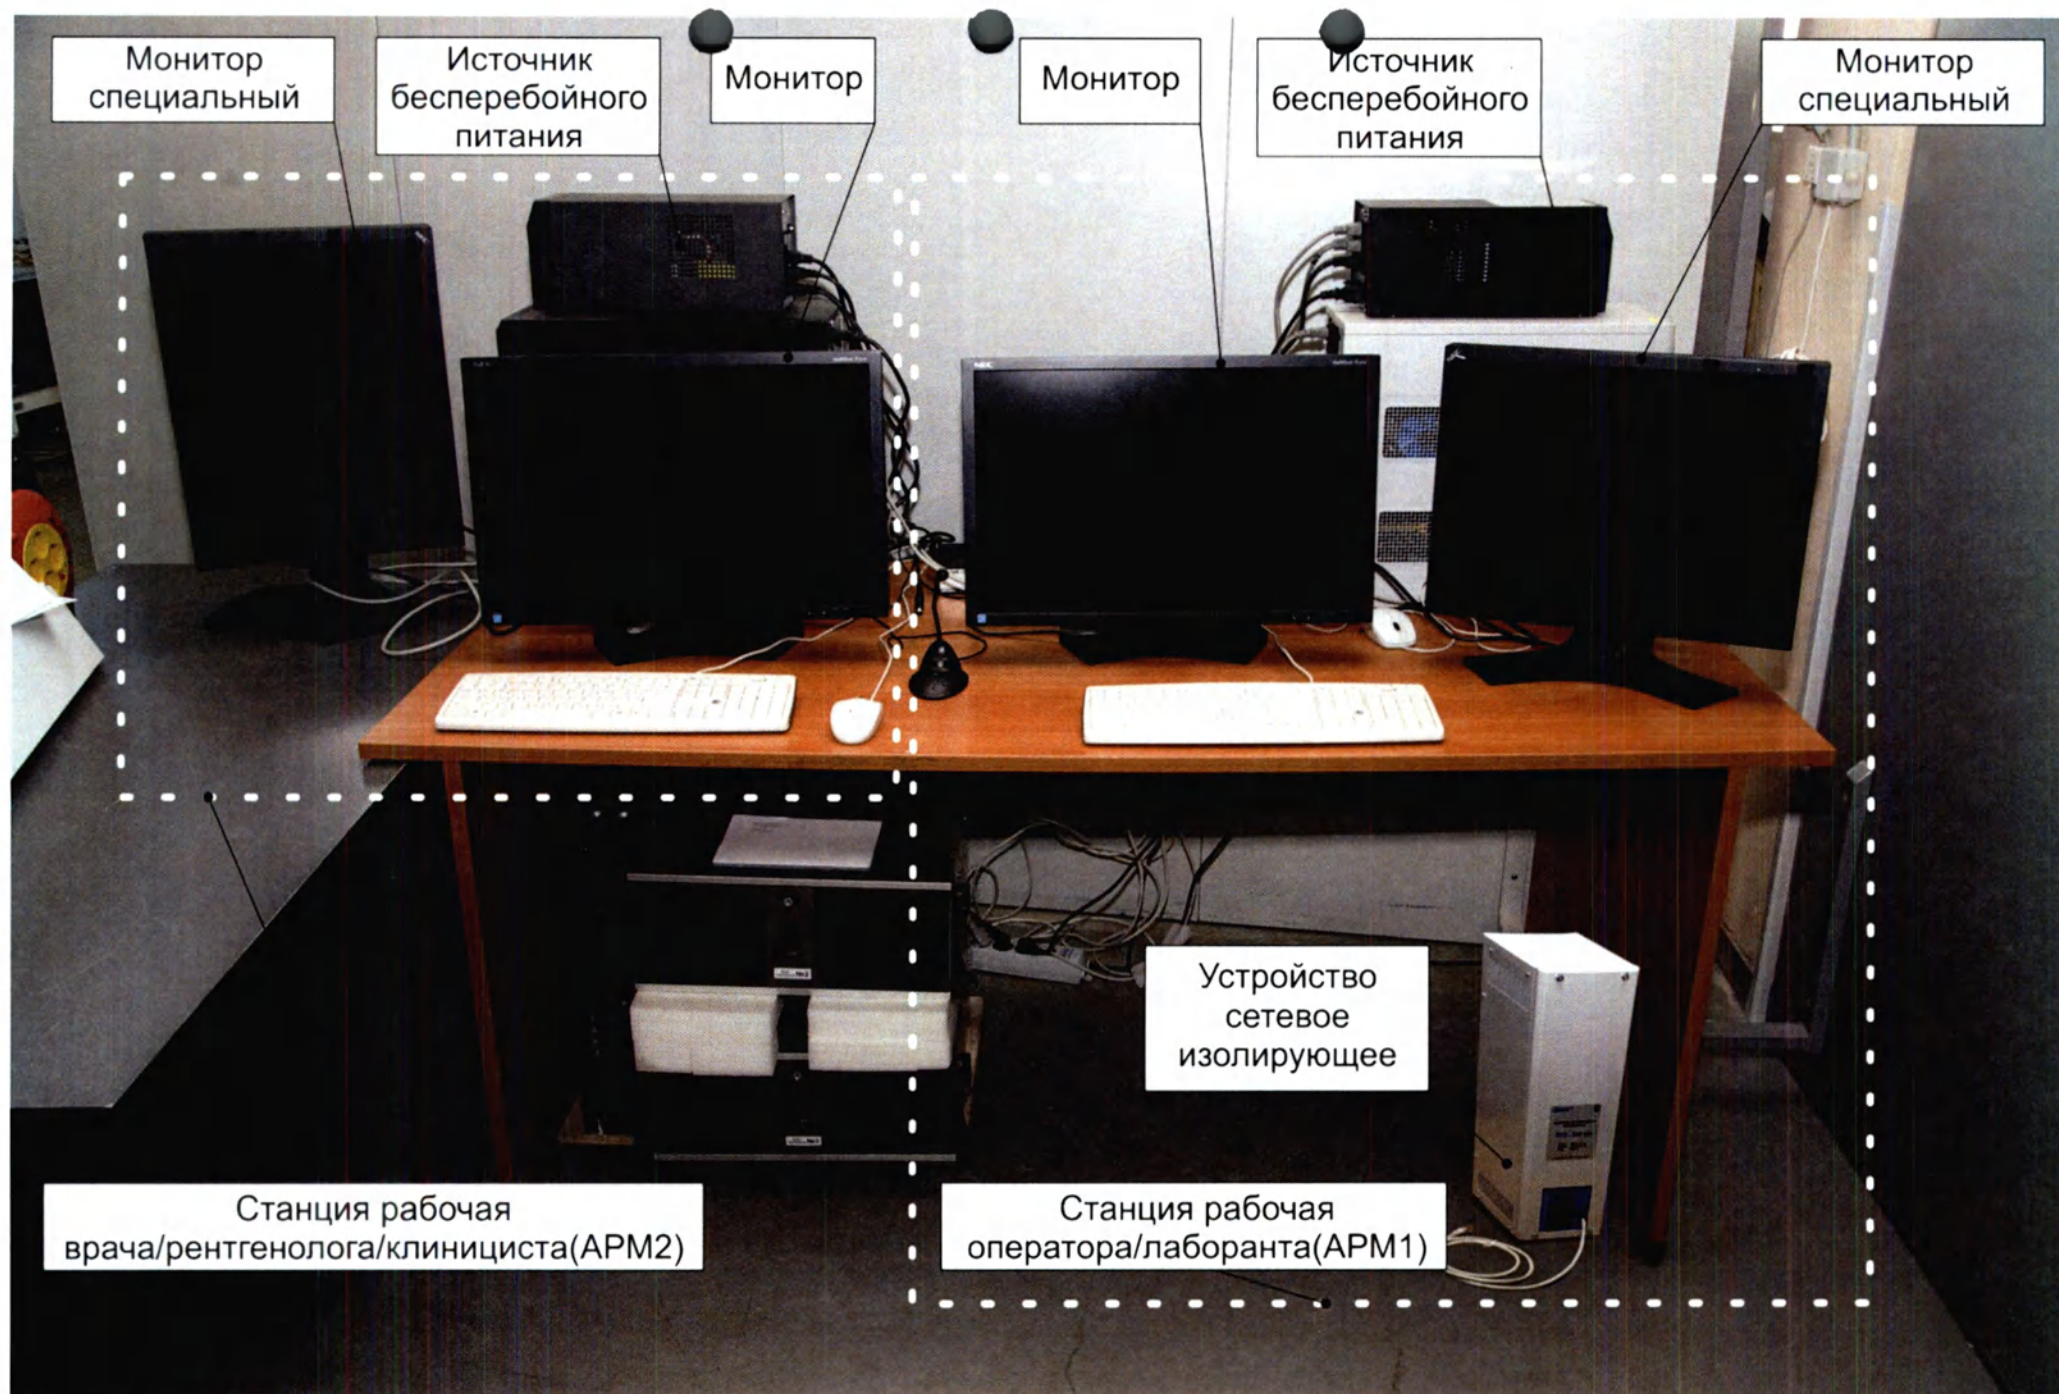

Фотография 18 – Станция рабочая оператора/лаборанта (APM1) и Станция рабочая врача/рентгенолога/клинициста (APM2)



Станция рабочая
оператора/лаборанта (АРМ1)

Серийный номер NN0027827
Дата изготовления 2023-05

Обозначение WST1-00-5100 (WST1-000)


Серийный номер МИ GP0005799

Изготовитель АО "НИПК "Электрон"

№ 20-0002-01



2/N/PE AC 230 В 50 Гц 1 кВА



Станция рабочая врача/
рентгенолога/клинициста
(АРМ2)

Серийный номер NN0027831
Дата изготовления 2023-05

Обозначение WST2-00-0300 (WST2-000)

Серийный номер МИ GP0005799

Изготовитель АО "НИПК "Электрон"

№ 20-0002-01



2/N/PE AC 230 В 50 Гц 1 кВА



Фотография 19 – Станция рабочая оператора/лаборанта (АРМ1) и Станция рабочая врача рентгенолога/клинициста (АРМ2). Маркировка



Фотография 20 – Станция рабочая регистратора/Web-доступа (АРМ3)



Фотография 21 – Сервер




Фотография 22 – Блок гальванической развязки



Фотография 23 – Принтер лазерный




Фотография 24 – Принтер универсальный, монохромный, графический

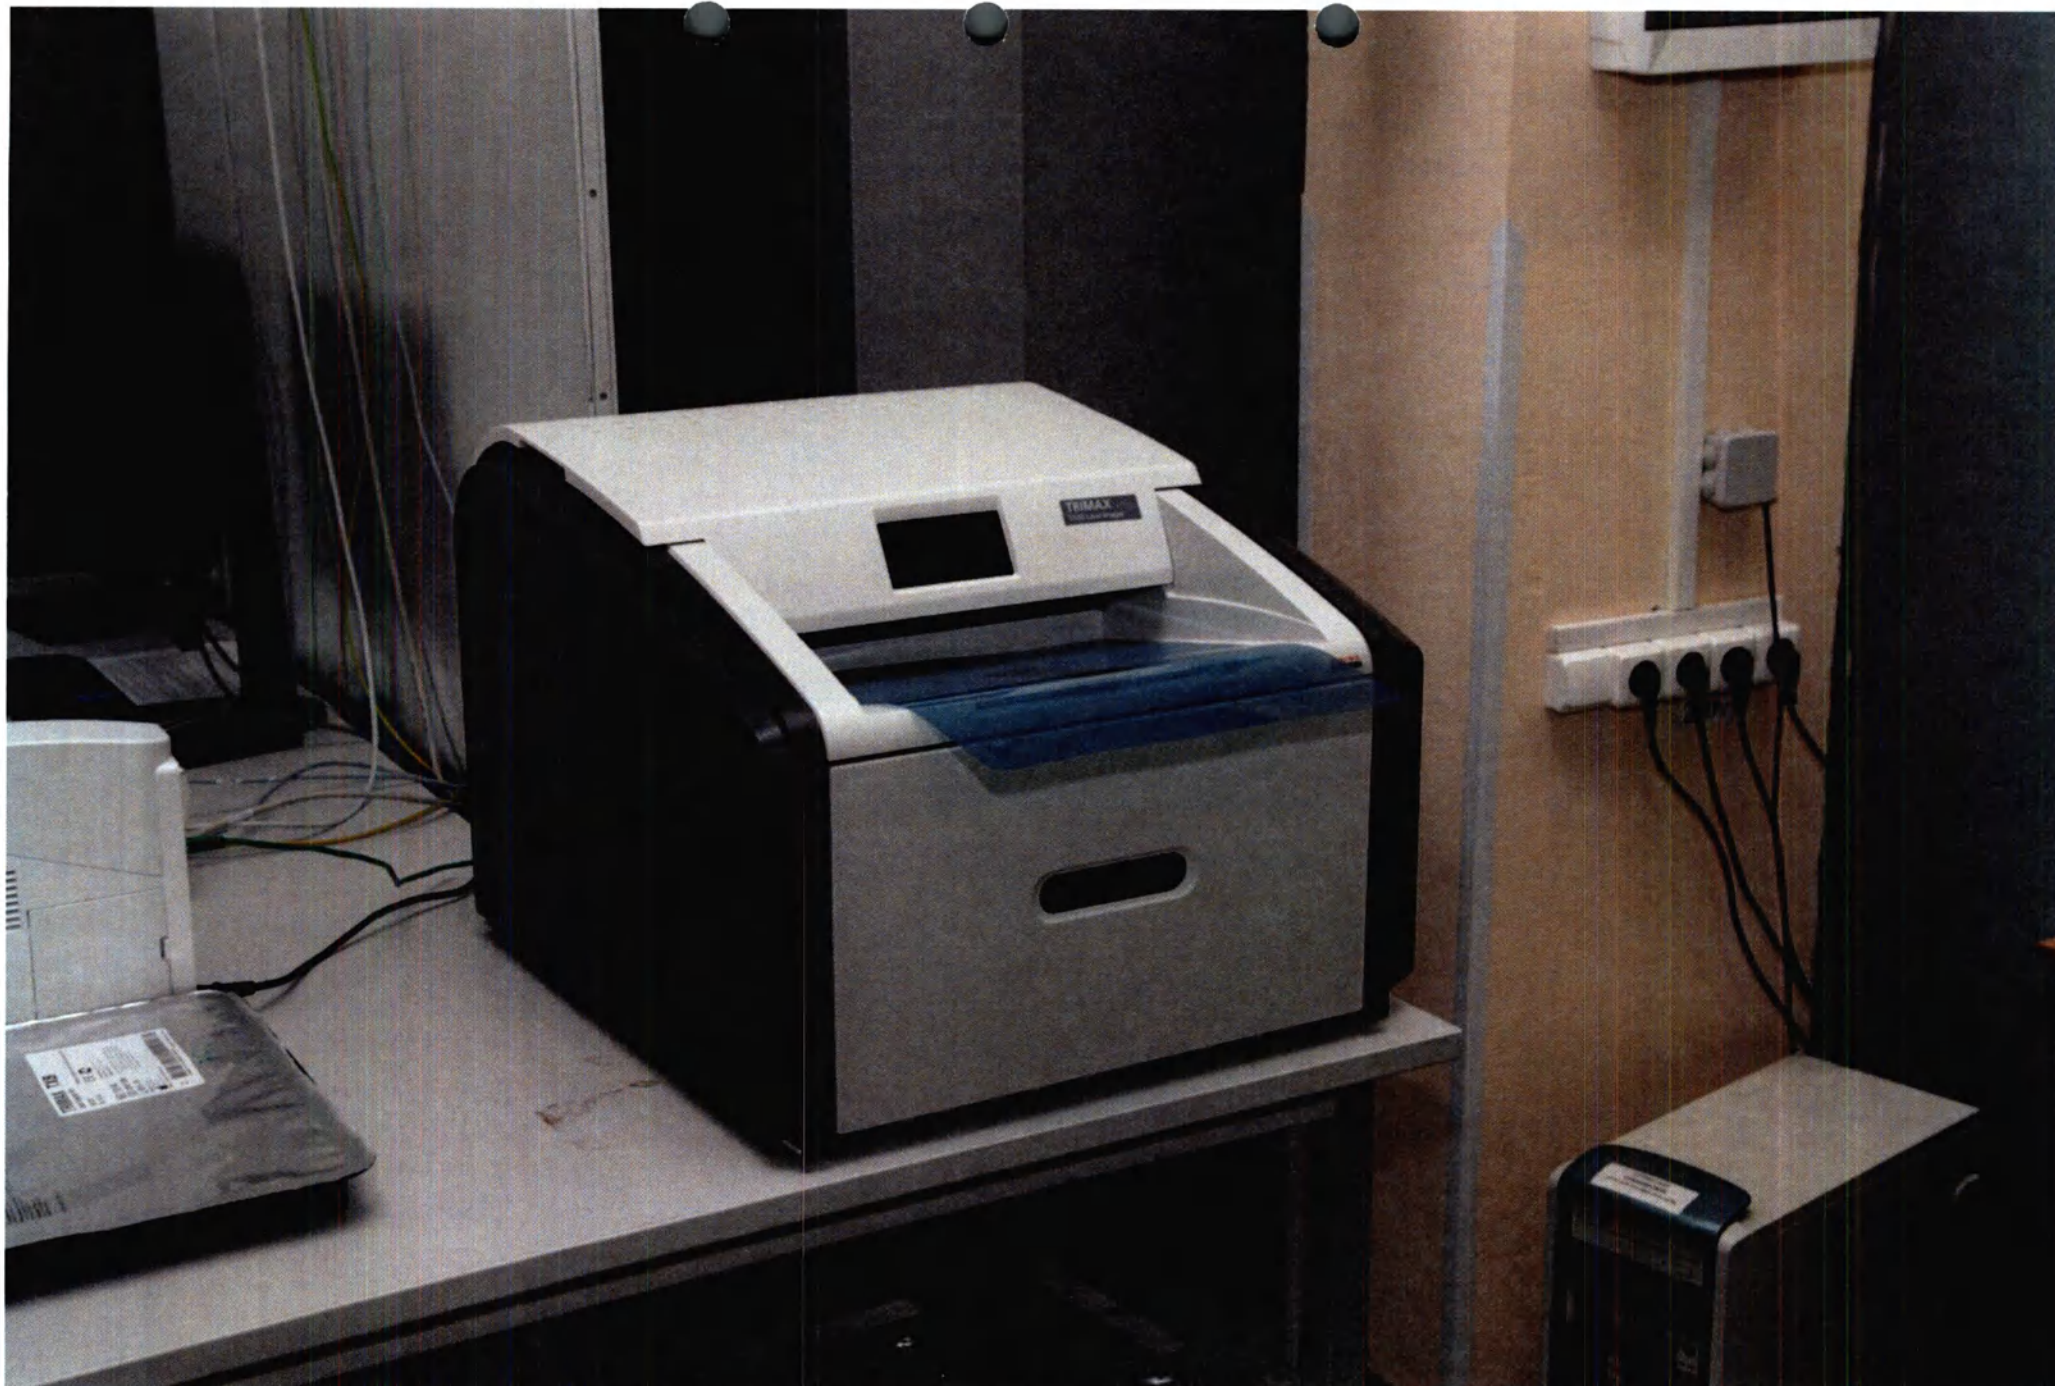

Фотография 25 – Камера лазерная мультиформатная для печати медицинских изображений



Фотография 26 – Устройство для печати медицинских изображений

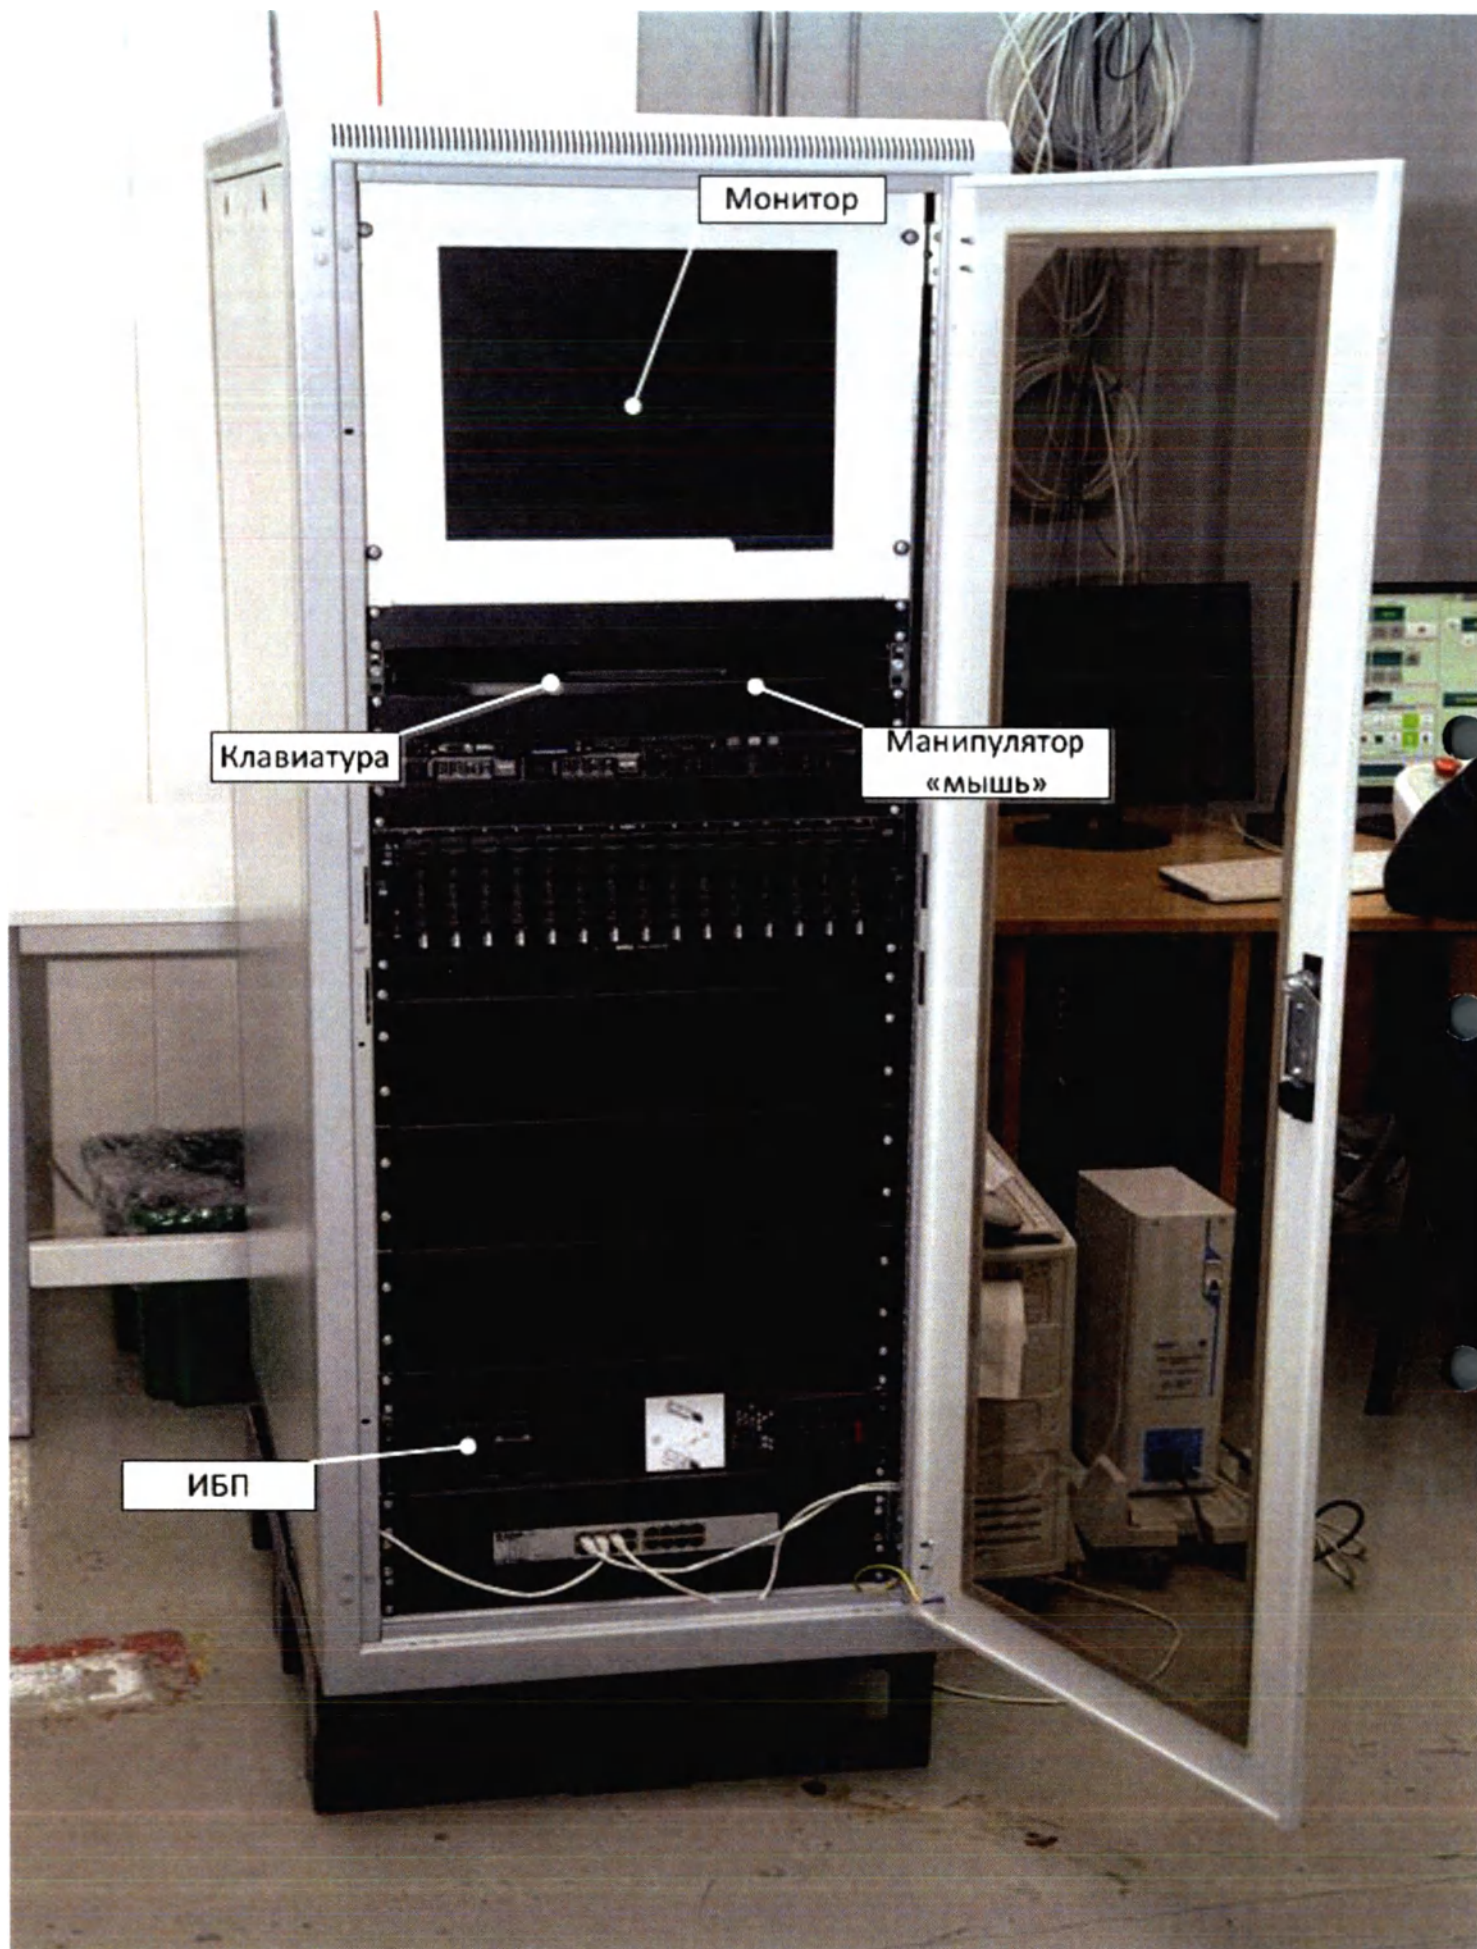

Фотография 27 – Комплекс программно-аппаратный ПАК (сервер)



Комплекс программно-
аппаратный РПАК

ТУ 9442-030-11150760-2009
№ФСР 2009/05504
Ссерийный номер NN0003545
Дата изготовления 2023-05

Обозначение PACS-00-0000

Серийный номер МИ GP0005799

Изготовитель АО "НИПК "ЭЛЕКТРОН"

NP-20-0001



Фотография 28 – Комплекс программно-аппаратный РПАК. Маркировка



Сервер

Серийный номер NN0003342
Дата изготовления 2023-05

Обозначение SRV-00-1300 (SRV- 000)

Серийный номер МИ GP0005799

Изготовитель АО "НИПК "ЭЛЕКТРОН"

NP-20-0002-02




~220В, 50Гц, 6А



Фотография 29 – Сервер. Маркировка



Фотография 30 – Комплекс программно-аппаратный ПАК (станция рабочая)

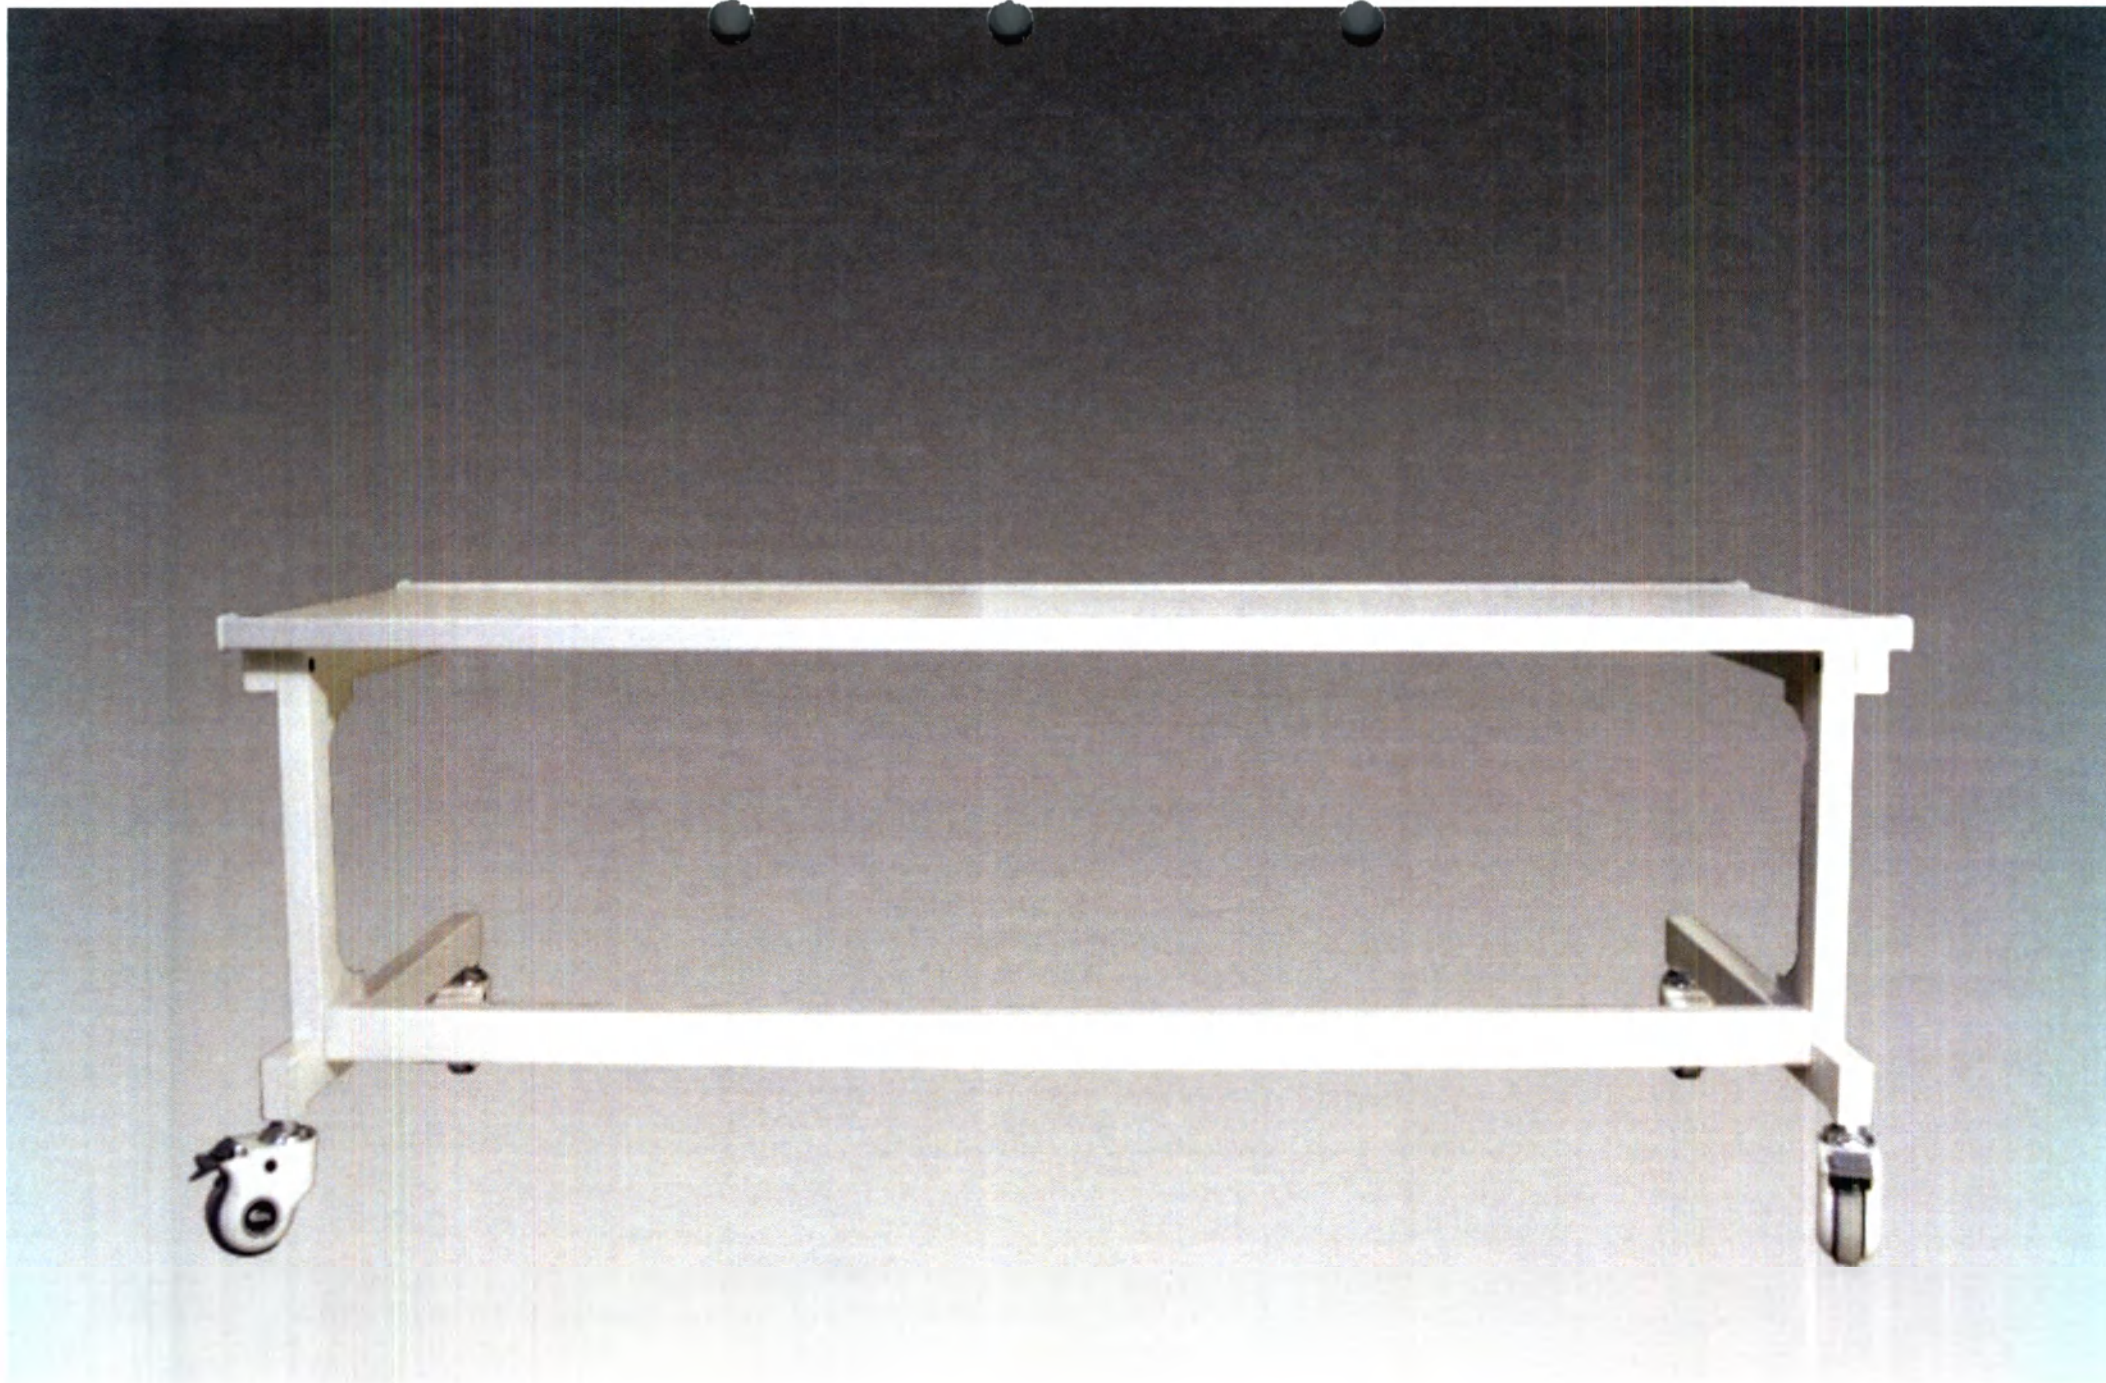

Фотография 31 – Стол-каталка

ЭЛЕКТРОН

Стол-каталка

Серийный номер
Дата изготовления

NN0003350
2023-05

Обозначение

SUR-10-0850-01


Серийный номер МИ

GP0005799

Изготовитель

АО "НИПК "Электрон"

NP-20-0002-01





Фотография 33 – Окно рентгенозащитное



Фотография 34 – Рентгенозащитная дверь




Фотография 35 – Комплект индивидуальных поливинилхлоридно-свинцовых средств защиты пациентов и медицинского персонала от рентгеновского излучения. Образцы



Фотография 36 – Комплект индивидуальных поливинилхлоридно-свинцовых средств защиты пациентов и медицинского персонала от рентгеновского излучения. Образцы




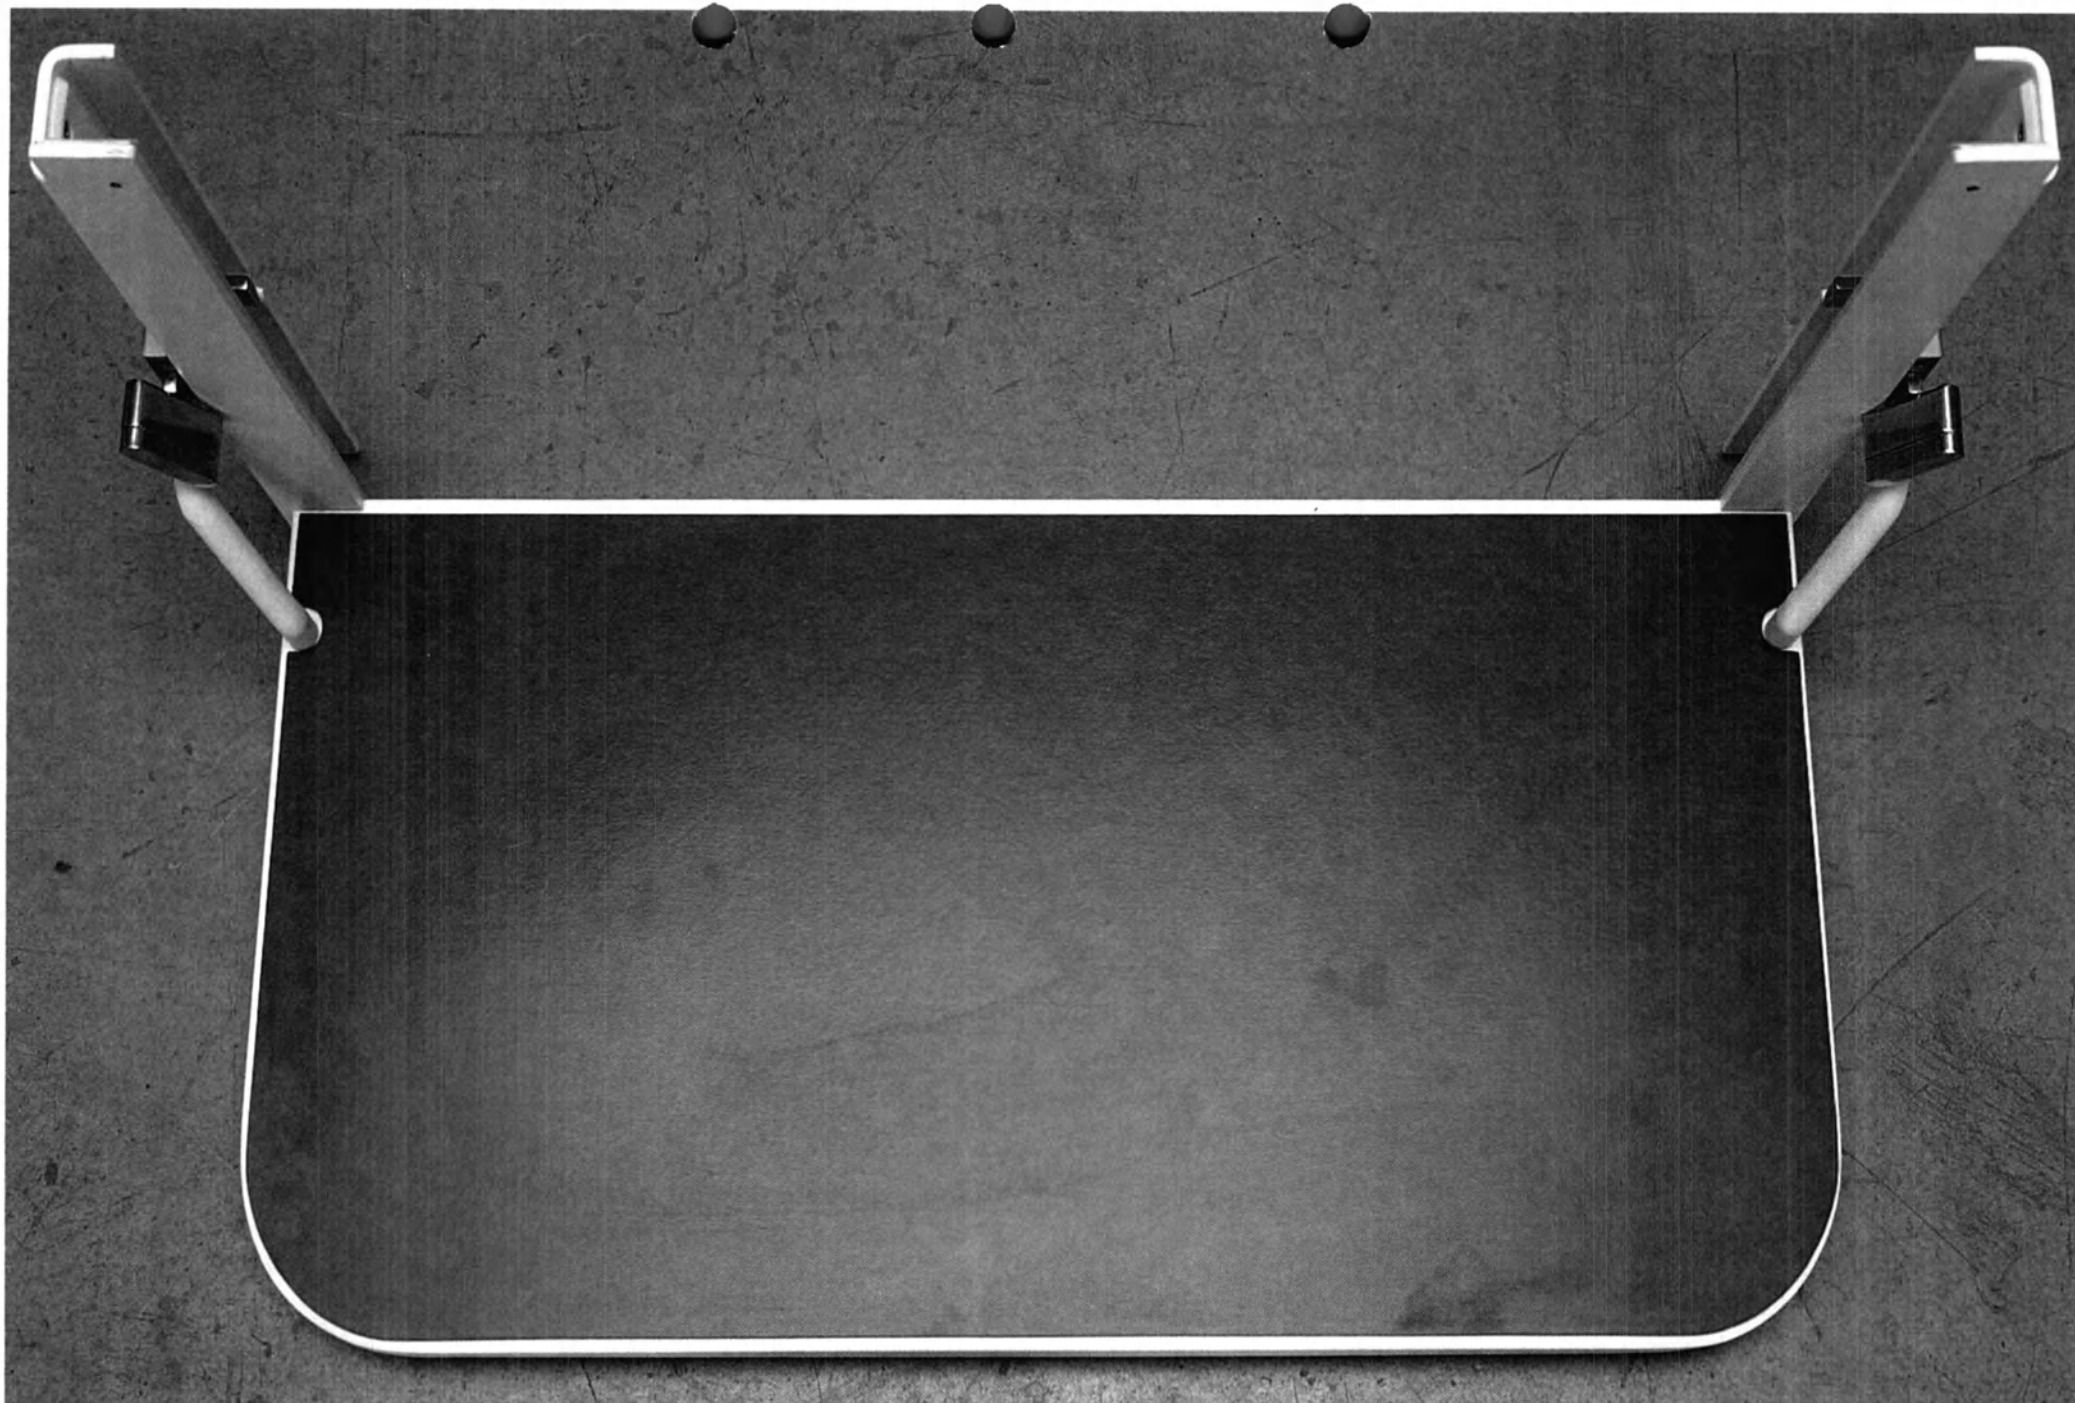


Фотография 38 – Подножка



Фотография 39 – Упор плечевой

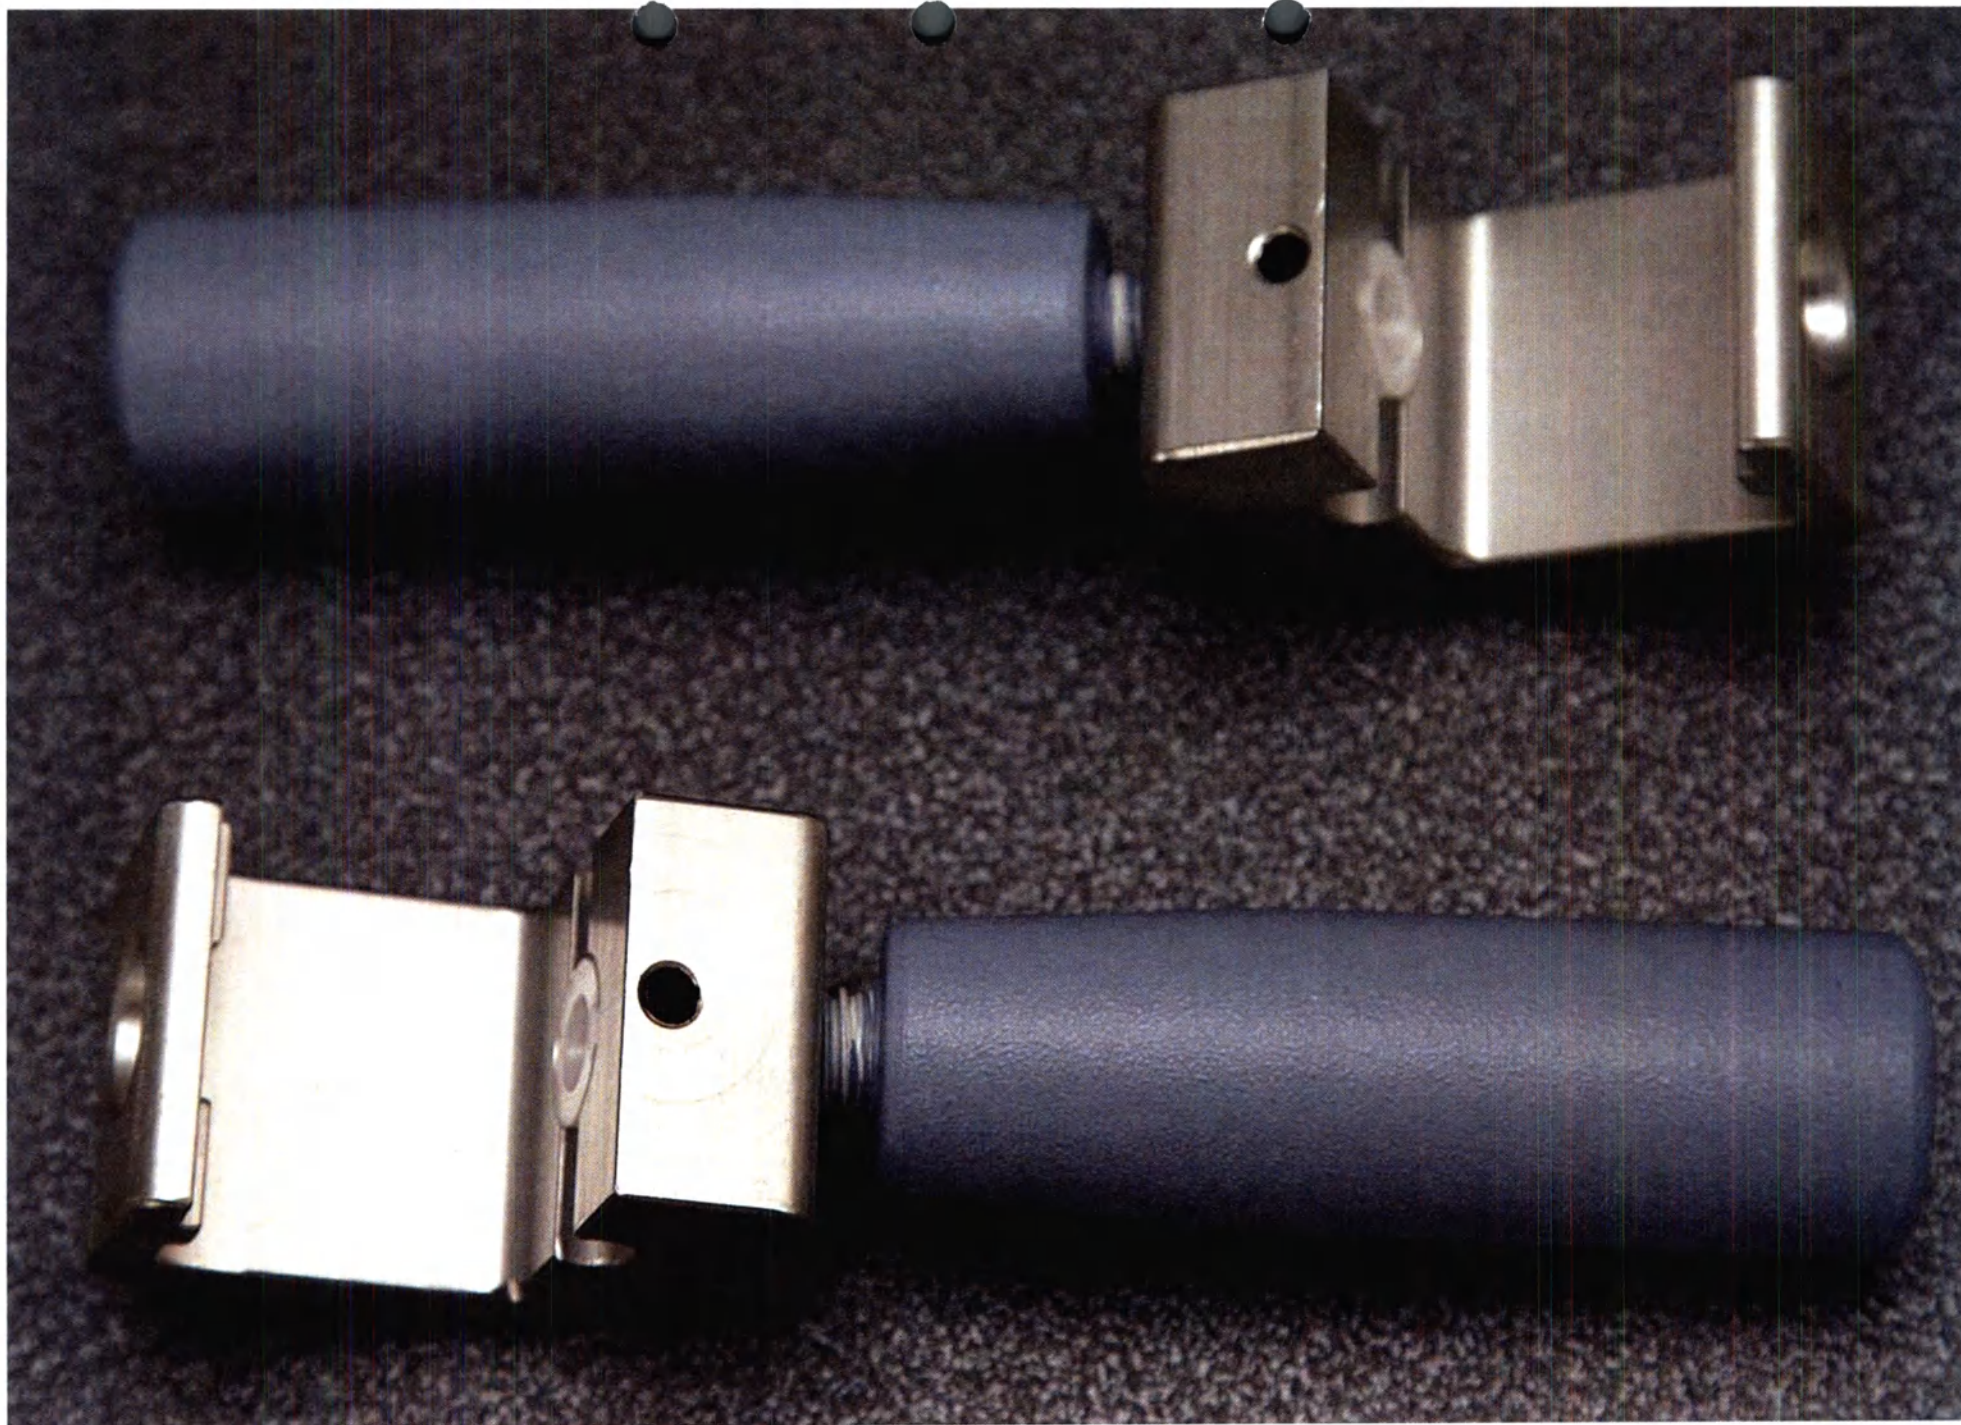

Фотография 40 – Поручень

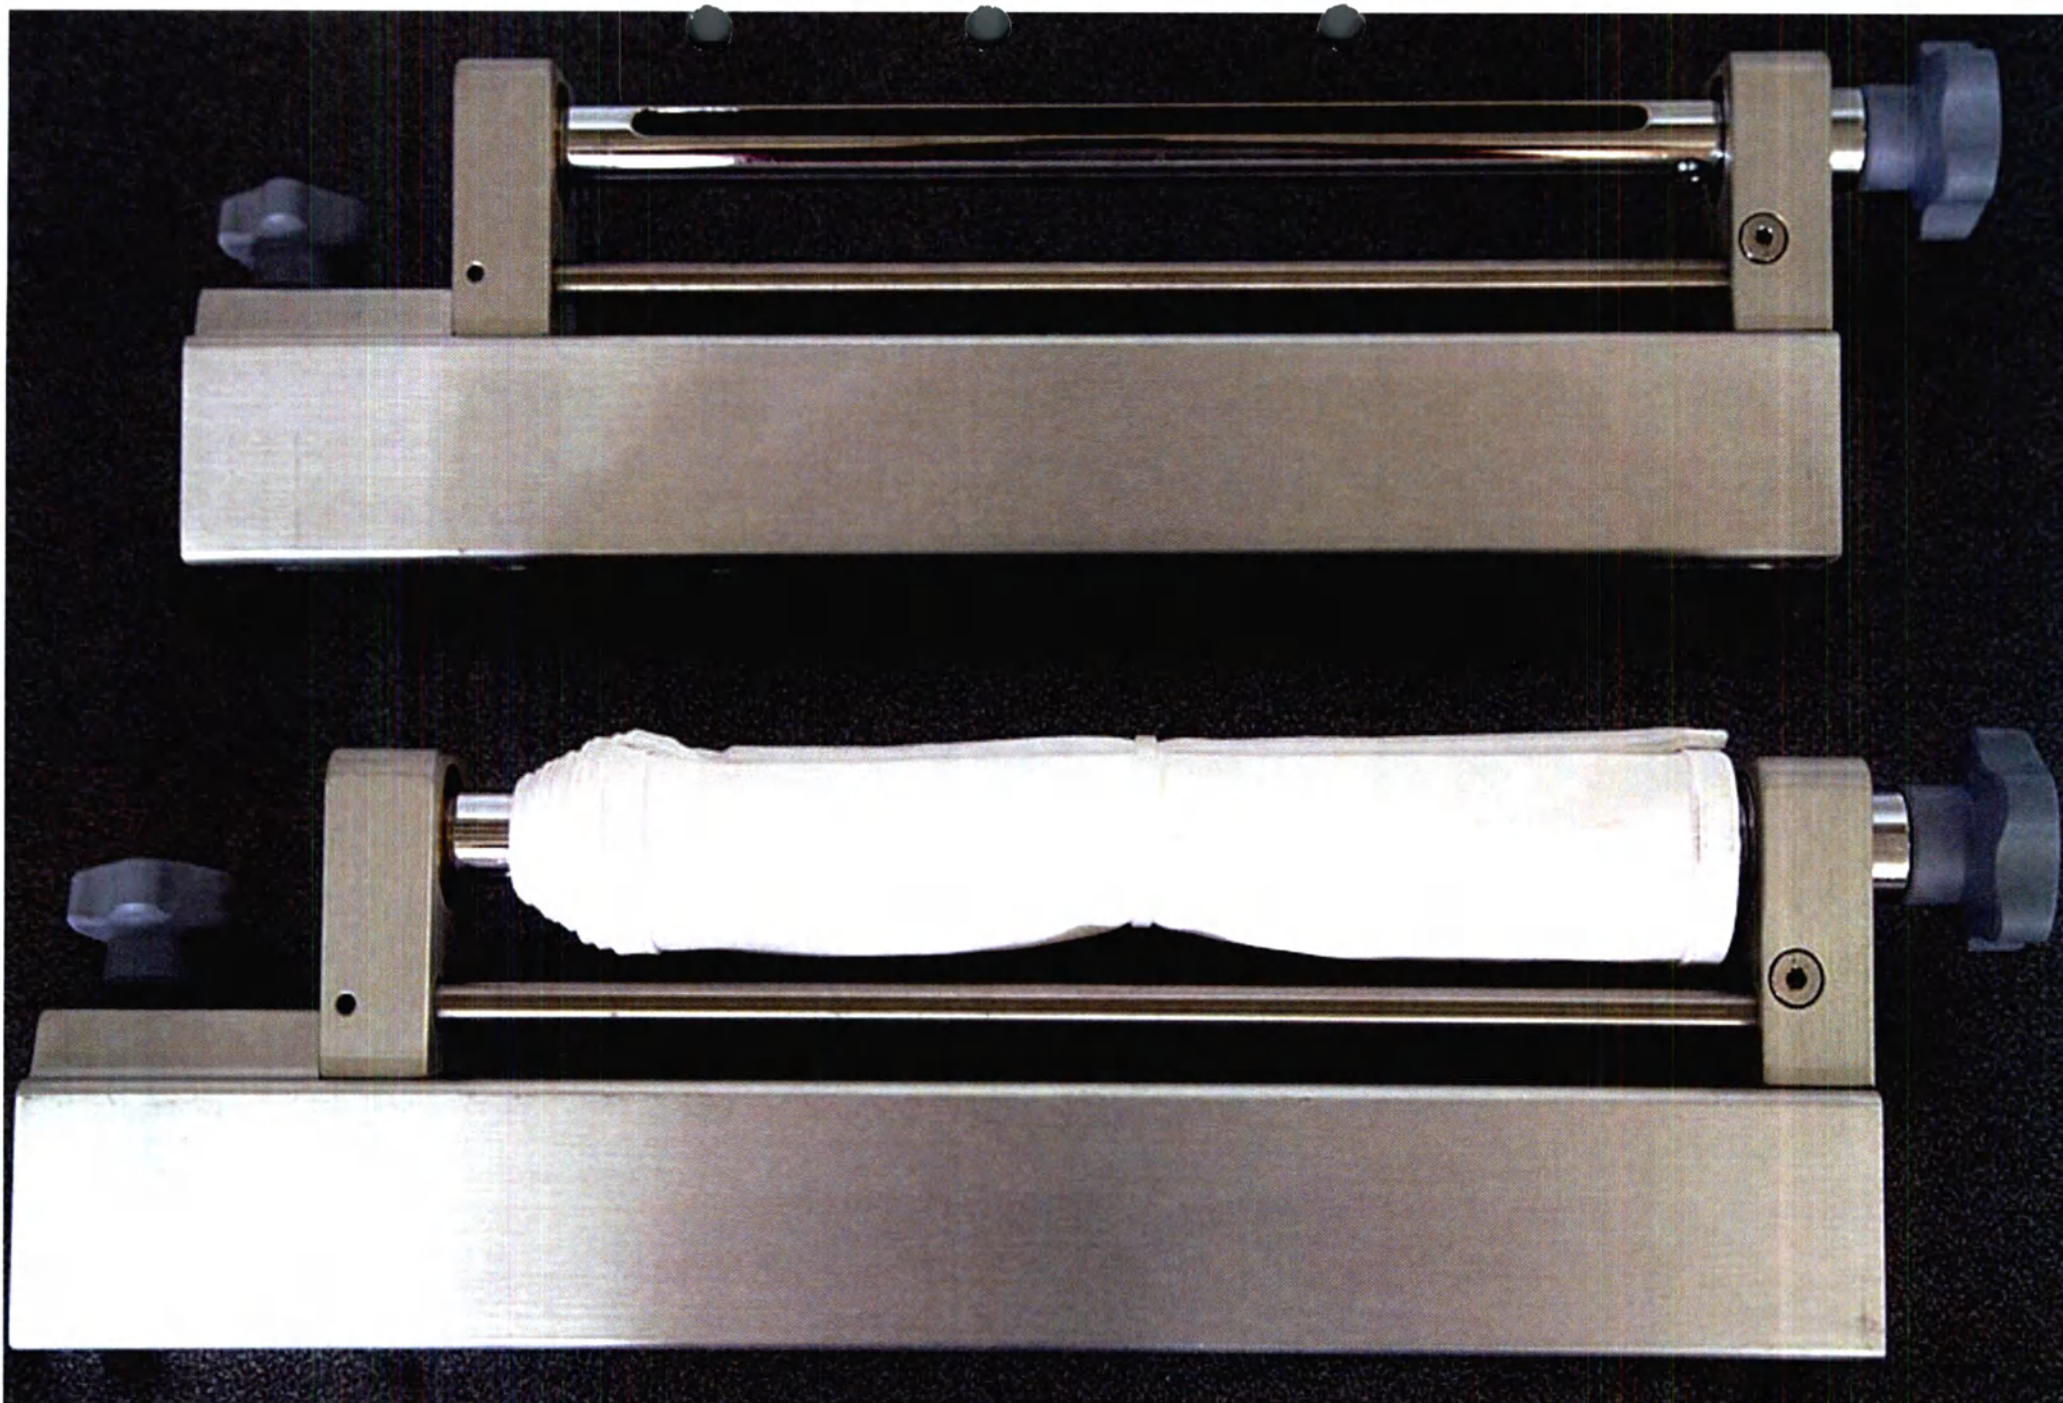

Фотография 41 – Ремень компрессионный



Фотография 42 – Пульт дистанционного управления

ЭЛЕКТРОН

**Пульт дистанционного
управления**

**Серийный номер
Дата изготовления**

**NN0027821
2023-05**

Обозначение

ВРАЕ 421455.001

Серийный номер МИ

GP0005799


Изготовитель

АО "НИПК "Электрон"

NP 20-0002-01



4/N/PE DC 24 В 500 мА



Фотография 43 – Пульт дистанционного управления. Маркировка



Фотография 44 – Приемник рентгеновского изображения



**Аппарат рентгенодиагностический
телеуправляемый АРТ
№ GP *******

МЕСТО № 1/X

Контракт №

Заказчик

Поставщик

Грузополучатель

Пункт назначения

БРУТТО * Кг**

Грузоотправитель:


НЕТТО * Кг**

АО «НИПК «Электрон»,
197758, г. Санкт-Петербург, ВНТЕР,
Г. Поселок Песочный, ул. Садовая, д. 88,
стр. 1, помещ. 8Н

***** х *** х *** СМ**

ВНИМАНИЕ!

Вскрывать только в присутствии представителя поставщика



Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 45
(Сорок пять) лист(ов)

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА
СЕРТИФИКАЦИИ
ДЕНИСОВА О.А.
ПО ДОВЕРЕННОСТИ №

