

МАКЕТ МАРКИРОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Система автоматизированная загрузки россыпью и сортировки
образцов биологических материалов HCTS2000 MK2**

Производства Сарштедт АГ и Ко. КГ, Германия (Sarstedt AG & Co. KG, Germany)

Система автоматизированная загрузки россыпью и сортировки образцов биологических материалов HCTS2000 MK2

АС ~ 110-230 В, 50/60 Гц, 100 ВА, Предохранители: Т 3,15 А



Sarstedt AG & Co. KG / «Сарштедт АГ и Ко. КГ»
Sarstedtstrasse 1, 51588 Numbrecht, Germany (Германия)



Дата изготовления: XX / XXXX



Только для диагностики *in vitro*



Серийный номер: XXXXX



Номер по каталогу: XX.XXX.XXX

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Сарштедт»

Адрес: 198517, Россия, Санкт-Петербург, вн. тер. г. город Петергоф, ул. Новые Заводы, д. 58, к. 4, стр. 1, помещ. 207

Тел. +7 495 937 52 28 Факс: +7 495 937 52 28

Адрес электронной почты: info.ru@sarstedt.com

и скреплено печатью
2 листа (-ов)
Генеральный директор
ООО «Сарштедт»
Белунин А.В.





ООО "Сарштедт"

Юр. Адрес: 198517, Россия, Санкт-Петербург, вн. тер. г. город Петергоф, ул. Новые Заводы, д. 58, к. 4, стр. 1, помещ. 207

ИНН 6037008575 КПП 781901001 ОГРН 1176027000896 Тел./факс: +7 (495) 937-52-28

Почтовый адрес: 198517, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, а/я №9

Приборы и
расходные
материалы
для медицины
и науки

Фотографические изображения медицинского изделия для диагностики in vitro


Система автоматизированная загрузки россыпью и сортировки образцов
биологических материалов HCTS2000 MK2




1. Система автоматизированная загрузки россыпью и сортировки образцов биологических материалов HCTS2000 MK2: общий вид изделия




2. Дополнительный сортировочный модуль, не более 3 шт. (при необходимости)

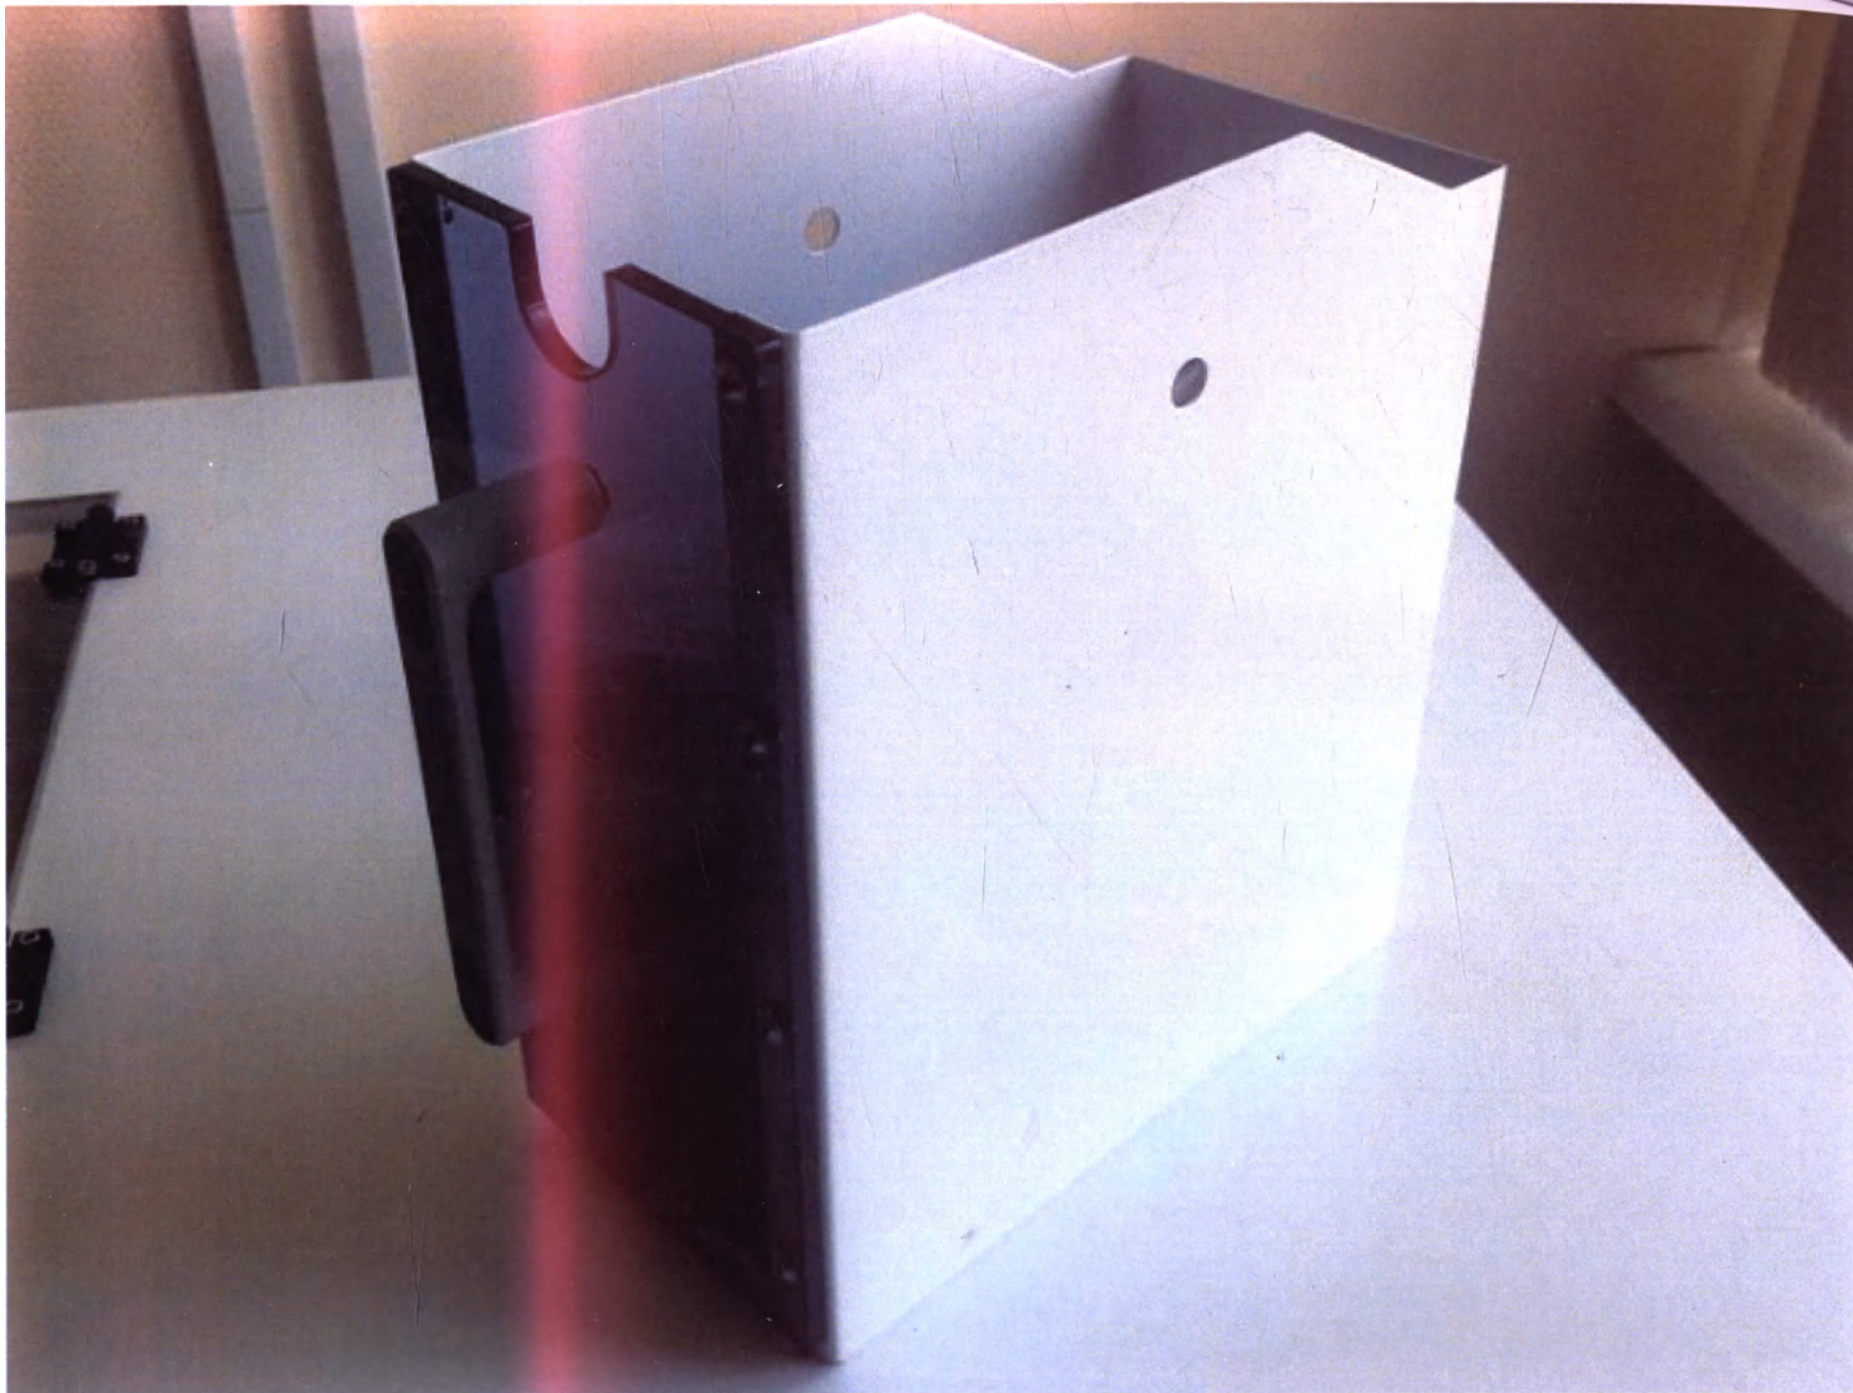

3. Съемный контейнер для выгрузки, не более 100 шт.

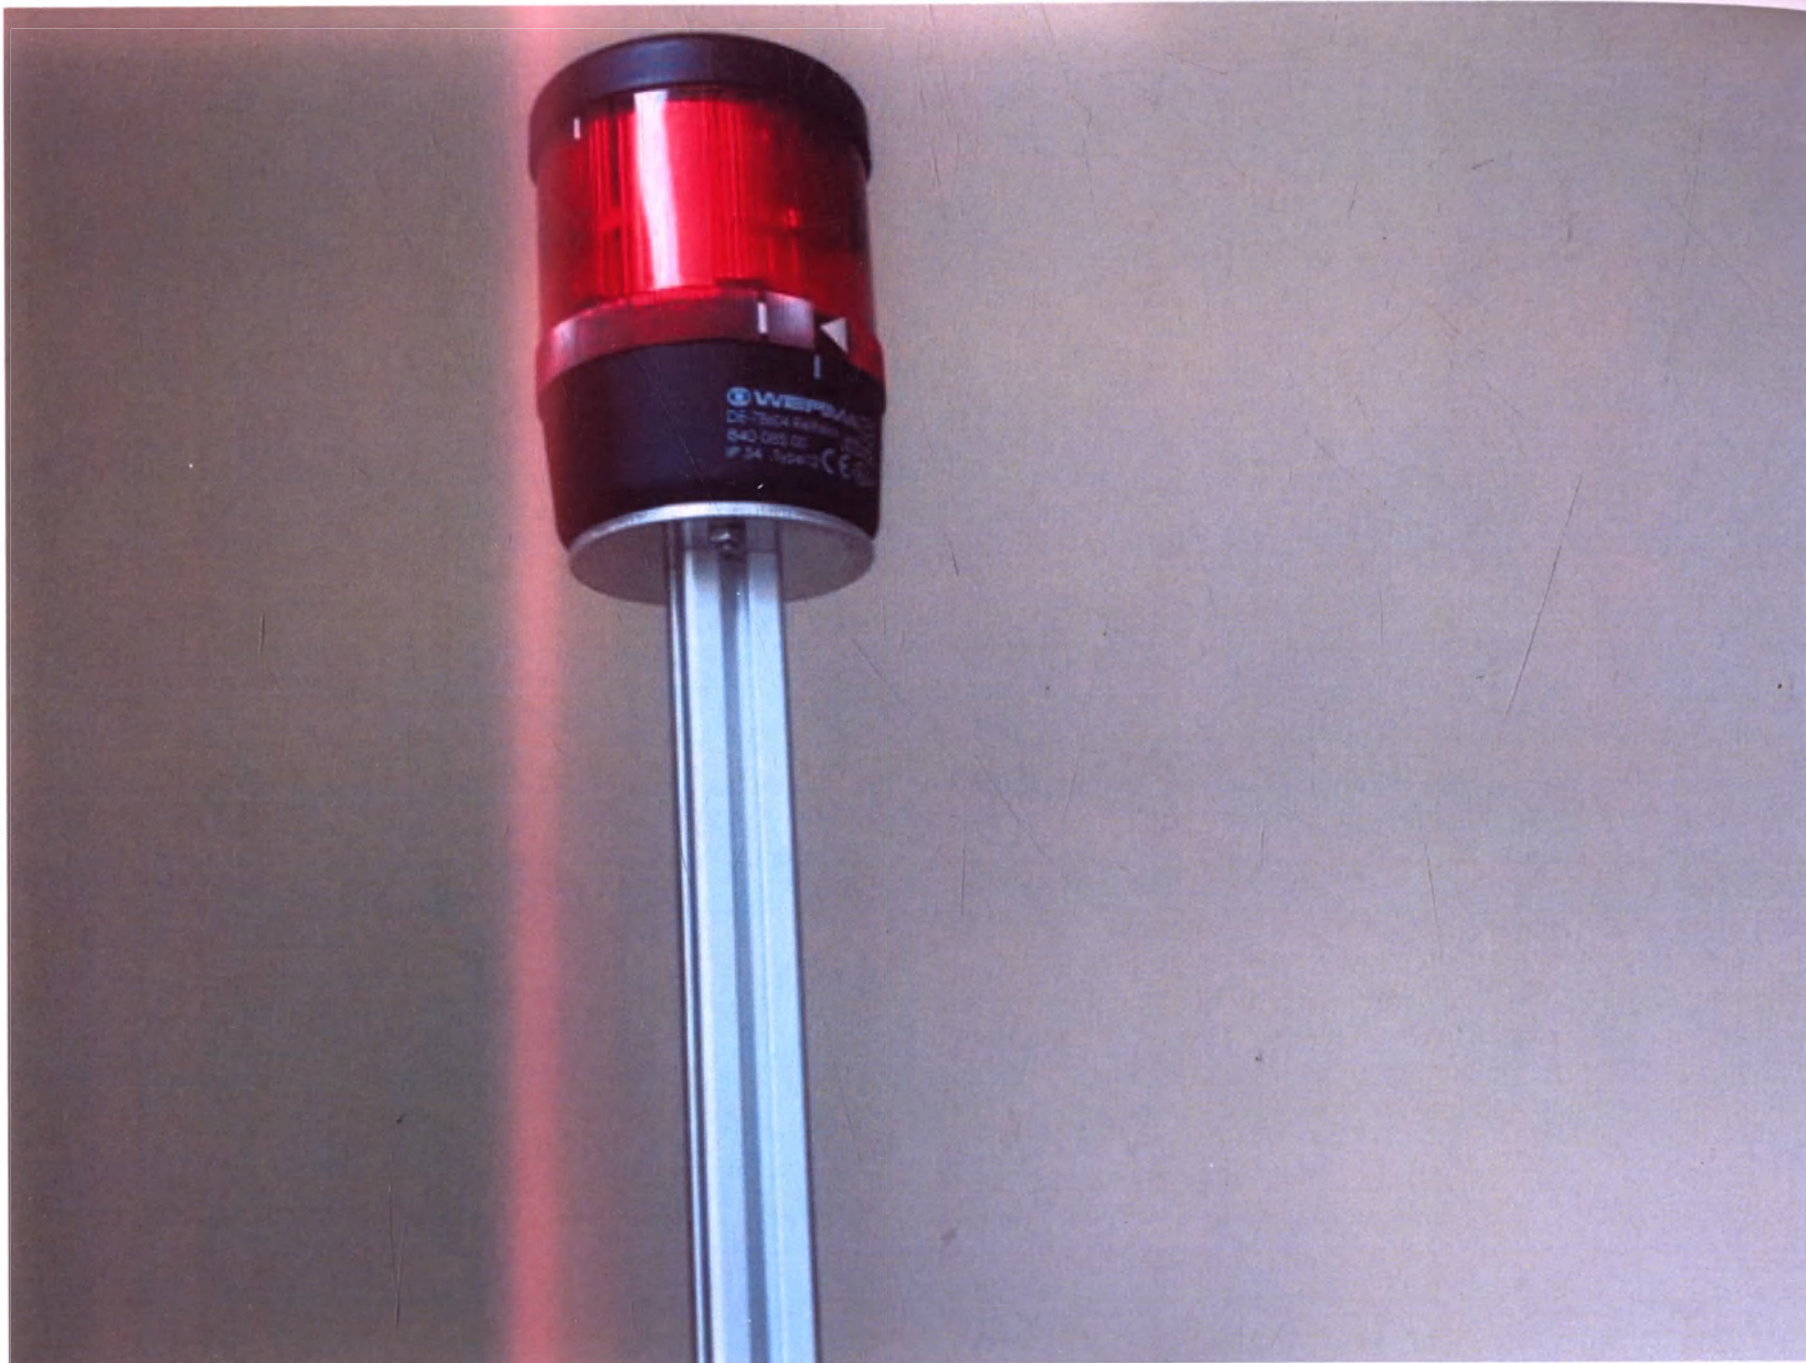


4. Сигнальная лампа (при необходимости)

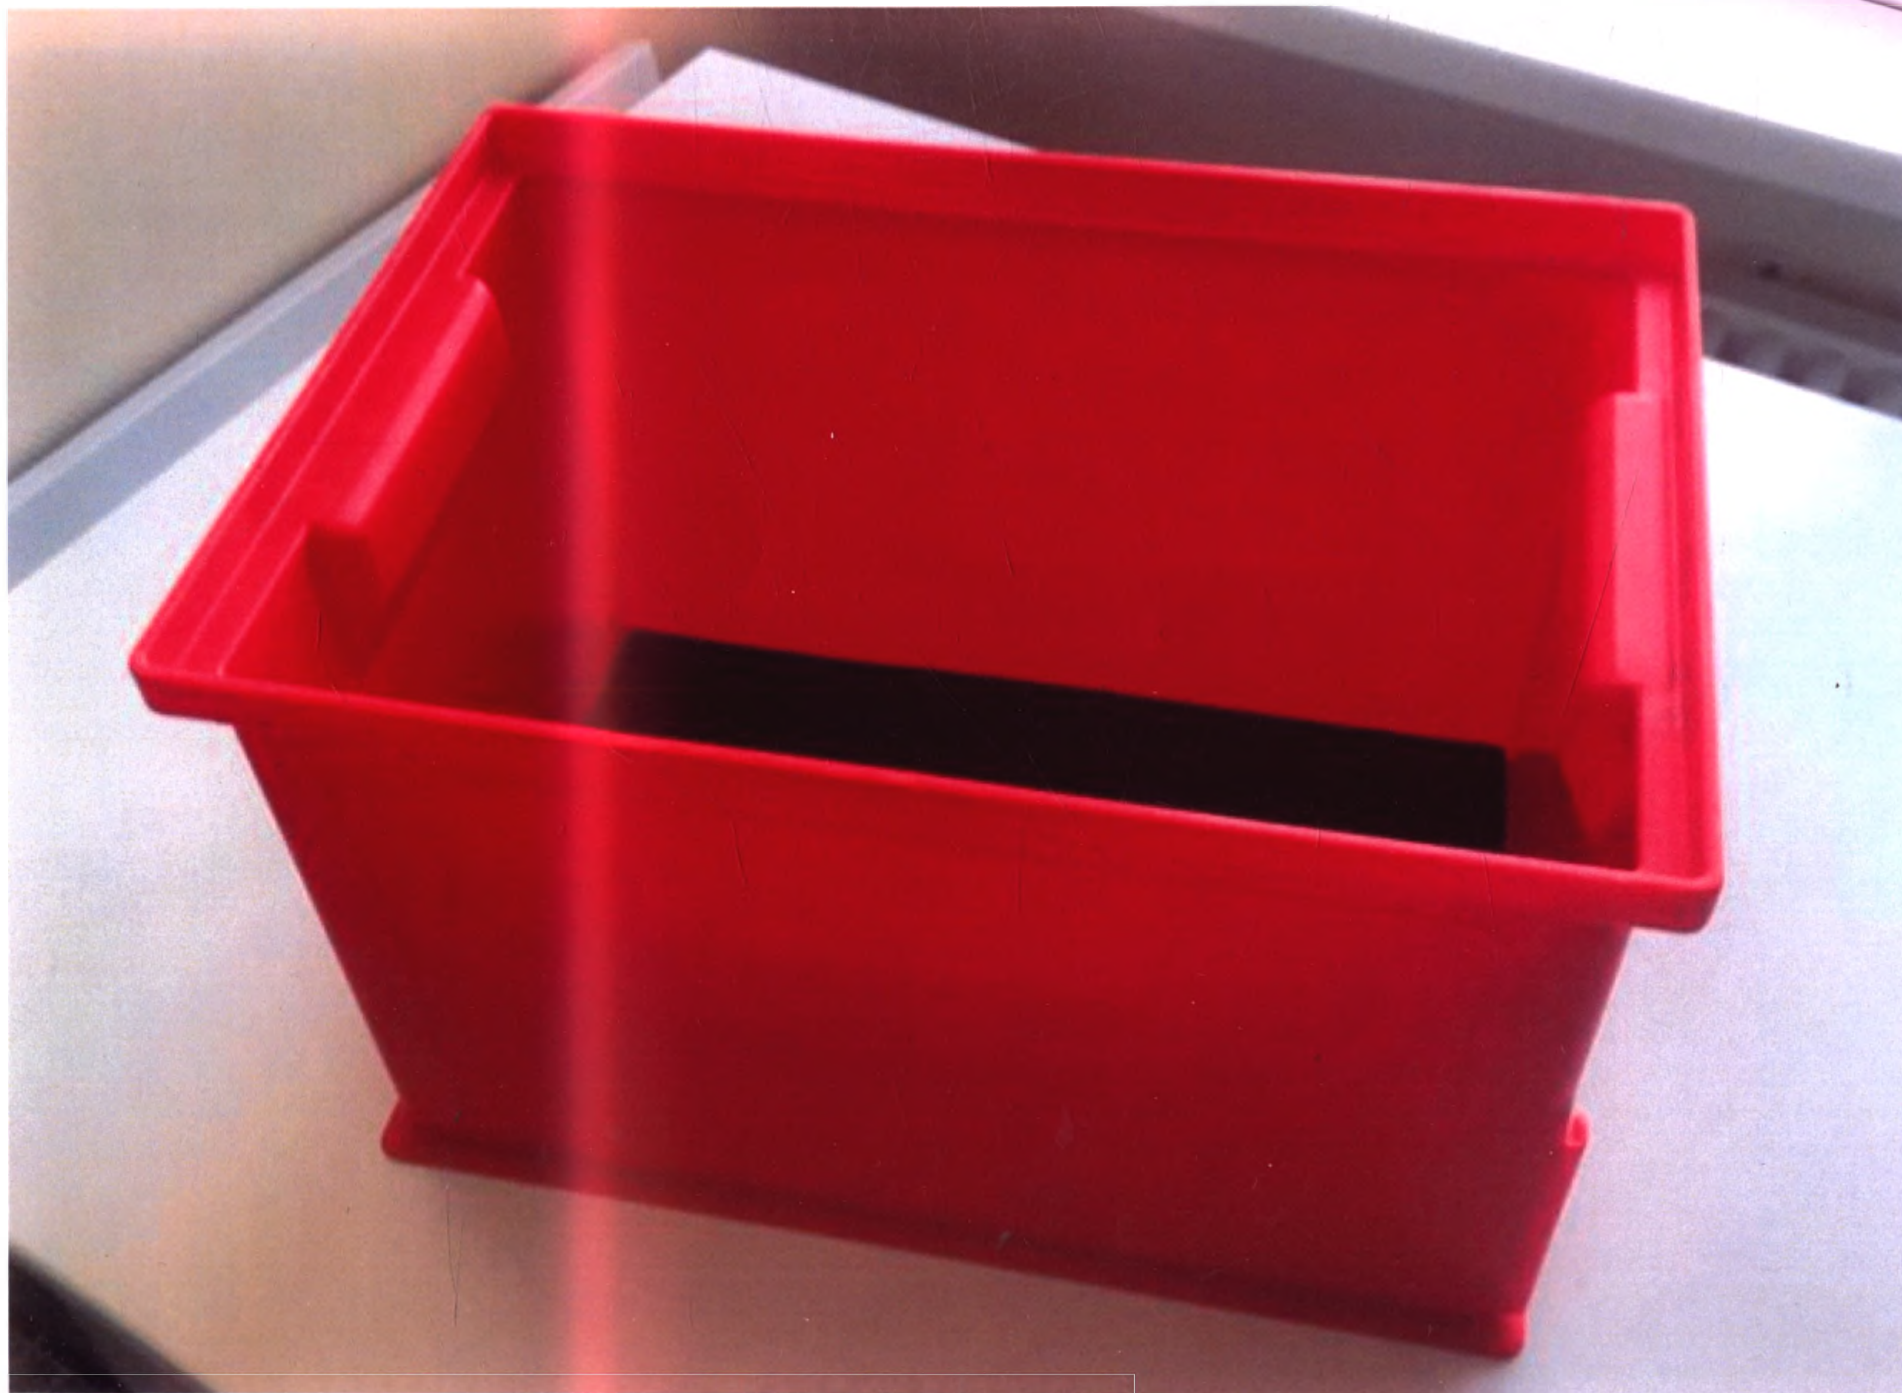


5. Контейнер для брака



6. Кабель последовательной связи

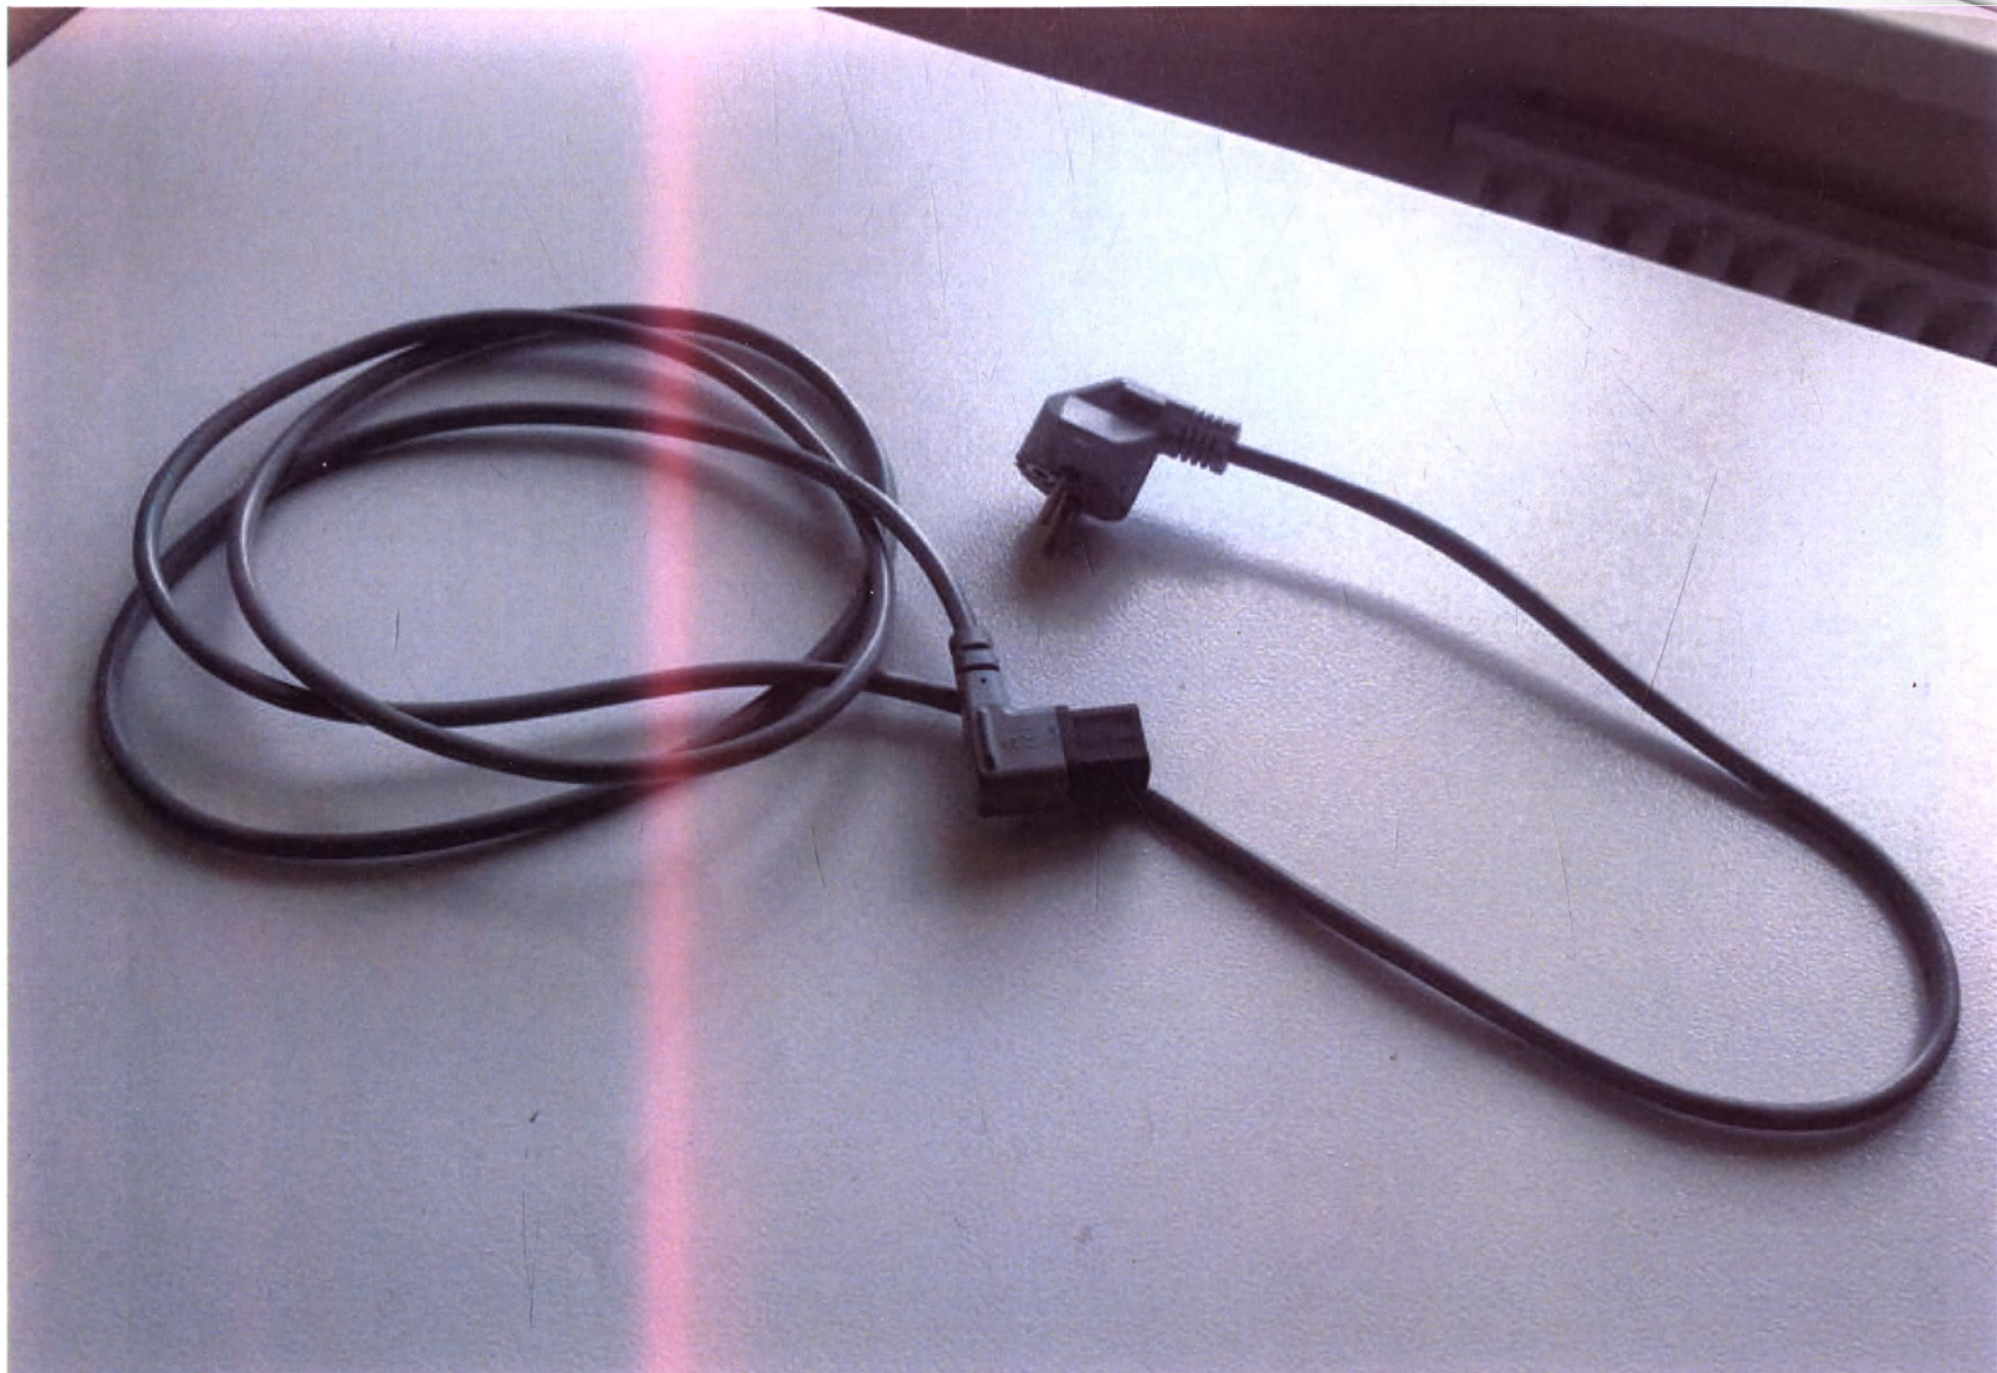


7. Съёмный шнур электропитания

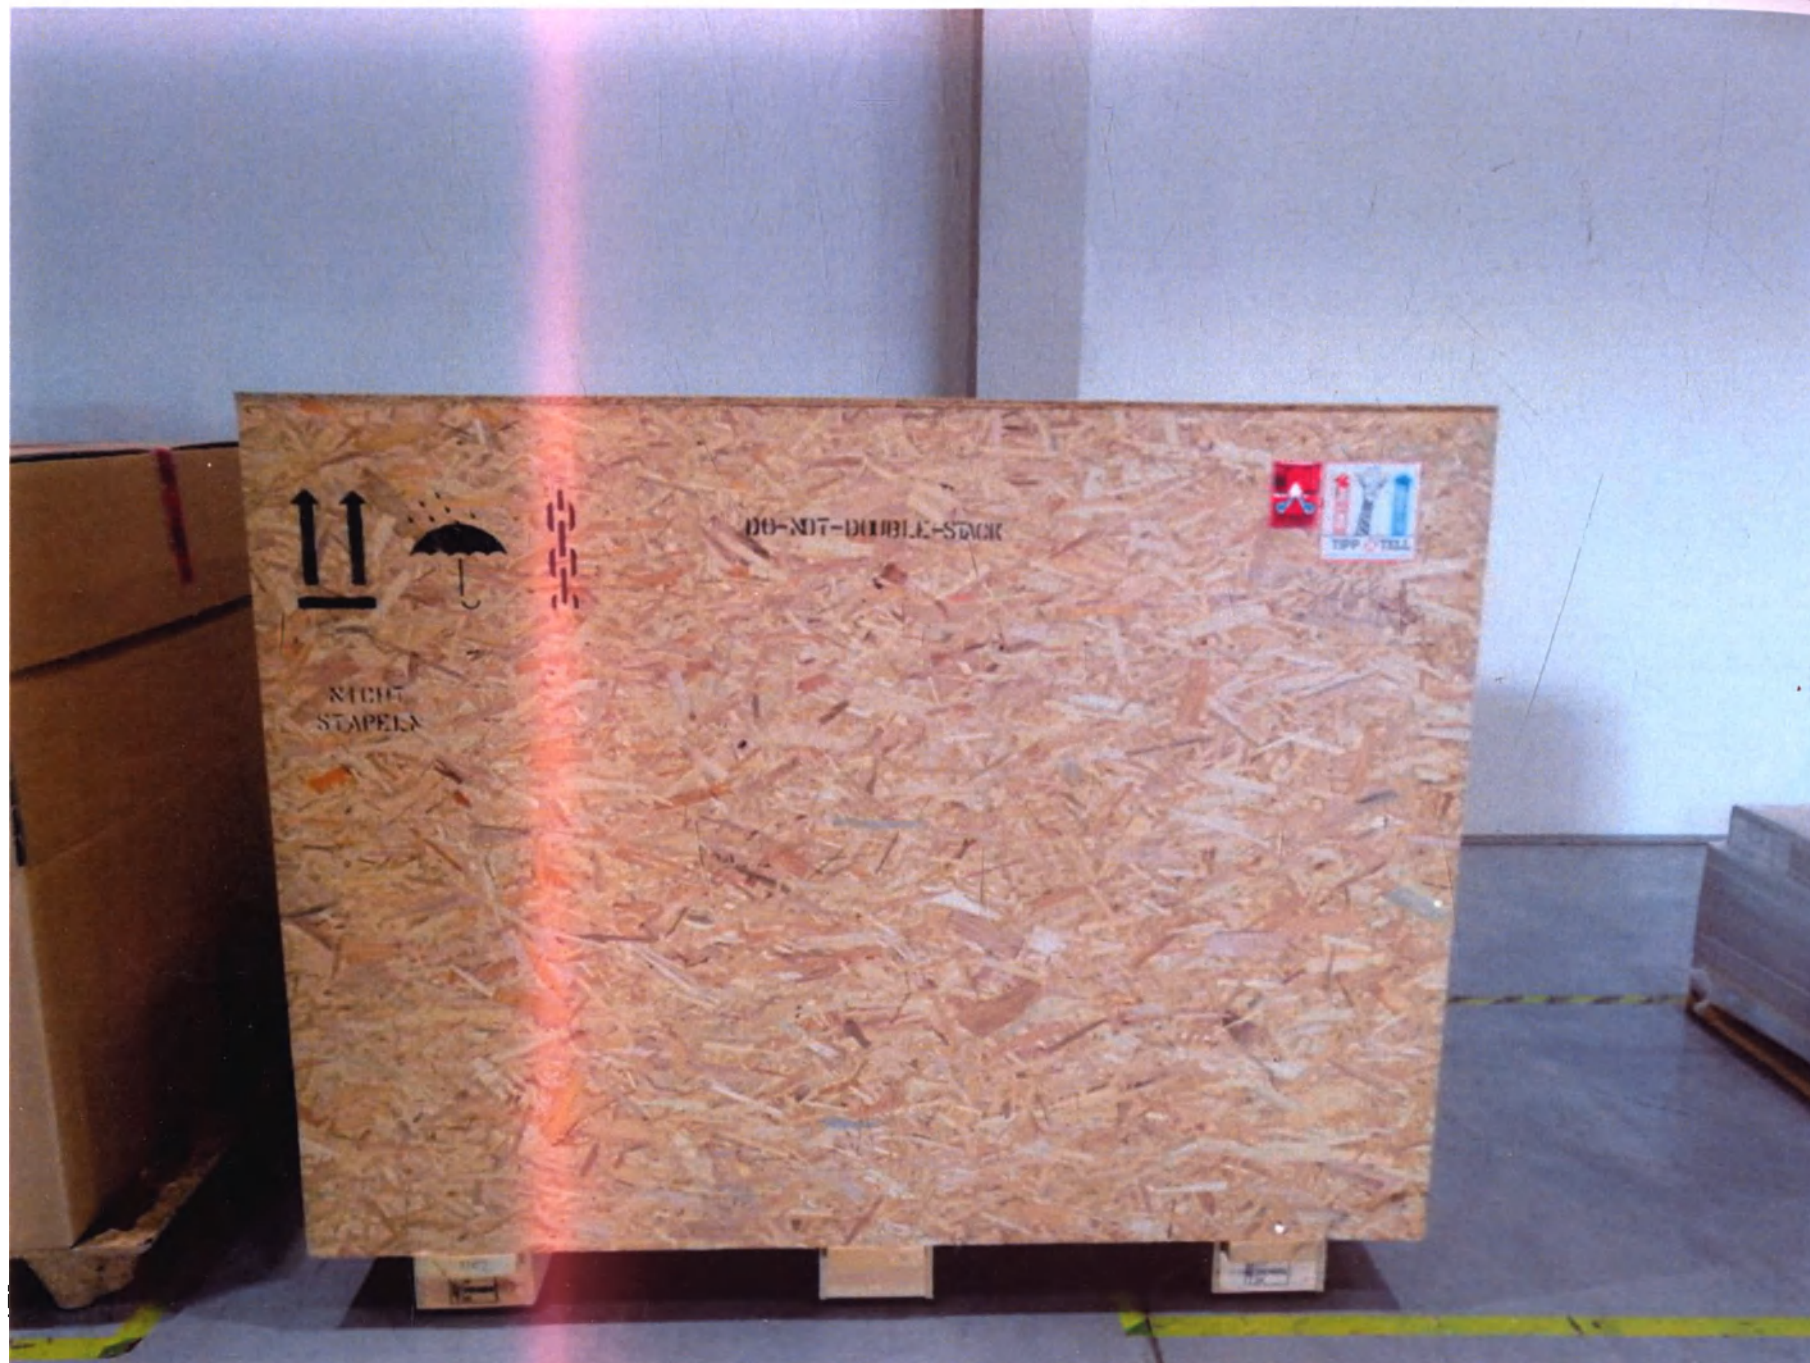

8. Фотографии транспортной упаковки изделия



9. Фотографии транспортной упаковки изделия

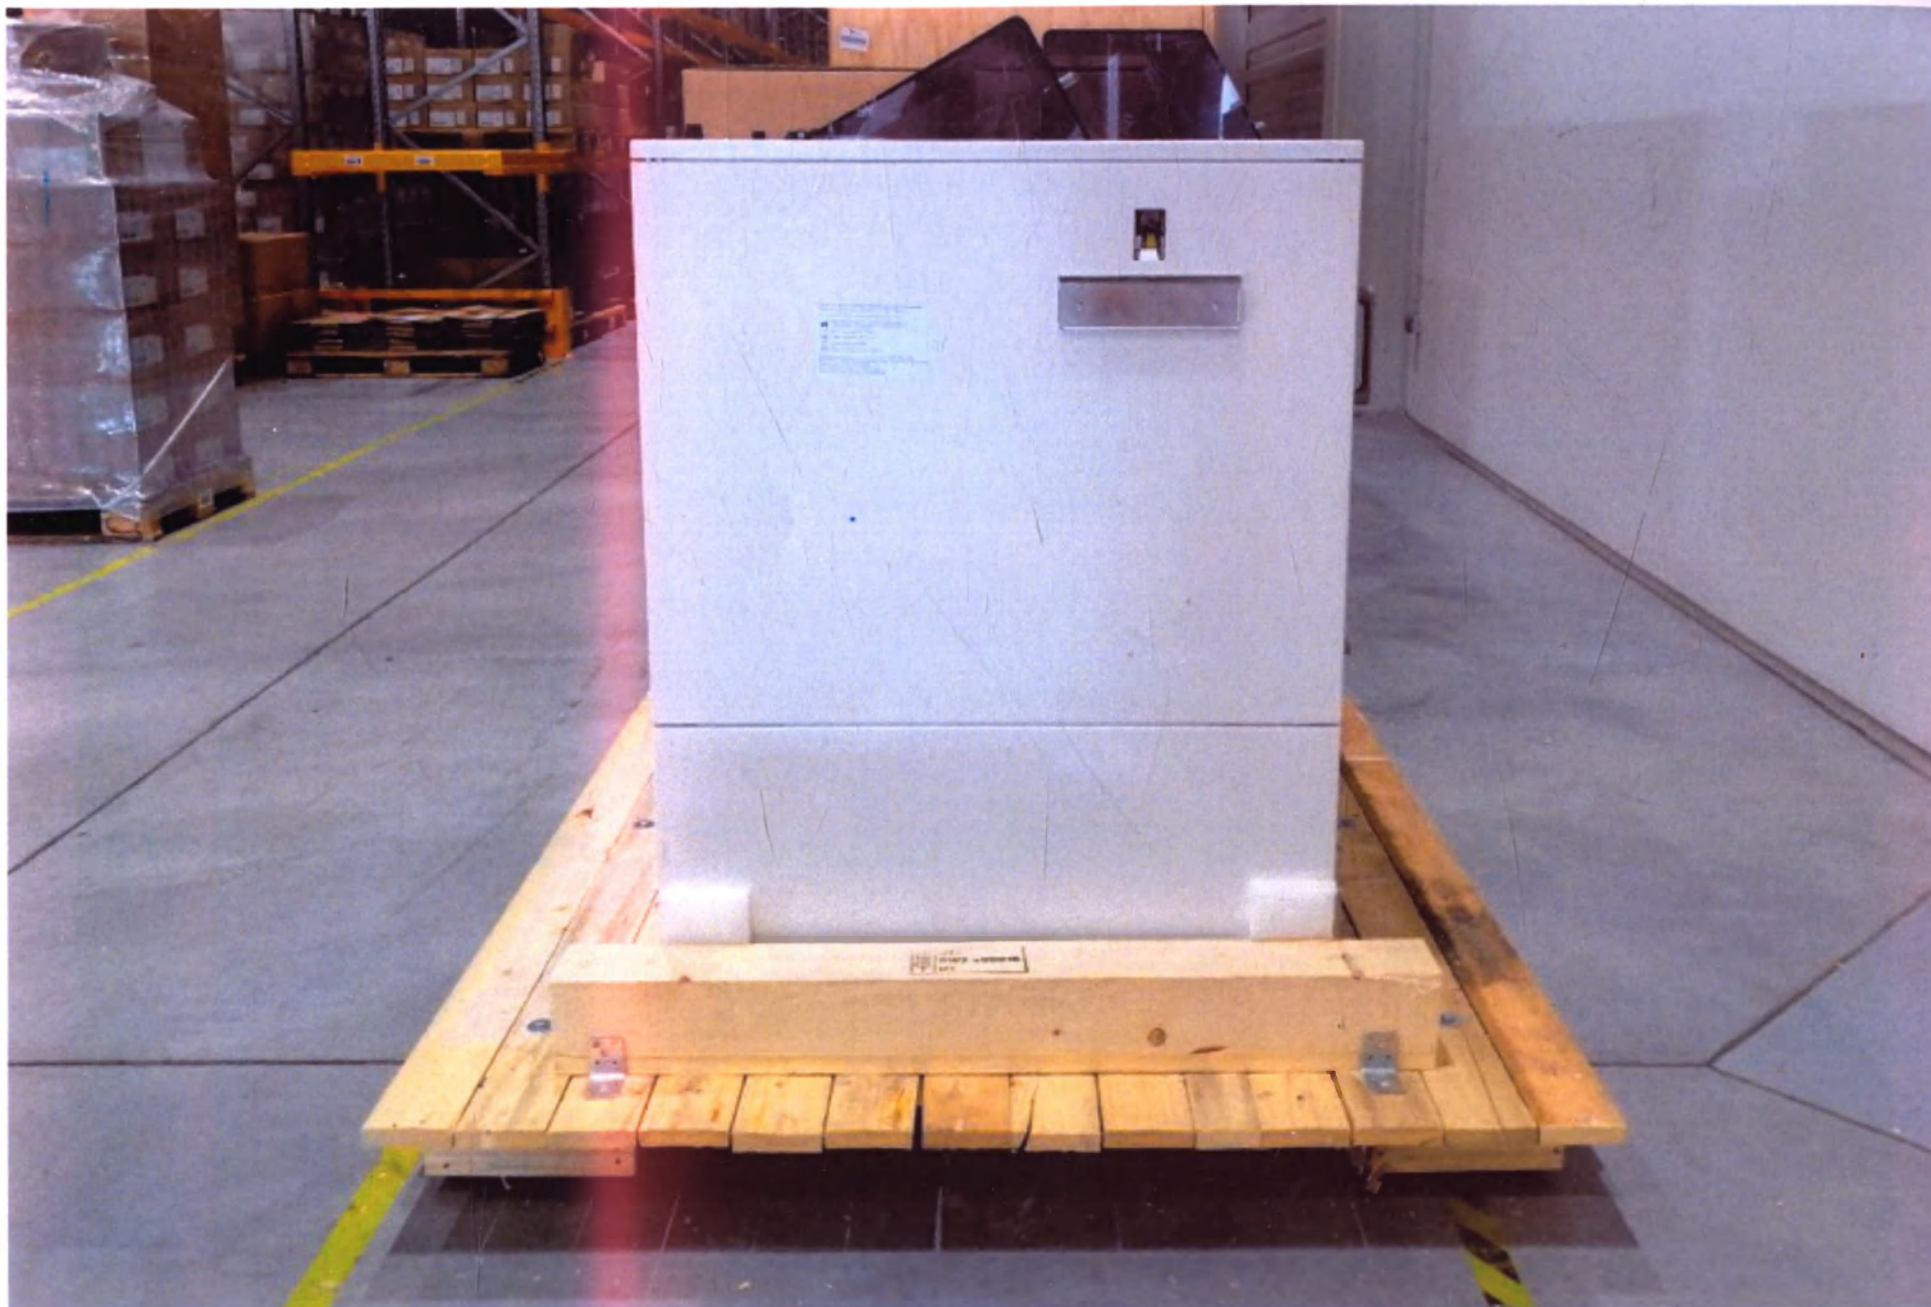

10. Общий вид изделия с маркировкой изделия.

Система автоматизированная загрузки россыпью и сортировки
образцов биологических материалов HCTS2000 MK2

АС ~ 110-230 В, 50/60 Гц, 100 ВА, Предохранители: Т 3,15 А



SARSTEDT AG & Co. KG / «САРШТЕДТ АГ и Ко. КГ»
Sarstedtstraße 1, 51588 Numbrecht, Germany (Германия)



Дата изготовления: XX / XXXX



Только для диагностики *in vitro*



Серийный номер: XXXXX



Номер по каталогу: XX.XXX.XXX

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Сарштедт»
Адрес: 198517, Россия, Санкт-Петербург, вн. тер. г. город Петергоф, ул. Новые
Заводы, д. 58, к. 4, стр. 1, помещ. 207

Тел. +7 495 937 52 28 Факс: +7 495 937 52 28

Адрес электронной почты: info.ru@sarstedt.com

Система автоматизированная загрузки россыпью и сортировки образцов биологических материалов HCTS2000 MK2

АС ~ 110-230 В, 50/60 Гц, 100 ВА, Предохранители: Т 3,15 А



SARSTEDT AG & Co. KG / «САРШТЕДТ АГ и Ко. КГ»
Sarstedtstraße 1, 51588 Numbrecht, Germany (Германия)



Дата изготовления: XX / XXXX



Только для диагностики *in vitro*



Серийный номер: XXXXX



Номер по каталогу: XX.XXX.XXX

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Сарштедт»


Адрес: 198517, Россия, Санкт-Петербург, вн. тер. г. город Петергоф, ул. Новые Заводы,
д. 58, к. 4, стр. 1, помещ. 207

Тел. +7 495 937 52 28 Факс: +7 495 937 52 28

Адрес электронной почты: info.ru@sarstedt.com

12. Макет маркировки изделия.

Руководство по эксплуатации

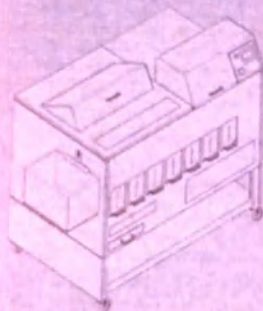

Руководство по эксплуатации
Система автоматизированная
загрузки, дозирования и
сортировки образцов
биологических материалов
HCTS2000 MK2, с
принадлежностями

Исходная версия: на
немецком языке, R6.1

Точные логистические решения для лаборатории

 **SARSTEDT**

Стр. 1

HCTS2000 MK2 / R 6.1

13. Руководство по эксплуатации.

и скреплено печатью

14 листа (-ов)

Генеральный директор

ООО «Сарштедт»

Белушин А.В.

