

Руководитель группы регистрации
ООО «Сименс Здоровоохранение»

«Сименс Н.А. Горшкова
«Сименс Здоровоохранение» 2021 г.



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO**

**« Набор реагентов для определения свободного трийодтиронина на анализаторах
иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Free Triiodothyronine (Atellica IM FT3))»**

производства «Сименс Хелскеа Диагностикс Инк.», Siemens Healthcare Diagnostics Inc., США

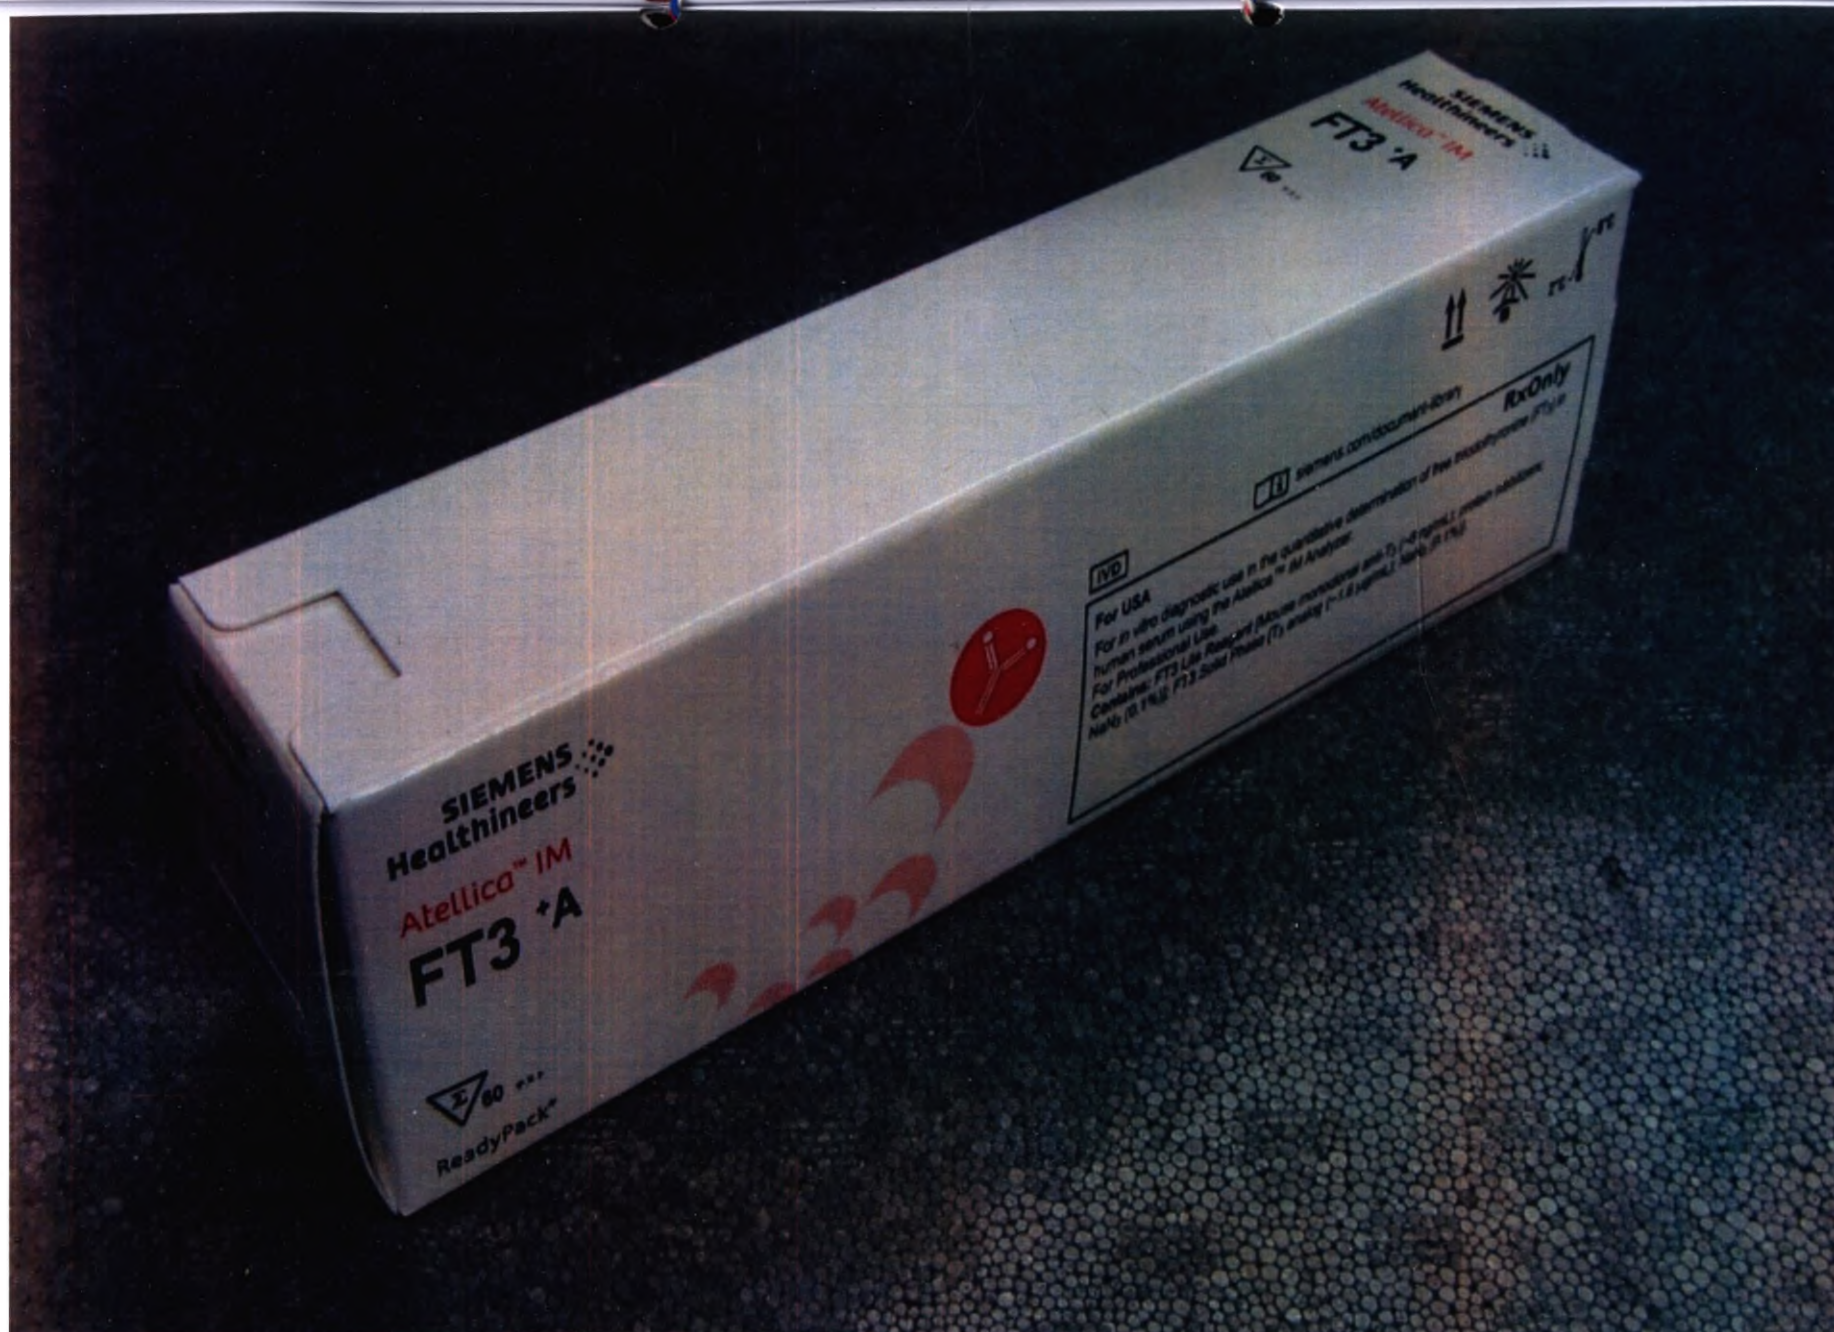


Рисунок 1. Набор реагентов для определения свободного трийодтиронина на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Free Triiodothyronine (Atellica IM FT3)), Фасовка 60 тестов. Общий вид

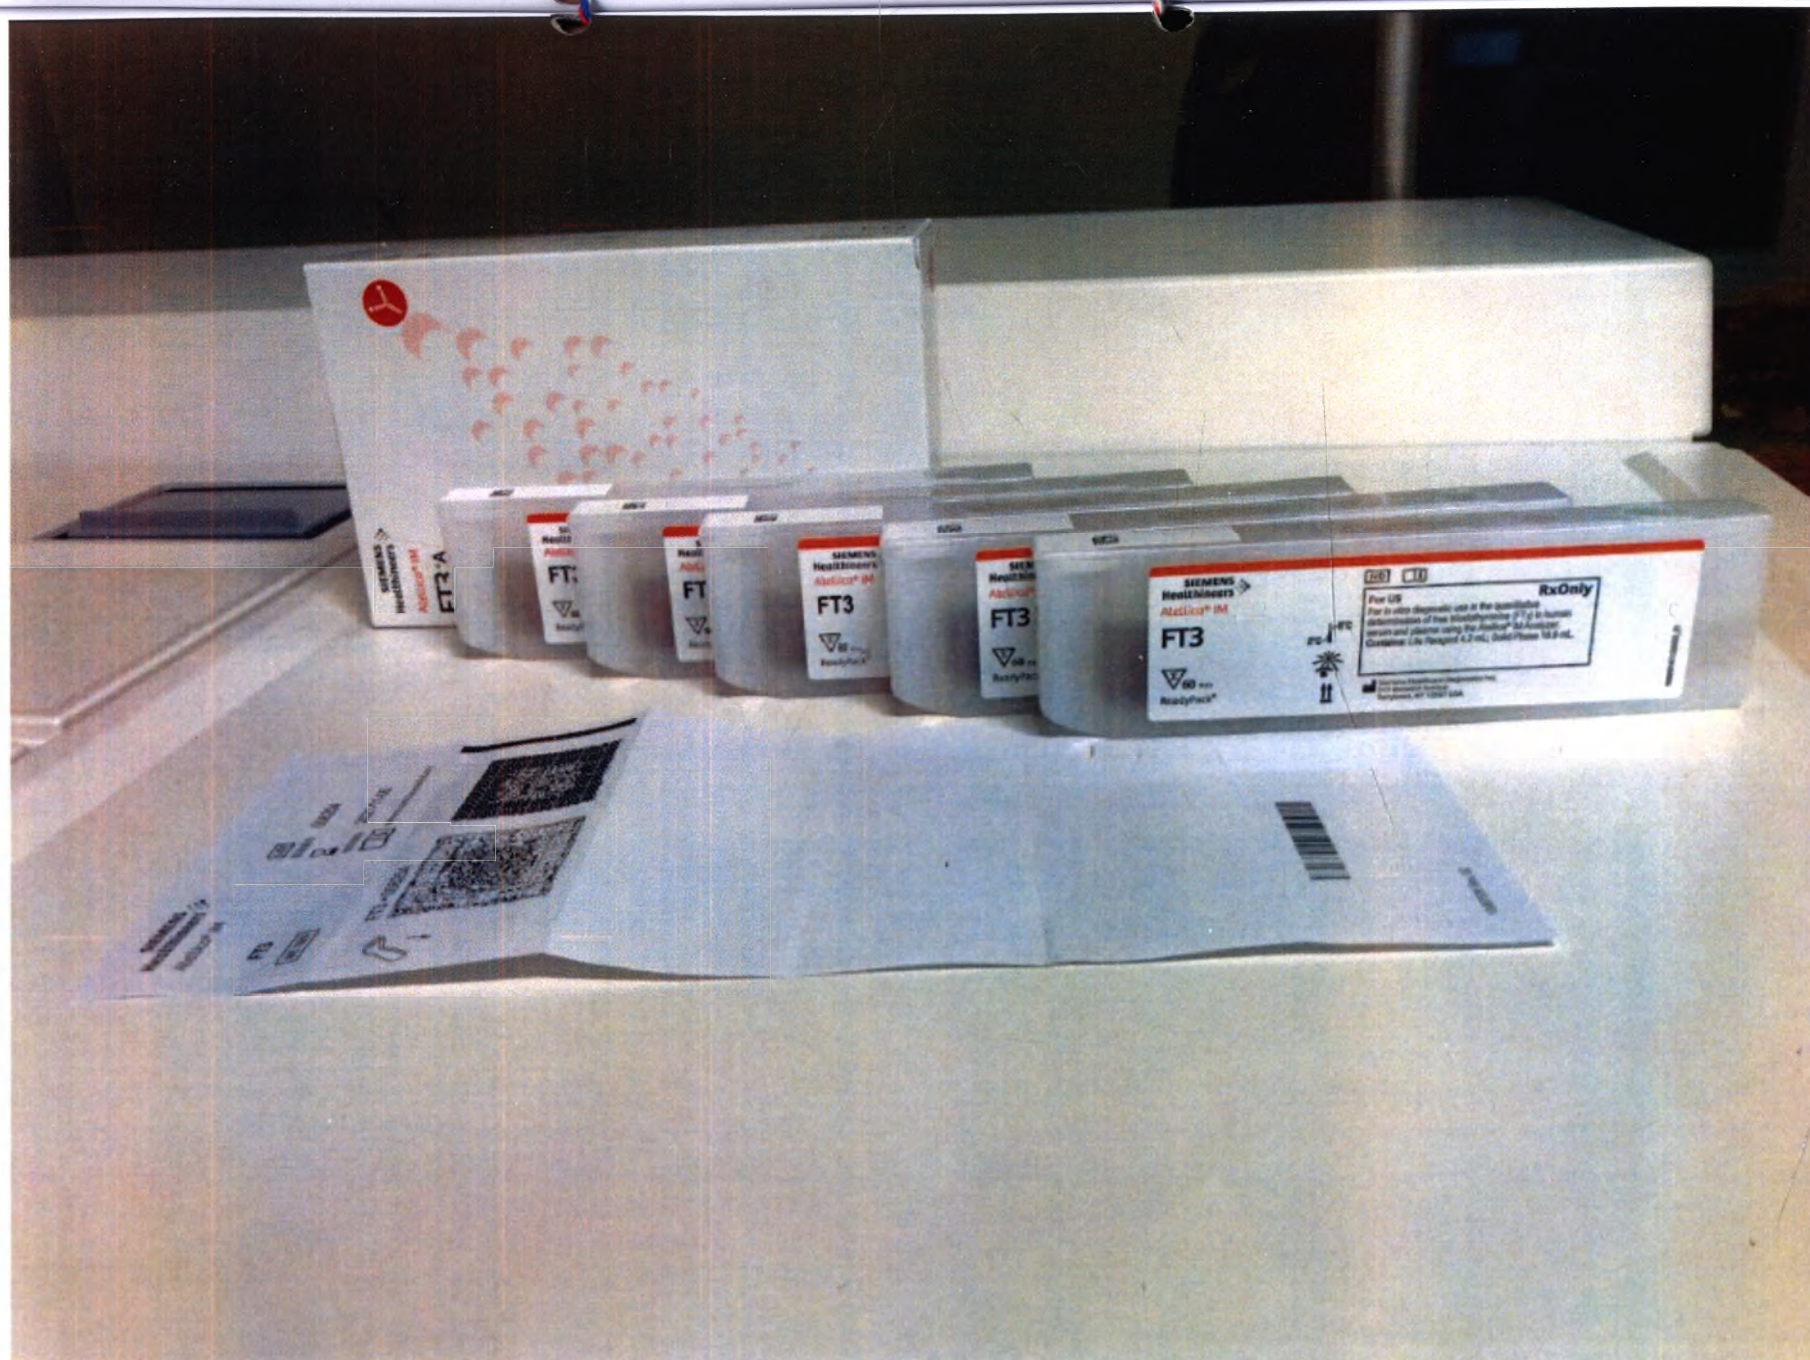


Рисунок 2. Набор реагентов для определения свободного трийодтиронина на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Free Triiodothyronine (Atellica IM

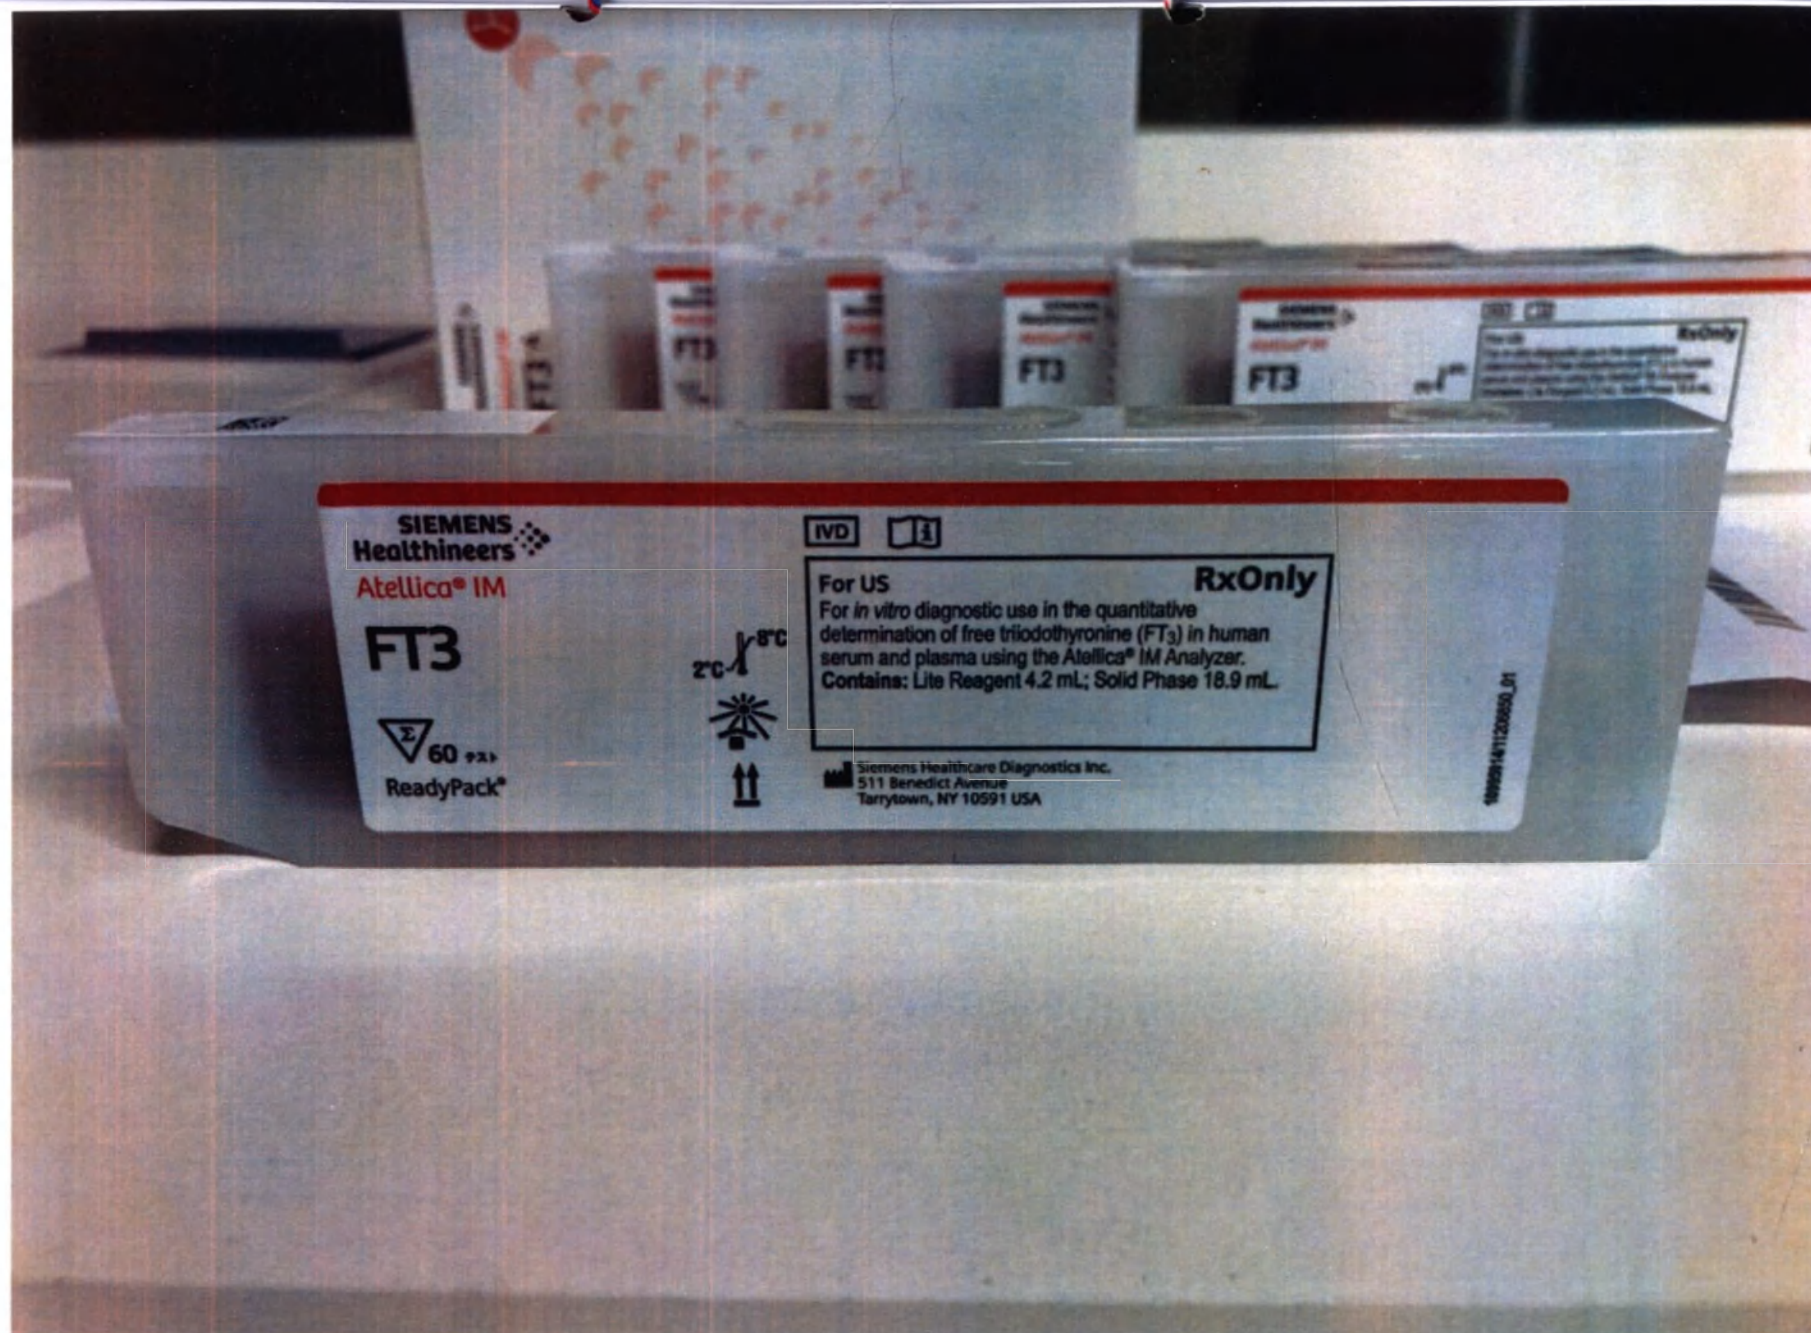


Рисунок 3. Набор реагентов для определения свободного трийодтиронина на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Free Triiodothyronine (Atellica IM FT3)): Первичный реагент Atellica IM FT3

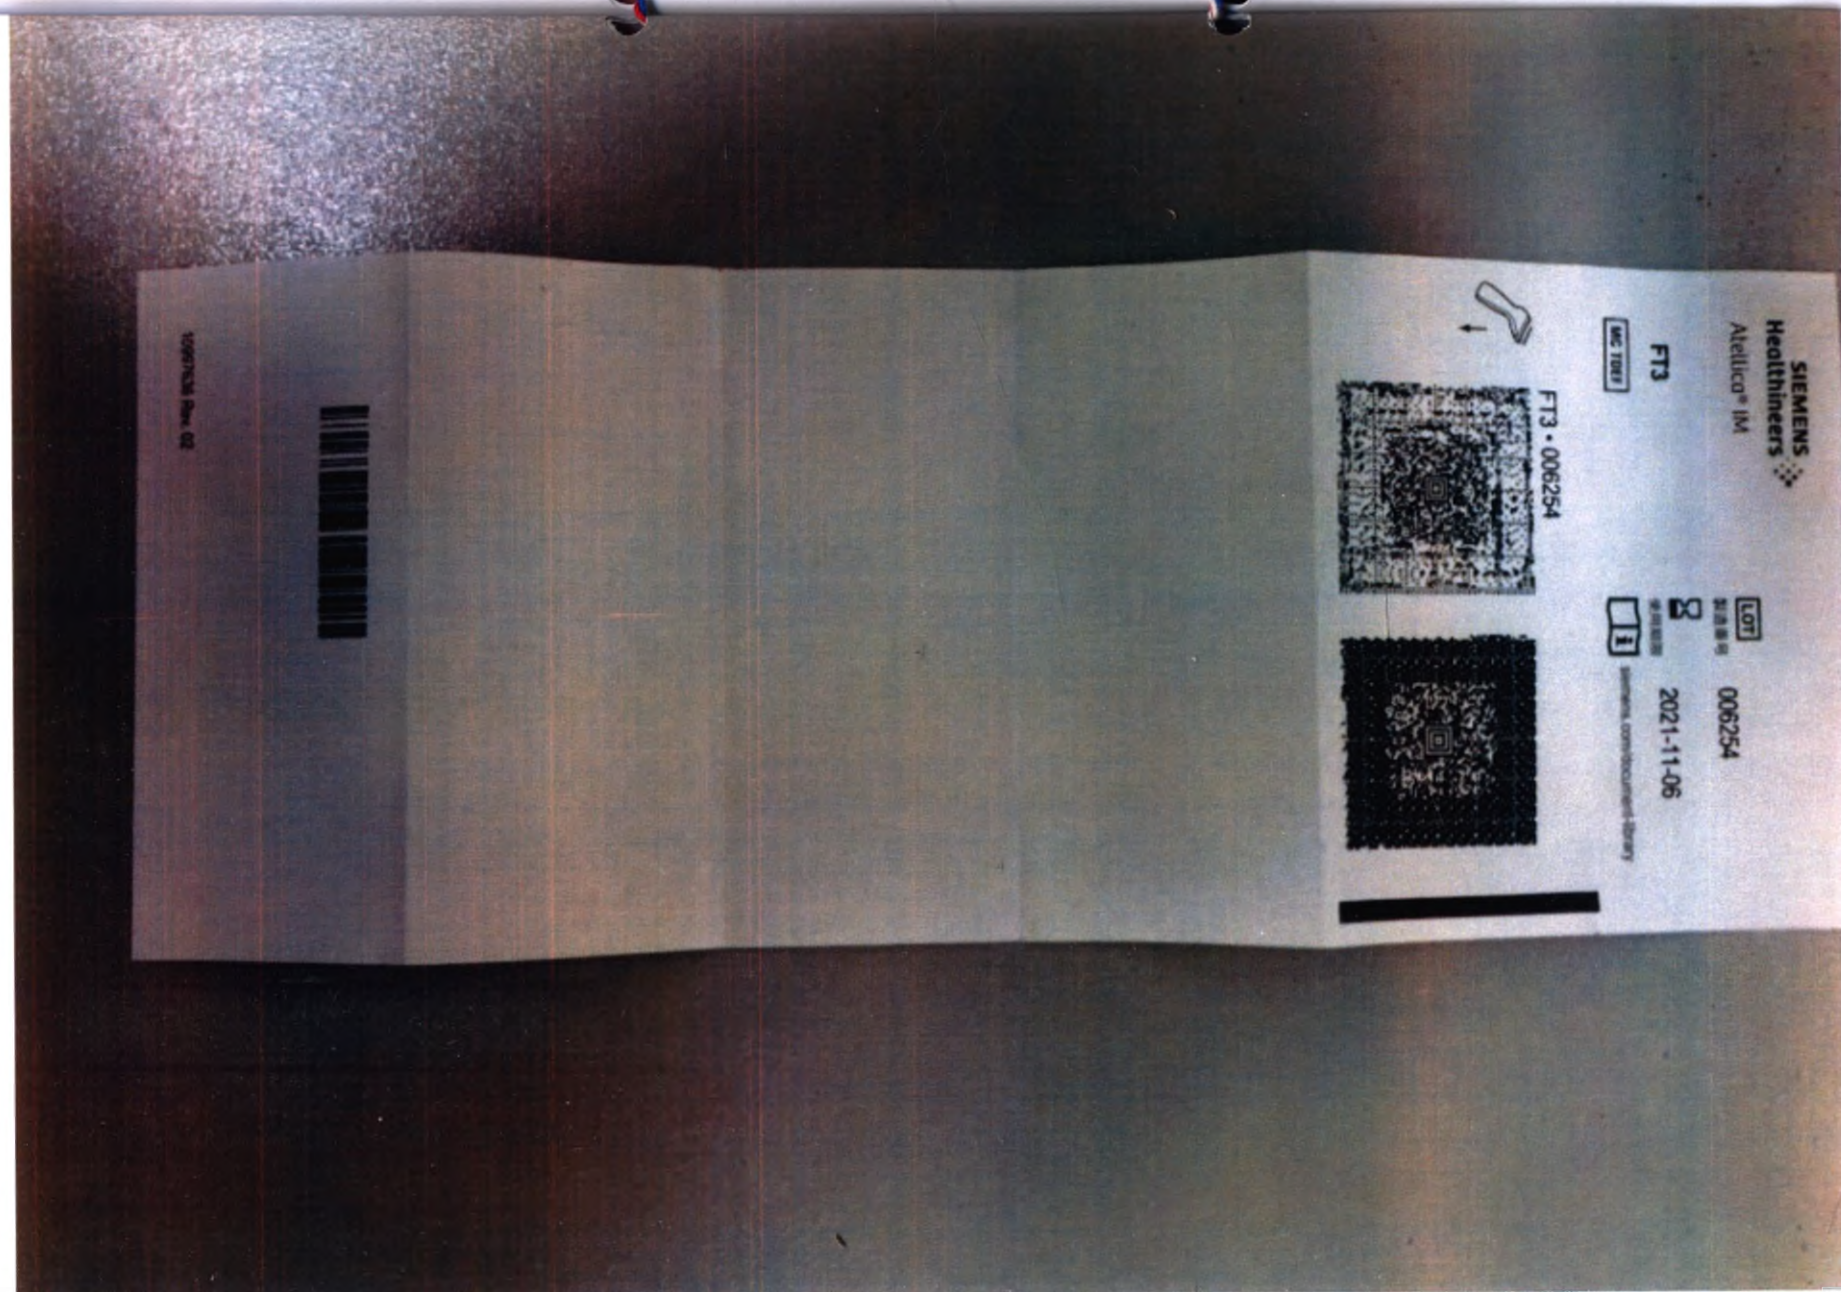


Рисунок 4. Набор реагентов для определения свободного трийодтиронина на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Free Triiodothyronine (Atellica IM FT3)): Вкладыш со штрих-кодом MC TDEF для Atellica IM FT3

10995584 Набор реагентов для определения свободного трийодтиронина на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Free Трийодтиронин (Atellica IM FT3))

Информация о производителе и стране происхождения см. на упаковке

Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/12502 от 11.11.2020

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO
Код партии, срок годности, условия хранения и др. символы указаны на оригинальной упаковке

Инструкция по применению на русском языке Rev. 01

Состав: указан на оригинальной упаковке и в инструкции по применению
Авторизованный представитель изготовителя на территории Российской Федерации:
ООО «Симанс Здоровоохранение», 115093, Москва, ул. Дубининская, 96

Рисунок 6. Русскоязычная маркировка для Набор реагентов для определения свободного трийодтиронина на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Free Triiodothyronine (Atellica IM FT3));



Всего прошито и пронумеровано
листа (ов).

ООО «Сиенс Здравоохранение»

