



«УТВЕРЖДАЮ»

Менеджер по регистрации

медицинских изделий

АО «БАЙЕР»

Тихонова М.А.

«13» апреля 2023 г.



//////////

АО «БАЙЕР»


107113, Россия, Москва
ул. 3-я Рыбинская д.18, стр.2

Тел.: (495) 234 20 00


www.bayer.ru

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ


Система инъекционная для КТ MEDRAD Stellant D
с рабочей станцией Certegra

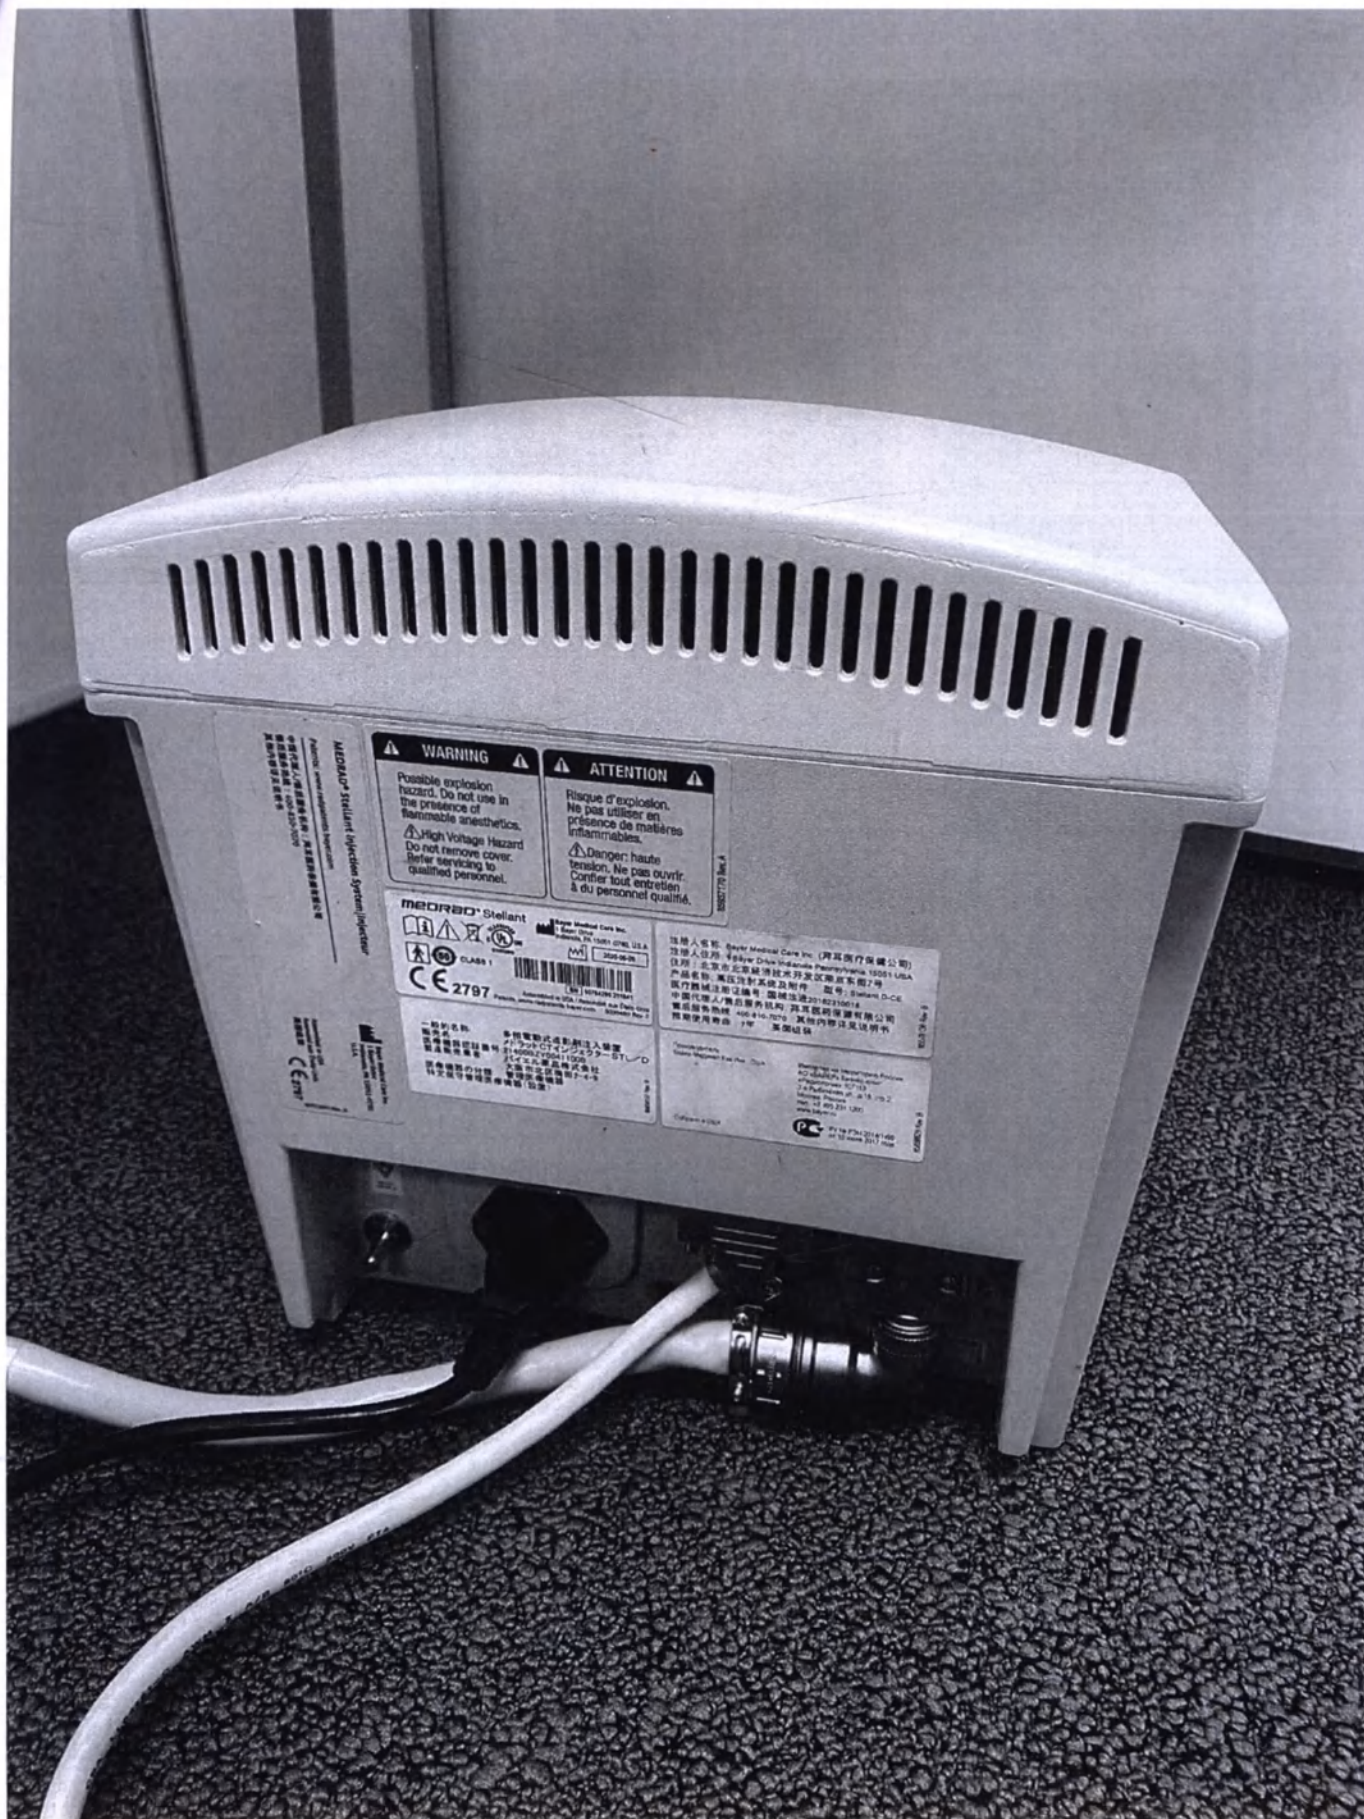

Основной модуль

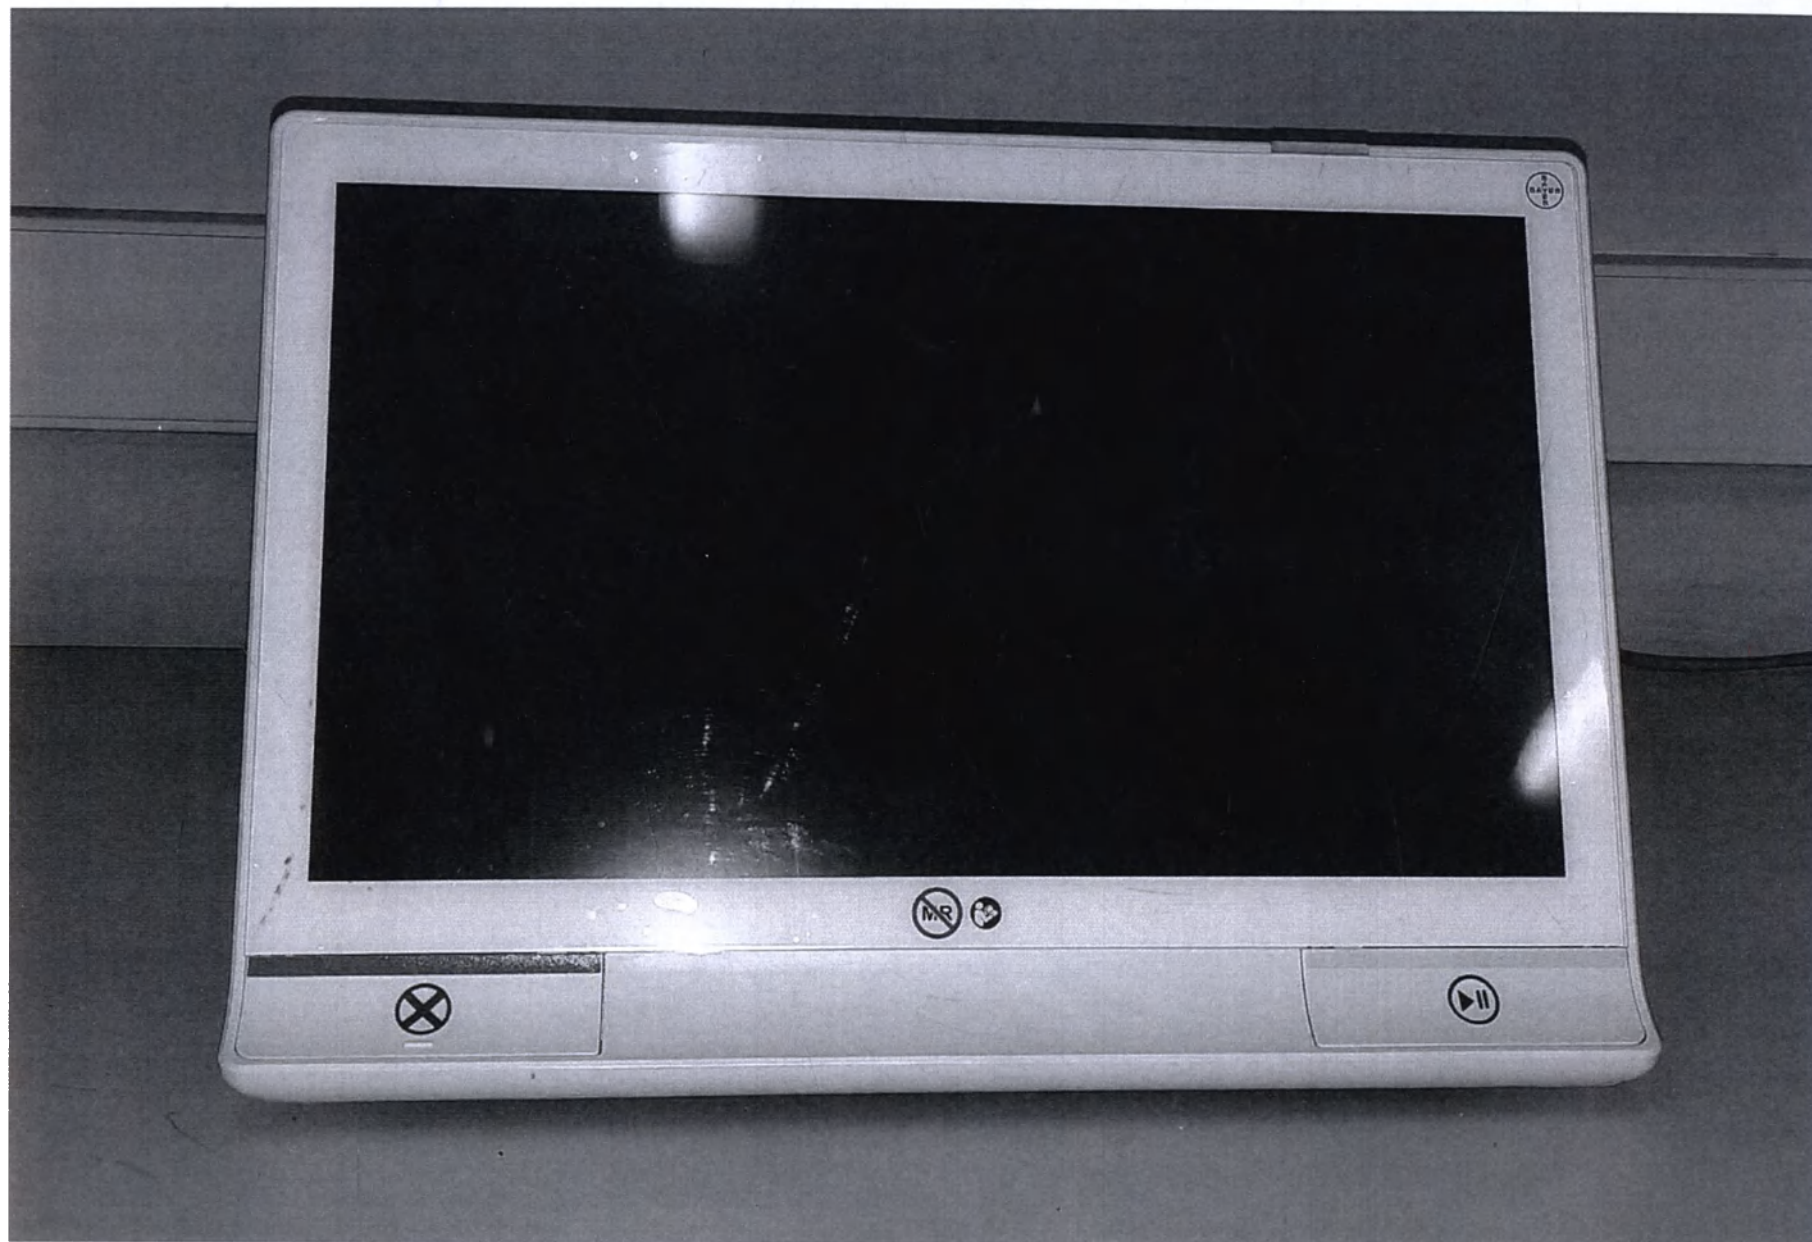


Рабочая станция Certegra

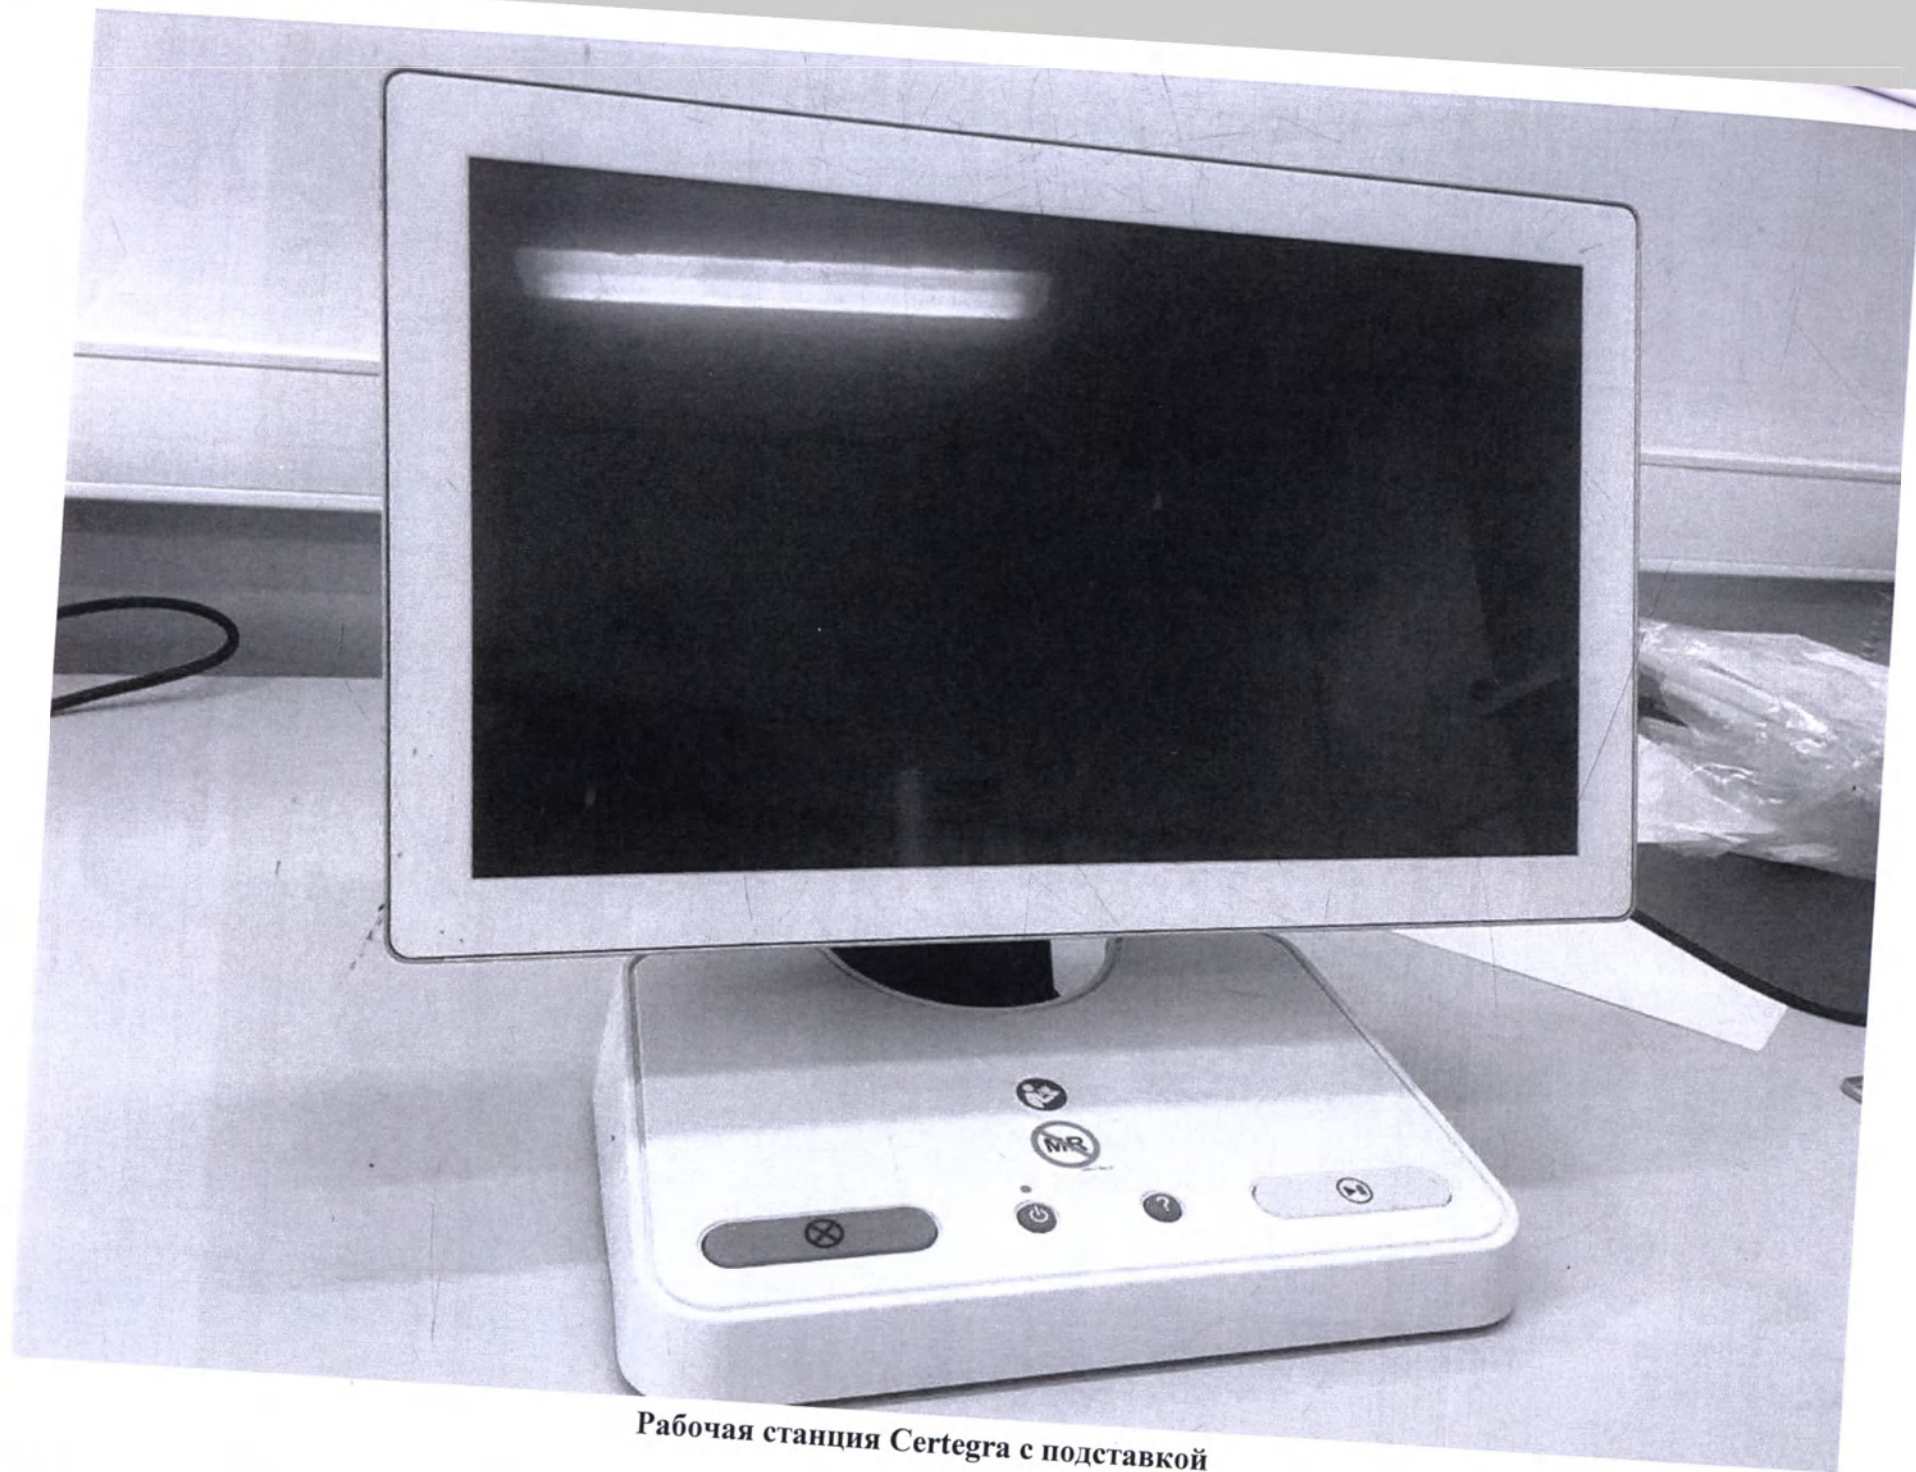

Рабочая станция Certegra с подставкой




Головка инъектора

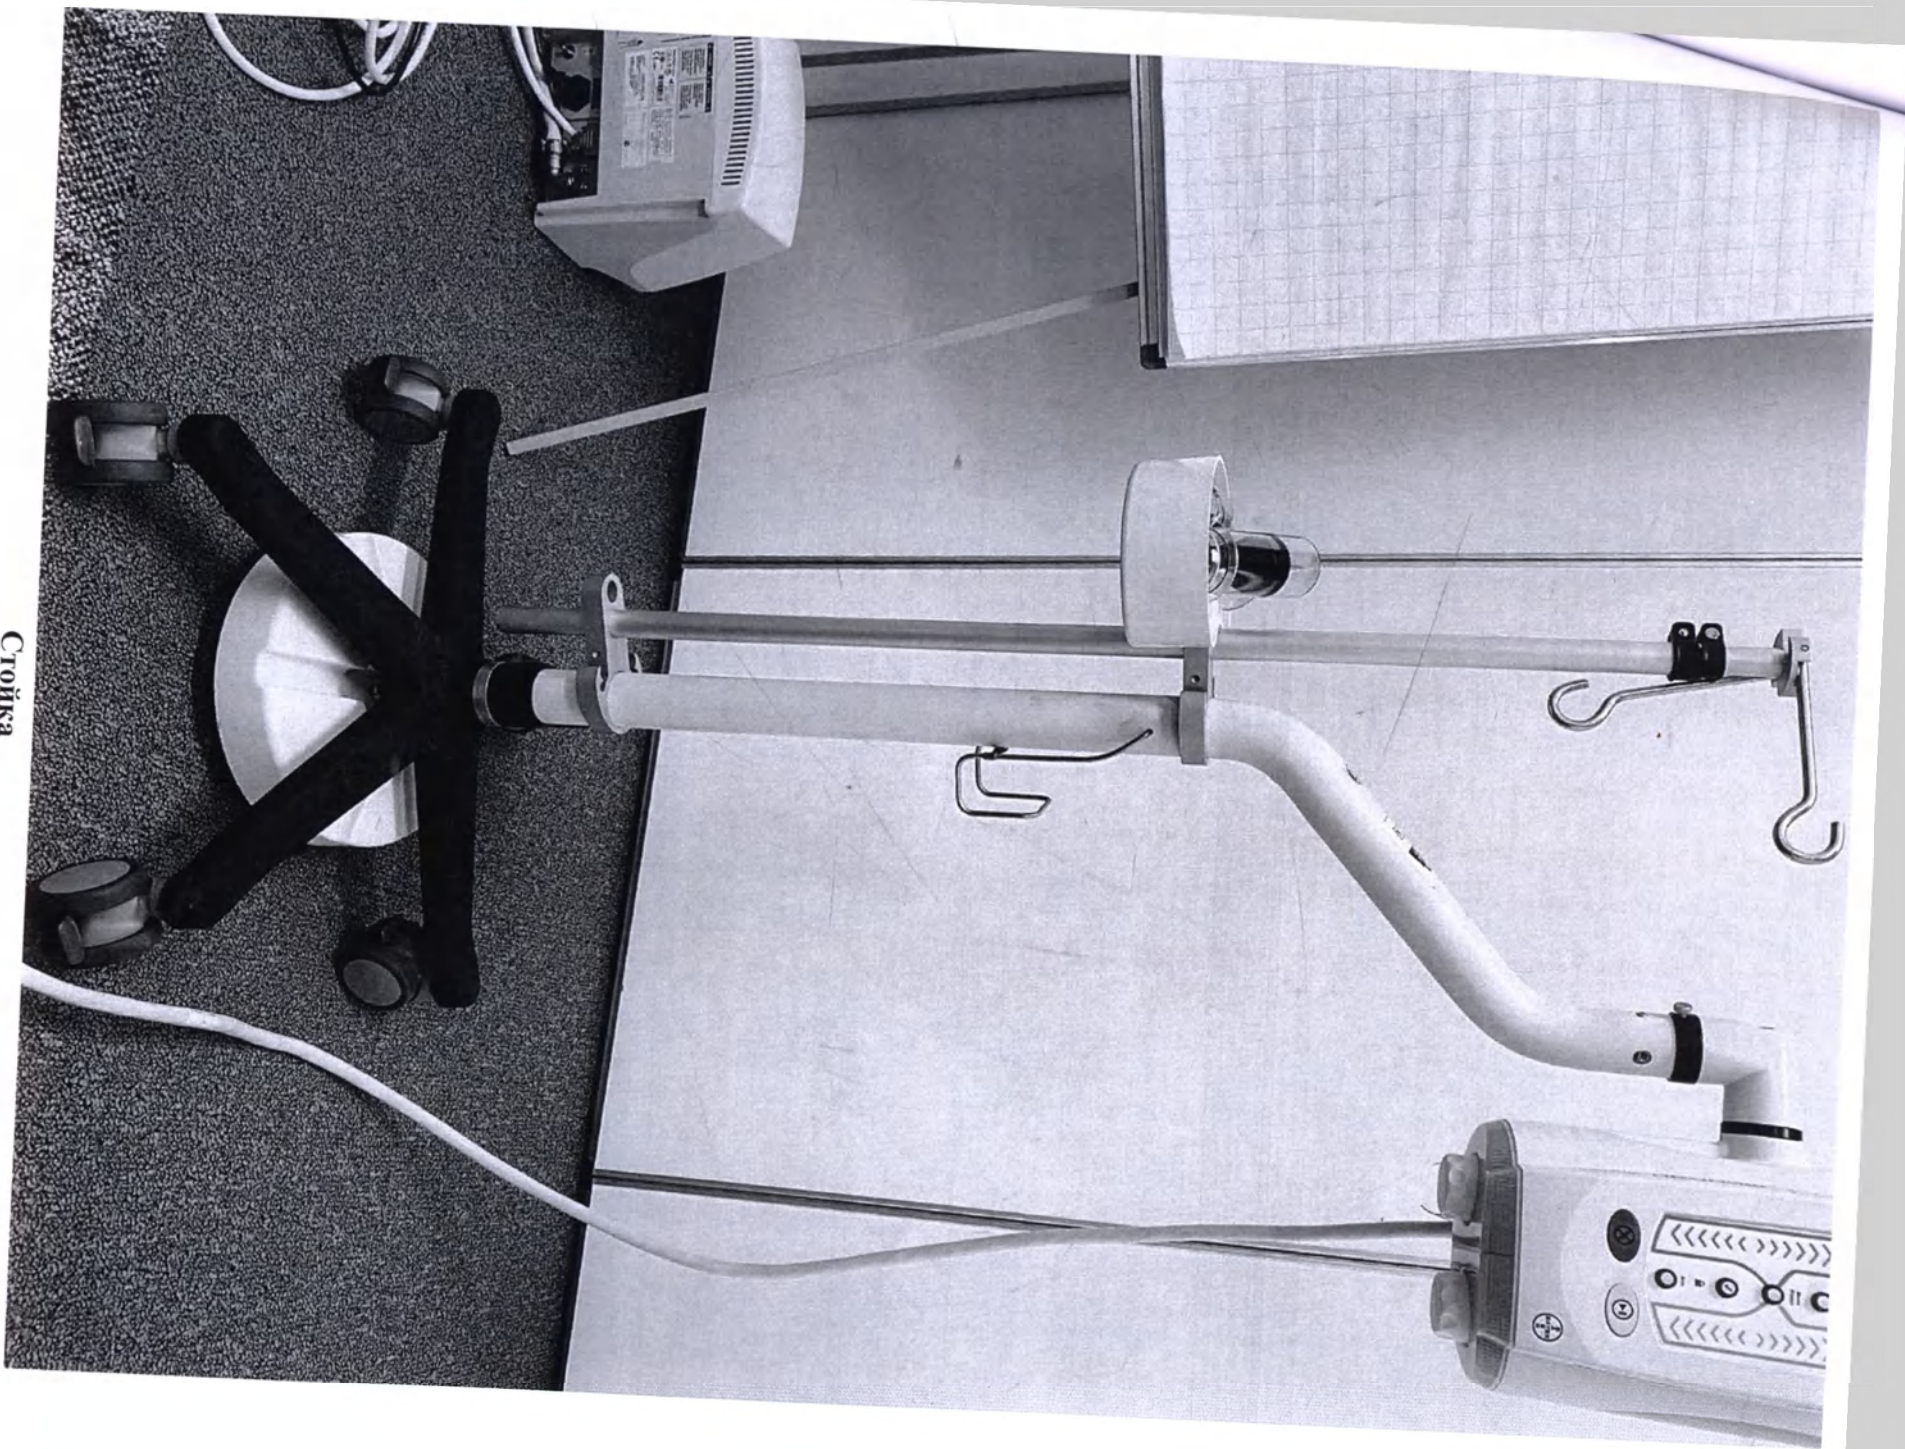


Стійка



Кабель питания

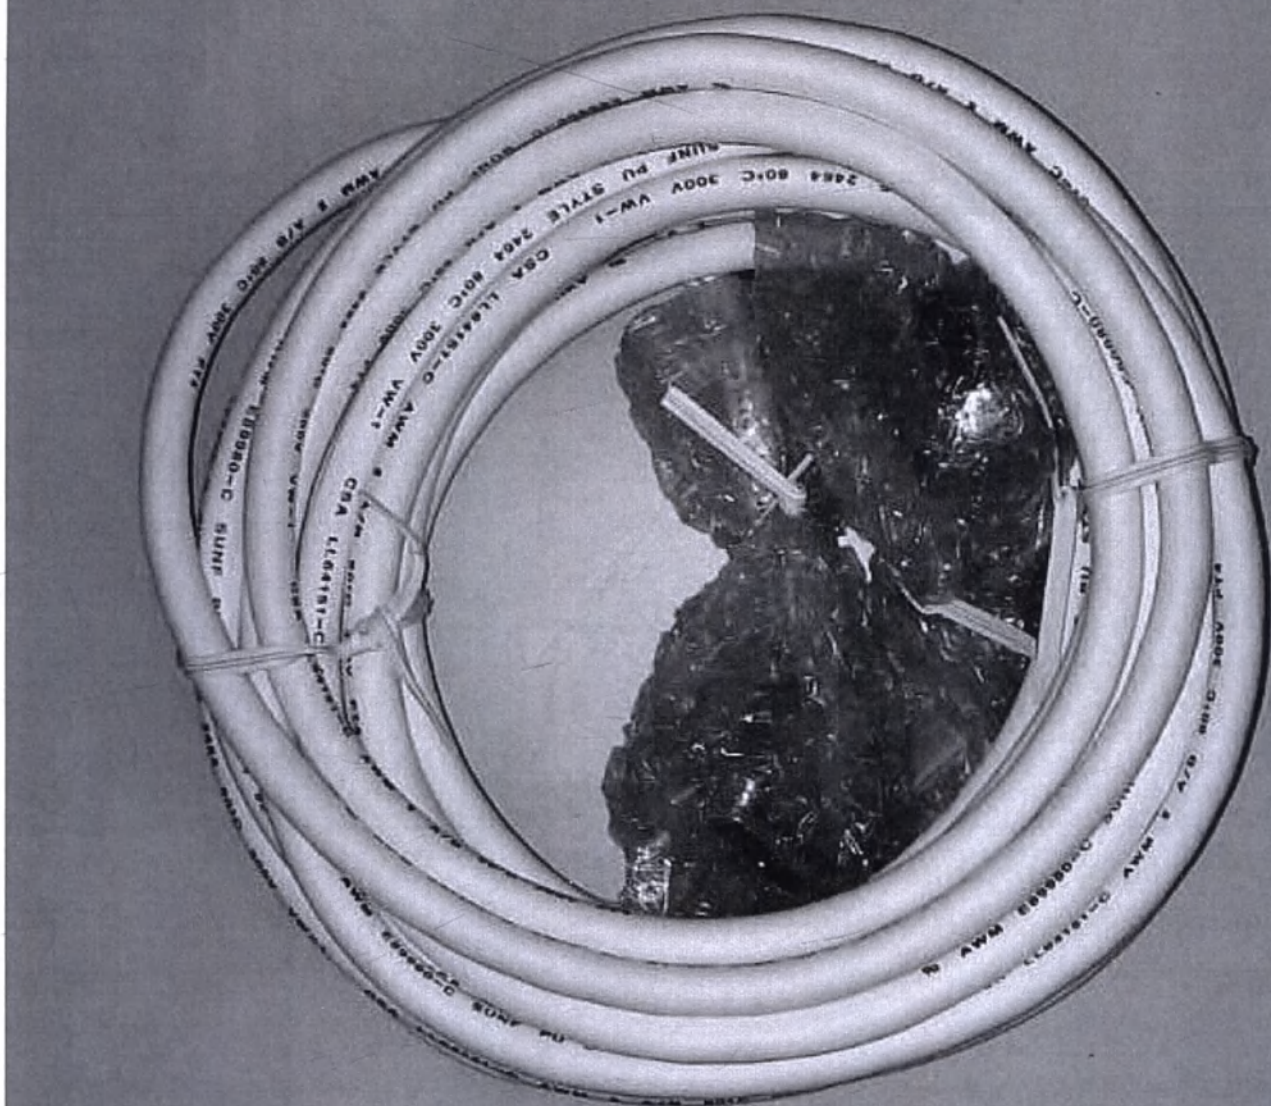

Кабель модуля управления и контроля 7,6 м (25 футов)

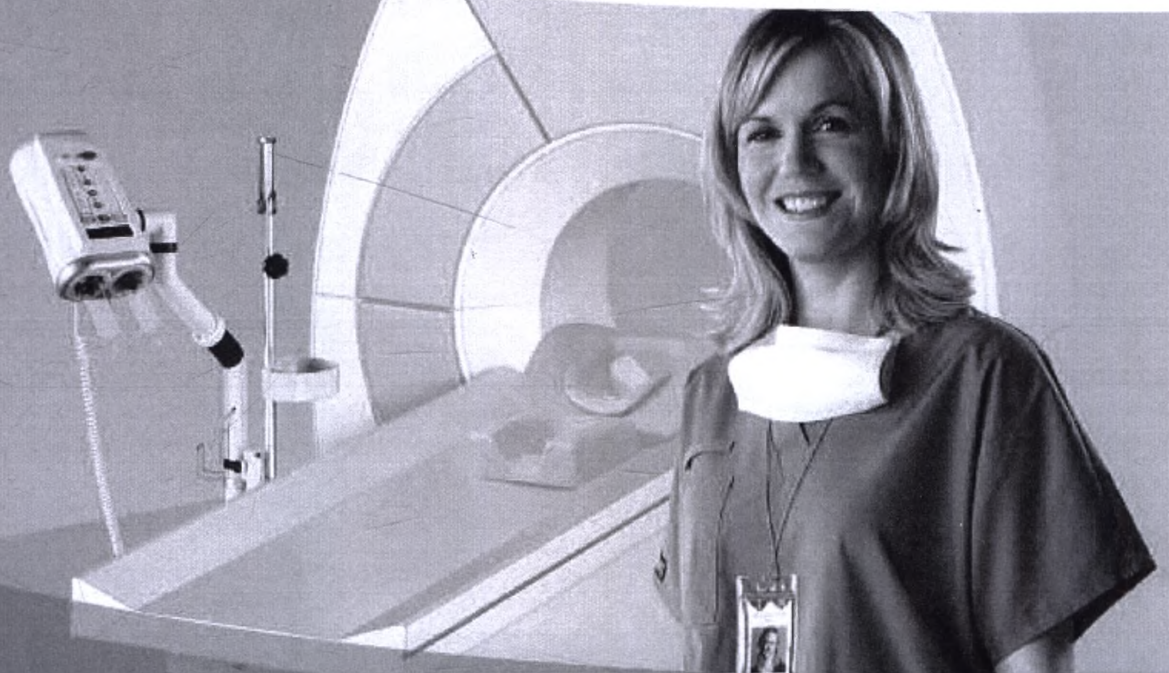

Руководство по эксплуатации

Система инъекционная для КТ
MEDRAD® Stellant D с рабочей станцией
Certegra™

Certegra™
Point of Care

MEDRAD® Stellant
CT Injection System

Руководство по эксплуатации

ATTENTION DEPARTMENT MANAGER

CONTAINS
IMPORTANT LITERATURE
AND WARRANTY INFORMATION

Contains Assembly Number:

☐ 60720418

☐ 60720426

☐ 60728125

☐ 3002451


☐ 60727609

☐ 3006982


☐ 3009822

☒ 60728044


Информационный пакет документов

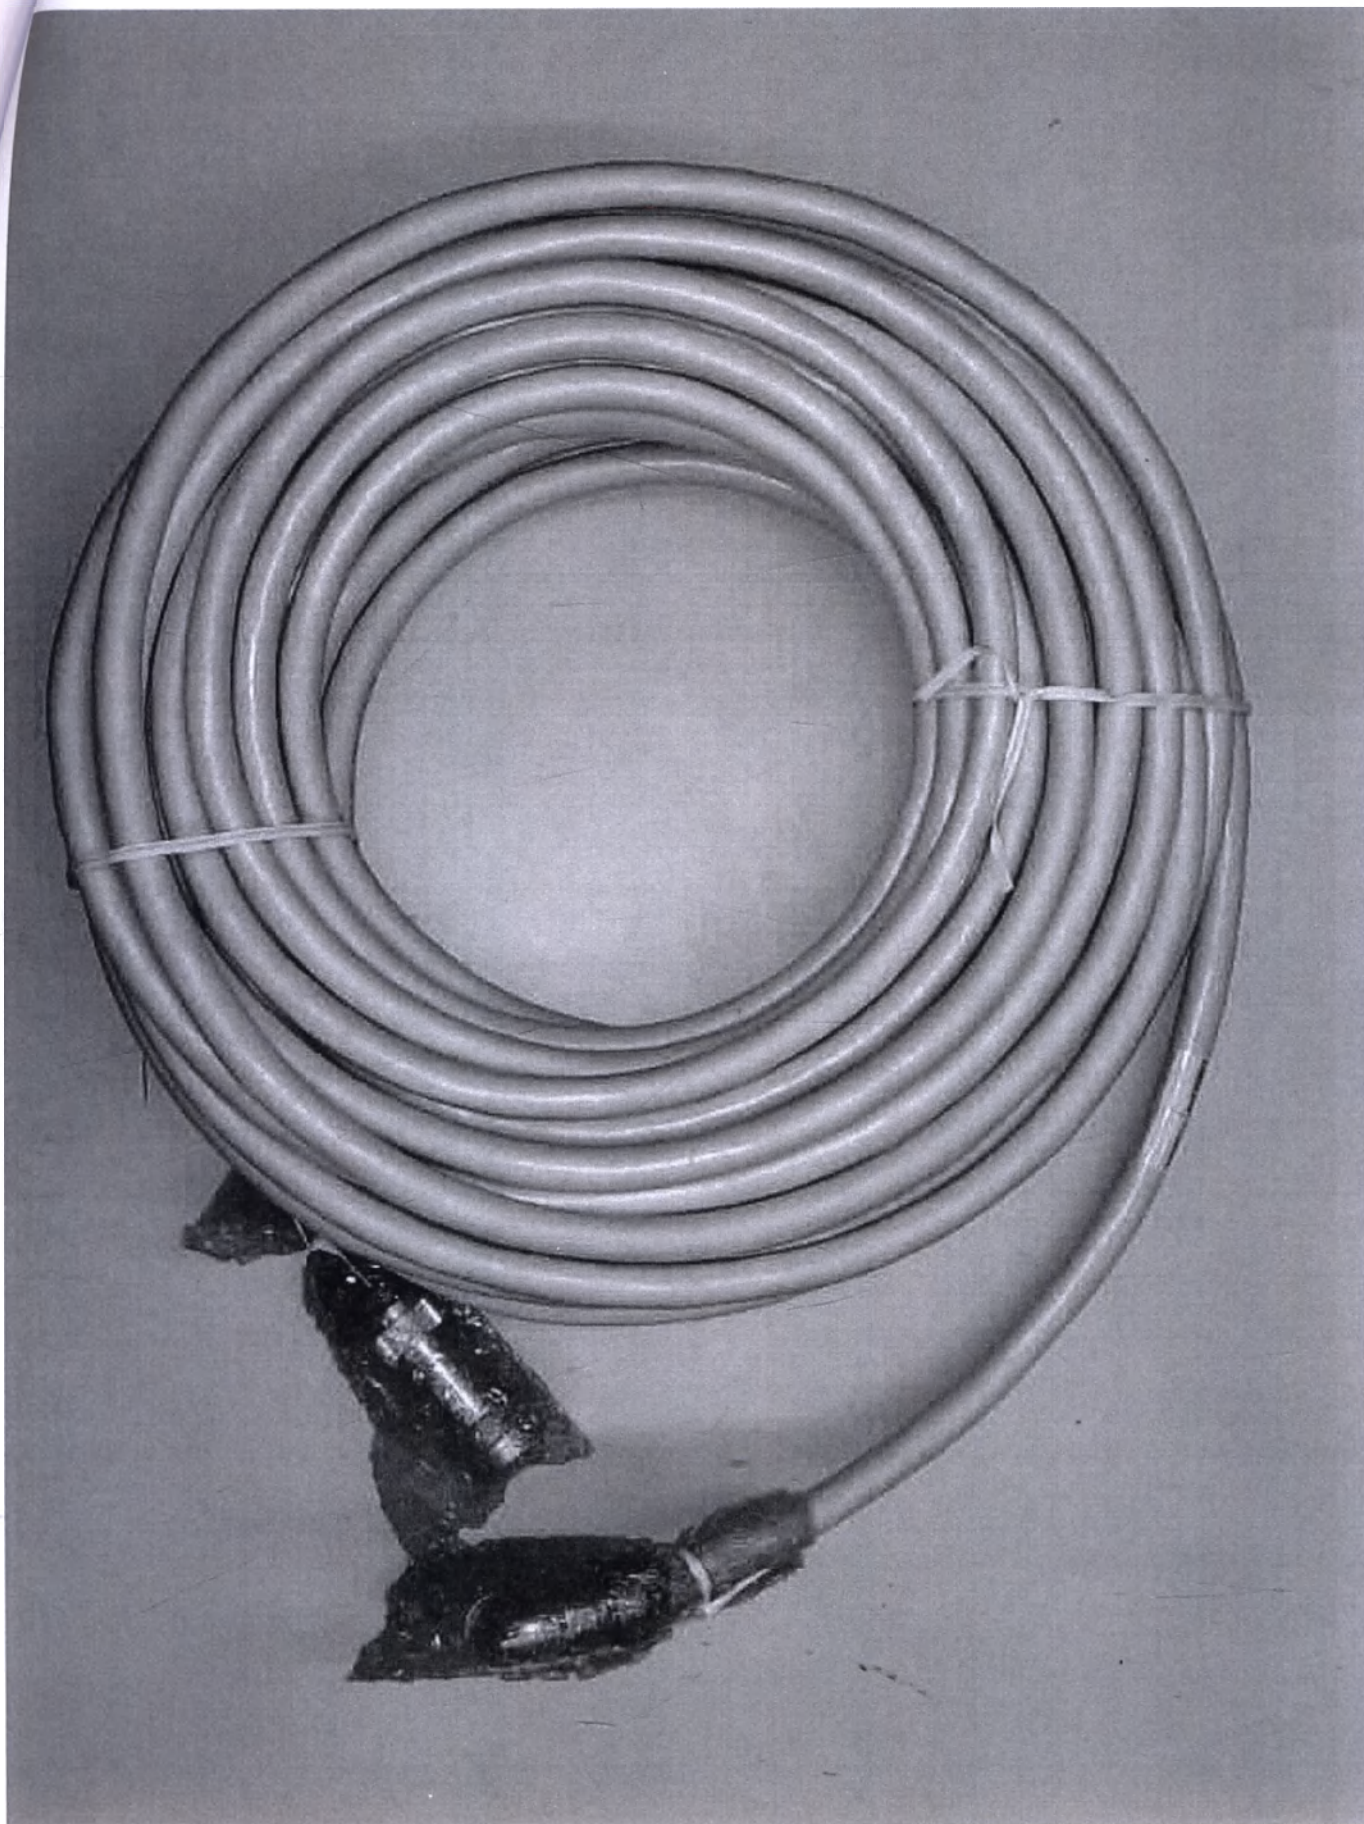

Кабель удлинительный головки иньектора

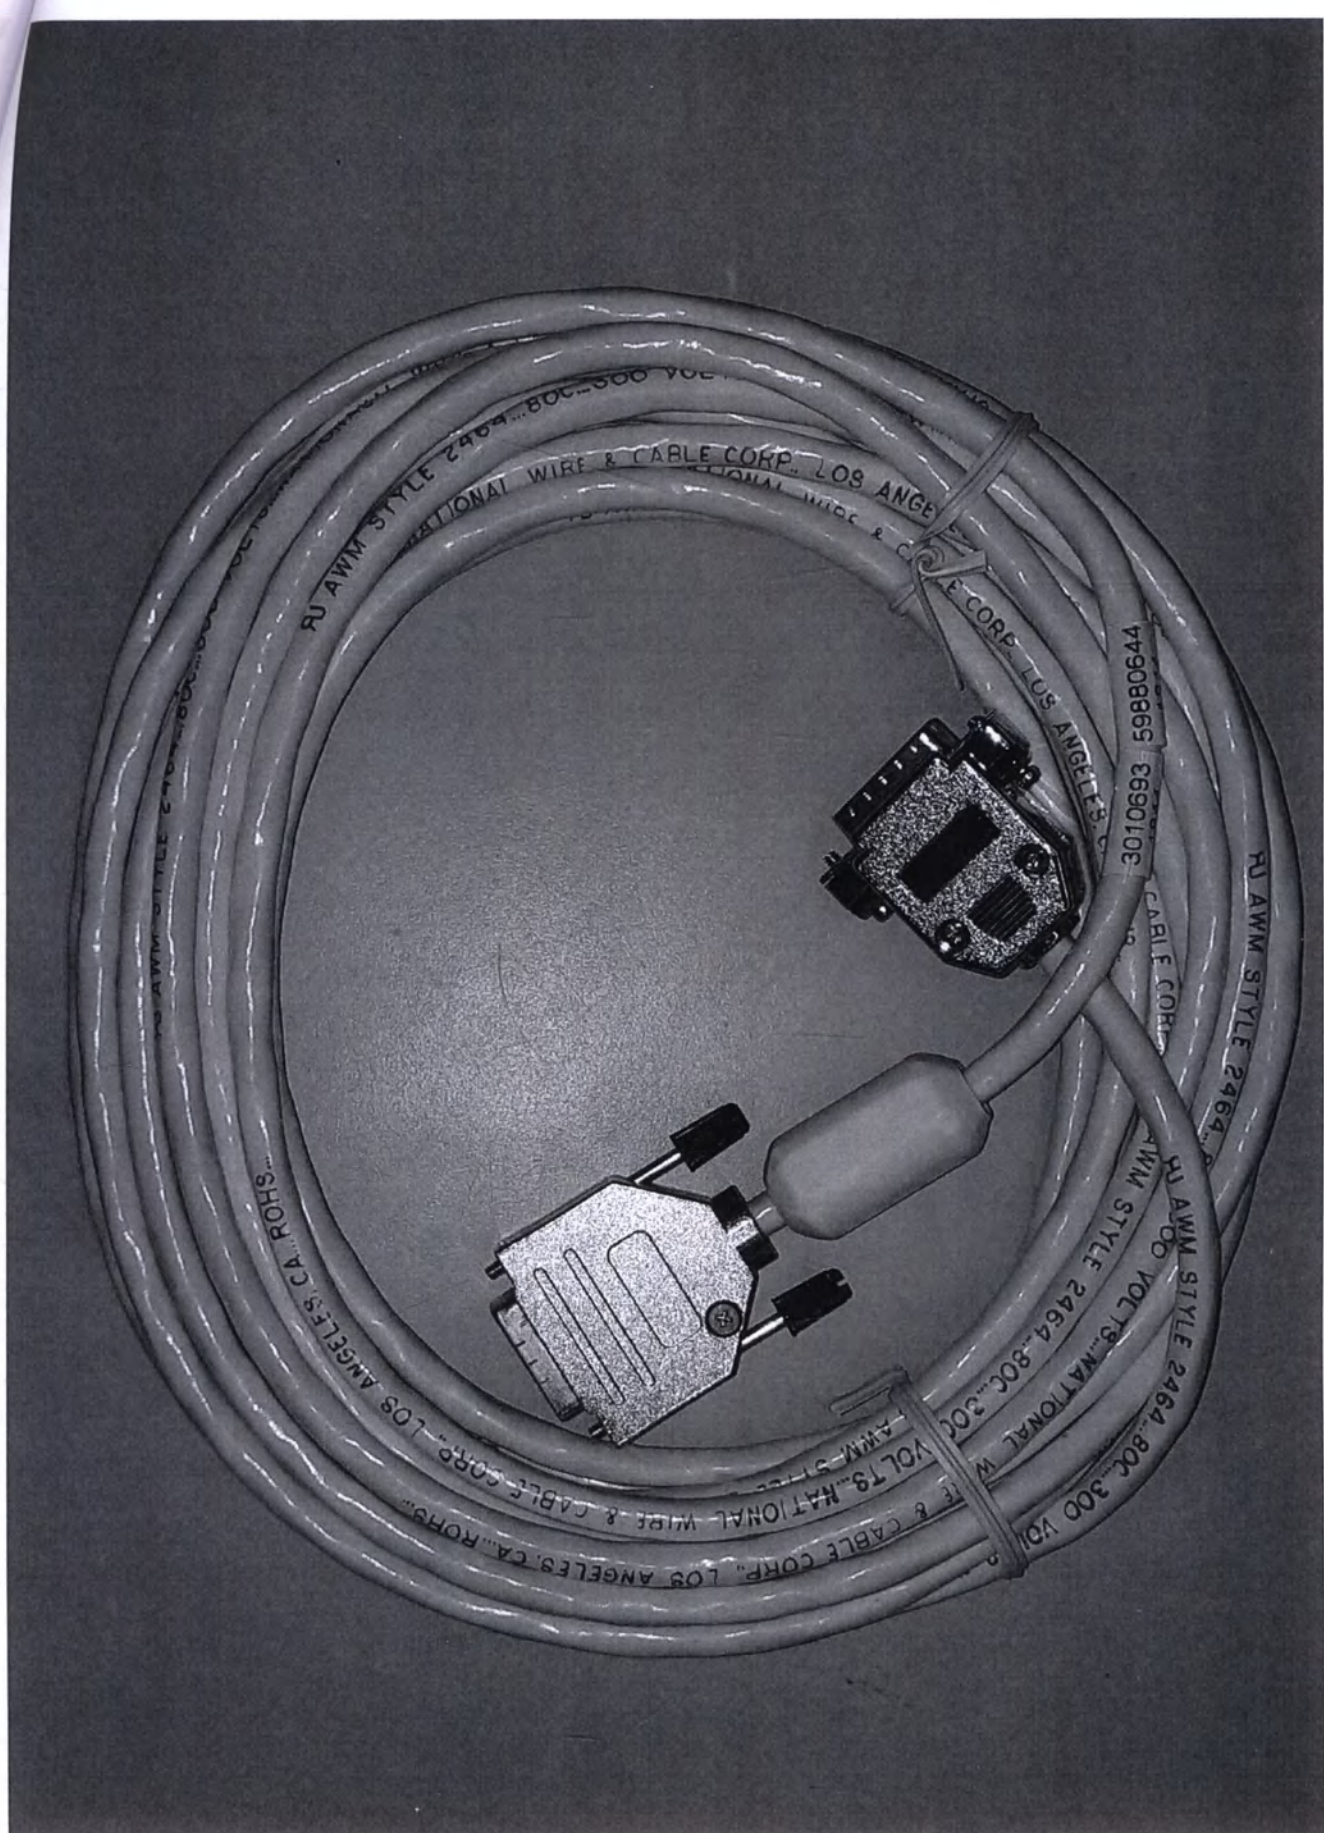


Кабель модуля управления и контроля 1,52 м (5 футов)

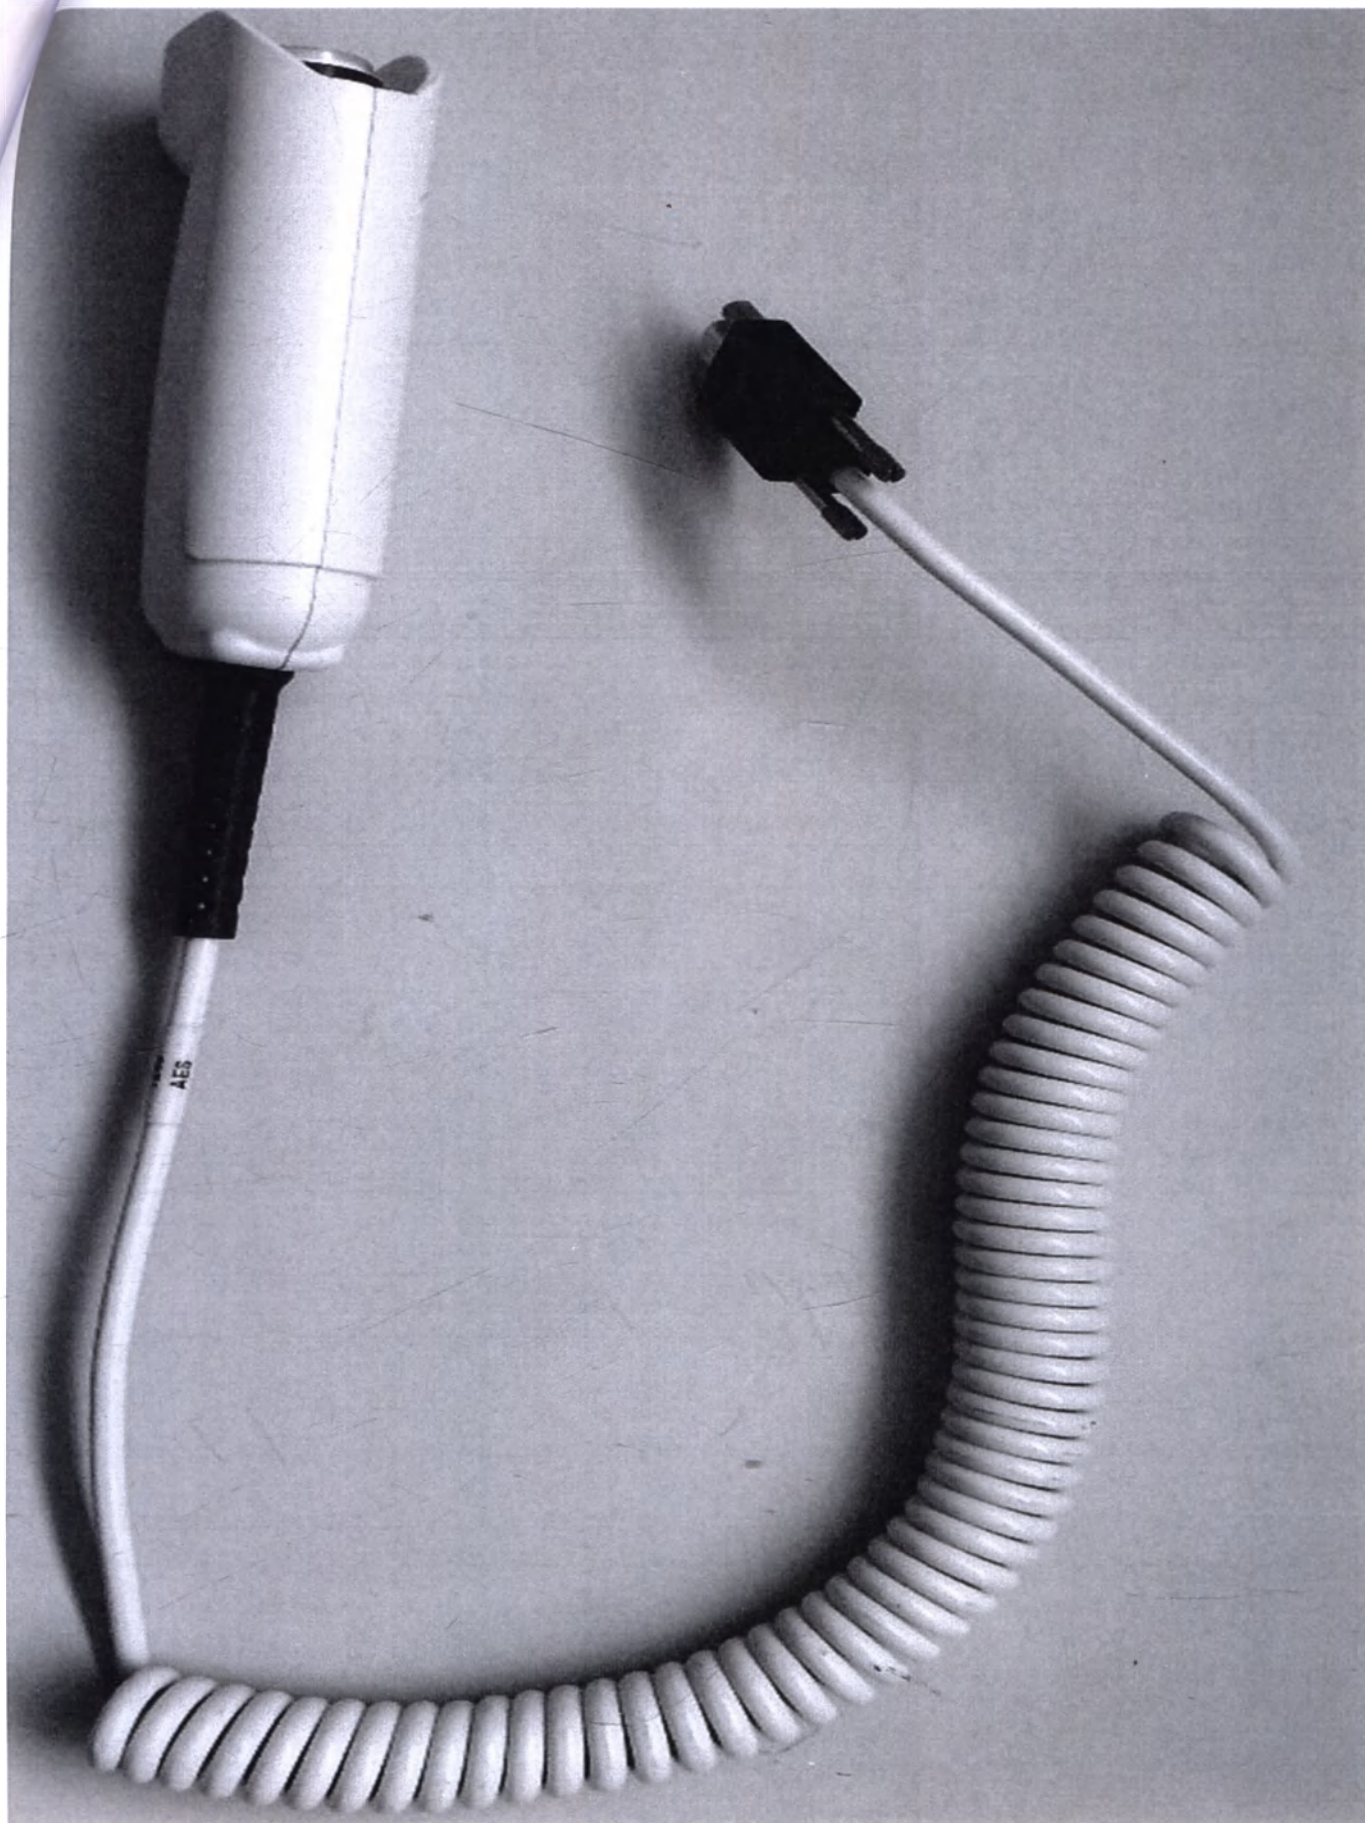

Ручной переключатель



Стойка с лотком и держателем

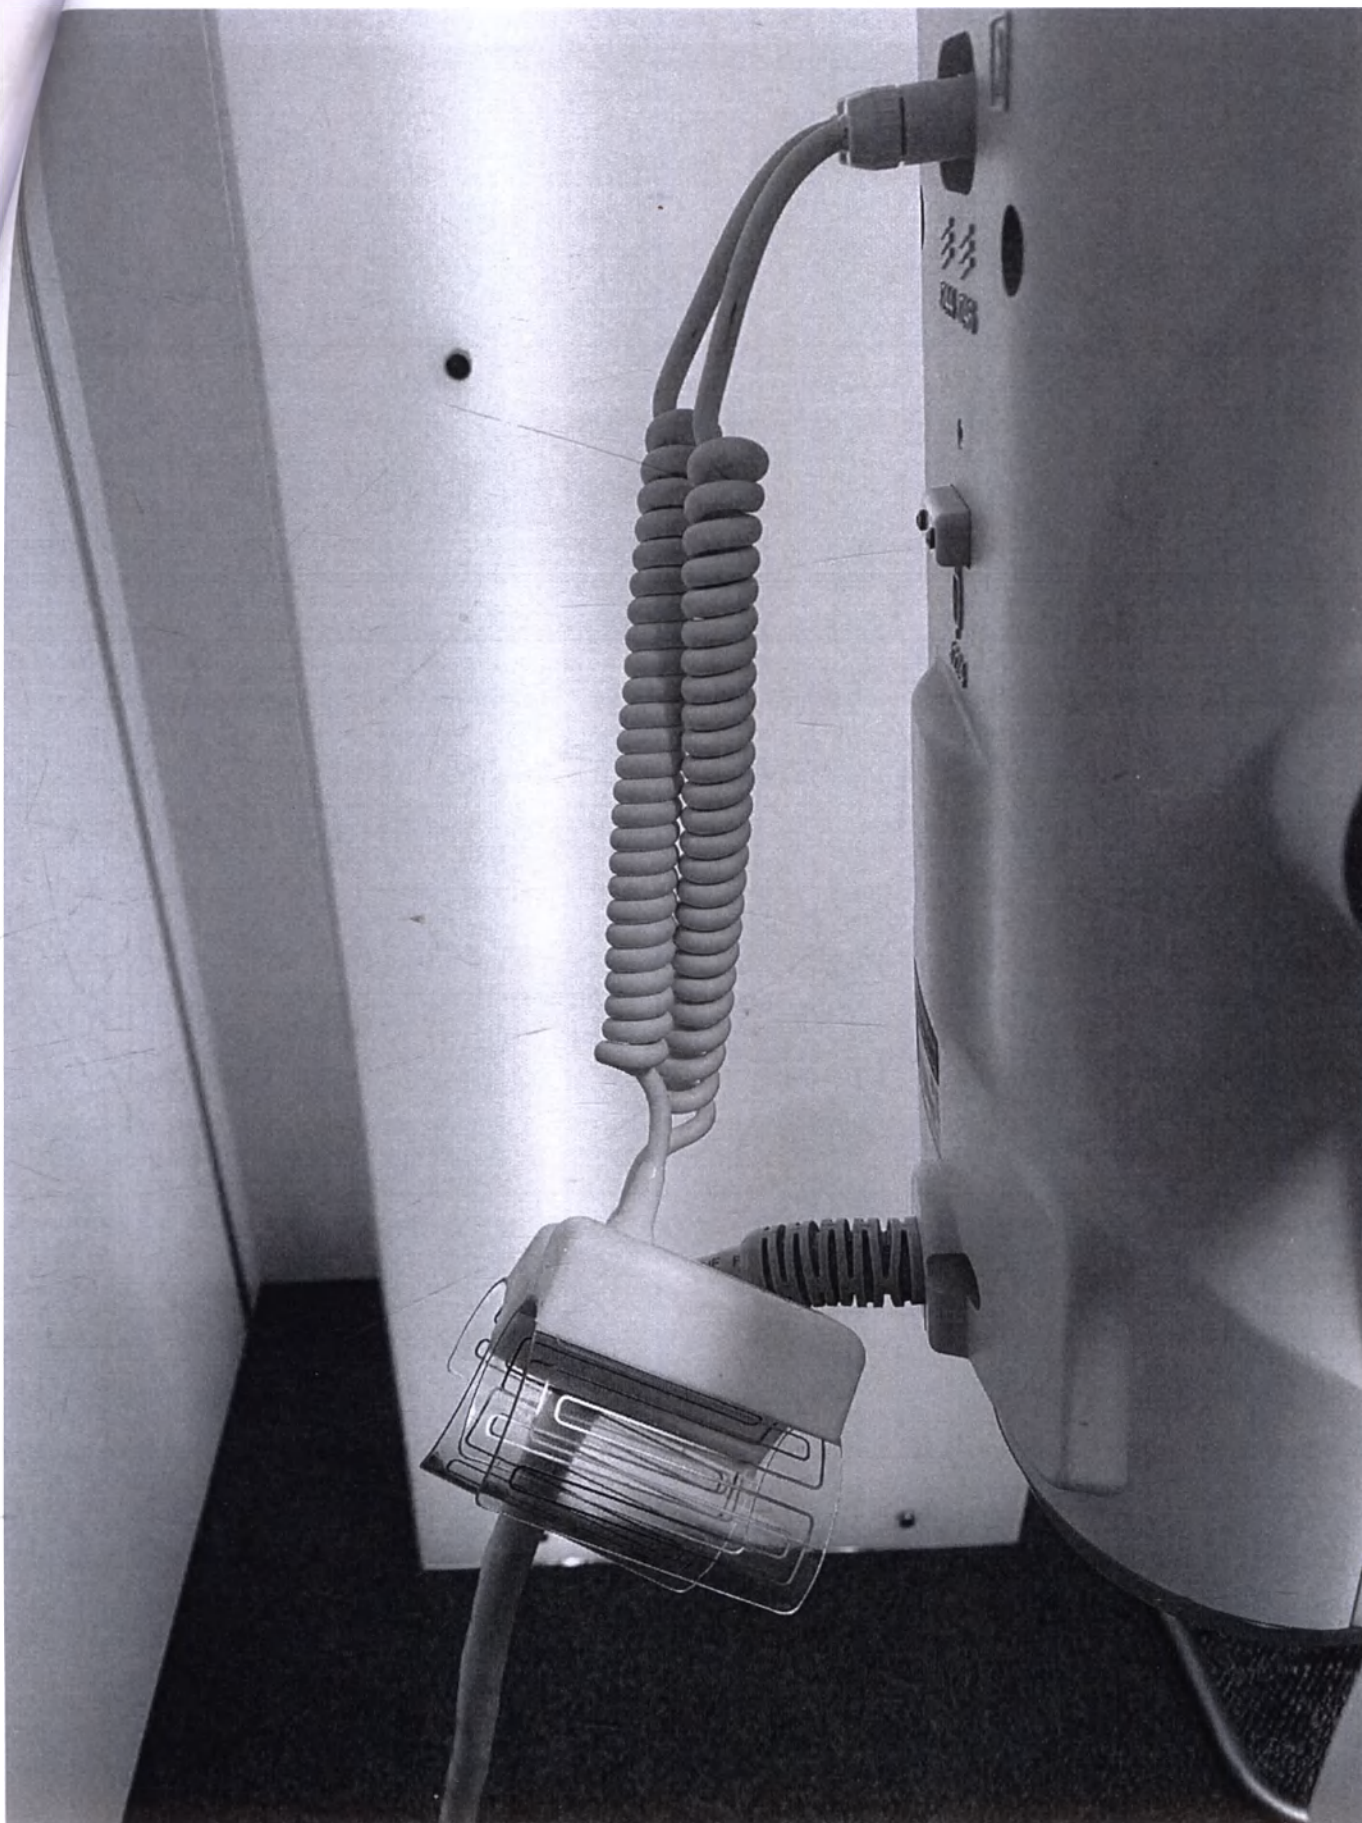

Подогреватель шприца




Держатель для контрастного вещества, лоток


МЕДРАД® Stellant ISI 700



Модуль интерфейсный системы визуализации (на примере ISI 700)

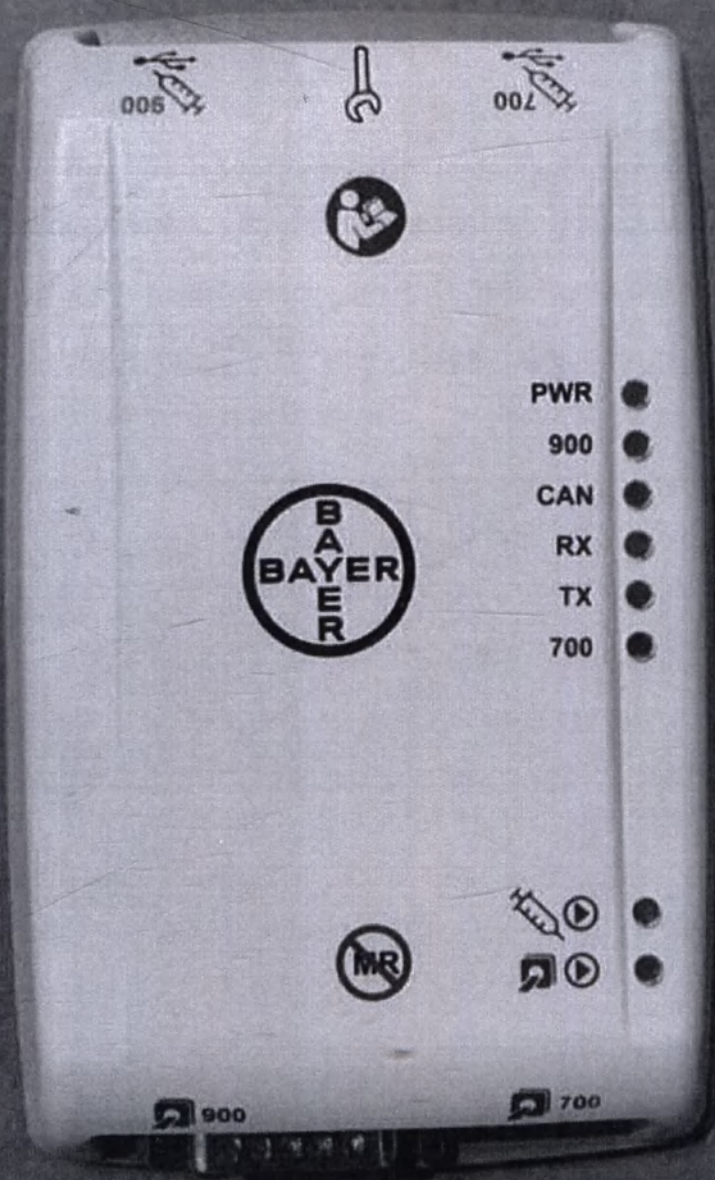

Модуль интерфейсный системы визуализации ISI2

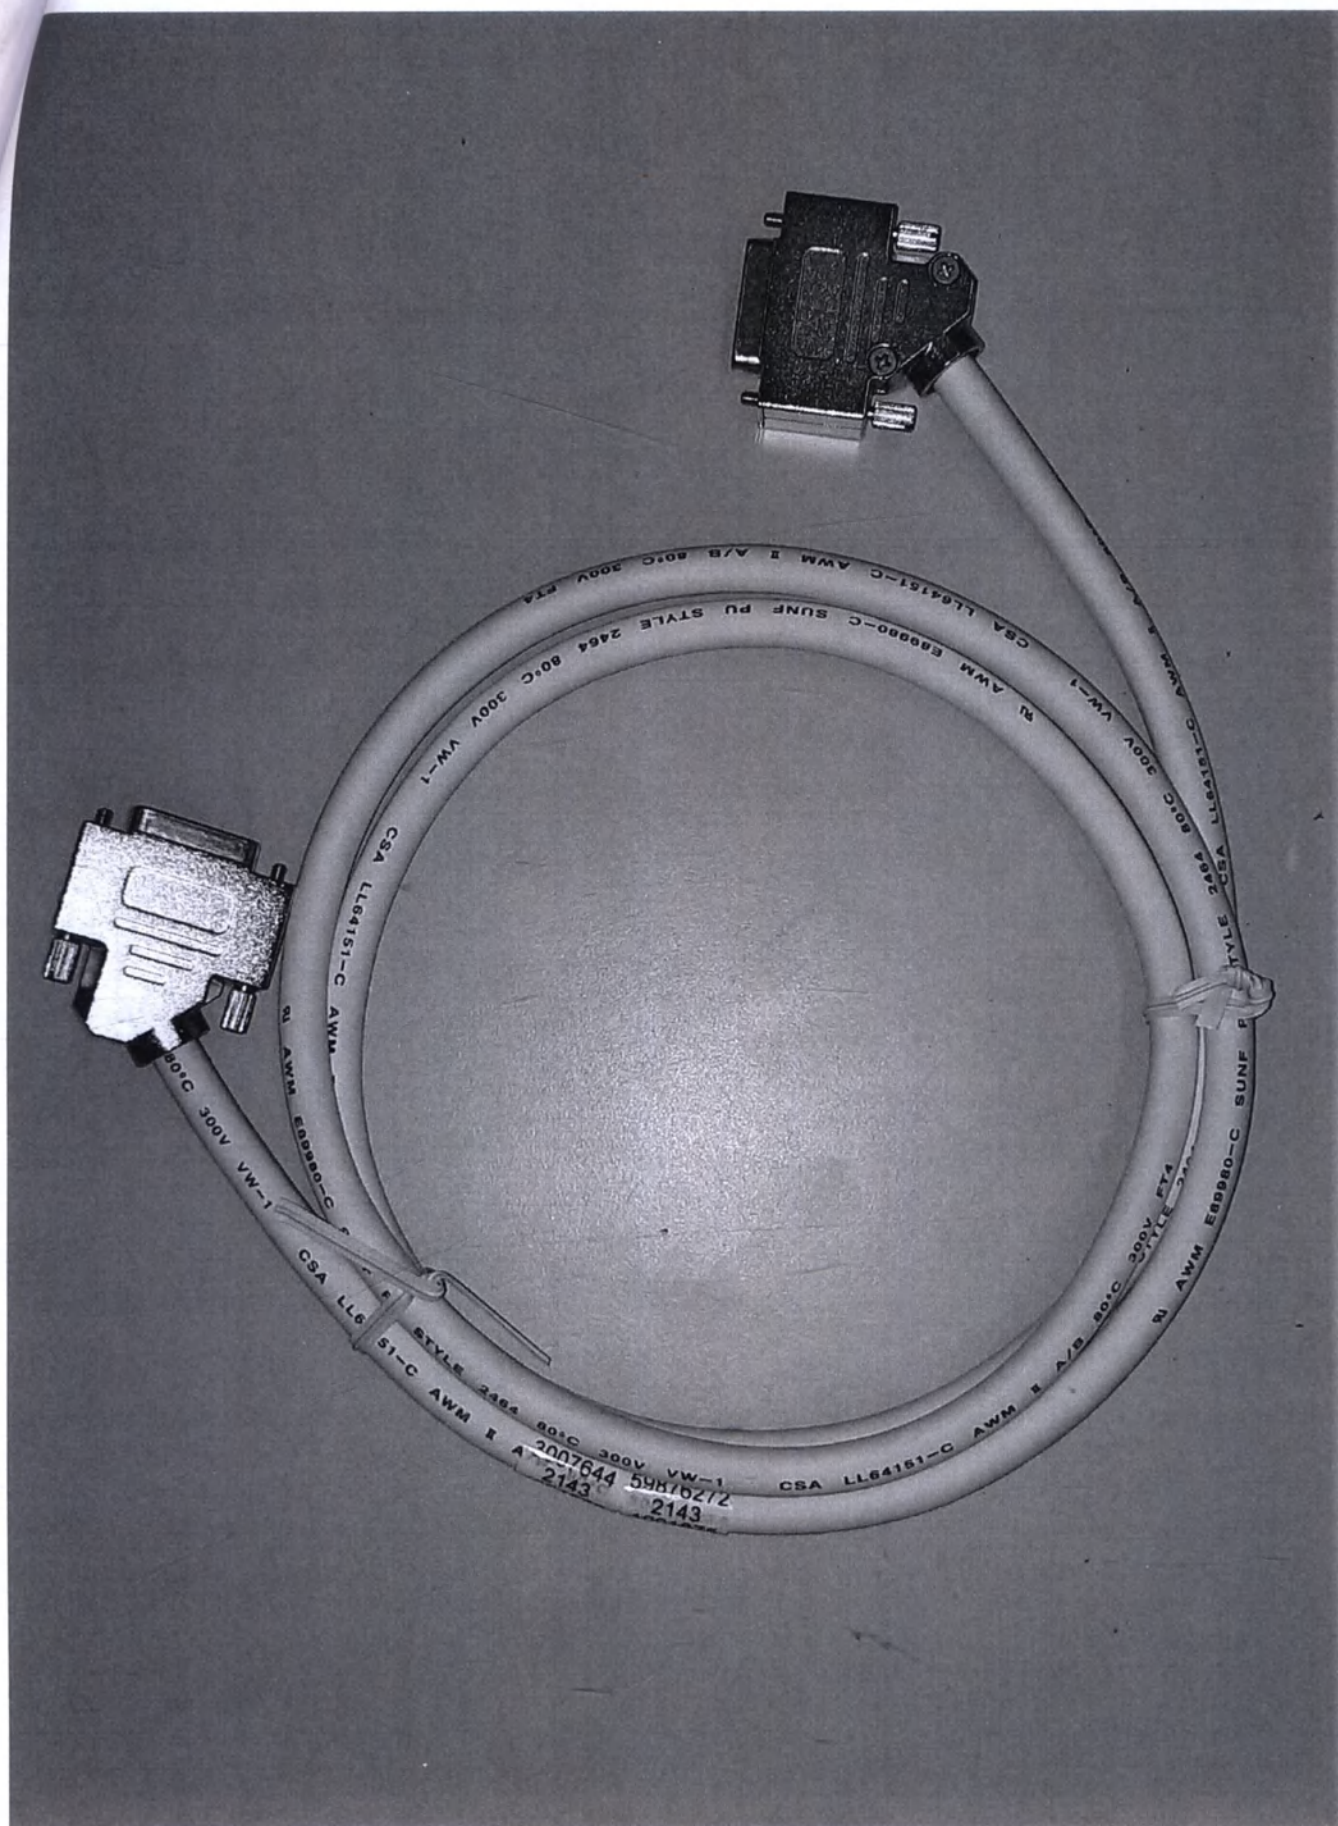

Кабель интерфейсный для интерфейсного модуля системы визуализации




Quantity: 1
59915189
ASSY. CABLE EQUIPOTEN
TIAL 5 METER LG
LOCAN: 78101 - 15 - AC - 26


RoHS
COMPLIANT

78101-15-AC-26
REV. F
2036


Кабель эквипотенциальный

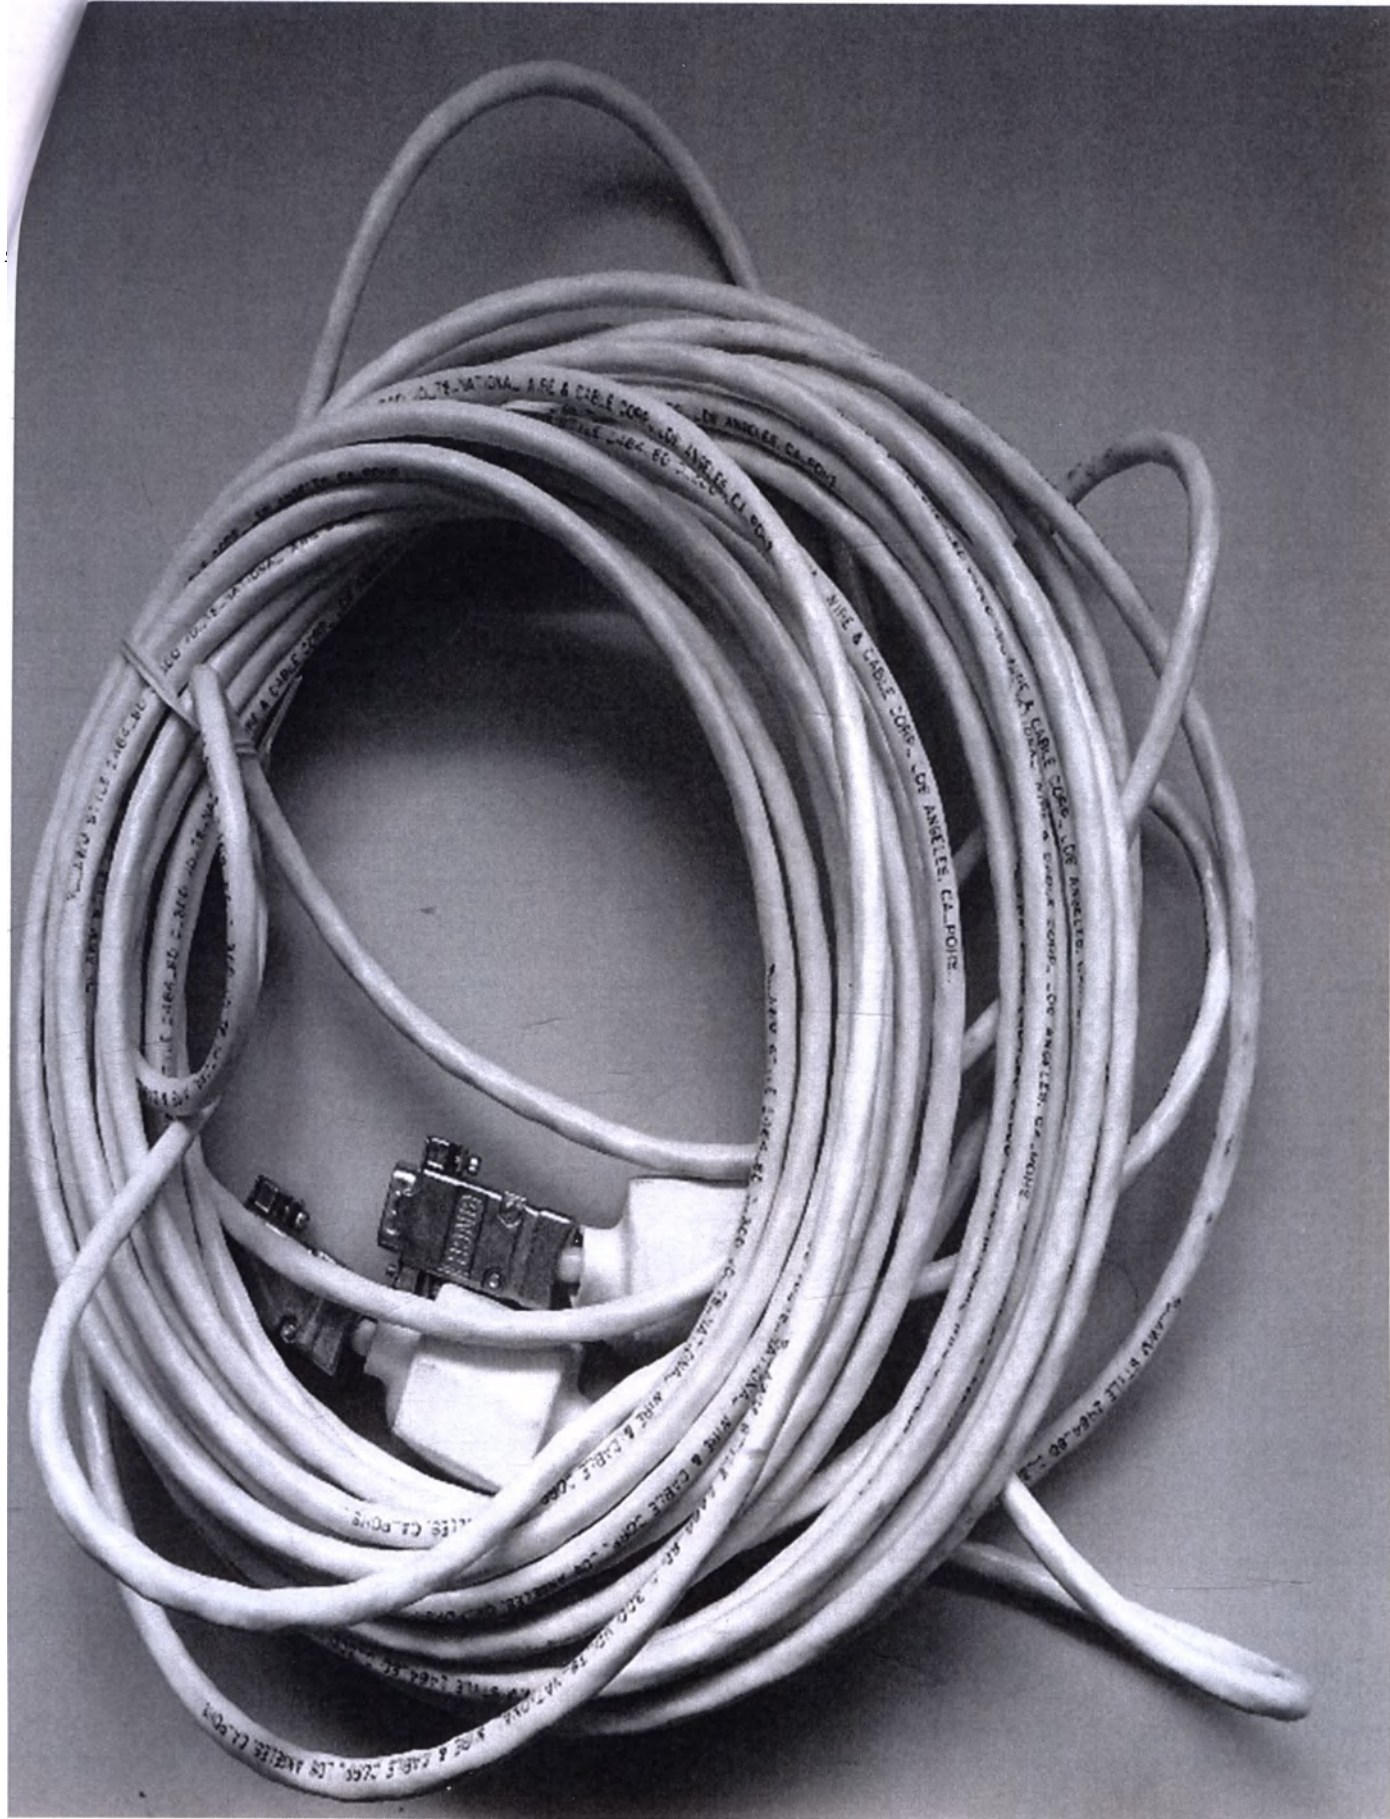

Кабель интерфейсный

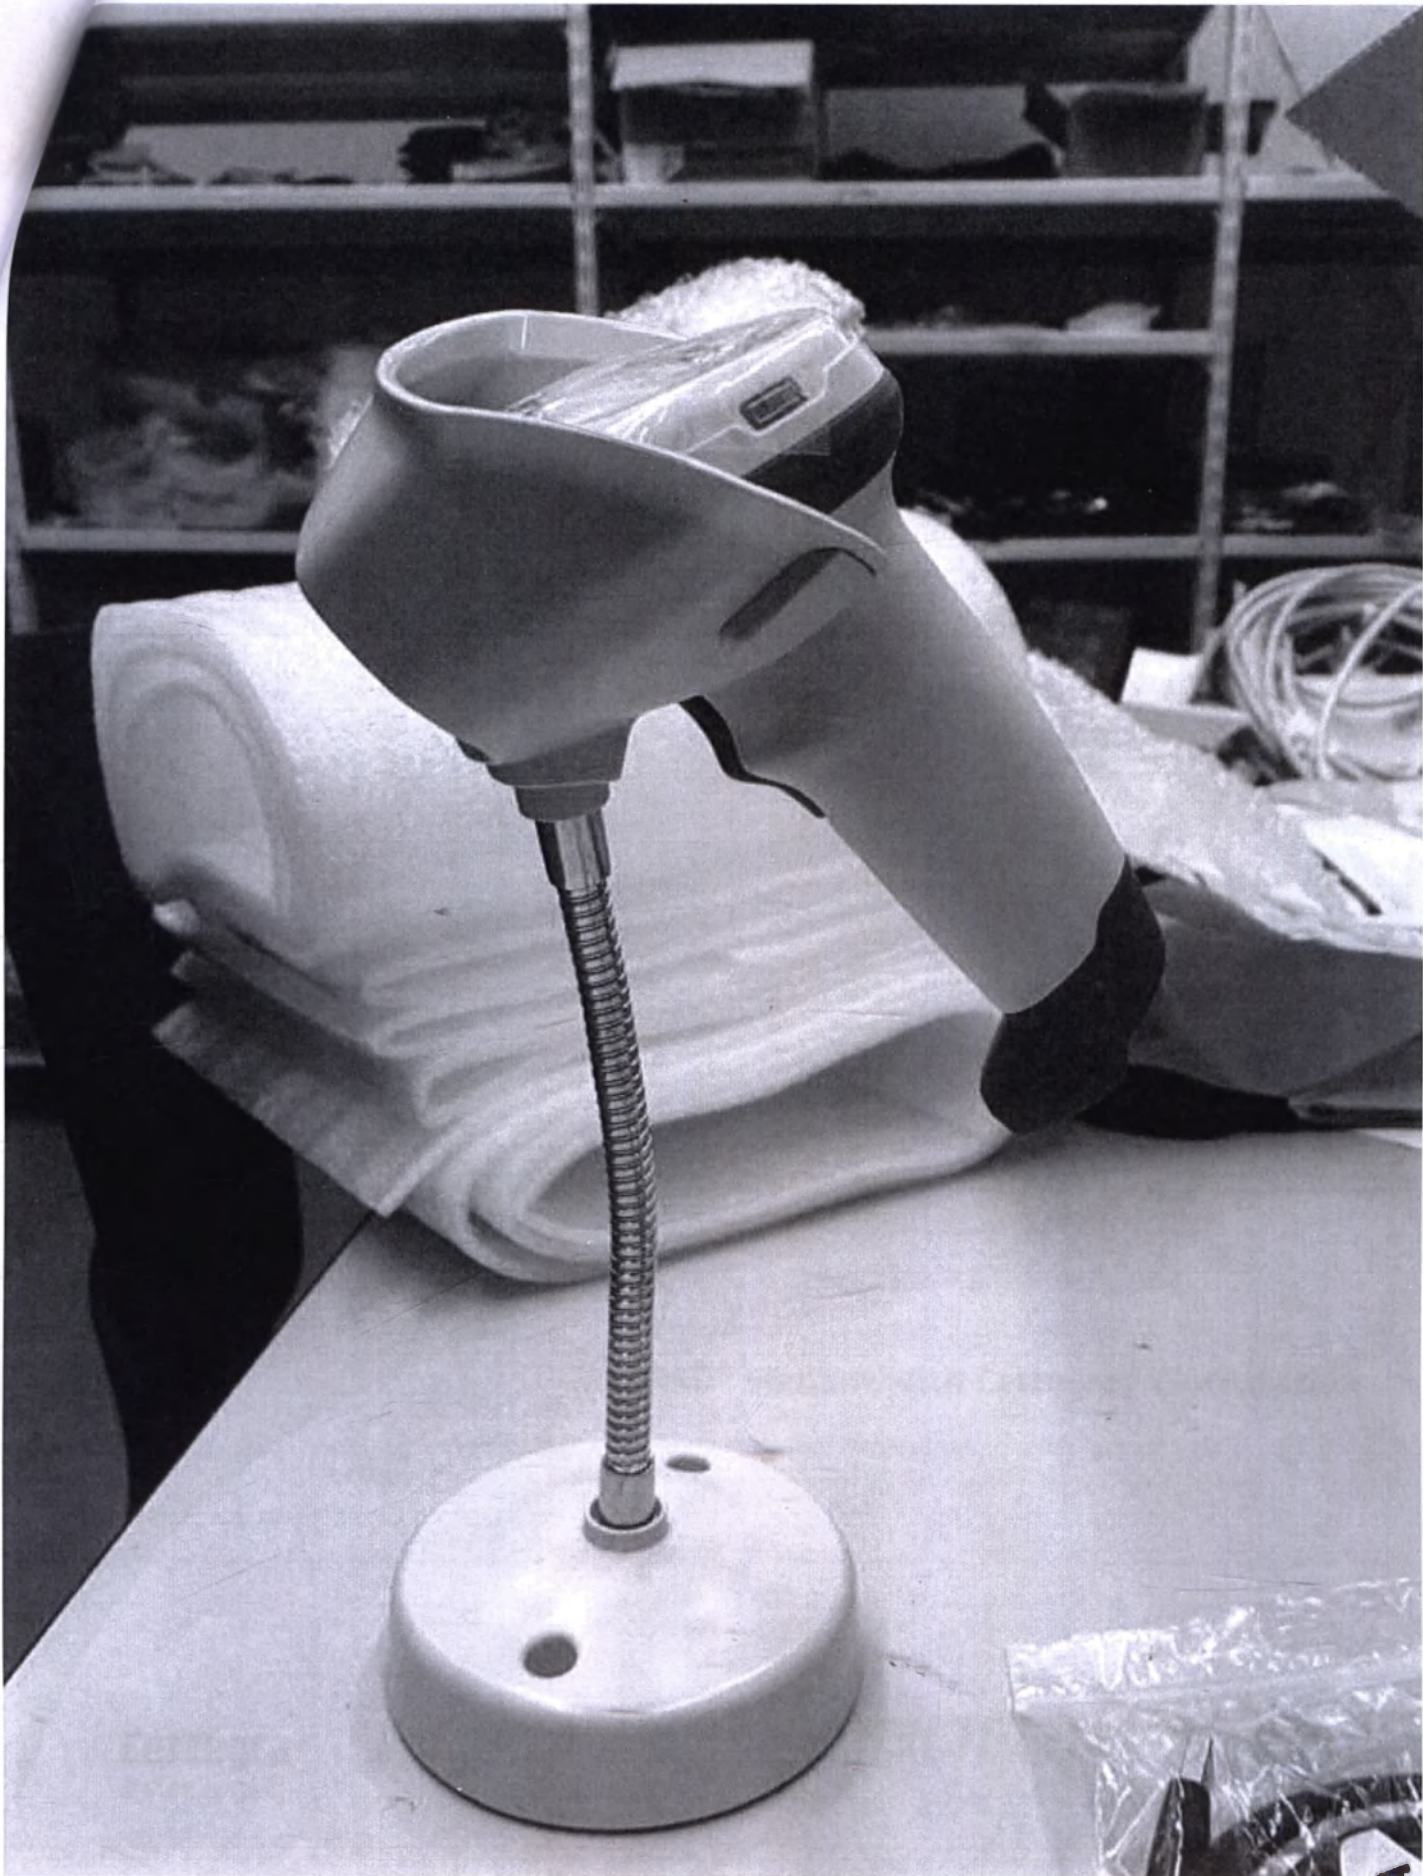

Устройство для штрихового кодирования

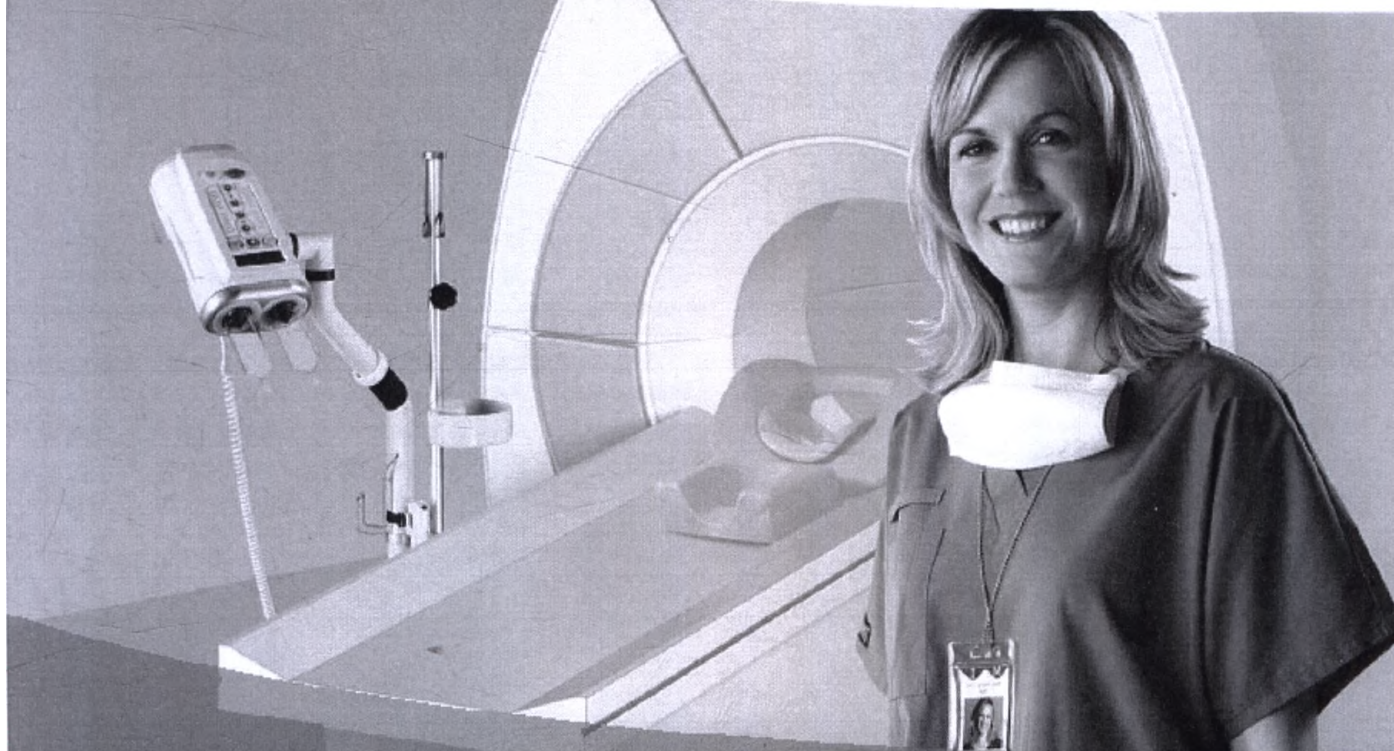


Service Manual

MEDRAD® Stellant with Certegra® Workstation


Certegra®
@ Point of Care

MEDRAD® Stellant
CT Injection System

Руководство сервисное

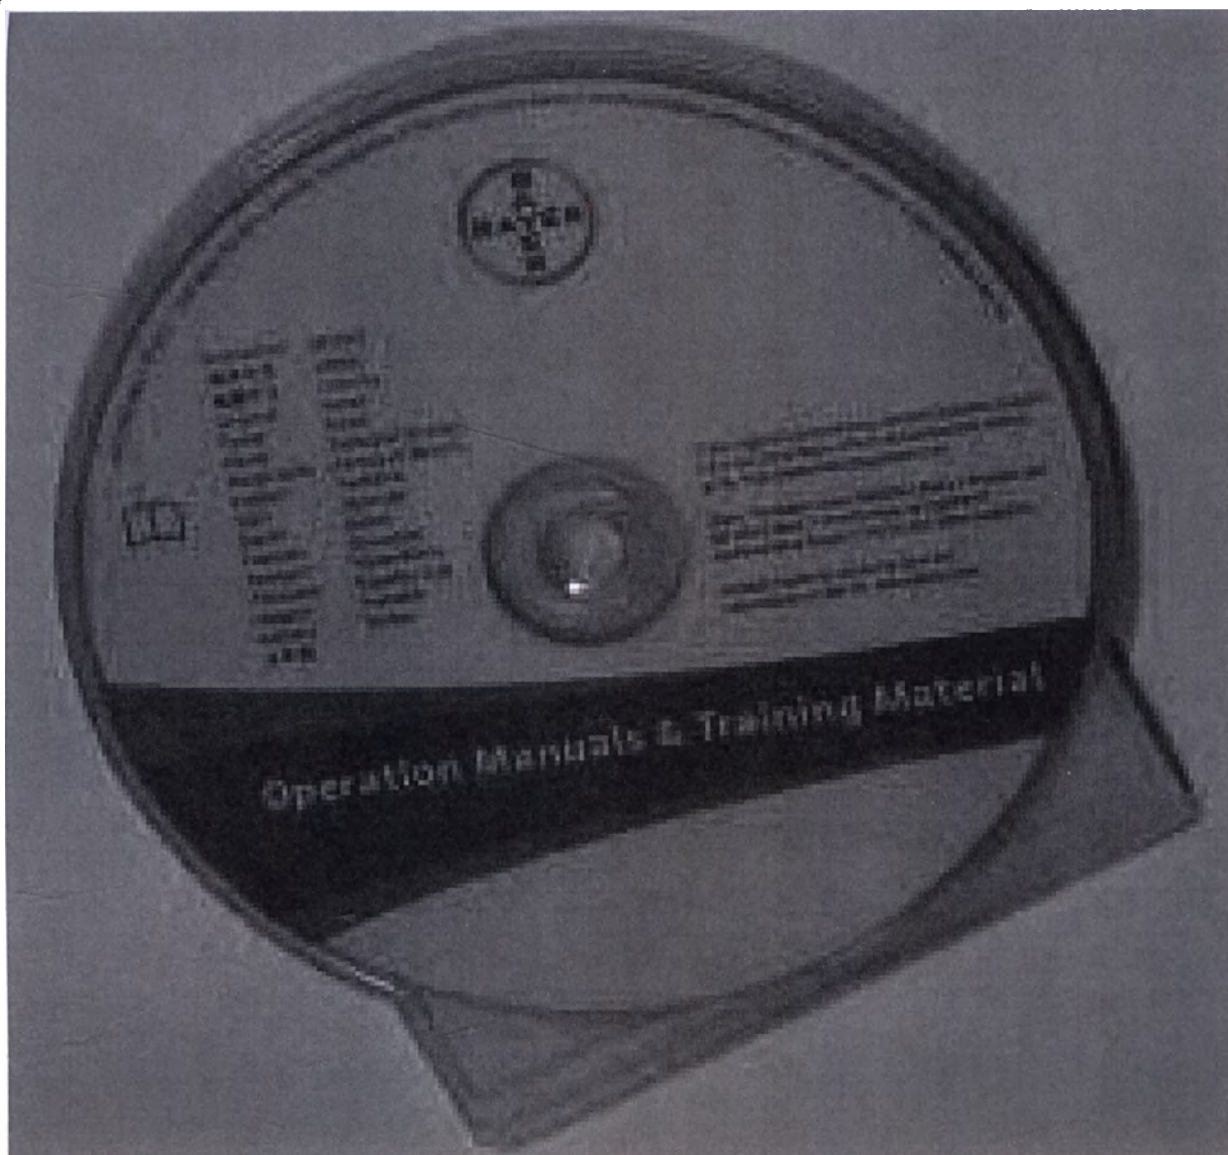

CD-диск многоязычный информационный диск

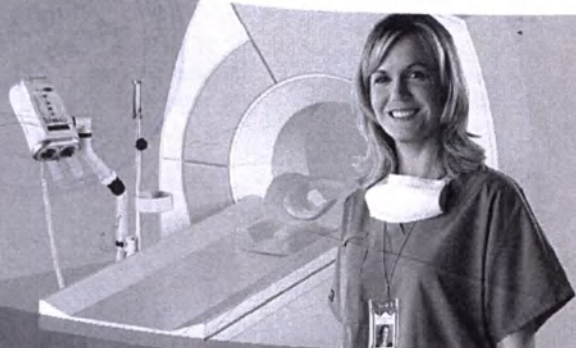


Руководство по эксплуатации

Система инъекционная для КТ MEDRAD® Stellant
с функцией MEDRAD® DualFlow для рабочей
станции Certegra™

Certegra™
Part of Care

MEDRAD® Stellant
CT Injection System

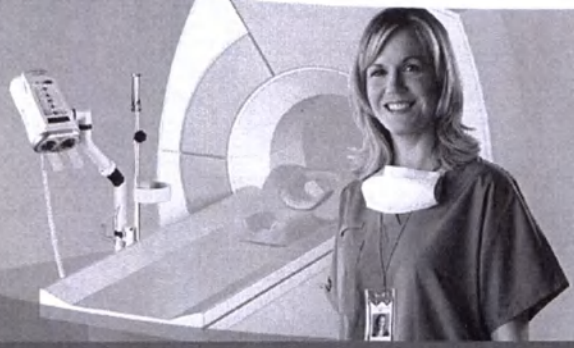

Руководство по эксплуатации


Технология персонализированного
протокола пациента (P3T)

Модуль P3T Abdomen
для рабочей станции Certegra® Workstation

Certegra®
Part of Care

MEDRAD® Stellant
CT Injection System

MEDRAD® Stellant FLEX
CT Injection System

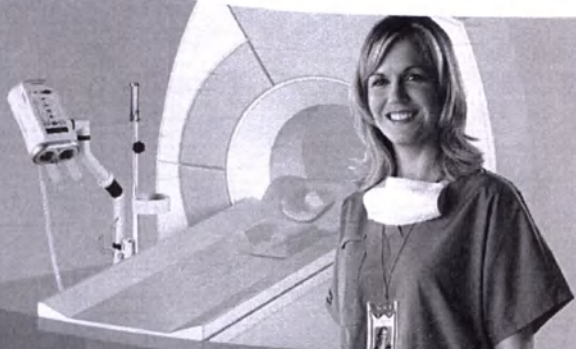

Руководство по эксплуатации


Технология персонализированного
протокола пациента (P3T)

Модуль P3T Cardiac
для рабочей станции Certegra® Workstation

Certegra®
Part of Care

MEDRAD® Stellant
CT Injection System

MEDRAD® Stellant FLEX
CT Injection System

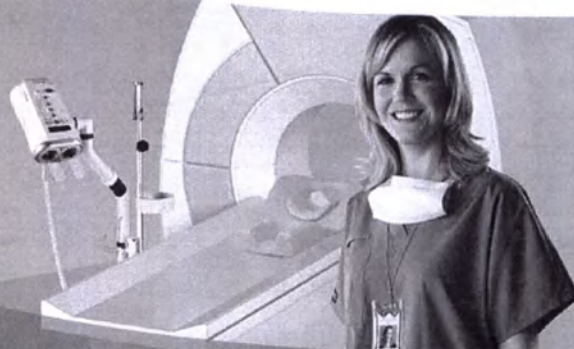

Руководство по эксплуатации

Технология персонализированного
протокола пациента (P3T)

Модуль P3T Pulmonary Angiography (PA)
для рабочей станции Certegra® Workstation

Certegra®
Part of Care

MEDRAD® Stellant
CT Injection System

MEDRAD® Stellant FLEX
CT Injection System

Эксплуатационная документация для функций

