

«УТВЕРЖДАЮ»

Исполнительный директор

АО НПП «Системные технологии»

М.В. Рюхин



«03» июля 20 23 г.


Фотографическое изображение медицинского изделия:

Комплекс аппаратно-программный
определения функционального состояния КАПД-02-СТ по ТУ 26.60.12.129-002-45520949-2021

Модификация

«Комплекс аппаратно-программный определения функционального состояния КАПД-02-СТ-Э»

2023

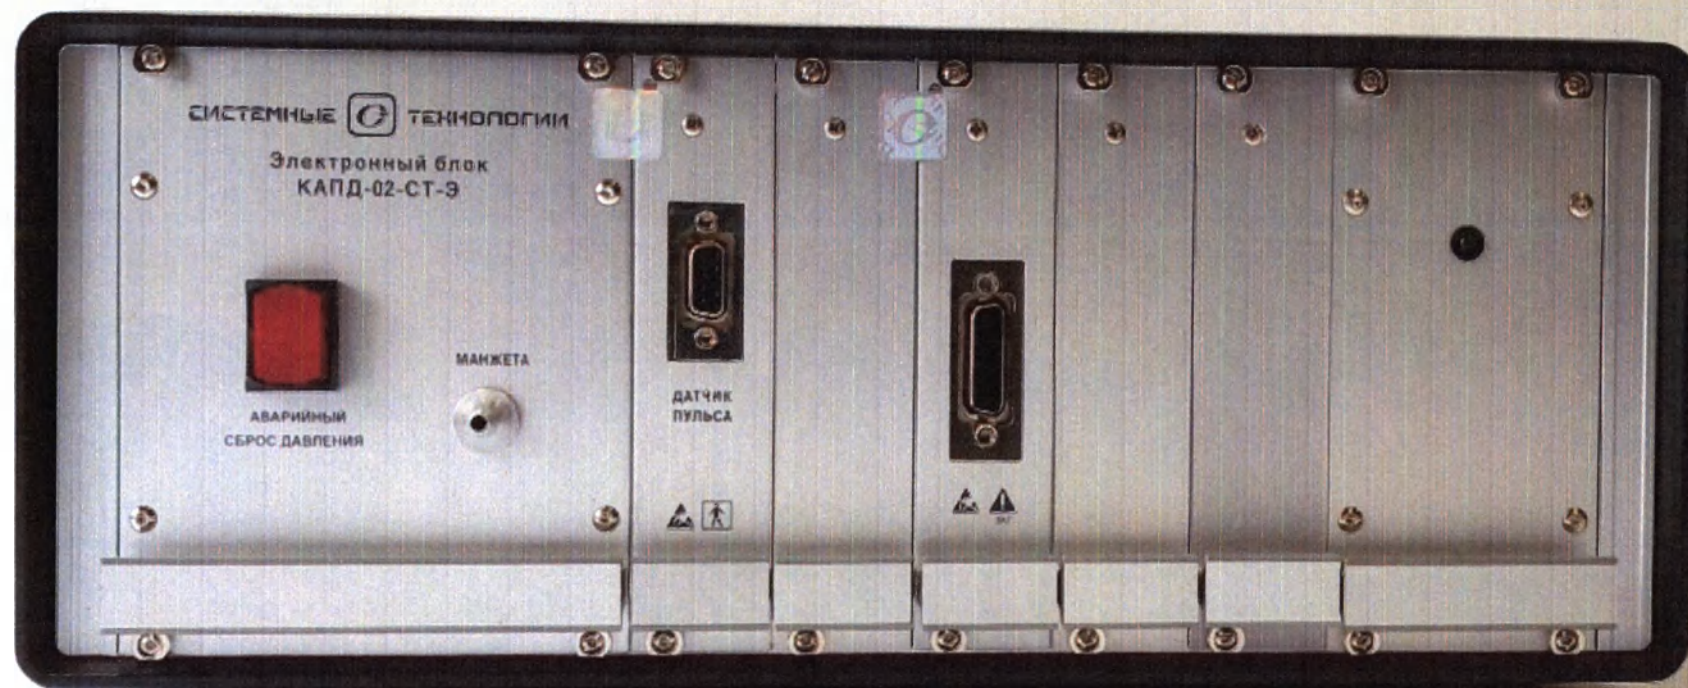

1 Электронный блок КАПД-02-СТ-Э



MODEL / МОДЕЛЬ F9009SSC

REF / арт. F9009SSC / RU24-SSC

ELECTRODE FOR ECG Ø24mm

ЭЛЕКТРОД ДЛЯ ЭКГ Ø24mm

WARNING - Do not use when defibrillating
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Не использовать при дефибриляции
РУ №ФСЗ 2010/07536 от 29.07.2010

LOT 7281

2019/12

2024/12

1x6

CE

FIAB

FIAB SpA - via Control, 4 - 50039 - Vico
(Florence, Italy) - www.fiab.it



MODEL / МОДЕЛЬ F9024

REF / арт. F9024 / RU24-SSC

ELECTRODE FOR ECG - ADULT

ЭЛЕКТРОД ДЛЯ ЭКГ - для взрослых

WARNING - Do not use when defibrillating
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Не использовать при дефибриляции
РУ №ФСЗ 2010/07536 от 29.07.2010

LOT 7262

2019/12

2024/12

1x4

CE

FIAB

FIAB SpA - via Control, 4 - 50039 - Vico
(Florence, Italy) - www.fiab.it



REF F6726R

CAVO PAZIENTE PER ECG 10 DERIVAZIONI
VERSIONE EUROPEA

ECG patient cable 10 leads European version

PROTETTO DA SCARICA DI DEFIBRILLAZIONE
PROTECTED AGAINST DEFIBRILLATOR DISCHARGE

10x 0.34mm

R=10KOhm

LOT N320

2024/09


CE

FIAB

APPARECCHIATURE COMPATIBILI / Compatible equipment
CARDIOLINE (C) DELTA 300, ELET 300, CANNON RAPID (A) 11, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 12, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 13, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 14, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9, 15, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 16, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.7, 16.8, 16.9, 17, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 17.8, 17.9, 18, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 18.6, 18.7, 18.8, 18.9, 19, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8, 19.9, 20, 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 21, 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5, 21.6, 21.7, 21.8, 21.9, 22, 22.1, 22.2, 22.3, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.8, 22.9, 23, 23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 23.5, 23.6, 23.7, 23.8, 23.9, 24, 24.1, 24.2, 24.3, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 25, 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5, 25.6, 25.7, 25.8, 25.9, 26, 26.1, 26.2, 26.3, 26.4, 26.5, 26.6, 26.7, 26.8, 26.9, 27, 27.1, 27.2, 27.3, 27.4, 27.5, 27.6, 27.7, 27.8, 27.9, 28, 28.1, 28.2, 28.3, 28.4, 28.5, 28.6, 28.7, 28.8, 28.9, 29, 29.1, 29.2, 29.3, 29.4, 29.5, 29.6, 29.7, 29.8, 29.9, 30, 30.1, 30.2, 30.3, 30.4, 30.5, 30.6, 30.7, 30.8, 30.9, 31, 31.1, 31.2, 31.3, 31.4, 31.5, 31.6, 31.7, 31.8, 31.9, 32, 32.1, 32.2, 32.3, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.9, 33, 33.1, 33.2, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8, 33.9, 34, 34.1, 34.2, 34.3, 34.4, 34.5, 34.6, 34.7, 34.8, 34.9, 35, 35.1, 35.2, 35.3, 35.4, 35.5, 35.6, 35.7, 35.8, 35.9, 36, 36.1, 36.2, 36.3, 36.4, 36.5, 36.6, 36.7, 36.8, 36.9, 37, 37.1, 37.2, 37.3, 37.4, 37.5, 37.6, 37.7, 37.8, 37.9, 38, 38.1, 38.2, 38.3, 38.4, 38.5, 38.6, 38.7, 38.8, 38.9, 39, 39.1, 39.2, 39.3, 39.4, 39.5, 39.6, 39.7, 39.8, 39.9, 40, 40.1, 40.2, 40.3, 40.4, 40.5, 40.6, 40.7, 40.8, 40.9, 41, 41.1, 41.2, 41.3, 41.4, 41.5, 41.6, 41.7, 41.8, 41.9, 42, 42.1, 42.2, 42.3, 42.4, 42.5, 42.6, 42.7, 42.8, 42.9, 43, 43.1, 43.2, 43.3, 43.4, 43.5, 43.6, 43.7, 43.8, 43.9, 44, 44.1, 44.2, 44.3, 44.4, 44.5, 44.6, 44.7, 44.8, 44.9, 45, 45.1, 45.2, 45.3, 45.4, 45.5, 45.6, 45.7, 45.8, 45.9, 46, 46.1, 46.2, 46.3, 46.4, 46.5, 46.6, 46.7, 46.8, 46.9, 47, 47.1, 47.2, 47.3, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.8, 47.9, 48, 48.1, 48.2, 48.3, 48.4, 48.5, 48.6, 48.7, 48.8, 48.9, 49, 49.1, 49.2, 49.3, 49.4, 49.5, 49.6, 49.7, 49.8, 49.9, 50, 50.1, 50.2, 50.3, 50.4, 50.5, 50.6, 50.7, 50.8, 50.9, 51, 51.1, 51.2, 51.3, 51.4, 51.5, 51.6, 51.7, 51.8, 51.9, 52, 52.1, 52.2, 52.3, 52.4, 52.5, 52.6, 52.7, 52.8, 52.9, 53, 53.1, 53.2, 53.3, 53.4, 53.5, 53.6, 53.7, 53.8, 53.9, 54, 54.1, 54.2, 54.3, 54.4, 54.5, 54.6, 54.7, 54.8, 54.9, 55, 55.1, 55.2, 55.3, 55.4, 55.5, 55.6, 55.7, 55.8, 55.9, 56, 56.1, 56.2, 56.3, 56.4, 56.5, 56.6, 56.7, 56.8, 56.9, 57, 57.1, 57.2, 57.3, 57.4, 57.5, 57.6, 57.7, 57.8, 57.9, 58, 58.1, 58.2, 58.3, 58.4, 58.5, 58.6, 58.7, 58.8, 58.9, 59, 59.1, 59.2, 59.3, 59.4, 59.5, 59.6, 59.7, 59.8, 59.9, 60, 60.1, 60.2, 60.3, 60.4, 60.5, 60.6, 60.7, 60.8, 60.9, 61, 61.1, 61.2, 61.3, 61.4, 61.5, 61.6, 61.7, 61.8, 61.9, 62, 62.1, 62.2, 62.3, 62.4, 62.5, 62.6, 62.7, 62.8, 62.9, 63, 63.1, 63.2, 63.3, 63.4, 63.5, 63.6, 63.7, 63.8, 63.9, 64, 64.1, 64.2, 64.3, 64.4, 64.5, 64.6, 64.7, 64.8, 64.9, 65, 65.1, 65.2, 65.3, 65.4, 65.5, 65.6, 65.7, 65.8, 65.9, 66, 66.1, 66.2, 66.3, 66.4, 66.5, 66.6, 66.7, 66.8, 66.9, 67, 67.1, 67.2, 67.3, 67.4, 67.5, 67.6, 67.7, 67.8, 67.9, 68, 68.1, 68.2, 68.3, 68.4, 68.5, 68.6, 68.7, 68.8, 68.9, 69, 69.1, 69.2, 69.3, 69.4, 69.5, 69.6, 69.7, 69.8, 69.9, 70, 70.1, 70.2, 70.3, 70.4, 70.5, 70.6, 70.7, 70.8, 70.9, 71, 71.1, 71.2, 71.3, 71.4, 71.5, 71.6, 71.7, 71.8, 71.9, 72, 72.1, 72.2, 72.3, 72.4, 72.5, 72.6, 72.7, 72.8, 72.9, 73, 73.1, 73.2, 73.3, 73.4, 73.5, 73.6, 73.7, 73.8, 73.9, 74, 74.1, 74.2, 74.3, 74.4, 74.5, 74.6, 74.7, 74.8, 74.9, 75, 75.1, 75.2, 75.3, 75.4, 75.5, 75.6, 75.7, 75.8, 75.9, 76, 76.1, 76.2, 76.3, 76.4, 76.5, 76.6, 76.7, 76.8, 76.9, 77, 77.1, 77.2, 77.3, 77.4, 77.5, 77.6, 77.7, 77.8, 77.9, 78, 78.1, 78.2, 78.3, 78.4, 78.5, 78.6, 78.7, 78.8, 78.9, 79, 79.1, 79.2, 79.3, 79.4, 79.5, 79.6, 79.7, 79.8, 79.9, 80, 80.1, 80.2, 80.3, 80.4, 80.5, 80.6, 80.7, 80.8, 80.9, 81, 81.1, 81.2, 81.3, 81.4, 81.5, 81.6, 81.7, 81.8, 81.9, 82, 82.1, 82.2, 82.3, 82.4, 82.5, 82.6, 82.7, 82.8, 82.9, 83, 83.1, 83.2, 83.3, 83.4, 83.5, 83.6, 83.7, 83.8, 83.9, 84, 84.1, 84.2, 84.3, 84.4, 84.5, 84.6, 84.7, 84.8, 84.9, 85, 85.1, 85.2, 85.3, 85.4, 85.5, 85.6, 85.7, 85.8, 85.9, 86, 86.1, 86.2, 86.3, 86.4, 86.5, 86.6, 86.7, 86.8, 86.9, 87, 87.1, 87.2, 87.3, 87.4, 87.5, 87.6, 87.7, 87.8, 87.9, 88, 88.1, 88.2, 88.3, 88.4, 88.5, 88.6, 88.7, 88.8, 88.9, 89, 89.1, 89.2, 89.3, 89.4, 89.5, 89.6, 89.7, 89.8, 89.9, 90, 90.1, 90.2, 90.3, 90.4, 90.5, 90.6, 90.7, 90.8, 90.9, 91, 91.1, 91.2, 91.3, 91.4, 91.5, 91.6, 91.7, 91.8, 91.9, 92, 92.1, 92.2, 92.3, 92.4, 92.5, 92.6, 92.7, 92.8, 92.9, 93, 93.1, 93.2, 93.3, 93.4, 93.5, 93.6, 93.7, 93.8, 93.9, 94, 94.1, 94.2, 94.3, 94.4, 94.5, 94.6, 94.7, 94.8, 94.9, 95, 95.1, 95.2, 95.3, 95.4, 95.5, 95.6, 95.7, 95.8, 95.9, 96, 96.1, 96.2, 96.3, 96.4, 96.5, 96.6, 96.7, 96.8, 96.9, 97, 97.1, 97.2, 97.3, 97.4, 97.5, 97.6, 97.7, 97.8, 97.9, 98, 98.1, 98.2, 98.3, 98.4, 98.5, 98.6, 98.7, 98.8, 98.9, 99, 99.1, 99.2, 99.3, 99.4, 99.5, 99.6, 99.7, 99.8, 99.9, 100, 100.1, 100.2, 100.3, 100.4, 100.5, 100.6, 100.7, 100.8, 100.9, 101, 101.1, 101.2, 101.3, 101.4, 101.5, 101.6, 101.7, 101.8, 101.9, 102, 102.1, 102.2, 102.3, 102.4, 102.5, 102.6, 102.7, 102.8, 102.9, 103, 103.1, 103.2, 103.3, 103.4, 103.5, 103.6, 103.7, 103.8, 103.9, 104, 104.1, 104.2, 104.3, 104.4, 104.5, 104.6, 104.7, 104.8, 104.9, 105, 105.1, 105.2, 105.3, 105.4, 105.5, 105.6, 105.7, 105.8, 105.9, 106, 106.1, 106.2, 106.3, 106.4, 106.5, 106.6, 106.7, 106.8, 106.9, 107, 107.1, 107.2, 107.3, 107.4, 107.5, 107.6, 107.7, 107.8, 107.9, 108, 108.1, 108.2, 108.3, 108.4, 108.5, 108.6, 108.7, 108.8, 108.9, 109, 109.1, 109.2, 109.3, 109.4, 109.5, 109.6, 109.7, 109.8, 109.9, 110, 110.1, 110.2, 110.3, 110.4, 110.5, 110.6, 110.7, 110.8, 110.9, 111, 111.1, 111.2, 111.3, 111.4, 111.5, 111.6, 111.7, 111.8, 111.9, 112, 112.1, 112.2, 112.3, 112.4, 112.5, 112.6, 112.7, 112.8, 112.9, 113, 113.1, 113.2, 113.3, 113.4, 113.5, 113.6, 113.7, 113.8, 113.9, 114, 114.1, 114.2, 114.3, 114.4, 114.5, 114.6, 114.7, 114.8, 114.9, 115, 115.1, 115.2, 115.3, 115.4, 115.5, 115.6, 115.7, 115.8, 115.9, 116, 116.1, 116.2, 116.3, 116.4, 116.5, 116.6, 116.7, 116.8, 116.9, 117, 117.1, 117.2, 117.3, 117.4, 117.5, 117.6, 117.7, 117.8, 117.9, 118, 118.1, 118.2, 118.3, 118.4, 118.5, 118.6, 118.7, 118.8, 118.9, 119, 119.1, 119.2, 119.3, 119.4, 119.5, 119.6, 119.7, 119.8, 119.9, 120, 120.1, 120.2, 120.3, 120.4, 120.5, 120.6, 120.7, 120.8, 120.9, 121, 121.1, 121.2, 121.3, 121.4, 121.5, 121.6, 121.7, 121.8, 121.9, 122, 122.1, 122.2, 122.3, 122.4, 122.5, 122.6, 122.7, 122.8, 122.9, 123, 123.1, 123.2, 123.3, 123.4, 123.5, 123.6, 123.7, 123.8, 123.9, 124, 124.1, 124.2, 124.3, 124.4, 124.5, 124.6, 124.7, 124.8, 124.9, 125, 125.1, 125.2, 125.3, 125.4, 125.5, 125.6, 125.7, 125.8, 125.9, 126, 126.1, 126.2, 126.3, 126.4, 126.5, 126.6, 126.7, 126.8, 126.9, 127, 127.1, 127.2, 127.3, 127.4, 127.5, 127.6, 127.7, 127.8, 127.9, 128, 128.1, 128.2, 128.3, 128.4, 128.5, 128.6, 128.7, 128.8, 128.9, 129, 129.1, 129.2, 129.3, 129.4, 129.5, 129.6, 129.7, 129.8, 129.9, 130, 130.1, 130.2, 130.3, 130.4, 130.5, 130.6, 130.7, 130.8, 130.9, 131, 131.1, 131.2, 131.3, 131.4, 131.5, 131.6, 131.7, 131.8, 131.9, 132, 132.1, 132.2, 132.3, 132.4, 132.5, 132.6, 132.7, 132.8, 132.9, 133, 133.1, 133.2, 133.3, 133.4, 133.5, 133.6, 133.7, 133.8, 133.9, 134, 134.1, 134.2, 134.3, 134.4, 134.5, 134.6, 134.7, 134.8, 134.9, 135, 135.1, 135.2, 135.3, 135.4, 135.5, 135.6, 135.7, 135.8, 135.9, 136, 136.1, 136.2, 136.3, 136.4, 136.5, 136.6, 136.7, 136.8, 136.9, 137, 137.1, 137.2, 137.3, 137.4, 137.5, 137.6, 137.7, 137.8, 137.9, 138, 138.1, 138.2, 138.3, 138.4, 138.5, 138.6, 138.7, 138.8, 138.9, 139, 139.1, 139.2, 139.3, 139.4, 139.5, 139.6, 139.7, 139.8, 139.9, 140, 140.1, 140.2, 140.3, 140.4, 140.5, 140.6, 140.7, 140.8, 140.9, 141, 141.1, 141.2, 141.3, 141.4, 141.5, 141.6, 141.7, 141.8, 141.9, 142, 142.1, 142.2, 142.3, 142.4, 142.5, 142.6, 142.7, 142.8, 142.9, 143, 143.1, 143.2, 143.3, 143.4, 143.5, 143.6, 143.7, 143.8, 143.9, 144, 144.1, 144.2, 144.3, 144.4, 144.5, 144.6, 144.7, 144.8, 144.9, 145, 145.1, 145.2, 145.3, 145.4, 145.5, 145.6, 145.7, 145.8, 145.9, 146, 146.1, 146.2, 146.3, 146.4, 146.5, 146.6, 146.7, 146.8, 146.9, 147, 147.1, 147.2, 147.3, 147.4, 147.5, 147.6, 147.7, 147.8, 147.9, 148, 148.1, 148.2, 148.3, 148.4, 148.5, 148.6, 148.7, 148.8, 148.9, 149, 149.1, 149.2, 149.3, 149.4, 149.5, 149.6, 149.7, 149.8, 149.9, 150, 150.1, 150.2, 150.3, 150.4, 150.5, 150.6, 150.7, 150.8, 150.9, 151, 151.1, 151.2, 151.3, 151.4, 151.5, 151.6, 151.7, 151.8, 151.9, 152, 152.1, 152.2, 152.3, 152.4, 152.5, 152.6, 152.7, 152.8, 152.9, 153, 153.1, 153.2, 153.3, 153.4, 153.5, 153.6, 153.7, 153.8, 153.9, 154, 154.1, 154.2, 154.3, 154.4, 154.5, 154.6, 154.7, 154.8, 154.9, 155, 155.1, 155.2, 155.3, 155.4, 155.5, 155.6, 155.7, 155.8, 155.9, 156, 156.1, 156.2, 156.3, 156.4, 156.5, 156.6, 156.7, 156.8, 156.9, 157, 157.1, 157.2, 157.3, 157.4, 157.5, 157.6, 157.7, 157.8, 157.9, 158, 158.1, 158.2, 158.3, 158.4, 158.5, 158.6, 158.7, 158.8, 158.9, 159, 159.1, 159.2, 159.3, 159.4, 159.5, 159.6, 159.7, 159.8, 159.9, 160, 160.1, 160.2, 160.3, 160.4, 160.5, 160.6, 160.7, 160.8, 160.9, 161, 161.1, 161.2, 161.3, 161.4, 161.5, 161.6, 161.7, 161.8, 161.9, 162, 162.1, 162.2, 162.3, 162.4, 162.5, 162.6, 162.7, 162.8, 162.9, 163, 163.1, 163.2, 163.3, 163.4, 163.5, 163.6, 163.7, 163.8, 163.9, 164, 164.1, 164.2, 164.3, 164.4, 164.5, 164.6, 164.7, 164.8, 164.9, 165, 165.1, 165.2, 165.3, 165.4, 165.5, 165.6, 165.7, 165.8, 165.9, 166, 166.1, 166.2, 166.3, 166.4, 166.5, 166.6, 166.7, 166.8, 166.9, 167, 167.1, 167.2, 167.3, 167.4, 167.5, 167.6, 167.7, 167.8, 167.9, 168, 168.1, 168.2, 168.3, 168.4, 168.5, 168.6, 168.7, 168.8, 168.9, 169, 169.1, 169.2, 169.3, 169.4, 169.5, 169.6, 169.7, 169.8, 169.9, 170, 170.1, 170.2, 170.3, 170.4, 170.5, 170.6, 170.7, 170.8, 170.9, 171, 171.1, 171.2, 171.3, 171.4, 171.5, 171.6, 171.7, 171.8, 171.9, 172, 172.1, 172.2, 172.3, 172.4, 172.5, 172.6, 172.7, 172.8, 172.9, 173, 173.1, 173.2, 173.3, 173.4, 173.5, 173.6, 173.7, 173.8, 173.9, 174, 174.1, 174.2, 174.3, 174.4, 174.5, 174.6, 174.7, 174.8, 174.9, 175, 175.1, 175.2, 175.3, 175.4, 175.5, 175.6, 175.7, 175.8, 175.9, 176, 176.1, 176.2, 176.3, 176.4, 176.5, 176.6, 176.7, 176.8, 176.9, 177, 177.1, 177.2, 177.3, 177.4, 177.5, 177.6, 177.7, 177.8, 177.9, 178, 178.1, 178.2, 178.3, 178.4, 178.5, 178.6, 178.7, 178.8, 178.9, 179, 179.


Для точных измерений


1. Закрепите манжету плотно, но не туго
2. Манжета должна находиться выше локтевого сгиба на расстоянии 2 – 3 см
3. Резиновая трубка должна находиться над локтевой ямкой

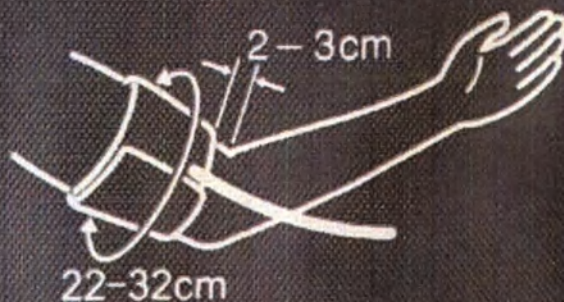

Для точных измерений

1. Закрепите манжету плотно, но не туго
2. Манжета должна находиться выше локтевого сгиба на расстоянии 2 – 3 см
3. Резиновая трубка должна находиться над локтевой ямкой

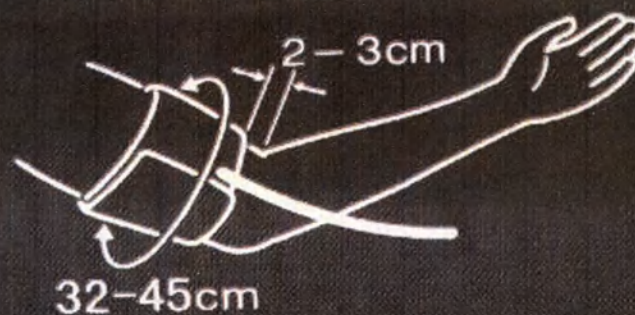

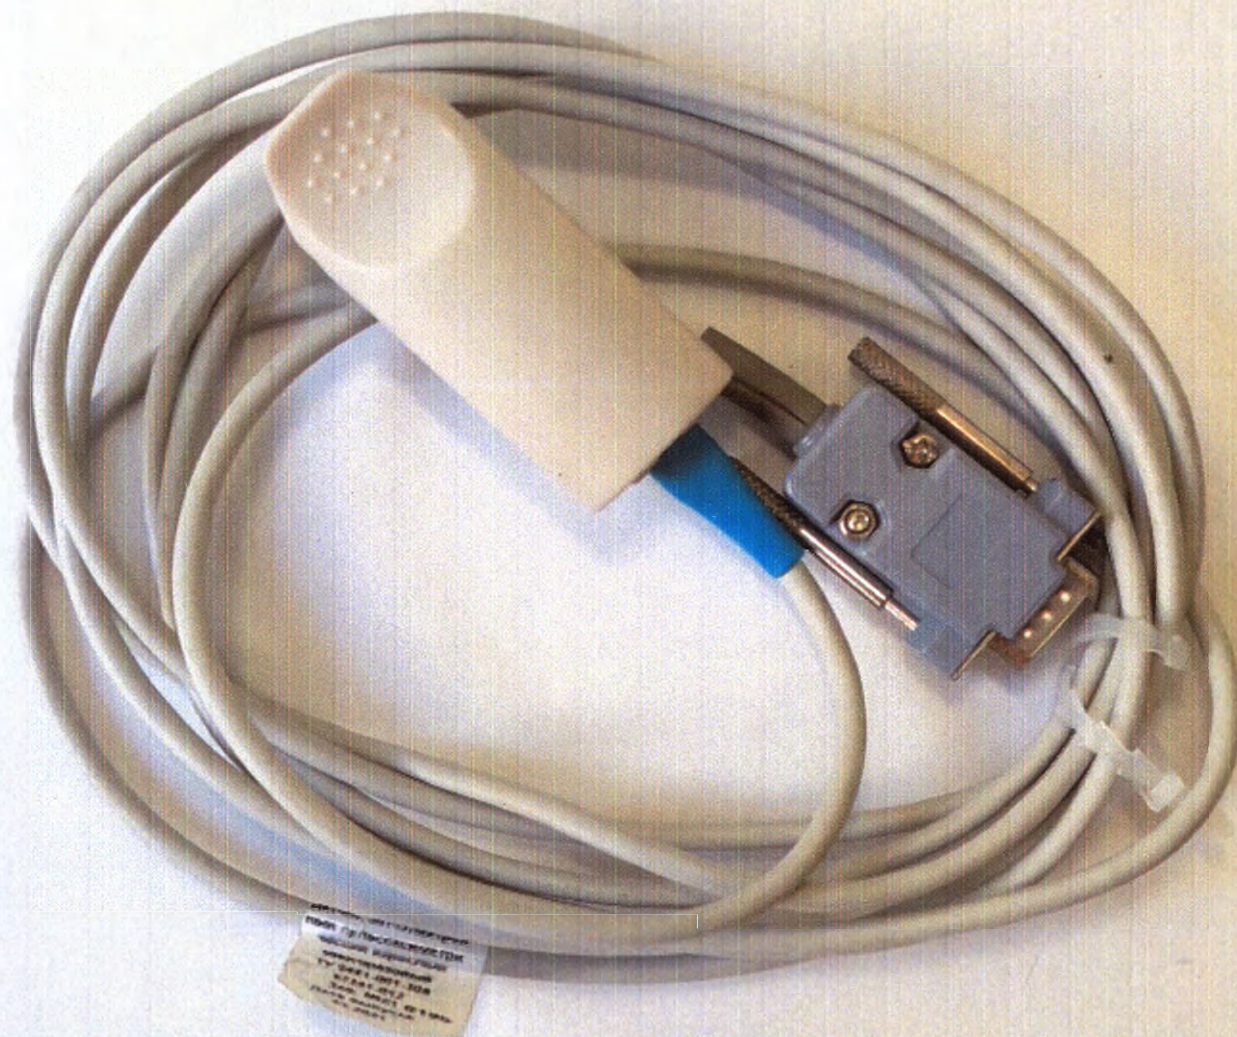


5 Датчики оптоэлектронные пульсоксиметрические взрослые и неонатальные многоцветные по ТУ 9441-001-30857241-2012: Датчик оптоэлектронный

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU лый многоцветный, артикул ДАСМ. 012.542.1, производства ООО «Аксиома», Россия, РУ №РЗН 2013/658

ООО "Аксиома"
Датчик в жидкость
не погружать! Стери-
лизовать протирани-
ем. Артикул ДАСМ.
012.542.1 Код А1


МАРКИРОВКА: Датчики оптоэлектронные пульсоксиметрические взрослые и неонатальные многоразовые по ТУ 9441-001-30857241-2012: Датчик оптоэлектронный
ООО ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU рослый многоразовый, артикул ДАСМ. 012.542.1, производства ООО «Аксиома», Россия, РУ №РЗН 2013/658

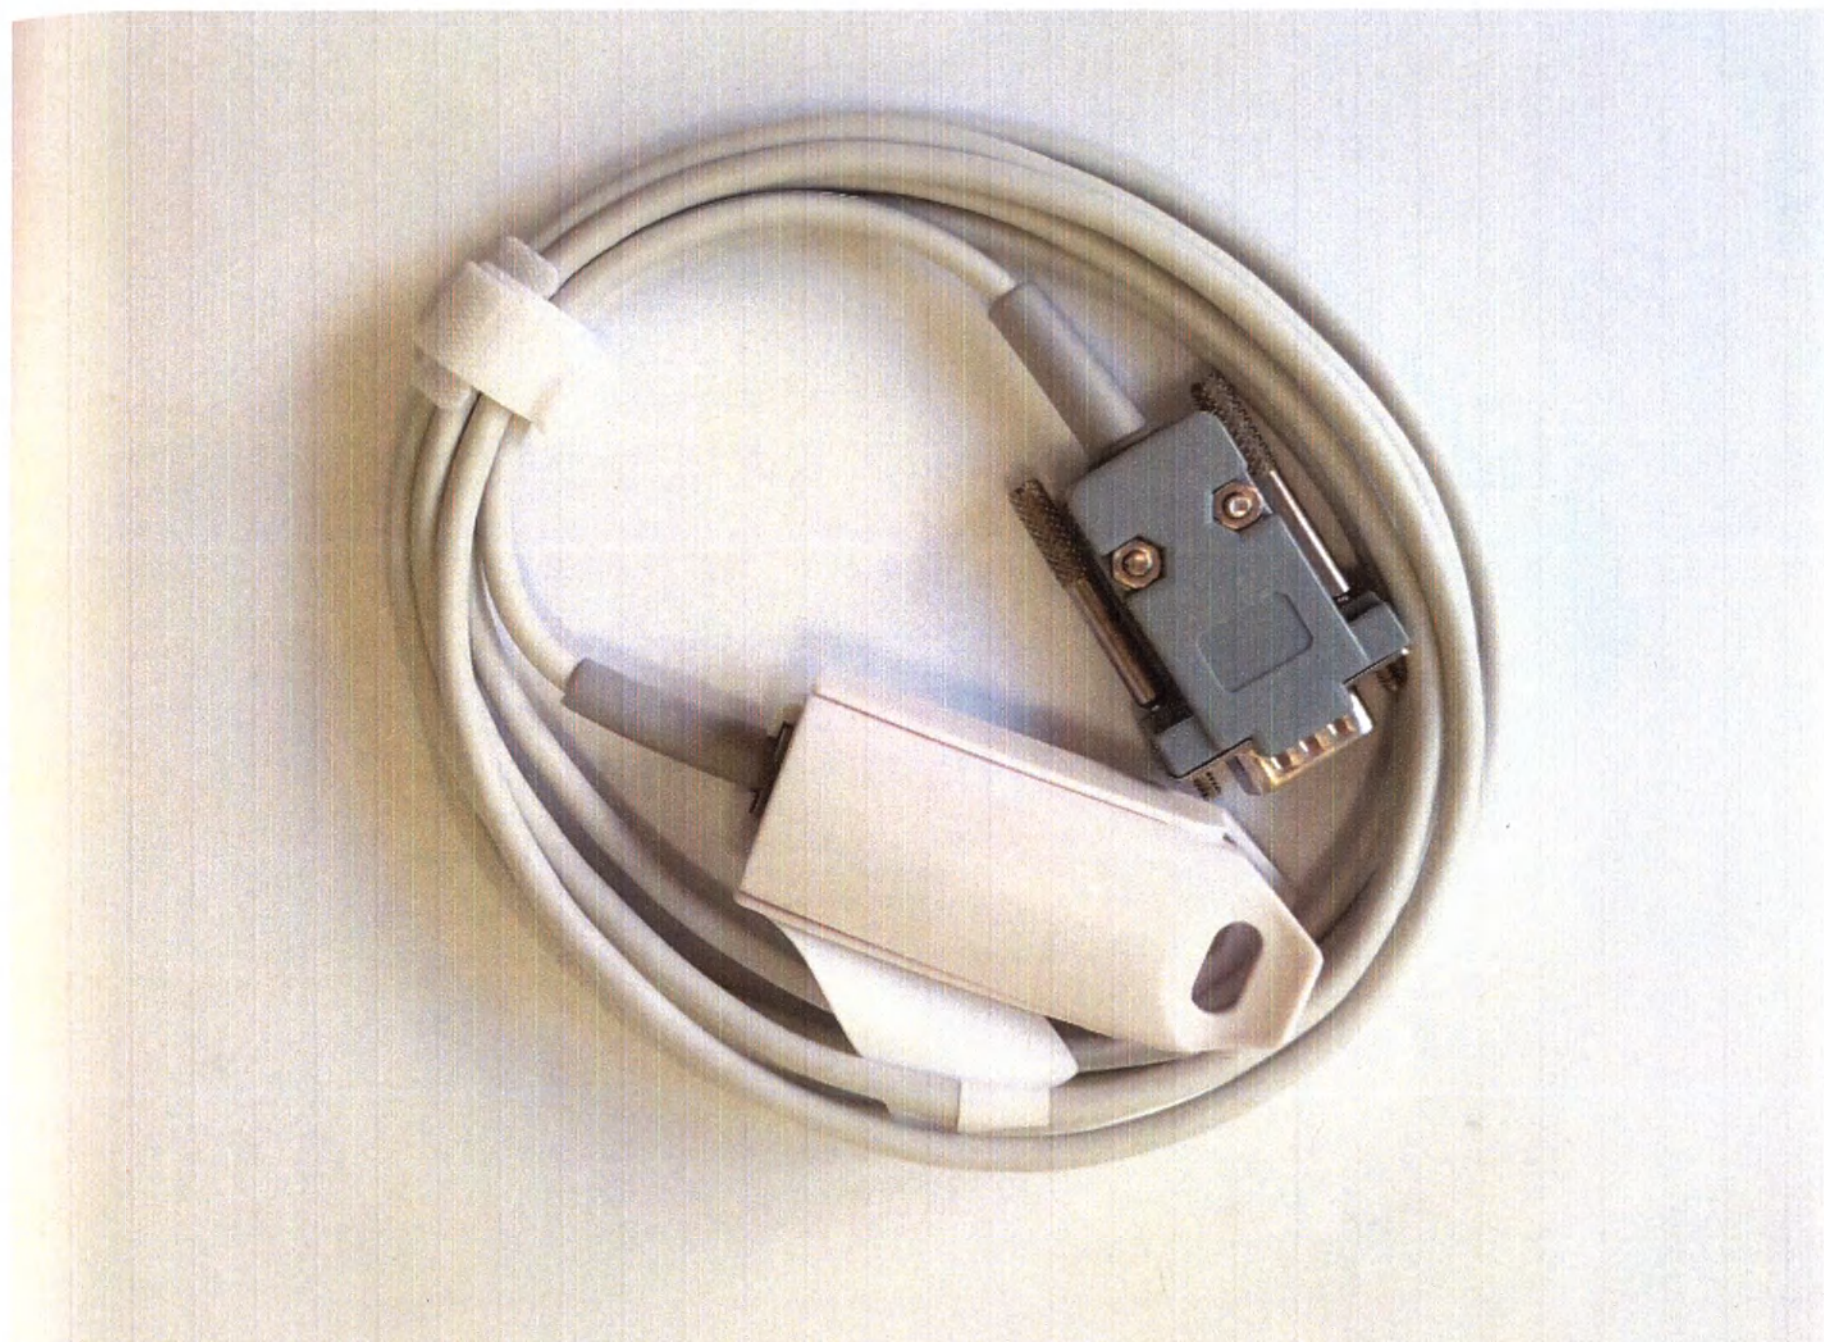

Датчик пульсоксиметрический SpO₂, взрослый, тип клипса, длинный кабель
ES-LA010, коннектор Oxite A1414 совместим с Nellcor Non-OxiMax DB9M



REF ES-LA010 (#H1574)



Для подключения датчика может потребоваться
кабель-переходник (приобретается отдельно)

Для взрослых >30КГ

LOT



Произведен Shenzhen EMS LIFE Technology Co., Limited
No. 02, 4F, No. 145-7, Furui Road, Tayong Industrial Park,
Fuyong Town, Baoan District, Shenzhen, P.R. China

РУ ММ РЗН 2015/2683
от 15/07/2015
срок не ограничен

30/10/24

30/10/19

ПРИМЕР: Датчики пульсоксиметрические SpO₂, кабели-удлинители для датчиков пульсоксиметрических SpO₂: Датчик пульсоксиметрический SpO₂, взрослый, тип



Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе "АЛКОТЕКТОР" в исполнениях "Юпитер", "Юпитер-К", "Юпитер-П" по ТУ 26.60.12-001-82139963-2011: Исполнение

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU «Юпитер», производства ООО «АЛКОТЕКТОР», Россия, РУ №ФСР 2012/13090



МАРКИРОВКА: Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе "АЛКОТЕКТОР" в исполнениях "Юпитер", "Юпитер-К", "Юпитер-П"



Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе «АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch-M» с принадлежностями, производства «Шеньжень Велл Электрик Кампании Лтд.»,



АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch-M
1. Для включения/выключения нажмите и удерживайте кнопку 
2. Выбирайте нужный пункт меню, касаясь экранов стилусом или пальцем.
3. При выполнении действия «Дует» дуйте в мундштук, пока экран не погаснет.
Адрес: ООО «АЛКОТЕКТОР», Р/У №ФСЗ 2011/10061
Адрес: Шеньчжень Велл Электрик Кампании Лтд., Китай
2022 128778


АЛКОТЕКТОР: Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе «АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch-M» с принадлежностями, производства «Шеньчжень Велл Электрик Кампании Лтд.», Китай, РУ №ФСЗ 2011/10061



Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе Динго с принадлежностями, вариант исполнения: Динго E-200 (В), производства «Сентек Корея Корп.», Корея, РУ №РЗН 2014/1689




МАРКИРОВКА: Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе Динго с принадлежностями, вариант исполнения: Динго Е-200 (В), производства «Сентек Корея Корп.», Корея, РУ №РЗН 2014/1689

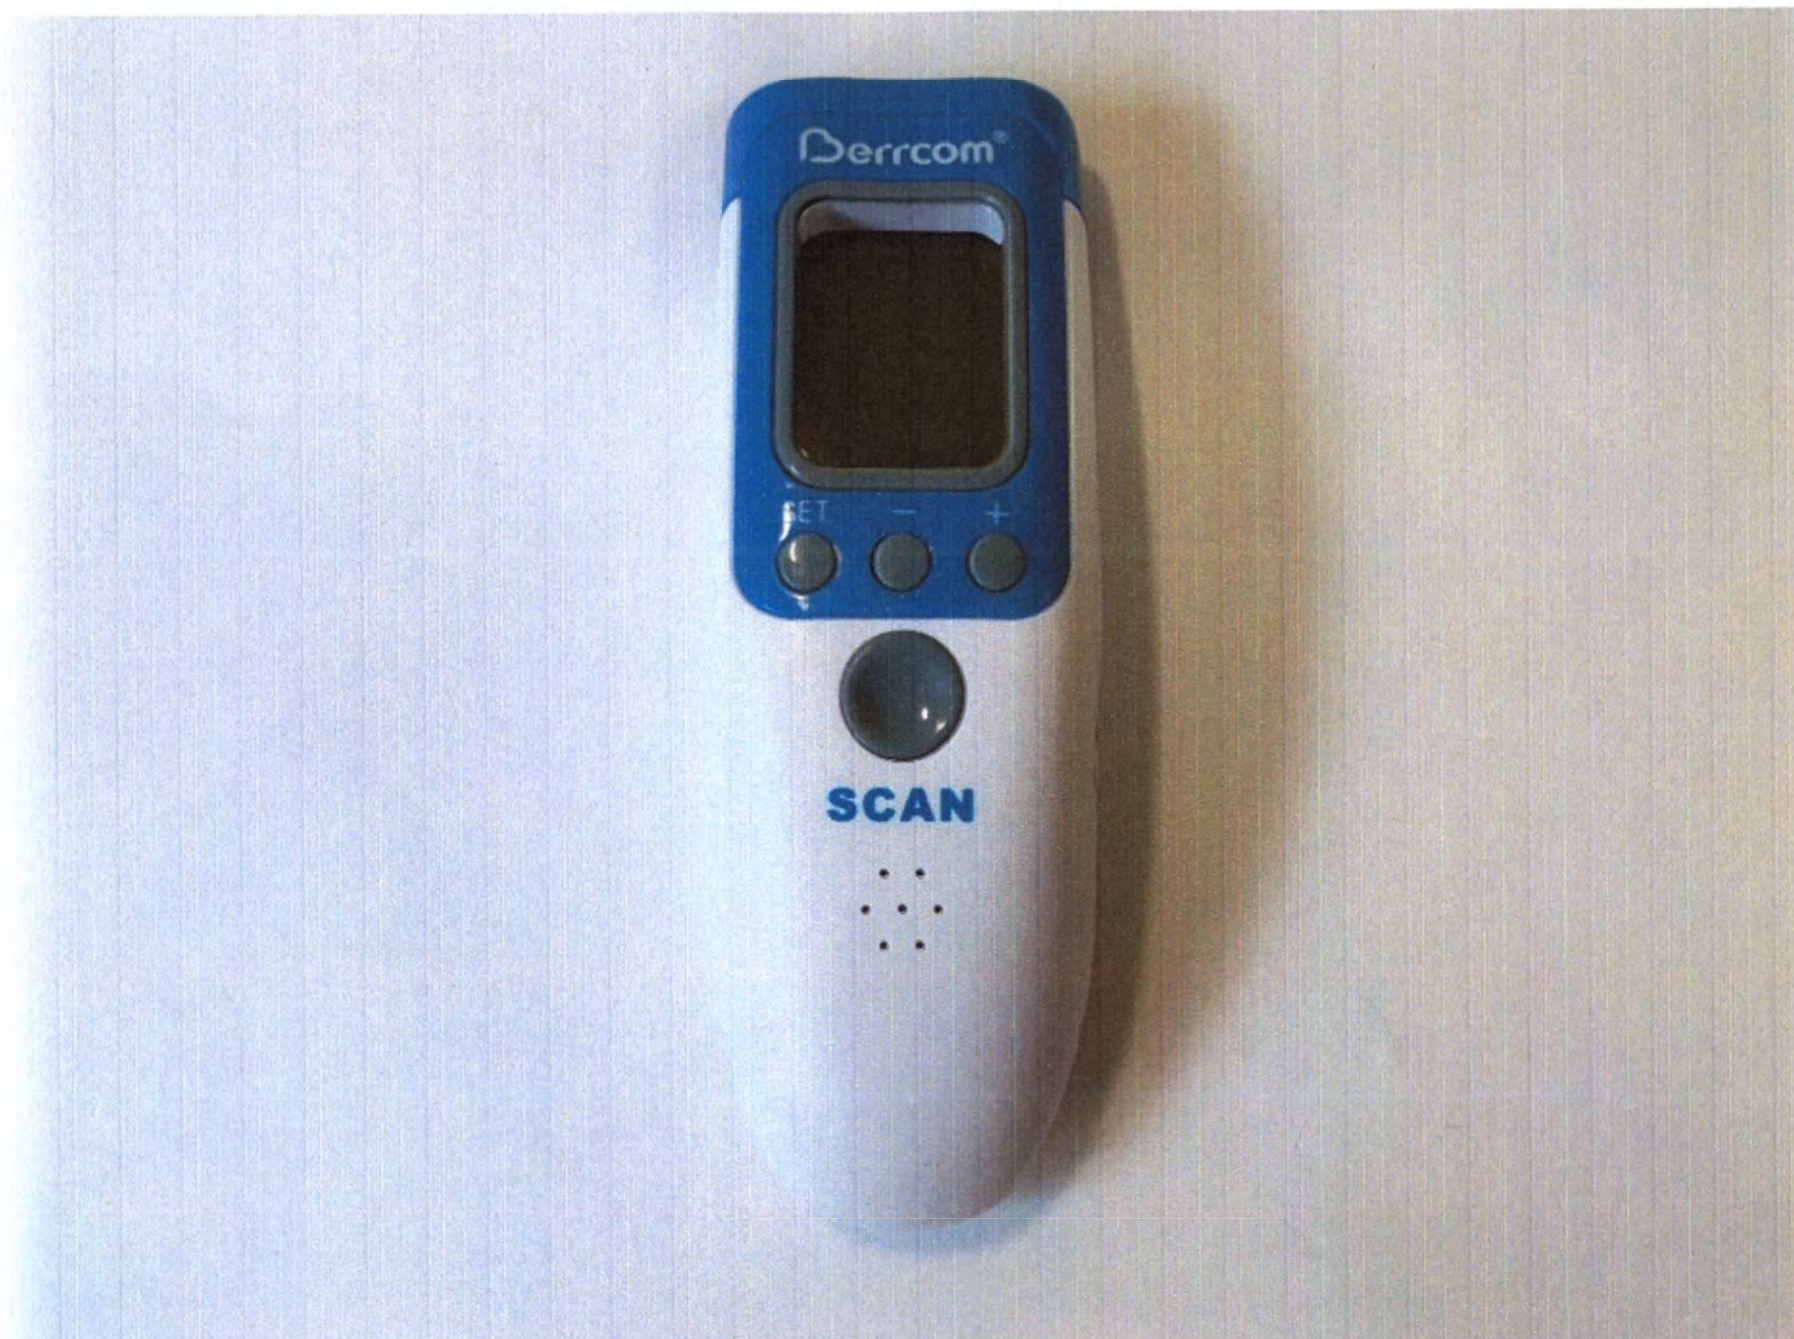

10 Бесконтактный инфракрасный термометр Derrcom, вариант исполнения JXB-183, производства «Джинхинбао Электроник Ко, Лтд», Китай,



МАРКИРОВКА: Бесконтактный инфракрасный термометр Вегсом, вариант исполнения JXB-183, производства «Джинхинбао Электроник Ко, Лтд», Китай, РУ №РЗН 2013/737

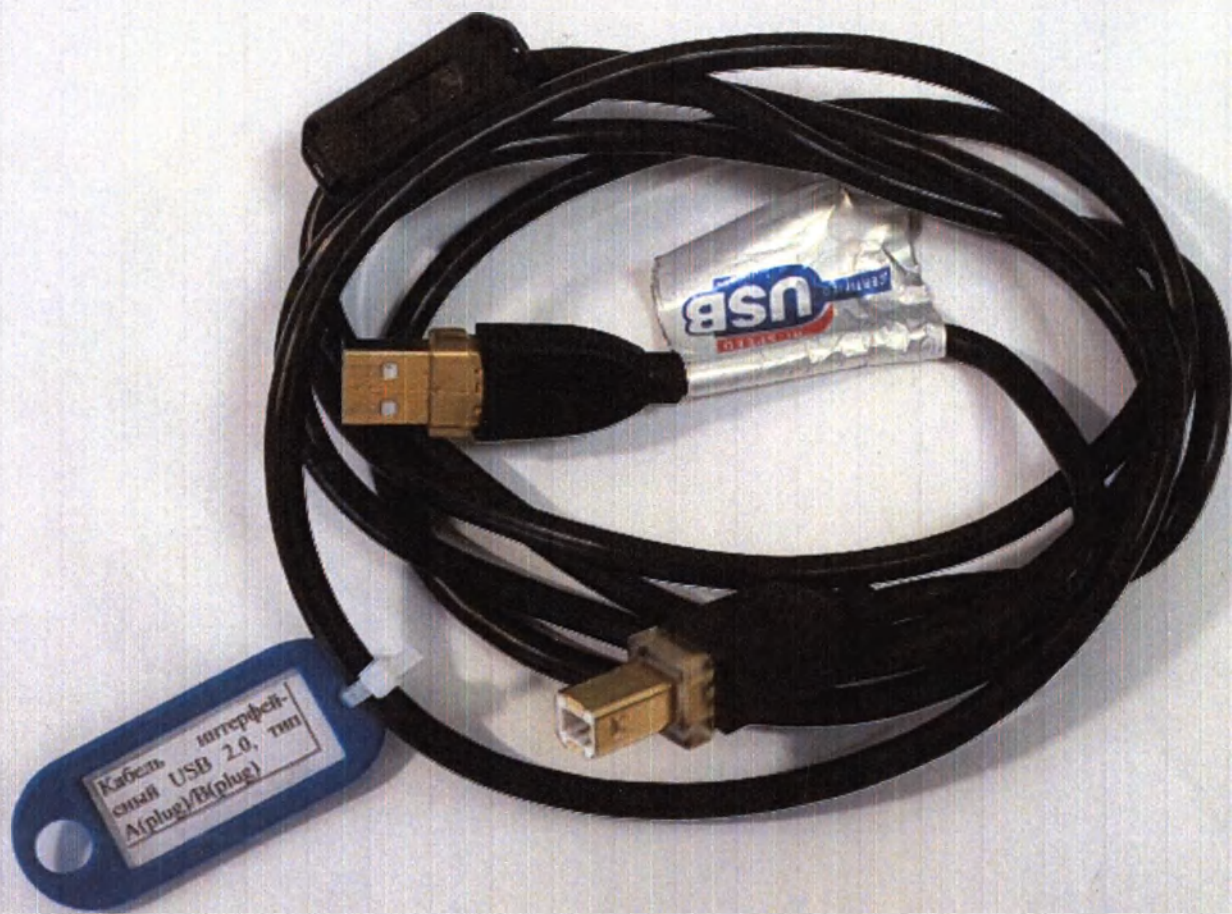


Кабель интерфейсный USB 2.0, тип A(plug)/B(plug)


Кабель интерфейсный USB 2.0, тип A(plug)/B(plug), производства «Ningbo Ousheng Electric Co., Ltd», Китай, или производства «5Bites Systems Ltd.», Китай, или производства ООО «КОМПАНИЯ АТКОМ», Россия, или производства «Bion Expert», Китай, или производства «Gembird Software Ltd.», Голландия, или производства ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU 1-ИНВЕСТ», Россия, или производства АО «ПЗКМК», Россия, или производства «Hyperline Systems Canada Ltd.», Канада, или производства «Premier Cable», Китай, или производства «Hama GmbH & Co. KG», Германия



Шнур сетевой, тип CEE 7/7 - IEC 60320 C13, производства «Ningbo Ousheng Electric Co., Ltd», Китай, или производства «5Bites Systems Ltd.», Китай, или производства «КОМПАНИЯ АТКОМ», Россия, или производства «Bion Expert», Китай, или производства «Gembird Software Ltd.», Голландия, или производства «ExeGate», Россия, или производства АО «ПЗКМК», Россия, или производства «Hyperline Systems Canada Ltd.», Канада, или производства «Premier Cable», Китай

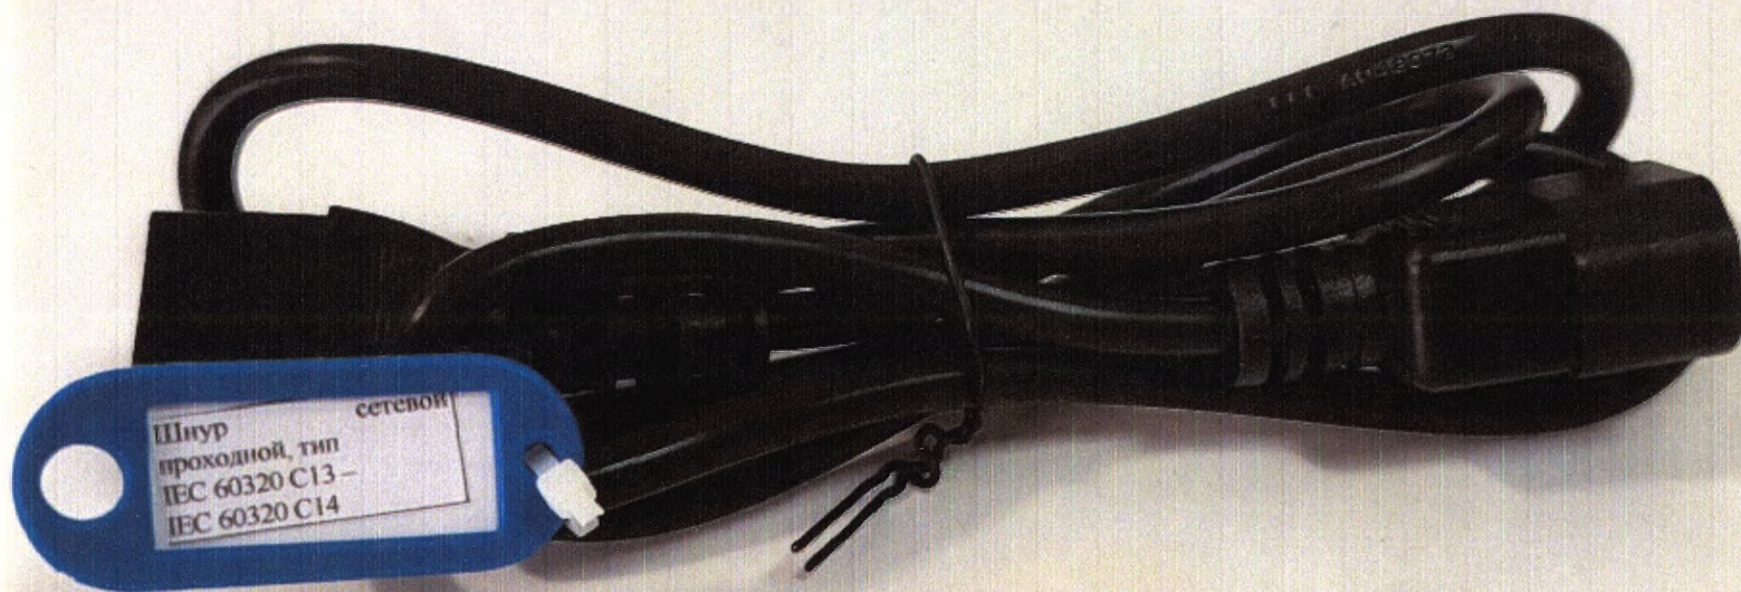

Шнур сетевой проходной, тип IEC 60320 C13 - IEC 60320 C14, производства «Ningbo Ousheng Electric Co., Ltd», Китай, или производства «5Bites Systems Ltd.», Китай, производства ООО «КОМПАНИЯ АТКОМ», Россия, или производства «Bion Expert», Китай, или производства «Gembird Software Ltd.», Голландия, или производства ООО «М-ИНВЕСТ», Россия, или производства АО «ПЗКМК», Россия, или производства «Hyperline Systems Canada Ltd.», Канада, производства «Premier Cable», Китай

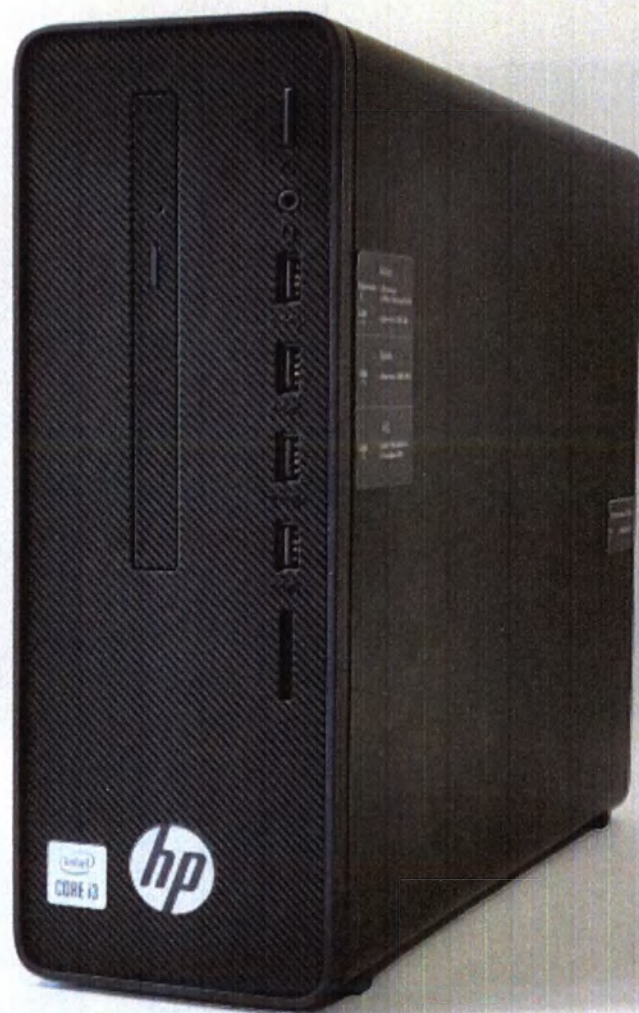


Персональный компьютер с предустановленным клиентским программным обеспечением, марки «HP», производства «HP Inc.», США, или марки «XCOMputer» по ТУ 14-001-76557231-2022, производства ООО «М-ИНВЕСТ», Россия, или марки «XComPuter» по ТУ 26.20.13-000-003-99599118-2018, производства ООО «М-ИНВЕСТ», или марки «VEKUS» по ЦДТВ.466219.001 ТУ, производства ООО «ЦКТ «ВЕКУС», Россия, или марки «iRU» по ЛПГР.466219.002 ТУ (ТУ 26.20.15-002-90521719-2019), или марки «Acer», производства «Acer Inc.», Китай, или марки «Lenovo», производства «Lenovo Group Limited», Китай, или «MSI», производства «Micro-Star International Co., Ltd.», Китай

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




Монитор, марки «ASUS», производства «ASUSTek Computer Inc.», Китай, или марки «Dell», производства «Wistron Corporation», Китай, или марки «Acer», производства «Acer Inc.», Китай, или марки «Benq», производства «Benq Corporation», Китай, или марки «HP», производства «HP Inc.», США, или марки «LG», производства «LG Electronics», Республика Корея, или марки «Samsung», производства «Samsung Electronics Co., Ltd.», Республика Корея, или марки «Iiyama», производства «Iiyama Corporation», Нидерланды, или марки «MSI», производства «Micro-Star International Co., Ltd.», Китай, или марки «Philips», производства «MMD (Shanghai) Electronics Co., Ltd.», Китай, или марки «ViewSonic», производства «ViewSonic Corporation», США, или марки «NEC», производства «Nippon Electric Corporation», Япония

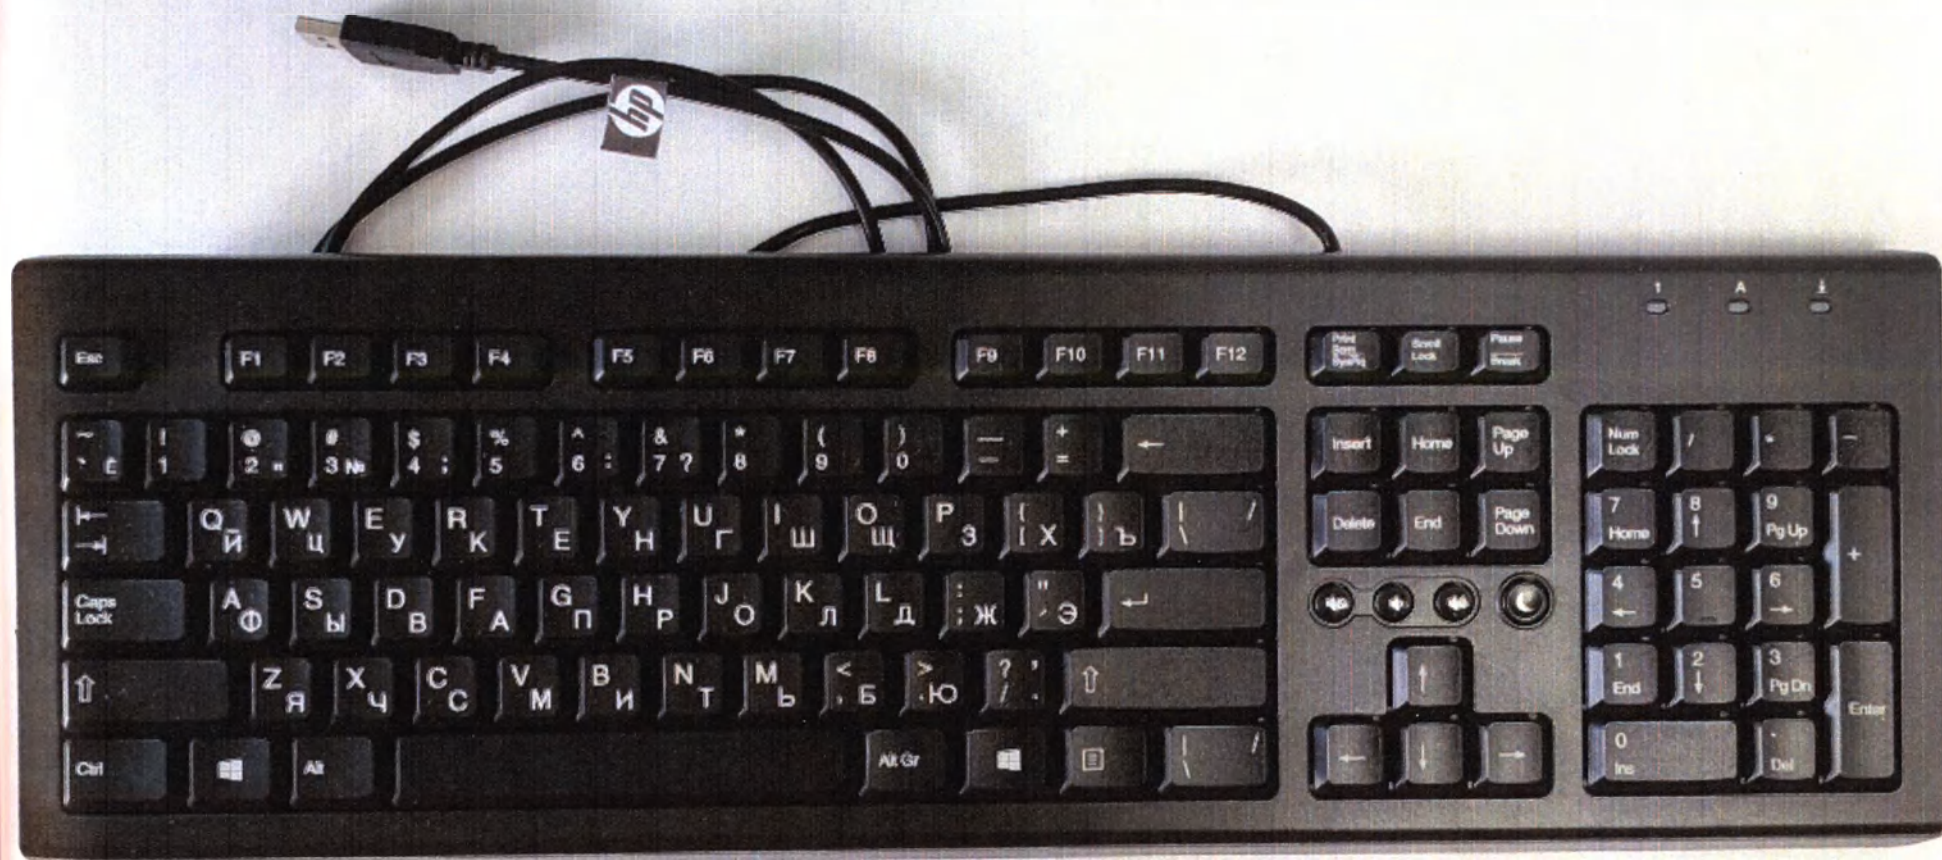


клавиатура, марки «HP», производства «HP Inc.», США, или марки «ASUS», производства «ASUSTek Computer Inc.», Китай, или марки «Acer», производства «Acer Inc.»,
 или марки «Lenovo», производства «Lenovo Group Limited», Китай, или марки «MSI», производства «Micro-Star International Co., Ltd.», Китай, или марки «Dell»,
 производства «Wistron Corporation», Китай, или марки «Logitech», производства «Logitech Europe S.A.», Швейцария, или марки «Genius», производства «KYE SYSTEMS
 P.», Китай или марки «Gembird» производства «Gembird Software Ltd.», Голландия, или марки «A4Tech», производства «A4Tech», Тайвань, или марки «HAMA»,
 производства «Hama GmbH & Co. KG», Германия, или марки «ExeGate», производства «ExeGate», Китай



мышь, марки «HP», производства «HP Inc.», США, или марки «ASUS», производства «ASUSTek Computer Inc.», Китай, или марки «Acer», производства «Acer Inc.»,
или марки «Lenovo», производства «Lenovo Group Limited», Китай, или марки «MSI», производства «Micro-Star International Co., Ltd.», Китай, или марки «Dell»,
производства «Wistron Corporation», Китай, или марки «Logitech», производства «Logitech Europe S.A.», Швейцария, или марки «Genius», производства «KYE SYSTEMS
производства «Gembird Software Ltd.», Голландия, или марки «A4Tech», производства «A4Tech», Тайвань, или марки «HAMA»,
производства «Hama GmbH & Co. KG», Германия, или марки «ExeGate», производства «ExeGate», Китай

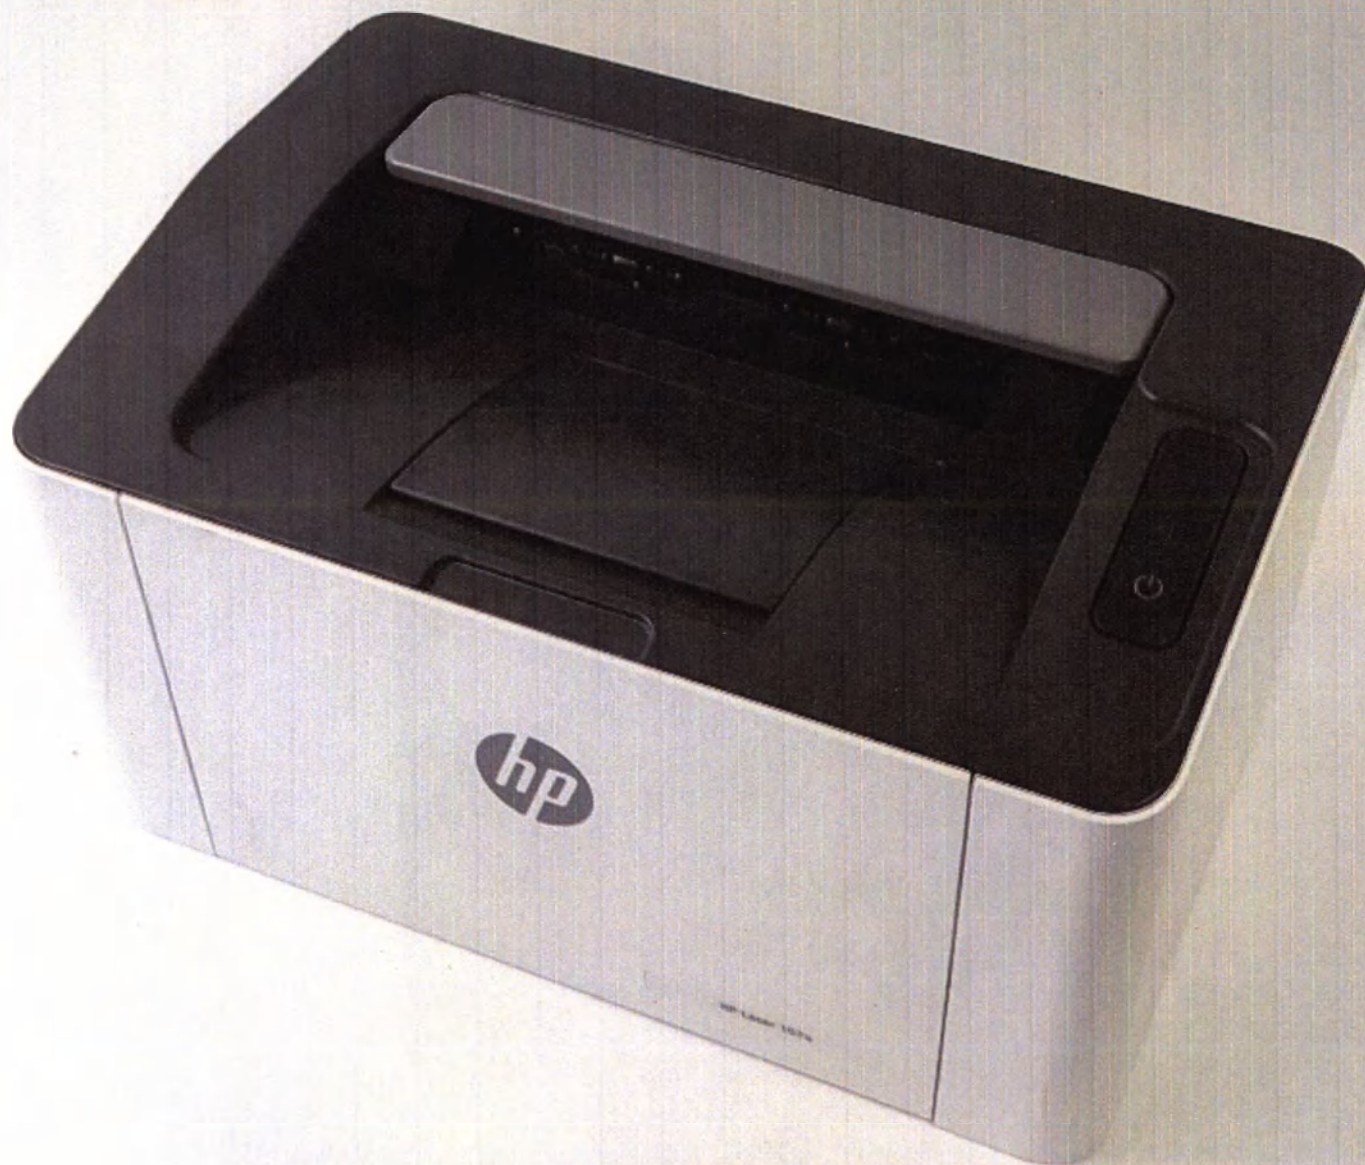


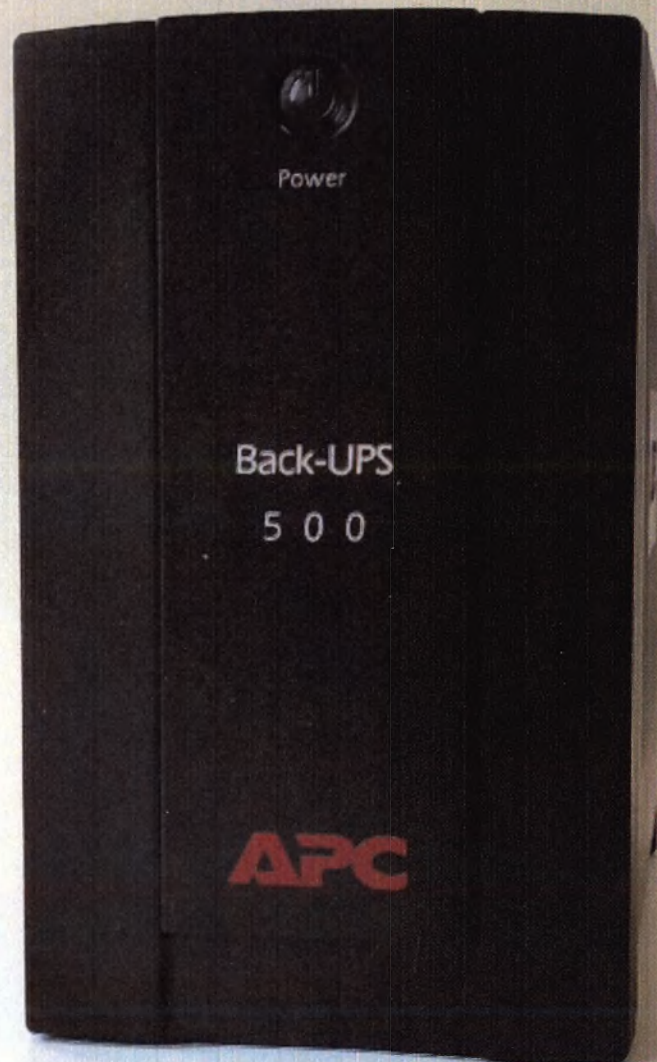

Источник бесперебойного питания, «APC», тип Back-UPS, производства «Schneider Electric Industries SAS», Франция, или «CyberPower», модели серии UTC850, или «POWERMAN» модели серии BACK PRO, производства «POWER LIMITED», Китай



20 Считыватель модель R5-USB Prof, по ТУ 4372-003-92462613-2012, производства АО «РусГард», Россия

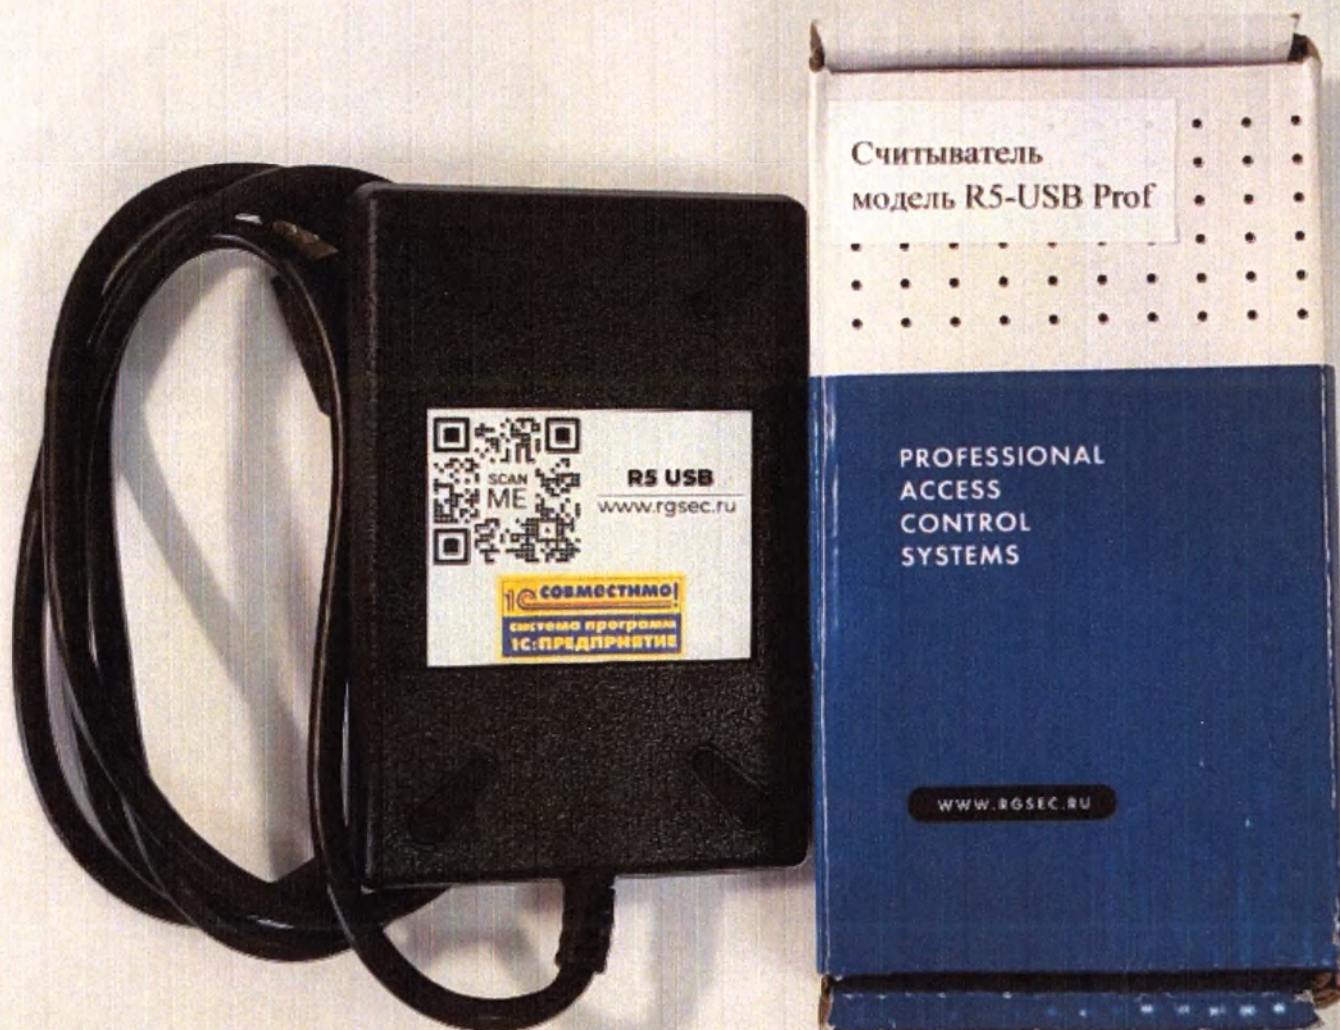


МАРКИРОВКА: Считыватель модель R5-USB Prof, по ТУ 4372-003-92462613-2012, производства АО «РусГард», Россия



21 Считыватель Z-2 модель RD_All, по ТУ 26.30.50-004-38111914-2018, производства АО «АВС», Россия



МАРКИРОВКА: Считыватель Z-2 модель RD_All, по ТУ 26.30.50-004-38111914-2018, производства АО «АВС», Россия

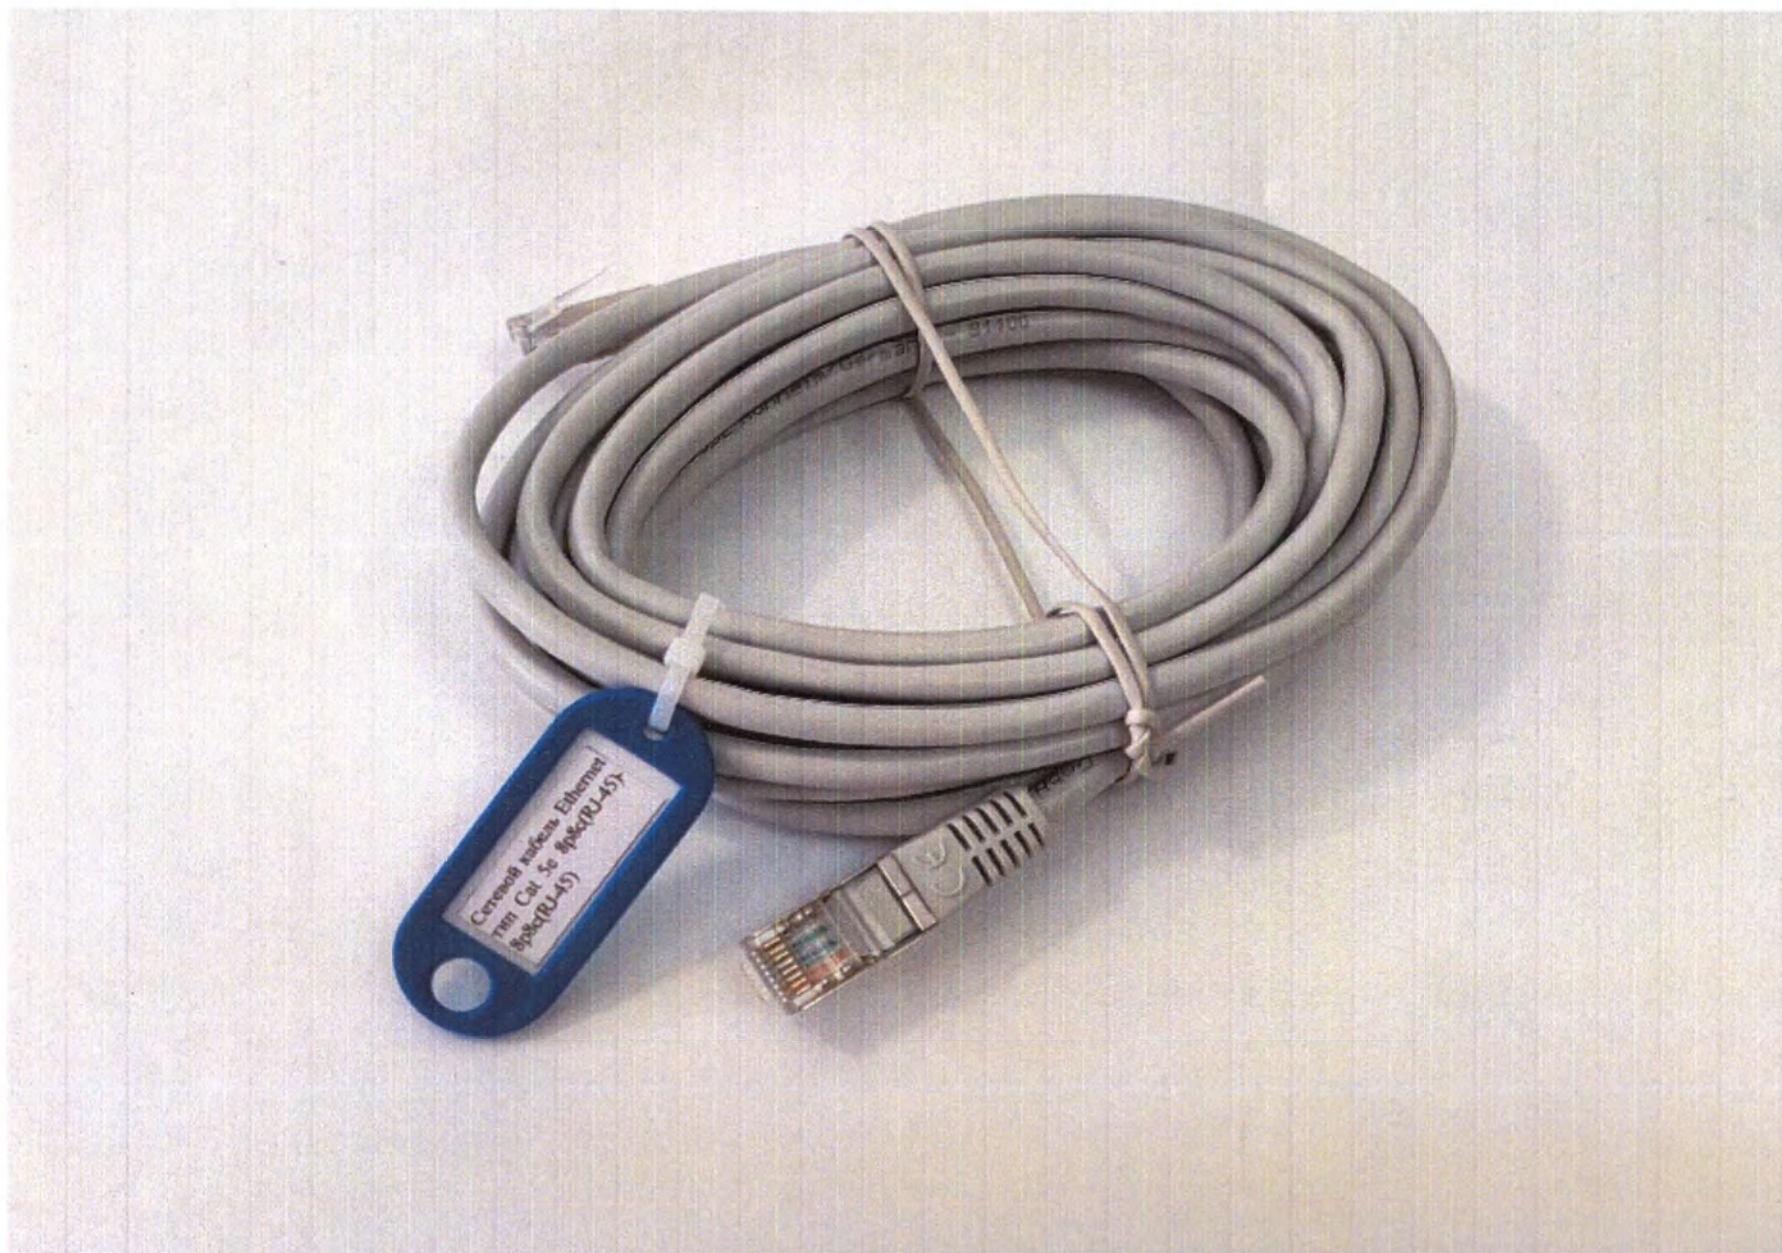

Сетевой кабель Ethernet тип Cat 5e 8p8c(RJ-45)- 8p8c(RJ-45), производства «Ningbo Ousheng Electric Co., Ltd», Китай, или производства «5Bites Systems Ltd.», Китай, производства ООО «КОМПАНИЯ АТКОМ», Россия, или производства «Bion Expert», Китай, или производства «Gembird Software Ltd.», Голландия, или производства «Gate», Китай, или производства ООО «М-ИНВЕСТ», Россия, или производства АО «ПЗКМК», Россия, или производства «Hyperline Systems Canada Ltd.», Канада, или производства «Hama GmbH & Co. KG», Германия

АО НПП «СИСТЕМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
КОМПЛЕКС АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
КАПД-02-СТ-Э

ЗАВ №

0001

ДАТА ИЗГОТ.

11.2021



U - 230±23В ~ 50Гц P - 30ВА
(с учетом подключаемых устройств
P-500 ВА)

УХЛ 4.2 IP20

ТУ 26.60.12.129-002-45520949-2021

Страна происхождения - Россия



ЭКГ

Маркировка



Фото 1: Маркировка транспортной упаковки



Фото 2: Маркировка транспортной упаковки

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью

36 (тридцать шесть) лист (об)

Руководитель организации:

М.В. Рюхин



«УТВЕРЖДАЮ»

Исполнительный директор

АО НПП «Системные технологии»

М.В. Рюхин



«03 июля» 20 23 г.

Фотографическое изображение медицинского изделия:


Комплекс аппаратно-программный
определения функционального состояния КАПД-02-СТ по ТУ 26.60.12.129-002-45520949-2021

Модификация

«Комплекс аппаратно-программный определения функционального состояния КАПД-02-СТ-А»

2023




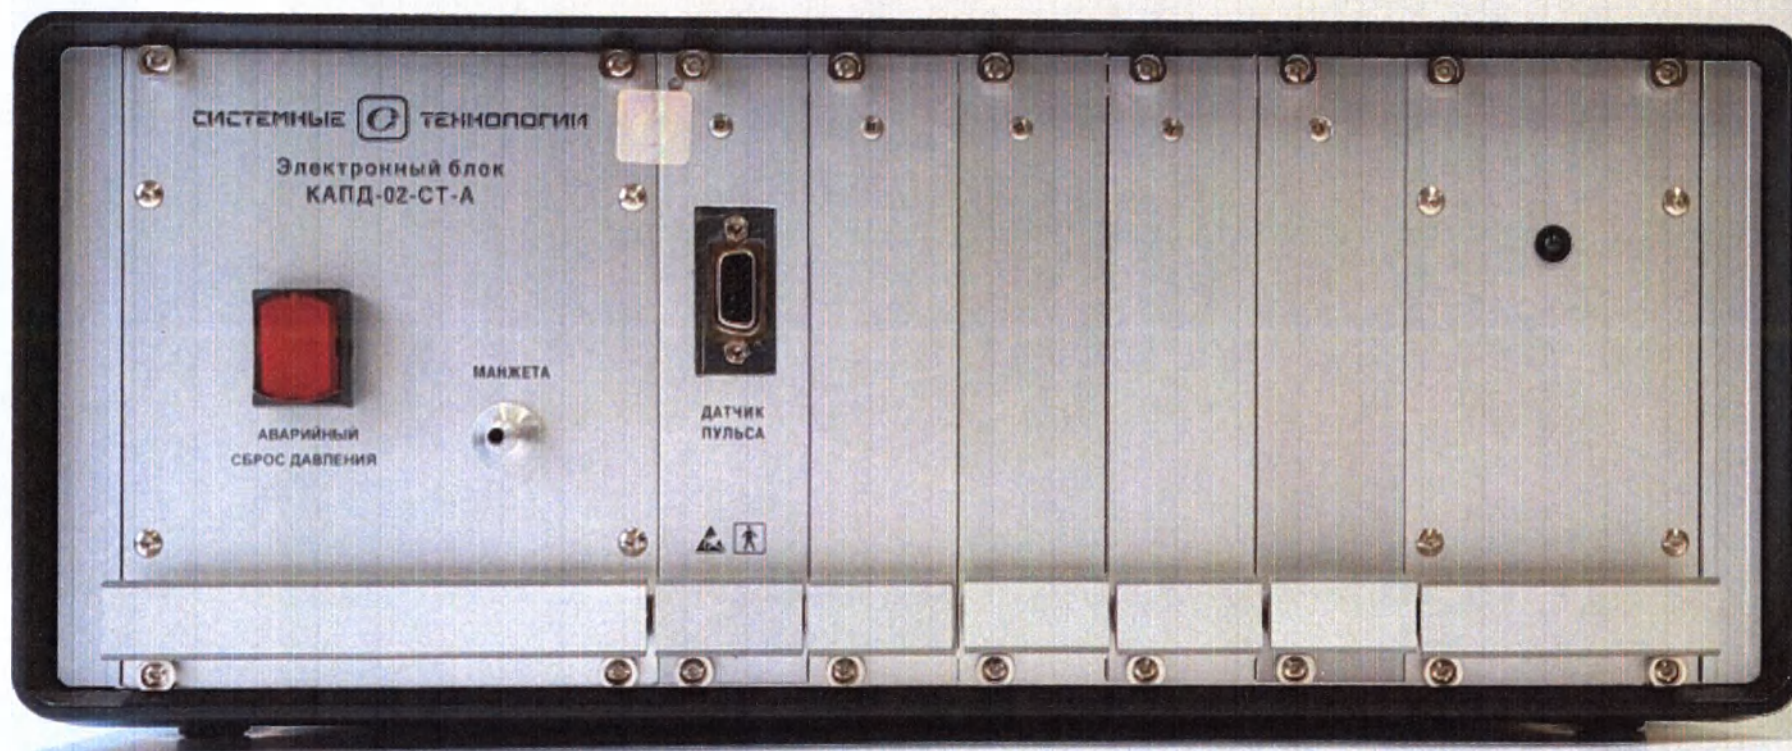

1 Электронный блок КАПД-02-СТ-А

Для точных измерений

1. Закрепите манжету плотно, но не туго
2. Манжета должна находиться выше локтевого сгиба на расстоянии 2 – 3 см
3. Резиновая трубка должна находиться над локтевой ямкой

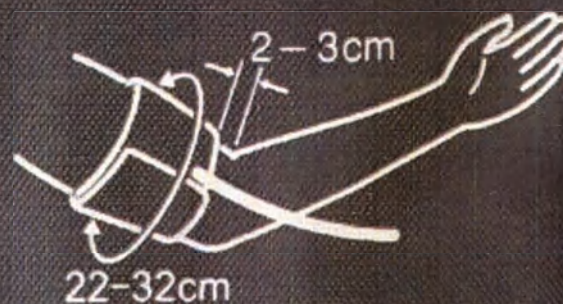


2 Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой серии UA с принадлежностями: Манжета стандартная (22-32 см), производства




Для точных измерений

1. Закрепите манжету плотно, но не туго
2. Манжета должна находиться выше локтевого сгиба на расстоянии 2 – 3 см
3. Резиновая трубка должна находиться над локтевой ямкой

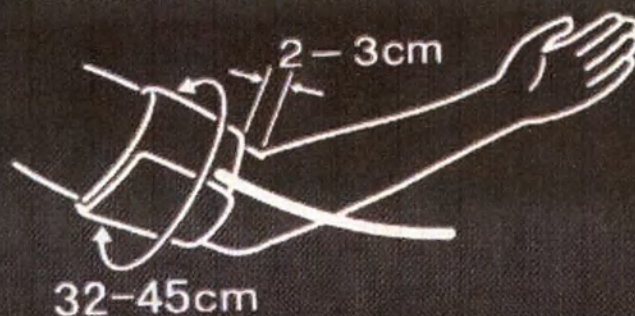

³ Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой серии UA с принадлежностями: Манжета большая (32-45 см), производства «Эй энд ДИ Компани Лимитед», Япония, РУ №ФСЗ 2011/09642

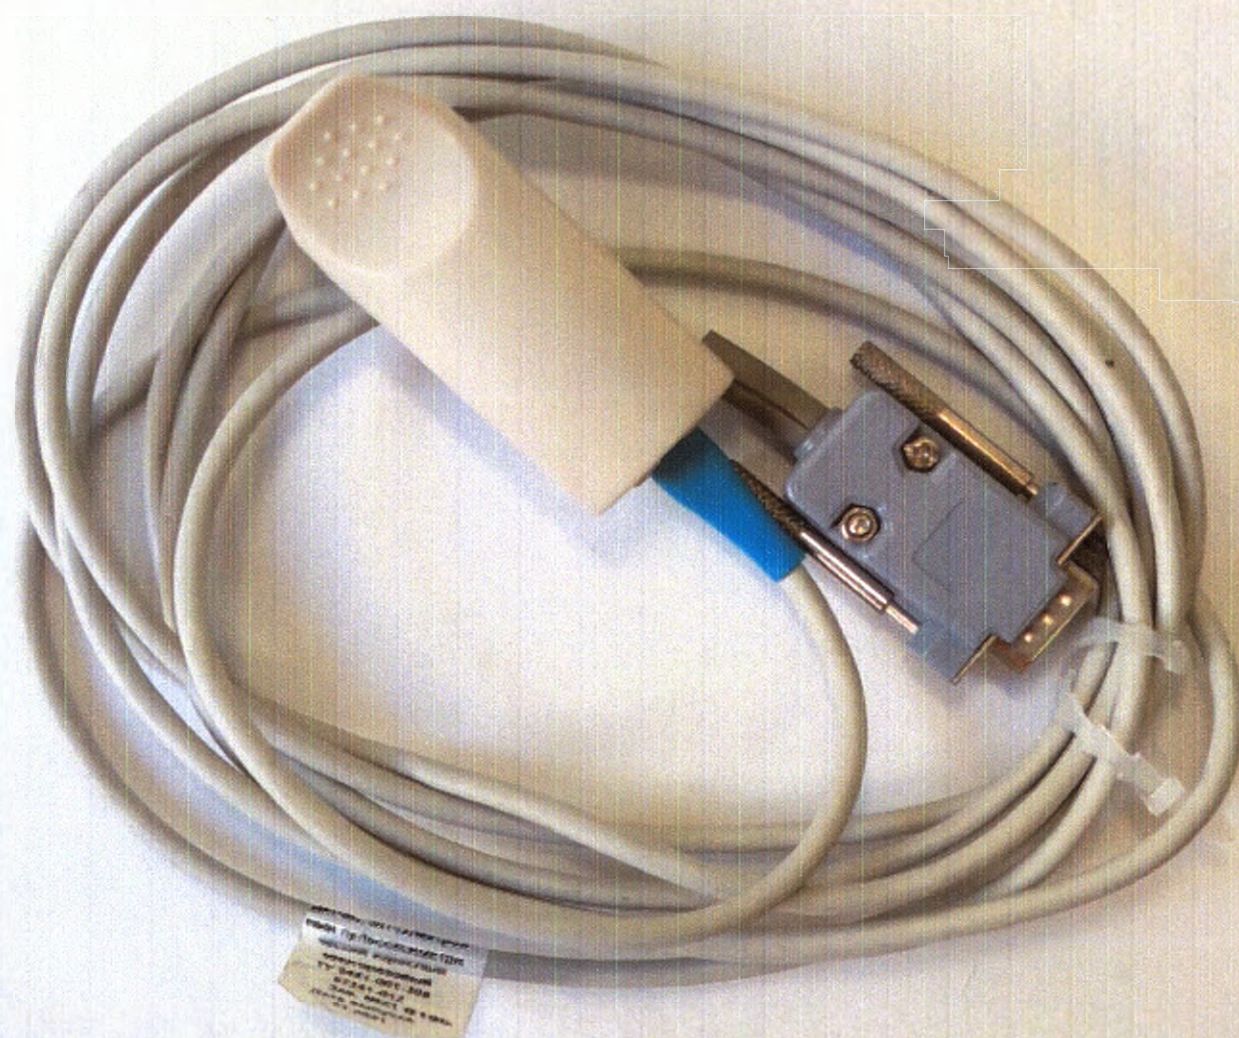


4 Датчики оптоэлектронные пульсоксиметрические взрослые и неонатальные многоцветные по ТУ 9441-001-30857241-2012: Датчик оптоэлектронный

ООО ЦИРМИ [INFO@CIRMI.RU](mailto:info@cirmi.ru) WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU взрослый многоцветный, артикул ДАСМ. 012.542.1, производства ООО «Аксиома», Россия, РУ №РЗН 2013/658



МАРКИРОВКА: Датчики оптоэлектронные пульсоксиметрические взрослые и неонатальные многоцветные по ТУ 9441-001-30857241-2012: Датчик

ООО ЦРМИ info@cirmi.ru www.goszdravnadzor.ru оптоэлектронный пульсоксиметрический взрослый многоцветный, артикул ДАСМ. 012.542.1, производства ООО «Аксиома», Россия, РУ №РЗН 2013/658

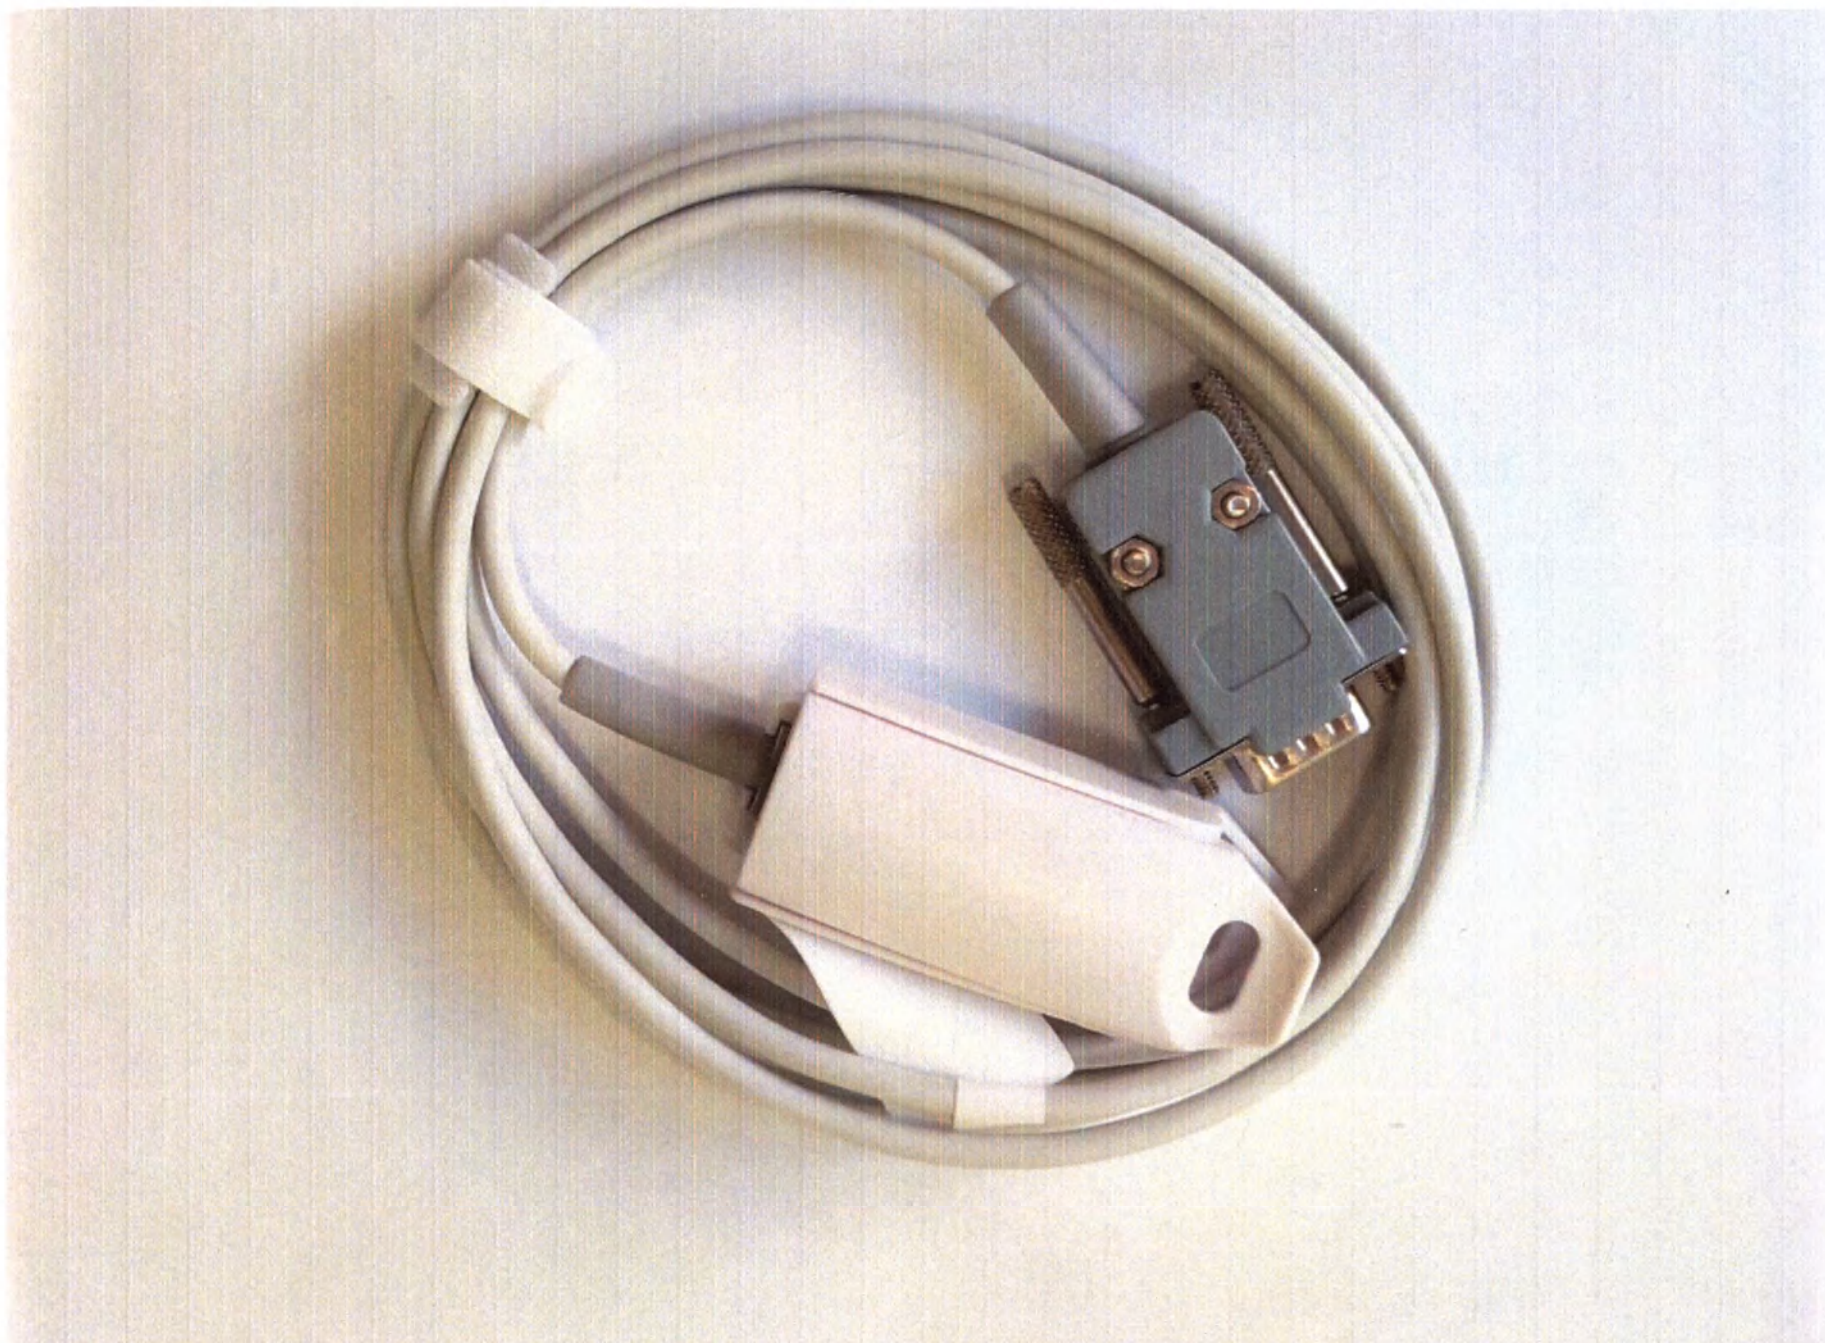

5 Датчики пульсоксиметрические SpO₂, кабели-удлинители для датчиков пульсоксиметрических SpO₂: Датчик пульсоксиметрический SpO₂, взрослый, тип



Датчик пульсоксиметрический SpO₂ взрослый, тип клипса, длинный кабель
ES-LA010, коннектор OxiMax 1414, совместим с Nellcor Non-OxiMax DB9M




REF ES-LA010 (#H: 1574)



Для подключения датчика может потребоваться
кабель-переходник (приобретается отдельно)

Для взрослых >30КГ



Произведен Shenzhen EMS LIFE Technology Co., Limited
No. 02, 4F, No. 145-7, Furui Road, Tayong Industrial Park,
Fuyong Town, Baoan District, Shenzhen, P.R. China

РУ МИ РЗН 2015/2683
от 15/07/2015
срок не ограничен

30/10/24

30/10/19

МАРКИРОВКА: Датчики пульсоксиметрические SpO₂, кабели-удлинители для датчиков пульсоксиметрических SpO₂: Датчик пульсоксиметрический SpO₂,

длинный кабель ES-LA010, производства «Шеньжень ЕМС ЛАЙФ Текнолоджи Ко., Лтд.», КНР, РУ №РЗН 2015/2683



6 Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе "АЛКОТЕКТОР" в исполнениях "Юпитер", "Юпитер-К", "Юпитер-П" по ТУ 26.60.12-001-82139963-2011:

Исполнение «Юпитер», производства ООО «АЛКОТЕКТОР», Россия, РУ №ФСР 2012/13090



МАРКИРОВКА: Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе "АЛКОТЕКТОР" в исполнениях "Юпитер", "Юпитер-К", "Юпитер-П"



7 Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе «АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch-M» с принадлежностями, производства «Шеньчжень Велл Электрик Кампании Лтд.», Китай, РУ №ФСЗ 2011/10061




ALKOTECTOR PRO-100 touch-M

1. Для включения/выключения нажмите и удерживайте кнопку.
 2. Выберите нужный пункт меню, касаясь экранов стилусом или пальцем.
 3. При сканировании мерцающей лампы нажмите и удерживайте кнопку, пока не появится результат.
- Алкотекс ООО «АЛКОТЕКТОР» 8127 320-22-37
Источники: Shenzhen Weil Electric Co., Ltd.


2022

128778

МАРКИРОВКА: Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе «АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch-M» с принадлежностями, производства «Шеньчжень Велл Электрик Кампании Лтд.», Китай, РУ №ФСЗ 2011/10061

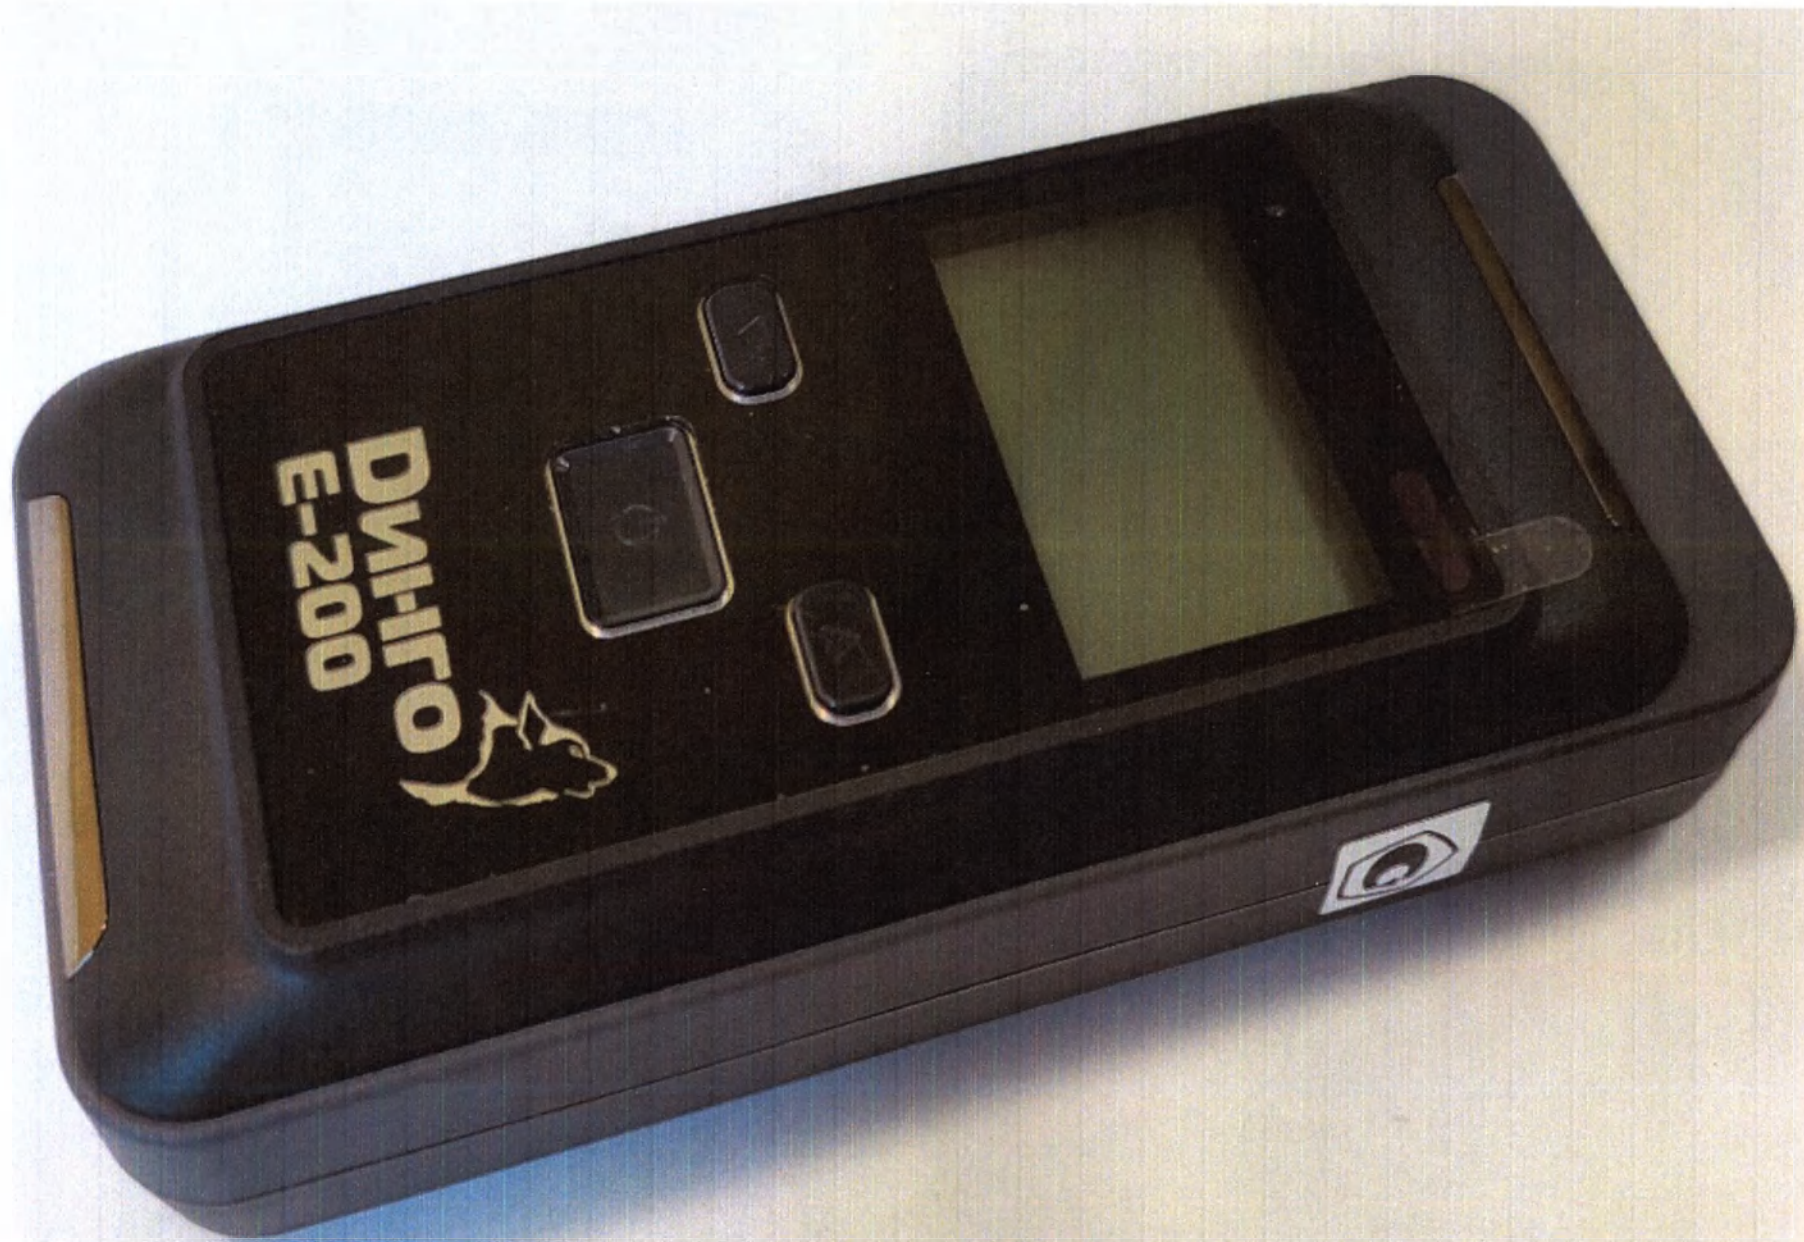

8 Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе Динго с принадлежностями, вариант исполнения: Динго E-200 (В), производства «Сентек Корея Корп.», Корея, РУ №РЗН 2014/1689

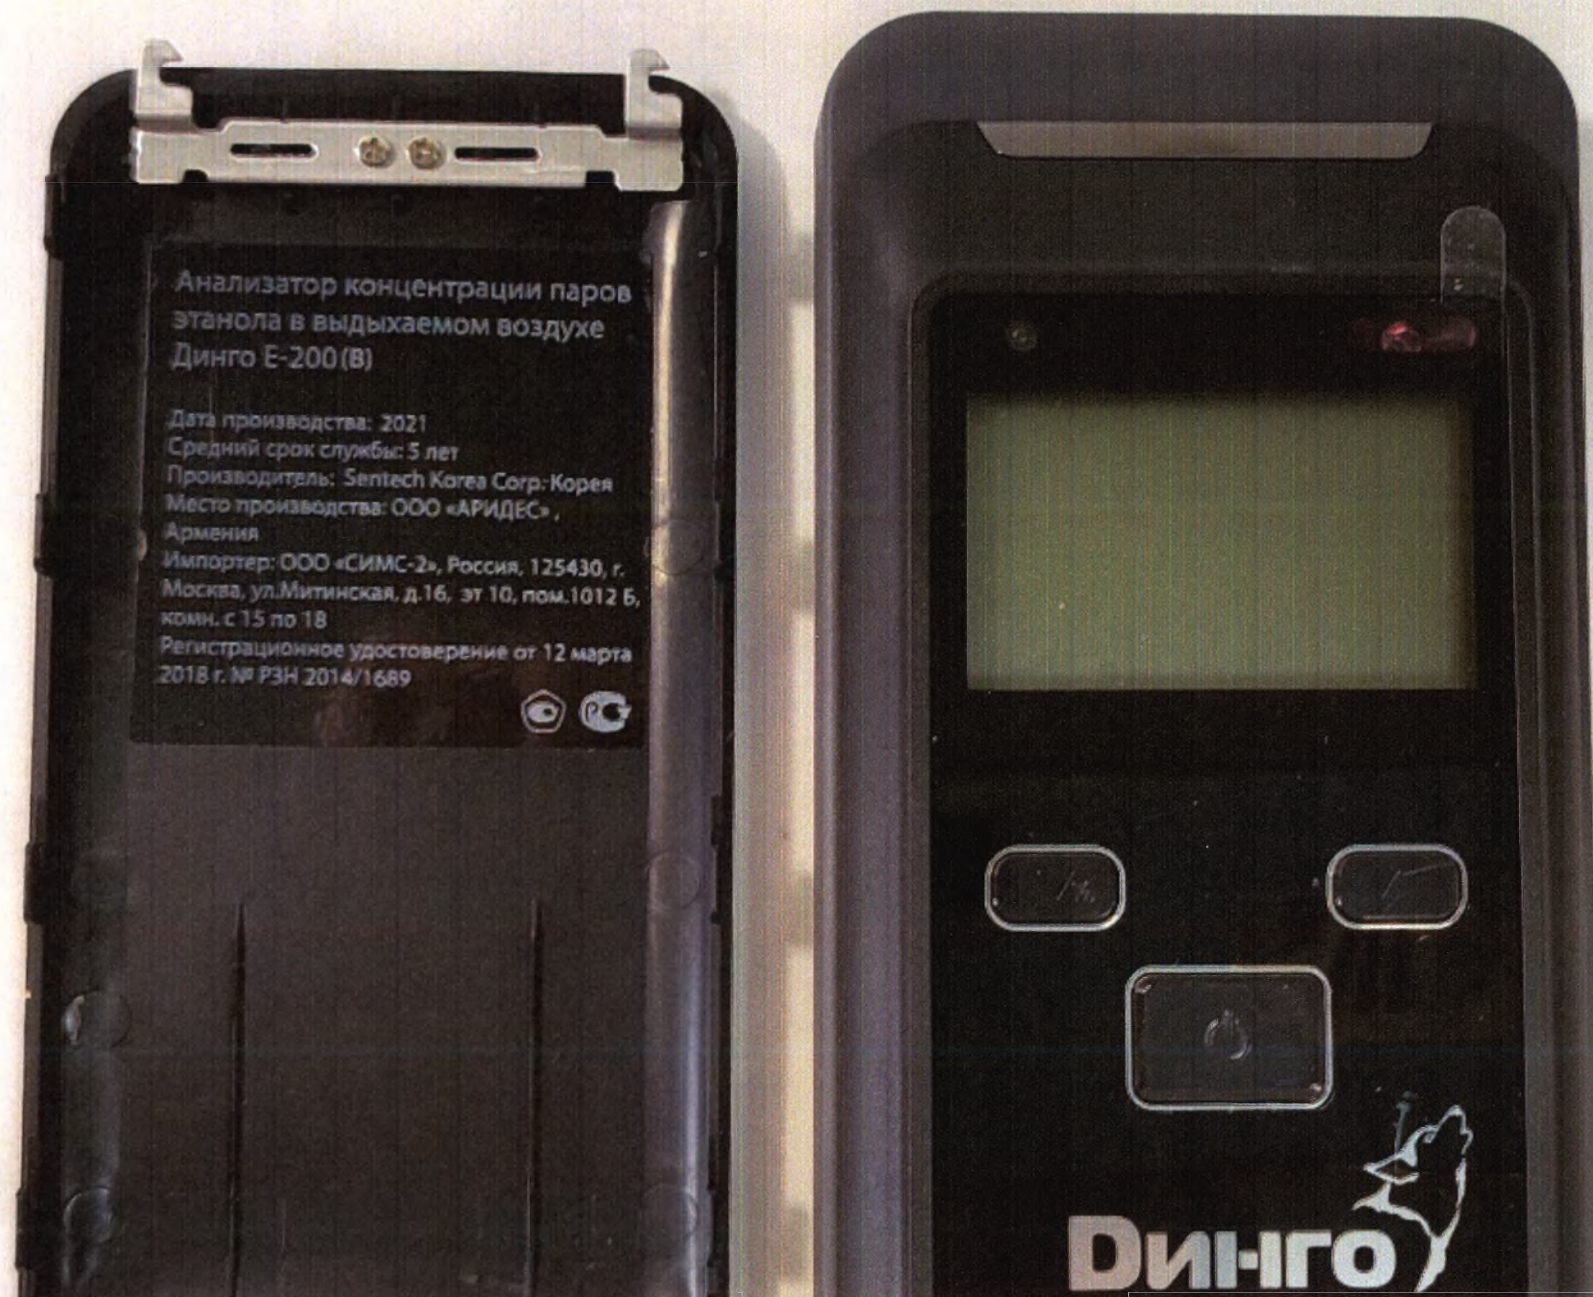

МАРКИРОВКА: Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе Динго с принадлежностями, вариант исполнения: Динго Е-200 (В), производства «Сентек Корея Корп.», Корея, РУ №РЗН 2014/1689




9 Бесконтактный инфракрасный термометр Bercom, вариант исполнения JXB-183, производства «Джинхинбао Электроник Ко, Лтд», Китай,

ПУ №ПЗН 2013/737




МАРКИРОВКА: Бесконтактный инфракрасный термометр Bettsom, вариант исполнения JXB-183, производства «Джинхинбао Электроник Ко, Лтд», Китай, РУ №РЗН 2013/737

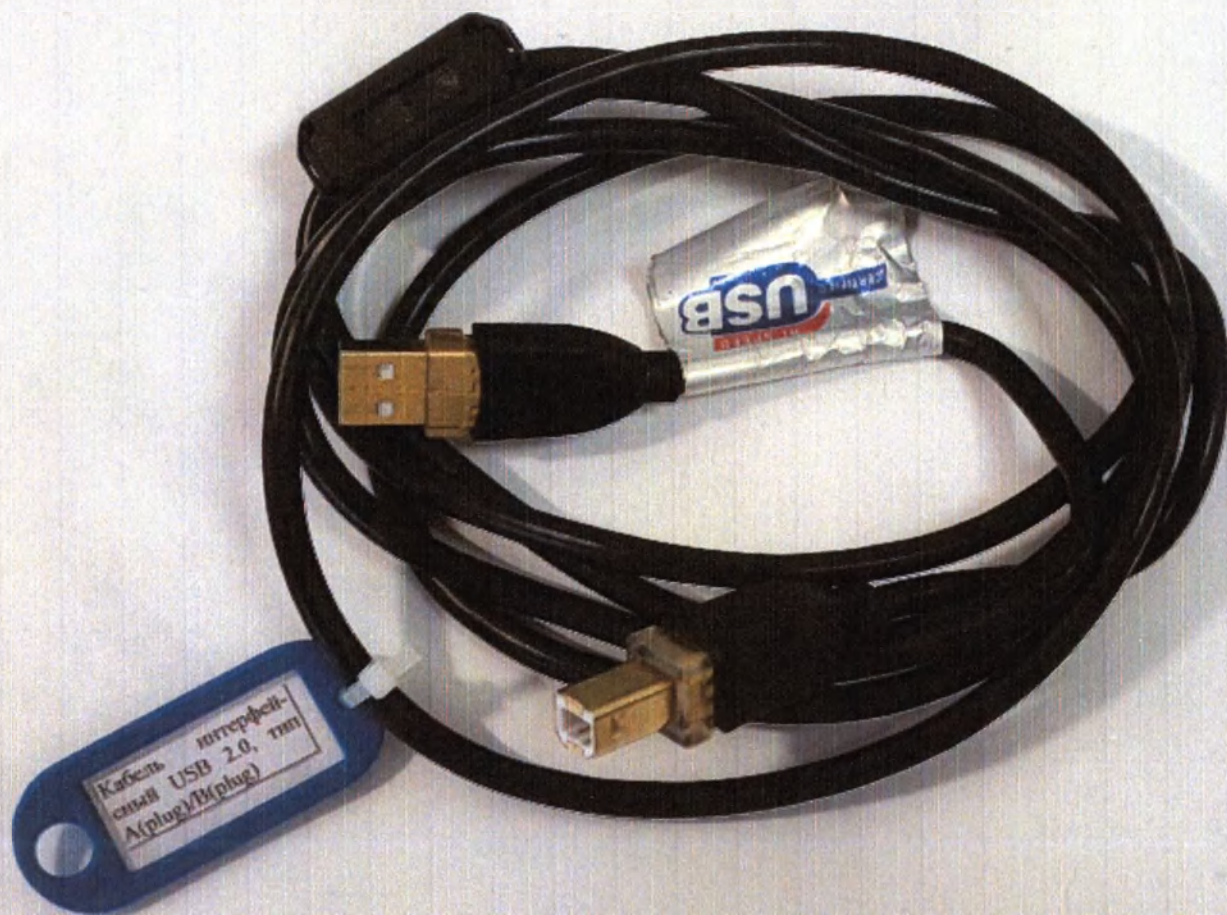

10 Кабель интерфейсный USB 2.0, тип A(plug)/B(plug), производства «Ningbo Ousheng Electric Co., Ltd», Китай, или производства «5Bites Systems Ltd.», Китай, или производства ООО «КОМПАНИЯ АТКОМ», Россия, или производства «Bion Expert», Китай, или производства «Gembird Software Ltd.», Голландия, или производства ООО «М-ИНВЕСТ», Россия, или производства АО «ПЗКМК», Россия, или производства «Hyperline Systems Canada Ltd.», Канада, или производства «Premier Cable», Китай, или производства «Hama GmbH & Co. KG», Германия




11 Шнур сетевой, тип CEE 7/7 - IEC 60320 C13, производства «Ningbo Ousheng Electric Co., Ltd», Китай, или производства «5Bites Systems Ltd.», Китай, или производства ООО «КОМПАНИЯ АТКОМ», Россия, или производства «Bion Expert», Китай, или производства «Gembird Software Ltd.», Голландия, или производства ООО «ЦИРМИ» INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU или производства ООО «М-ИНВЕСТ», Россия, или производства АО «ПЗКМК», Россия, или производства «Hyperline Systems Canada Ltd.», Канада, или производства «Premier Cable», Китай

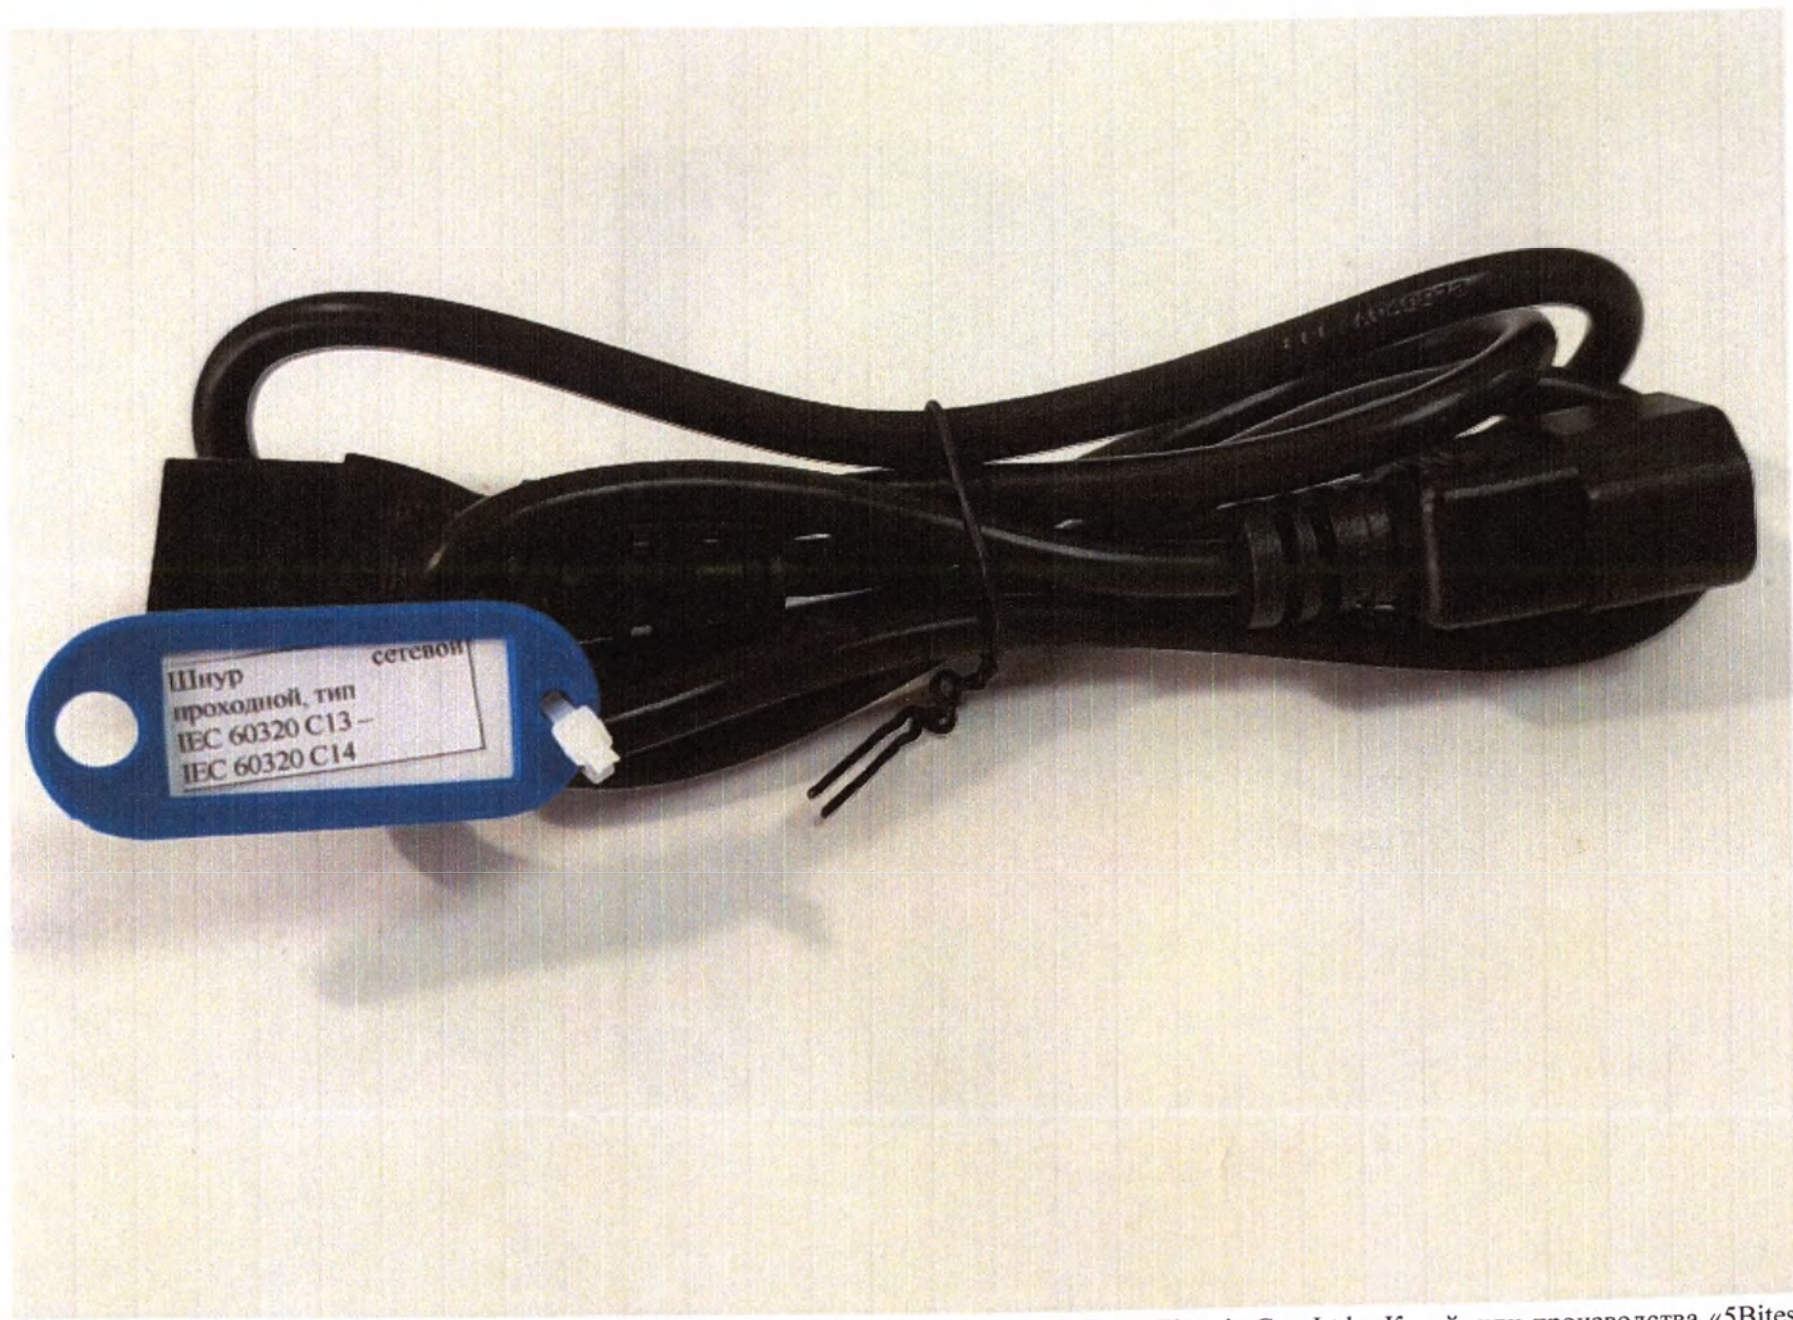

12 Шнур сетевой проходной, тип IEC 60320 C13 - IEC 60320 C14, производства «Ningbo Ousheng Electric Co., Ltd», Китай, или производства «5Bites Systems Ltd.», Китай, или производства ООО «КОМПАНИЯ АТКОМ», Россия, или производства «Bion Expert», Китай, или производства «Gembird Software Ltd.», Голландия, или производства «EkeGate», Китай, или производства ООО «М-ИНВЕСТ», Россия, или производства АО «ПЗКМК», Россия, или производства Superline Systems Canada Ltd.», Канада, или производства «Premier Cable», Китай




14 Монитор, марки «ASUS», производства «ASUSTek Computer Inc.», Китай, или марки «Dell», производства «Wistron Corporation», Китай, или марки «Acer», производства «Acer Inc.», Китай, или марки «Benq», производства «Benq Corporation», Китай, или марки «HP», производства «HP Inc.», США, или марки «LG», производства «LG Electronics», Республика Корея, или марки «Samsung», производства «Samsung Electronics Co., Ltd.», Республика Корея, или марки «Iiyama», производства «IIYAMA CORPORATION», Нидерланды, или марки «MSI», производства «Micro-Star International Co., Ltd.», Китай, или марки «Philips», производства «Philips», Нидерланды, или марки «ViewSonic», производства «ViewSonic Corporation», США, или марки «NEC», производства «Nippon Electric Corporation», Япония

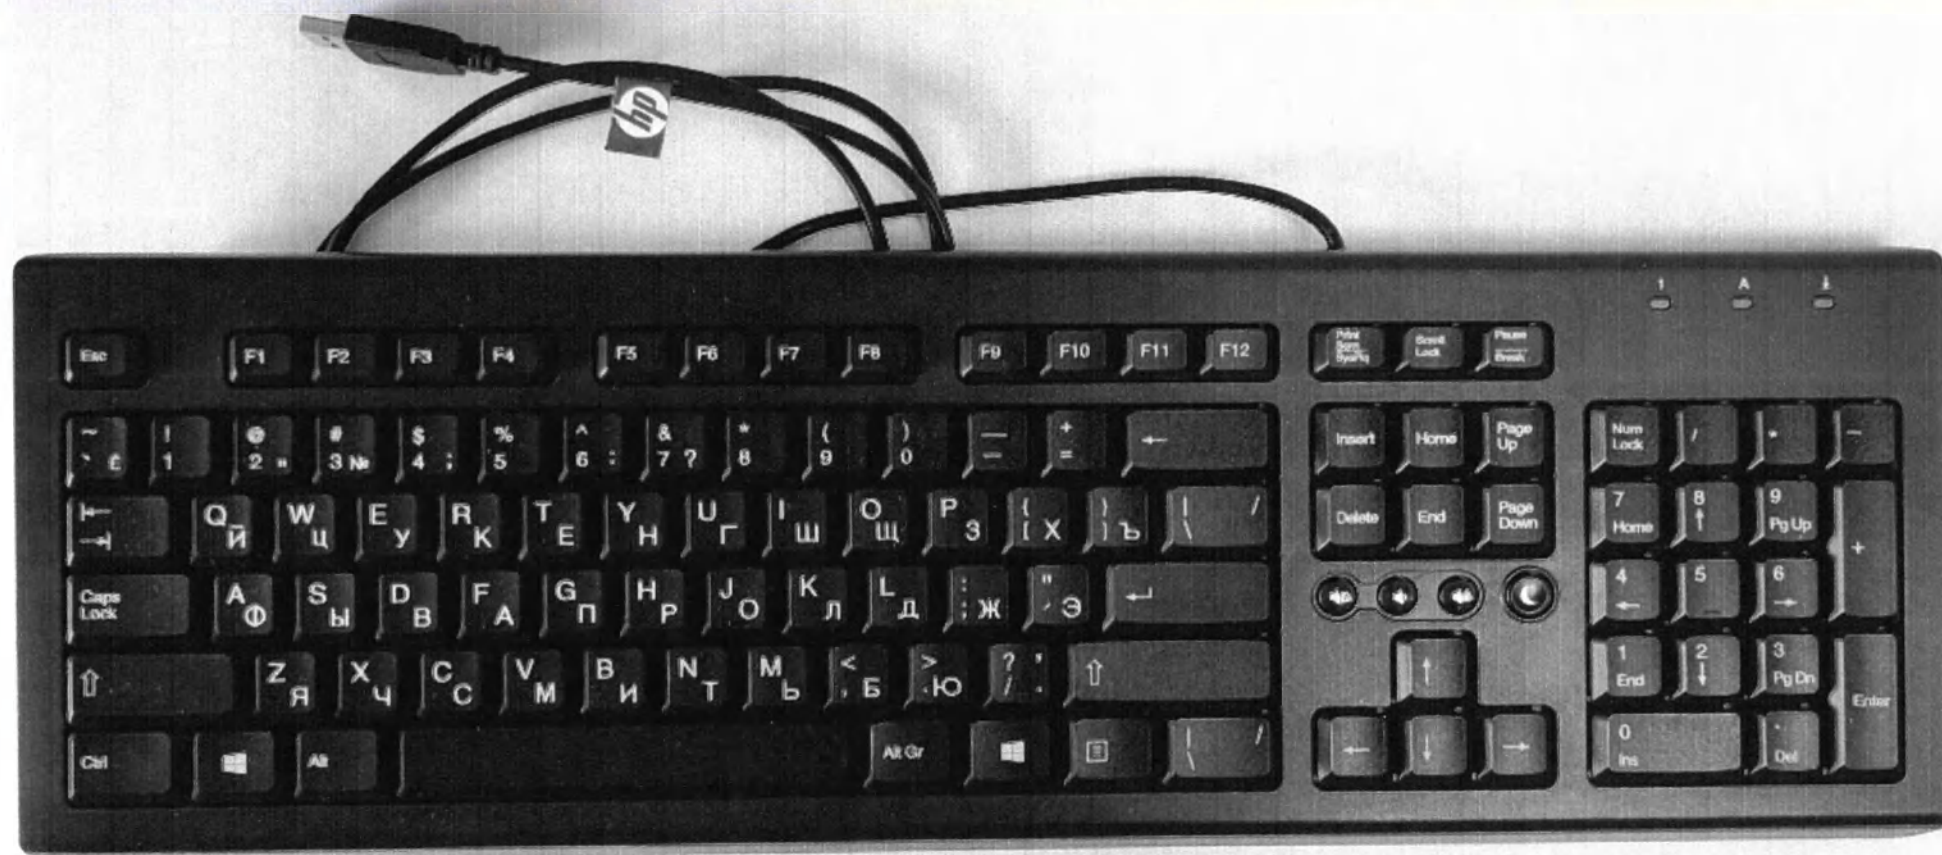


15 Клавиатура, марки «HP», производства «HP Inc.», США, или марки «ASUS», производства «ASUSTek Computer Inc.», Китай, или марки «Acer», производства «Acer Inc.», Китай, или марки «Lenovo», производства «Lenovo Group Limited», Китай, или марки «MSI», производства «Micro-Star International Co., Ltd.», Китай, или марки «Dell», производства «Wistron Corporation», Китай, или марки «Logitech», производства «Logitech Europe S.A.», Швейцария, или марки «Genius», производства «KYE SYSTEMS CORP.», Китай, или марки «Gembird», производства «Gembird Software Ltd.», Голландия, или марки «A4Tech», или марки «НАМА», производства «Nama GmbH & Co. KG», Германия, или марки «ExeGate», производства «ExeGate»,



16 Мышь, марки «HP», производства «HP Inc.», США, или марки «ASUS», производства «ASUSTek Computer Inc.», Китай, или марки «Acer», производства «Acer Inc.», Китай, или марки «Lenovo», производства «Lenovo Group Limited», Китай, или марки «MSI», производства «Micro-Star International Co., Ltd.», Китай, или марки «Dell», производства «Wistron Corporation», Китай, или марки «Logitech», производства «Logitech Europe S.A.», Швейцария, или марки «Genius», Тайвань, или марки «Gembird», производства «Gembird Software Ltd.», Голландия, или марки «A4Tech», производства «A4Tech», Тайвань, или марки «НАМА», производства «Nama GmbH & Co. KG», Германия, или марки «ExeGate», производства «ExeGate», Китай

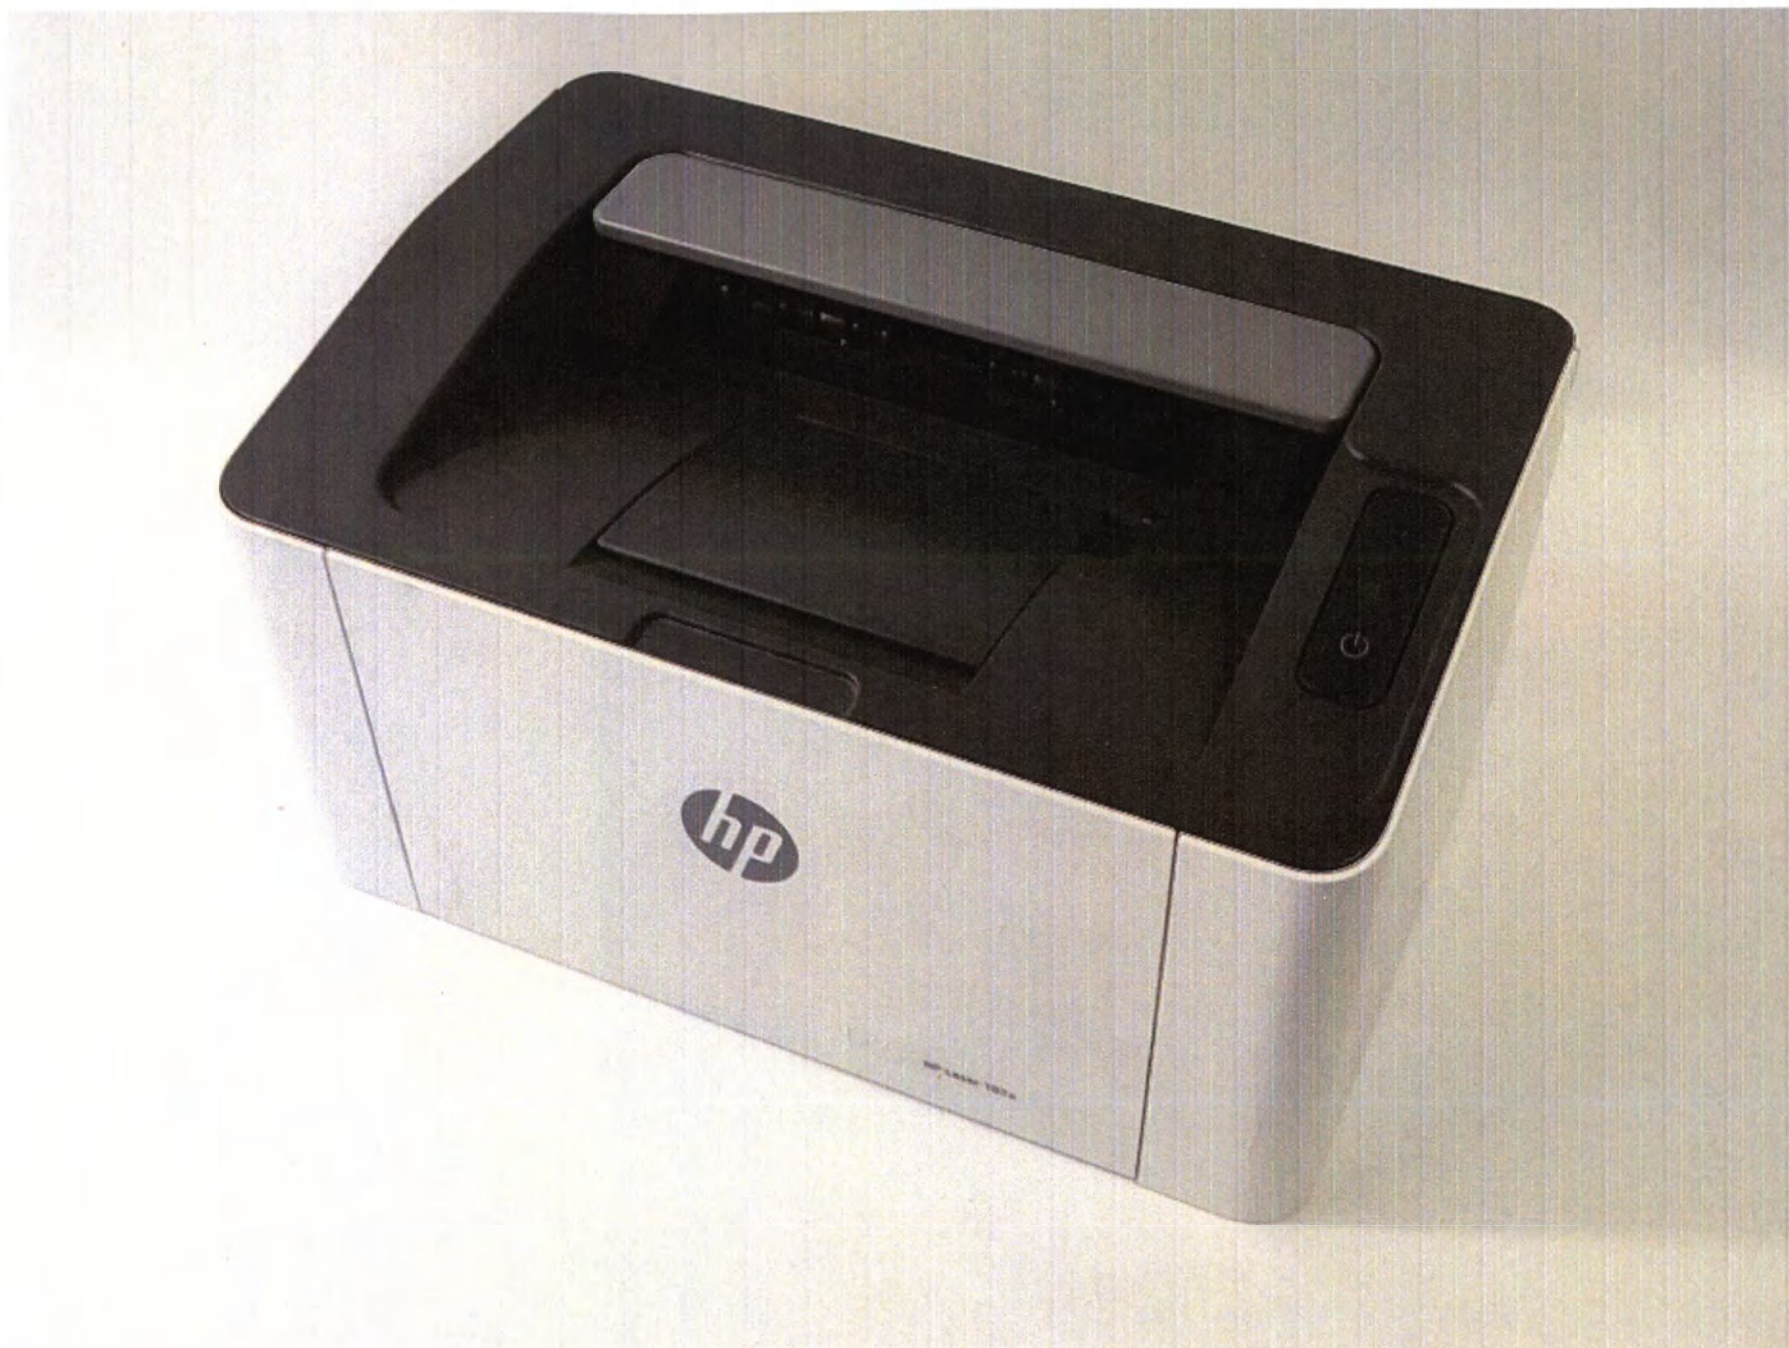

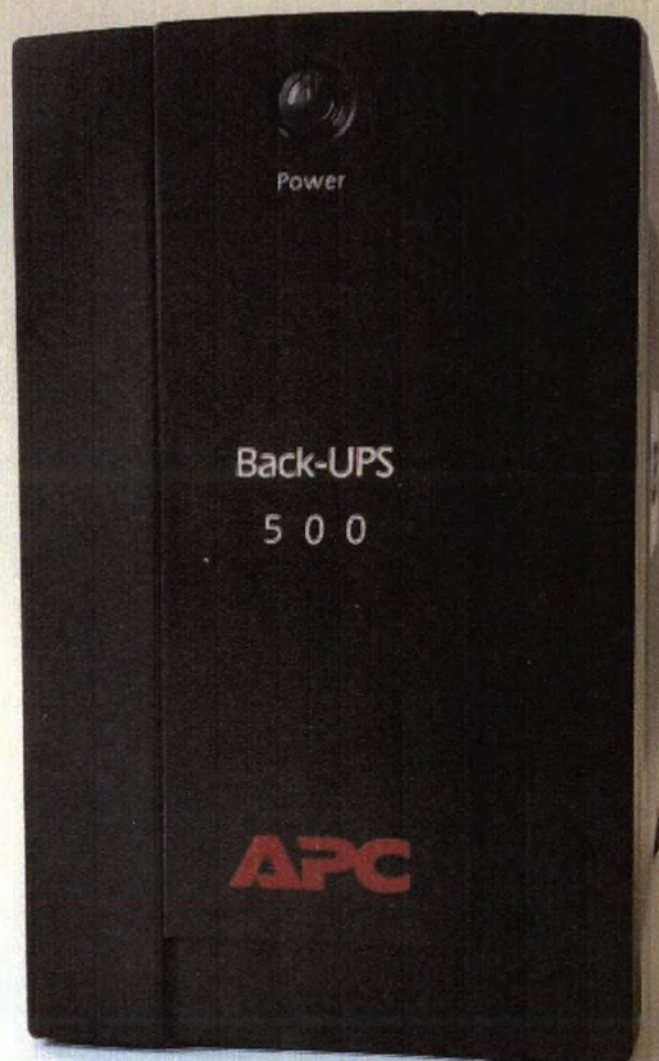

18 Источник бесперебойного питания, «APC», тип Back-UPS, производства «Schneider Electric Industries SAS», Франция, или «CyberPower», модели серии UTC850, Китай, или «POWERMAN» модели серии BACK PRO, производства «POWER LIMITED», Китай



19 Считыватель модель R5-USB Prof, по ТУ 4372-003-92462613-2012, производства АО «РусГард», Россия




МАРКИРОВКА: Считыватель модель R5-USB Prof, по ТУ 4372-003-92462613-2012, производства АО «РусГард», Россия



20 Считыватель Z-2 модель RD_All, по ТУ 26.30.50-004-38111914-2018, производства АО «АВС», Россия



МАРКИРОВКА: Считыватель Z-2 модель RD_All, по ТУ 26.30.50-004-38111914-2018, производства АО «АВС», Россия

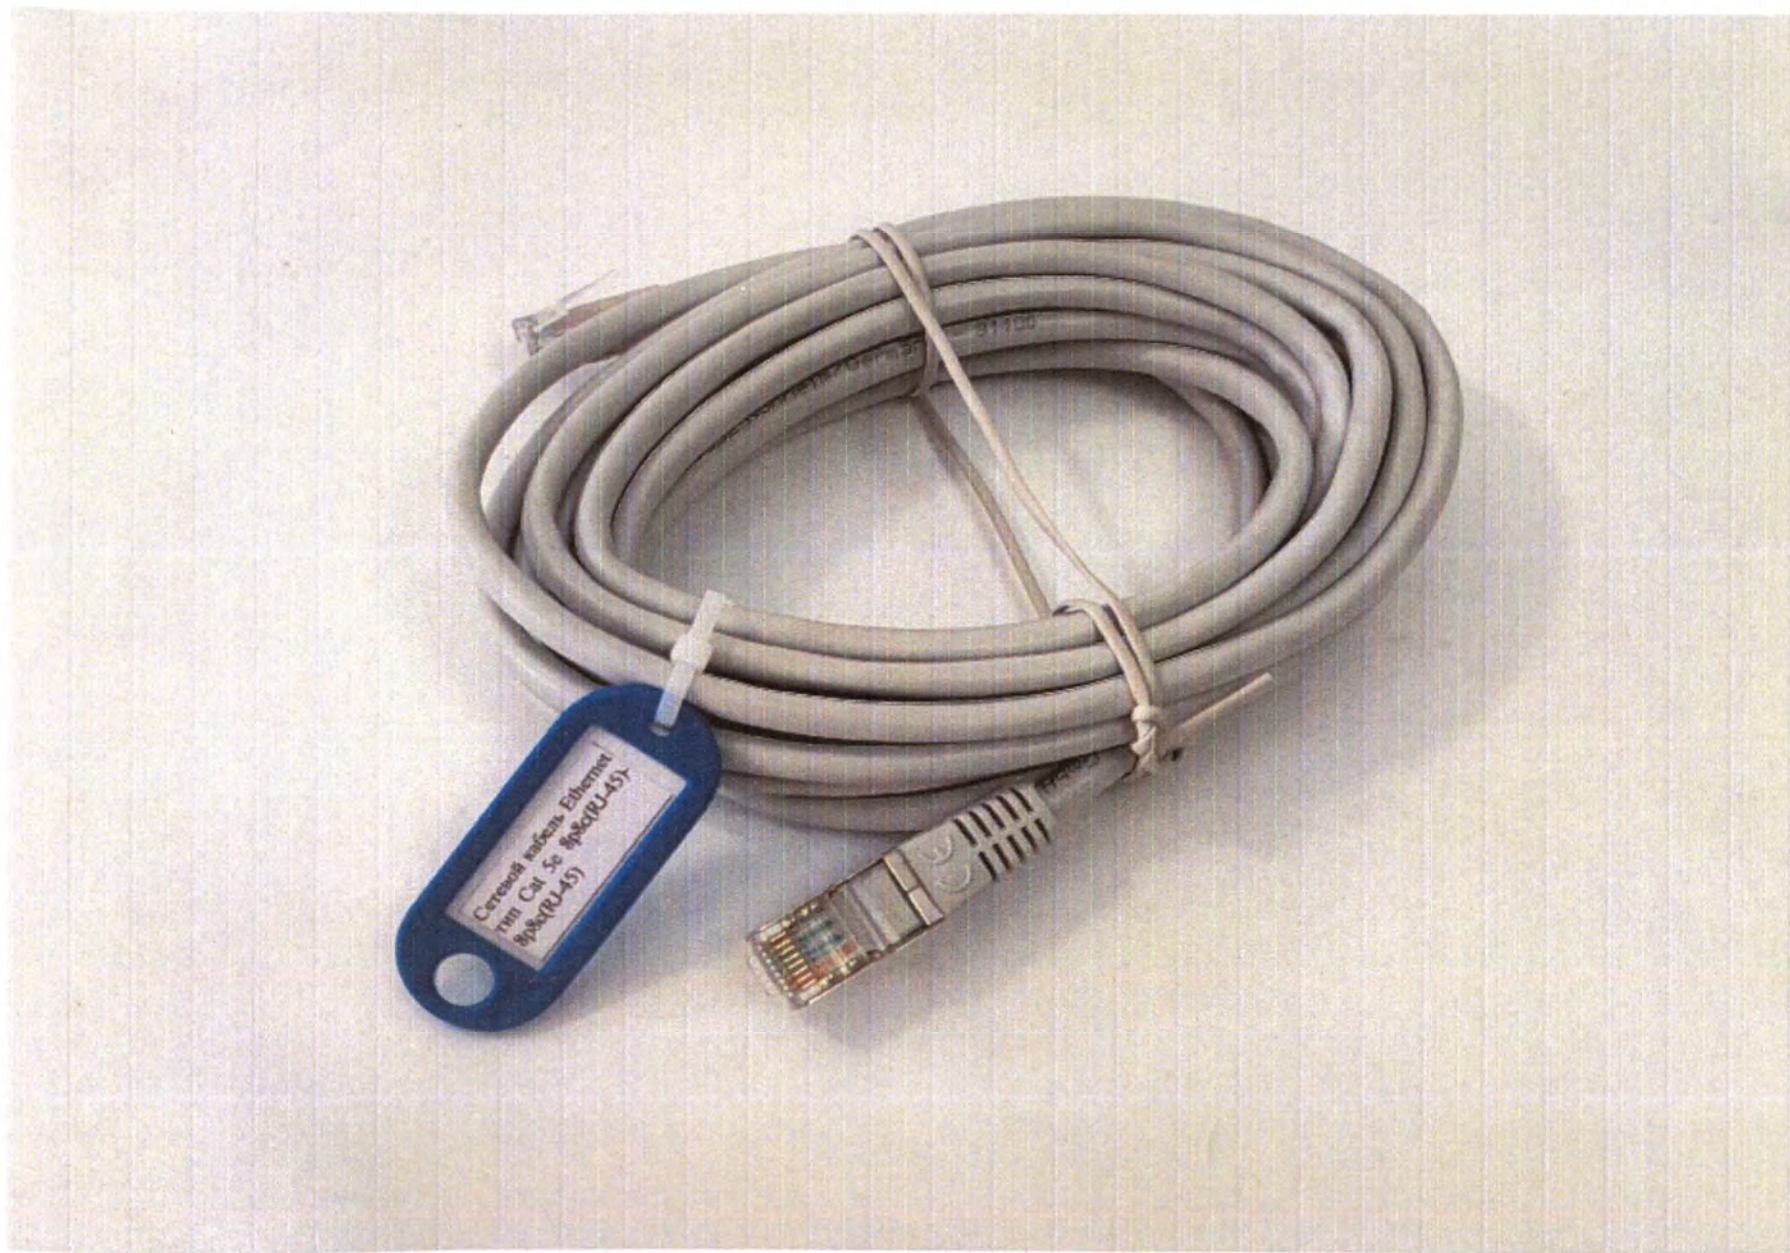

21 Сетевой кабель Ethernet тип Cat 5e 8p8c(RJ-45)- 8p8c(RJ-45), производства «Ningbo Ousheng Electric Co., Ltd», Китай, или производства «5Bites Systems Ltd.», Китай, или производства ООО «КОМПАНИЯ АТКОМ», Россия, или производства «Bion Expert», Китай, или производства «Gembird Software Ltd.», Голландия, или производства «ExeGate», Китай, или производства ООО «М-ИНВЕСТ», Россия, или производства АО «ПЗКМК», Россия, или производства «Hyperline Systems Canada Ltd.», Канада, или производства «Premier Cable», Китай, или производства «Hama GmbH & Co. KG», Германия

АО НПП «СИСТЕМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
КОМПЛЕКС АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
КАПД-02-СТ-А

ЗАВ №

00002

ДАТА ИЗГОТ.

11.2021



U - 230±23В ~ 50Гц P - 30ВА
(с учетом подключаемых устройств
P-500 ВА)

УХЛ 4.2 IP20



ТУ 26.60.12.129-002-45520949-2021

Страна происхождения - Россия

Маркировка

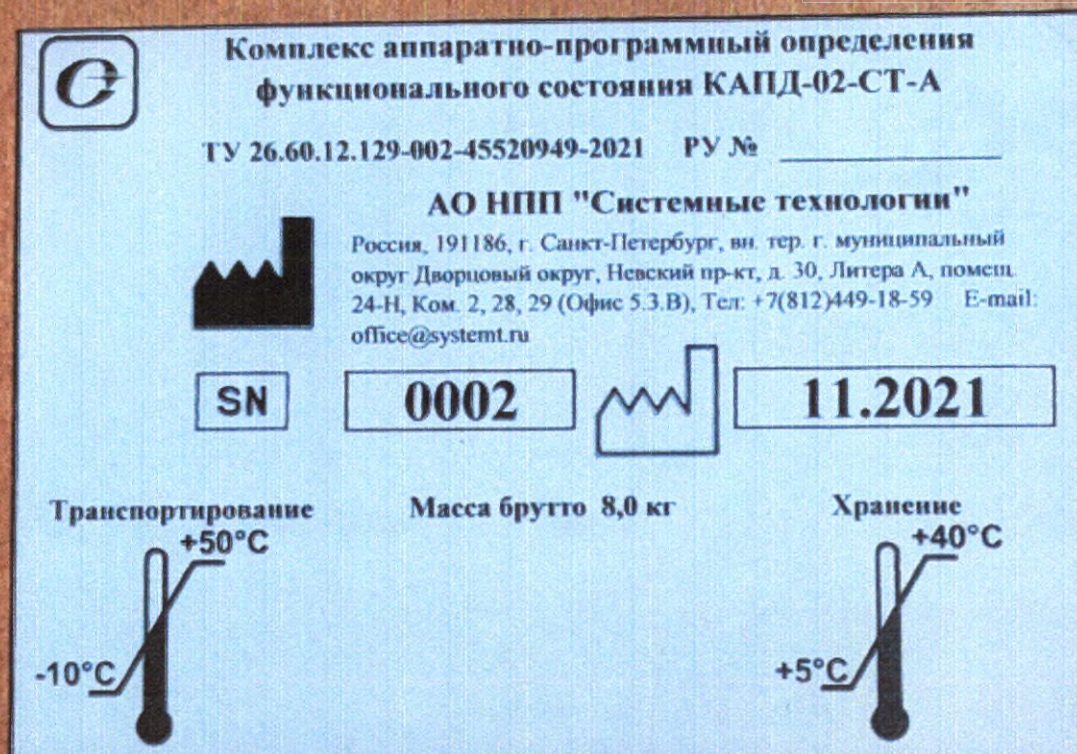


Фото 1: Маркировка транспортной упаковки



Фото 2: Маркировка транспортной упаковки

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью

34 (тридцать четыре) лист (2)

Руководитель организации:



М.В. Рюхин

«УТВЕРЖДАЮ»

Исполнительный директор

АО НПП «Системные технологии»

М.В. Рюхин



«03» июля 20 23 г.


Фотографическое изображение медицинского изделия:


Комплекс аппаратно-программный
определения функционального состояния КАПД-02-СТ по ТУ 26.60.12.129-002-45520949-2021

Модификация

«Комплекс аппаратно-программный определения функционального состояния КАПД-02-СТ-МА»

2023

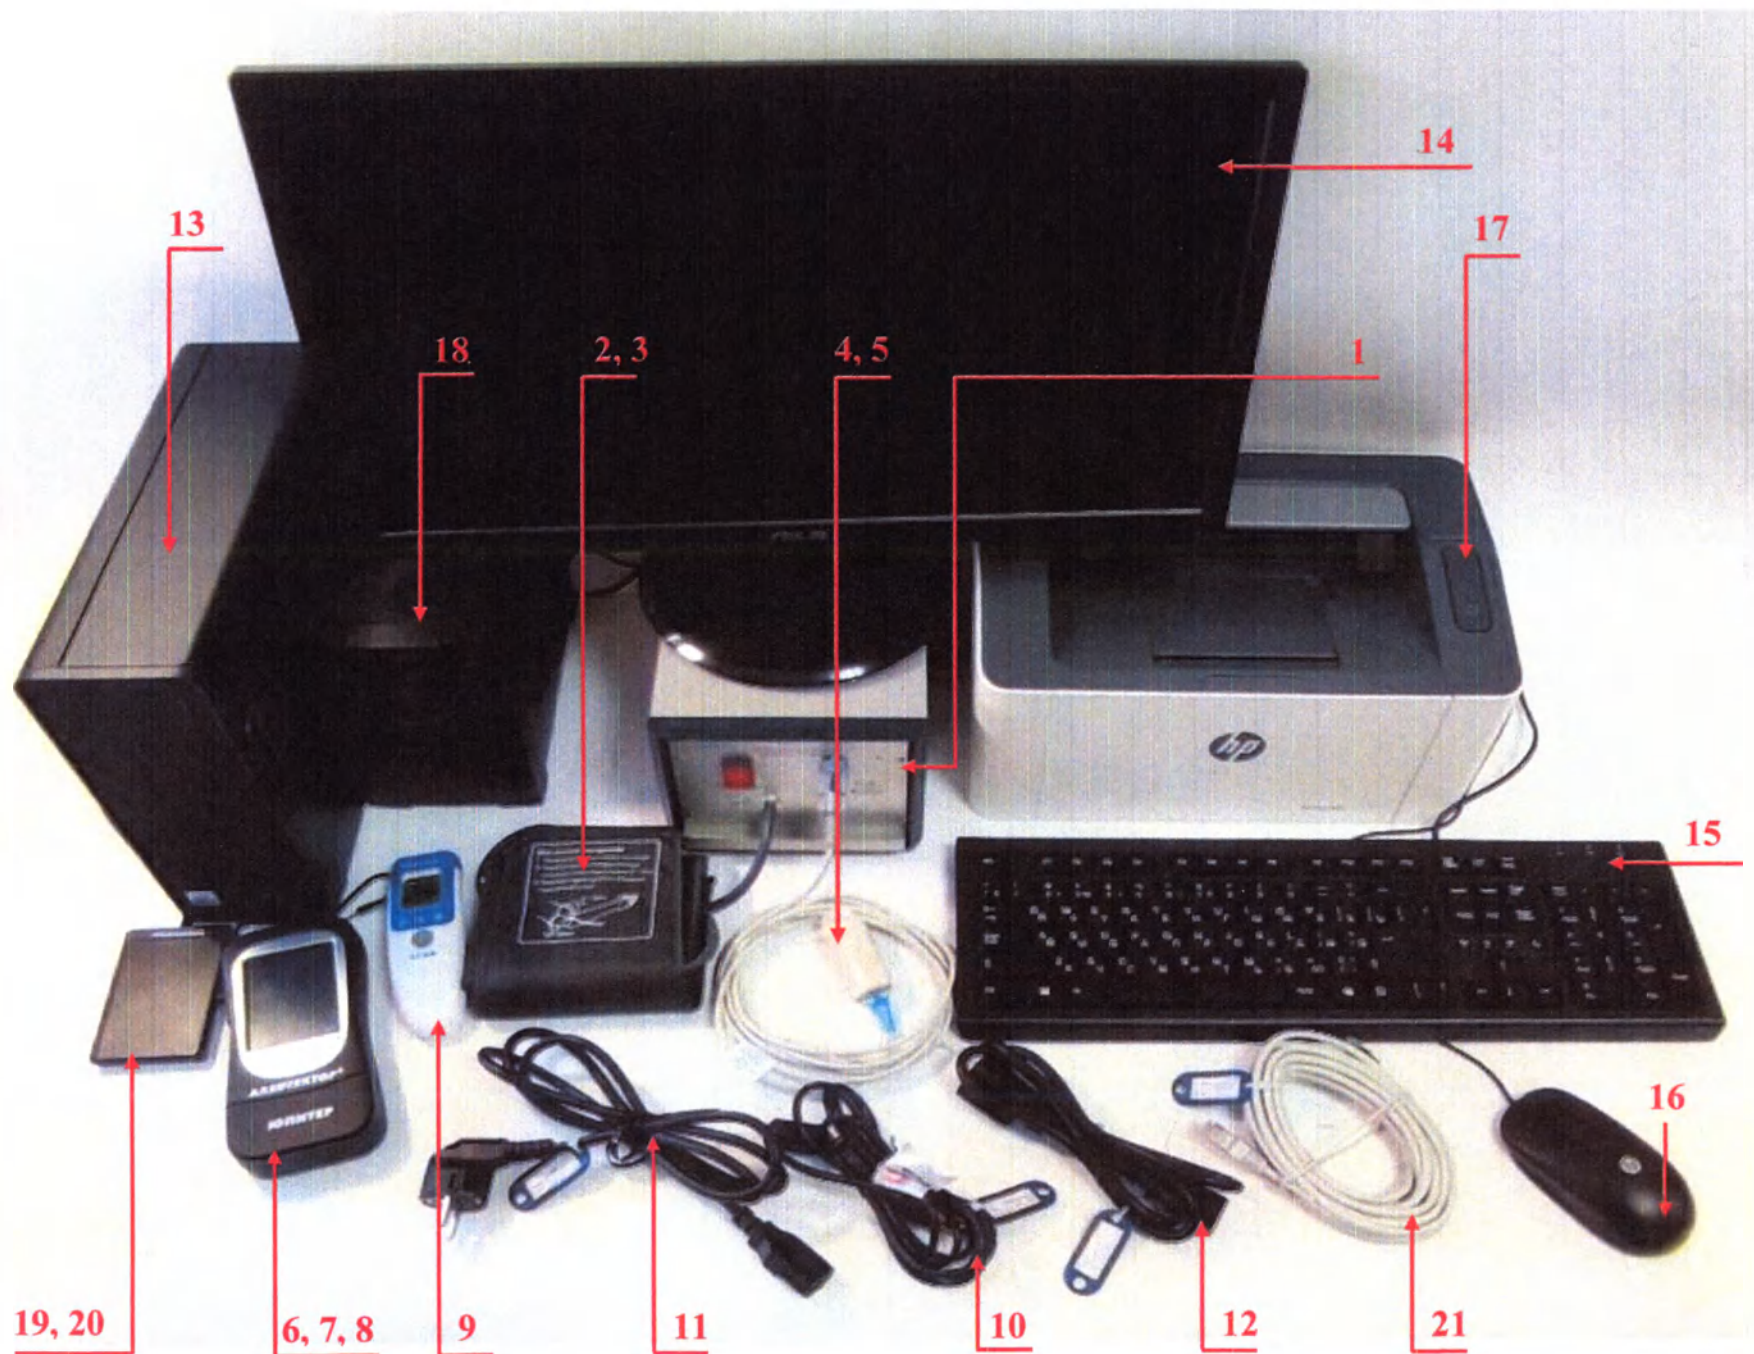


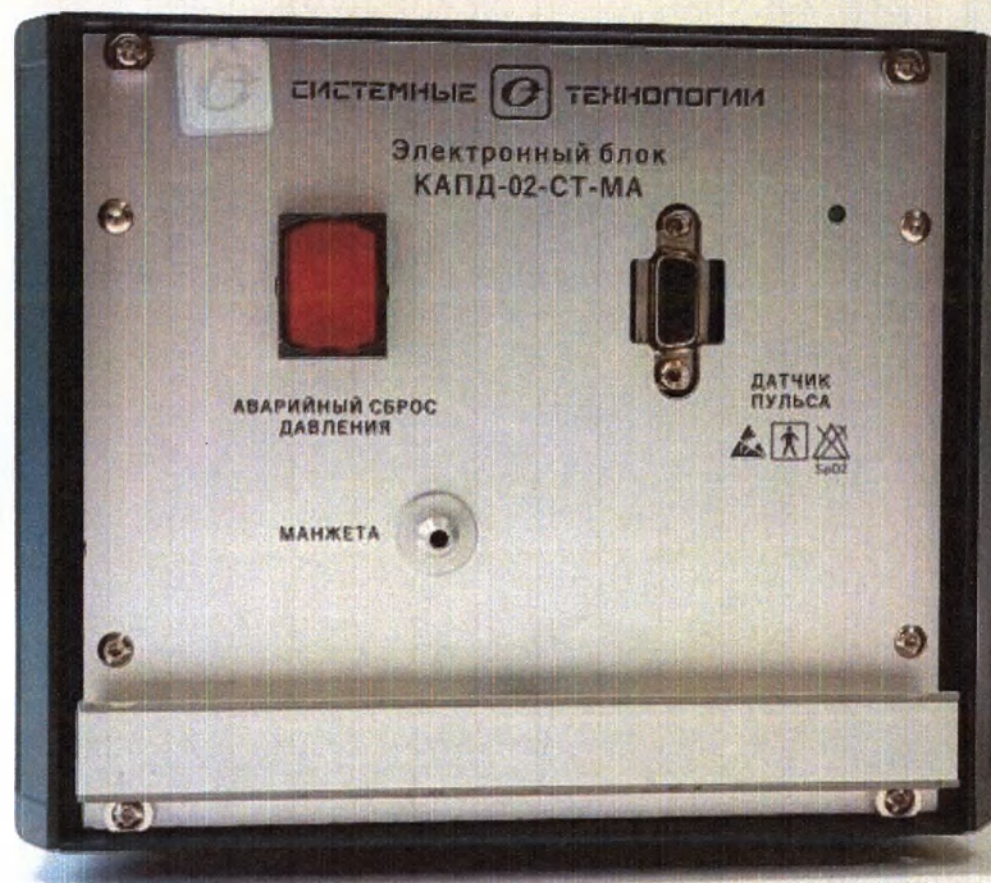

1 Электронный блок КАПД-02-СТ-МА

Для точных измерений


1. Закрепите манжету плотно, но не туго
2. Манжета должна находиться выше локтевого сгиба на расстоянии 2 – 3 см
3. Резиновая трубка должна находиться над локтевой ямкой

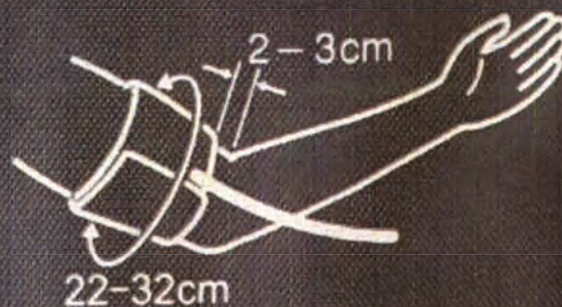

2 Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой серии UA с принадлежностями: Манжета стандартная (22-32 см), производства


Для точных измерений

1. Закрепите манжету плотно, но не туго
2. Манжета должна находиться выше локтевого сгиба на расстоянии 2 – 3 см
3. Резиновая трубка должна находиться над локтевой ямкой

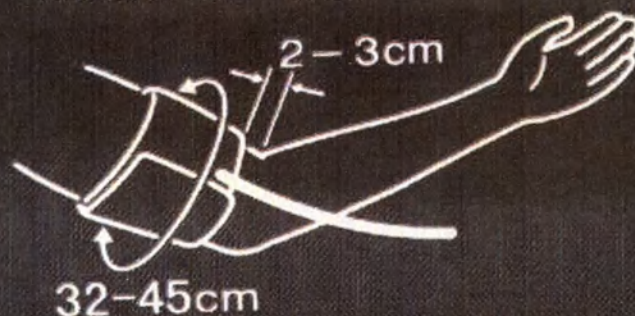

3 Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой серии UA с принадлежностями: Манжета большая (32-45 см), производства «Эй

энд ДИ Компани Лимитед», Япония, РУ №ФСЗ 2011/09642

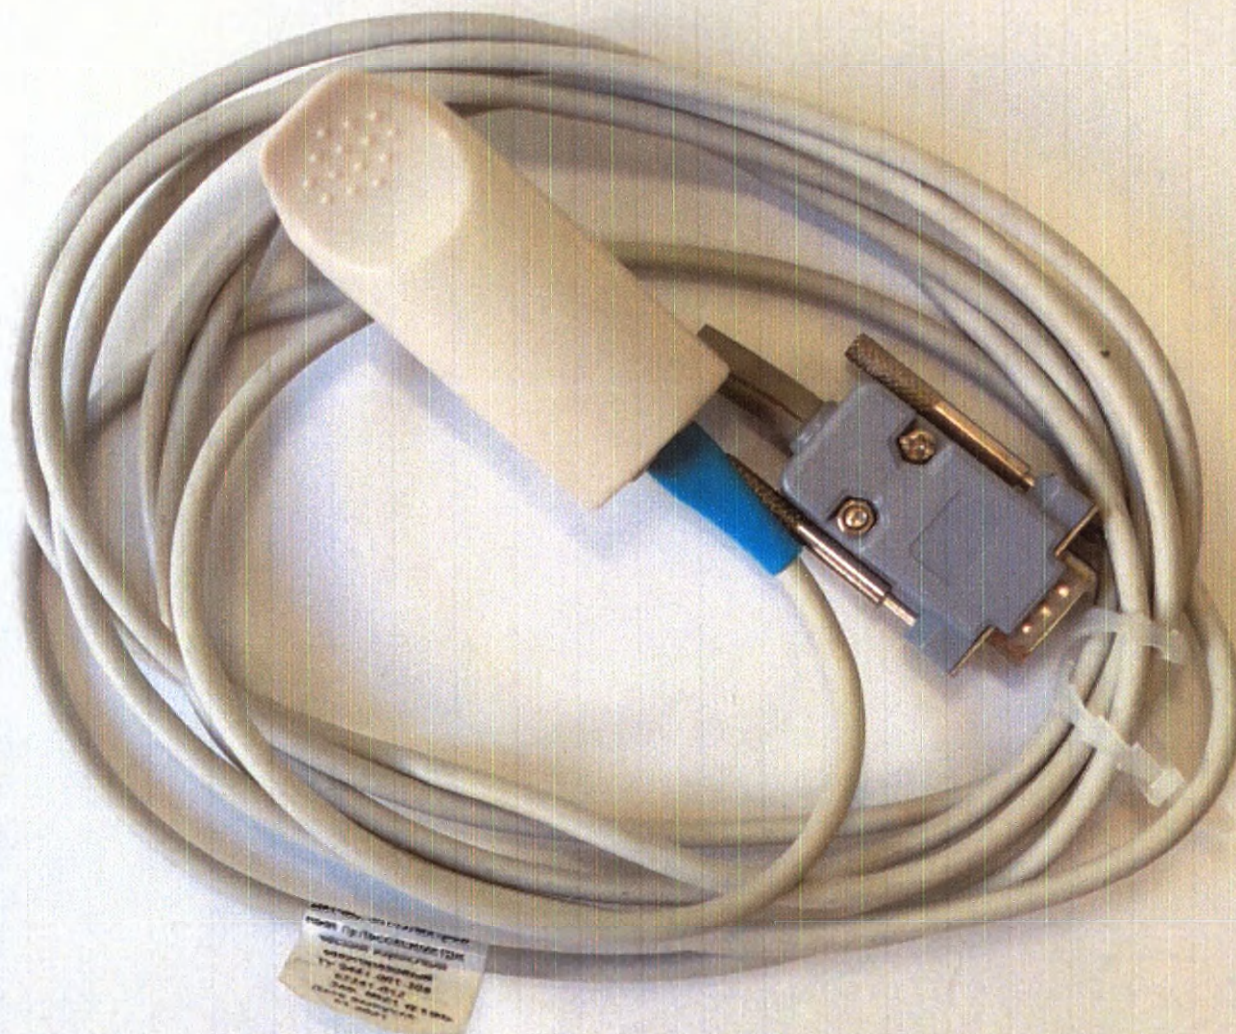


4 Датчики оптоэлектронные пульсоксиметрические взрослые и неонатальные многоцветные по ТУ 9441-001-30857241-2012: Датчик оптоэлектронный

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU и взрослый многоцветный, артикул ДАСМ. 012.542.1, производства ООО «Аксиома», Россия, РУ №РЗН 2013/658



МАРКИРОВКА: Датчики оптоэлектронные пульсоксиметрические взрослые и неонатальные многоцветные по ТУ 9441-001-30857241-2012: Датчик

ООО ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU ический взрослый многоцветный, артикул ДАСМ. 012.542.1, производства ООО «Аксиома», Россия, РУ №РЗН 2013/658

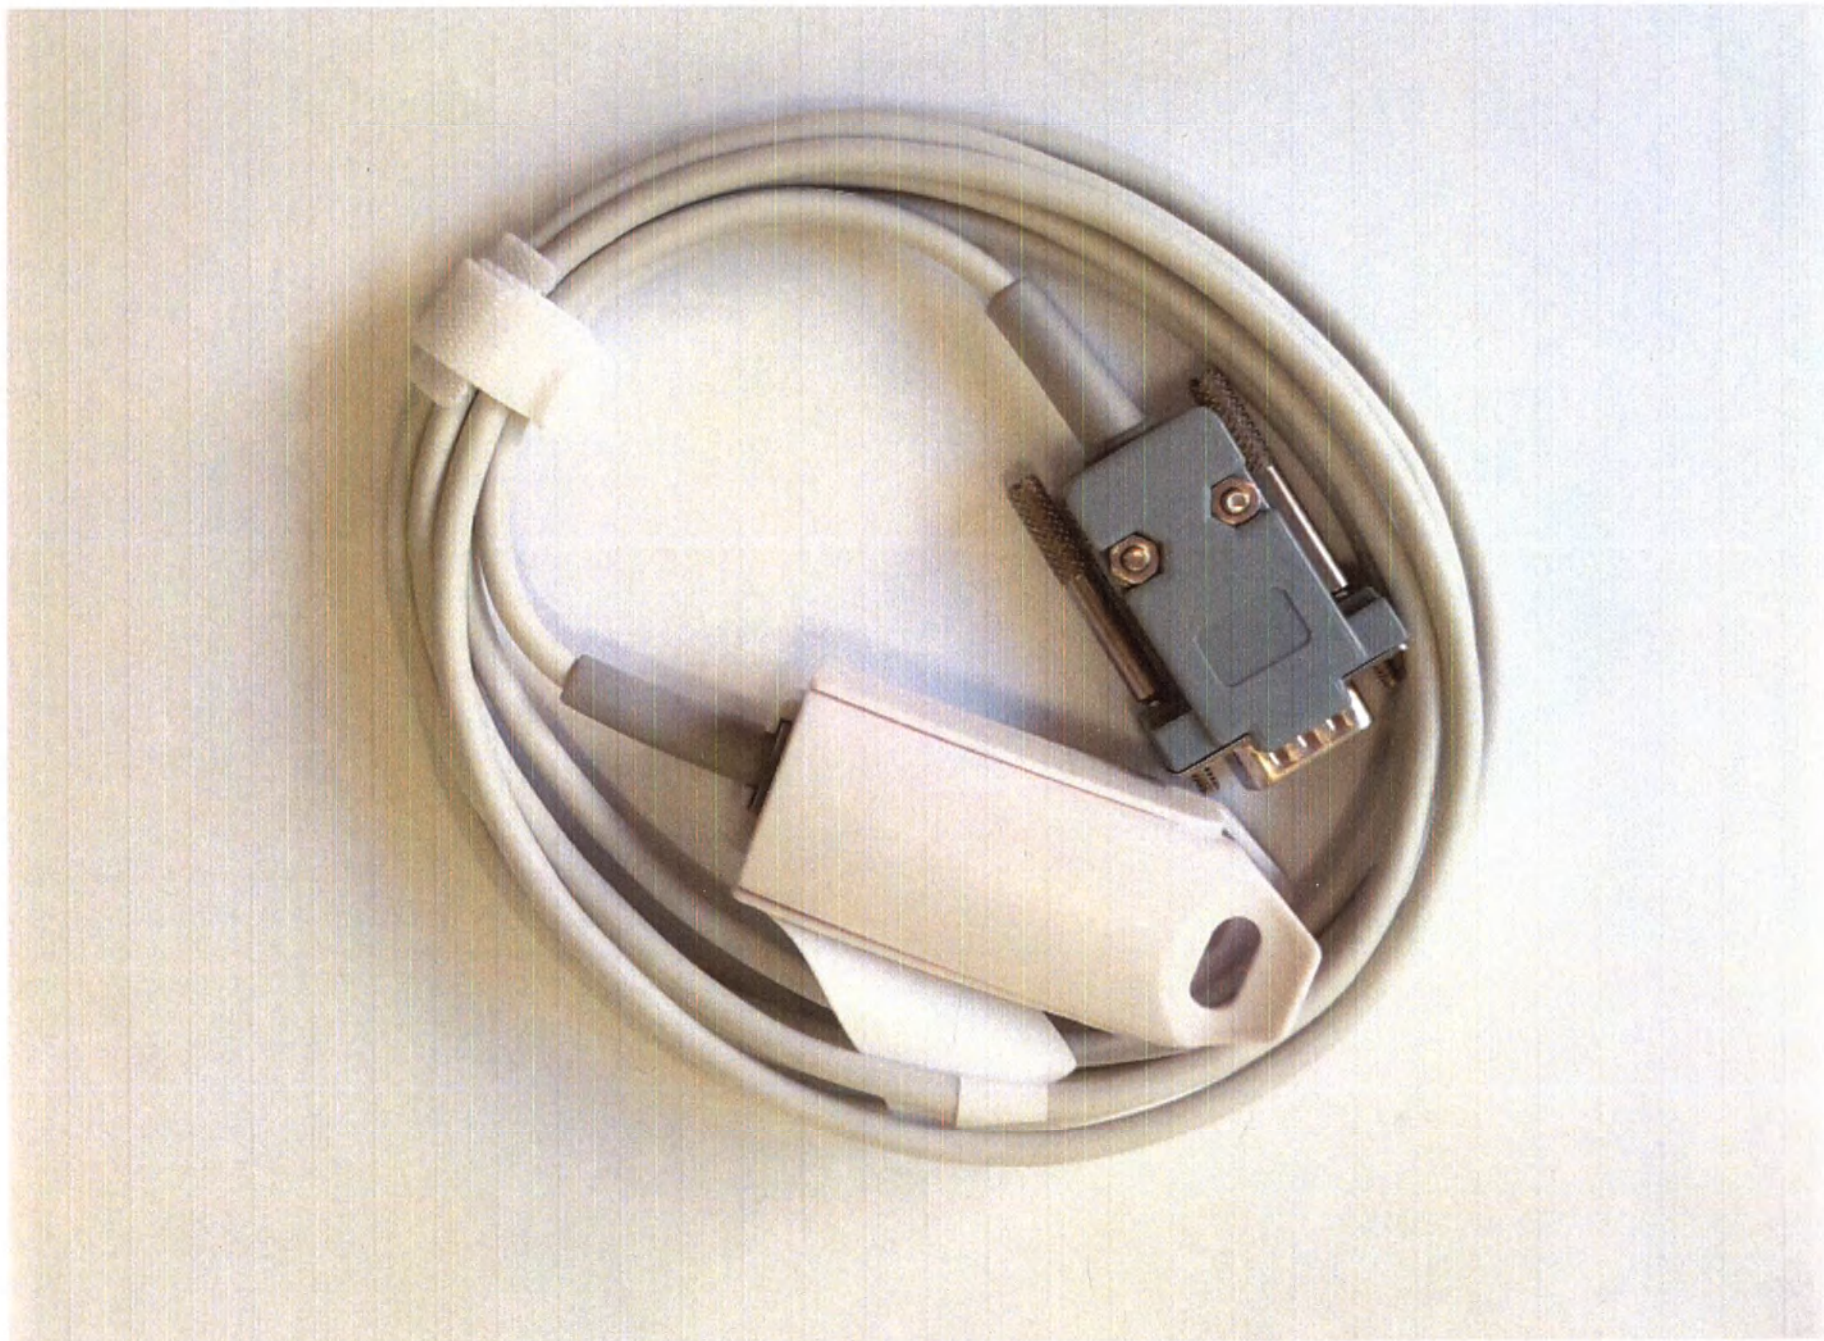

5 Датчики пульсоксиметрические SpO₂, кабели-удлинители для датчиков пульсоксиметрических SpO₂: Датчик пульсоксиметрический SpO₂, взрослый, тип



Датчик пульсоксиметрический SpO₂, взрослый, тип клипса, длинный кабель
ES-LA010, коннектор Oximax DB9M совместим с Nellcor Non-OxiMax DB9M



REF ES-LA010 (#H: 1574)



Для подключения датчика может потребоваться
кабель-переходник (приобретается отдельно)

Для взрослых >30КГ

LOT



H W 2 0 1 9 2 5 9 0

Произведен Shenzhen EMS LIFE Technology Co., Limited
No. 02, 4F, No. 145-7, Furui Road, Tayong Industrial Park,
Fuyong Town, Baoan District, Shenzhen, P.R. China

РУ МИ РЗН 2015/2683
от 15/07/2015
срок не ограничен

30/10/24

30/10/19

МАРКИРОВКА: Датчики пульсоксиметрические SpO₂, кабели-удлинители для датчиков пульсоксиметрических SpO₂: Датчик пульсоксиметрический SpO₂, длинный кабель ES-LA010, производства «Шеньжень EMC ЛАЙФ Текнолоджи Ко., Лтд.», КНР, РУ №РЗН 2015/2683



6 Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе "АЛКОТЕКТОР" в исполнениях "Юпитер", "Юпитер-К", "Юпитер-П" по ТУ 26.60.12-001-82139963-2011:

ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU исполнение «Юпитер», производства ООО «АЛКОТЕКТОР», Россия, РУ №ФСР 2012/13090



МАРКИРОВКА: Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе "АЛКОТЕКТОР" в исполнениях "Юпитер", "Юпитер-К", "Юпитер-П"




7 Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе «АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch-M» с принадлежностями, производства «Шеньжень Велл Электрик Кампании Лтд.», Китай, РУ №ФСЗ 2011/10061



МАРКИРОВКА: Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе «АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch-M» с принадлежностями, производства «Шеньчжень Велл
Электрик Кампании Лтд.», Китай, РУ №ФСЗ 2011/10061



8 Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе Динго с принадлежностями, вариант исполнения: Динго Е-200 (В), производства «Сентек Корея Корп.», Корея, РУ №РЗН 2014/1689

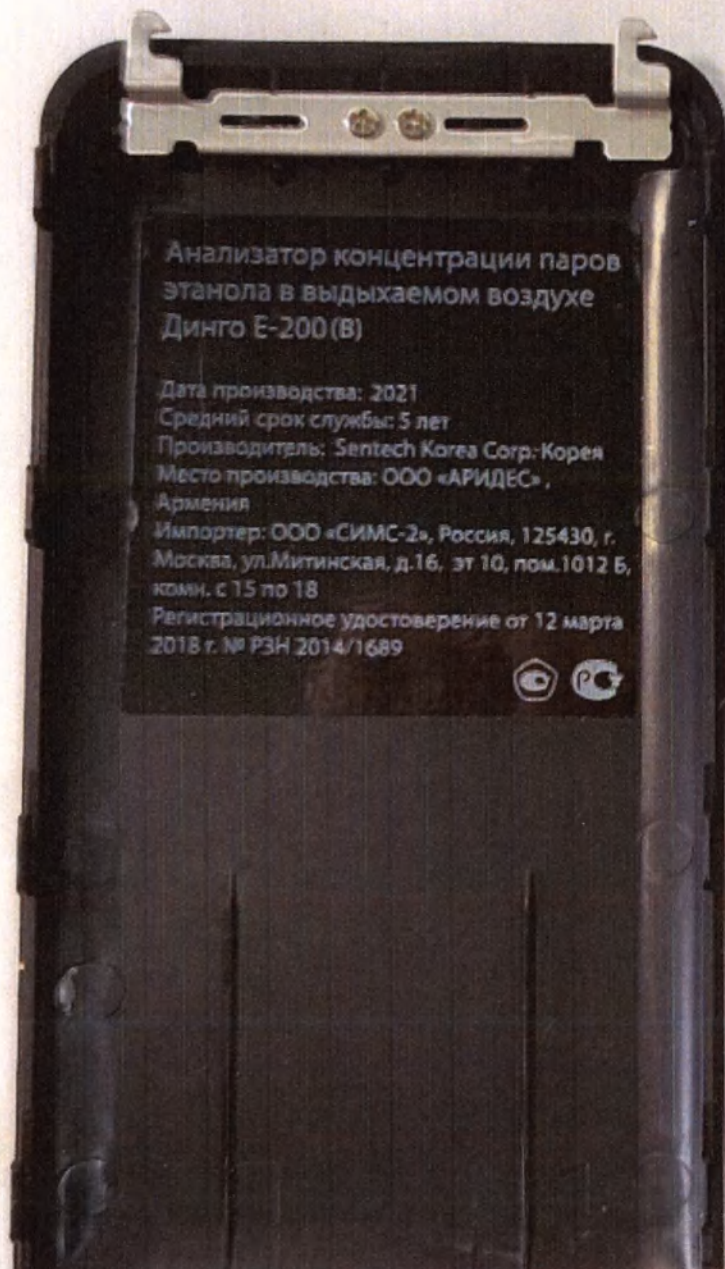


МАРКИРОВКА: Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе Динго с принадлежностями, вариант исполнения: Динго Е-200 (В), производства «Сентек Корея Корп.», Корея, РУ №РЗН 2014/1689




9 Бесконтактный инфракрасный термометр Derrcom, вариант исполнения JXB-183, производства «Джинхинбао Электроник Ко, Лтд», Китай, РУ №РЗН 2013/737




МАРКИРОВКА: Бесконтактный инфракрасный термометр Bettsom, вариант исполнения JXB-183, производства «Джинхинбао Электроник Ко, Лтд», Китай, РУ №РЗН 2013/737

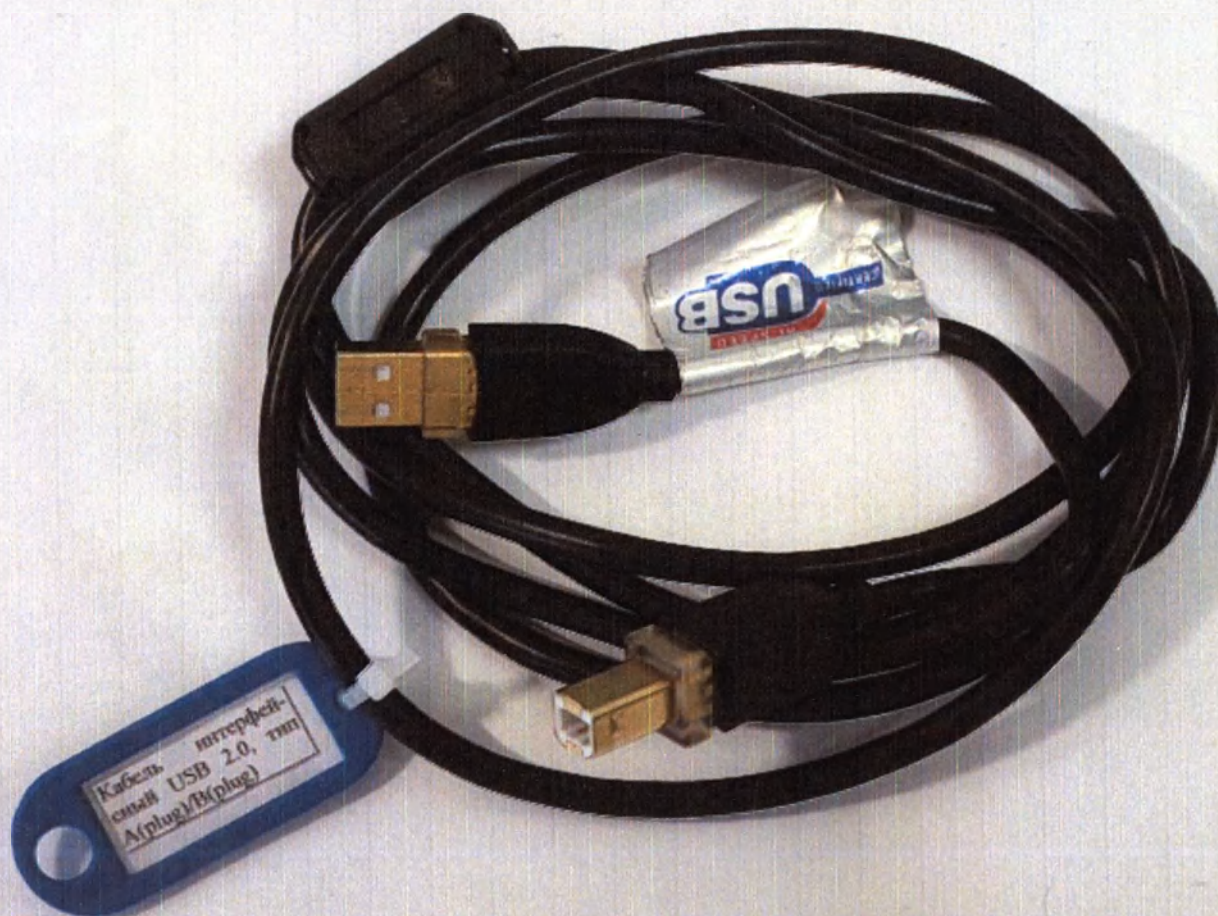

10 Кабель интерфейсный USB 2.0, тип A(plug)/B(plug), производства «Ningbo Ousheng Electric Co., Ltd», Китай, или производства «5Bites Systems Ltd.», Китай, или производства ООО «КОМПАНИЯ АТКОМ», Россия, или производства «Bion Expert», Китай, или производства «Gembird Software Ltd.», Голландия, или производства ООО «ЦИРМИ» INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU и производства ООО «М-ИНВЕСТ», Россия, или производства АО «ПЗКМК», Россия, или производства «Hyperline Systems Canada Ltd.», Канада, или производства «Premier Cable», Китай, или производства «Nema GmbH & Co. KG», Германия

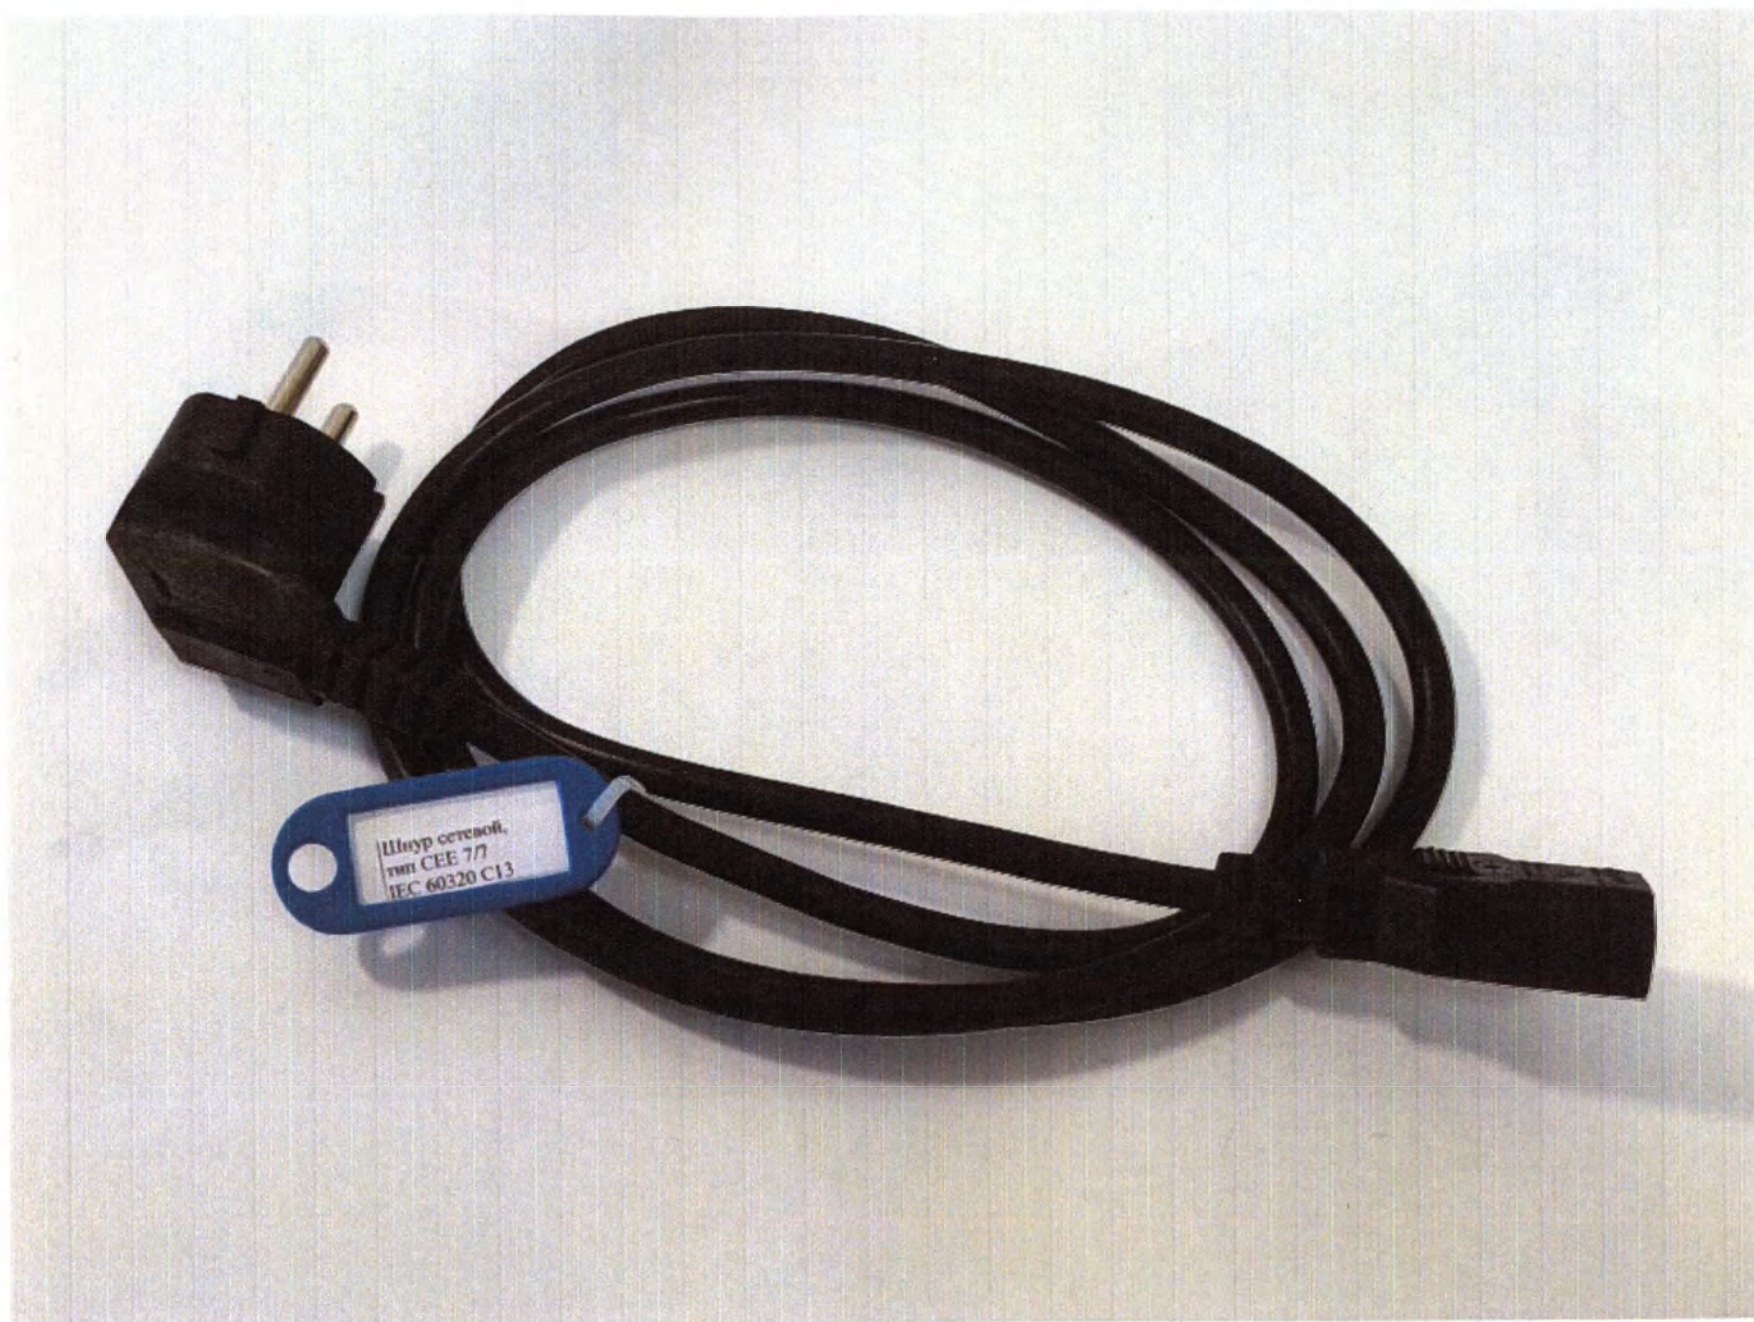

11 Шнур сетевой, тип CEE 7/7 - IEC 60320 C13, производства «Ningbo Ousheng Electric Co., Ltd», Китай, или производства «5Bites Systems Ltd.», Китай, или производства ООО «КОМПАНИЯ АТКОМ», Россия, или производства «Bion Expert», Китай, или производства «Gembird Software Ltd.», Голландия, или ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU и производства ООО «М-ИНВЕСТ», Россия, или производства АО «ПЗКМК», Россия, или производства «Hyperline Systems Canada Ltd.», Канада, или производства «Premier Cable», Китай

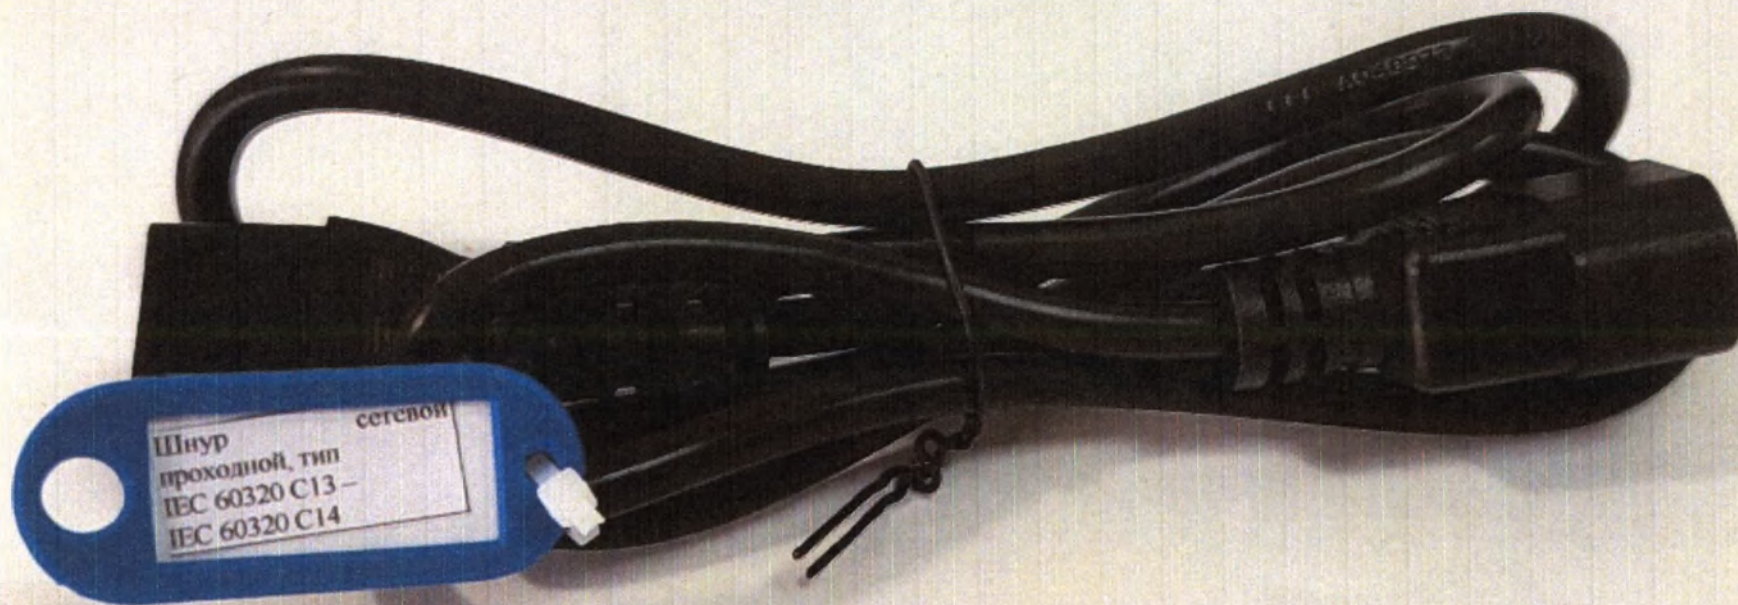

12 Шнур сетевой проходной, тип IEC 60320 C13 - IEC 60320 C14, производства «Ningbo Ousheng Electric Co., Ltd», Китай, или производства «5Bites Systems Ltd.», Китай, или производства ООО «КОМПАНИЯ АТКОМ», Россия, или производства «Bion Expert», Китай, или производства «Gembird Software Ltd.», Китай, или производства ООО «М-ИНВЕСТ», Россия, или производства АО «ПЗКМК», Россия, или производства «Hyperline Systems Canada Ltd.», Канада, или производства «Premier Cable», Китай




13 Персональный компьютер с предустановленным клиентским программным обеспечением, марки «HP», производства «HP Inc.»), США, или марки «XCOMputer» по ТУ 26.20.14-001-76557231-2022, производства ООО «М-ИНВЕСТ»), Россия, или марки «XComPuter» по ТУ 26.20.13-000-003-99599118-2018, производства ООО «М-ИНВЕСТ»), Россия, или марки «VEKUS» по ЦДТВ.466219.001 ТУ, производства ООО «ЦКТ «ВЕКУС», Россия, или марки «iRU» по ИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU) 2-90521719-2019), производства ООО «ДЕЛОВОЙ ОФИС»), Россия, или марки «Acer», производства «Acer Inc.»), Китай, или марки «Lenovo», производства «Lenovo Group Limited»), Китай, или марки «MSI», производства «Micro-Star International Co., Ltd.»), Китай




14 Монитор, марки «ASUS», производства «ASUSTek Computer Inc.», Китай, или марки «Dell», производства «Wistron Corporation», Китай, или марки «Acer», производства «Acer Inc.», Китай, или марки «Benq», производства «Benq Corporation», Китай, или марки «HP», производства «HP Inc.», США, или марки «LG», производства «LG Electronics», Республика Корея, или марки «Samsung», производства «Samsung Electronics Co., Ltd.», Республика Корея, или марки «Iiyama», производства «IYAMA CORPORATION», Нидерланды, или марки «MSI», производства «Micro-Star International Co., Ltd.», Китай, или марки «Philips», производства «Philips», Нидерланды, или марки «ViewSonic», производства «ViewSonic Corporation», США, или марки «NEC», производства «Nippon Electric Corporation», Япония



16 Мышь, марки «HP», производства «HP Inc.», США, или марки «ASUS», производства «ASUSTek Computer Inc.», Китай, или марки «Acer», производства «Acer Inc.», Китай, или марки «Lenovo», производства «Lenovo Group Limited», Китай, или марки «MSI», производства «Micro-Star International Co., Ltd.», Китай, или марки «Dell», производства «Wistron Corporation», Китай, или марки «Logitech», производства «Logitech Europe S.A.», Швейцария, или марки «Genius», марки «A4Tech», Тайвань, или марки «НАМА», производства «Нама GmbH & Co. KG», Германия, или марки «ExeGate», производства «ExeGate», Китай

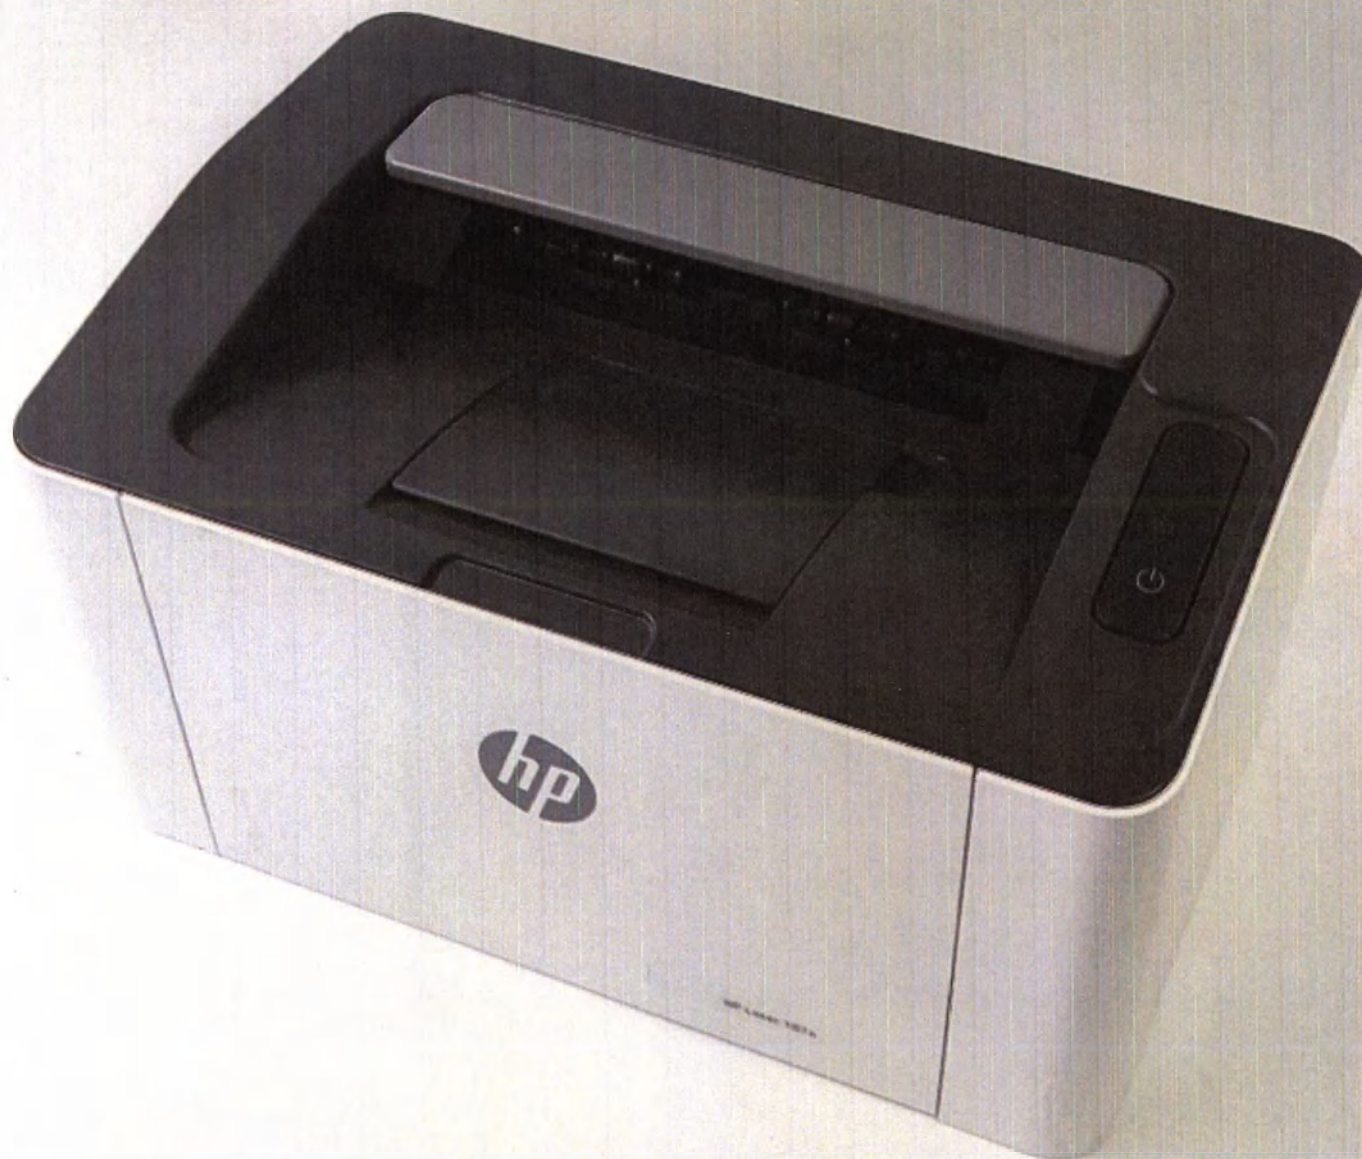


17 Принтер, марки «HP», производства «HP Inc.», США, или марки «Canon», производства «Canon Japan Inc.», Япония, или марки «Xerox», производства «Xerox Corp.», США, или марки «Epson», производства «SEIKO EPSON CORP.», Филиппины, или марки «Samsung», производства «Samsung Electronics Co., Ltd.», Республика Корея

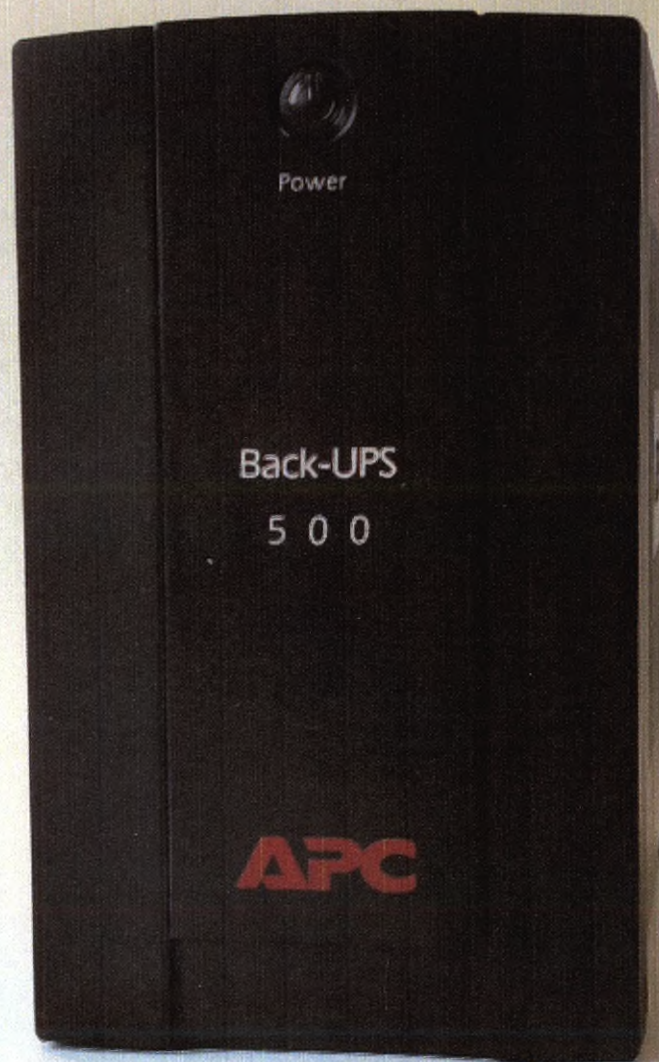

18 Источник бесперебойного питания, «APC», тип Back-UPS, производства «Schneider Electric Industries SAS», Франция, или «CyberPower», модели серии UTC850, производства «CyberPower Systems», Китай, или «POWERMAN» модели серии BACK PRO, производства «POWER LIMITED», Китай



19 Считыватель модель R5-USB Prof, по ТУ 4372-003-92462613-2012, производства АО «РусГард», Россия

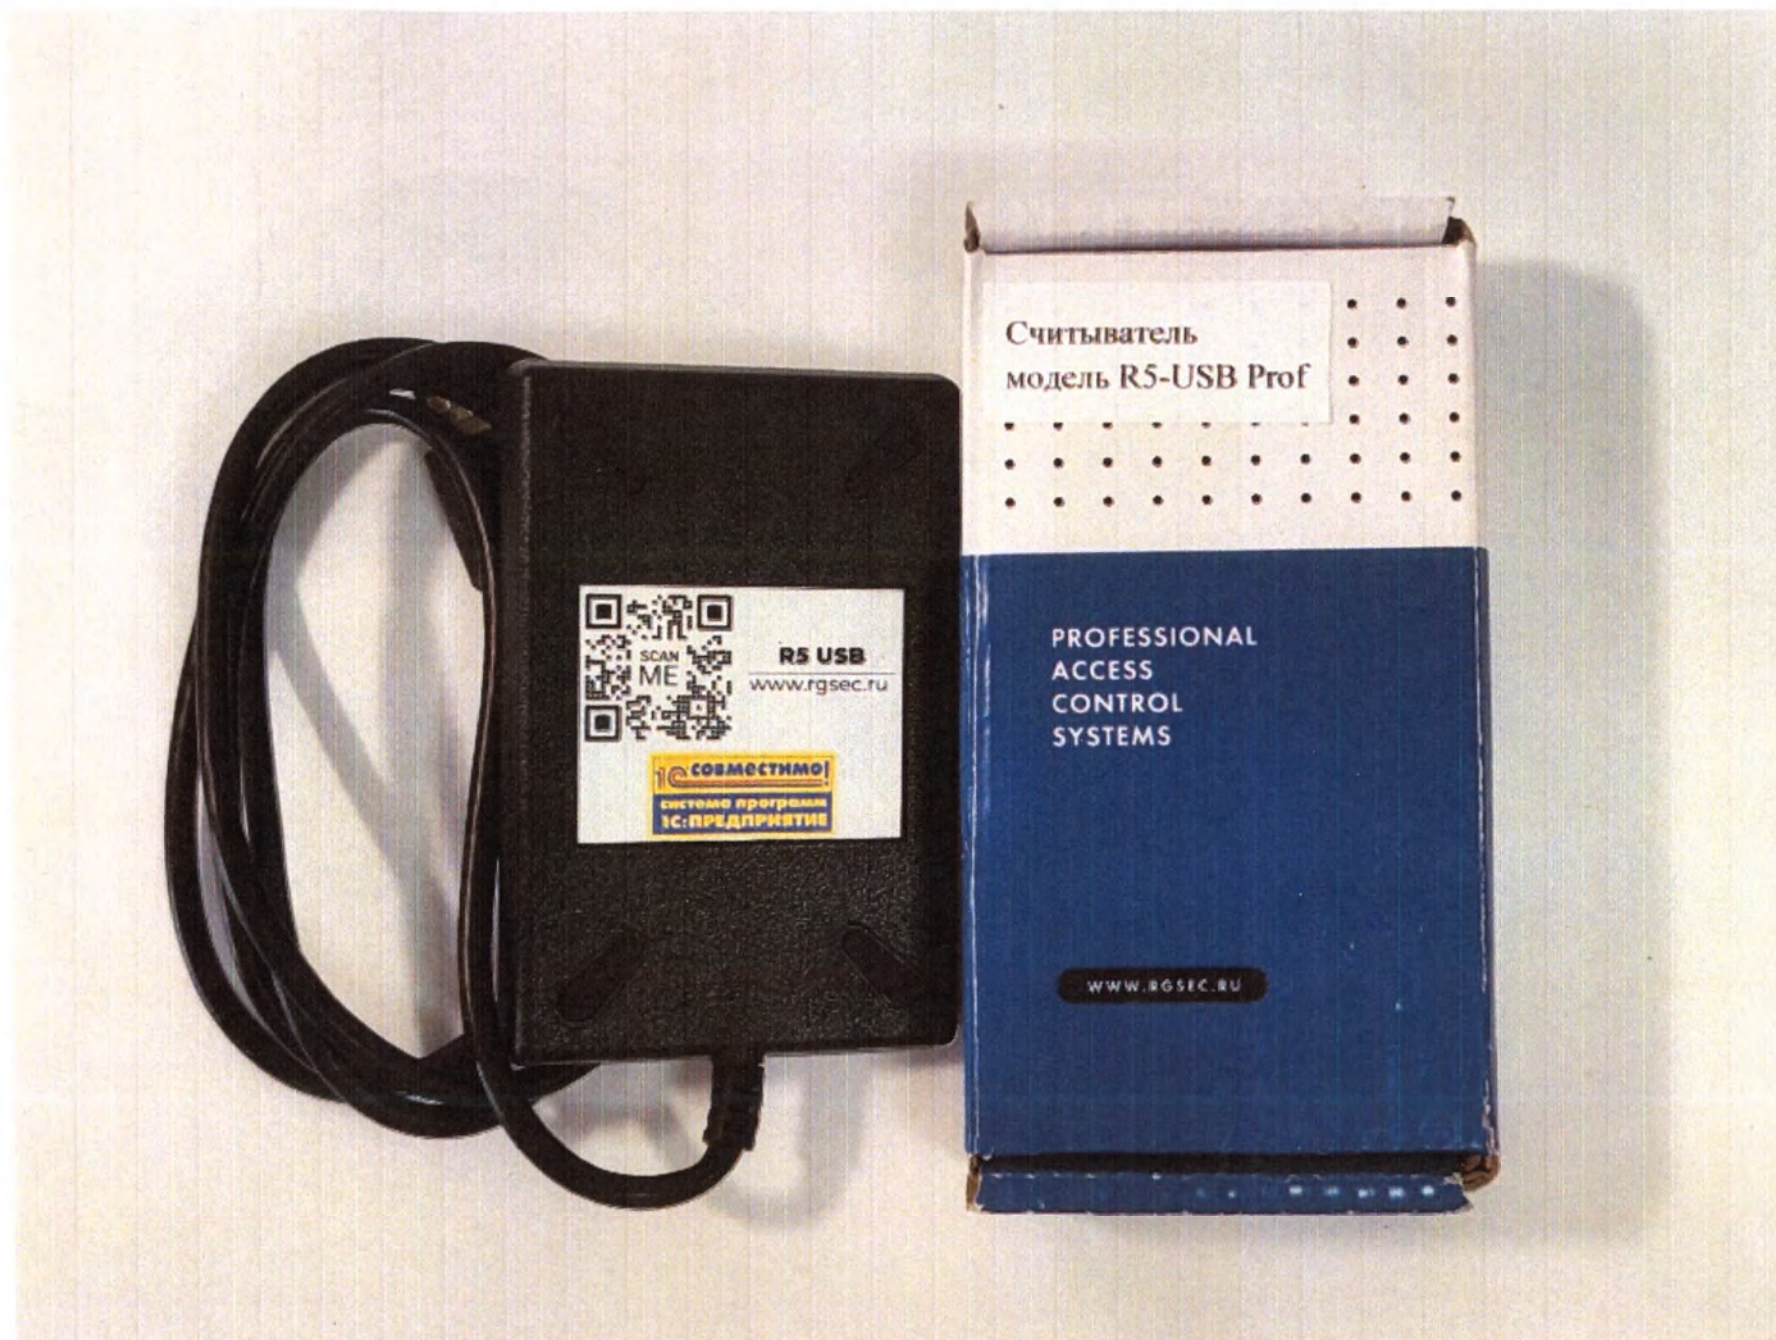


МАРКИРОВКА: Считыватель модель R5-USB Prof, по ТУ 4372-003-92462613-2012, производства АО «РусГард», Россия



20 Считыватель Z-2 модель RD_All, по ТУ 26.30.50-004-38111914-2018, производства АО «АВС», Россия



МАРКИРОВКА: Считыватель Z-2 модель RD_All, по ТУ 26.30.50-004-38111914-2018, производства АО «АВС», Россия

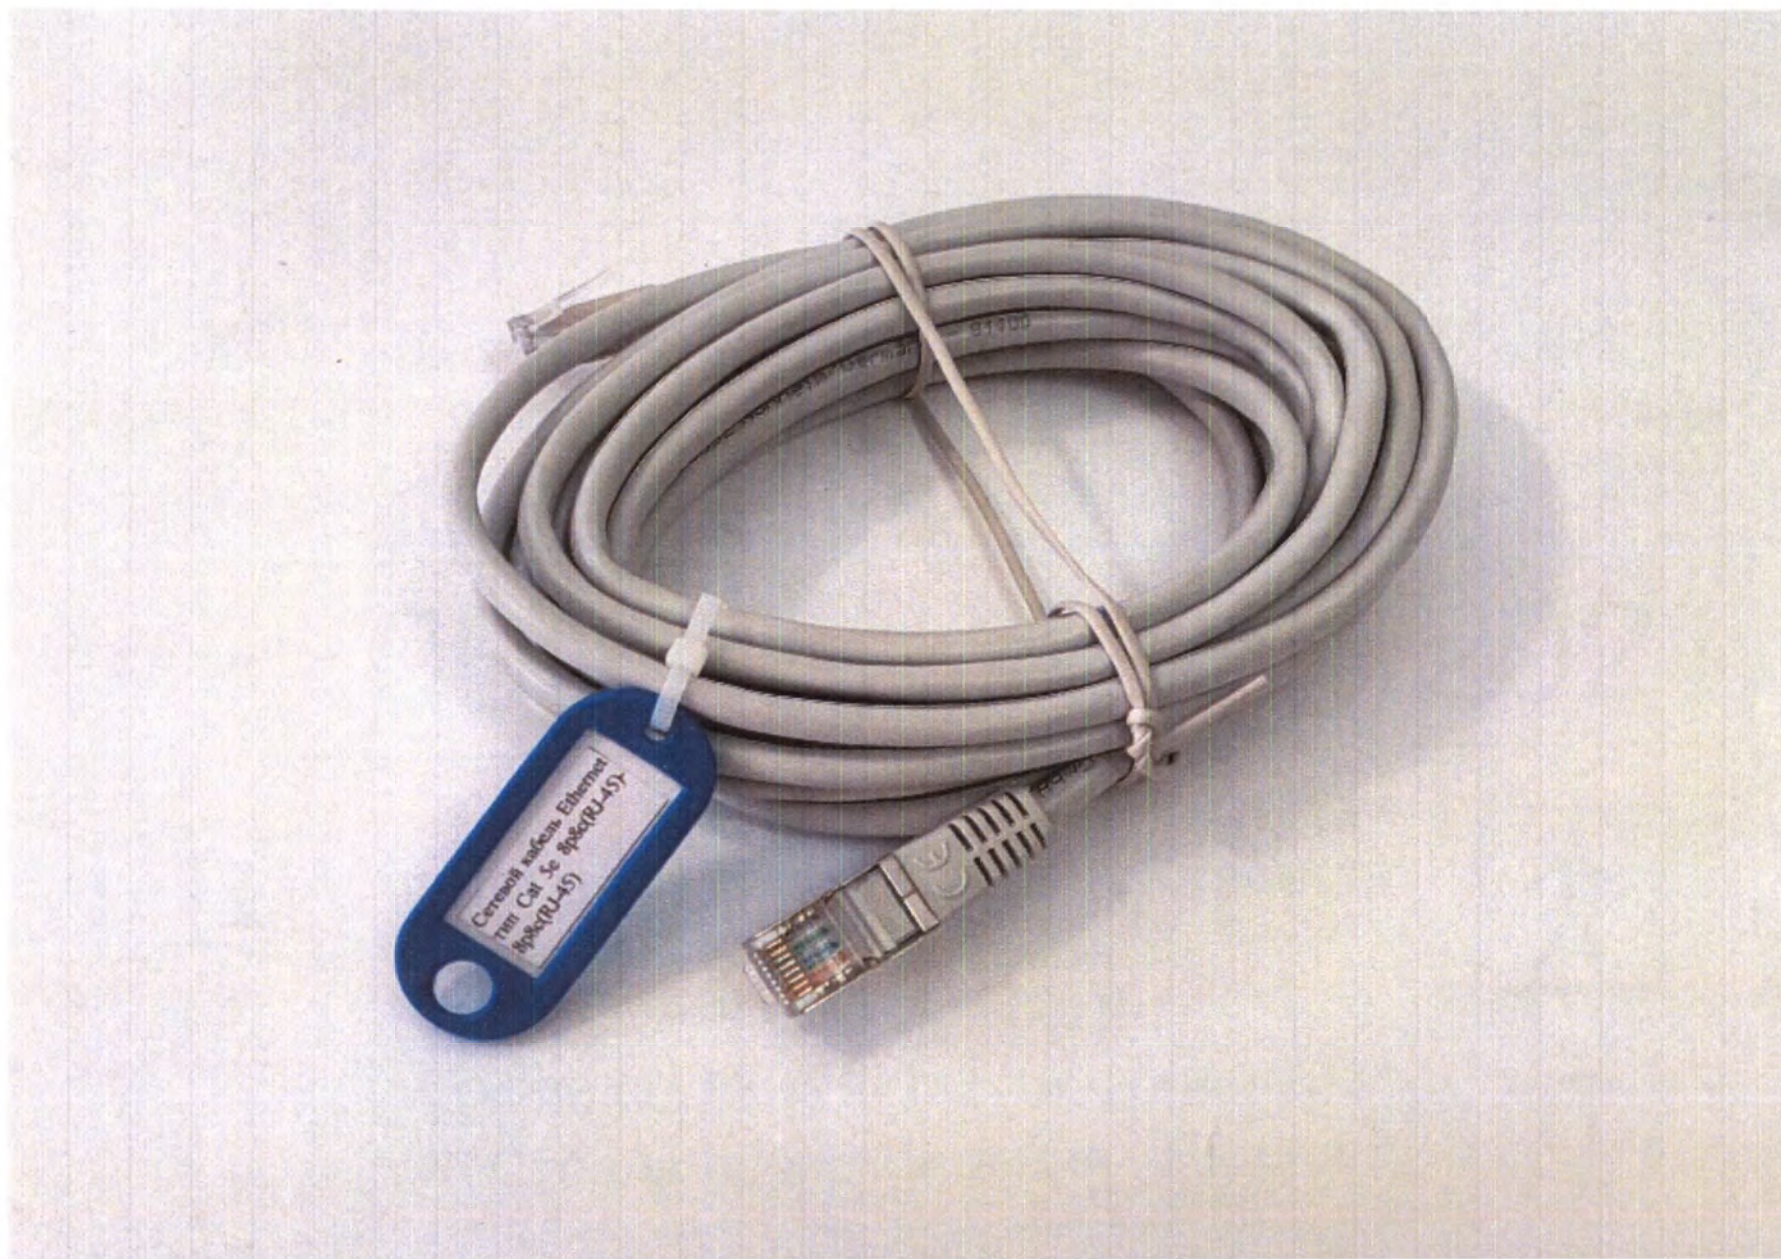

21 Сетевой кабель Ethernet тип Cat 5e 8p8c(RJ-45)- 8p8c(RJ-45), производства «Ningbo Ousheng Electric Co., Ltd», Китай, или производства «5Bites Systems Ltd.», Китай, или производства ООО «КОМПАНИЯ АТКОМ», Россия, или производства «Bion Expert», Китай, или производства «Gembird Software Ltd.», Голландия, или производства «ExeGate», Китай, или производства ООО «М-ИНВЕСТ», Россия, или производства АО «ПЗКМК», Россия, или производства «Hyperline Systems Canada Ltd.» Канада, или производства «Premier Cable», Китай, или производства «Hama GmbH & Co. KG», Германия

АО НПП «СИСТЕМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
КОМПЛЕКС АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
КАПД-02-СТ-МА

ЗАВ №

00003

ДАТА ИЗГОТ.

11.2021



U - 230±23В ~ 50Гц P - 30ВА
(с учетом подключаемых устройств
P-500 ВА)

УХЛ 4.2 IP20



ТУ 26.60.12.129-002-45520949-2021

Страна происхождения - Россия

Маркировка



Комплекс аппаратно-программный определения функционального состояния КАПД-02-СТ-МА

ТУ 26.60.12.129-002-45520949-2021 РУ № _____

АО НПП "Системные технологии"



Россия, 191186, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Дворцовый округ, Невский пр-кт, д. 30, Литера А, помещ. 24-Н, Ком. 2, 28, 29 (Офис 5.3.В), Тел: +7(812)449-18-59 E-mail: office@systemt.ru


SN

0003



11.2021

Транспортирование

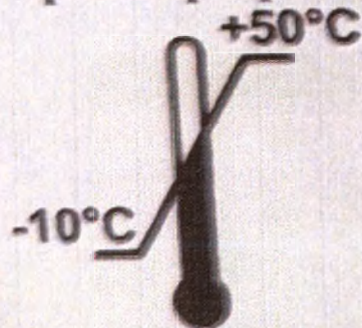

Масса брутто 5,0 кг

Хранение

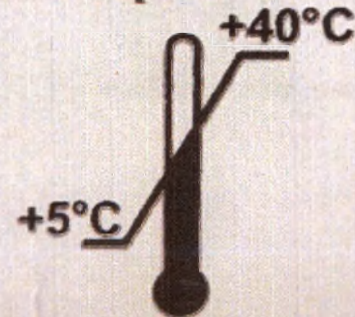


Фото 1: Маркировка транспортной упаковки

Комплекс аппаратно-программный определения функционального состояния КАПД-02-СТ-МА



Комплекс аппаратно-программный определения функционального состояния КАПД-02-СТ-МА

ТУ 26.60.12.129-002-45520949-2021 РУ № _____


АО НПП "Системные технологии"



Россия, 191186, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Дворцовый округ, Невский пр-кт, д. 30, Литера А, помещ. 24-Н, Ком. 2, 28, 29 (Офис 5.3.В), Тел: +7(812)449-18-59 E-mail: office@systemt.ru


SN

0003



11.2021

Транспортирование

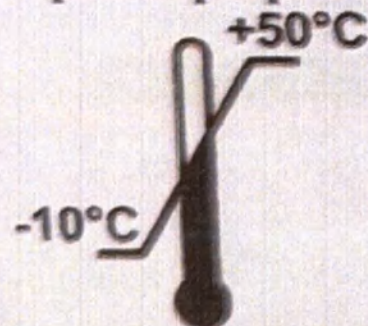

Масса брутто 5,0 кг

Хранение

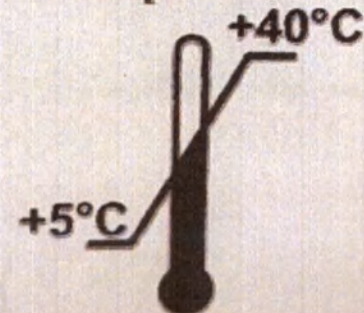


Фото 1: Маркировка транспортной упаковки



Фото 2: Маркировка транспортной упаковки

Комплекс аппаратно-программный определения функционального состояния КАПД-02-СТ-МА

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью

34 (тридцать четыре) лист (2)

Руководитель организации:



[Signature]

М.В. Рюхин

«УТВЕРЖДАЮ»



Исполнительный директор
АО НПП «Системные технологии»

М.В. Рюхин

» июля 20 23 г.


Фотографическое изображение медицинского изделия:

Комплекс аппаратно-программный
определения функционального состояния КАПД-02-СТ по ТУ 26.60.12.129-002-45520949-2021

Модификация

«Комплекс аппаратно-программный определения функционального состояния КАПД-02-СТ-МО»

2023

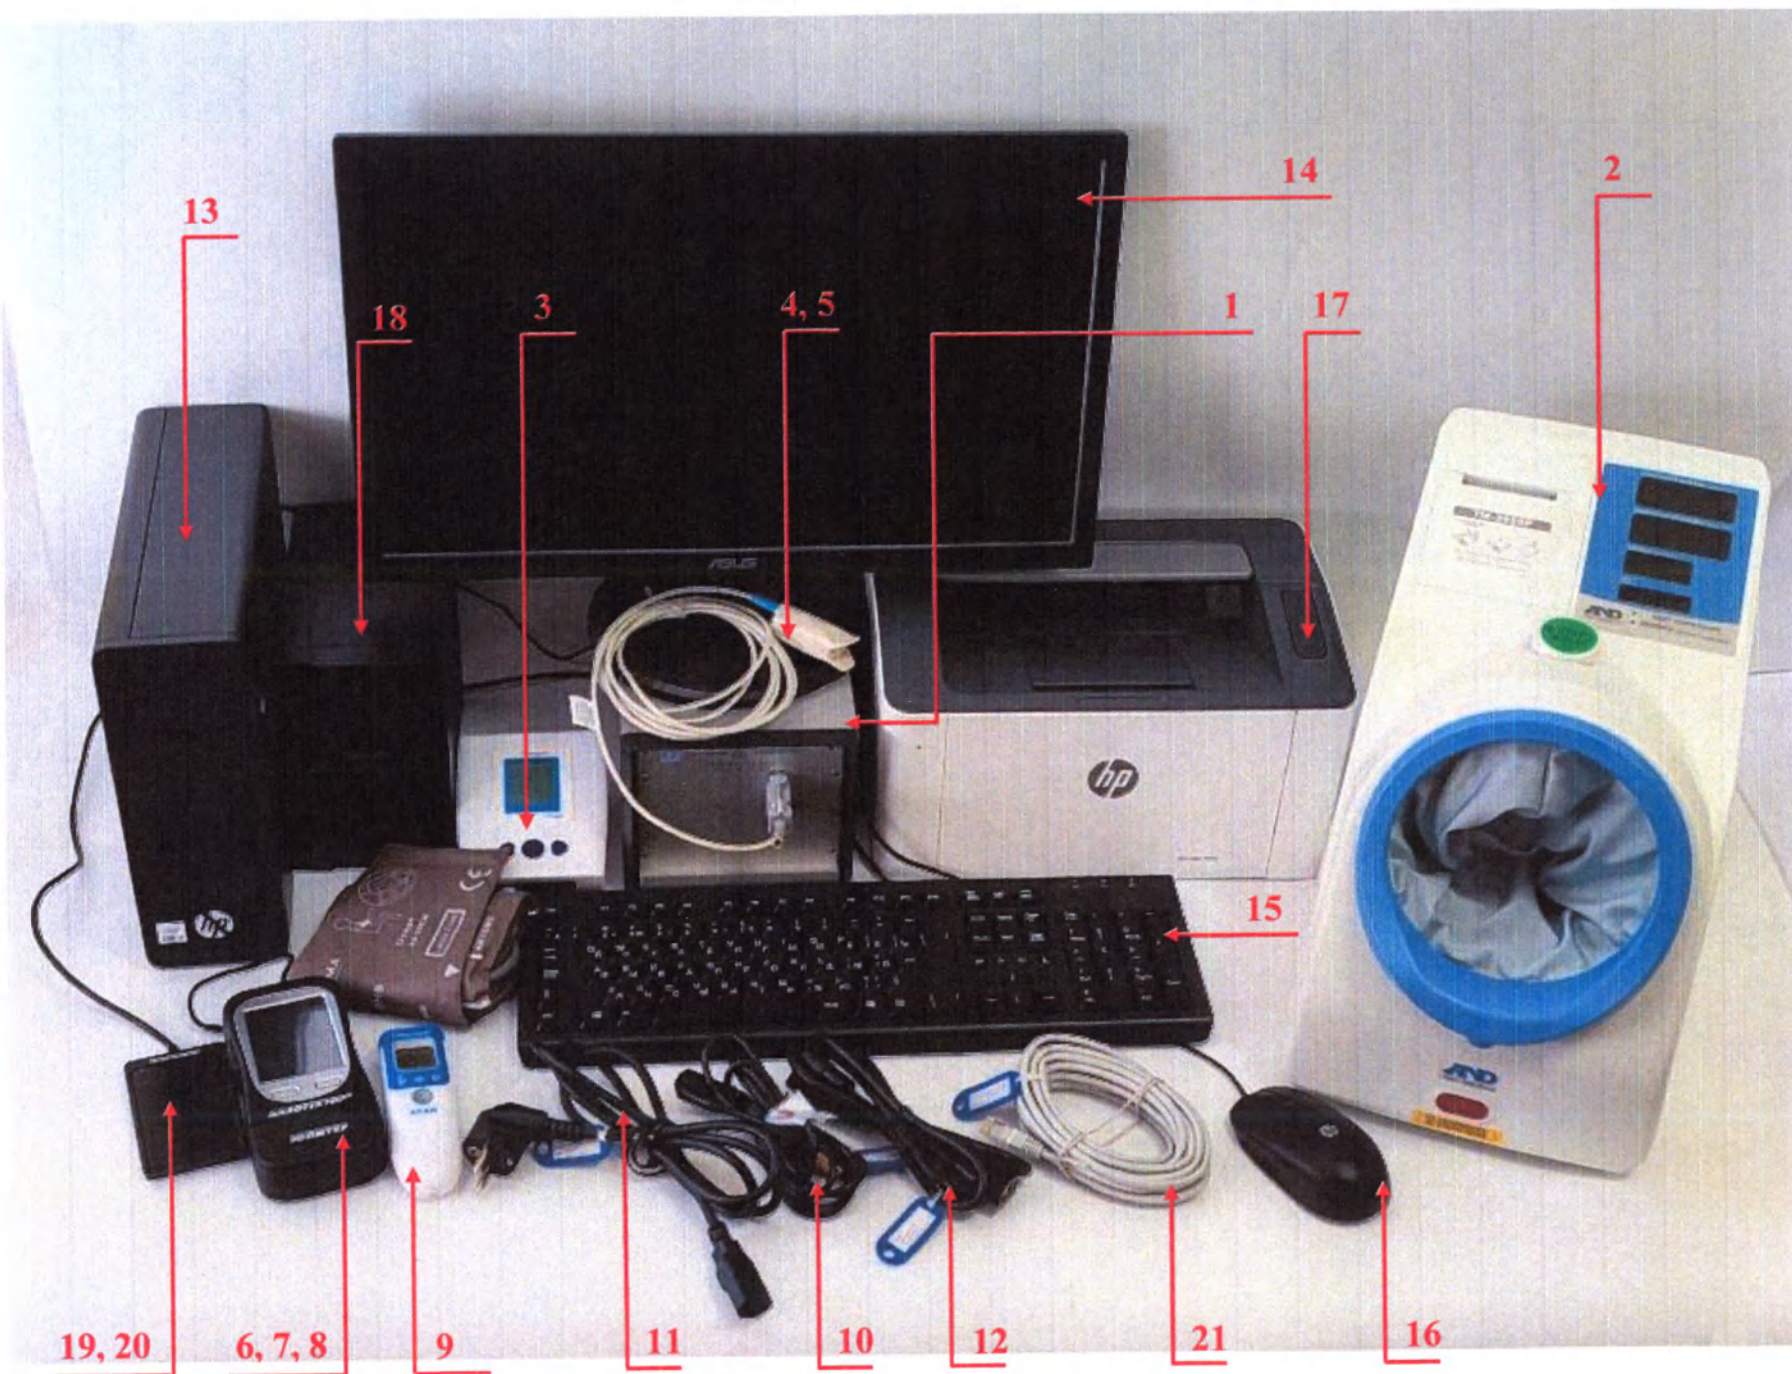



1 Электронный блок КАПД-02-СТ-МО




2 Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический цифровой с принадлежностями, модель ТМ-2655Р, производства


«Эй энд ДИ Компани Лимитед», Япония, РУ №РЗН 2013/283



МАРКИРОВКА: Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический цифровой с принадлежностями, модель ТМ-2655Р, производства «Эй энд ДИ Компани Лимитед», Япония, РУ №РЗН 2013/283

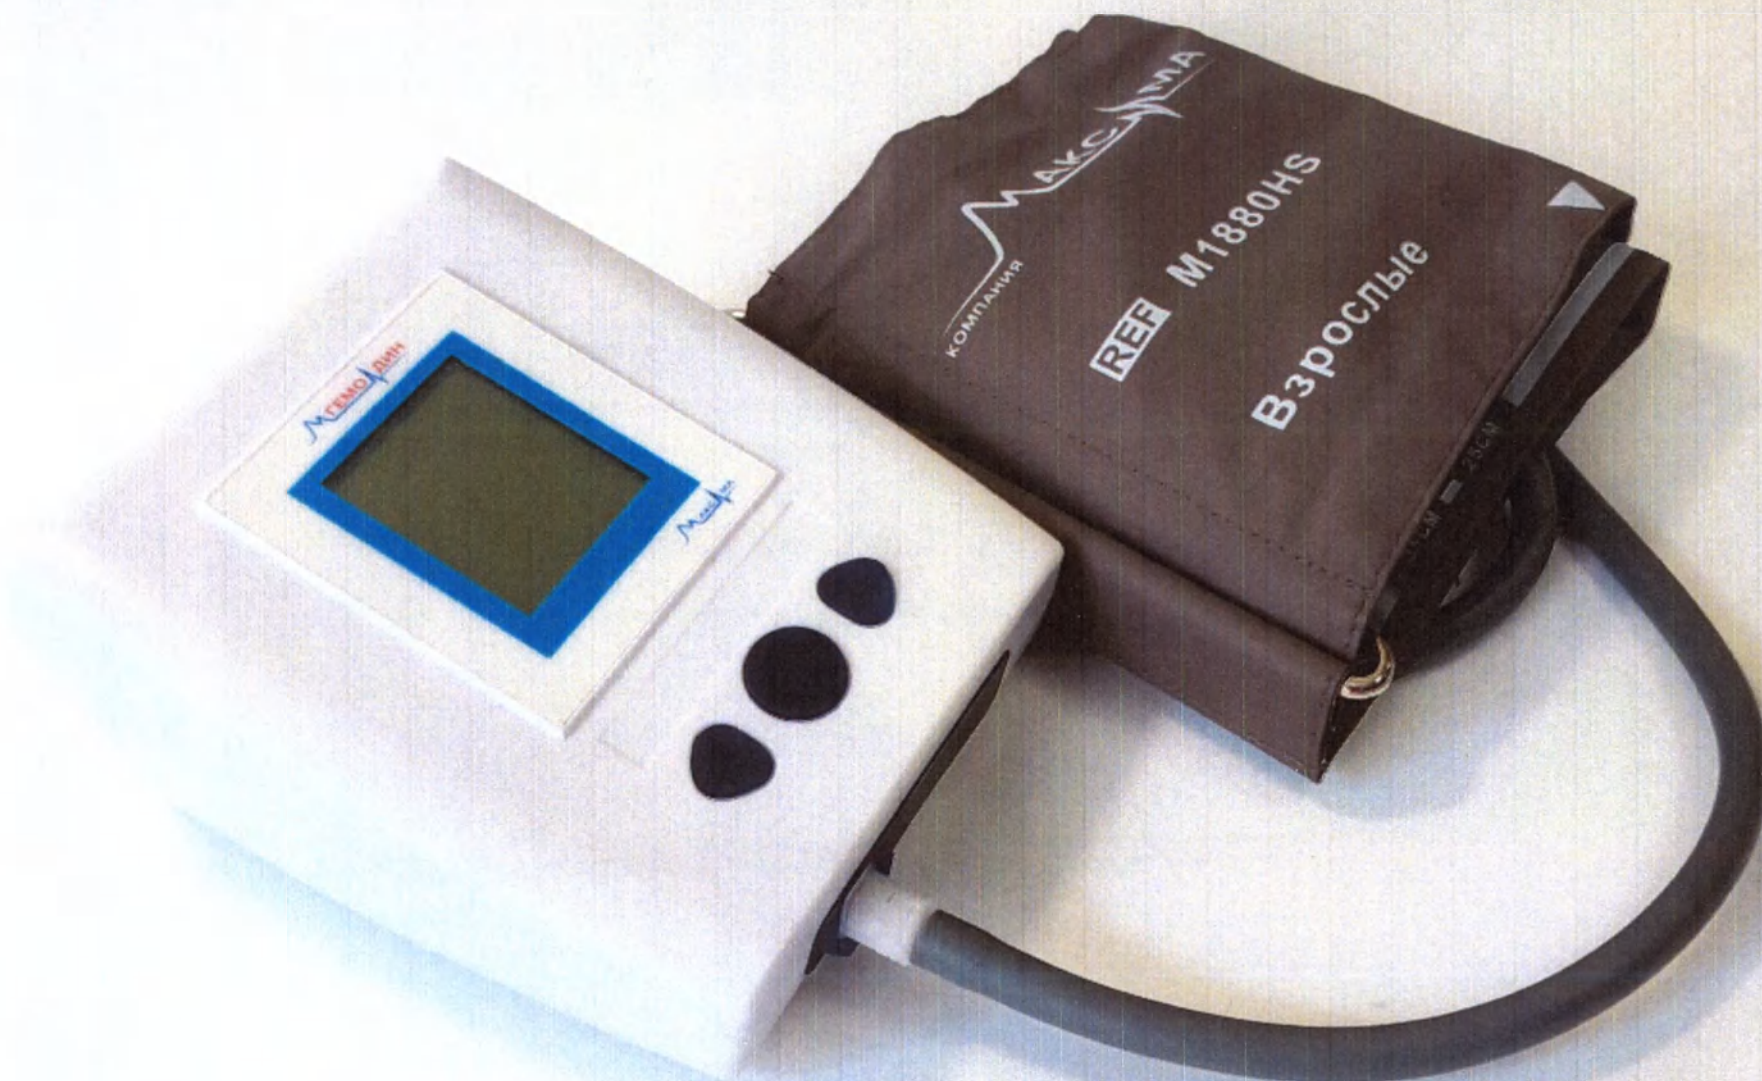


3 Измеритель артериального давления и анализатор параметров кровообращения осциллометрический, автоматически передающий результаты измерения в телеметрическую систему "ГемоДин-АКСМА", модель "ГемоДин-ВТ" по ТУ ТНШВ. 941111.001ТУ, производства ООО «АКСМА», Россия, РУ №РЗН 2020/10110

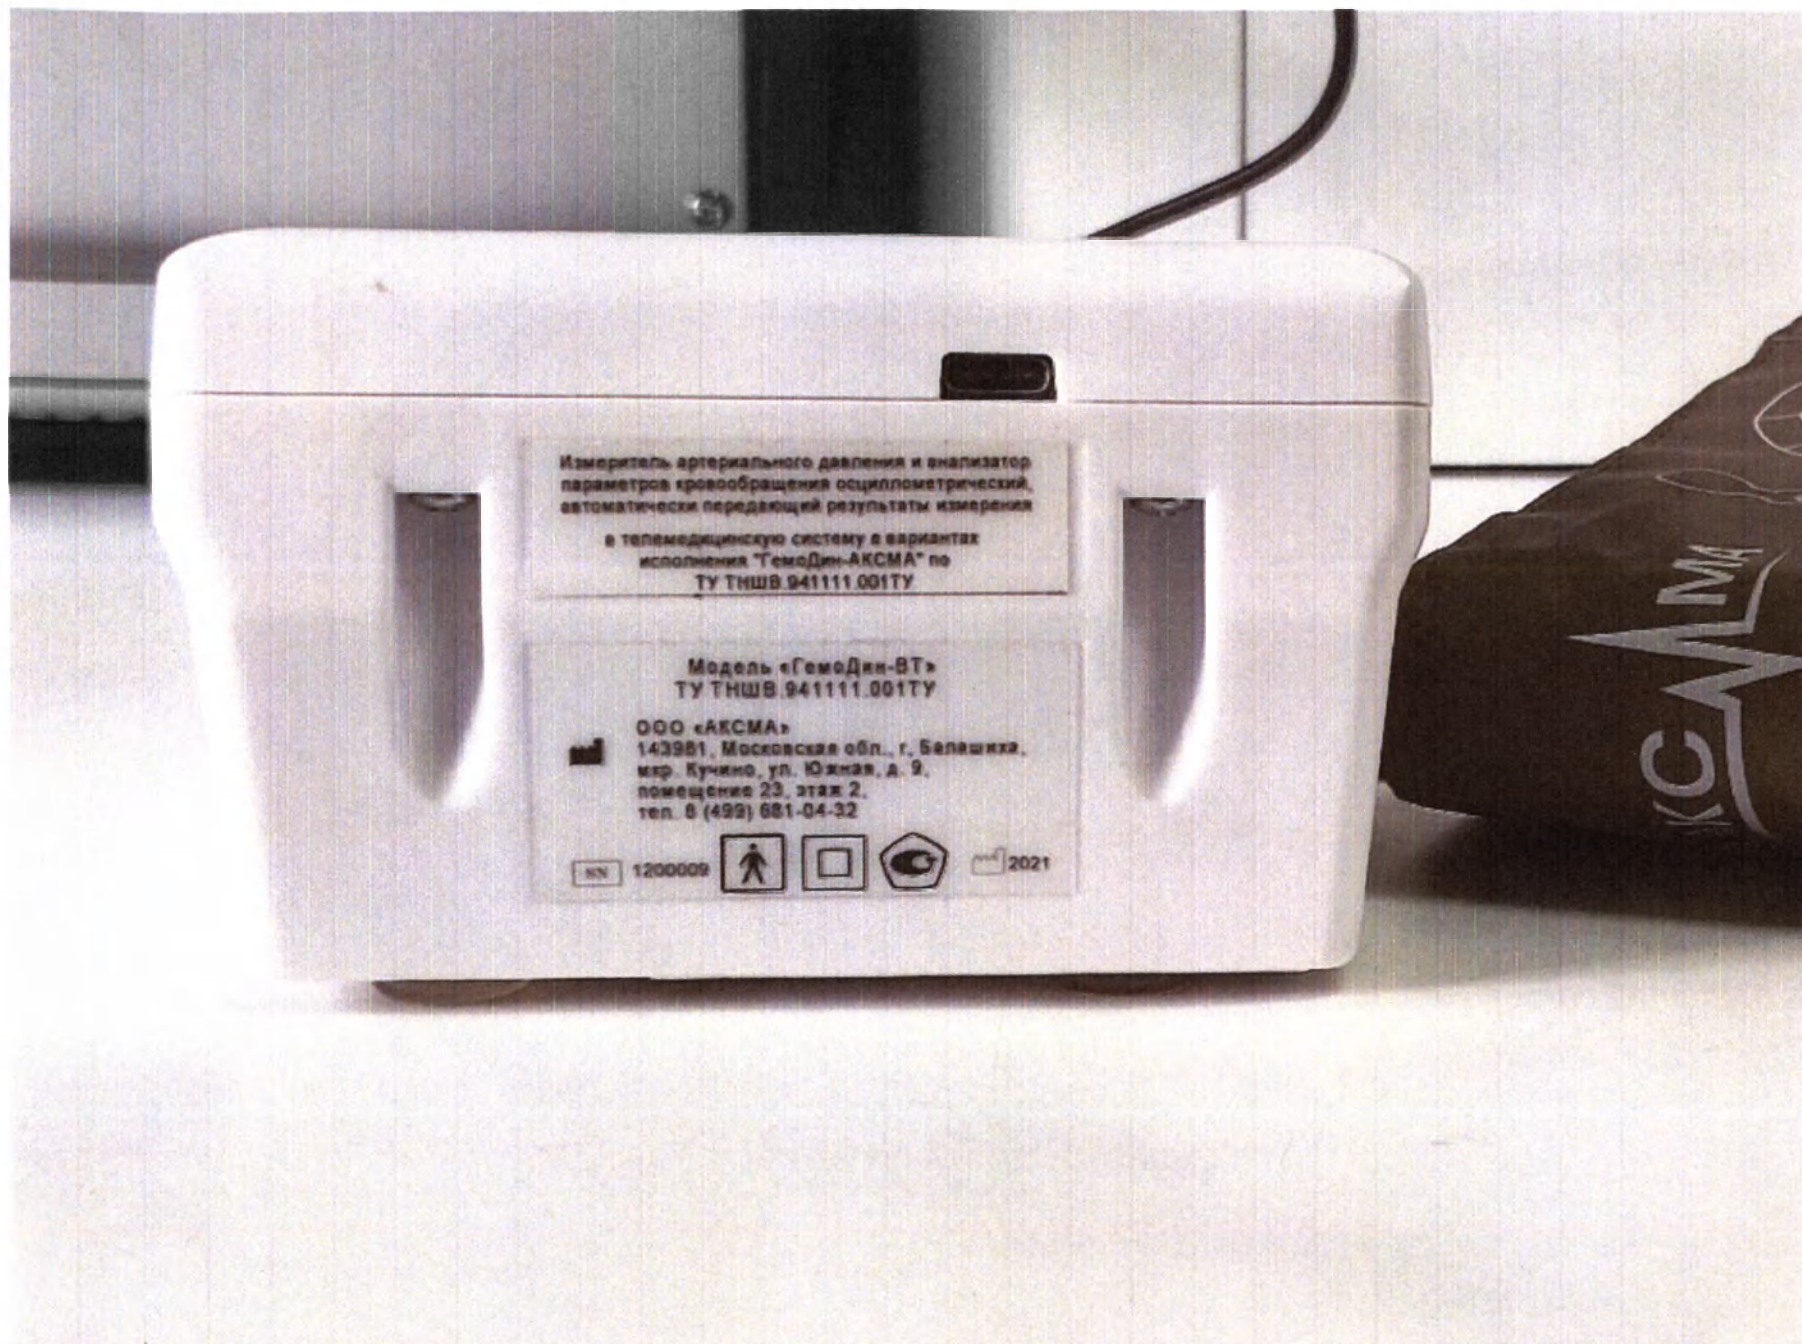


Измеритель артериального давления и анализатор параметров кровообращения осциллометрический, автоматически передающий результаты измерения в телемедицинскую систему в варианте исполнения "ГемоДин-АКСМА" по ТУ ТНШВ.941111.001ТУ

Модель «ГемоДин-ВТ»
ТУ ТНШВ.941111.001ТУ

ООО «АКСМА»
143981, Московская обл., г. Балашиха,
мкр. Кучино, ул. Южная, д. 9,
помещение 23, этаж 2,
тел. 8 (499) 681-04-32




МАРКИРОВКА: Измеритель артериального давления и анализатор параметров кровообращения осциллометрический, автоматически передающий результаты измерения в телемедицинскую систему "ГемоДин-АКСМА", модель "ГемоДин-ВТ" по ТУ ТНШВ. 941111.001ТУ, производства ООО «АКСМА», Россия, РУ №РЗН 2020/10110

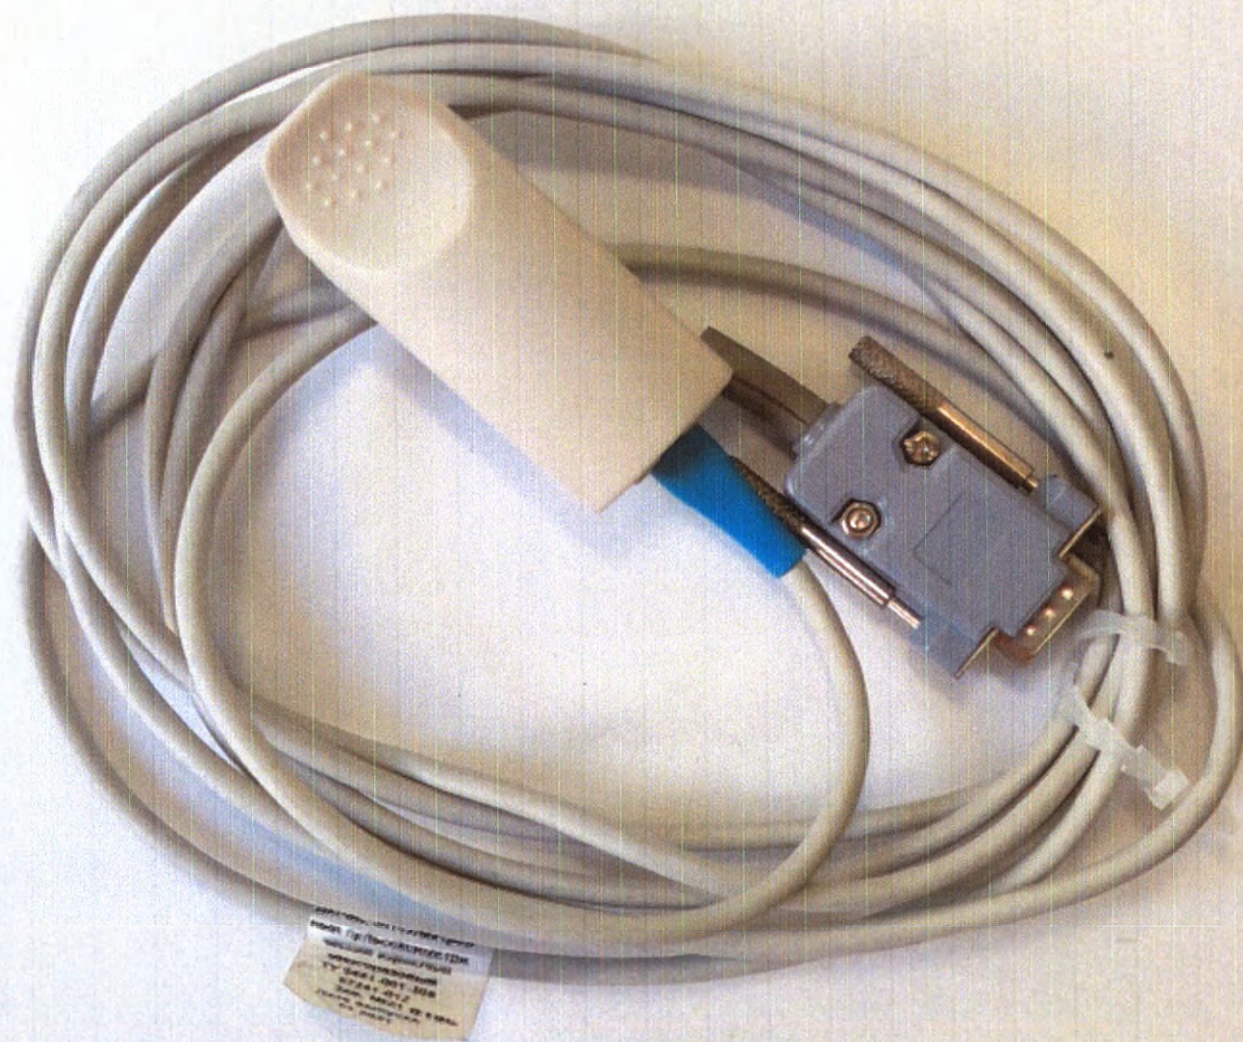



МАРКИРОВКА: Датчики оптоэлектронные пульсоксиметрические взрослые и неонатальные многоцветные по ТУ 9441-001-30857241-2012: Датчик

оптоэлектронный пульсоксиметрический взрослый многоцветный, артикул ДАСМ. 012.542.1, производства ООО «Аксиома», Россия, РУ №РЗН 2013/658

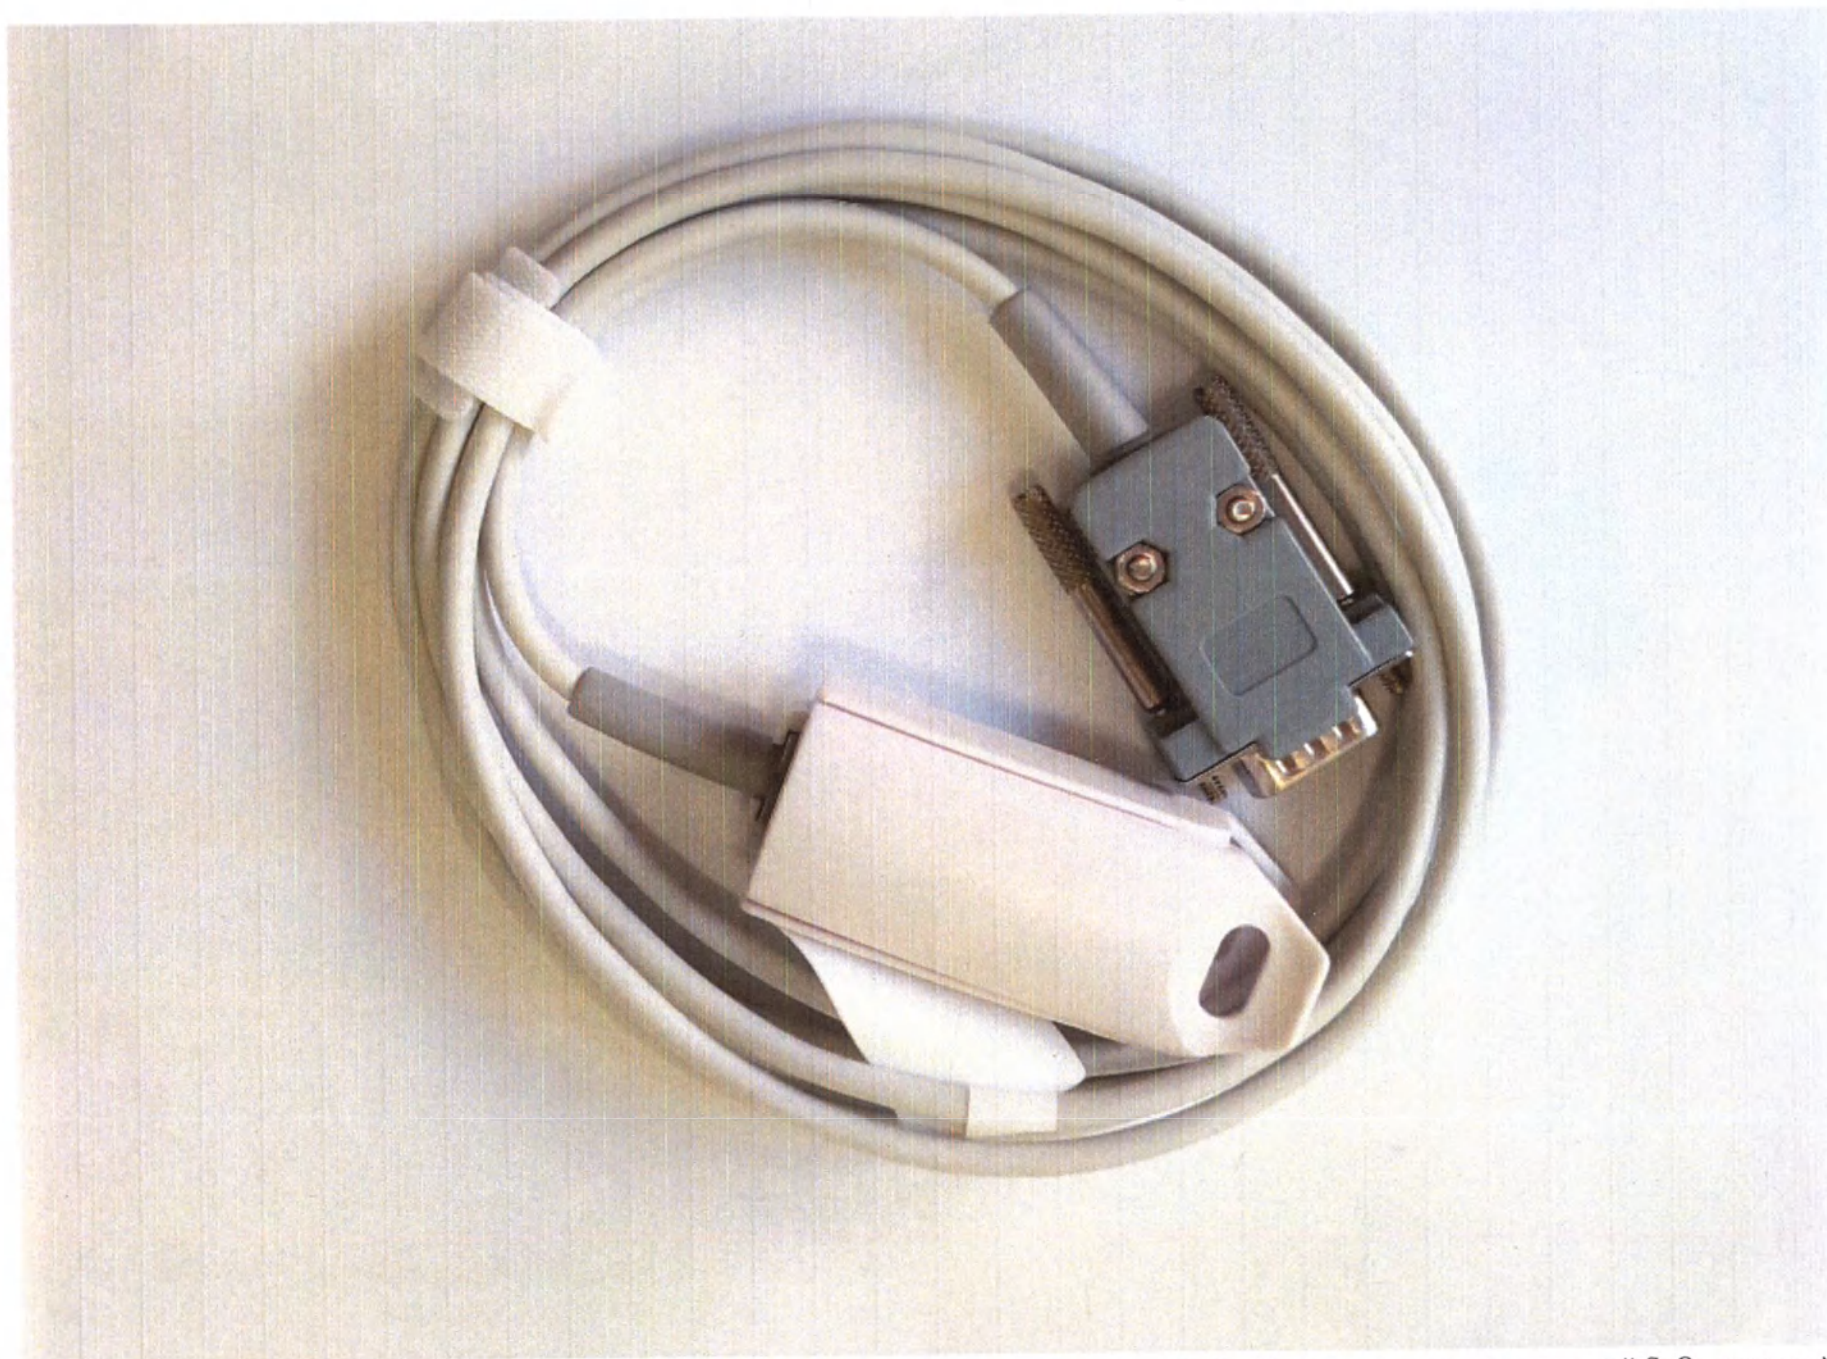


5 Датчики пульсоксиметрические SpO₂, кабели-удлинители для датчиков пульсоксиметрических SpO₂: Датчик пульсоксиметрический SpO₂, взрослый, тип

Датчик пульсоксиметрический SpO₂, взрослый, тип клипса, длинный кабель
ES-LA010, коннектор OxiMax DB9M совместим с Nellcor Non-OxiMax DB9M




REF ES-LA010 (#H: 1574)



Для подключения датчика может потребоваться
кабель-переходник (приобретается отдельно)

Для взрослых >30KG



Произведен Shenzhen EMS LIFE Technology Co., Limited
No. 02, 4F, No. 145-7, Furui Road, Tayong Industrial Park,
Fuyong Town, Baoan District, Shenzhen, P.R. China

РУ МИ РЗН 2015/2683
от 15/07/2015
срок не ограничен

30/10/24

30/10/19

МАРКИРОВКА: Датчики пульсоксиметрические SpO₂, кабели-удлинители для датчиков пульсоксиметрических SpO₂: Датчик пульсоксиметрический SpO₂,
взрослый, тип клипса, длинный кабель ES-LA010, производства «Шеньжень ЕМС ЛАЙФ Текнолоджи Ко., Лтд.», КНР, РУ №РЗН 2015/2683



6 Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе "АЛКОТЕКТОР" в исполнениях "Юпитер", "Юпитер-К", "Юпитер-П" по ТУ 26.60.12-001-82139963-2011:

Исполнение «Юпитер», производства ООО «АЛКОТЕКТОР», Россия, РУ №ФСР 2012/13090




МАРКИРОВКА: Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе "АЛКОТЕКТОР" в исполнениях "Юпитер", "Юпитер-К", "Юпитер-П"




7 Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе «АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch-M» с принадлежностями, производства «Шеньчжень Велл Электрик Кампании Лтд.», Китай, РУ №ФСЗ 2011/10061



МАРКИРОВКА: Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе «АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch-M» с принадлежностями, производства «Шеньчжень Велл Электрик Кампании Лтд.», Китай, РУ №ФСЗ 2011/10061

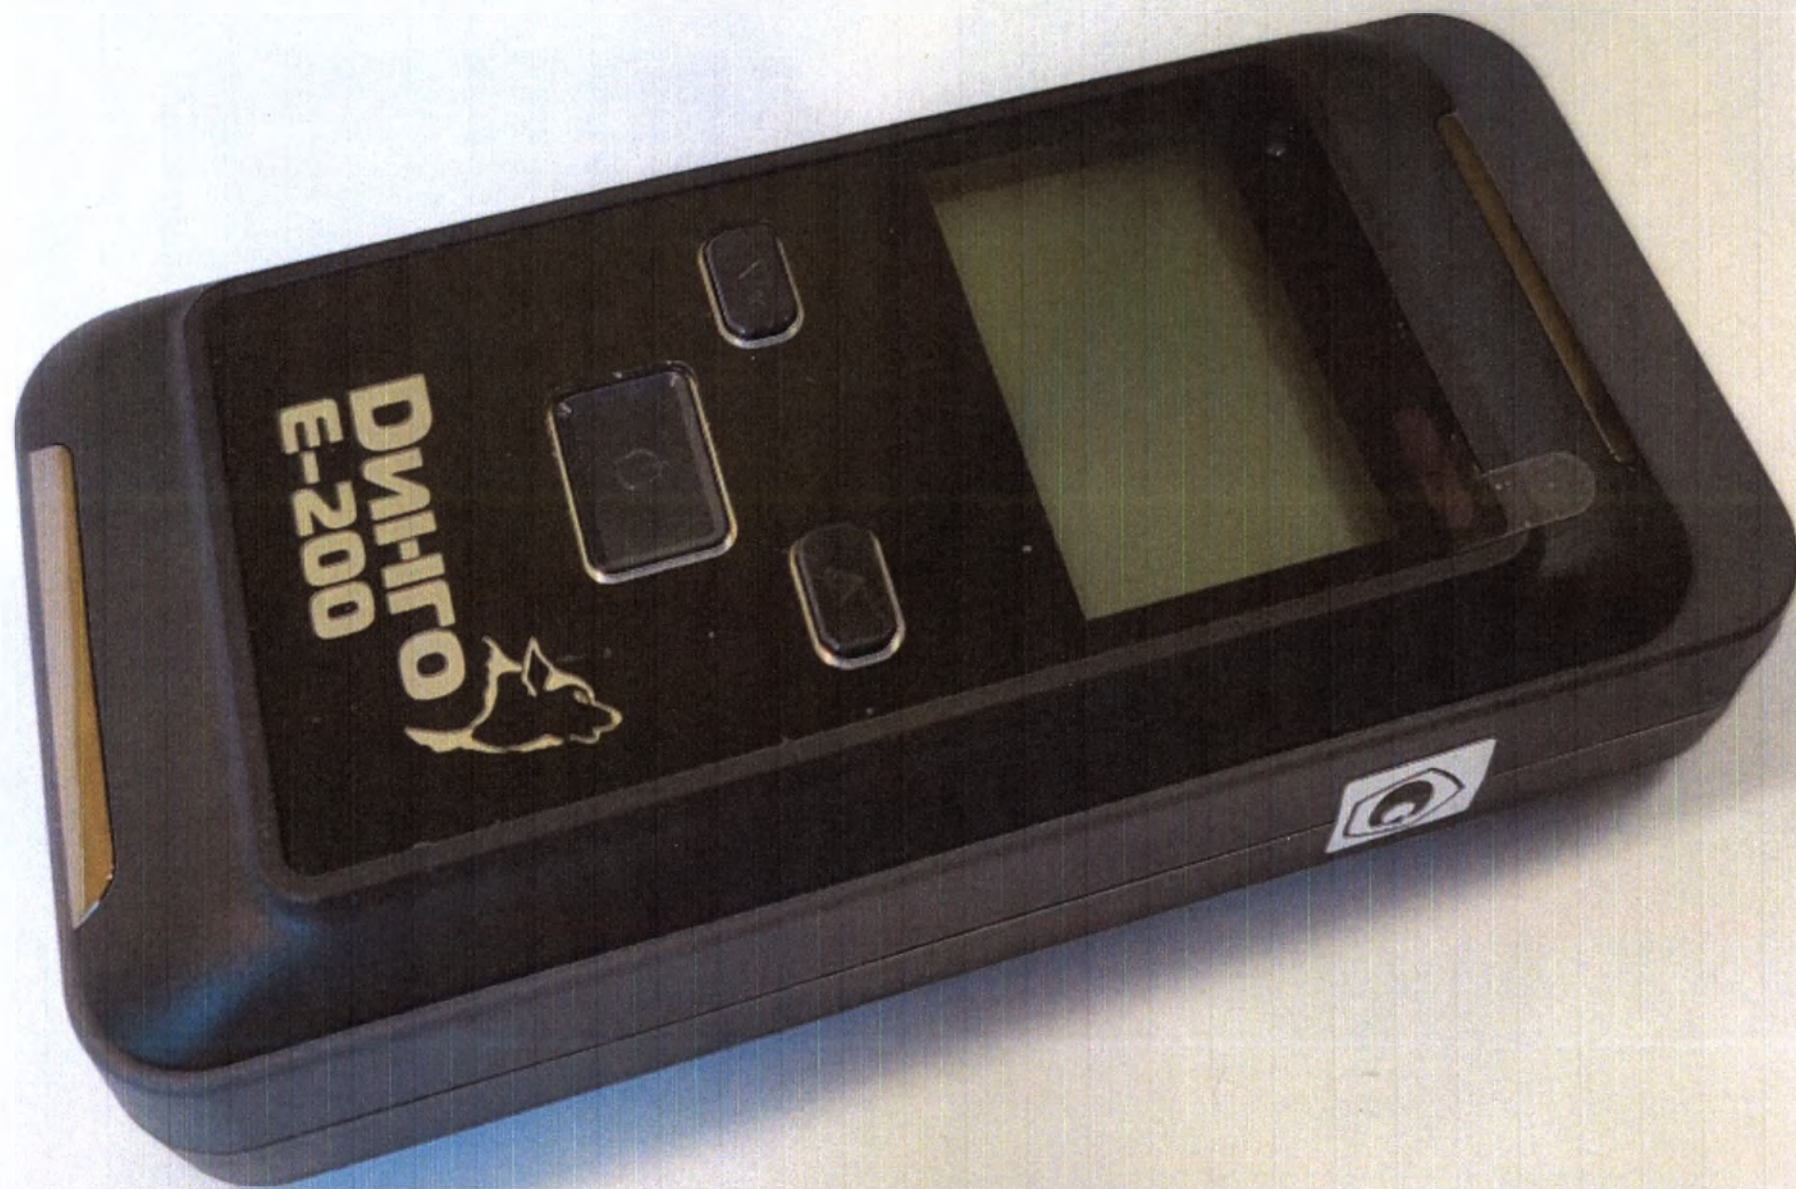

8 Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе Динго с принадлежностями, вариант исполнения: Динго E-200 (В), производства «Сентек Корея Корп.», Корея, РУ №РЗН 2014/1689

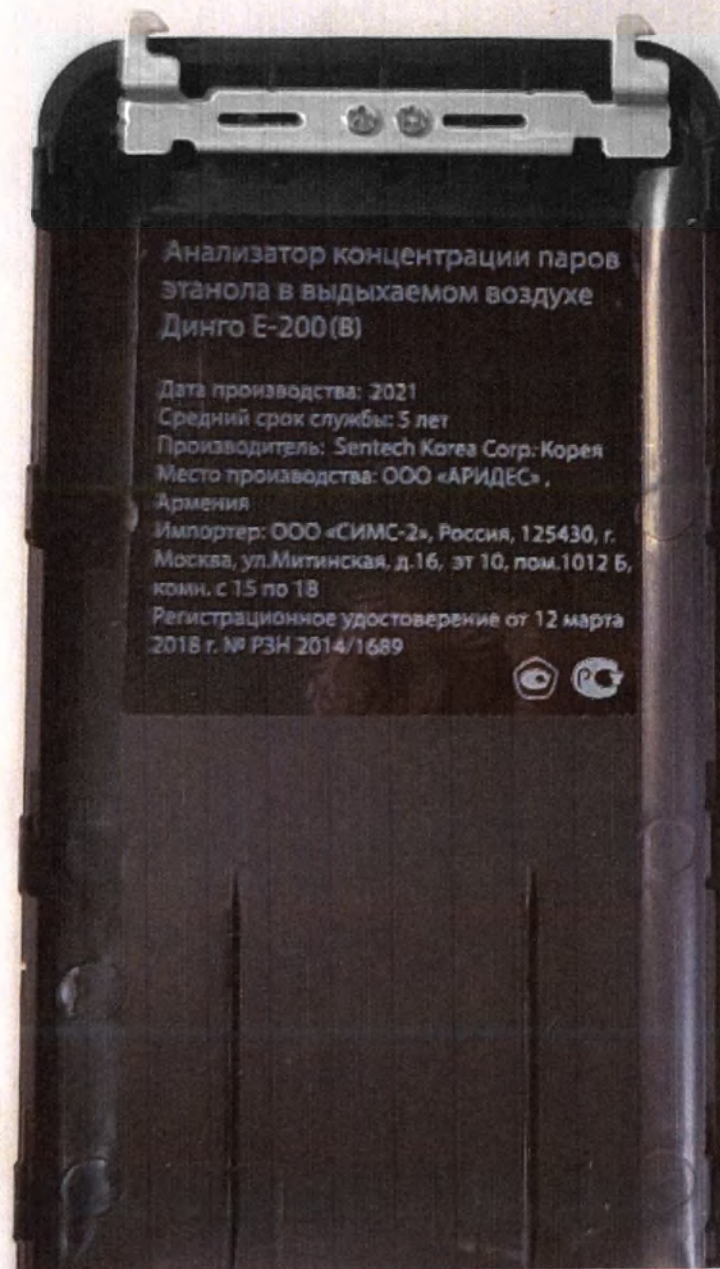

Анализатор концентрации паров
этаноло в выдыхаемом воздухе
Динго Е-200 (В)

Дата производства: 2021

Средний срок службы: 5 лет



Производитель: Sentech Korea Corp. Корея

Место производства: ООО «АРИДЕС»,

Армения

Импортер: ООО «СИМС-2», Россия, 125430, г.
Москва, ул. Митинская, д. 16, эт 10, пом. 1012 Б,
комн. с 15 по 18

Регистрационное удостоверение от 12 марта
2018 г. № РЗН 2014/1689

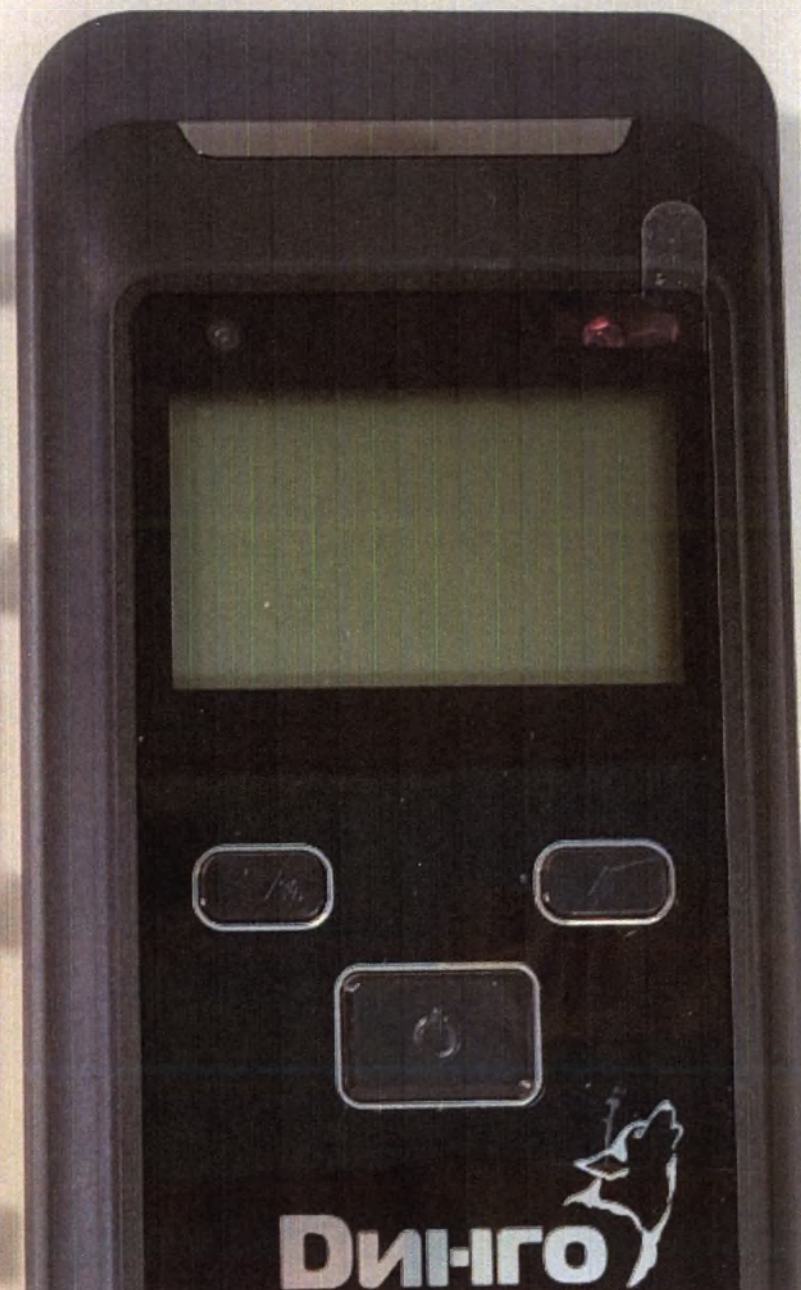

Динго


МАРКИРОВКА: Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе Динго с принадлежностями, вариант исполнения: Динго Е-200 (В),
производства «Сентек Корея Корп.», Корея, РУ №РЗН 2014/1689




9 Бесконтактный инфракрасный термометр Derrcom, вариант исполнения JXB-183, производства «Джинхинбао Электроник Ко, Лтд», Китай, РУ №РЗН 2013/737




МАРКИРОВКА: Бесконтактный инфракрасный термометр Вегсом, вариант исполнения JXB-183, производства «Джинхинбао Электроник Ко, Лтд», Китай, РУ №РЗН 2013/737

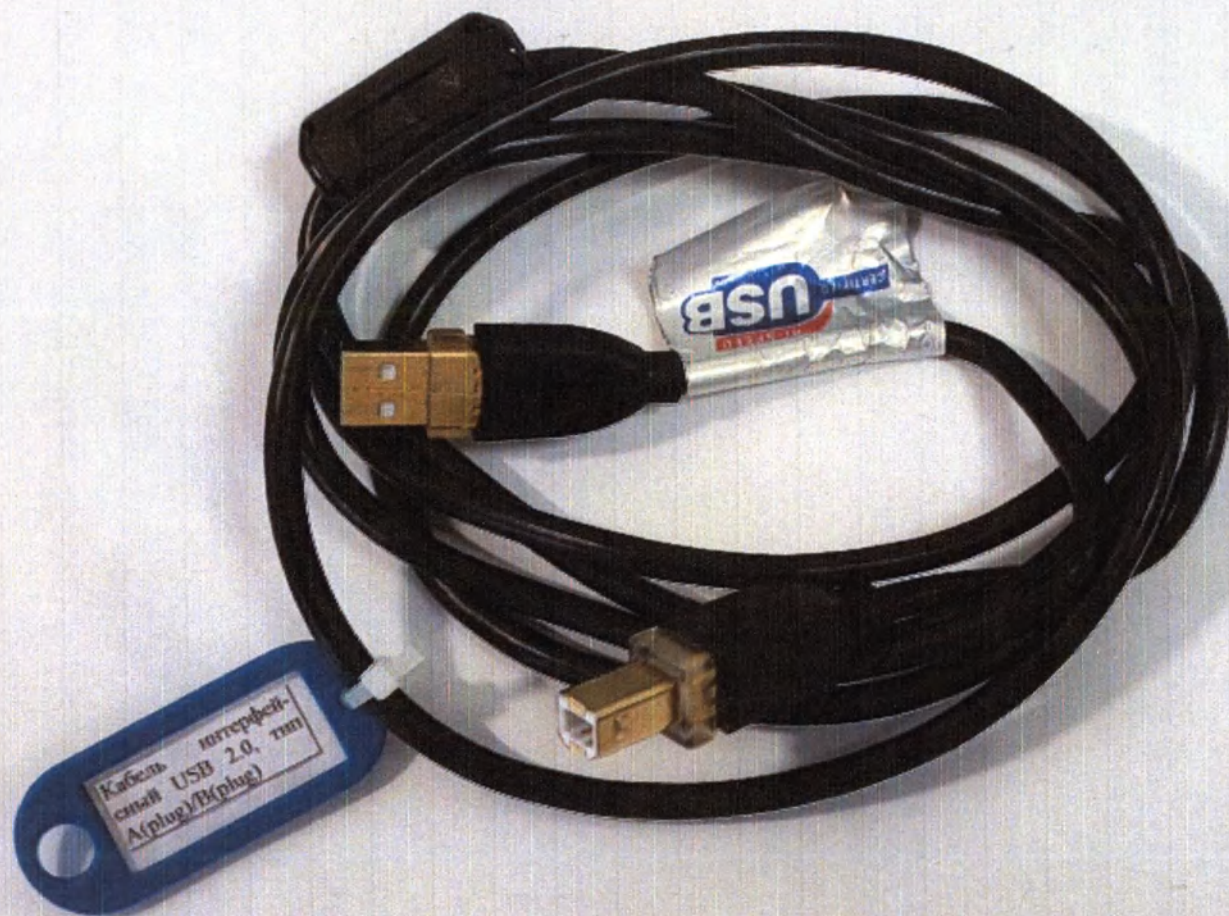


10 Кабель интерфейсный USB 2.0, тип A(plug)/B(plug), производства «Ningbo Ousheng Electric Co., Ltd», Китай, или производства «5Bites Systems Ltd.», Китай, или производства ООО «КОМПАНИЯ АТКОМ», Россия, или производства «Bion Expert», Китай, или производства «Gembird Software Ltd.», Голландия, или производства ООО «М-ИНВЕСТ», Россия, или производства АО «ПЗКМК», Россия, или производства «Hyperline Systems Canada Ltd.», Канада, или производства «Premier Cable», Китай, или производства «Hama GmbH & Co. KG», Германия

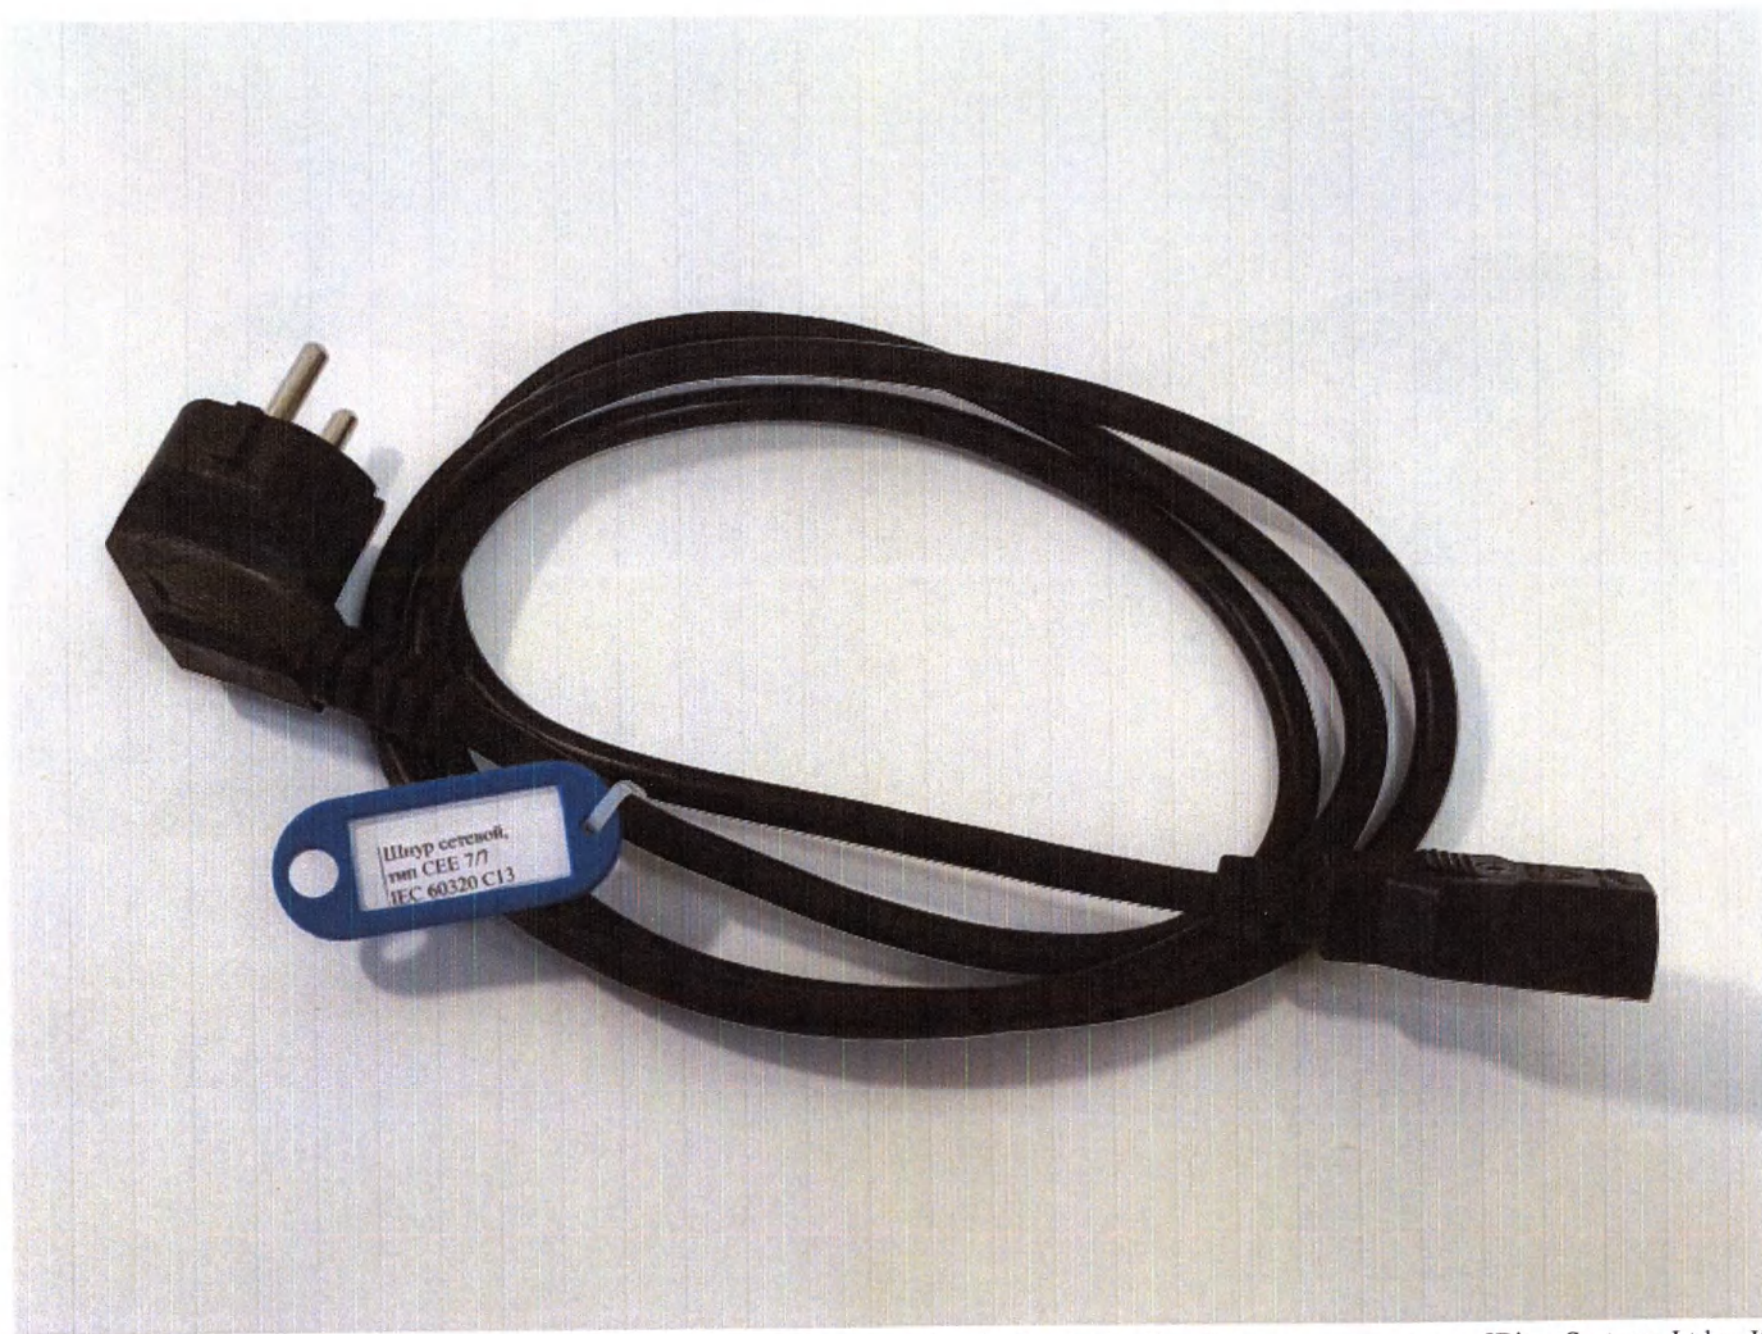

11 Шнур сетевой, тип CEE 7/7 - IEC 60320 C13, производства «Ningbo Ousheng Electric Co., Ltd», Китай, или производства «5Bites Systems Ltd.», Китай, или производства ООО «КОМПАНИЯ АТКОМ», Россия, или производства «Bion Expert», Китай, или производства «Gembird Software Ltd.», Голландия, или производства ООО «М-ИНВЕСТ», Россия, или производства АО «ПЗКМК», Россия, или производства «Hyperline Systems Canada Ltd.», Канада, или производства «Premier Cable», Китай

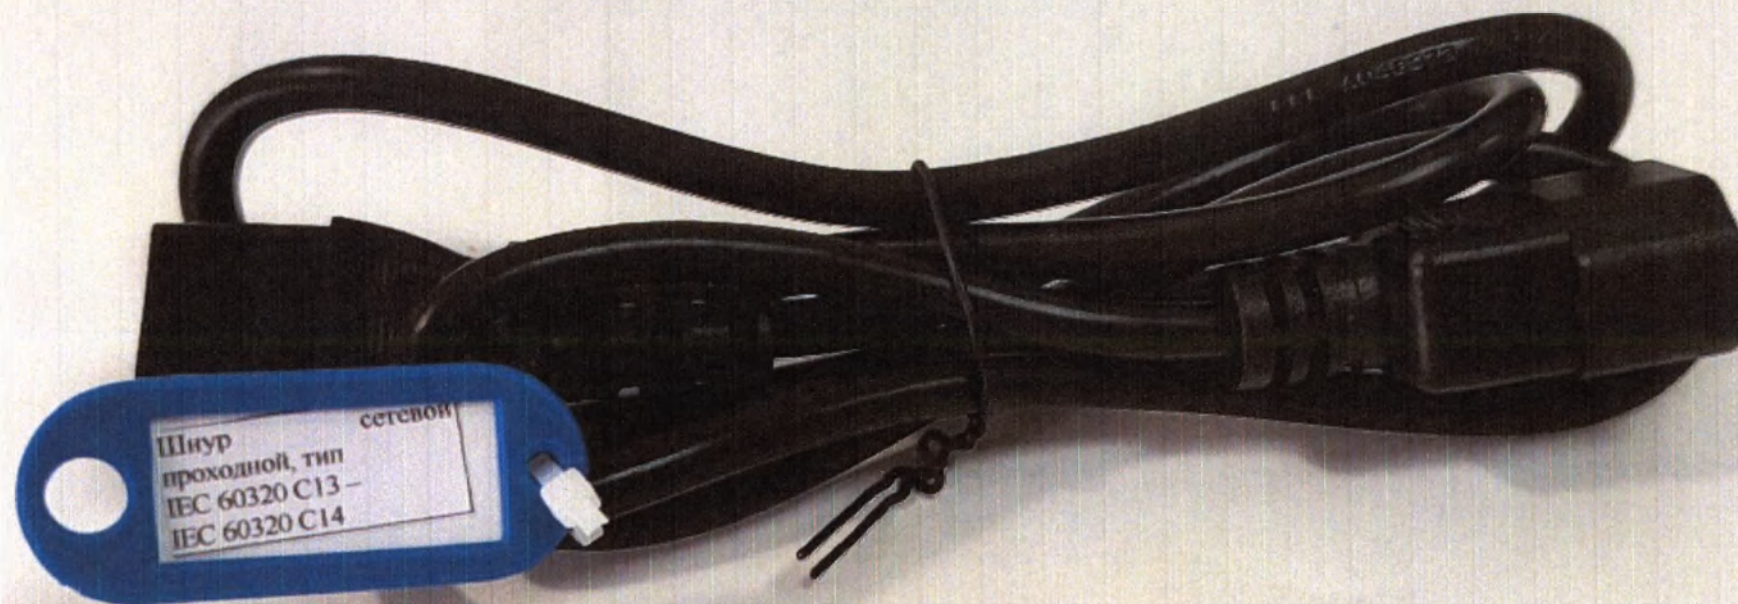

12 Шнур сетевой проходной, тип IEC 60320 C13 - IEC 60320 C14, производства «Ningbo Ousheng Electric Co., Ltd», Китай, или производства «5Bits Systems Ltd.», Китай, или производства ООО «КОМПАНИЯ АТКОМ», Россия, или производства «Bion Expert», Китай, или производства «Gembird Software Ltd.», Голландия, или производства «ExeGate», Китай, или производства ООО «М-ИНВЕСТ», Россия, или производства АО «ПЗКМК», Россия, или производства «Purpine Systems Canada Ltd.», Канада, или производства «Premier Cable», Китай

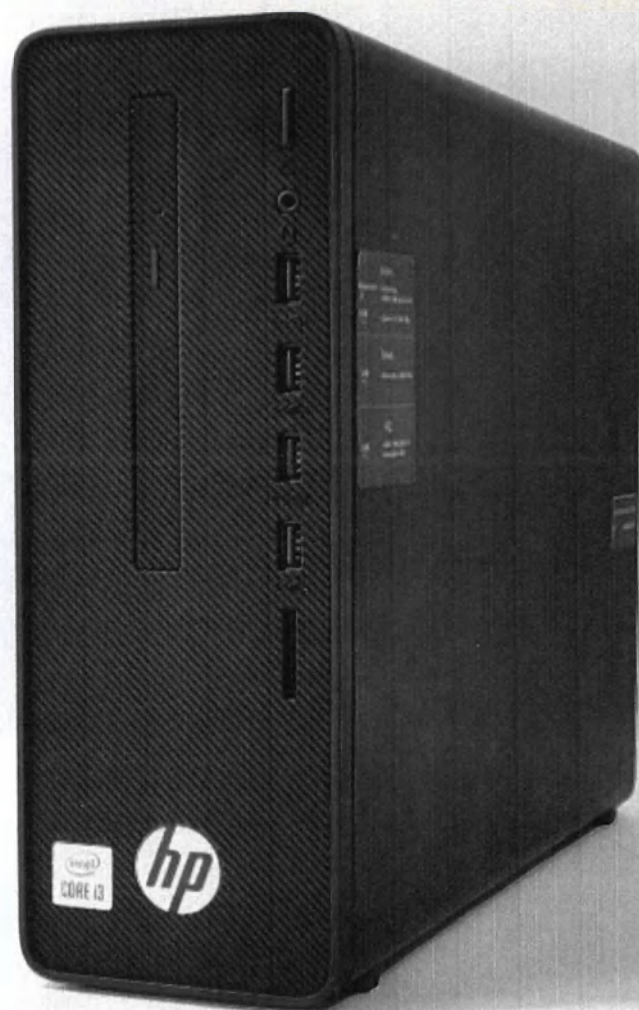


13 Персональный компьютер с предустановленным клиентским программным обеспечением, марки «HP», производства «HP Inc.», США, или марки «XCOMputer» по ТУ 26.20.14-001-76557231-2022, производства ООО «М-ИНВЕСТ», Россия, или марки «XComPuter» по ТУ 26.20.13-000-003-99599118-2018, производства ООО «М-ИНВЕСТ», Россия, или марки «VEKUS» по ЦДТВ.466219.001 ТУ, производства ООО «ЦКТ «ВЕКУС», Россия, или марки «iRU» по 002-90521719-2019), производства ООО «ДЕЛОВОЙ ОФИС», Россия, или марки «Acer», производства «Acer Inc.», Китай, или марки «Lenovo», производства «Lenovo Group Limited», Китай, или марки «MSI», производства «Micro-Star International Co., Ltd.», Китай




14 Монитор, марки «ASUS», производства «ASUSTek Computer Inc.», Китай, или марки «Dell», производства «Wistron Corporation», Китай, или марки «Acer», производства «Acer Inc.», Китай, или марки «Benq», производства «Benq Corporation», Китай, или марки «HP», производства «HP Inc.», США, или марки «LG», производства «LG Electronics», Республика Корея, или марки «Samsung», производства «Samsung Electronics Co., Ltd.», Республика Корея, или марки «Iiyama», производства «IYAMA CORPORATION», Нидерланды, или марки «MSI», производства «Micro-Star International Co., Ltd.», Китай, или марки «Philips», производства «Philips», Нидерланды, или марки «ViewSonic», производства «ViewSonic Corporation», США, или марки «NEC», производства «Nippon Electric Corporation», Япония



16 Мышь, марки «HP», производства «HP Inc.», США, или марки «ASUS», производства «ASUSTek Computer Inc.», Китай, или марки «Acer», производства «Acer Inc.», Китай, или марки «Lenovo», производства «Lenovo Group Limited», Китай, или марки «MSI», производства «Micro-Star International Co., Ltd.», Китай, или марки «Dell», производства «Wistron Corporation», Китай, или марки «Logitech», производства «Logitech Europe S.A.», Швейцария, или марки «Genius», производства «KYE SYSTEMS CORP.», Китай, или марки «Gembird», производства «Gembird Software Ltd.», Голландия, или марки «A4Tech», производства «A4Tech», Тайвань, или марки «НАМА», производства «Nana GmbH & Co. KG», Германия, или марки «ExeGate», производства «ExeGate», Китай

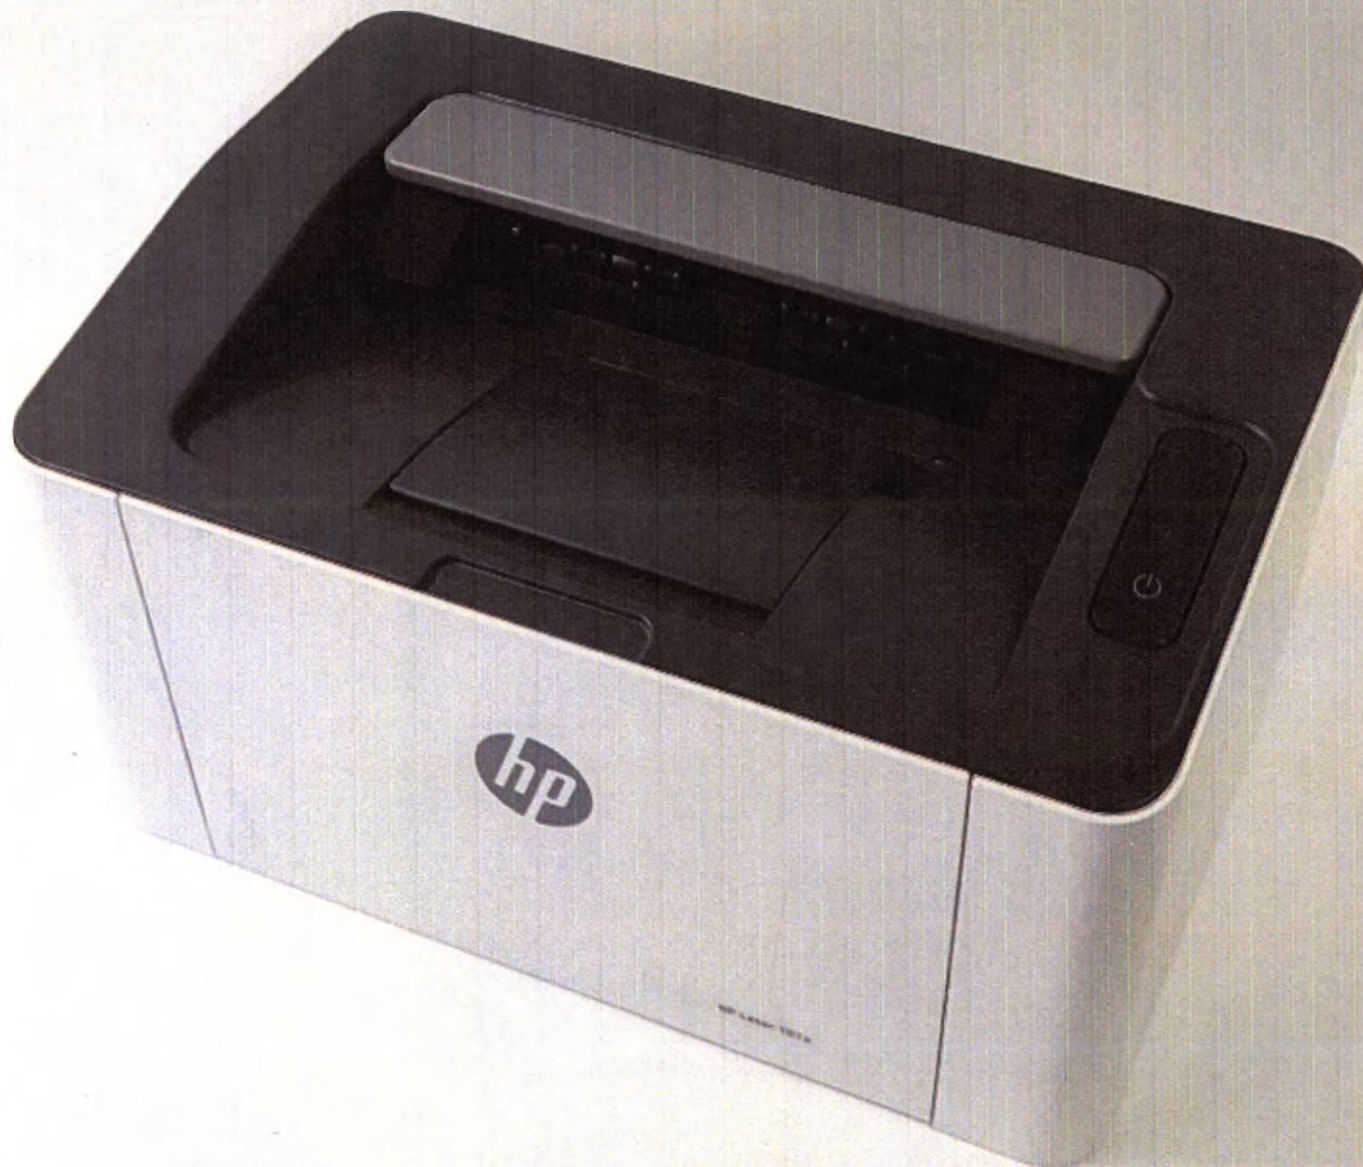


17 Принтер, марки «HP», производства «HP Inc.», США, или марки «Canon», производства «Canon Japan Inc.», Япония, или марки «Xerox», производства
ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU :и «Epson», производства «SEIKO EPSON CORP.», Филиппины, или марки «Samsung», производства «Samsung Electronics
Co., Ltd.», Республика Корея

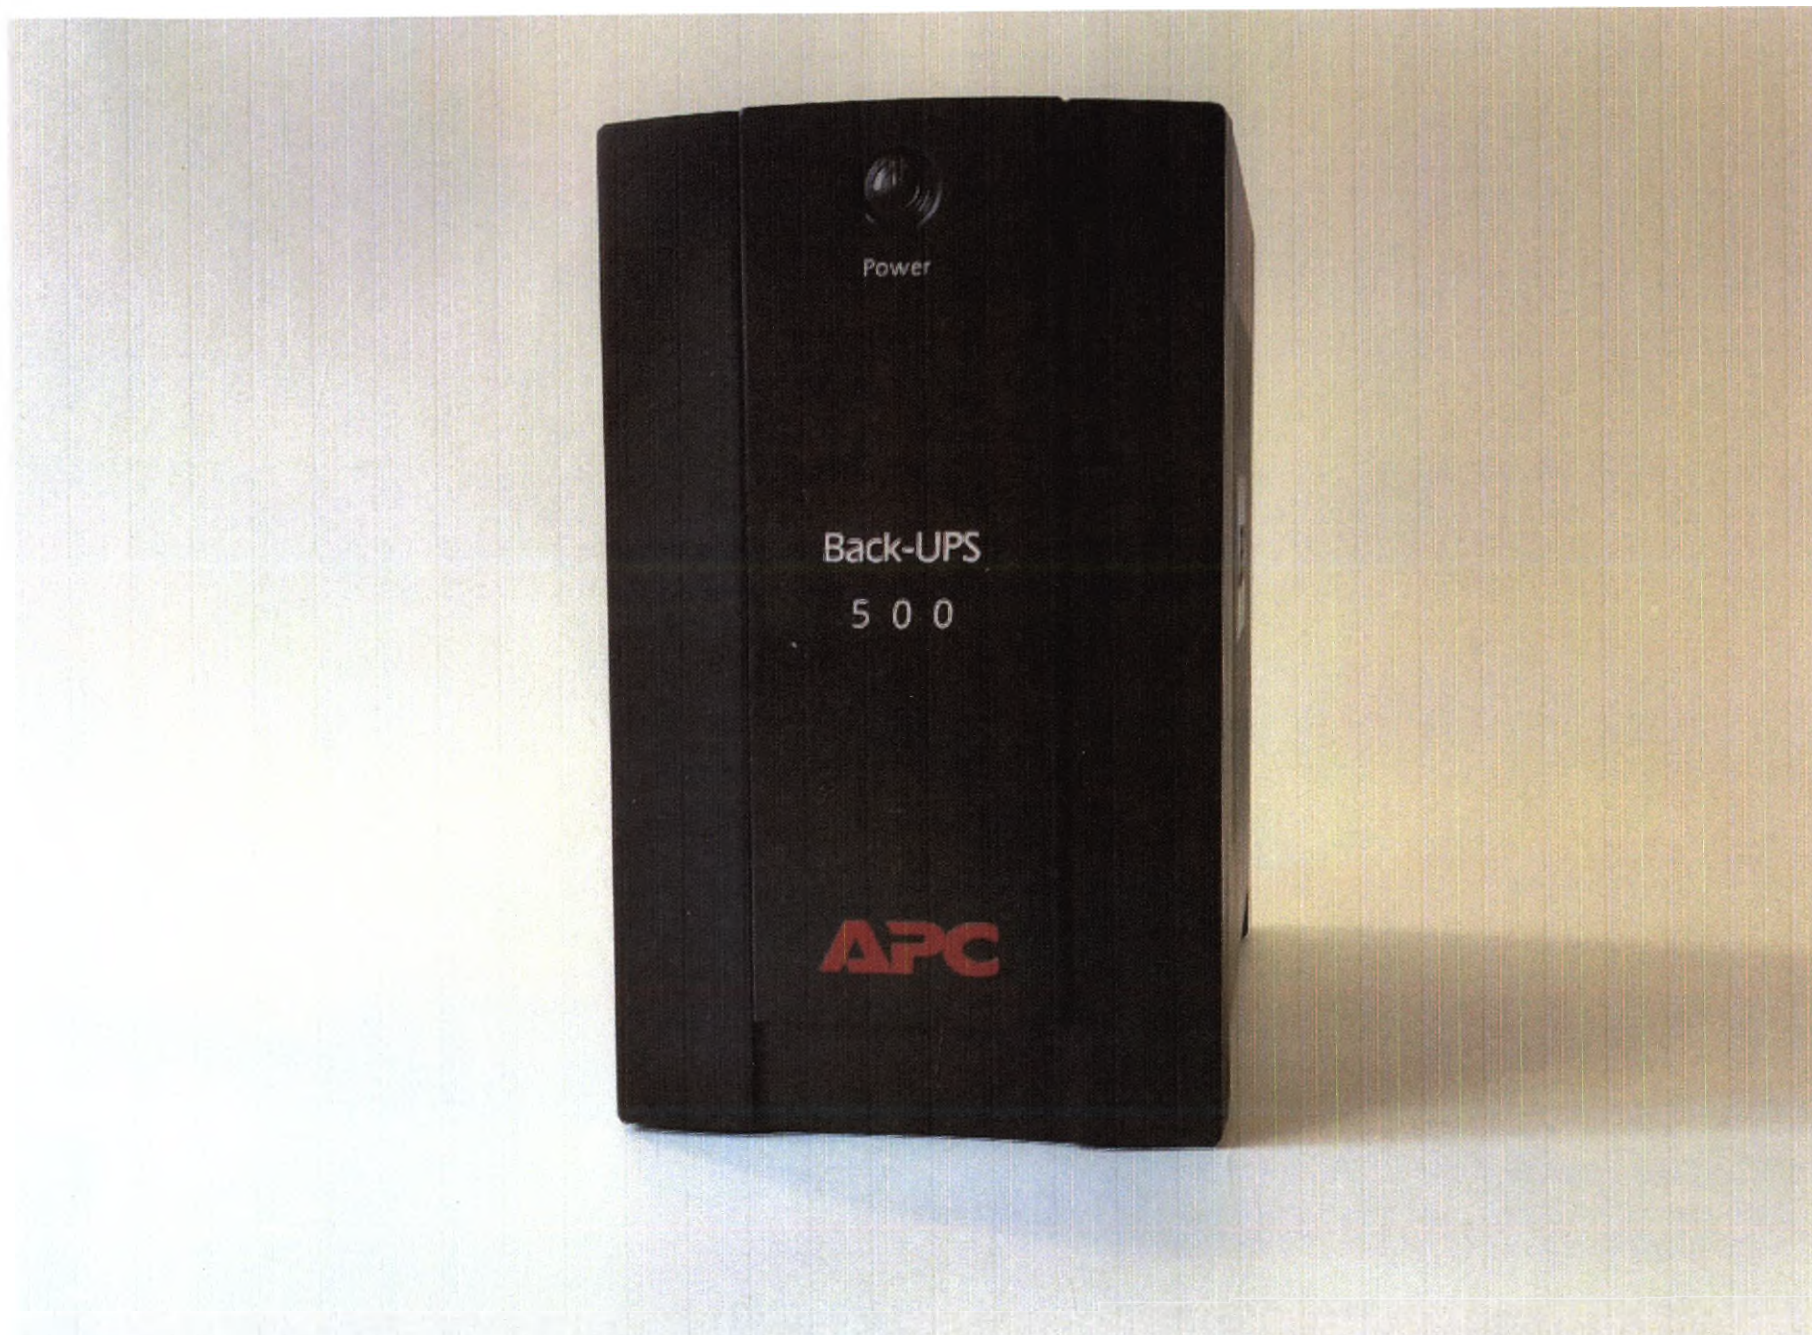

18 Источник бесперебойного питания, «APC», тип Back-UPS, производства «Schneider Electric Industries SAS», Франция, или «CyberPower», модели серии UTC850, или «CyberPower Systems», Китай, или «POWERMAN» модели серии BACK PRO, производства «POWER LIMITED», Китай



19 Считыватель модель R5-USB Prof, по ТУ 4372-003-92462613-2012, производства АО «РусГард», Россия

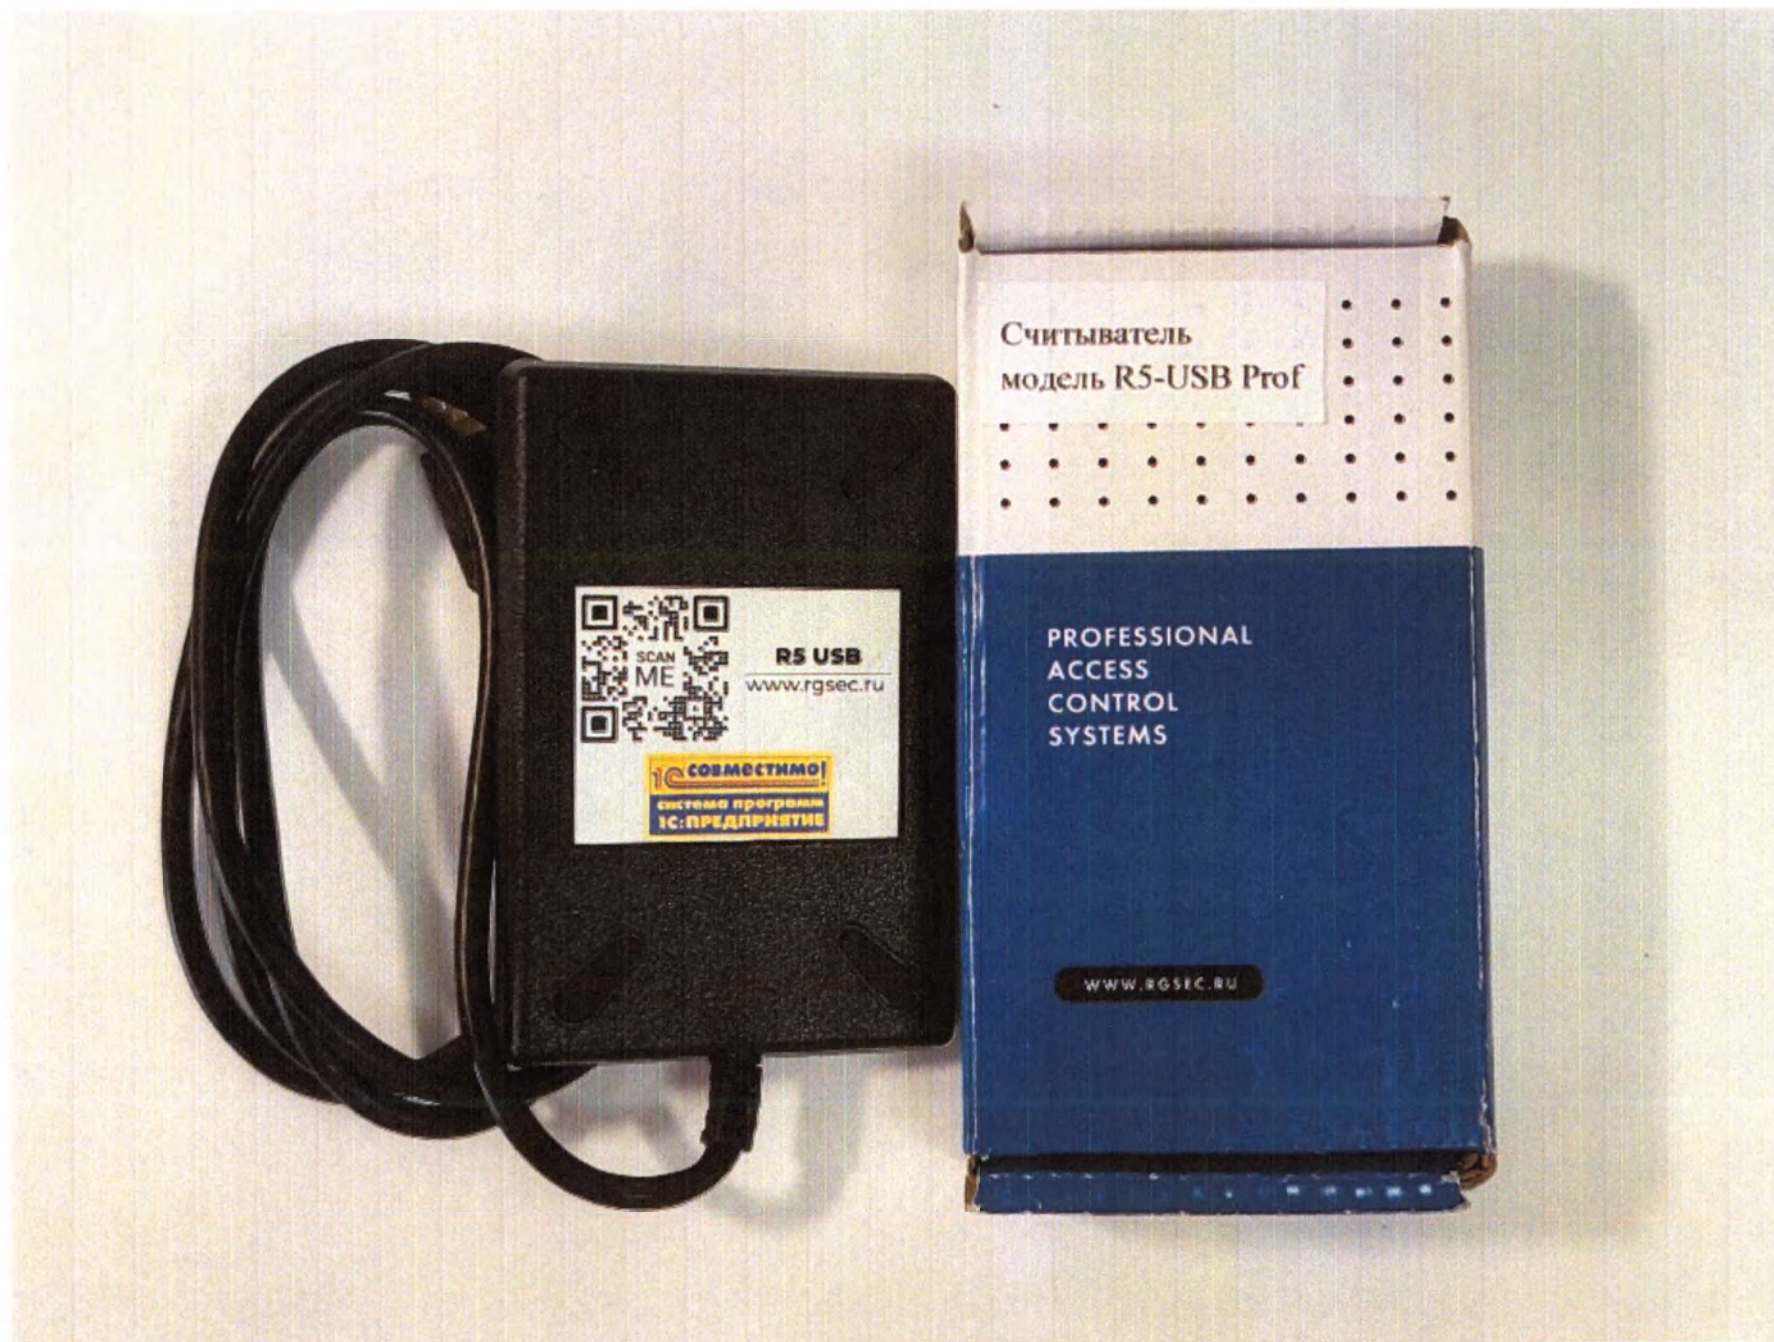


МАРКИРОВКА: Считыватель модель R5-USB Prof, по ТУ 4372-003-92462613-2012, производства АО «РусГард», Россия



20 Считыватель Z-2 модель RD_All, по ТУ 26.30.50-004-38111914-2018, производства АО «АВС», Россия



МАРКИРОВКА: Считыватель Z-2 модель RD_All, по ТУ 26.30.50-004-38111914-2018, производства АО «АВС», Россия

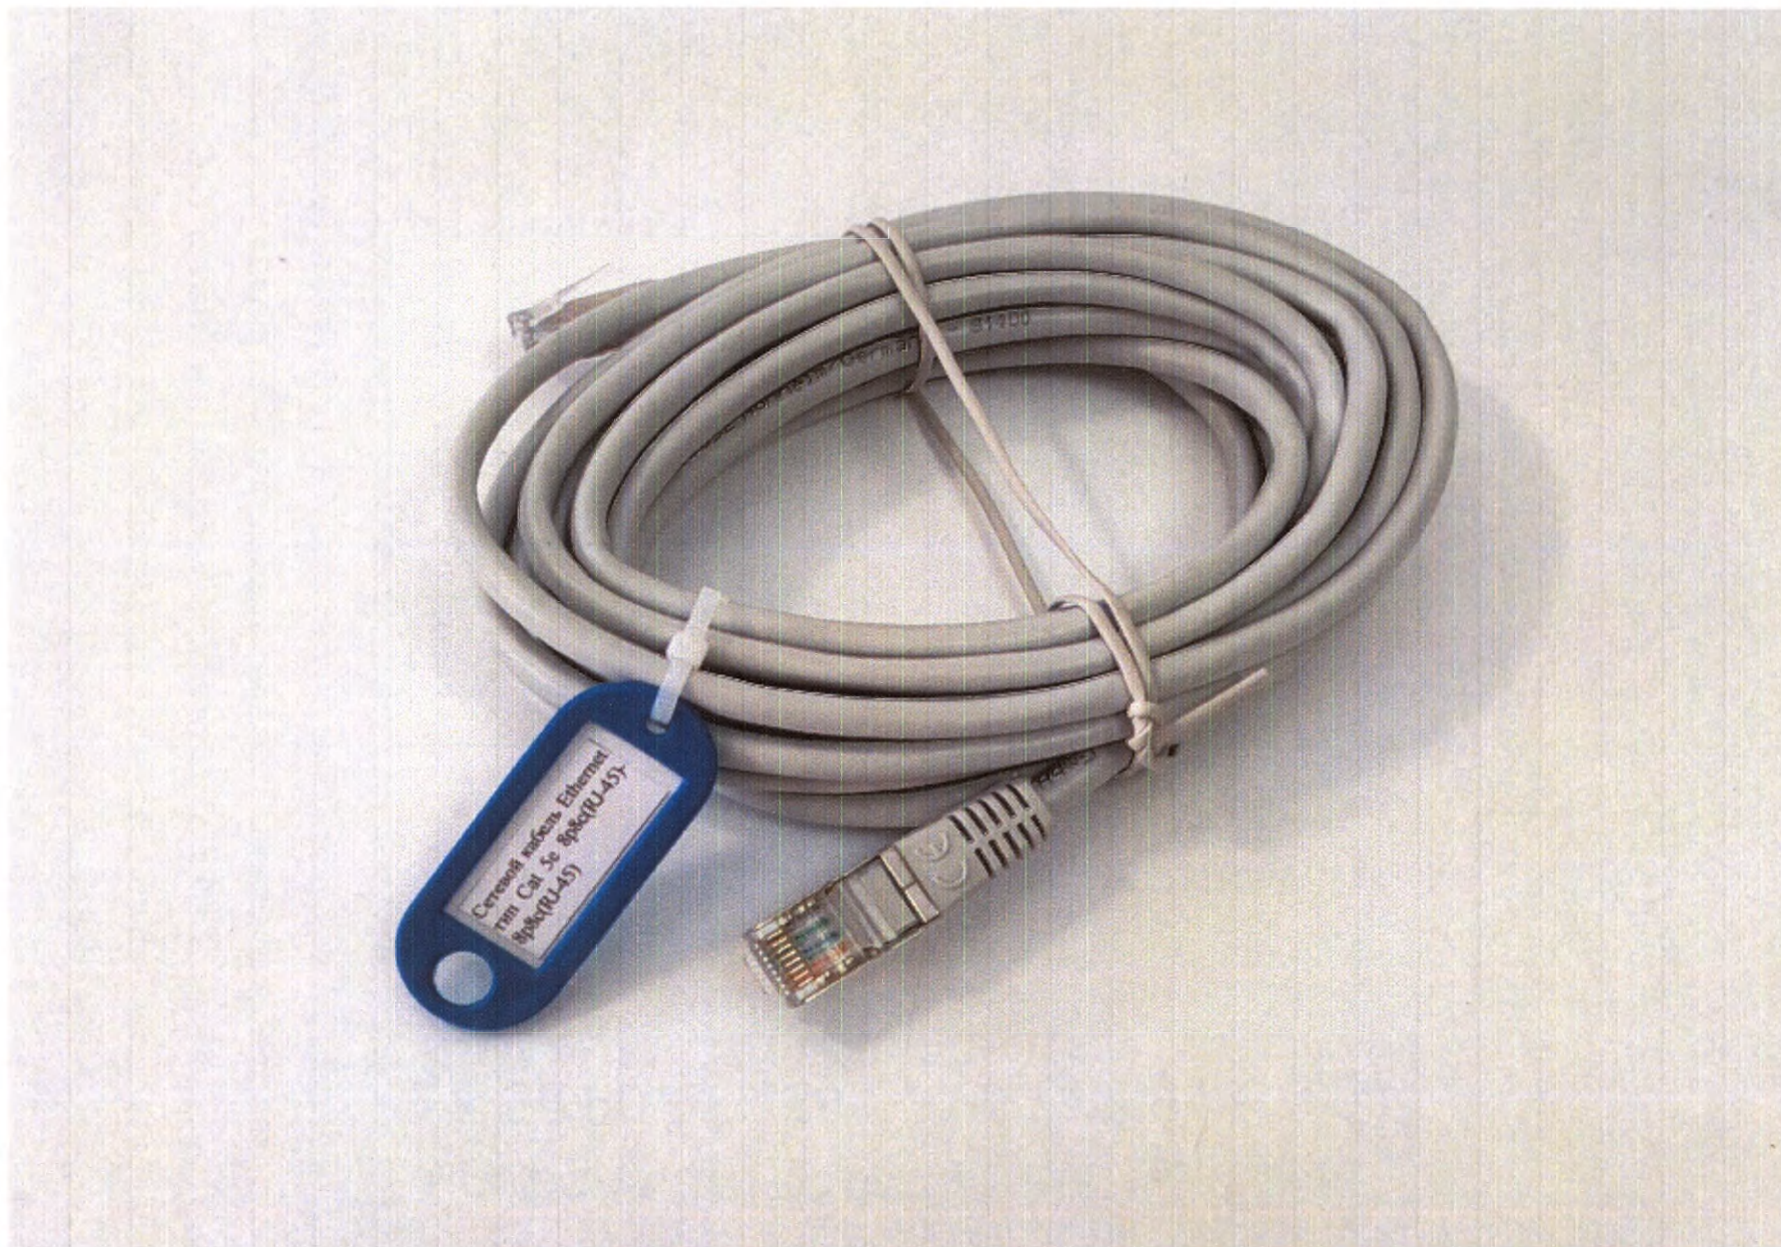

21 Сетевой кабель Ethernet тип Cat 5e 8p8c(RJ-45)- 8p8c(RJ-45), производства «Ningbo Ousheng Electric Co., Ltd», Китай, или производства «5Bites Systems Ltd.», Китай, или производства ООО «КОМПАНИЯ АТКОМ», Россия, или производства «Bion Expert», Китай, или производства «Gembird Software Ltd.», Голландия, или производства «EneGate», Китай, или производства ООО «М-ИНВЕСТ», Россия, или производства АО «ПЗКМК», Россия, или производства «Hyperline Systems Canada Ltd.», Канада, или производства «Premier Cable», Китай, или производства «Hama GmbH & Co. KG», Германия

АО НПП «СИСТЕМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
КОМПЛЕКС АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
КАПД-02-СТ-МО

ЗАВ №

0004

ДАТА ИЗГОТ.

11.2021



U - 230±23В ~ 50Гц P - 30ВА
(с учетом подключаемых устройств
P-500 ВА)



УХЛ 4.2 IP20

ТУ 26.60.12.129-002-45520949-2021

Страна происхождения - Россия

Маркировка



**Комплекс аппаратно-программный определения
функционального состояния КАПД-02-СТ-МО**

ТУ 26.60.12.129-002-45520949-2021 РУ № _____


АО НПП "Системные технологии"



Россия, 191186, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный
округ Дворцовый округ, Невский пр-кт, д. 30, Литера А, помещ.
24-Н, Ком. 2, 28, 29 (Офис 5.3.В), Тел: +7(812)449-18-59 E-mail:
office@systemt.ru


SN

0004



11.2021

Транспортирование

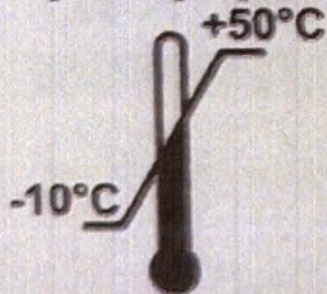

Масса брутто 5,0 кг

Хранение

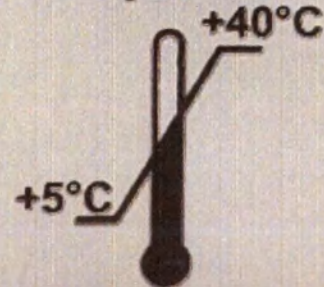


Фото 1: Маркировка транспортной упаковки



Фото 2: Маркировка транспортной упаковки

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью

36 (тридцать шесть) лист (об)

Руководитель организации:



М.В. Рюхин