

Групповая тара

«Контейнер для отмывания эритроцитов методом центрифугирования из металлического или полимерного контейнера с полимерными иглами для подключения отмывающих растворов в полимерных контейнерах или стеклянных бутылках»
1 исполнение




Технический директор

Е. В. Дерябин

Групповая тара

«Контейнер для отмывания эритроцитов методом центрифугирования из металлического или полимерного контейнера с металлическими иглами для подключения отмывающих растворов в стеклянных бутылках»
в групповой таре, 2 исполнение

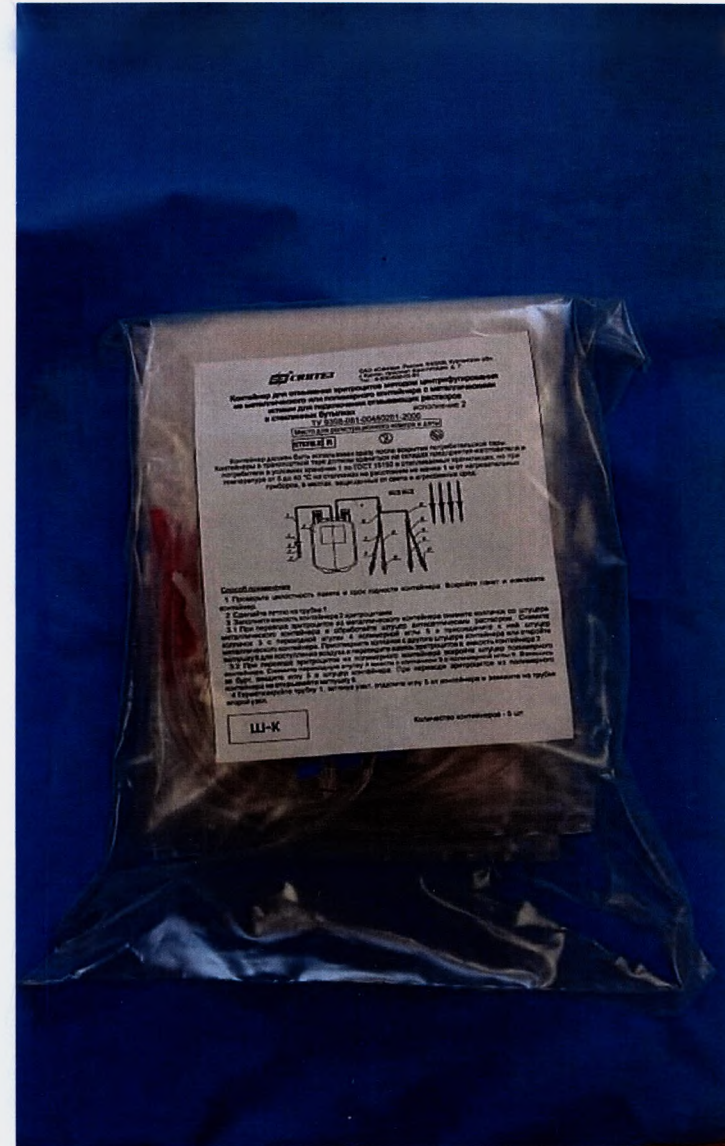


Технический директор

Е. В. Дерябин



Контейнер для отмывания эритроцитов методом центрифугирования из металлического или полимерного контейнера с полимерными иглами для подключения отмывающих растворов в полимерных контейнерах или стеклянных бутылках



ОАО «Синтез», Россия, 640008, Курганская обл., г. Курган,
проспект Конституции, д. 7. Тел.: 8-800-600-00-80

¹ 10420 до 0523

Контейнер для отмывания эритроцитов методом центрифугирования из металлического или полимерного контейнера с полимерными иглами для подключения отмывающих растворов в полимерных контейнерах или стеклянных бутылках

ТУ 9398-081-00480201-2006

Место для регистрационного номера и даты

Вместимость емкости 600 мл

Учреждение службы крови

Ф.И.О. донора крови

№ донора

Дата взятия крови

«AB0» «Rh»

Хранить при температуре от 2 до 6 °C

ВНИМАНИЕ!

Перед переливанием врач обязан проверить:

1 группу крови больного;


2 группу переливаемой взвеси эритроцитов;

3 совместимость эритроцитов донора с сывороткой больного по системе AB0 и Rh-фактору

и провести биологическую пробу

Переливать через устройство с полимерной иглой и фильтром

Исполнение 1



Заморожены

Разморожены и отмты

Контейнер №

Врач

Объем отмывтых эритроцитов

Наименование и объем

взвешивающего раствора

Ш-К

Контейнер для отмывания эритроцитов методом центрифугирования из металлического или полимерного контейнера с металлическими иглами для подключения отмывающих растворов в стеклянных бутылках



ОАО «Синтез», Россия, 640008, Курганская обл., г. Курган,
проспект Конституции, д. 7. Тел.: 8-800-600-00-80

¹ 10420 до 0523

Стерильно внутри
Алирировано
Натоксично


Контейнер для отмывания эритроцитов методом центрифугирования из металлического или полимерного контейнера с металлическими иглами для подключения отмывающих растворов в стеклянных бутылках
ТУ 9398-081-00480201-2006

Место для регистрационного номера и даты

Вместимость емкости 600 мл
Учреждение службы крови
Ф.И.О. донора крови
№ донора
Дата взятия крови
«AB0» «Rh»
Хранить при температуре от 2 до 6 °C
ВНИМАНИЕ!

Перед переливанием врач обязан проверить:
1 группу крови больного;
2 группу переливаемой взвеси эритроцитов;
3 совместимость эритроцитов донора с сывороткой больного по системе AB0 и Rh-фактору и провести биологическую пробу
Переливать через устройство с полимерной иглой и фильтром

Исполнение 2



Заморожены
Разморожены и отмывы
Контейнер №
Врач
Объем отмываемых эритроцитов
Наименование и объем
взвешивающего раствора

Ш-К

Транспортная тара

Контейнер для отмывания эритроцитов методом центрифугирования из
алюминиевого или полимерного контейнера с полимерными иглами для
подключения отмывающих растворов в полимерных контейнерах или
стеклянных бутылках



Транспортная тара

Контейнер для отмывания эритроцитов методом центрифугирования из металлического или полимерного контейнера с металлическими иглами для подключения отмывающих растворов в стеклянных бутылках



Технический директор

Е.В. Дерябин

Прошнуровано, пронумеровано,
скреплено печатью
(4) листов

Копия
верна
Технический
директор



В.В. Дерябин

Макет по проекту изв. № 7 к ТУ 9398-081-00480201-2006
Контейнеры полимерные стерильные для отмывания эритроцитов
методом центрифугирования «Синтез»

Лист упаковочный, ярлык на ящик



ОАО «Синтез», Россия, 640008, Курганская обл., г. Курган,
проспект Конституции, д. 7. Тел.: 8-800-600-00-80

**Контейнер для отмывания эритроцитов методом
центрифугирования из металлического или полимерного контейнера
с металлическими иглами для подключения отмывающих
растворов в стеклянных бутылках**

исполнение 2

ТУ 9398-081-00480201-2006

№ партии

Упаковщик

Количество контейнеров

шт.

После транспортирования в условиях отрицательных температур
контейнеры в транспортной таре должны быть выдержаны в нормальных
климатических условиях не менее 24 ч.



**Контейнер для отмывания эритроцитов
методом центрифугирования
из металлического или полимерного
контейнера с металлическими иглами
для подключения отмывающих
растворов в стеклянных бутылках**

исполнение 2

ТУ 9398-081-00480201-2006

№ партии

Масса брутто кг

Годен до

Ящик №

Упаковщик

Количество контейнеров

шт

Условия хранения 1 по ГОСТ 15150 в отапливаемых хранилищах, но при
температуре от 5 до 40 °С на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от
нагревательных приборов, в местах, защищенных от света и агрессивных сред.

STERILE R

ОКК

ОАО «Синтез»

Россия, 640008,
Курганская обл.,
г. Курган,
проспект
Конституции, д. 7.

Тел.: 8-800-600-00-80

Технический директор

Е.В. Дерябин



Макет по проекту изв. № 7 к ТУ 9398-081-00480201-2006
Контейнеры полимерные стерильные для отмывания эритроцитов
методом центрифугирования «Синтез»

Лист упаковочный, ярлык на ящик



ОАО «Синтез», Россия, 640008, Курганская обл., г. Курган,
проспект Конституции, д. 7. Тел.: 8-800-600-00-80

**Контейнер для отмывания эритроцитов методом
центрифугирования из металлического или полимерного контейнера
с полимерными иглами для подключения отмывающих растворов
в полимерных контейнерах или стеклянных бутылках**

исполнение 1

ТУ 9398-081-00480201-2006

№ партии

Упаковщик

Количество контейнеров

шт.

После транспортирования в условиях отрицательных температур
контейнеры в транспортной таре должны быть выдержаны в нормальных
климатических условиях не менее 24 ч.



**Контейнер для отмывания эритроцитов
методом центрифугирования
из металлического или полимерного
контейнера с полимерными иглами
для подключения отмывающих
растворов в полимерных контейнерах
или стеклянных бутылках**

исполнение 1

ТУ 9398-081-00480201-2006

№ партии

Масса брутто

кг

Годен до

Ящик №

Упаковщик

Количество контейнеров

шт

Условия хранения 1 по ГОСТ 15150 в отопляемых хранилищах, но при
температуре от 5 до 40 °С на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от
нагревательных приборов, в местах, защищенных от света и агрессивных сред.

STERILE R

OKK

ОАО «Синтез»

Россия, 640008,
Курганская обл.,
г. Курган,
проспект
Конституции, д. 7.

Тел.: 8-800-600-00-80

Технический директор

Е.В. Дерибин

