

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "ЛИДКОР"

Е.Ю. Гохгут

«05» июня 2023 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ


«Набор контрольных материалов «Лидлаб Амур EB EA IgM Контроль» для контроля качества качественного определения иммуноглобулинов класса М (IgM) к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (EBV EA) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 204-65614693-2022»

2023


Лиофилизированный контрольный материал, уровень 1, положительный




Лиофилизированный контрольный материал, уровень 2, отрицательный

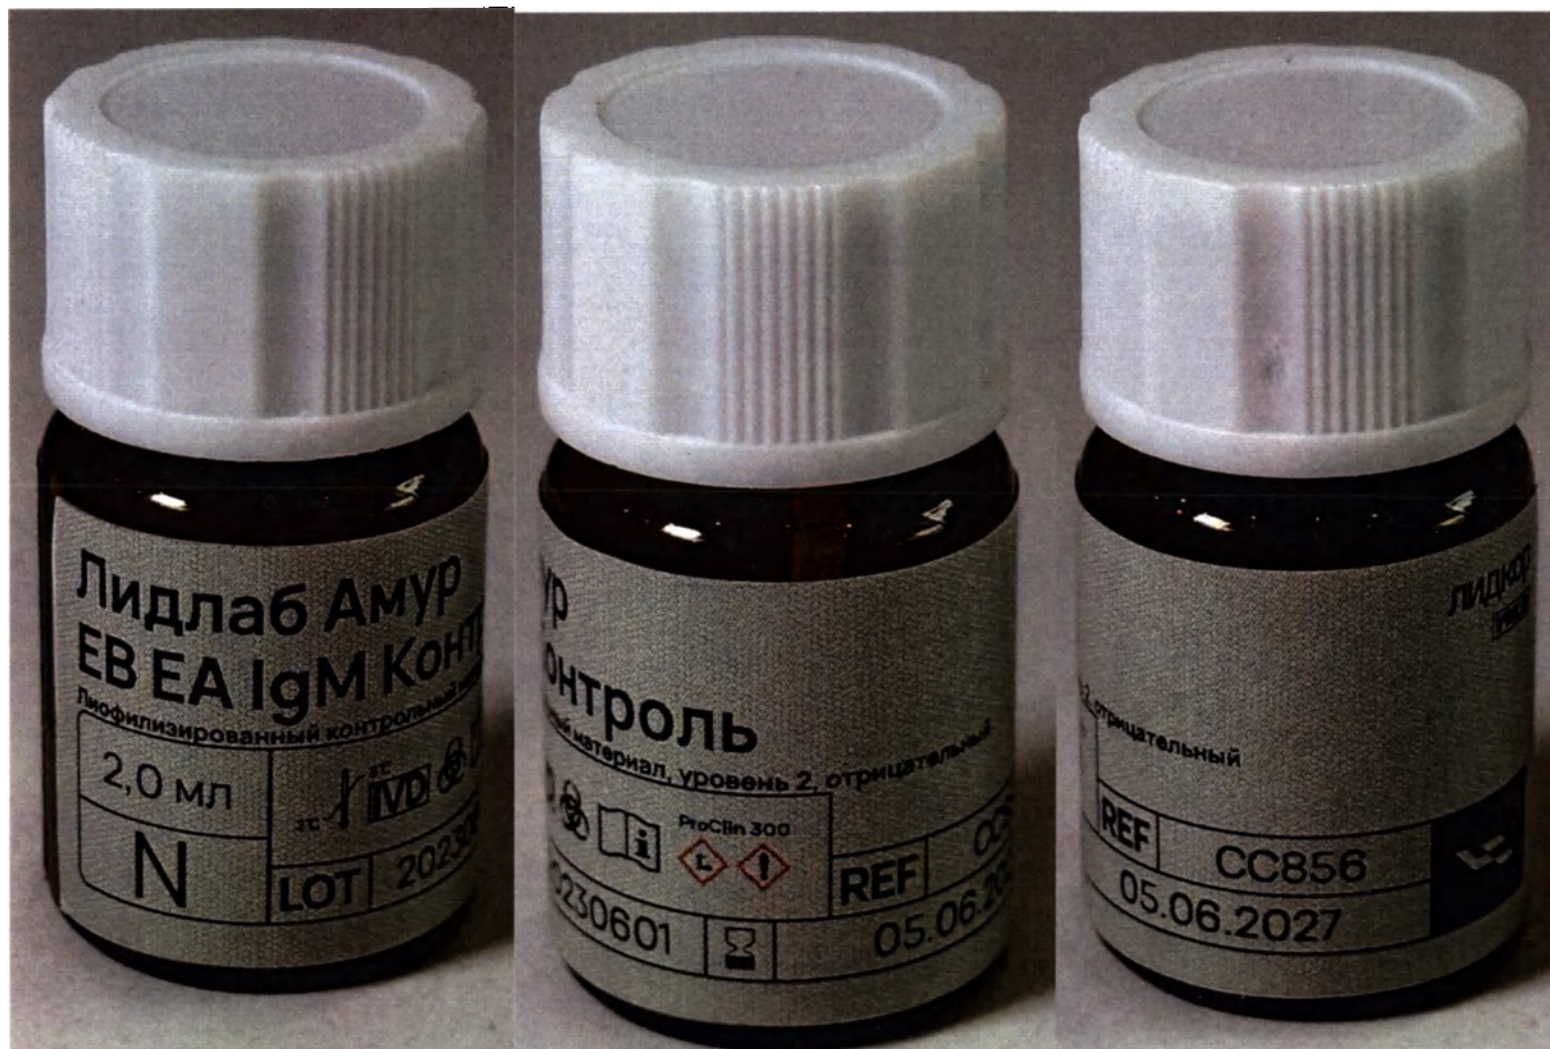

Потребительская упаковка

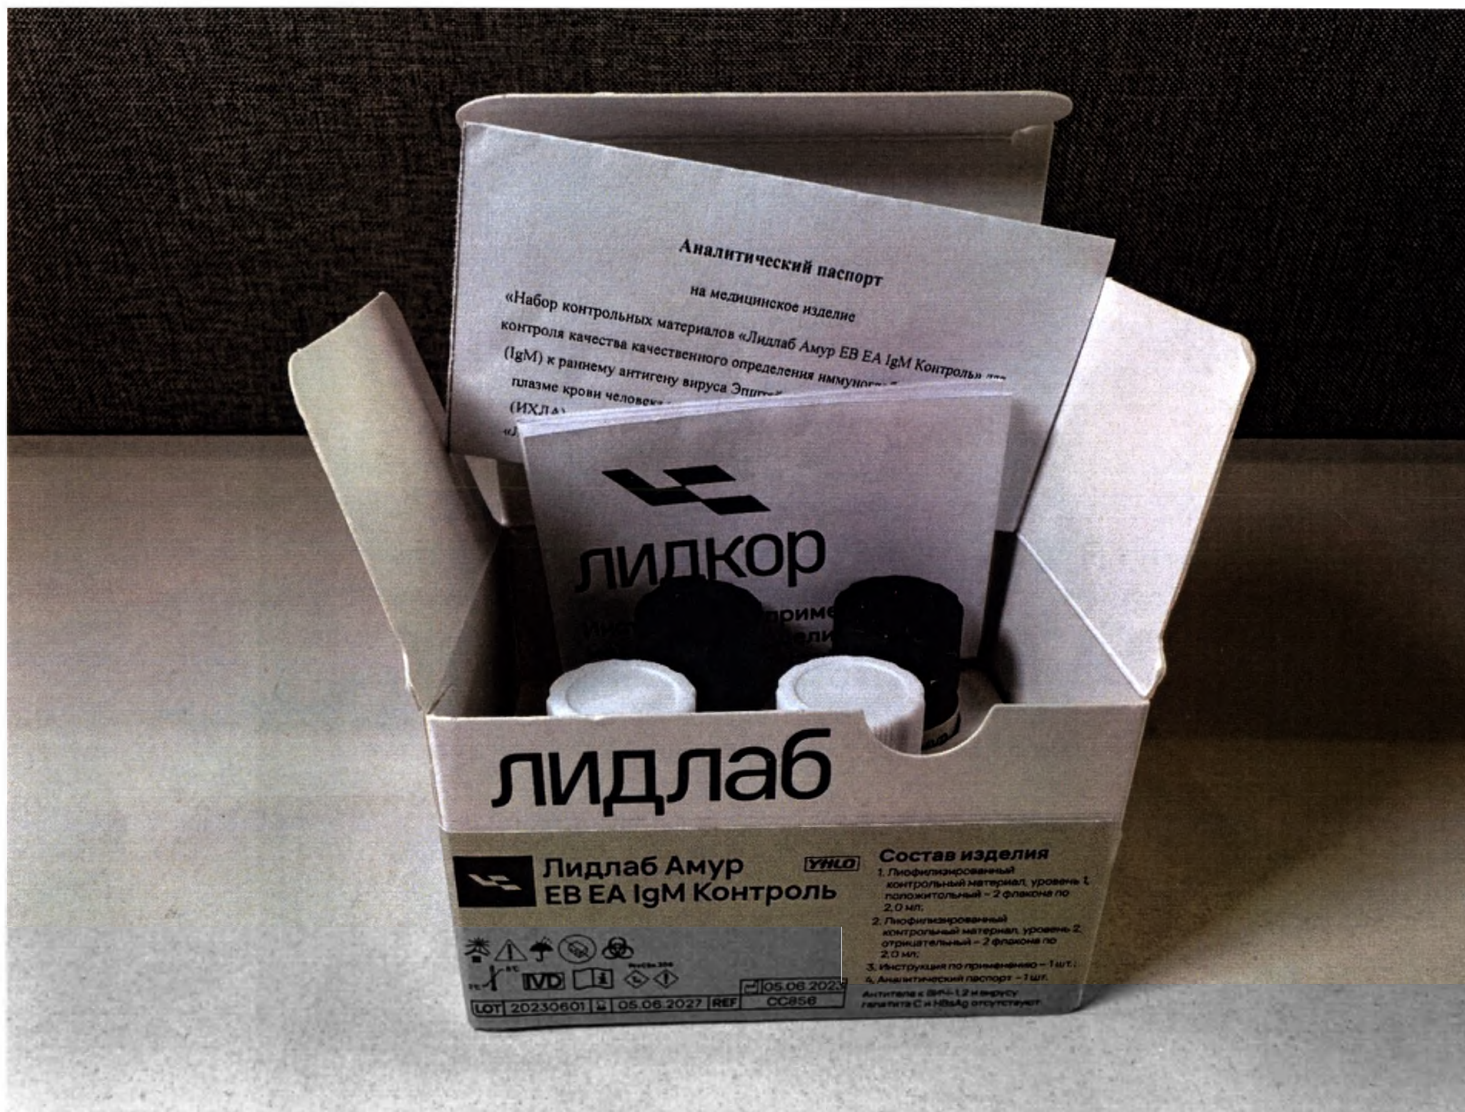

Потребительская упаковка. Вид сбоку

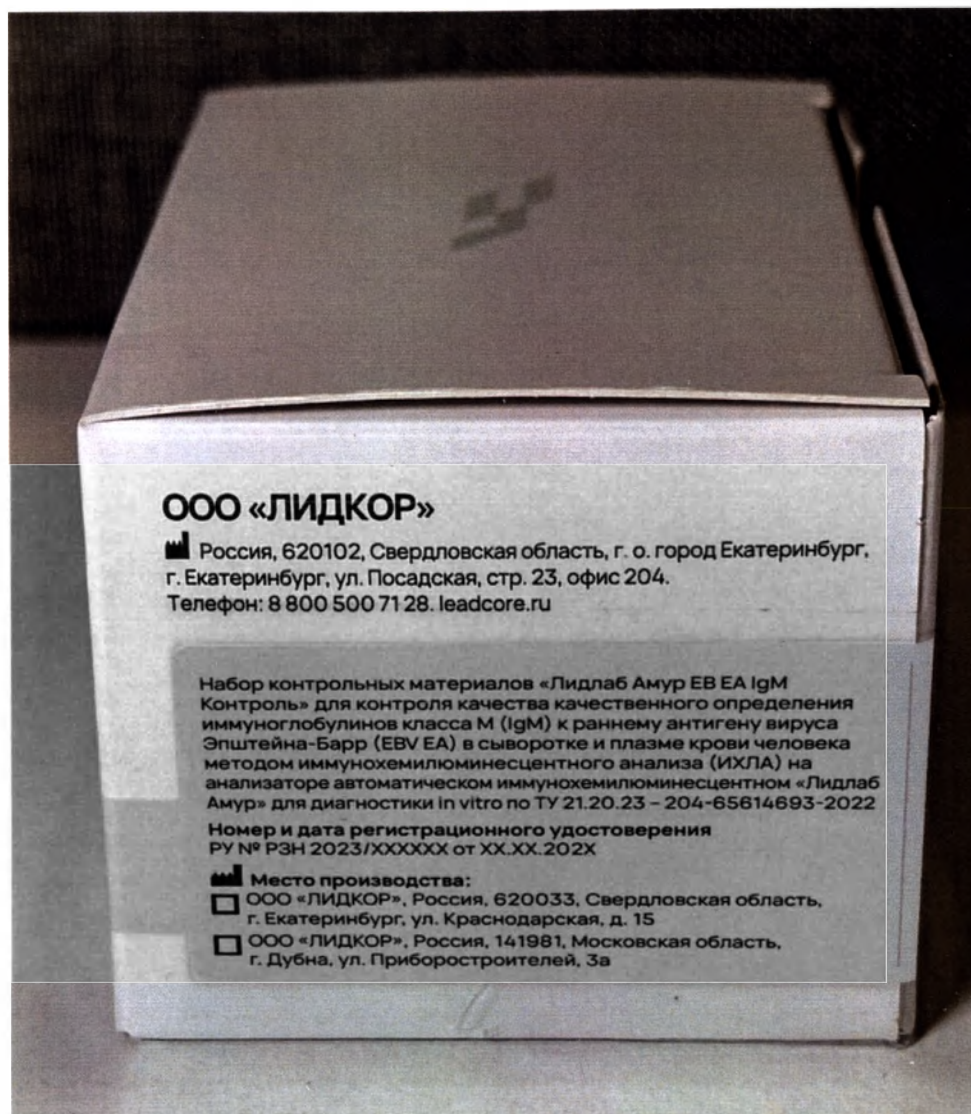

ООО «ЛИДКОР»

Россия, 620102, Свердловская область, г. о. город Екатеринбург,
г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.
Телефон: 8 800 500 71 28. leadcore.ru

Набор контрольных материалов «Лидлаб Амур EB EA IgM
Контроль» для контроля качества качественного определения
иммуноглобулинов класса M (IgM) к раннему антигену вируса
Эпштейна-Барр (EBV EA) в сыворотке и плазме крови человека
методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на
анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб
Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 204-65614693-2022

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № РЗН 2023/XXXXXX от XX.XX.202X

Место производства:

- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область,
г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а

Потребительская упаковка. Вид сзади



Общий вид медицинского изделия



Транспортная упаковка



Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
8 (восемь) л.

Директор
ООО «ЛИДКОР»

/Е. Ю. Гохгут/



УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "ЛИДКОР"



Е.Ю. Гохгут

«05» июня 2023 г.

МАКЕТ МАРКИРОВКИ

«Набор контрольных материалов «Лидлаб Амур EB EA IgM Контроль» для контроля качества качественного определения иммуноглобулинов класса М (IgM) к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (EBV EA) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 204-65614693-2022»

2023


Набор контрольных материалов «Лидлаб Амур EB EA IgM Контроль» для контроля качества качественного определения иммуноглобулинов класса М (IgM) к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (EBV EA) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 204-65614693-2022

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № РЗН 2023/XXXXXX от XX.XX.202X

Место производства:


☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15

☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область,
г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур EB EA IgM Контроль

YHLO

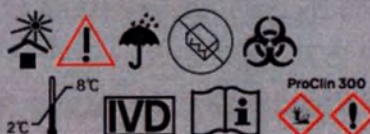

LOT	20230601	05.06.2027	REF	CC856
-----	----------	------------	-----	-------

Состав изделия

1. Лиофилизированный контрольный материал, уровень 1, положительный – 2 флакона по 2,0 мл;
2. Лиофилизированный контрольный материал, уровень 2, отрицательный – 2 флакона по 2,0 мл;
3. Инструкция по применению – 1 шт.;
4. Аналитический паспорт – 1 шт.

Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Лидлаб Амур EB EA IgM Контроль

лидкор
YHLO

Лиофилизированный контрольный материал, уровень 2, отрицательный


2,0 мл						REF	CC856	
N	LOT	20230601	05.06.2027					

Лидлаб Амур EB EA IgM Контроль

лидкор
YHLO

Лиофилизированный контрольный материал, уровень 1, положительный

2,0 мл						REF	CC856	
P	LOT	20230601	05.06.2027					

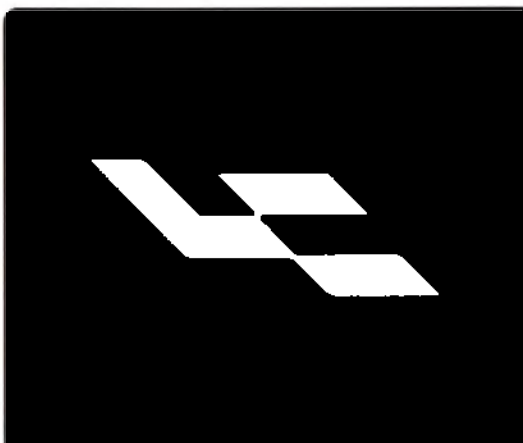



Набор контрольных материалов «Лидлаб Амур EB EA IgM Контроль» для контроля качества качественного определения иммуноглобулинов класса М (IgM) к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (EBV EA) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 204-65614693-2022



Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.					05.06.2023
LOT	20230601		05.06.2027	REF	CC856	

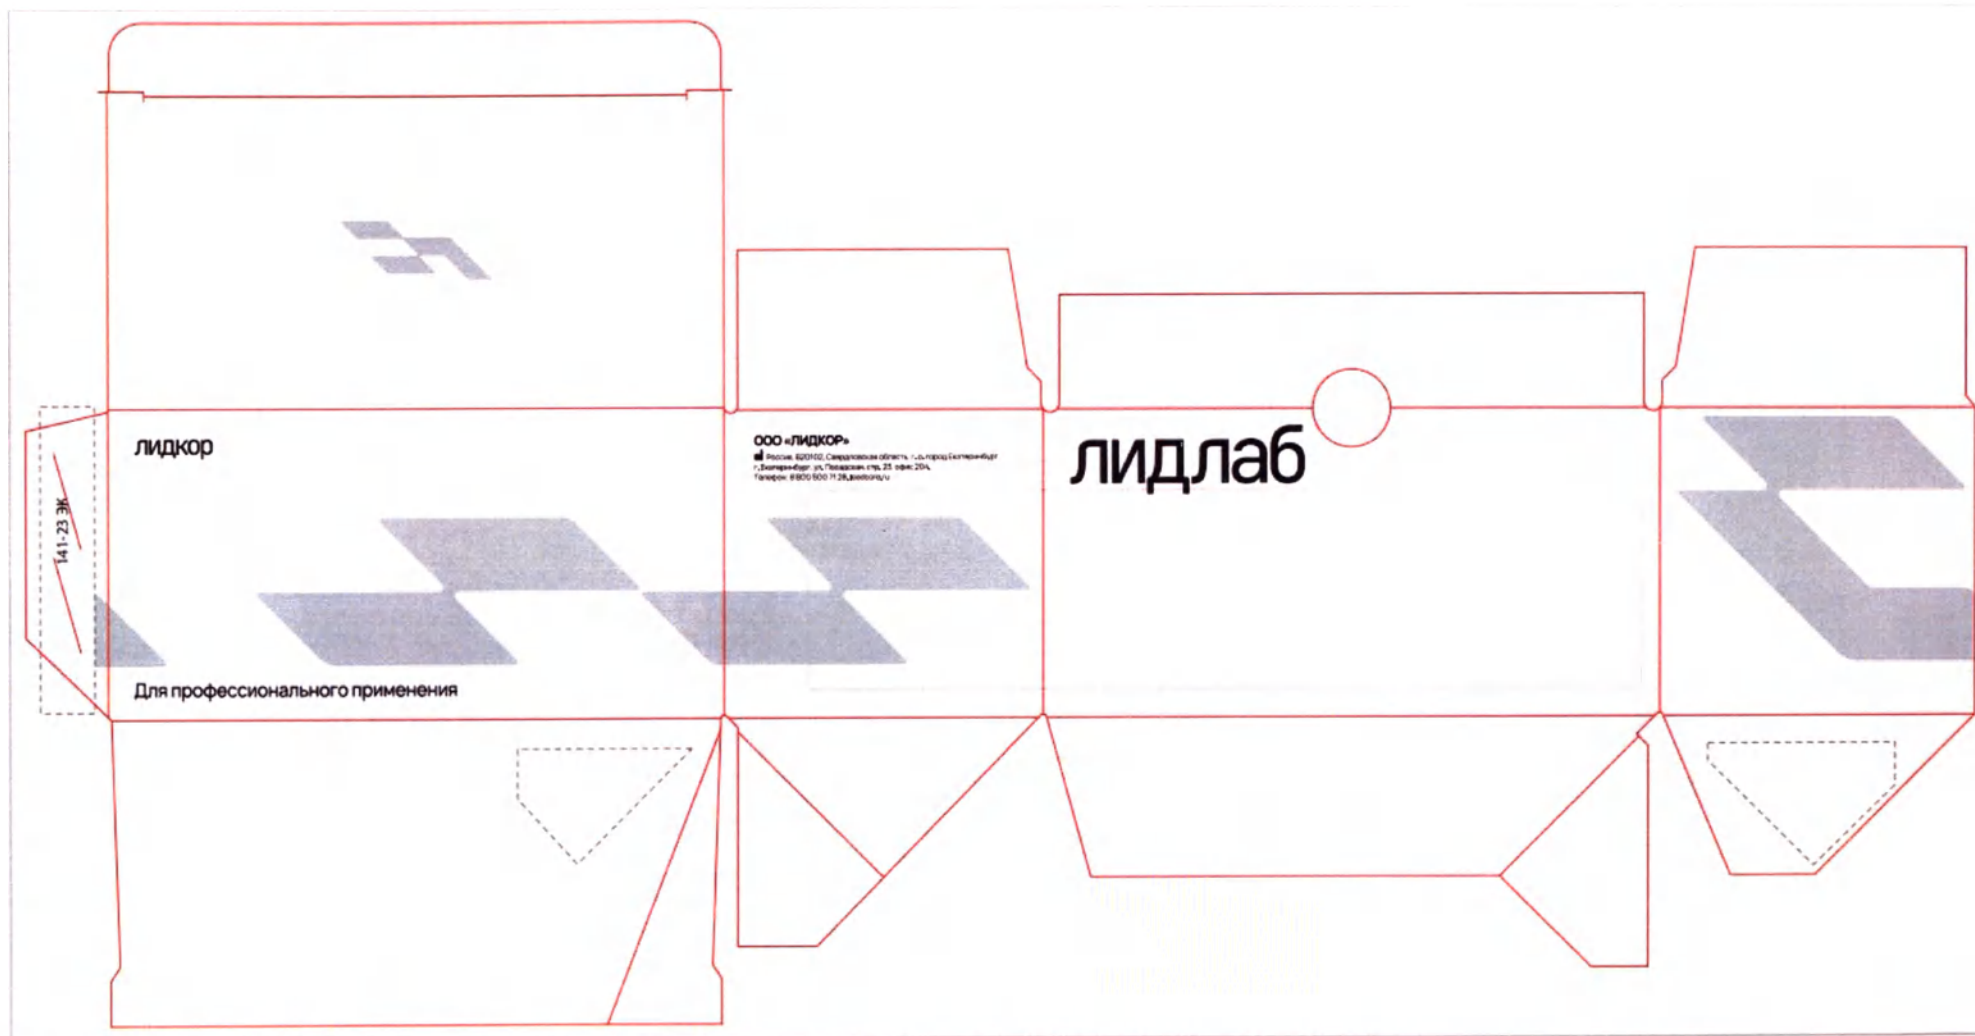

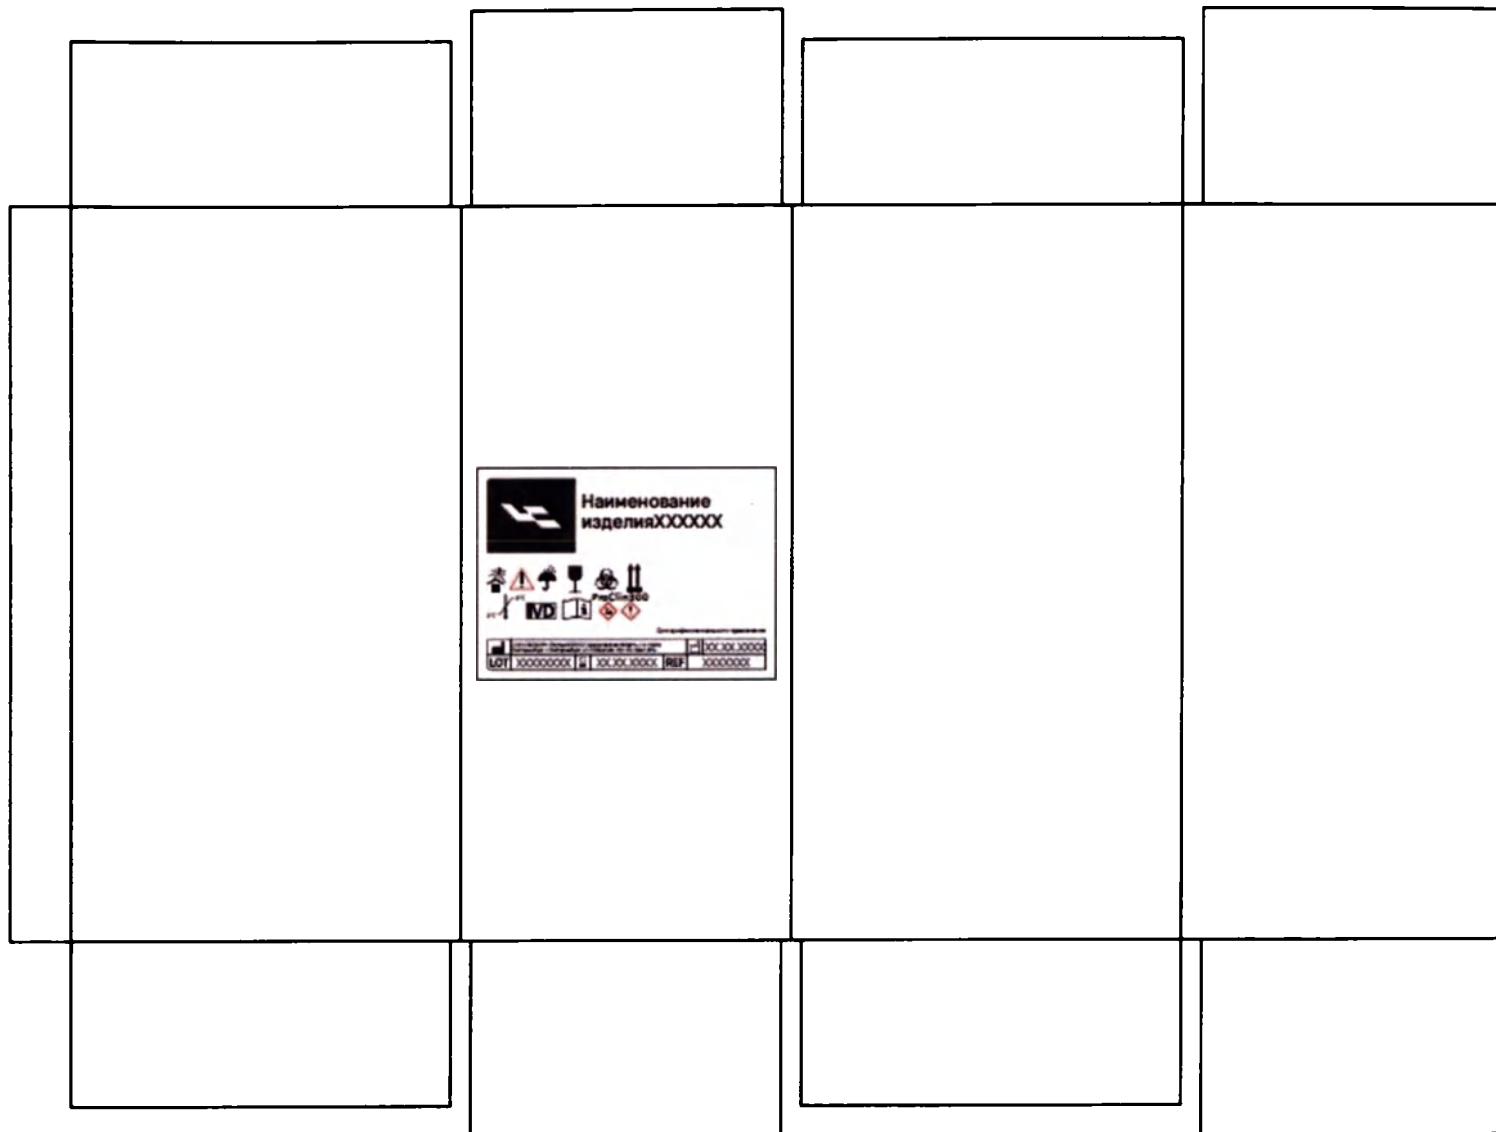

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
5 (пять) л

Директор
ООО «ЛИДКОР»

/Е. Ю. Гохгут/

