

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "ЛИДКОР"

Е.Ю. Гохгут

23 июня 2023 г.



МАКЕТ МАРКИРОВКИ

«Набор реагентов «Лидлаб Амур ВПГ-2 IgM» для качественного определения иммуноглобулинов класса М (IgM) к вирусу простого герпеса 2 типа (ВПГ-2) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-262-65614693-2022»


2023

Набор реагентов «Лидлаб Амур ВПГ-2 IgM» для качественного определения иммуноглобулинов класса М (IgM) к вирусу простого герпеса 2 типа (ВПГ-2) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-262-65614693-2022. Набор реагентов на 100 тестов. Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:


- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур ВПГ-2 IgM

YHLO

Набор реагентов на 100 тестов

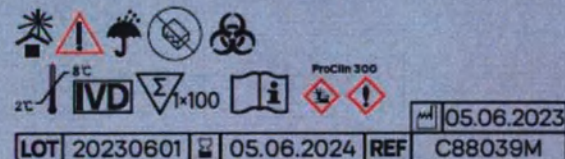

Состав изделия

1. Картридж (в составе: реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; реагент меченых антител (R2), 6,5 мл/уп.; реагент для разведения образцов (R3), 6,5 мл/уп.) – 2 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон – 1 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон – 1 шт.;
4. Пароизоляционные крышки – 8 шт.;
5. Инструкция по применению – 1 шт.;
6. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур ВПГ-2 IgM» для качественного определения иммуноглобулинов класса М (IgM) к вирусу простого герпеса 2 типа (ВПГ-2) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-262-65614693-2022. Набор реагентов на 200 тестов. Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:

- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур ВПГ-2 IgM

YHLO

Набор реагентов на 200 тестов



Состав изделия

1. Картридж (в составе: реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; реагент меченых антител (R2), 6,5 мл/уп.; реагент для разведения образцов (R3), 6,5 мл/уп.) – 4 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон – 4 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон – 4 шт.;
4. Пароизоляционные крышки – 16 шт.;
5. Инструкция по применению – 1 шт.;
6. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур ВПГ-2 IgM» для качественного определения иммуноглобулинов класса М (IgM) к вирусу простого герпеса 2 типа (ВПГ-2) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-262-65614693-2022. Набор реагентов на 500 тестов. Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:


- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а

Набор реагентов «Лидлаб Амур ВПГ-2 IgM» для качественного определения иммуноглобулинов класса М (IgM) к вирусу простого герпеса 2 типа (ВПГ-2) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-262-65614693-2022. Набор реагентов на 1000 тестов. Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:


- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур ВПГ-2 IgM

Набор реагентов на 500 тестов

YHLO

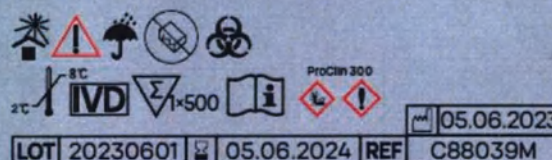

Состав изделия


1. Картридж (в составе: реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; реагент меченых антител (R2), 6,5 мл/уп.; реагент для разведения образцов (R3), 6,5 мл/уп.) – 10 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон – 5 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон – 5 шт.;
4. Пароизоляционные крышки – 40 шт.;
5. Инструкция по применению – 1 шт.;
6. Аналитический паспорт – 1 шт.



Лидлаб Амур ВПГ-2 IgM

Набор реагентов на 1000 тестов

YHLO

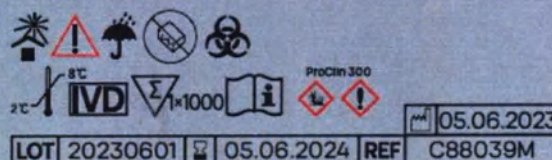

Состав изделия

1. Картридж (в составе: реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; реагент меченых антител (R2), 6,5 мл/уп.; реагент для разведения образцов (R3), 6,5 мл/уп.) – 20 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон – 10 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон – 10 шт.;
4. Пароизоляционные крышки – 80 шт.;
5. Инструкция по применению – 1 шт.;
6. Аналитический паспорт – 1 шт.

лидкор **YHLO**

Лидлаб Амур
ВПГ-2 IgM

3,5 мл	6,5 мл	6,5 мл
R 1	R 2	R 3

LOT	20230601	05.06.2024
-----	----------	------------



лидкор

Лидлаб Амур ВПГ-2 IgM

2°C 8°C IVD ProClin 300		
1,0 мл	LOT	20230601
		05.06.2024
CAL 1	REF	C88039M

лидкор

Лидлаб Амур ВПГ-2 IgM

2°C 8°C IVD ProClin 300		
1,0 мл	LOT	20230601
		05.06.2024
CAL 2	REF	C88039M



Лидлаб Амур ВПГ-2 IgM



LOT 20230601 EXP 05.06.2024

лидкор

Лидлаб Амур
ВПГ-2 IgM

Пароизоляционные
крышки – 4 шт.


LOT 20230601




05.06.2024

REF C88039M



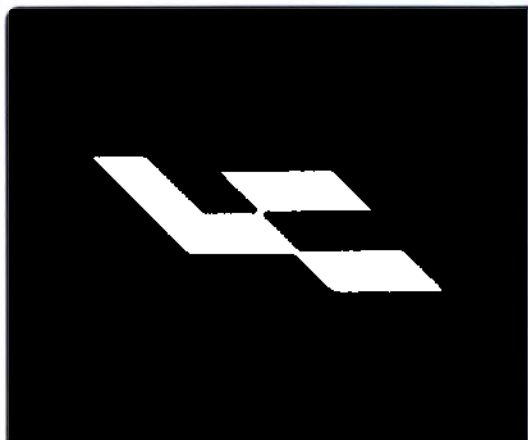


Набор реагентов «Лидлаб Амур ВПГ-2 IgM» для качественного определения иммуноглобулинов класса М (IgM) к вирусу простого герпеса 2 типа (ВПГ-2) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-262-65614693-2022

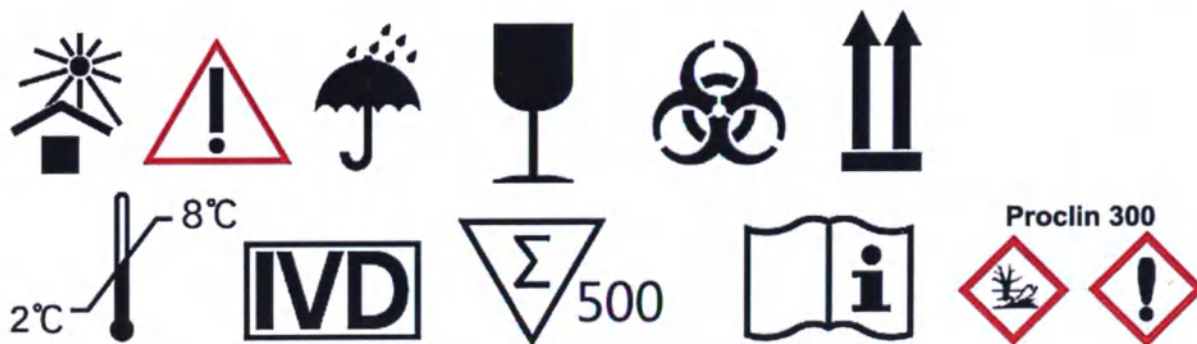


Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.					05.06.2023
LOT	20230601		05.06.2024	REF	C88039M	

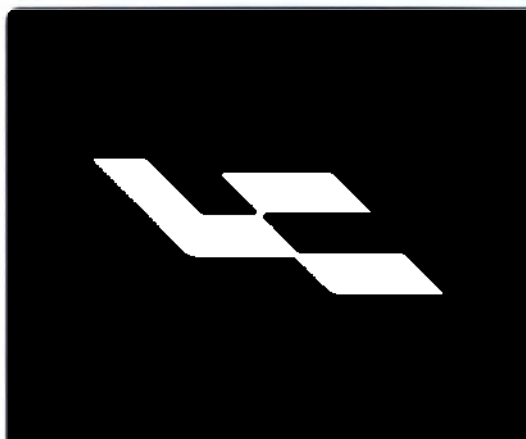


Набор реагентов «Лидлаб Амур ВПГ-2 IgM» для качественного определения иммуноглобулинов класса М (IgM) к вирусу простого герпеса 2 типа (ВПГ-2) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-262-65614693-2022

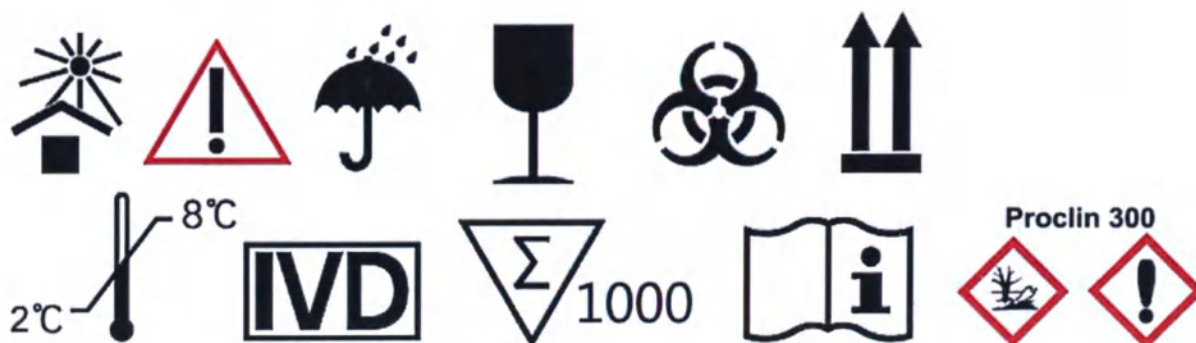


Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.					05.06.2023
LOT	20230601		05.06.2024	REF	C88039M	

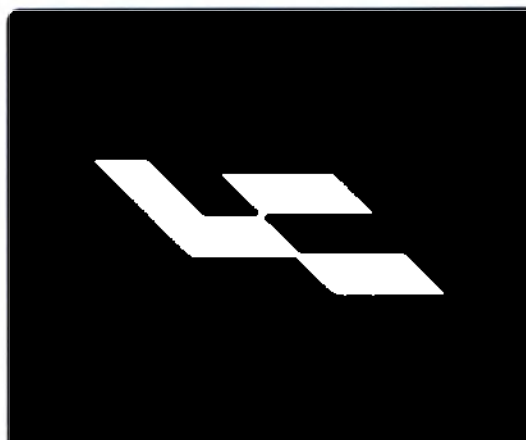

Набор реагентов «Лидлаб Амур ВПГ-2 IgM» для качественного определения иммуноглобулинов класса М (IgM) к вирусу простого герпеса 2 типа (ВПГ-2) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-262-65614693-2022

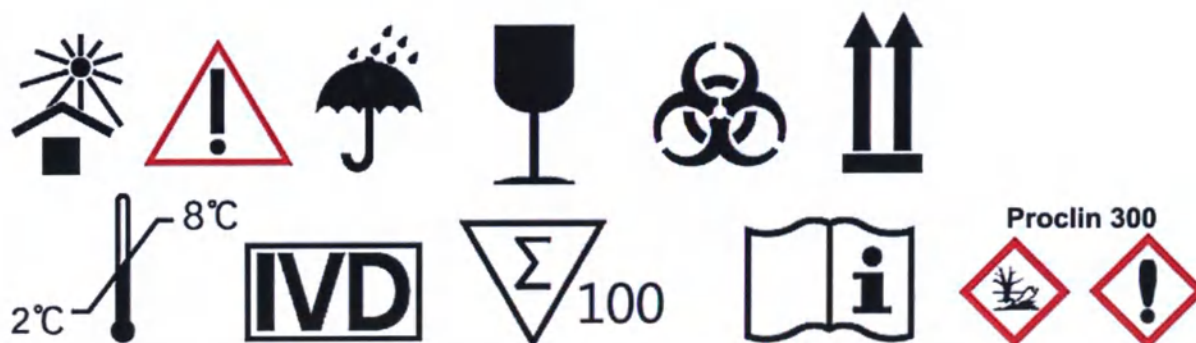


Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.					05.06.2023
LOT	20230601		05.06.2024	REF	C88039M	





Набор реагентов «Лидлаб Амур ВПГ-2 IgM» для качественного определения иммуноглобулинов класса М (IgM) к вирусу простого герпеса 2 типа (ВПГ-2) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-262-65614693-2022

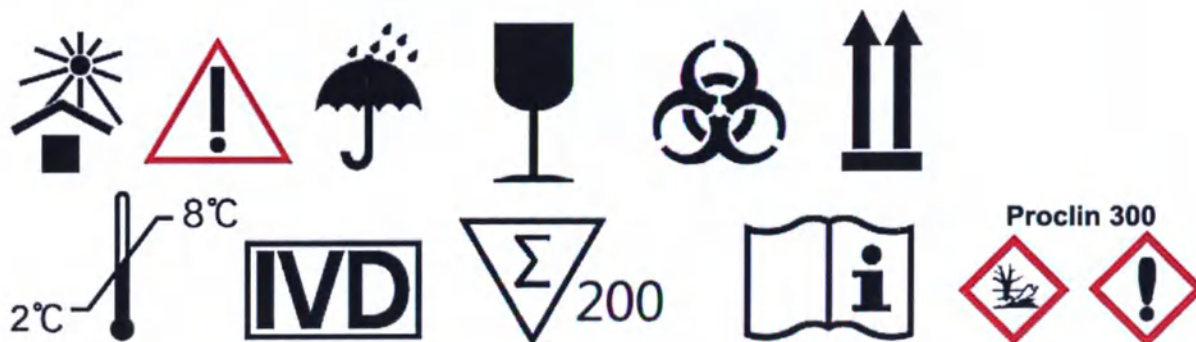

Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.					05.06.2023
LOT	20230601		05.06.2024	REF	C88039M	

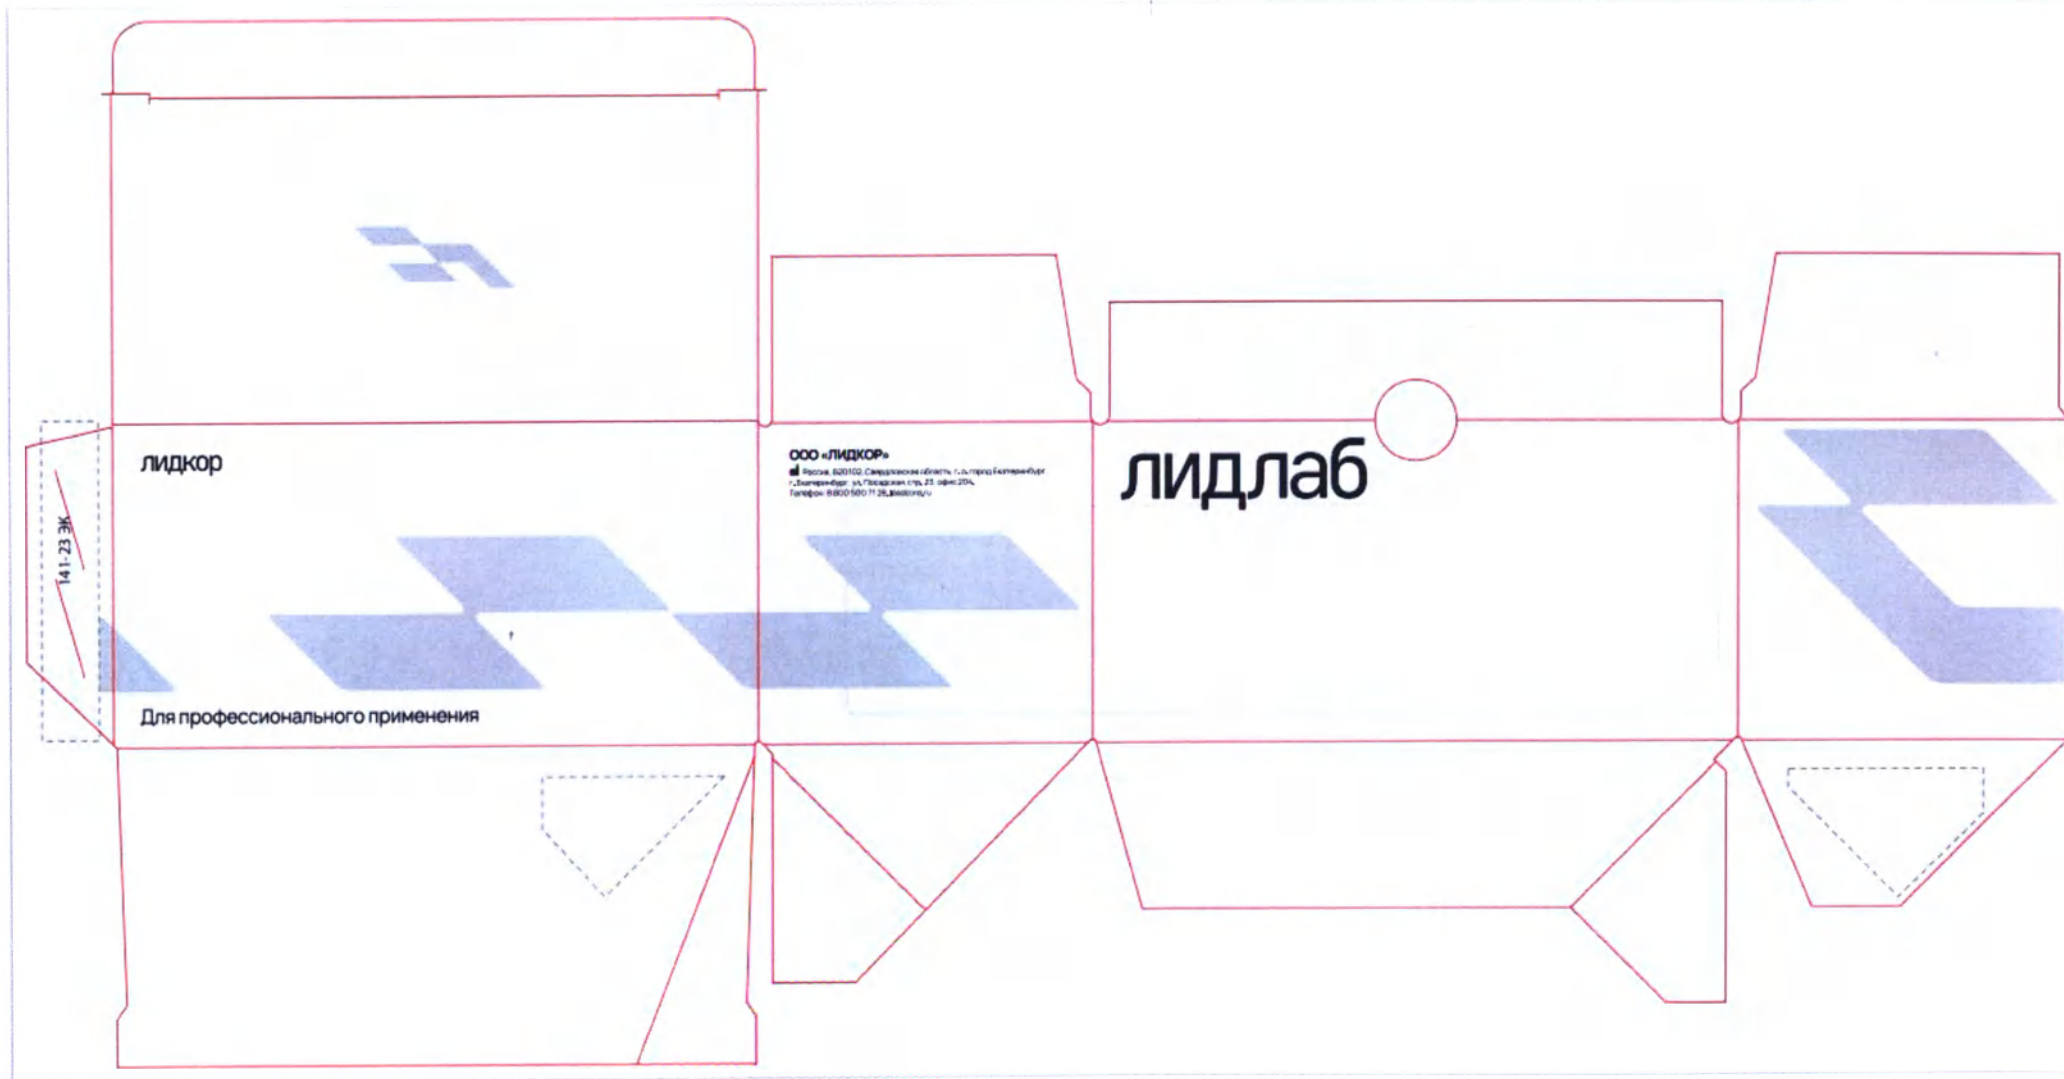

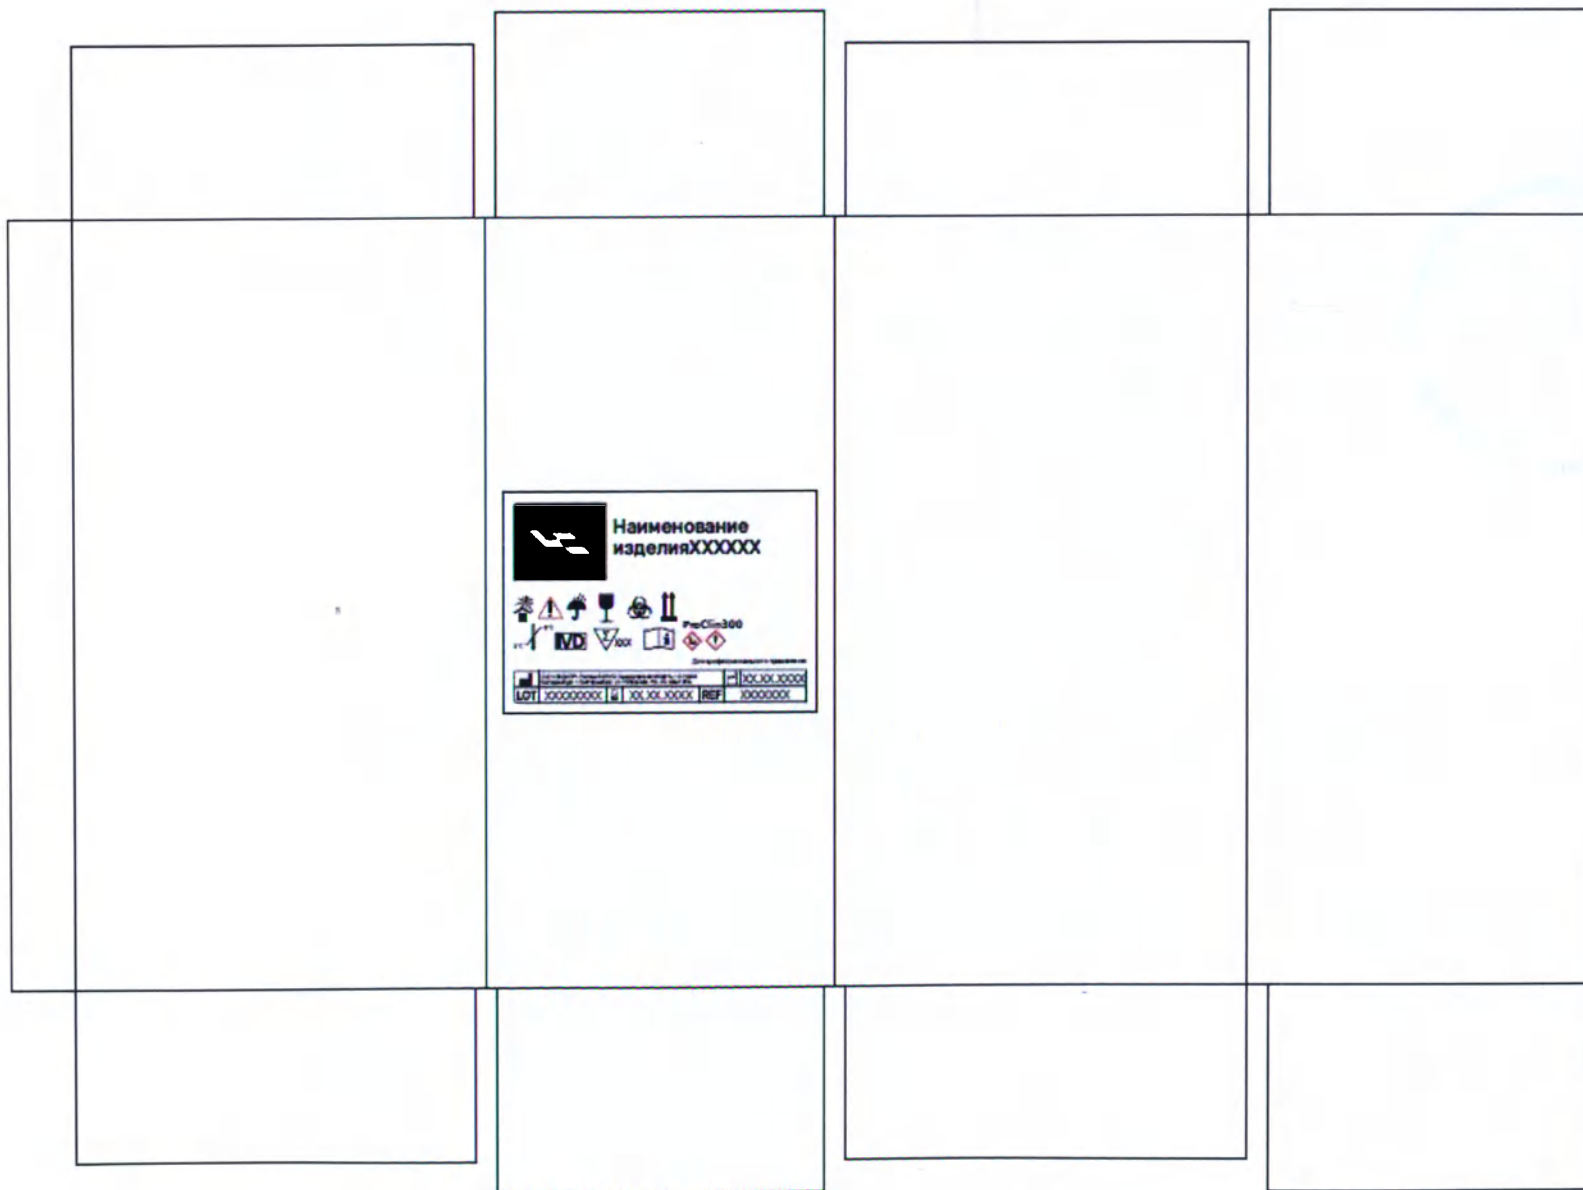

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
11 (однимодуль) л.



Директор
ООО «ЛИДКОР»

/Е. Ю. Гохгут/

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "ЛИДКОР"

Е.Ю. Гохгут

«23» июня 2023 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Набор реагентов «Лидлаб Амур ВПГ-2 IgM» для качественного определения иммуноглобулинов класса М (IgM) к вирусу простого герпеса 2 типа (ВПГ-2) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-262-65614693-2022»

2023


Маркировка первичной упаковки пароиоляционных крышек



Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп., Реагент меченых антител (R2), 6,5 мл/уп., Реагент для разведения образцов (R3), 6,5 мл/уп.)



Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон

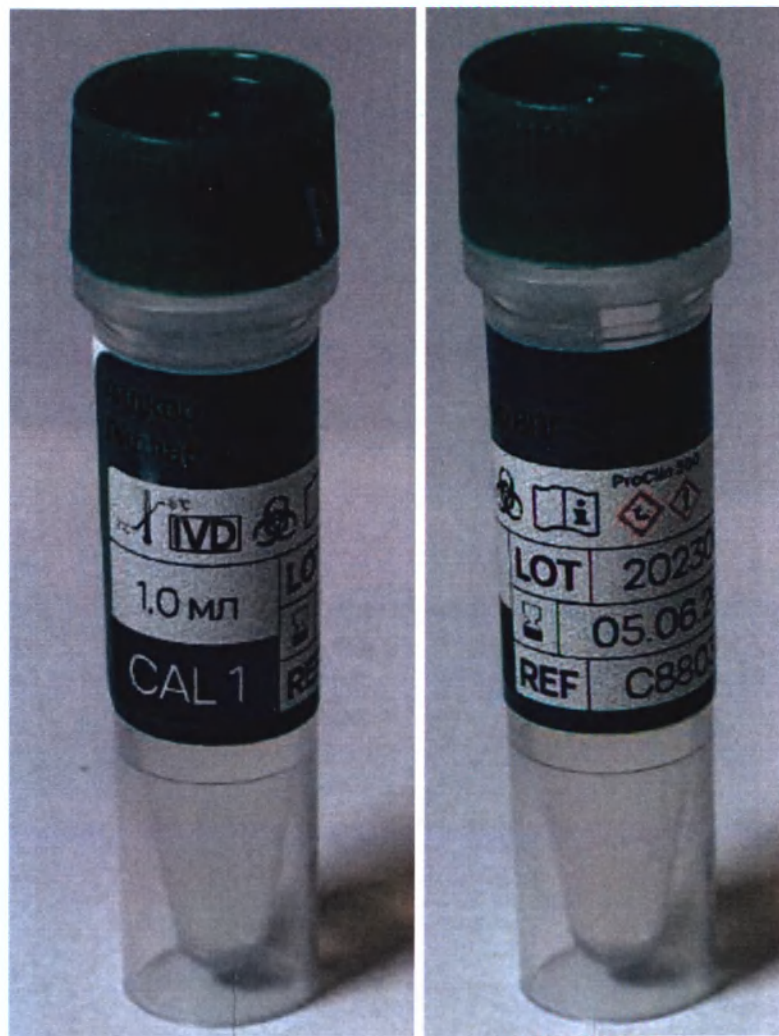

Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон




Потребительская упаковка Набор реагентов на 100 тестов



Потребительская упаковка Набор реагентов на 100 тестов. Вид сбоку




Потребительская упаковка Набор реагентов на 100 тестов. Вид сзади

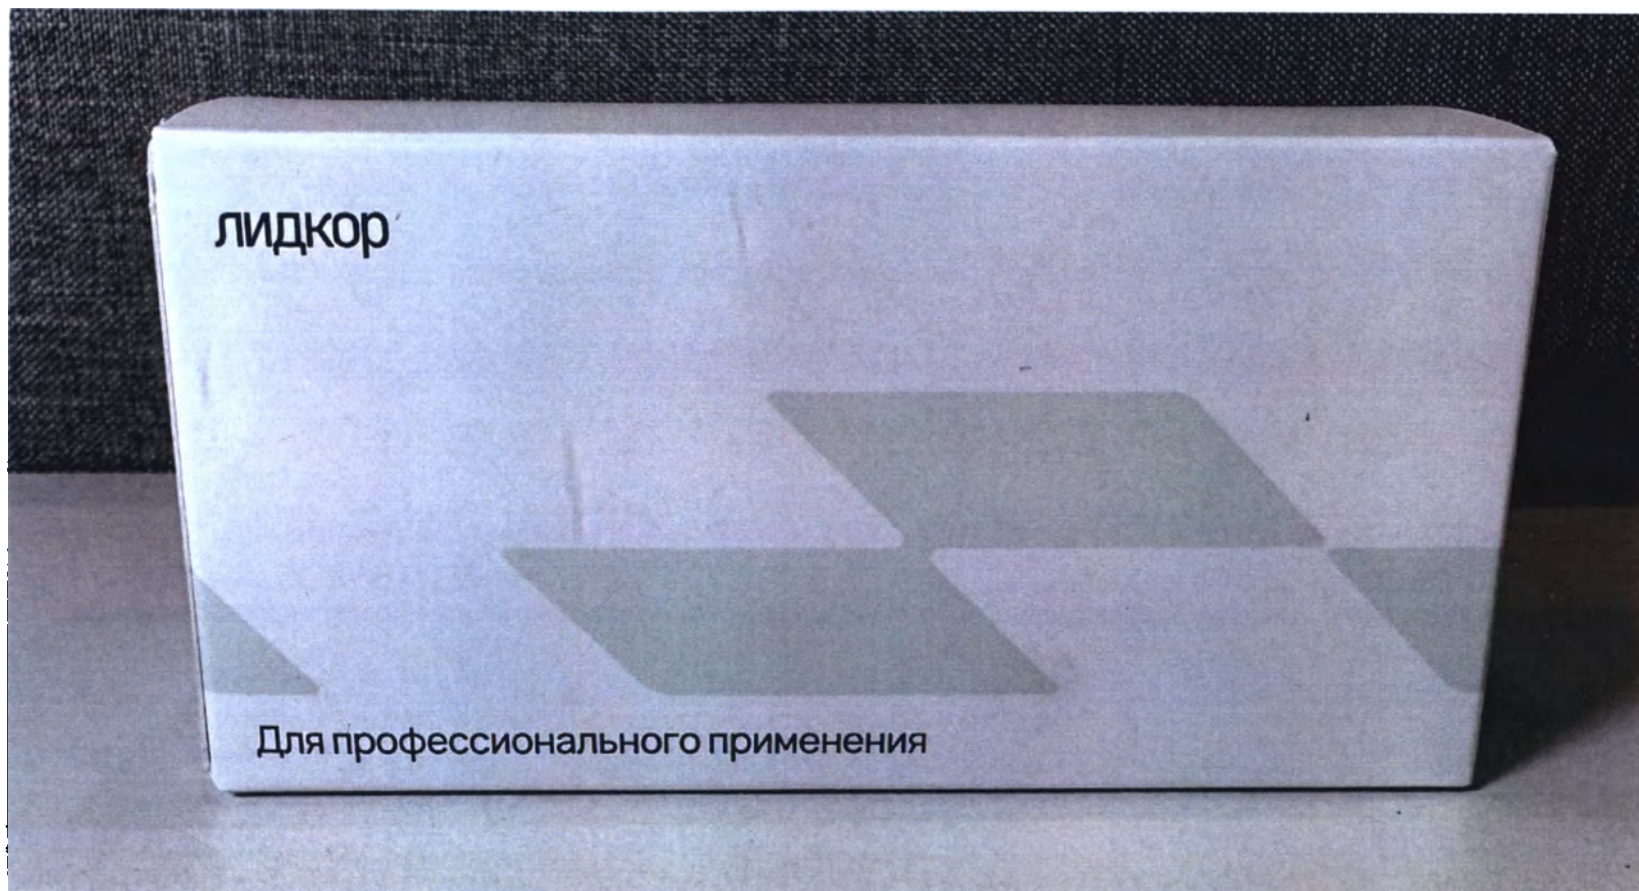


Потребительская упаковка Набор реагентов на 200 тестов




Потребительская упаковка Набор реагентов на 200 тестов. Вид сбоку

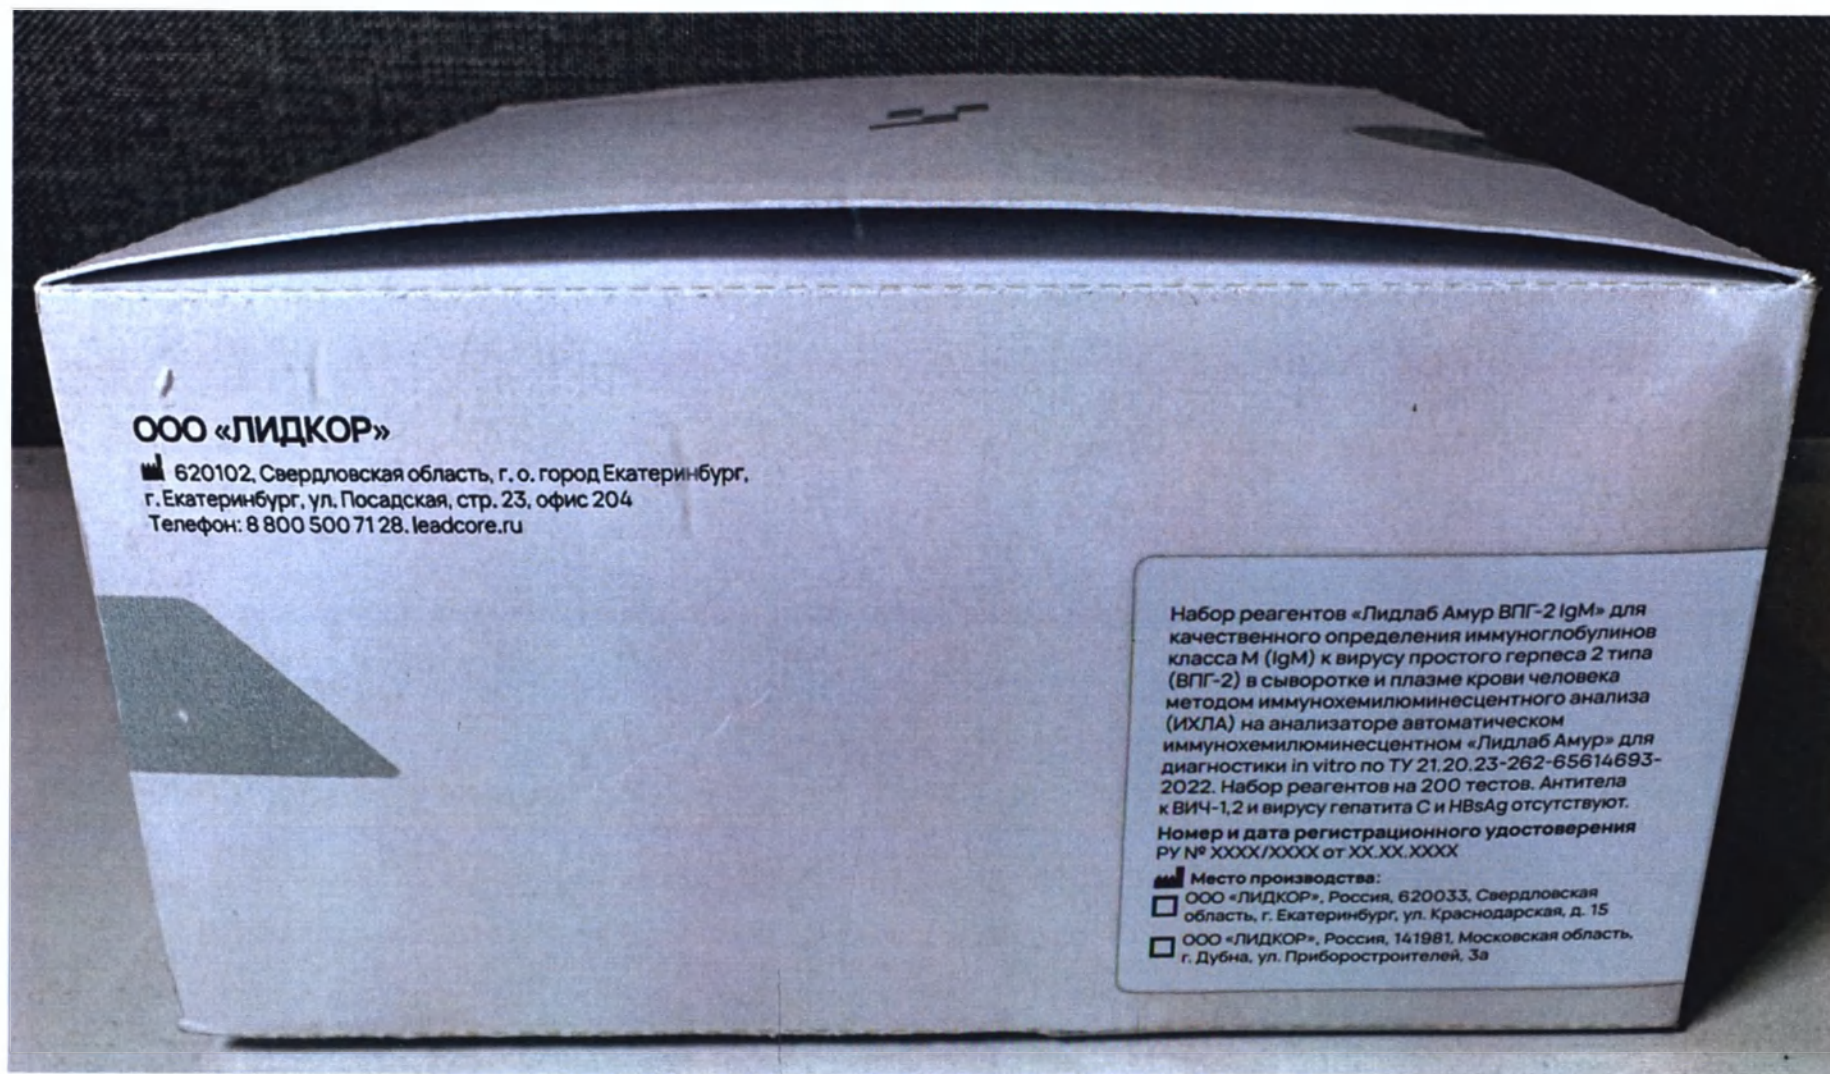


Потребительская упаковка Набор реагентов на 200 тестов. Вид сзади

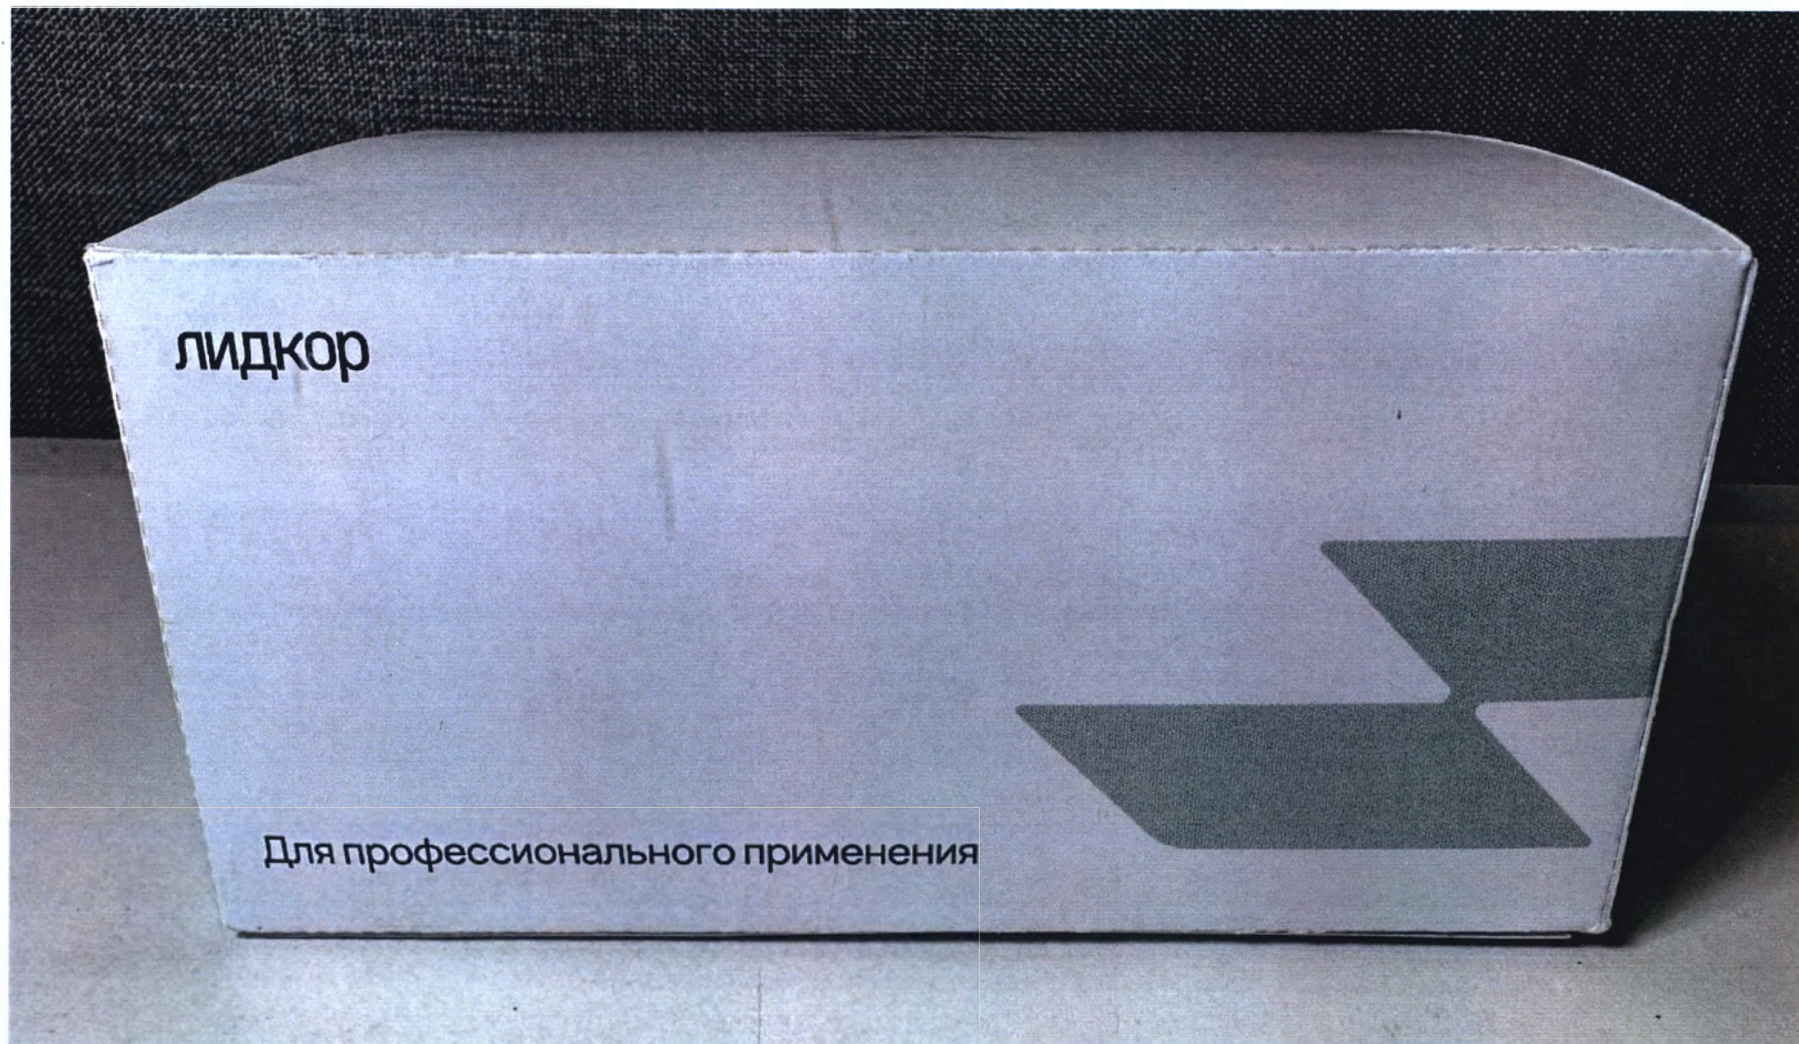


Потребительская упаковка Набор реагентов на 500 тестов

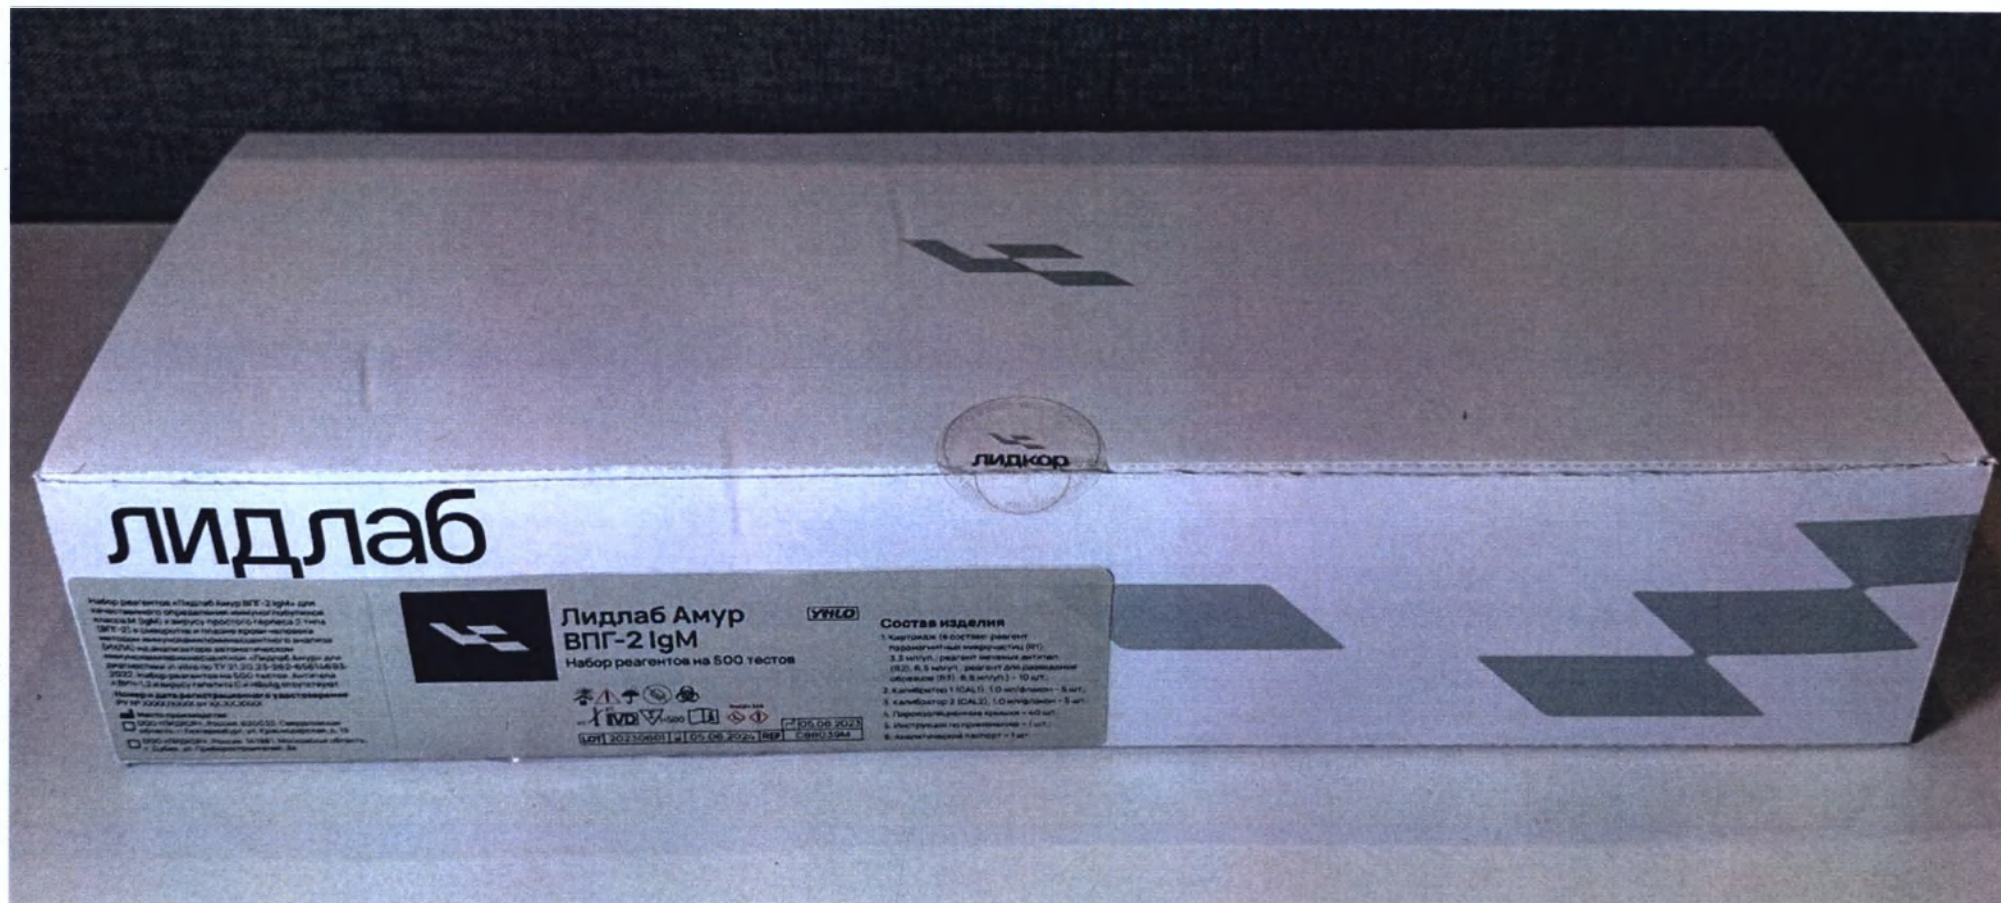


Потребительская упаковка Набор реагентов на 500 тестов. Вид сбоку

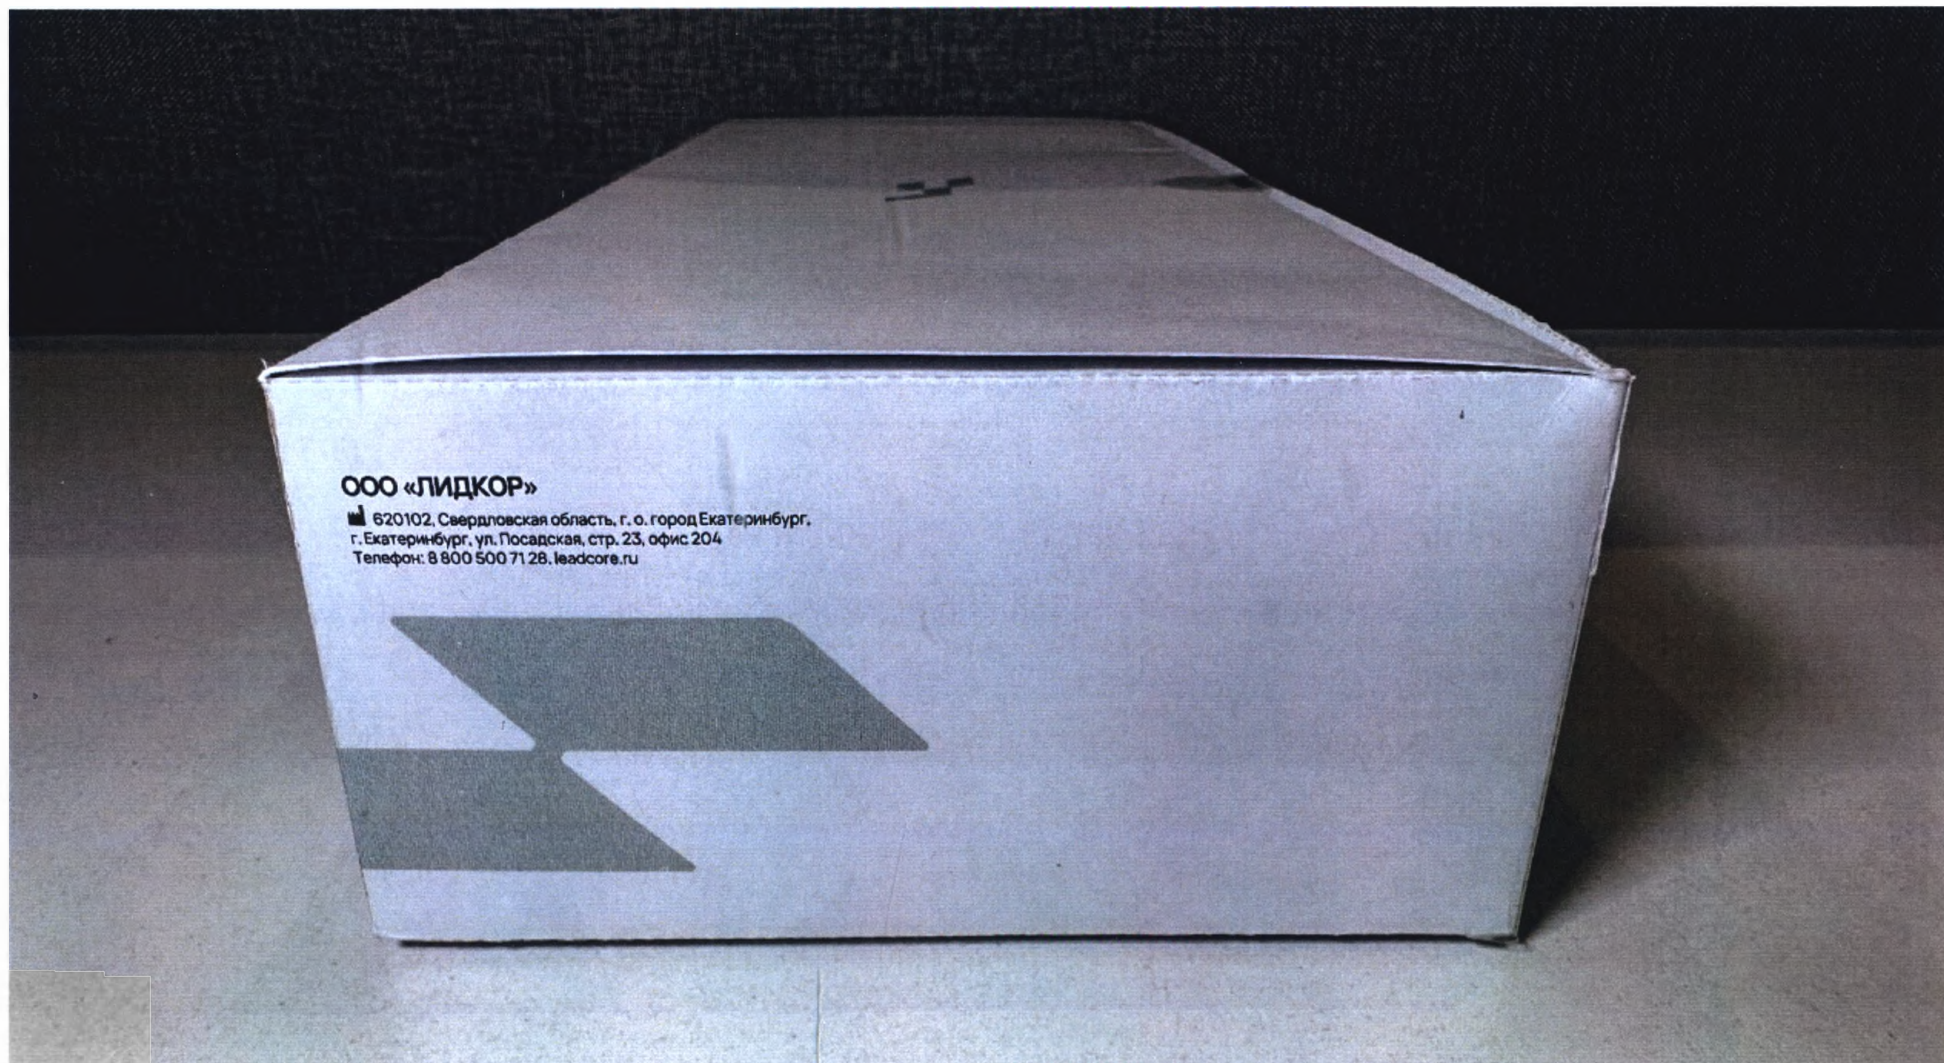

Потребительская упаковка Набор реагентов на 500 тестов. Вид сзади

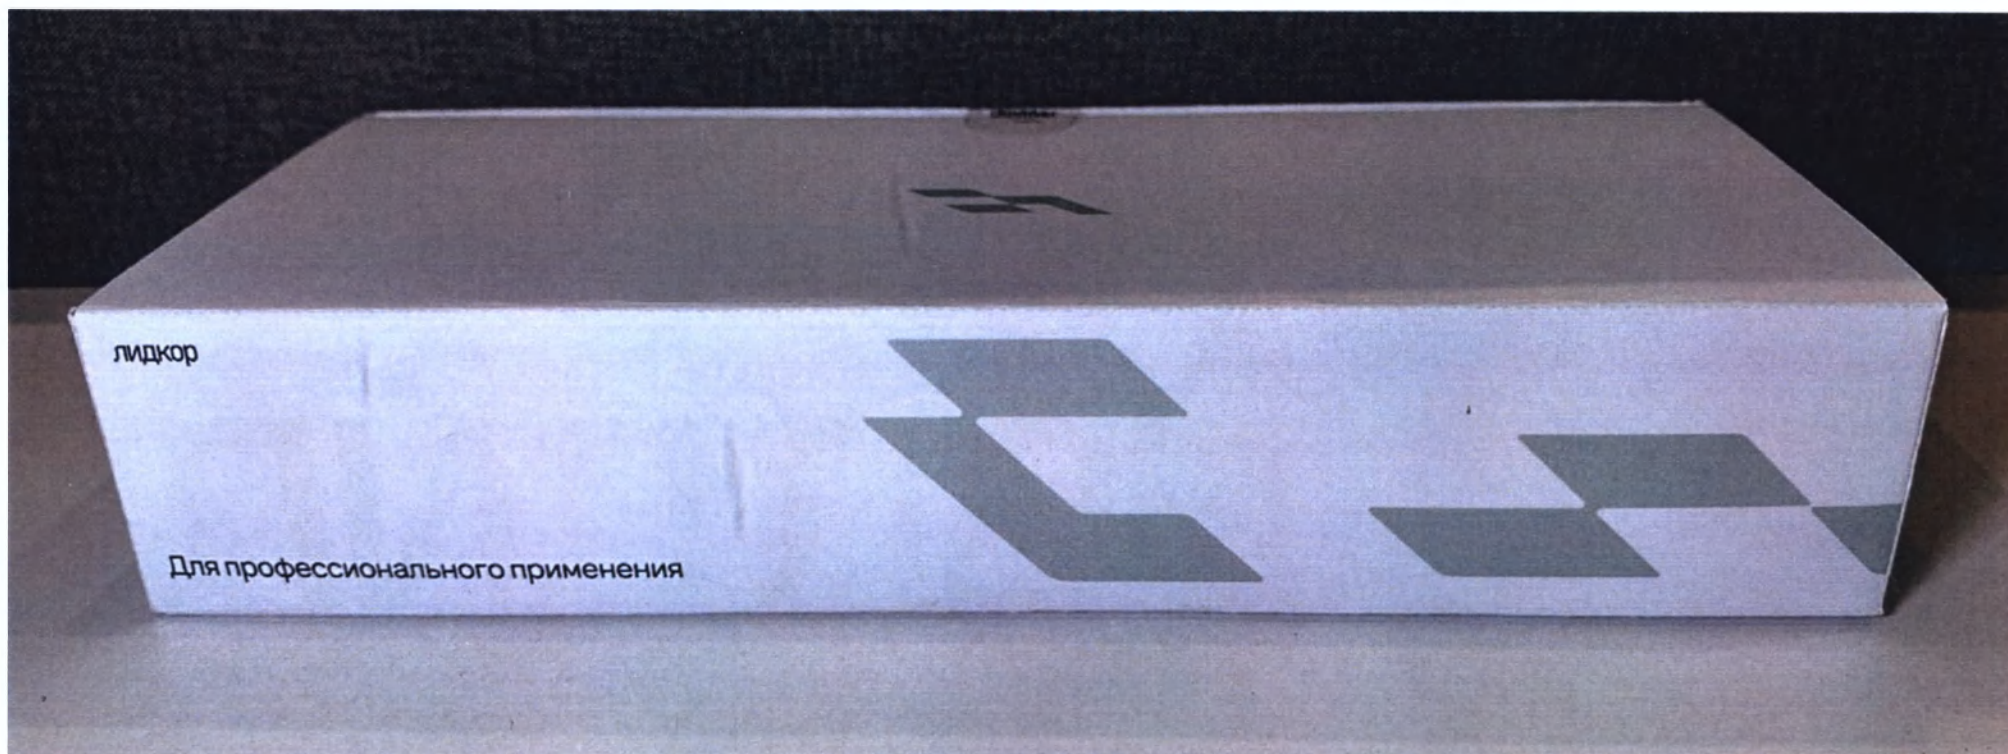


Потребительская упаковка Набор реагентов на 1000 тестов

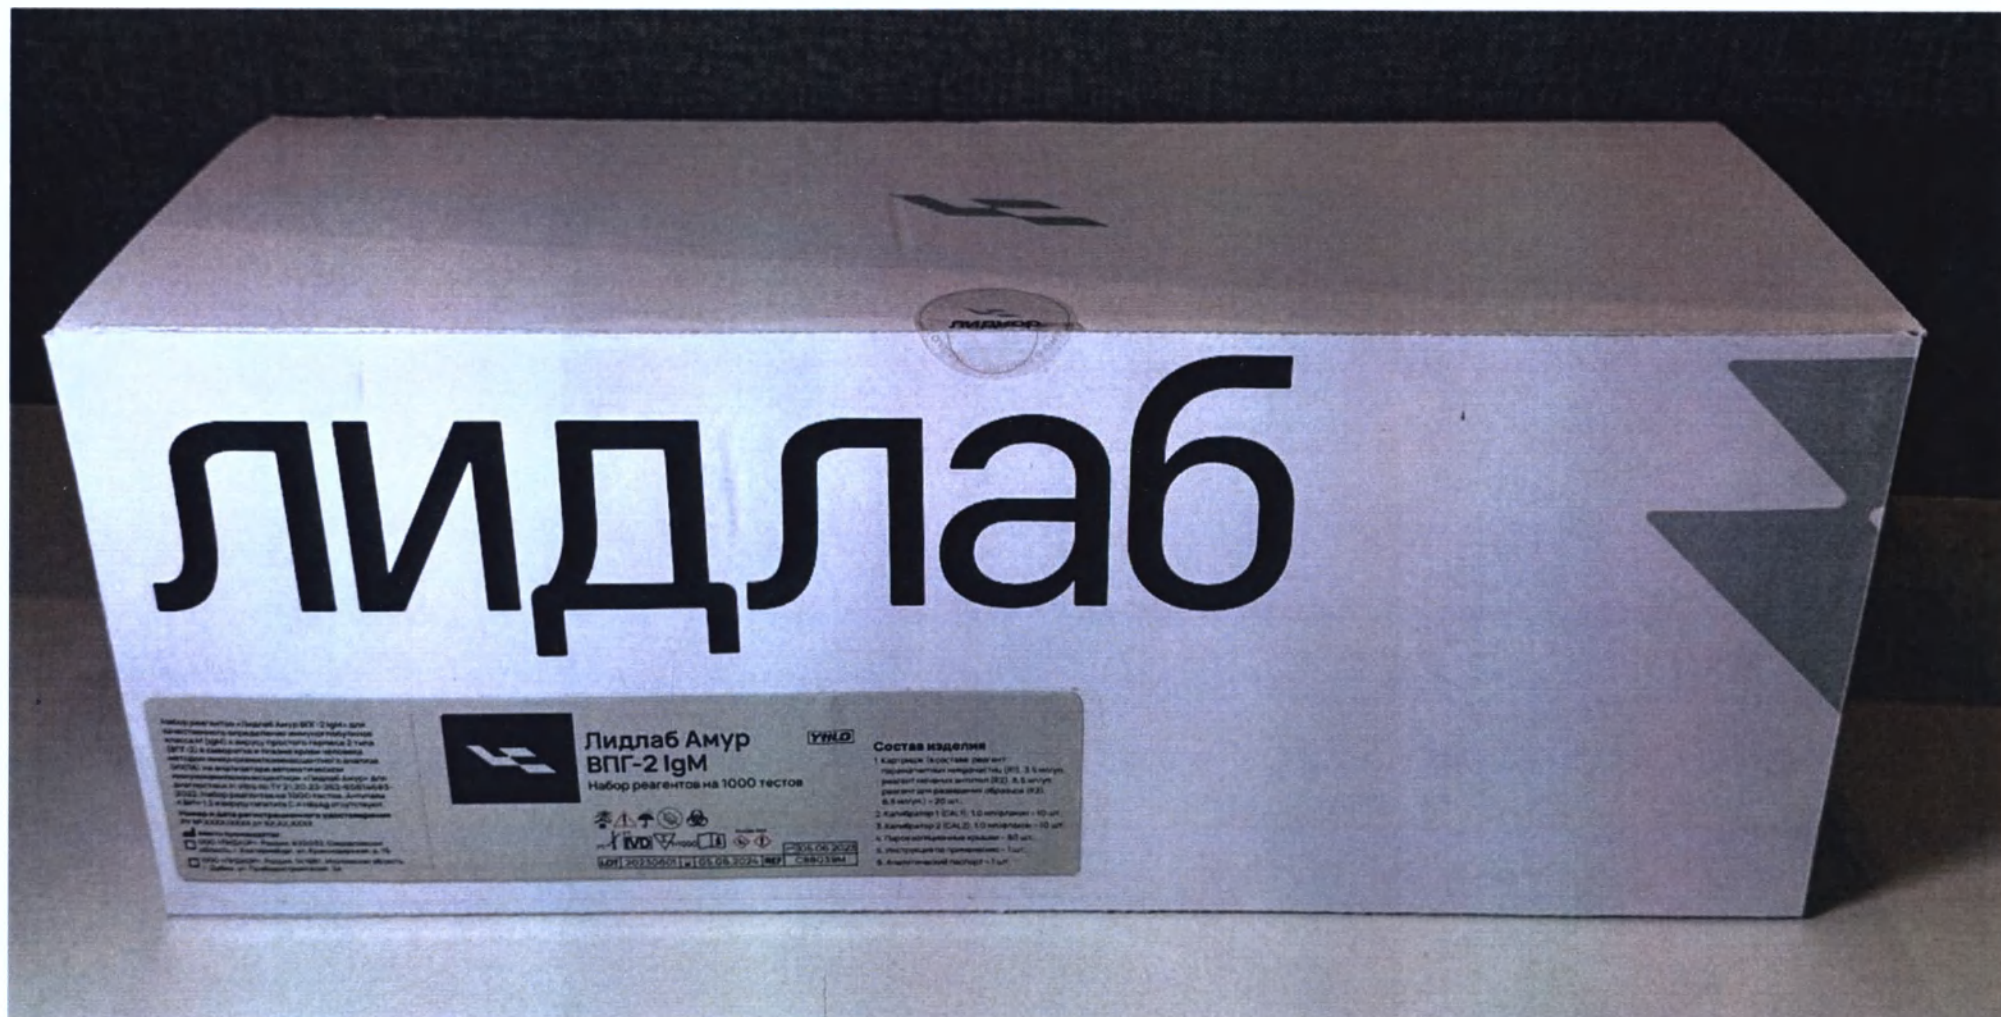

Потребительская упаковка Набор реагентов на 1000 тестов. Вид сбоку



Потребительская упаковка Набор реагентов на 1000 тестов. Вид сзади

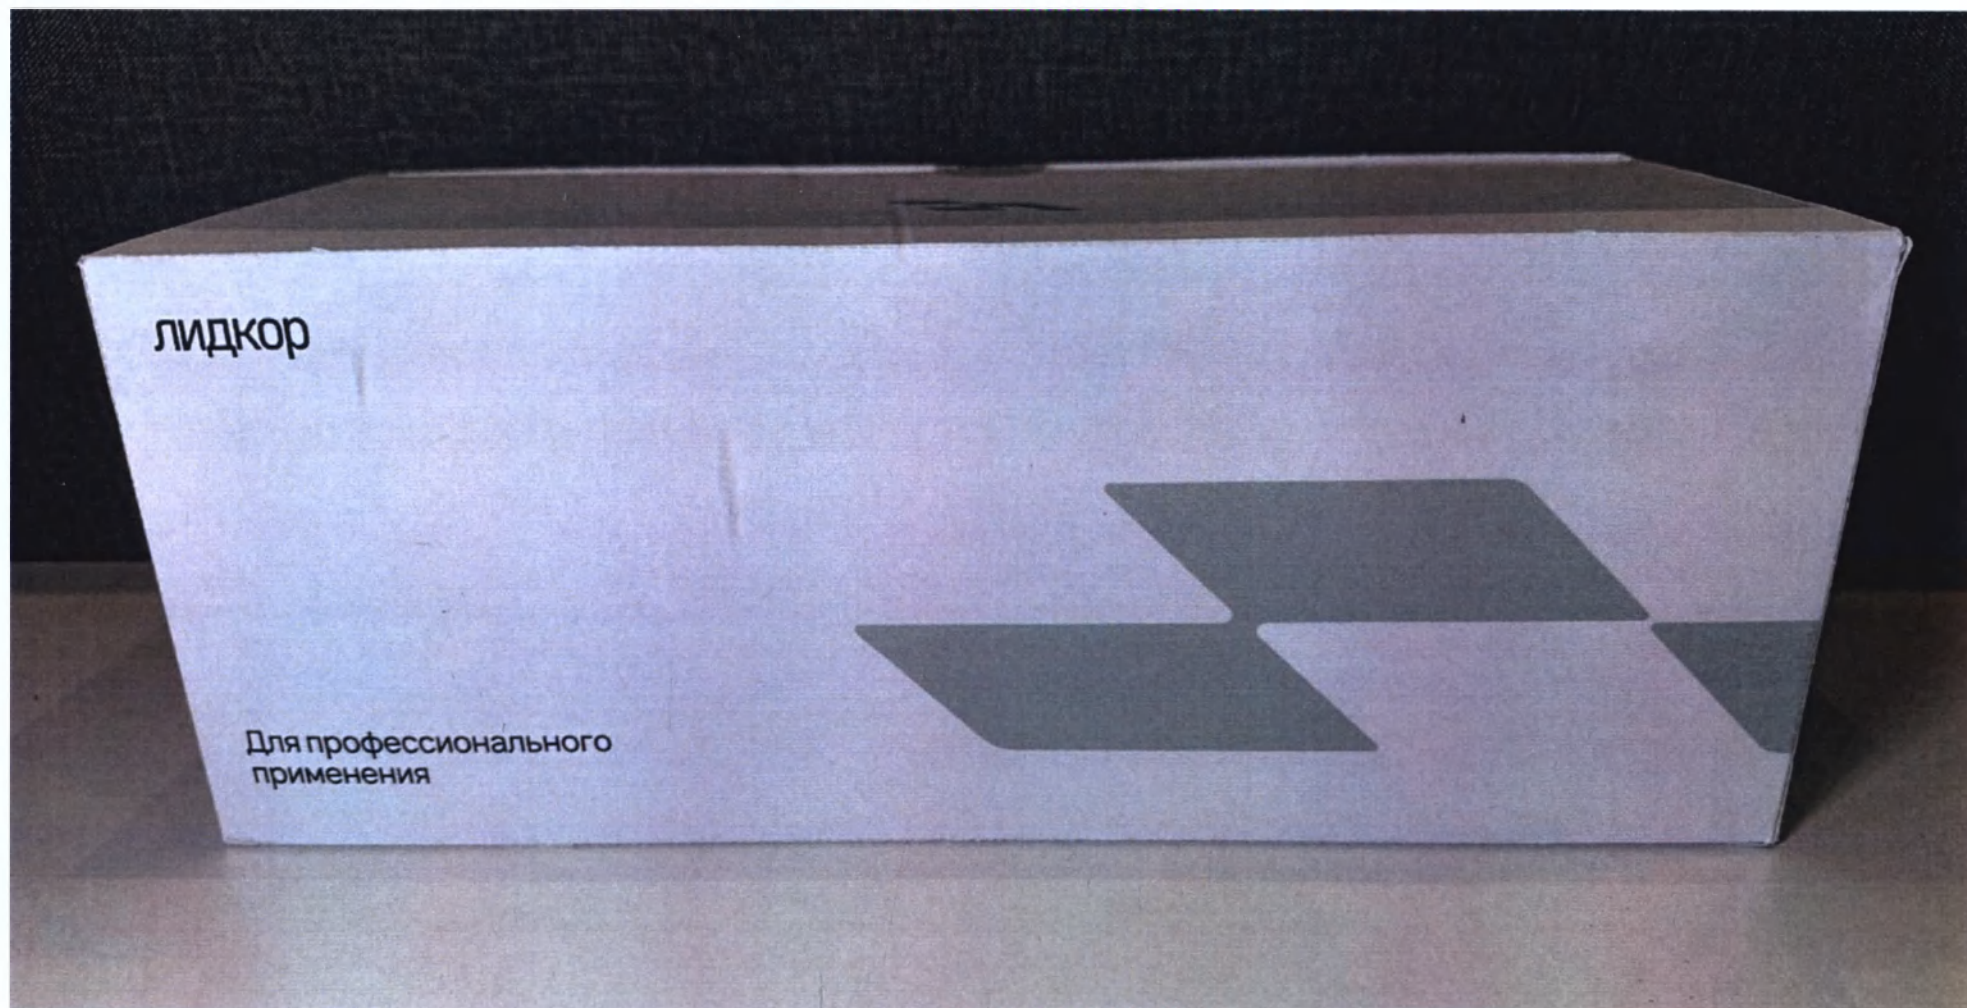

Общий вид медицинского изделия



Транспортная упаковка Набор реагентов на 100 тестов



Транспортная упаковка Набор реагентов на 200 тестов



Транспортная упаковка Набор реагентов на 500 тестов



Транспортная упаковка Набор реагентов на 1000 тестов



Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

22 (двадцать два) л.

Директор

ООО «ЛИДКОР»

/Е. Ю. Гохгут/

