


УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «ЛИДКОР»



 Гохгут. Е.Ю.




2023 г.
М.П.

Макет маркировки
«Калибратор ретикулоцитов для анализатора
гематологического автоматического «Лидлаб Енисей»
серии F 8, по ТУ 21.20.23–310-65614693-2022»

Калибратор ретикулоцитов 2,5 мл – 1 шт.

	Калибратор ретикулоцитов	2,5 мл	
	IVD  2°C – 8°C   	 12345678901234567890	
	РУ № РЗН 2023/XXXXXX от XX.XX.202X		
	LOT		XXXXXXXX
			XX.XX.XXXX
	XX.XX.XXXX		



«Лидлаб Енисей» серии F 8

Калибратор ретикулоцитов

Калибратор ретикулоцитов для анализатора
гематологического автоматического «Лидлаб Енисей»
серии F 8, по ТУ 21.20.23-310-65614693-2022



Место производства


- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область,
г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а

Состав изделия:

Калибратор ретикулоцитов 2,5 мл – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

Аналитический паспорт – 1 шт.



	XX.XX.XXXX	LOT	XXXXXXXXXX
	XX.XX.XXXX	REF	XXXXXXXXXX

maccura

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № РЗН 2023/XXXXXX от XX.XX.202X



«Лидлаб Енисей» серии F 8

Калибратор ретикулоцитов



«Лидлаб Енисей» серии F 8

Калибратор ретикулоцитов

Калибратор ретикулоцитов для анализатора
гематологического автоматического «Лидлаб Енисей»
серии F 8, по ТУ 21.20.23-310-65614693-2022





Место производства

☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15

☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область,
г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а

Масса нетто 3,1 кг

Масса брутто 4,1 кг



XX.XX.XXXX

LOT

XXXXXXXXXX



XX.XX.XXXX

REF

XXXXXXXXXX

Для профессионального
применения

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № РЗН 2023/XXXXXX от XX.XX.202X

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
4 (четыре) л.



Директор
ООО «ЛИДКОР»

/Е. Ю. Гохгут/

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «ЛИДКОР»



Гохгут. Е.Ю.

2023 г.
М.П.

**Фотографические изображения общего вида
«Калибратор ретикулоцитов для анализатора
гематологического автоматического «Лидлаб Енисей»
серии F 8, по ТУ 21.20.23–310-65614693-2022»**

Калибратор ретикулоцитов 2,5 мл – 1 шт.
Серия 20230905



Калибратор ретикулоцитов 2,5 мл – 1 шт.
Серия 20230706




Потребительская упаковка
Серия 20230905



(Вид сверху)

ООО «ЛИДКОР»

Россия, 620102, Свердловская область, г. о. город Екатеринбург,
г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204
Телефон: 8 800 500 71 28. leadcore.ru

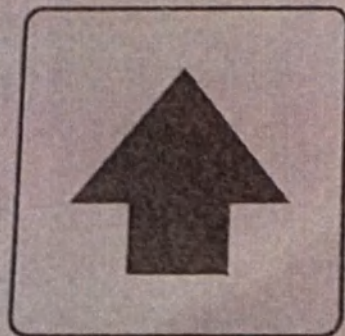


(Вид сзади)

Для профессионального
применения



(Вид справа)

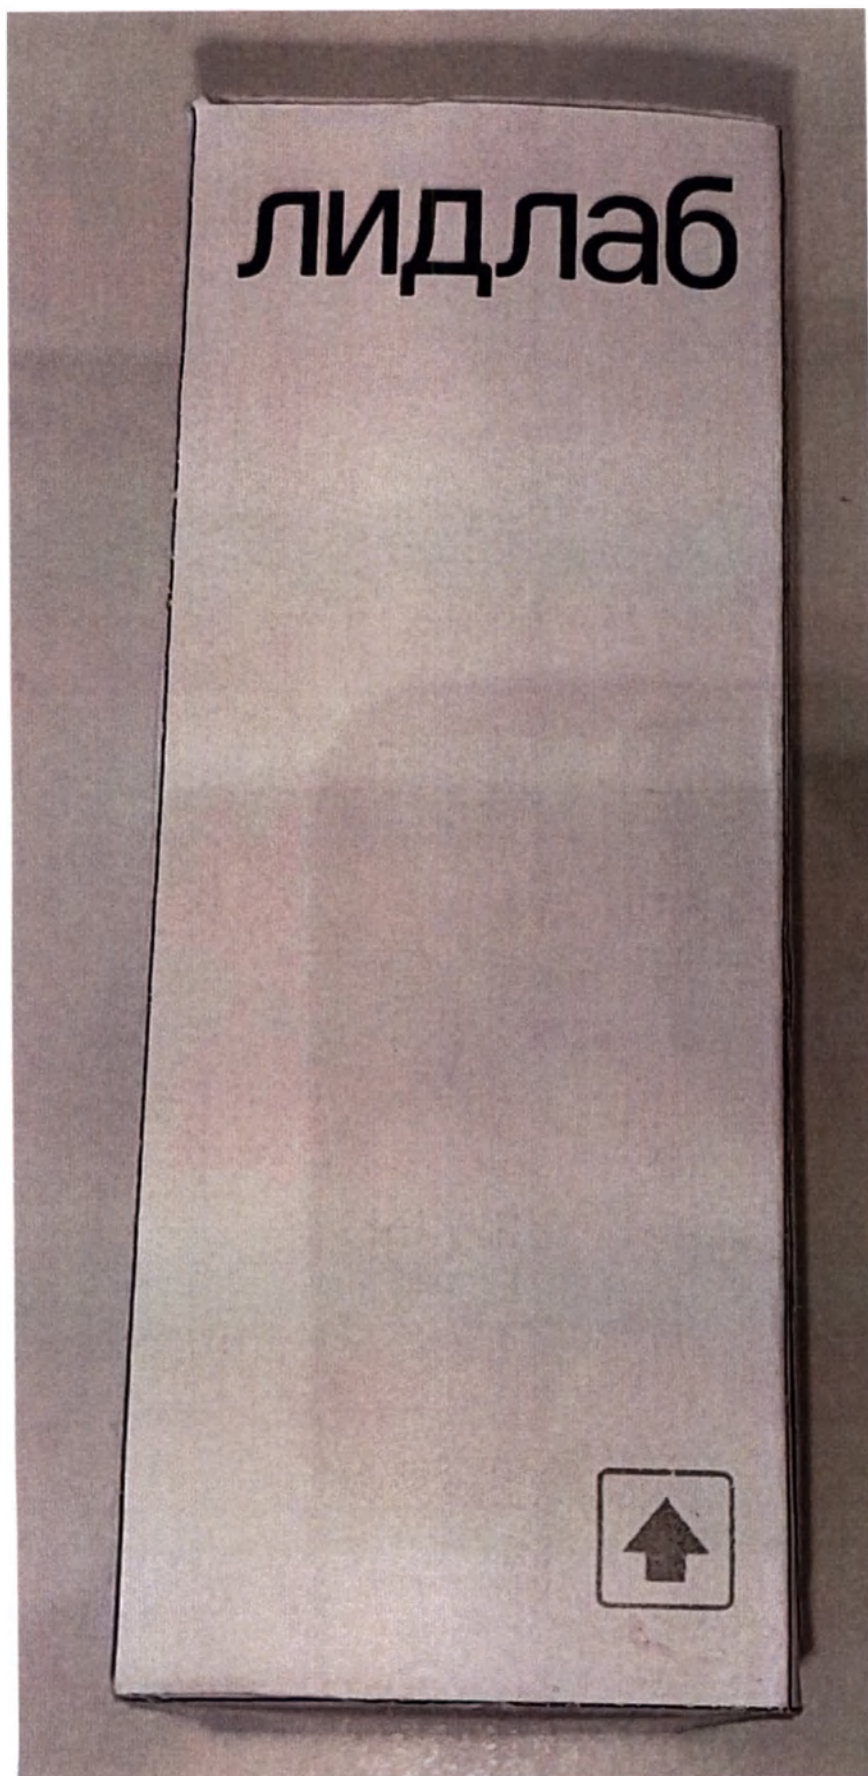

(Вид слева)

 Место производства


- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область,
г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а

Состав изделия:

Калибратор ретикулоцитов 2,5 мл – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

Аналитический паспорт – 1 шт.



	08.09.2023	LOT	20230905
	13.10.2023	REF	BL2281100

massura

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № РЗН 2023/XXXXXX от XX.XX.202X



«Лидлаб Енисей» серии F 8

**Калибратор
ретикулоцитов**

(Вид спереди)


Потребительская упаковка
Серия 20230706




(Вид сверху)

ООО «ЛИДКОР»


Россия, 620102, Свердловская область, г. о. город Екатеринбург,
г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204
Телефон: 8 800 500 71 28. leadcore.ru

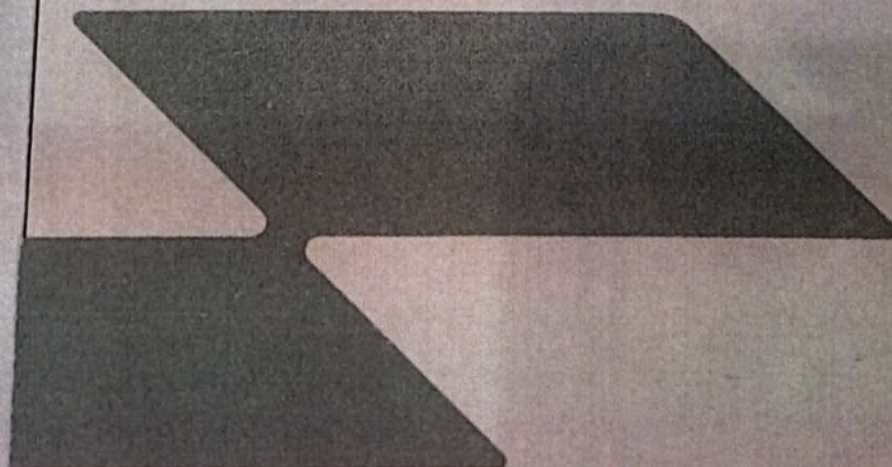

(Вид сзади)

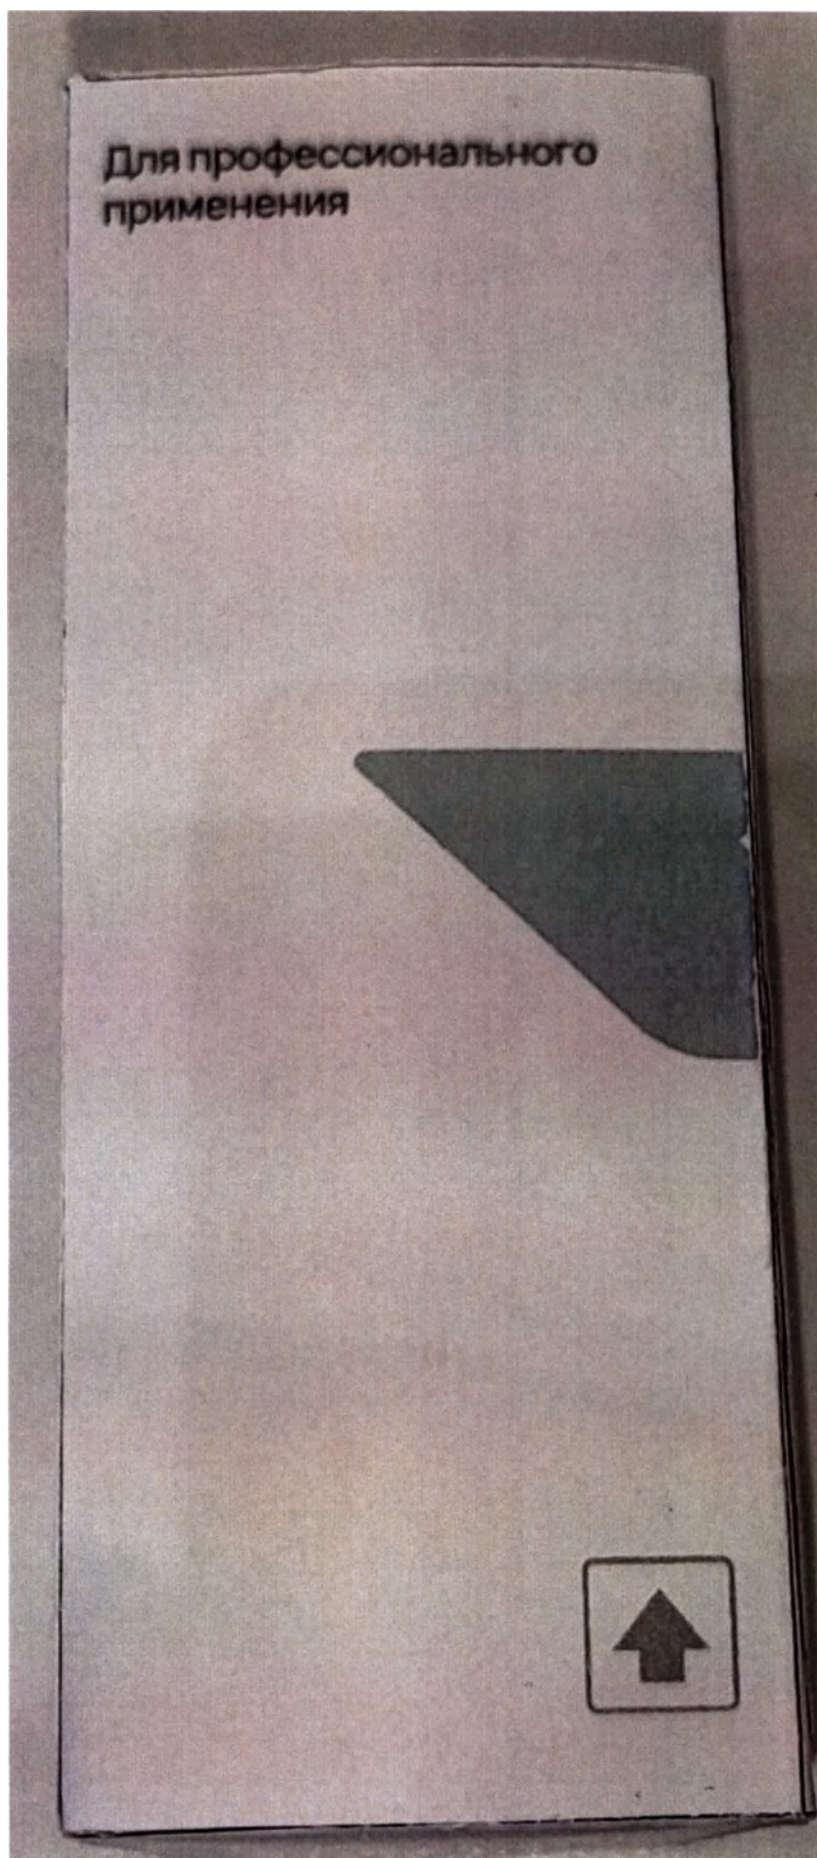

(Вид справа)

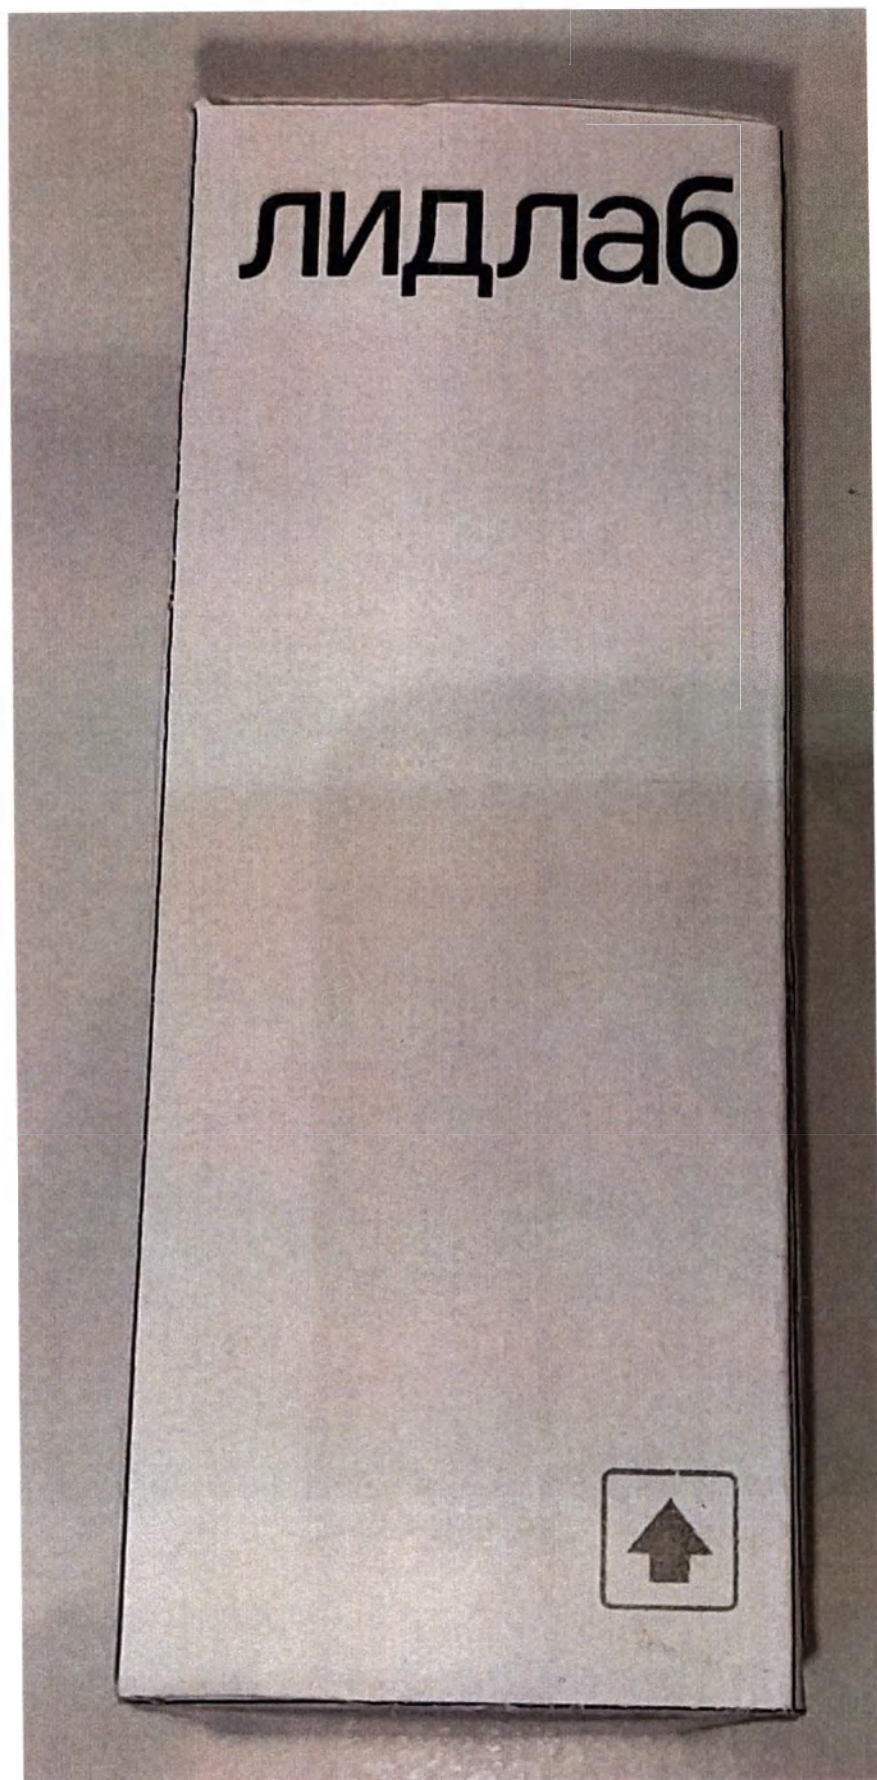

(Вид слева)

 Место производства

☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15


☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область,
г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а

Состав изделия:

Калибратор ретикулоцитов 2,5 мл – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

Аналитический паспорт – 1 шт.



	19.09.2023	LOT	20230706
	24.10.2023	REF	BL2281100

maccura

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № РЗН 2023/XXXXXX от XX.XX.202X




«Лидлаб Енисей» серии F 8


**Калибратор
ретикулоцитов**

(Вид спереди)


Групповое фото
Серия 20230905

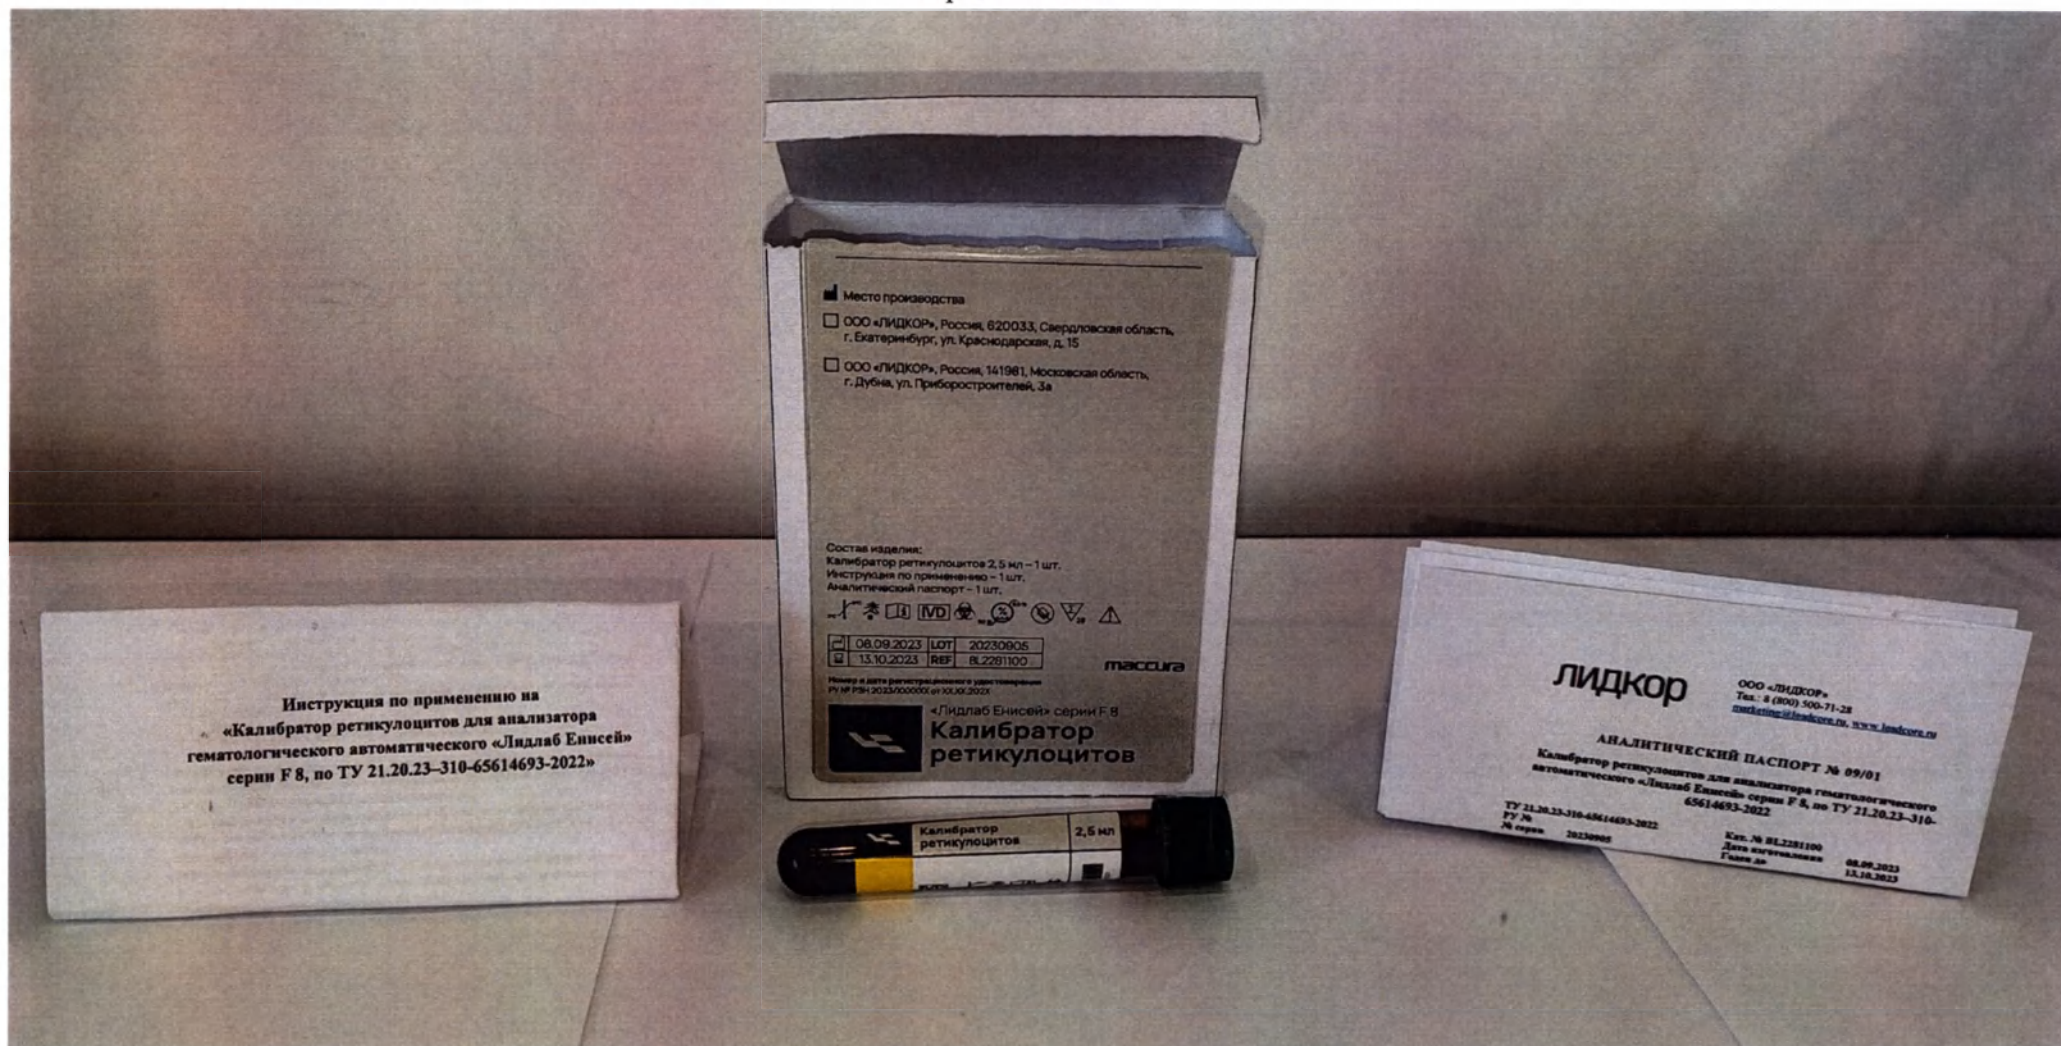

Групповое фото
Серия 20230706

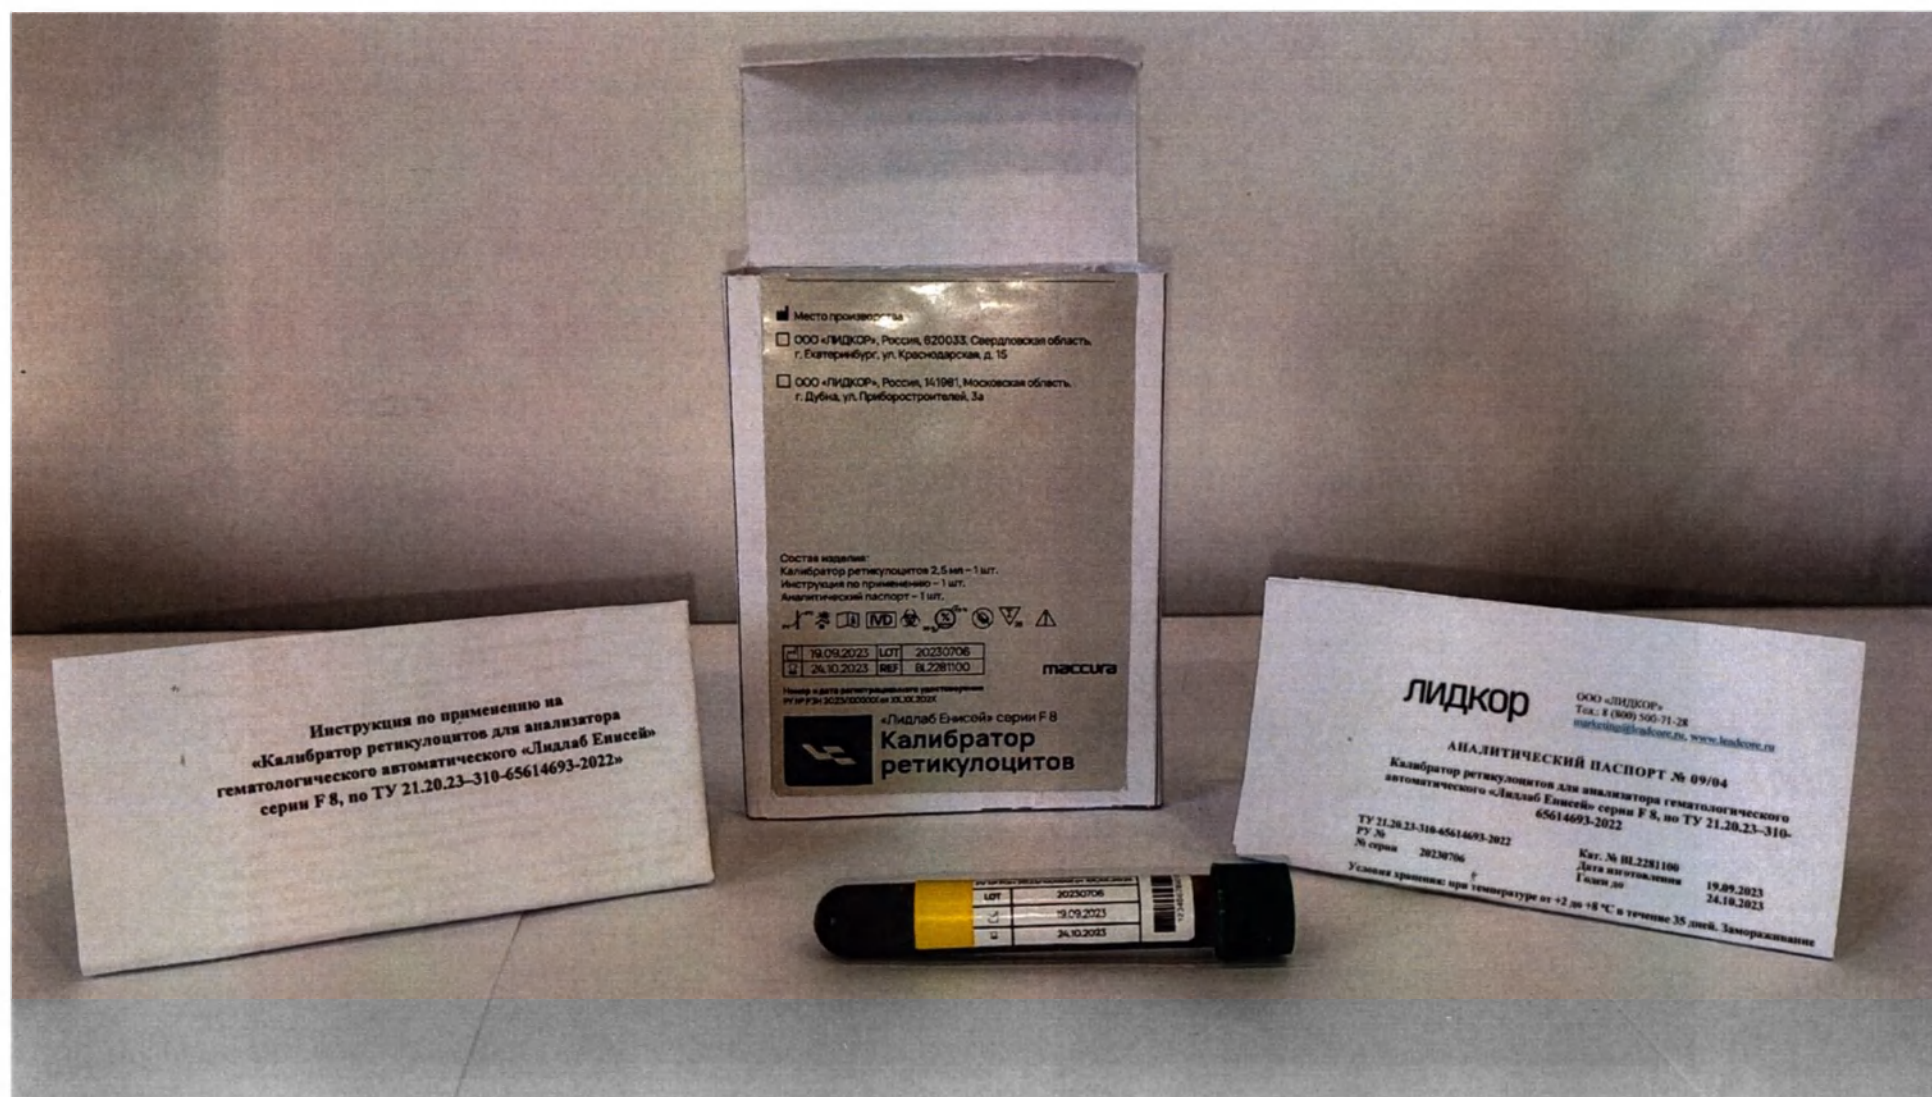

Серия 20230905

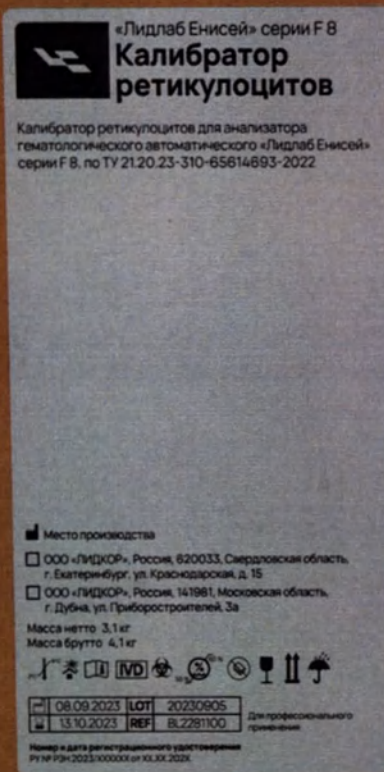

Транспортная упаковка

Серия 20230706



Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
(*Е. Ю. Гохгут*) л.

Директор
ООО «ИДКОР»
Е. Ю. Гохгут/

