

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "ЛИДКОР"

Е.Ю. Гохгут

«10» июля 2023 г.



МАКЕТ МАРКИРОВКИ

«Набор реагентов «Лидлаб Амур EB NA IgG» для количественного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр (EBV NA) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 249-65614693-2022»

2023

Набор реагентов «Лидлаб Амур EB NA IgG» для количественного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр (EBV NA) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-249-65614693-2022. Набор реагентов на 100 тестов. Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

 Место производства:

- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур EB NA IgG

Набор реагентов на 100 тестов

YHLO



2°C
8°C
IVD

Σ x100



05.06.2023

LOT 20230601 05.06.2024 REF C88008G

Состав изделия

1. Картридж (в составе: реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; реагент меченых антител (R2), 6,5 мл/уп.; реагент для разведения образцов (R3), 6,5 мл/уп.) – 2 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон – 1 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон – 1 шт.;
4. Калибратор 3 (CAL3), 1,0 мл/флакон – 1 шт.;
5. Пароизоляционные крышки – 8 шт.;
6. Инструкция по применению – 1 шт.;
7. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур EB NA IgG» для количественного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр (EBV NA) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-249-65614693-2022. Набор реагентов на 200 тестов. Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

 Место производства:

- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур EB NA IgG

Набор реагентов на 200 тестов

YHLO



2°C
8°C
IVD

Σ x200



05.06.2023

LOT 20230601 05.06.2024 REF C88008G

Состав изделия

1. Картридж (в составе: реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; реагент меченых антител (R2), 6,5 мл/уп.; реагент для разведения образцов (R3), 6,5 мл/уп.) – 4 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон – 2 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон – 2 шт.;
4. Калибратор 3 (CAL3), 1,0 мл/флакон – 2 шт.;
5. Пароизоляционные крышки – 16 шт.;
6. Инструкция по применению – 1 шт.;
7. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур EB NA IgG» для количественного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр (EBV NA) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-249-65614693-2022. Набор реагентов на 500 тестов. Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:



- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур EB NA IgG

Набор реагентов на 500 тестов

YHLO



LOT 20230601 05.06.2024 REF C88008G

Состав изделия

1. Картридж (в составе: реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; реагент меченых антител (R2), 6,5 мл/уп.; реагент для разведения образцов (R3), 6,5 мл/уп.) – 10 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон – 5 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон – 5 шт.;
4. Калибратор 3 (CAL3), 1,0 мл/флакон – 5 шт.;
5. Пароизоляционные крышки – 40 шт.;
6. Инструкция по применению – 1 шт.;
7. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур EB NA IgG» для количественного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр (EBV NA) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-249-65614693-2022. Набор реагентов на 1000 тестов. Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:




- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур EB NA IgG

Набор реагентов на 1000 тестов

YHLO



LOT 20230601 05.06.2024 REF C88008G

Состав изделия

1. Картридж (в составе: реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; реагент меченых антител (R2), 6,5 мл/уп.; реагент для разведения образцов (R3), 6,5 мл/уп.) – 20 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон – 10 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон – 10 шт.;
4. Калибратор 3 (CAL3), 1,0 мл/флакон – 10 шт.;
5. Пароизоляционные крышки – 80 шт.;
6. Инструкция по применению – 1 шт.;
7. Аналитический паспорт – 1 шт.

лидкор **YHLO**

**Лидлаб Амур
EB NA IgG**

3,5мл	6,5мл	6,5мл
R 1	R 2	R 3

LOT 20230601 05.06.2024

9031 1017

лидкор

**Лидлаб Амур
EB NA IgG**

Пароизоляционные
крышки – 4 шт.

LOT	20230601	IVD
	05.06.2024	
REF	CC88008G	

Лидлаб Амур EB NA IgG



LOT 20230601 EXP 05.06.2024

лидкор

Лидлаб Амур EB NA IgG

1,0 мл	LOT	20230601
		05.06.2024
CAL 1	REF	CC88008G

лидкор


Лидлаб Амур EB NA IgG

1,0 мл	LOT	20230601
		05.06.2024
CAL 2	REF	CC88008G

лидкор

Лидлаб Амур EB NA IgG

1,0 мл	LOT	20230601
		05.06.2024
CAL 3	REF	CC88008G

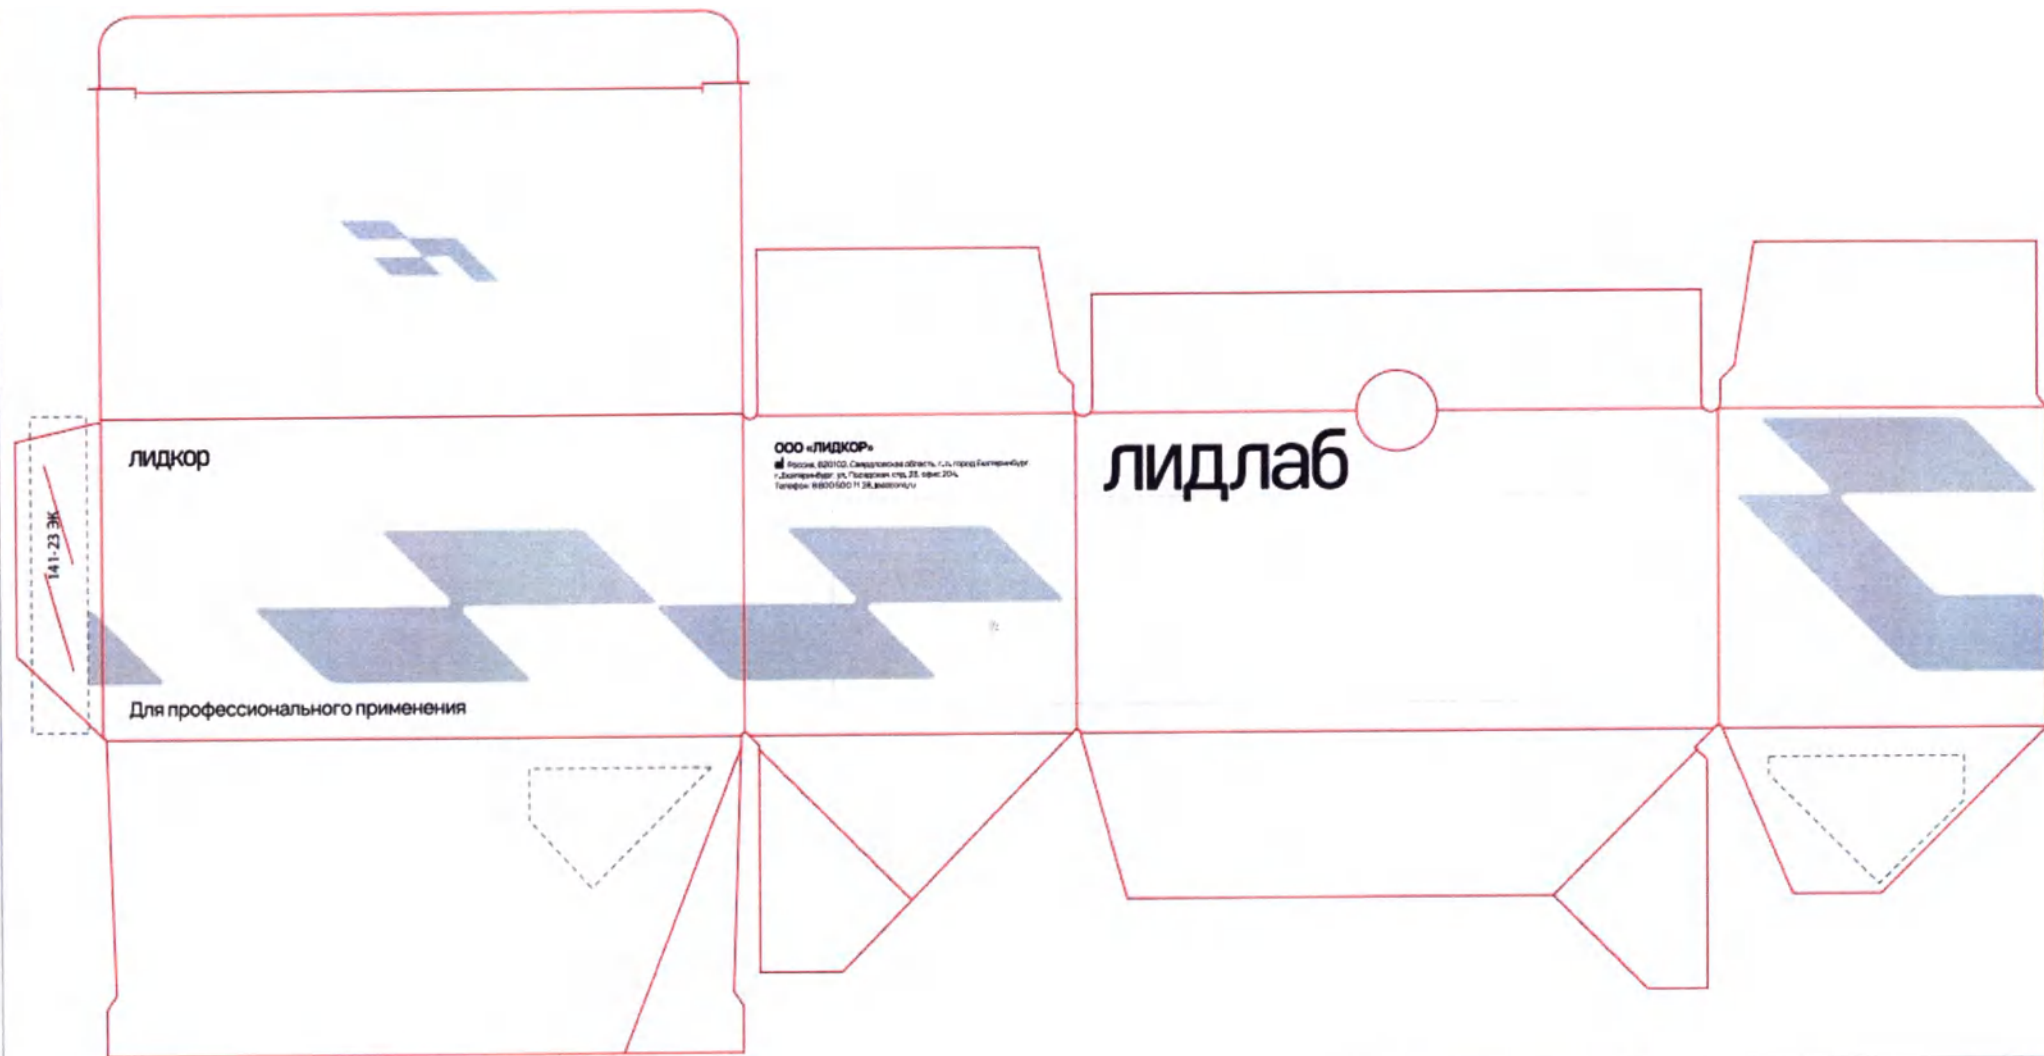

Макет транспортной маркировки



Набор реагентов «Лидлаб Амур EB NA IgG» для количественного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр (EBV NA) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-249-65614693-2022



Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.		05.06.2023
LOT	20230601		05.06.2024
REF	C88008G		

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

6 (Шесть) л.



/Е. Ю. Гохгут/

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО "ЛИДКОР"

Е.Ю. Гохгут

«10» июля 2023 г.




ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Набор реагентов «Лидлаб Амур EB NA IgG» для количественного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр (EBV NA) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 249-65614693-2022»


2023




«Набор реагентов «Лидлаб Амур EB NA IgG» для количественного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр (EBV NA) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 249-65614693-2022» выпускается в четырех вариантах исполнения: Набор реагентов на 100 тестов; Набор реагентов на 200 тестов; Набор реагентов на 500 тестов; Набор реагентов на 1000 тестов

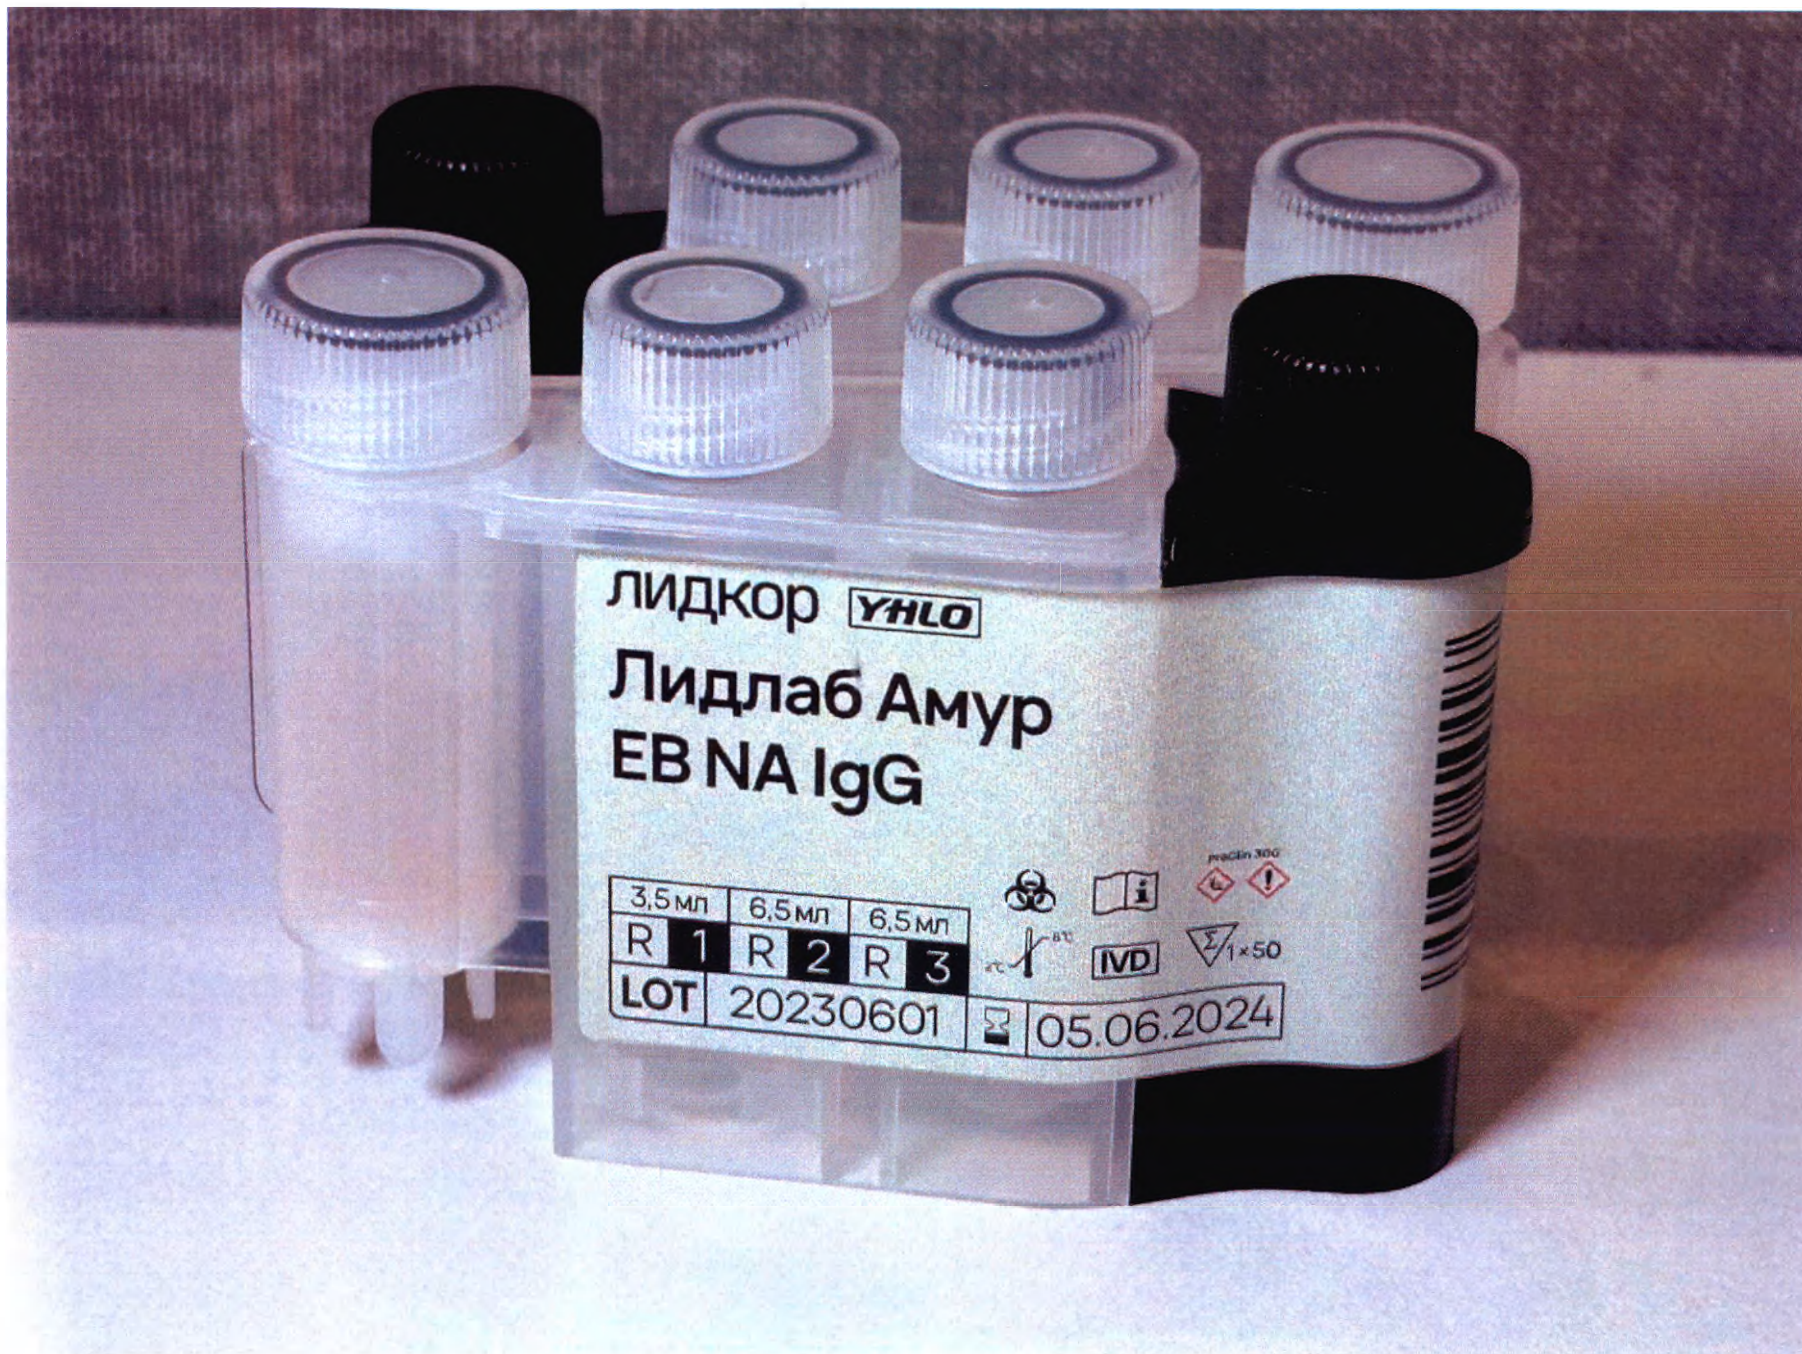


Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп., Реагент меченых антител (R2), 6,5 мл/уп., Реагент для разведения образцов (R3), 6,5 мл/уп.)

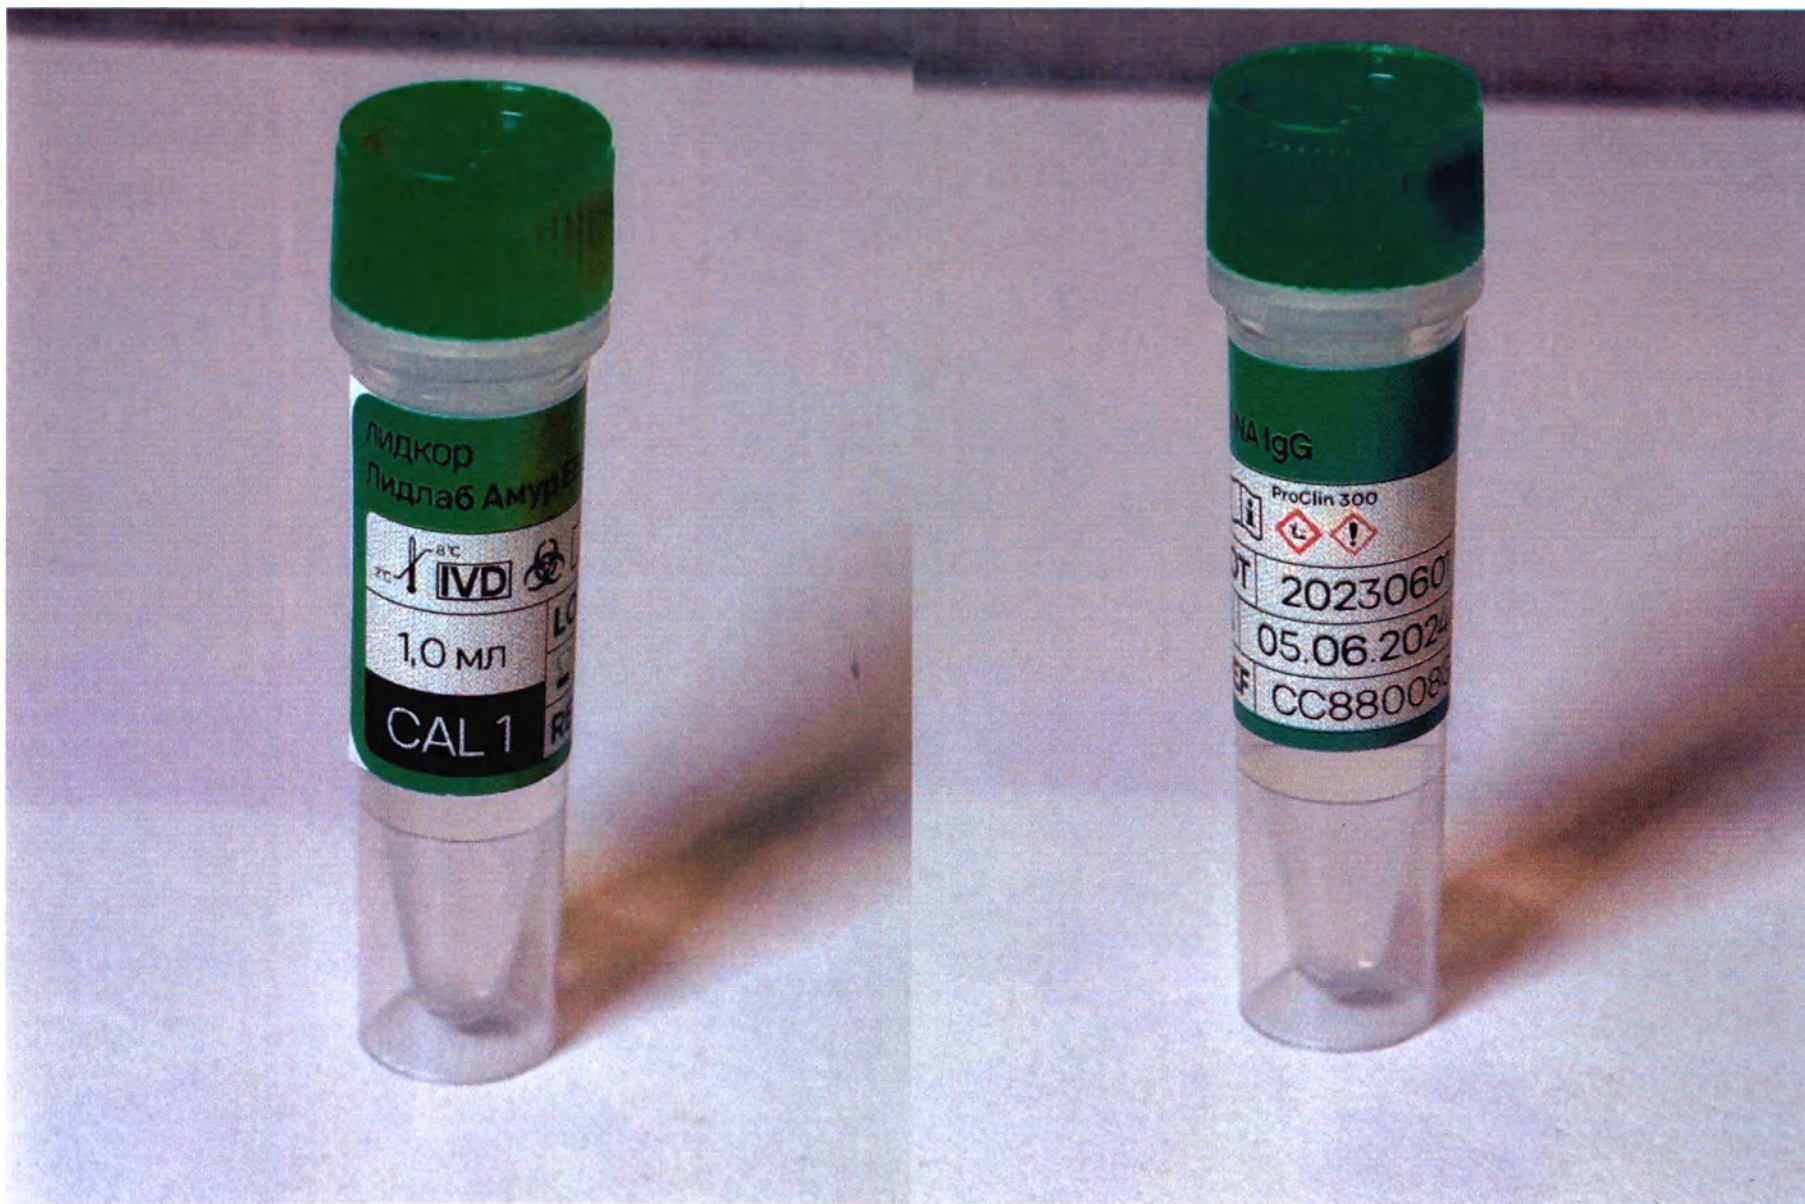

Калибратор 1 (CAL1)

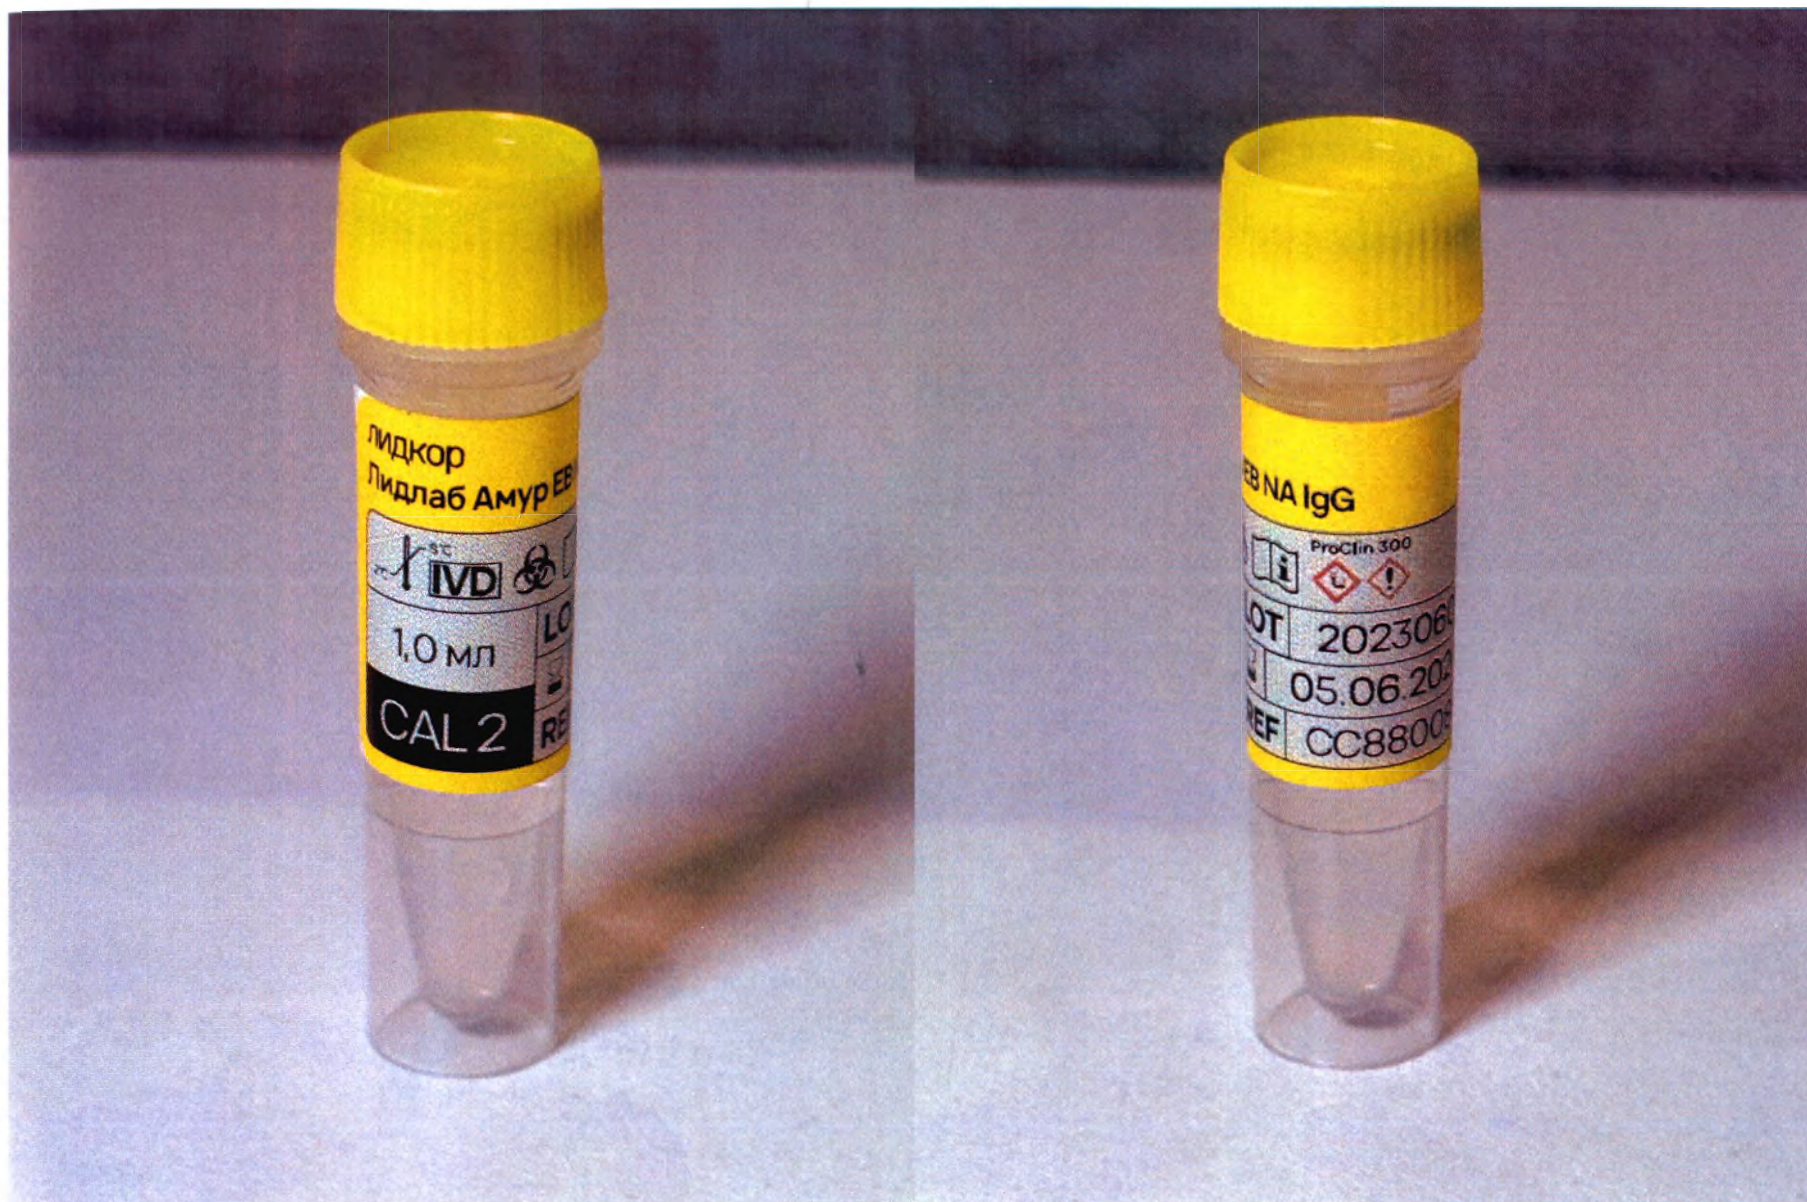

Калибратор 2 (CAL2)

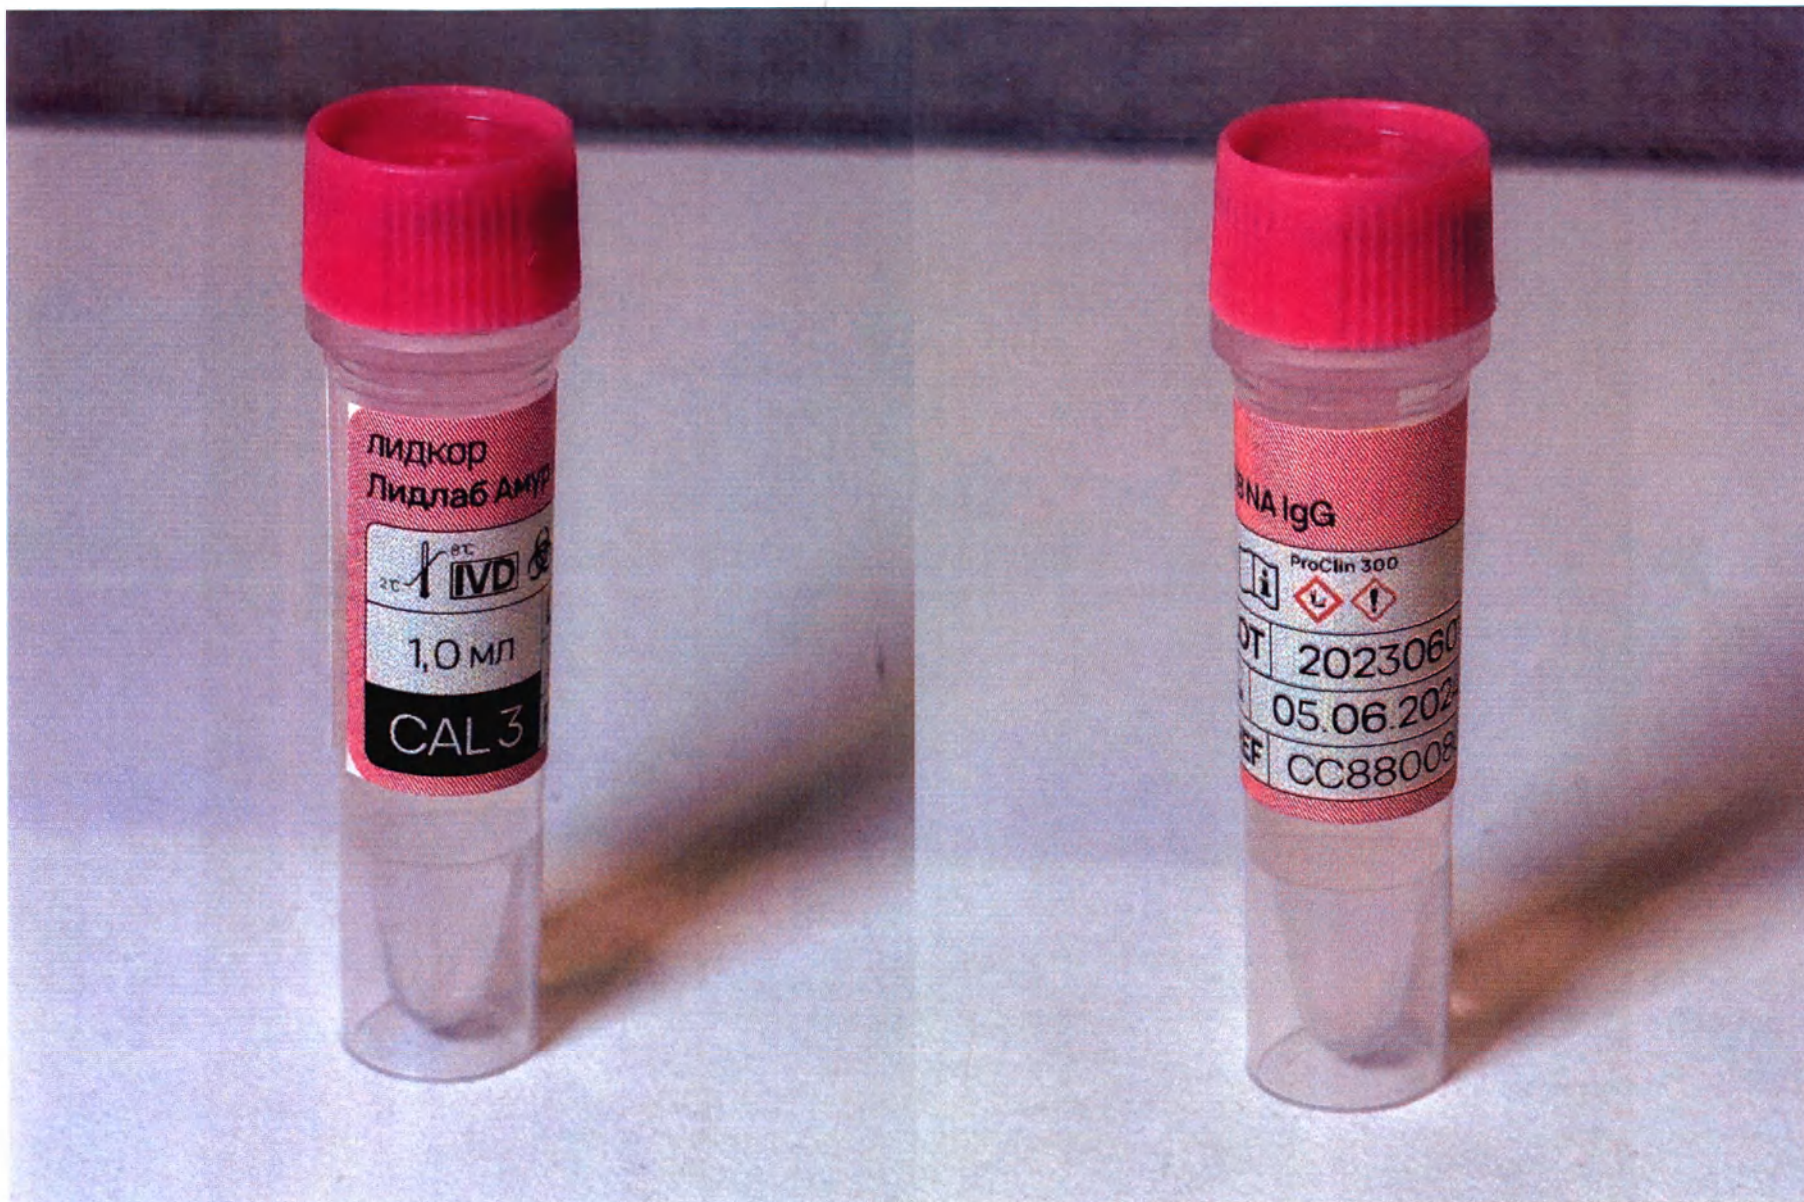

Калибратор 3 (CAL3)



Набор реагентов на 100 тестов

ООО «ЛИДКОР»

 Россия, 620102, Свердловская область, г. о. город Екатеринбург,
г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.
Телефон: 8 800 500 71 28. leadcore.ru

Набор реагентов «Лидлаб Амур EB NA IgG» для
количественного определения иммуноглобулинов
класса G (IgG) к ядерному антигену вируса
Эпштейна-Барр (EBV NA) в сыворотке и плазме крови
человека методом иммунохемилюминесцентного
анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом
иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для
диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-249-65614693-
2022. Набор реагентов на 100 тестов. Антитела к
ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

 Место производства:

- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская
область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область,
г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а

лидлаб

лидкор



**Лидлаб Амур
EB NA IgG**

Набор реагентов на 200 тестов

YHLO

Состав изделия

1. Картридж (в составе: реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; реагент меченых антител (R2), 6,5 мл/уп.; реагент для разведения образцов (R3), 6,5 мл/уп.) – 4 шт.
2. Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон – 2 шт.
3. Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон – 2 шт.
4. Калибратор 3 (CAL3), 1,0 мл/флакон – 2 шт.
5. Паронепроницаемые крышки – 18 шт.
6. Инструкция по применению – 1 шт.
7. Аналитический паспорт – 1 шт.



IVD Σ 1+200

LOT 20230601 05.06.2024 REF C88008G

05.06.2023

C88008G

Набор реагентов на 200 тестов


ООО «ЛИДКОР»

620102, Свердловская область, г. о. город Екатеринбург,
г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204
Телефон: 8 800 500 71 28. leadcore.ru

Набор реагентов «Лидлаб Амур Chlamydia рп. IgG» для количественного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к бактерии *Chlamydia pneumoniae* в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-253-65614693-2022. Набор реагентов на 200 тестов. Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

- Место производства:
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
 - ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а

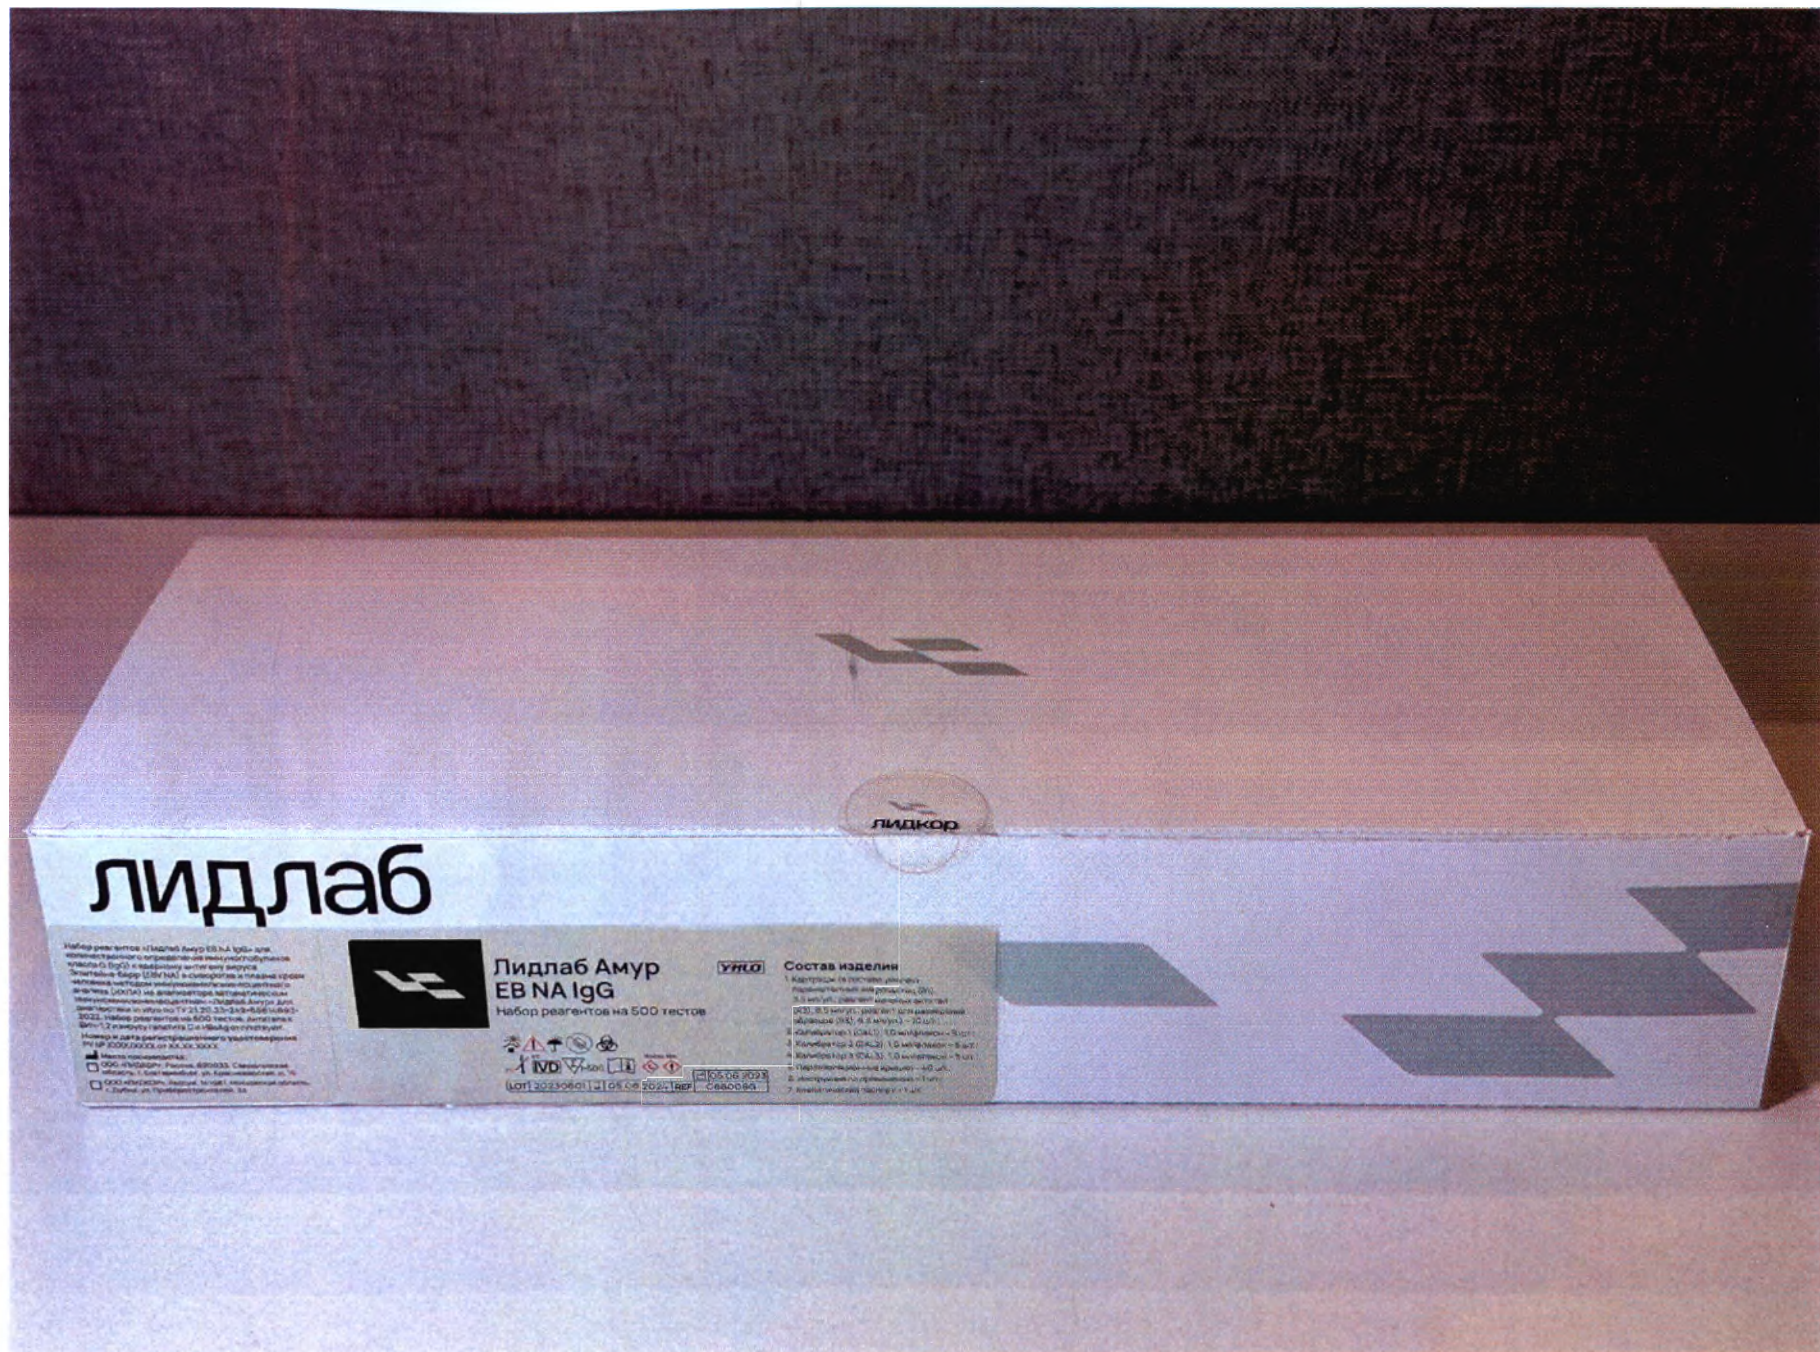

лидлаб

Набор реагентов «Лидлаб Амур EB NA IgG» для выявления антител к возбудителю инактивированной вакцины против гриппа (вакцина «Лидлаб Амур EB NA IgG») в лабораториях и клинических центрах. Набор реагентов «Лидлаб Амур EB NA IgG» для выявления антител к возбудителю инактивированной вакцины против гриппа (вакцина «Лидлаб Амур EB NA IgG») в лабораториях и клинических центрах. Набор реагентов «Лидлаб Амур EB NA IgG» для выявления антител к возбудителю инактивированной вакцины против гриппа (вакцина «Лидлаб Амур EB NA IgG») в лабораториях и клинических центрах.



**Лидлаб Амур
EB NA IgG**
Набор реагентов на 500 тестов

YHCO

Состав изделия

1. Матричные тест-системы (20 шт.)
2. Реагенты (20 шт.)
3. Реагенты (20 шт.)
4. Реагенты (20 шт.)
5. Реагенты (20 шт.)
6. Реагенты (20 шт.)
7. Реагенты (20 шт.)
8. Реагенты (20 шт.)
9. Реагенты (20 шт.)
10. Реагенты (20 шт.)

ИЗД. 01/2023
Lot: 2023-06-01
Срок годности: 12 мес.
Срок годности: 12 мес.

Набор реагентов на 500 тестов



Набор реагентов на 1000 тестов



Пароизоляционные крышки



Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

13 (Приказ) л.

Директор
ООО «ЛИДКОР»

029 /Е. Ю. Похгут/

