



**Фотографические изображения медицинского изделия
для диагностики *in vitro***

**«Кюветы одноразовые «LIAISON® XL Cuvettes» для анализатора
иммунохимического автоматического LIAISON XL»**

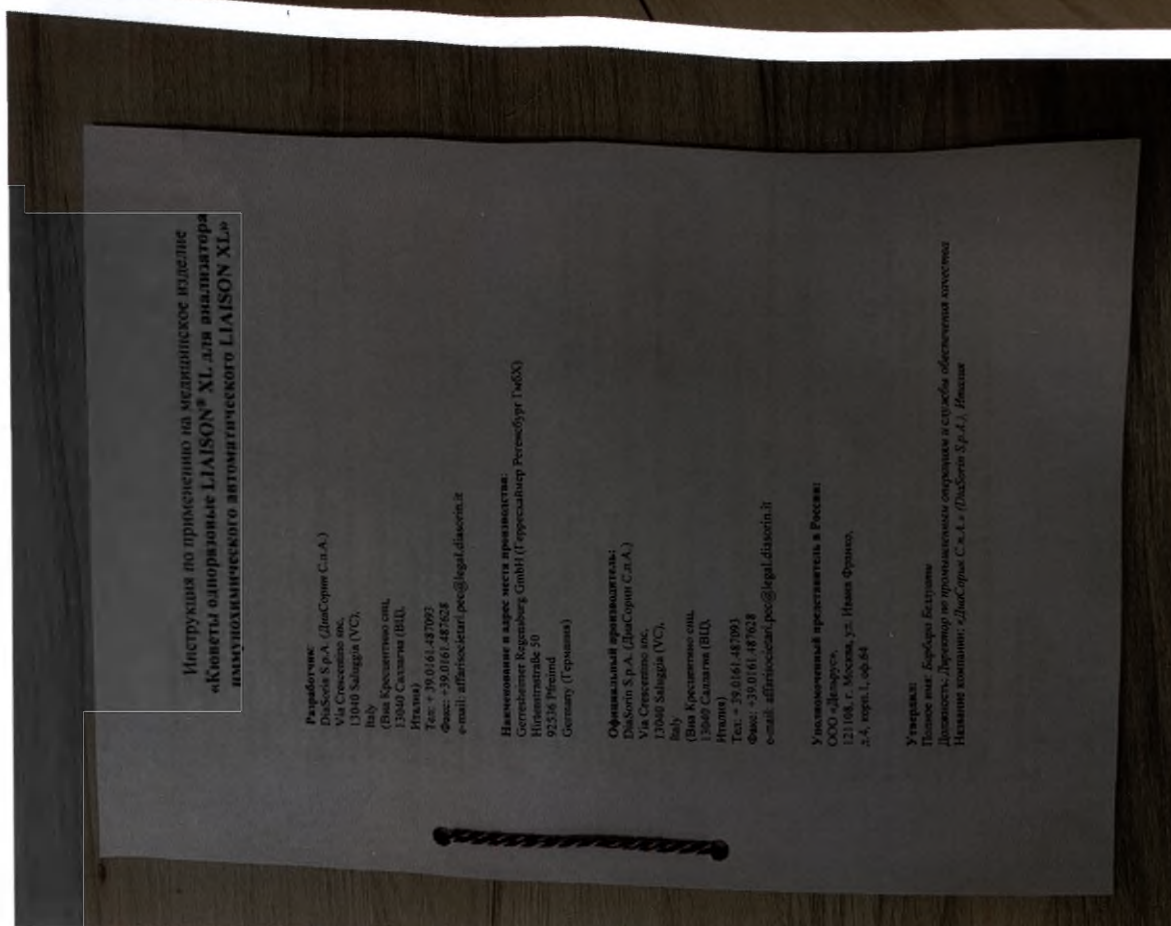

Комплект поставки медицинского изделия «Кюветы одноразовые «LIAISON® XL Cuvettes» для анализатора иммунохимического автоматического LIAISON XL», LOT 60101329323002, использовать до: 2024-03, REF X0016

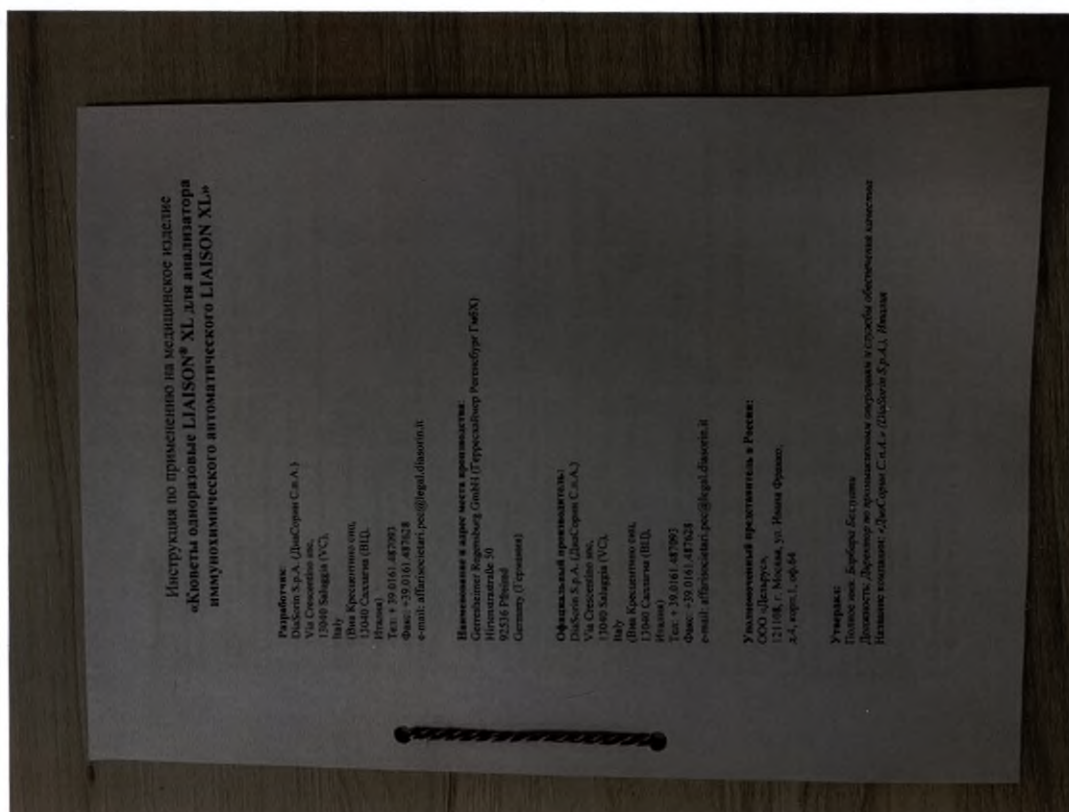


**Комплект поставки медицинского изделия «Кюветы одноразовые «LIAISON® XL Cuvettes» для
анализатора иммунохимического автоматического LIAISON XL», LOT 60101329308002,
использовать до: 2024-03-28, REF X0016**



Маркировка транспортной упаковки медицинского изделия «Кюветы одноразовые «LIAISON® XL Cuvettes» для анализатора иммунохимического автоматического LIAISON XL», LOT 60101329323002, использовать до: 2024-03, REF X0016




Маркировка транспортной упаковки медицинского изделия «Кюветы одноразовые «LIAISON® XL Cuvettes» для анализатора иммунохимического автоматического LIAISON XL», LOT 60101329308002, использовать до: 2024-03-28, REF X0016

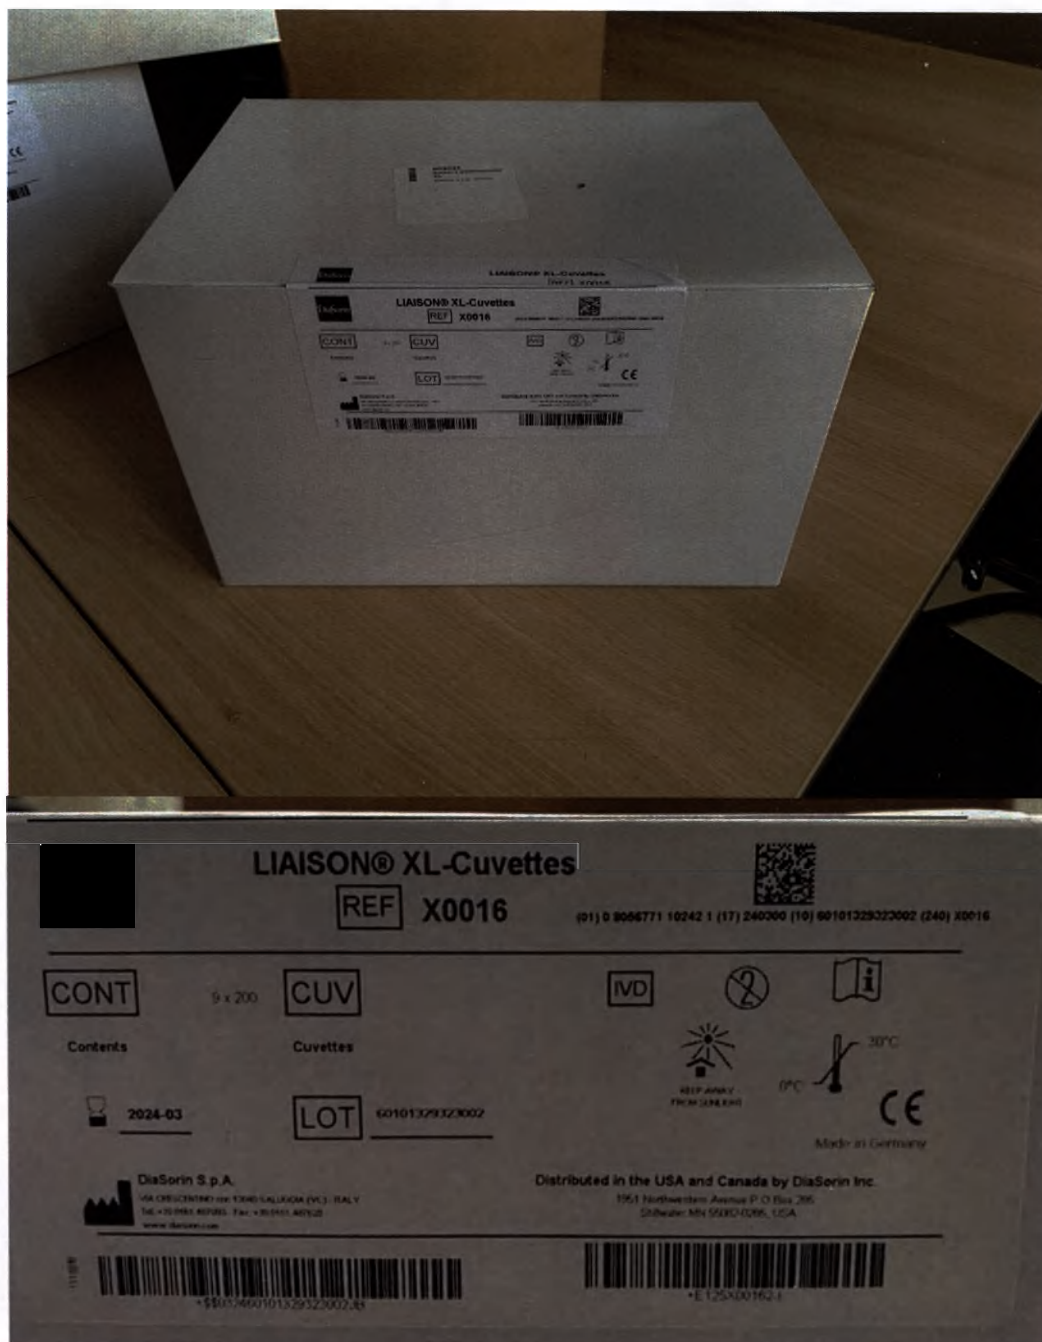



Вторичная упаковка и маркировка медицинского изделия «Кюветы одноразовые «LIAISON® XL Cuvettes» для анализатора иммунохимического автоматического LIAISON XL», LOT 60101329323002, использовать до: 2024-03, REF X0016




Вторичная упаковка и маркировка медицинского изделия «Кюветы одноразовые «LIAISON® XL Cuvettes» для анализатора иммунохимического автоматического LIAISON XL», LOT 60101329308002, использовать до: 2024-03-28, REF X0016

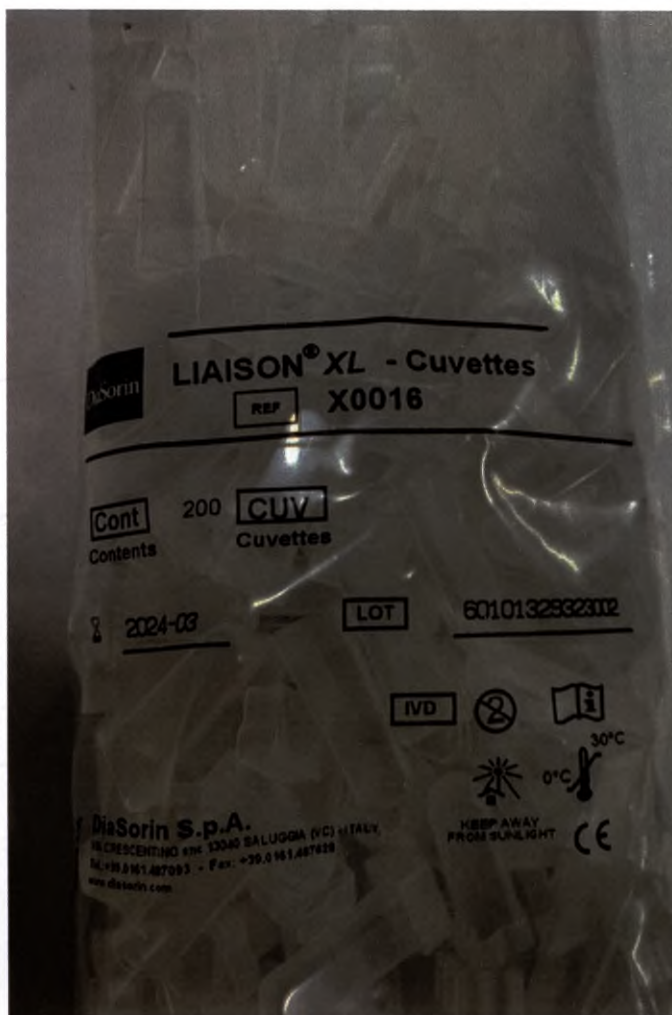

Первичная упаковка и маркировка медицинского изделия «Кюветы одноразовые «LIAISON® XL Cuvettes» для анализатора иммунохимического автоматического LIAISON XL», LOT 60101329323002, использовать до: 2024-03, REF X0016

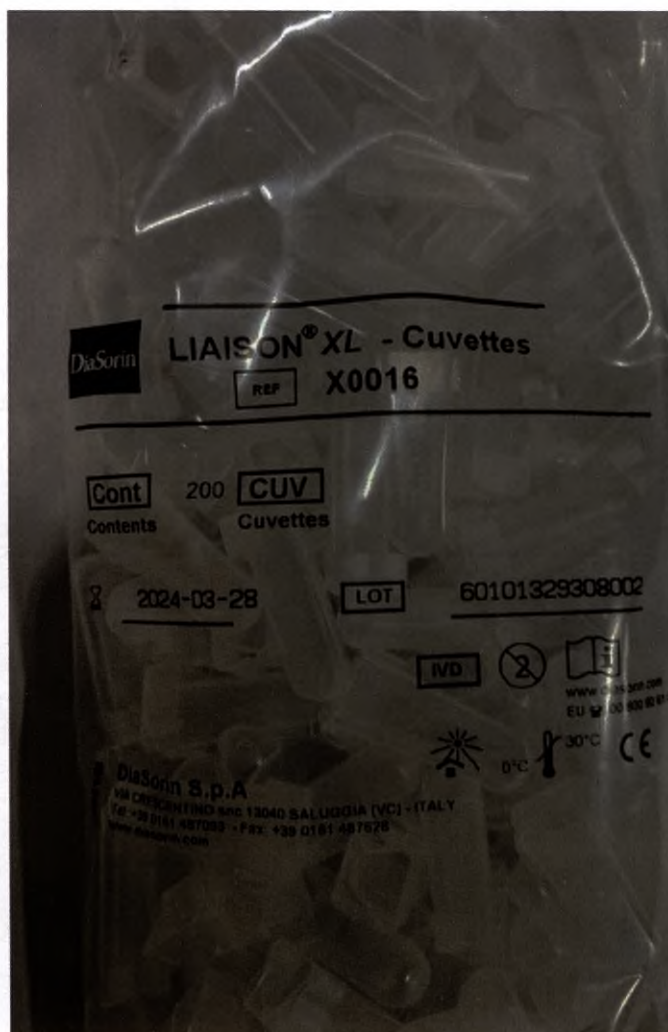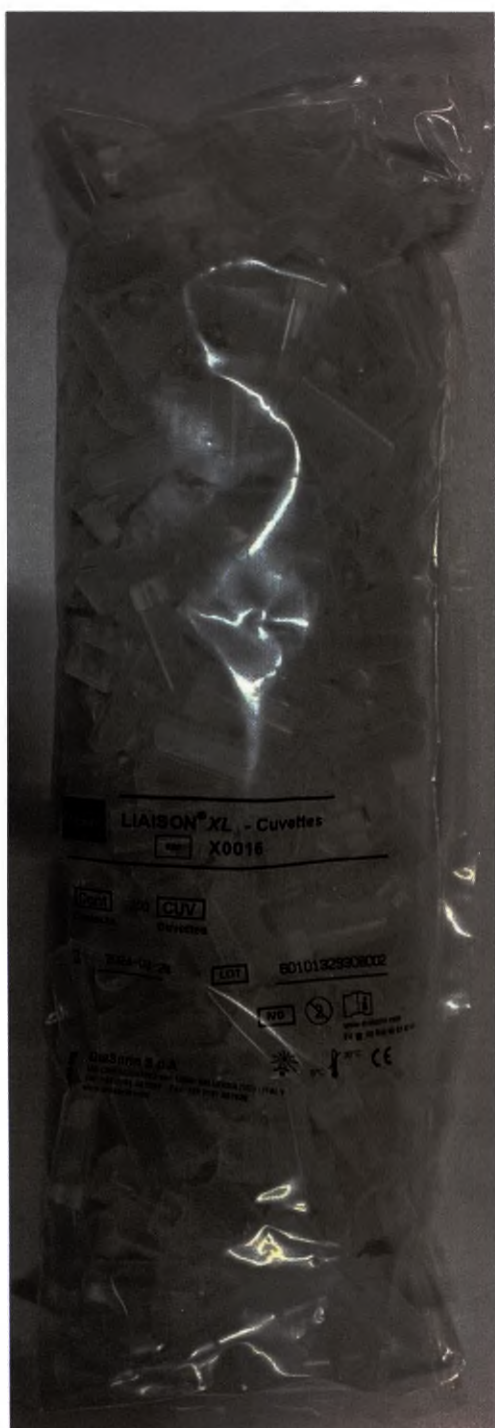

Первичная упаковка и маркировка медицинского изделия «Кюветы одноразовые «LIAISON® XL Cuvettes» для анализатора иммунохимического автоматического LIAISON XL», LOT 60101329308002, использовать

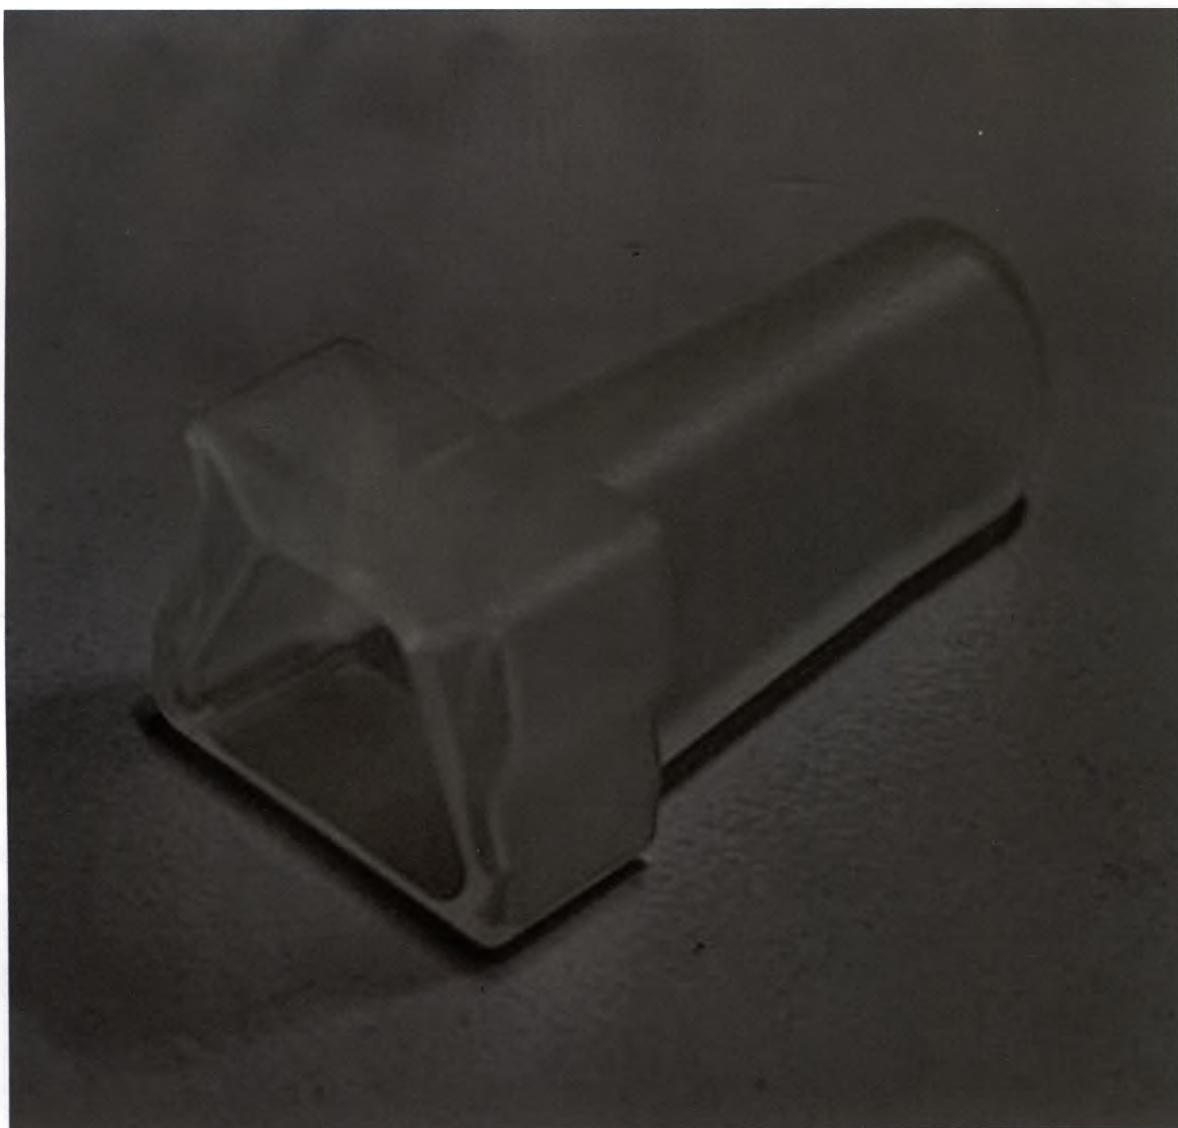

Общий вид медицинского изделия «Кюветы одноразовые «LIAISON® XL Cuvettes» для анализатора иммунохимического автоматического LIAISON XL»

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью
9 (двух) л.

Генеральный директор
ООО «Дельрус»

И.В.Федотов

ПО ДОВЕРЕННОСТИ
№ 638 от 25.10.2021
РУКОВОДИТЕЛЬ ОРМ
М В КУЛЯС



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Дельрус»

И.В. Федотов

ПО ДОВЕРЕННОСТИ № 638 ОТ 25.10.2021
РУКОВОДИТЕЛЬ ОРМИ
М В КУЛЯС

«15» декабря 2021 г.

**Макеты этикеток
на медицинское изделие для диагностики in vitro**

**«Кюветы одноразовые «LIAISON® XL Cuvettes» для анализатора
иммунохимического автоматического LIAISON XL»**

Макет этикетки (потребительская упаковка)

**Наконечники одноразовые «LIAISON® Disposable Tips» для
анализатора иммунохимического автоматического LIAISON XL**

REF X0055

Номенклатурный номер: xxxx

Номер партии, условия хранения, срок годности и др. символы указаны на оригинальной упаковке.

Производитель:

DiaSorin S.p.A., Италия

Via Crescentino snc,

13040 Saluggia (VC), Italy

Место производства:

Eppendorf Polymere GmbH, Германия

Sebenter Weg 39,

23758 Oldenburg i. H.,

Germany

**Уполномоченный представитель
производителя:**

ООО «Дельрус»

121108, г. Москва, ул. Ивана

Франко, д.4, корп.1, оф.64

Тел.: +8 (495) 120-77-00

e-mail: delrus@delrus.ru

Рег.уд.: <указывается дата и номер регистрационного удостоверения>

Макет этикетки (транспортная упаковка)

**Кюветы одноразовые «LIAISON® XL Cuvettes» для анализатора
иммунохимического автоматического LIAISON XL**

REF X0016

Номенклатурный номер: xxxx

Номер партии, условия хранения, срок годности и др. символы указаны на оригинальной упаковке.

Производитель:

DiaSorin S.p.A., Италия

Via Crescentino snc,

13040 Saluggia (VC), Italy

Место производства:

Gerresheimer Regensburg GmbH, Германия

Hirtenstraße 50

92536 Pfreimd

Germany

**Уполномоченный представитель
производителя:**

ООО «Дельрус»

121108, г. Москва, ул. Ивана

Франко, д.4, корп.1, оф.64

Тел.: +8 (495) 120-77-00

e-mail: delrus@delrus.ru

Вес нетто: <Фактический вес указывается в зависимости от количества упаковок внутри транспортной упаковки>

Вес брутто: <Фактический вес указывается в зависимости от количества упаковок внутри транспортной упаковки>

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью
2 (два) л.

Генеральный директор
ООО «Дельрус» И.В.Федотов

ПО ДОВЕРЕННОСТИ
№ 638 от 23.10.2021
РУКОВОДИТЕЛЕМ
М В КУЛЯС

