

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "ЛИДКОР"



Е.Ю. Гохгут

«05» июня 2023 г.

МАКЕТ МАРКИРОВКИ

«Набор реагентов «Лидлаб Амур EB VCA IgG» для количественного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (EBV VCA) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-247-65614693-2022»

2023

Набор реагентов «Лидлаб Амур EB VCA IgG» для количественного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (EBV VCA) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-247-65614693-2022. Набор реагентов на 100 тестов. Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

 Место производства:

- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а

Набор реагентов «Лидлаб Амур EB VCA IgG» для количественного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (EBV VCA) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-247-65614693-2022. Набор реагентов на 200 тестов. Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

 Место производства:


- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур EB VCA IgG

Набор реагентов на 100 тестов

YHLO



LOT 20230601 05.06.2024 REF C88006G

Состав изделия


1. Картридж (в составе: реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; реагент меченых антител (R2), 6,5 мл/уп.; реагент для разведения образцов (R3), 6,5 мл/уп.) – 2 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон – 1 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон – 1 шт.;
4. Калибратор 3 (CAL3), 1,0 мл/флакон – 1 шт.;
5. Пароизоляционные крышки – 8 шт.;
6. Инструкция по применению – 1 шт.;
7. Аналитический паспорт – 1 шт.



Лидлаб Амур EB VCA IgG

Набор реагентов на 200 тестов

YHLO



LOT 20230601 05.06.2024 REF C88006G

Состав изделия

1. Картридж (в составе: реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; реагент меченых антител (R2), 6,5 мл/уп.; реагент для разведения образцов (R3), 6,5 мл/уп.) – 4 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон – 2 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон – 2 шт.;
4. Калибратор 3 (CAL3), 1,0 мл/флакон – 2 шт.;
5. Пароизоляционные крышки – 16 шт.;
6. Инструкция по применению – 1 шт.;
7. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур EB VCA IgG» для количественного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (EBV VCA) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-247-65614693-2022. Набор реагентов на 500 тестов. Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:

☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15

☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а


Набор реагентов «Лидлаб Амур EB VCA IgG» для количественного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (EBV VCA) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-247-65614693-2022. Набор реагентов на 1000 тестов. Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:


☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15

☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур EB VCA IgG

Набор реагентов на 500 тестов



05.06.2023

LOT 20230601 05.06.2024 REF C88006G

YHLO


Состав изделия

1. Картридж (в составе: реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; реагент меченых антител (R2), 6,5 мл/уп.; реагент для разведения образцов (R3), 6,5 мл/уп.) – 10 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон – 5 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон – 5 шт.;
4. Калибратор 3 (CAL3), 1,0 мл/флакон – 5 шт.;
5. Пароизоляционные крышки – 40 шт.;
6. Инструкция по применению – 1 шт.;
7. Аналитический паспорт – 1 шт.



Лидлаб Амур EB VCA IgG

Набор реагентов на 1000 тестов



05.06.2023

LOT 20230601 05.06.2024 REF C88006G

YHLO

Состав изделия


1. Картридж (в составе: реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; реагент меченых антител (R2), 6,5 мл/уп.; реагент для разведения образцов (R3), 6,5 мл/уп.) – 20 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон – 10 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон – 10 шт.;
4. Калибратор 3 (CAL3), 1,0 мл/флакон – 10 шт.;
5. Пароизоляционные крышки – 80 шт.;
6. Инструкция по применению – 1 шт.;
7. Аналитический паспорт – 1 шт.

лидкор **YNLO**

Лидлаб Амур
EB VCA IgG



3,5мл	6,5мл	6,5мл
R 1	R 2	R 3

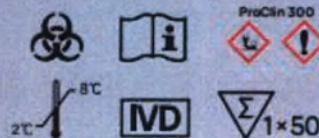

LOT	20230601	05.06.2024
-----	----------	------------

лидкор
Лидлаб Амур EB VCA IgG

1,0 мл	LOT	20230601
CAL 1	REF	C88006G

лидкор
Лидлаб Амур EB VCA IgG

1,0 мл	LOT	20230601
CAL 2	REF	C88006G

лидкор
Лидлаб Амур EB VCA IgG

   		
1,0 мл	LOT	20230601
CAL 3		05.06.2024
	REF	C88006G




Лидлаб Амур EB VCA IgG




LOT 20230601 EXP 05.06.2024

лидкор
Лидлаб Амур
EB VCA IgG

Пароизоляционные крышки – 4 шт.		
LOT	20230601	 
	05.06.2024	
REF	C88006G	

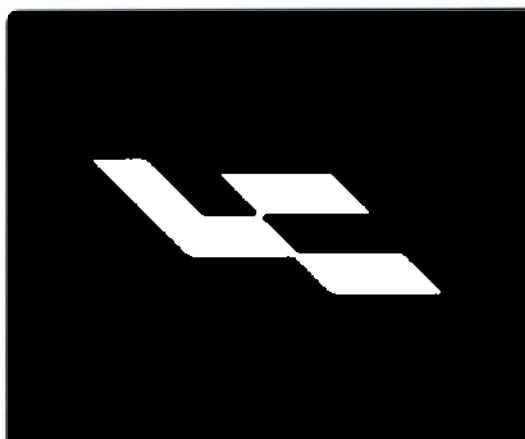


Набор реагентов «Лидлаб Амур EB VCA IgG»
для количественного определения иммуноглобу-
линов класса G (IgG) к капсидному антигену ви-
руса Эпштейна-Барр (EBV VCA) в сыворотке и
плазме крови человека методом иммунохемилю-
минесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе
автоматическом иммунохемилюминесцентном
«Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ
21.20.23-247-65614693-2022

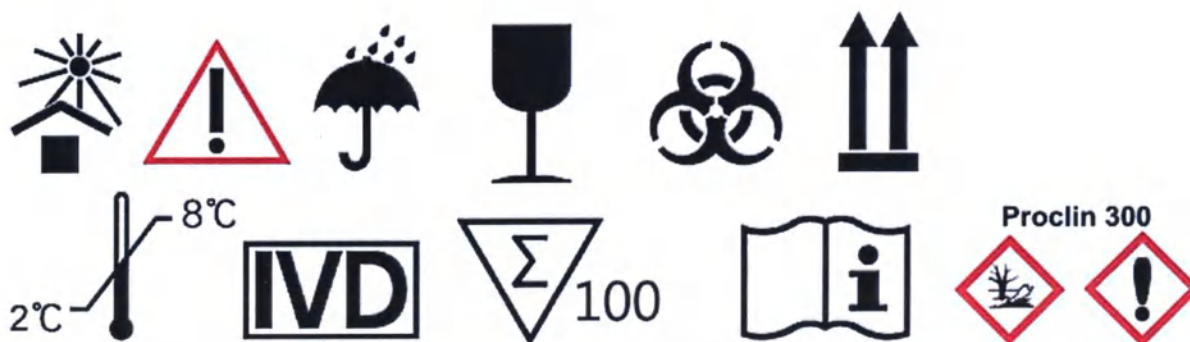


Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.					05.06.2023
LOT	20230601		05.06.2024	REF	C88006G	

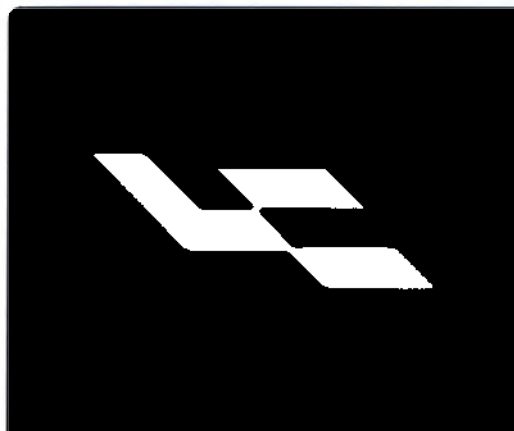


Набор реагентов «Лидлаб Амур EB VCA IgG»
для количественного определения иммуноглобу-
линов класса G (IgG) к капсидному антигену ви-
руса Эпштейна-Барр (EBV VCA) в сыворотке и
плазме крови человека методом иммунохемилю-
минесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе
автоматическом иммунохемилюминесцентном
«Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ
21.20.23-247-65614693-2022

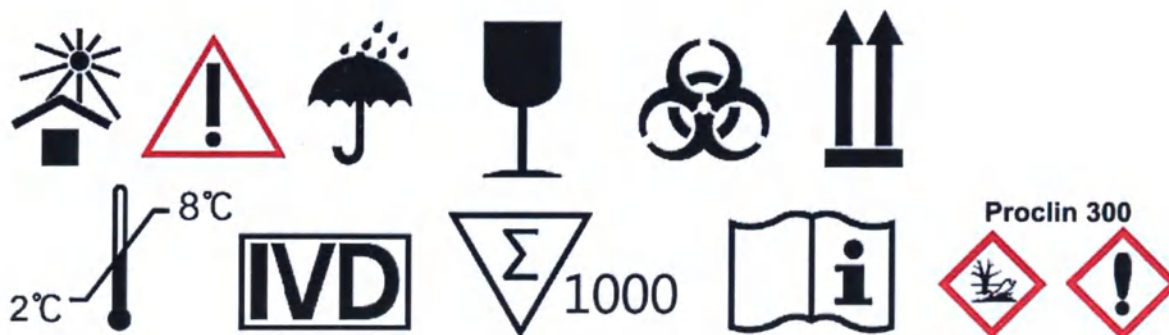

Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.					05.06.2023
LOT	20230601		05.06.2024	REF	C88006G	

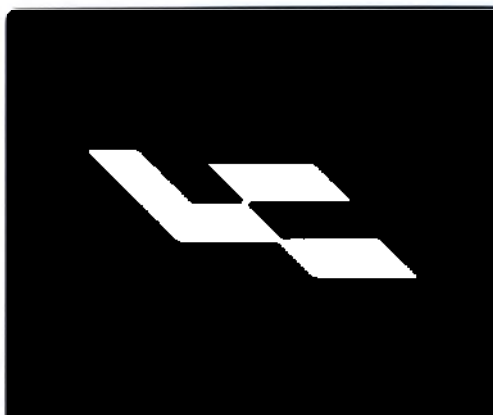


Набор реагентов «Лидлаб Амур EB VCA IgG»
для количественного определения иммуноглобу-
линов класса G (IgG) к капсидному антигену ви-
руса Эпштейна-Барр (EBV VCA) в сыворотке и
плазме крови человека методом иммунохемилю-
минесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе
автоматическом иммунохемилюминесцентном
«Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ
21.20.23-247-65614693-2022



Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.					05.06.2023
LOT	20230601		05.06.2024	REF	C88006G	

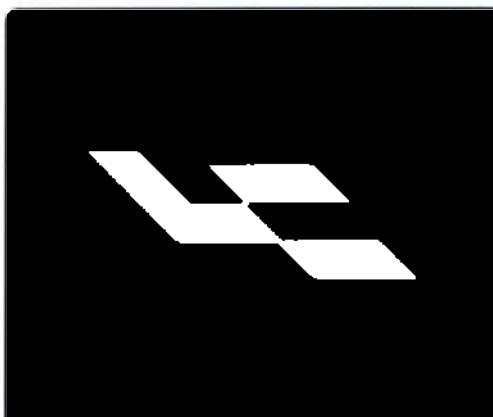


Набор реагентов «Лидлаб Амур EB VCA IgG»
для количественного определения иммуноглобу-
линов класса G (IgG) к капсидному антигену ви-
руса Эпштейна-Барр (EBV VCA) в сыворотке и
плазме крови человека методом иммунохемилю-
минесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе
автоматическом иммунохемилюминесцентном
«Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ
21.20.23-247-65614693-2022



Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.					05.06.2023
LOT	20230601		05.06.2024	REF	C88006G	

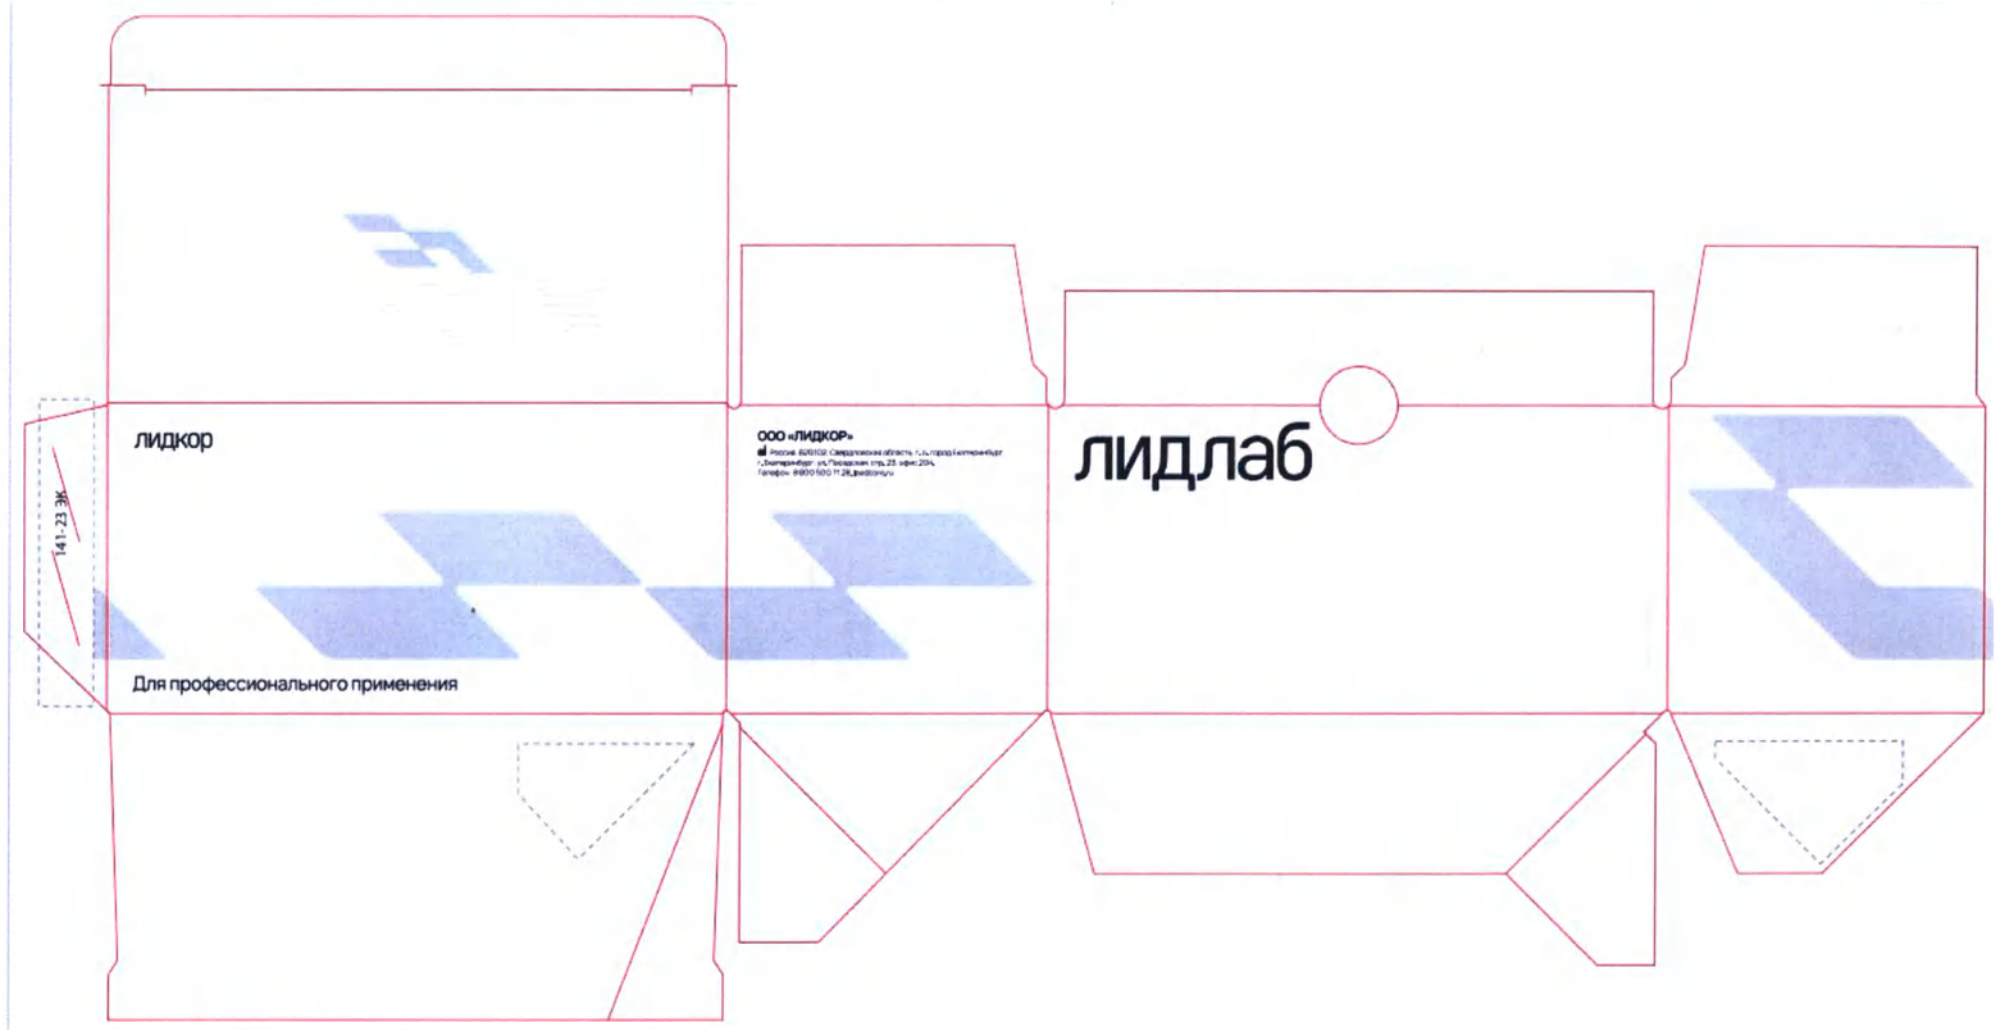

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
11 (двенадцать) л.

Директор
ООО «ЛИДКОР»

_____/Е. Ю. Гохгут/



УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "ЛИДКОР"

Е.Ю. Гохгут

«05» июня 2023 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ


«Набор реагентов «Лидлаб Амур EB VCA IgG» для количественного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (EBV VCA) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-247-65614693-2022»

2023


Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; Реагент меченых антител (R2), 6,5 мл/уп.; Реагент для разведения образцов (R3), 6,5 мл/уп.)




Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон

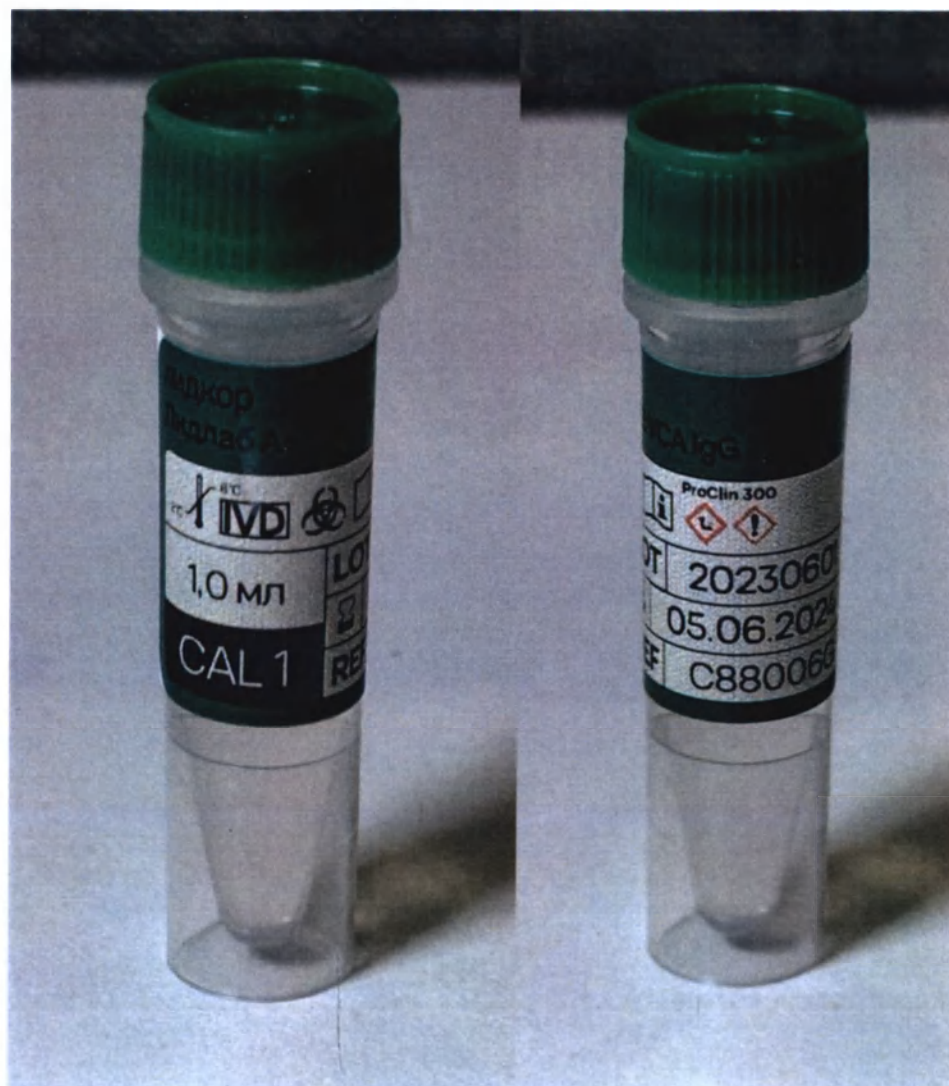


Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон

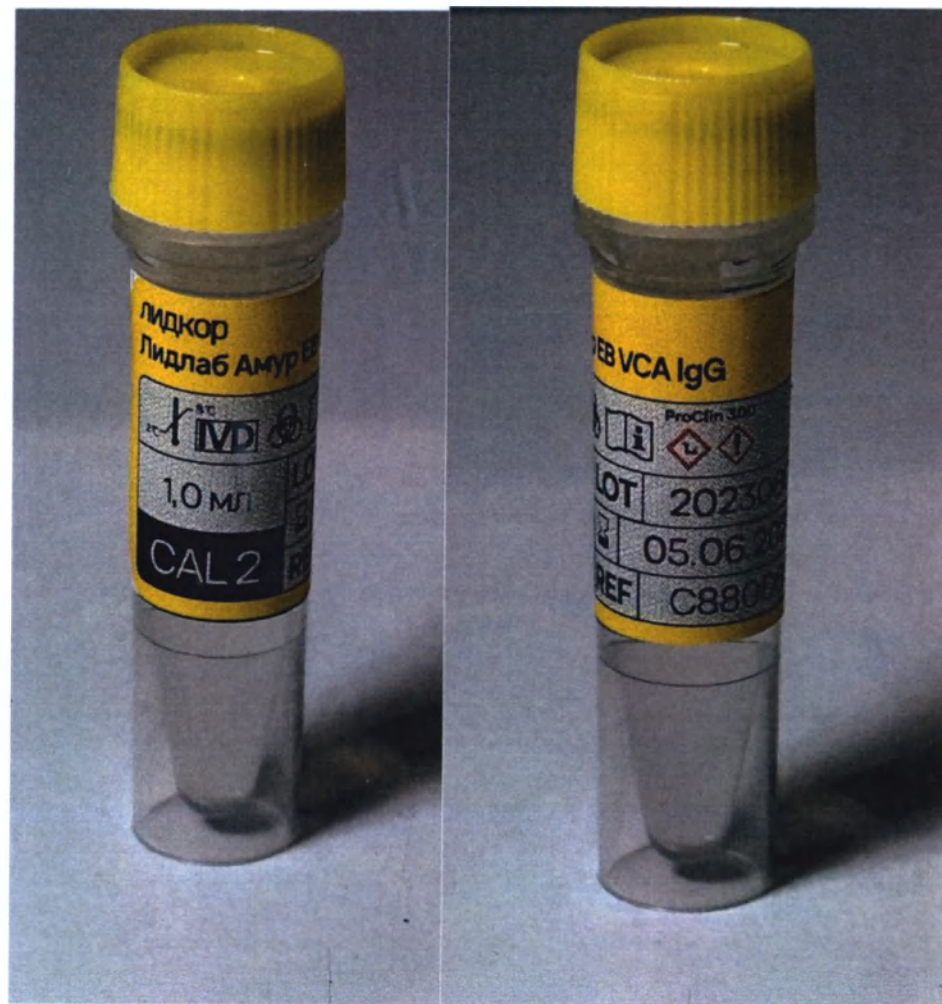

Калибратор 3 (CAL3), 1,0 мл/флакон

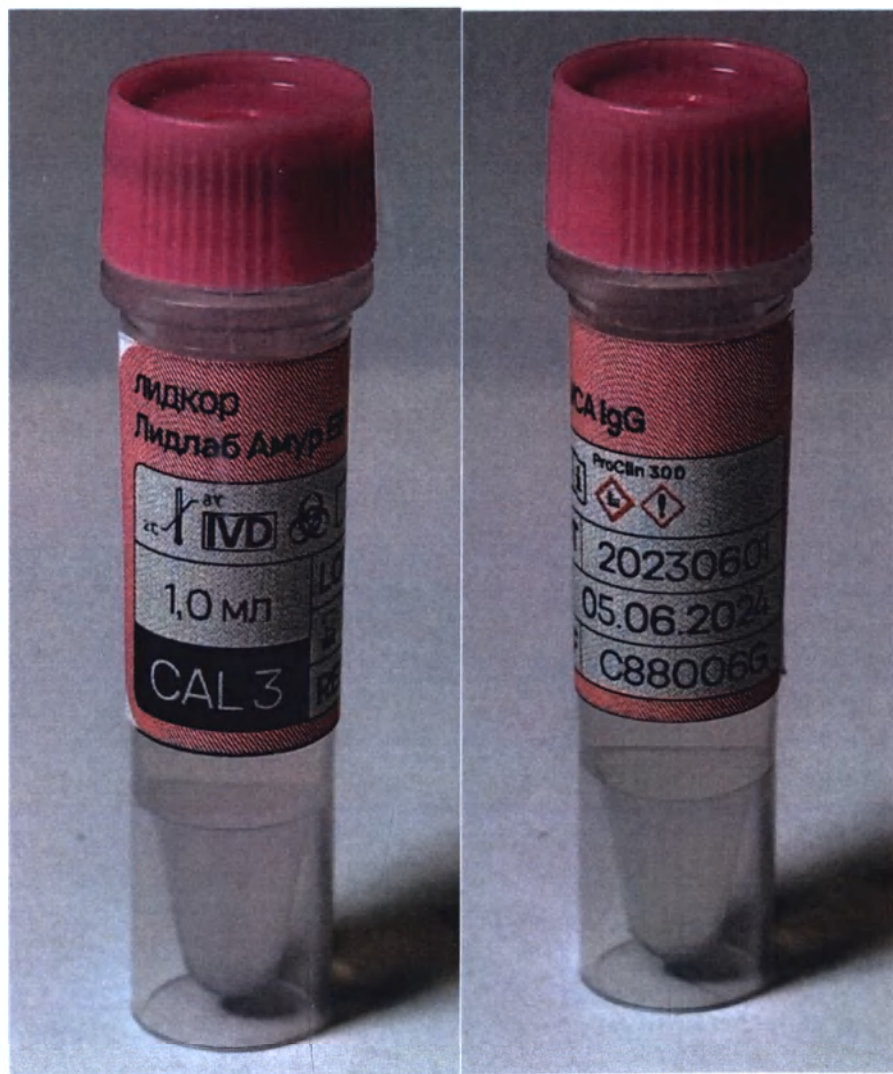

Пароизоляционные крышки

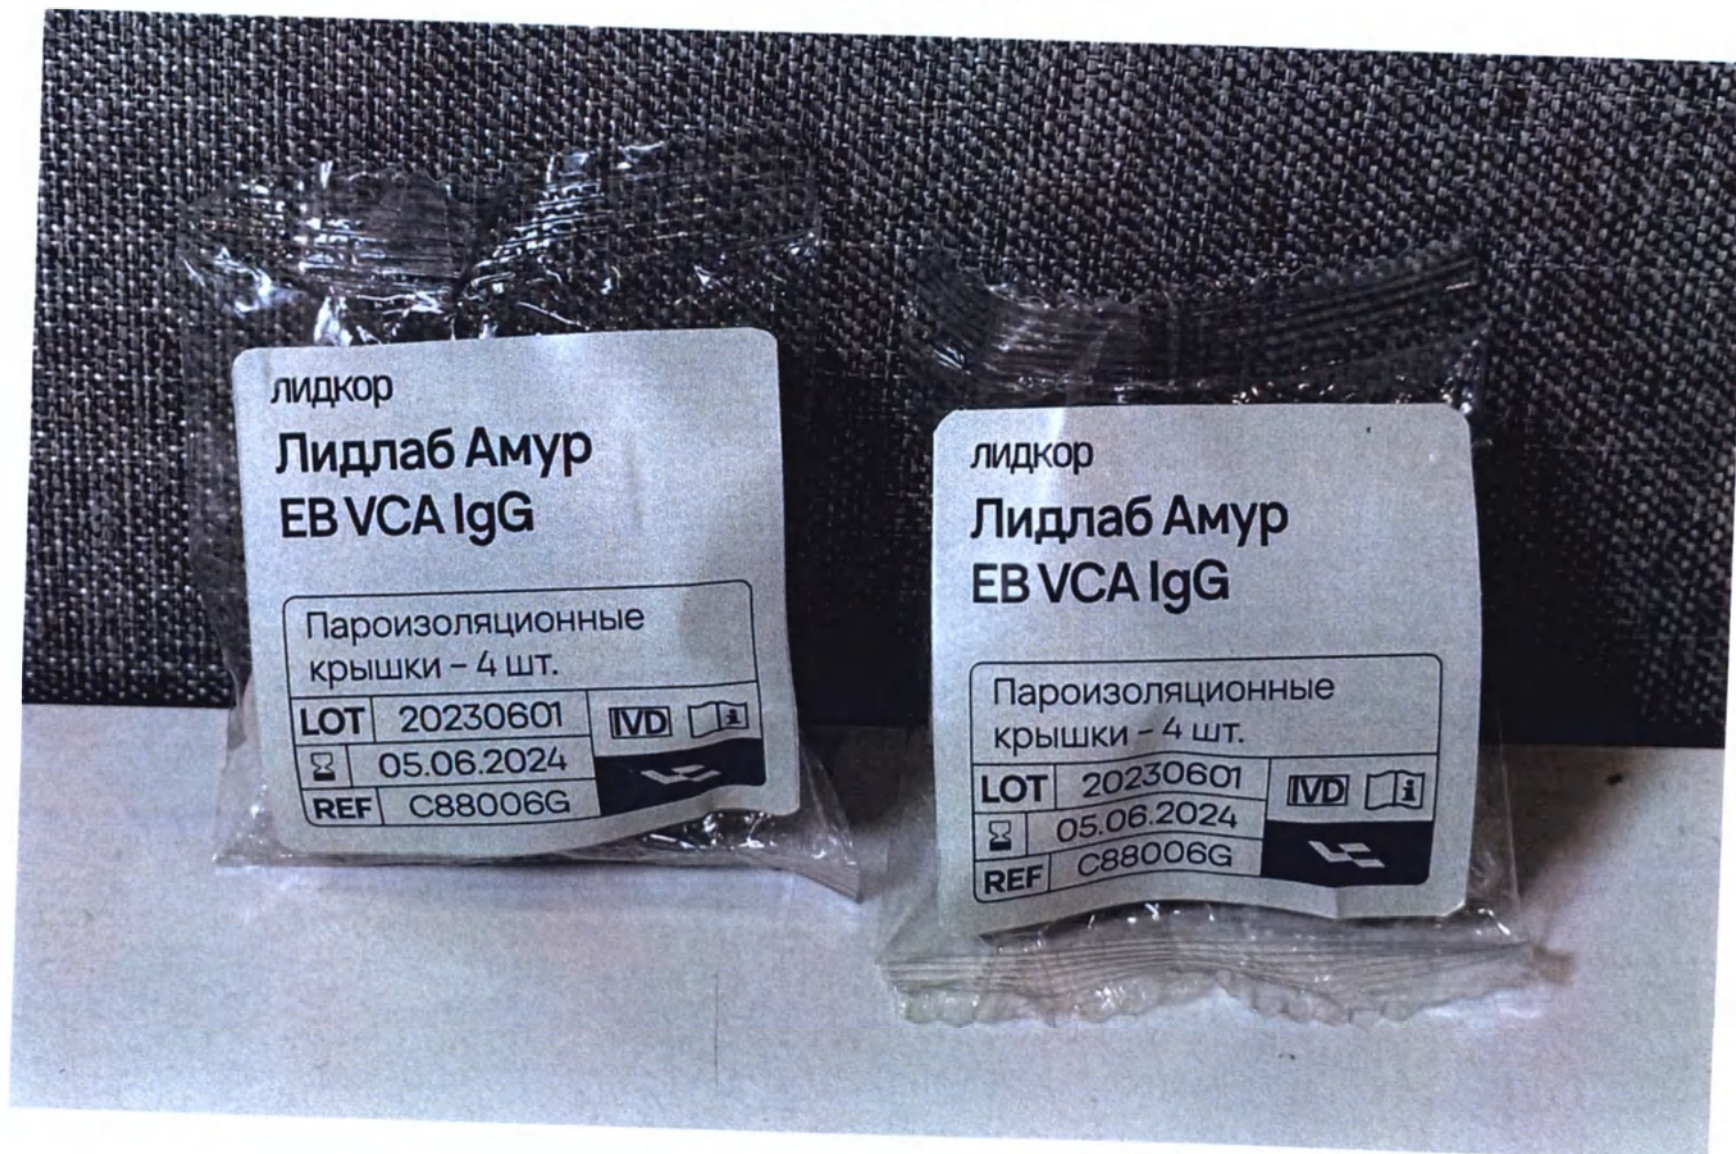


Потребительская упаковка Набор реагентов на 100 тестов



Потребительская упаковка Набор реагентов на 100 тестов. Вид сбоку




Потребительская упаковка Набор реагентов на 100 тестов. Вид сзади

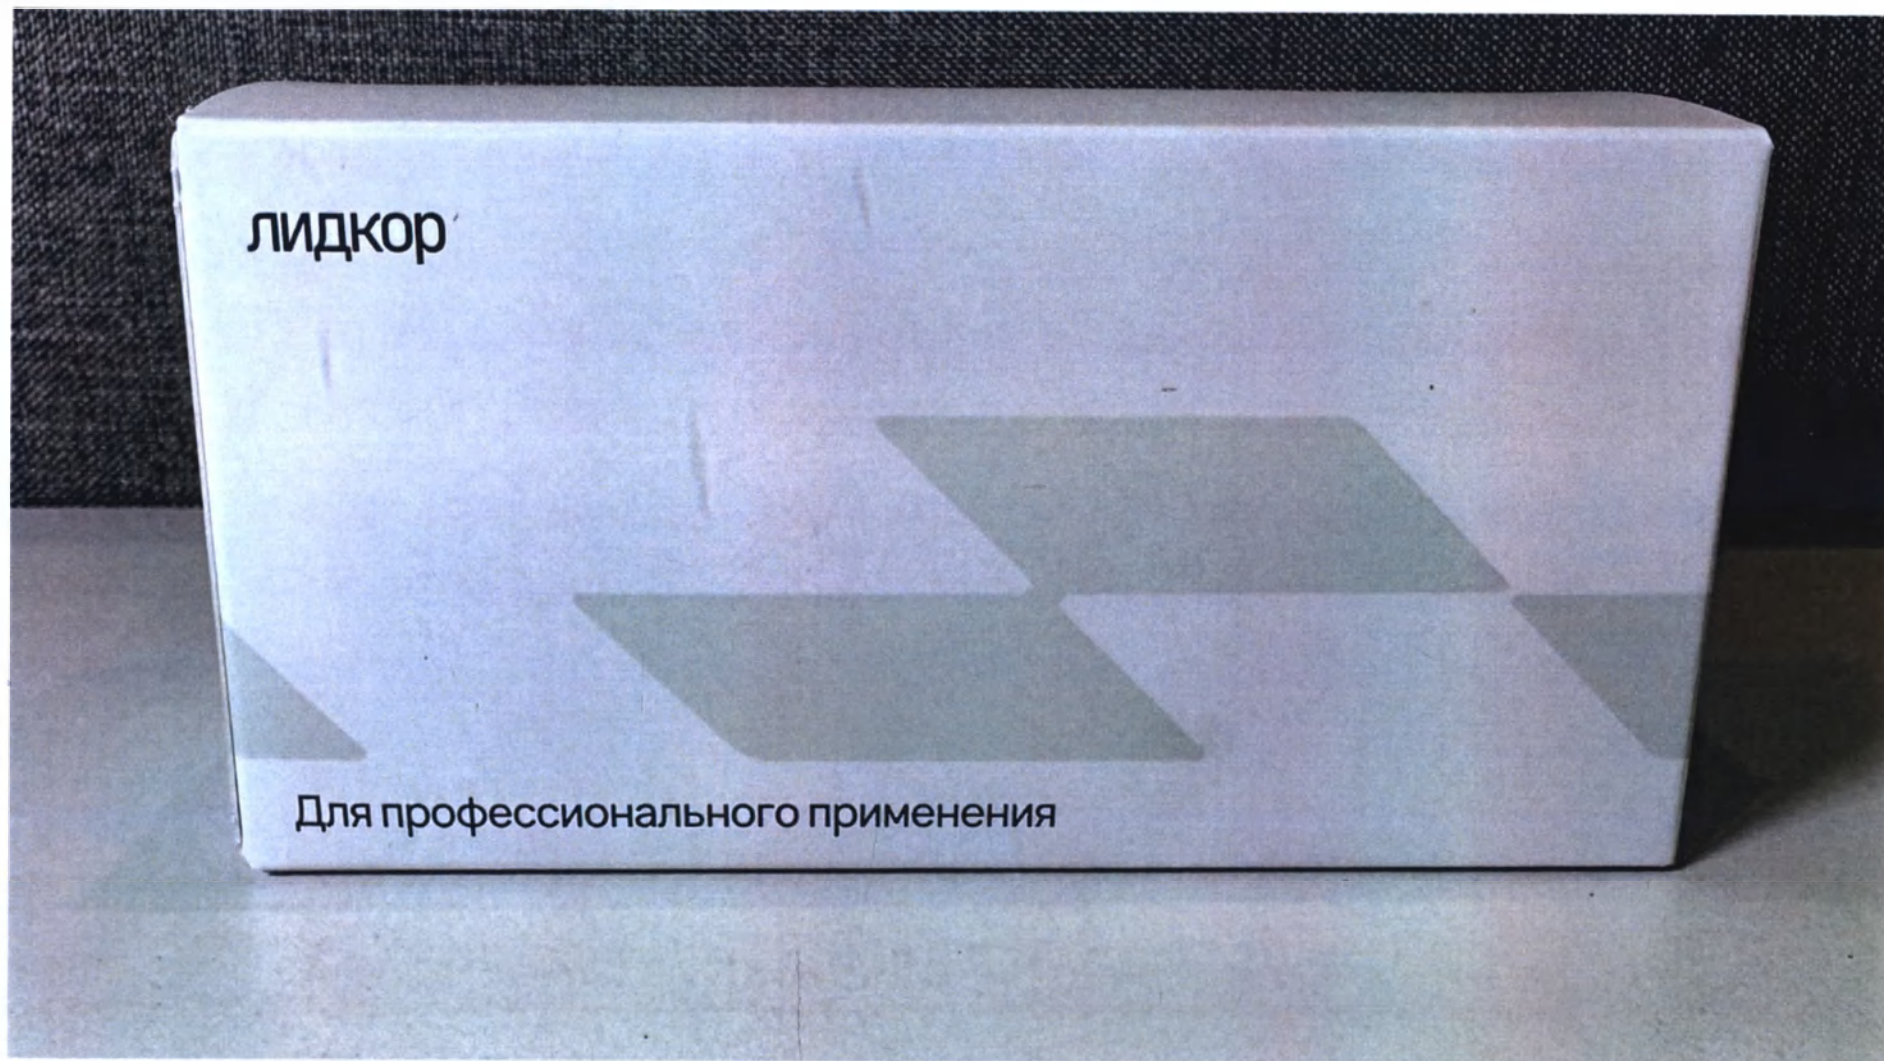

Потребительская упаковка Набор реагентов на 200 тестов




Потребительская упаковка Набор реагентов на 200 тестов. Вид сбоку

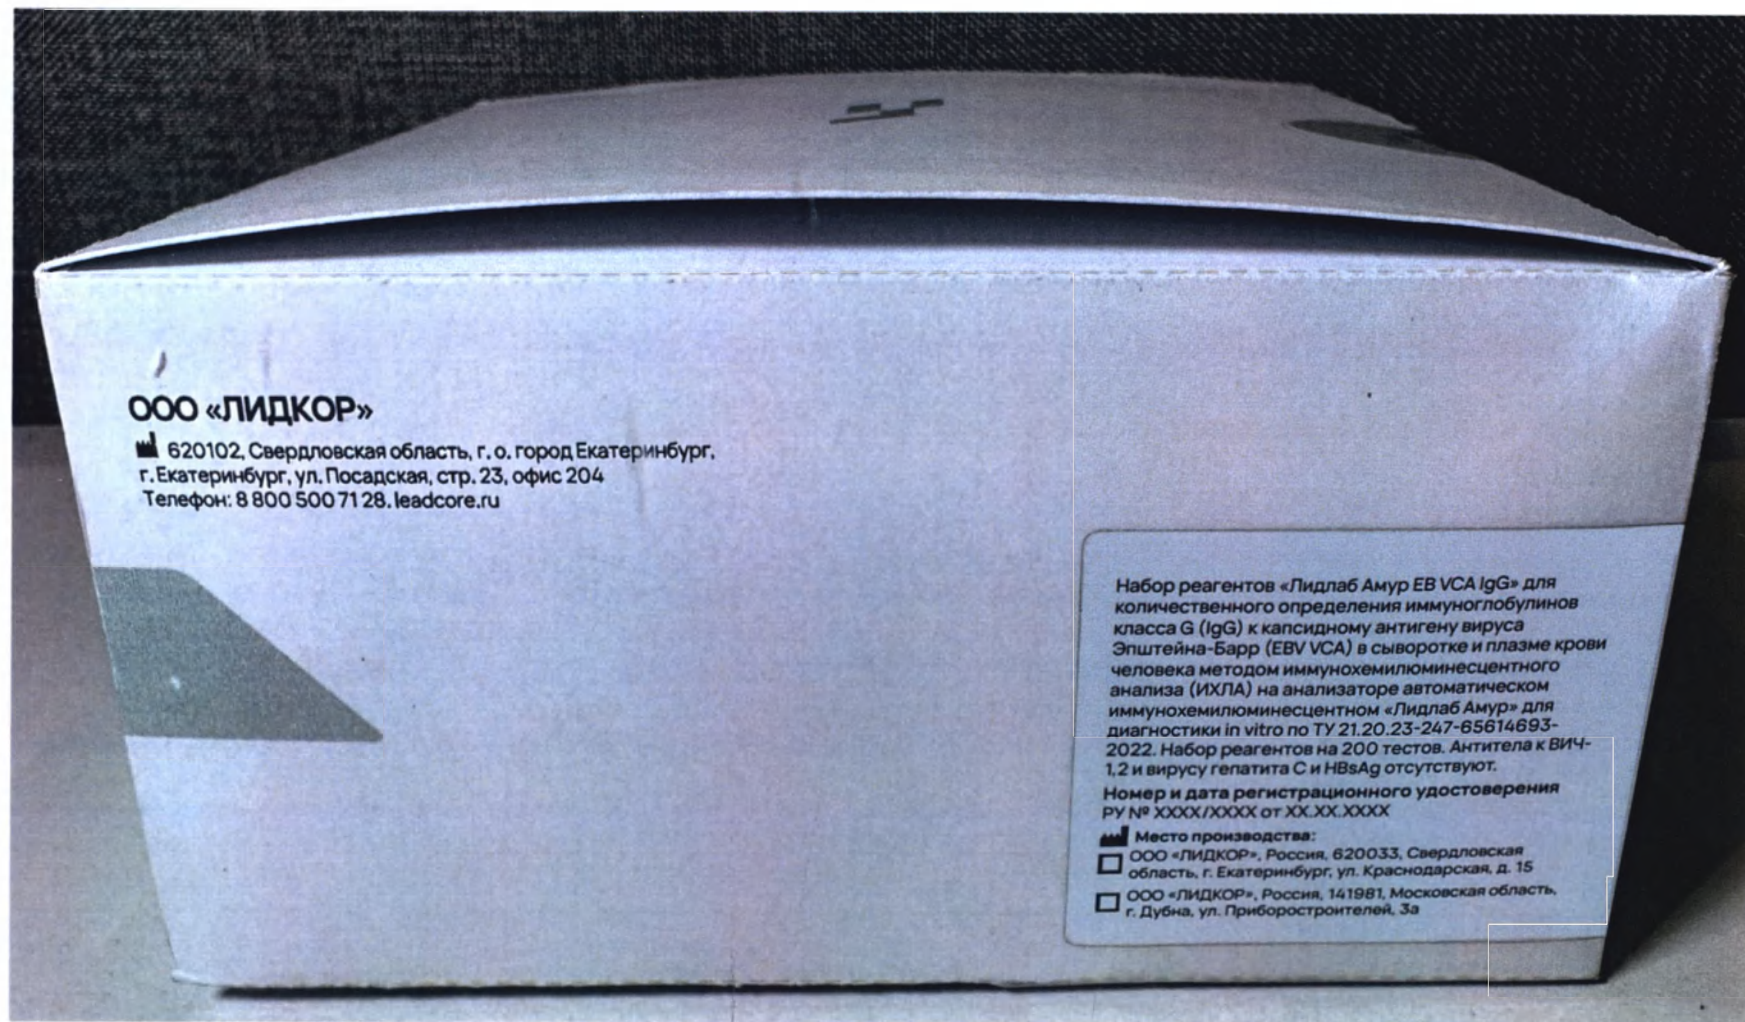


Потребительская упаковка Набор реагентов на 200 тестов. Вид сзади




Потребительская упаковка Набор реагентов на 500 тестов

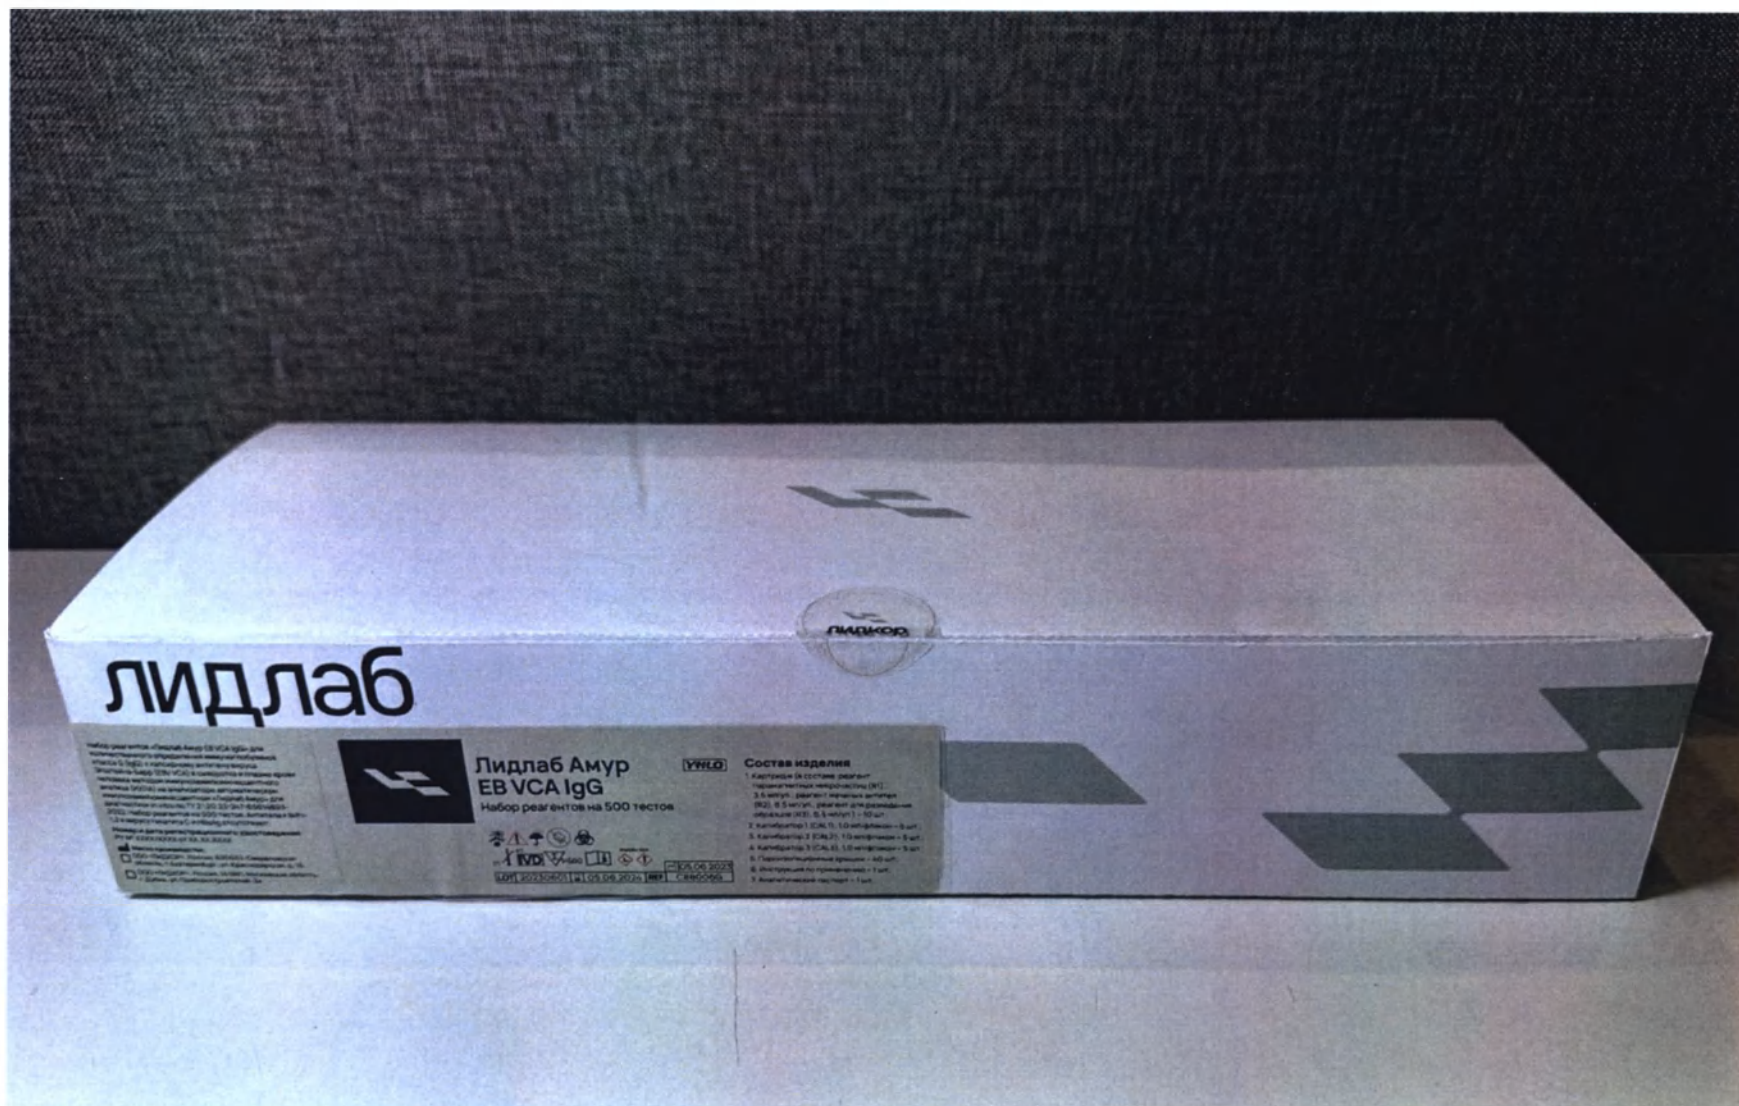

Потребительская упаковка Набор реагентов на 500 тестов. Вид сбоку

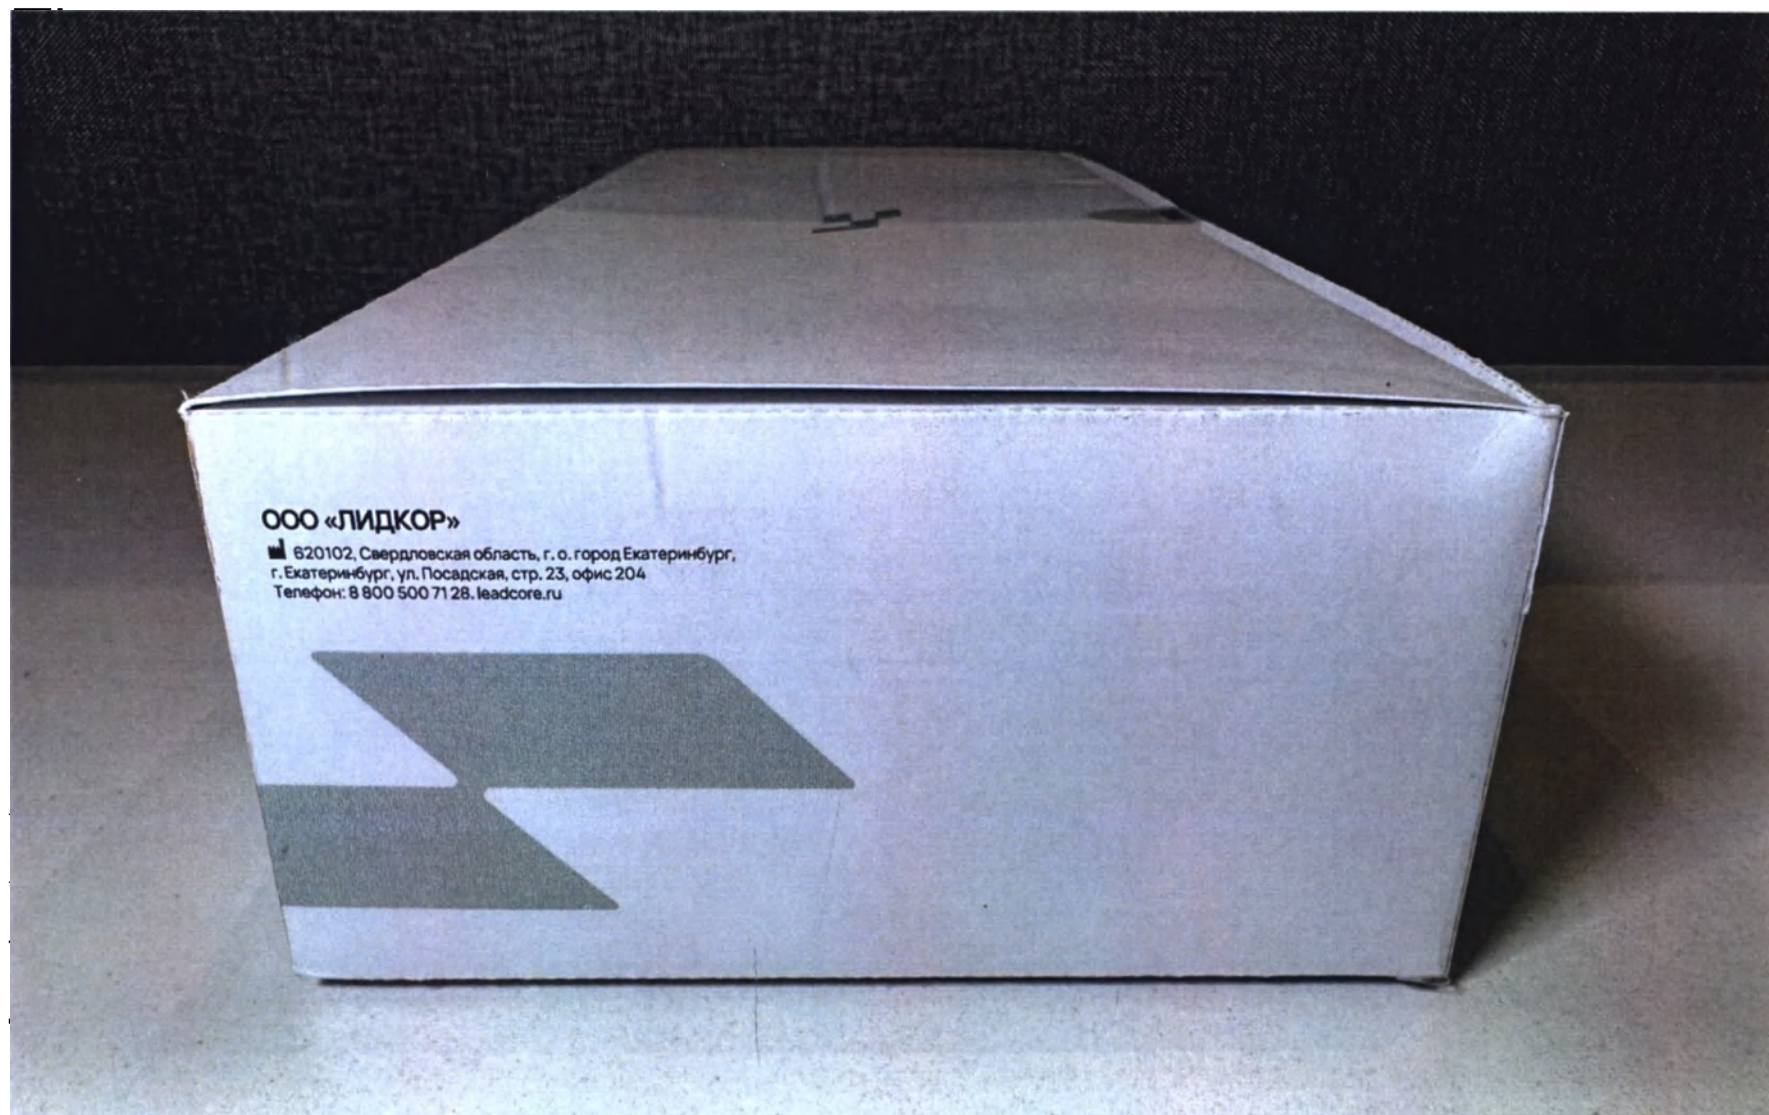

Потребительская упаковка Набор реагентов на 500 тестов. Вид сзади

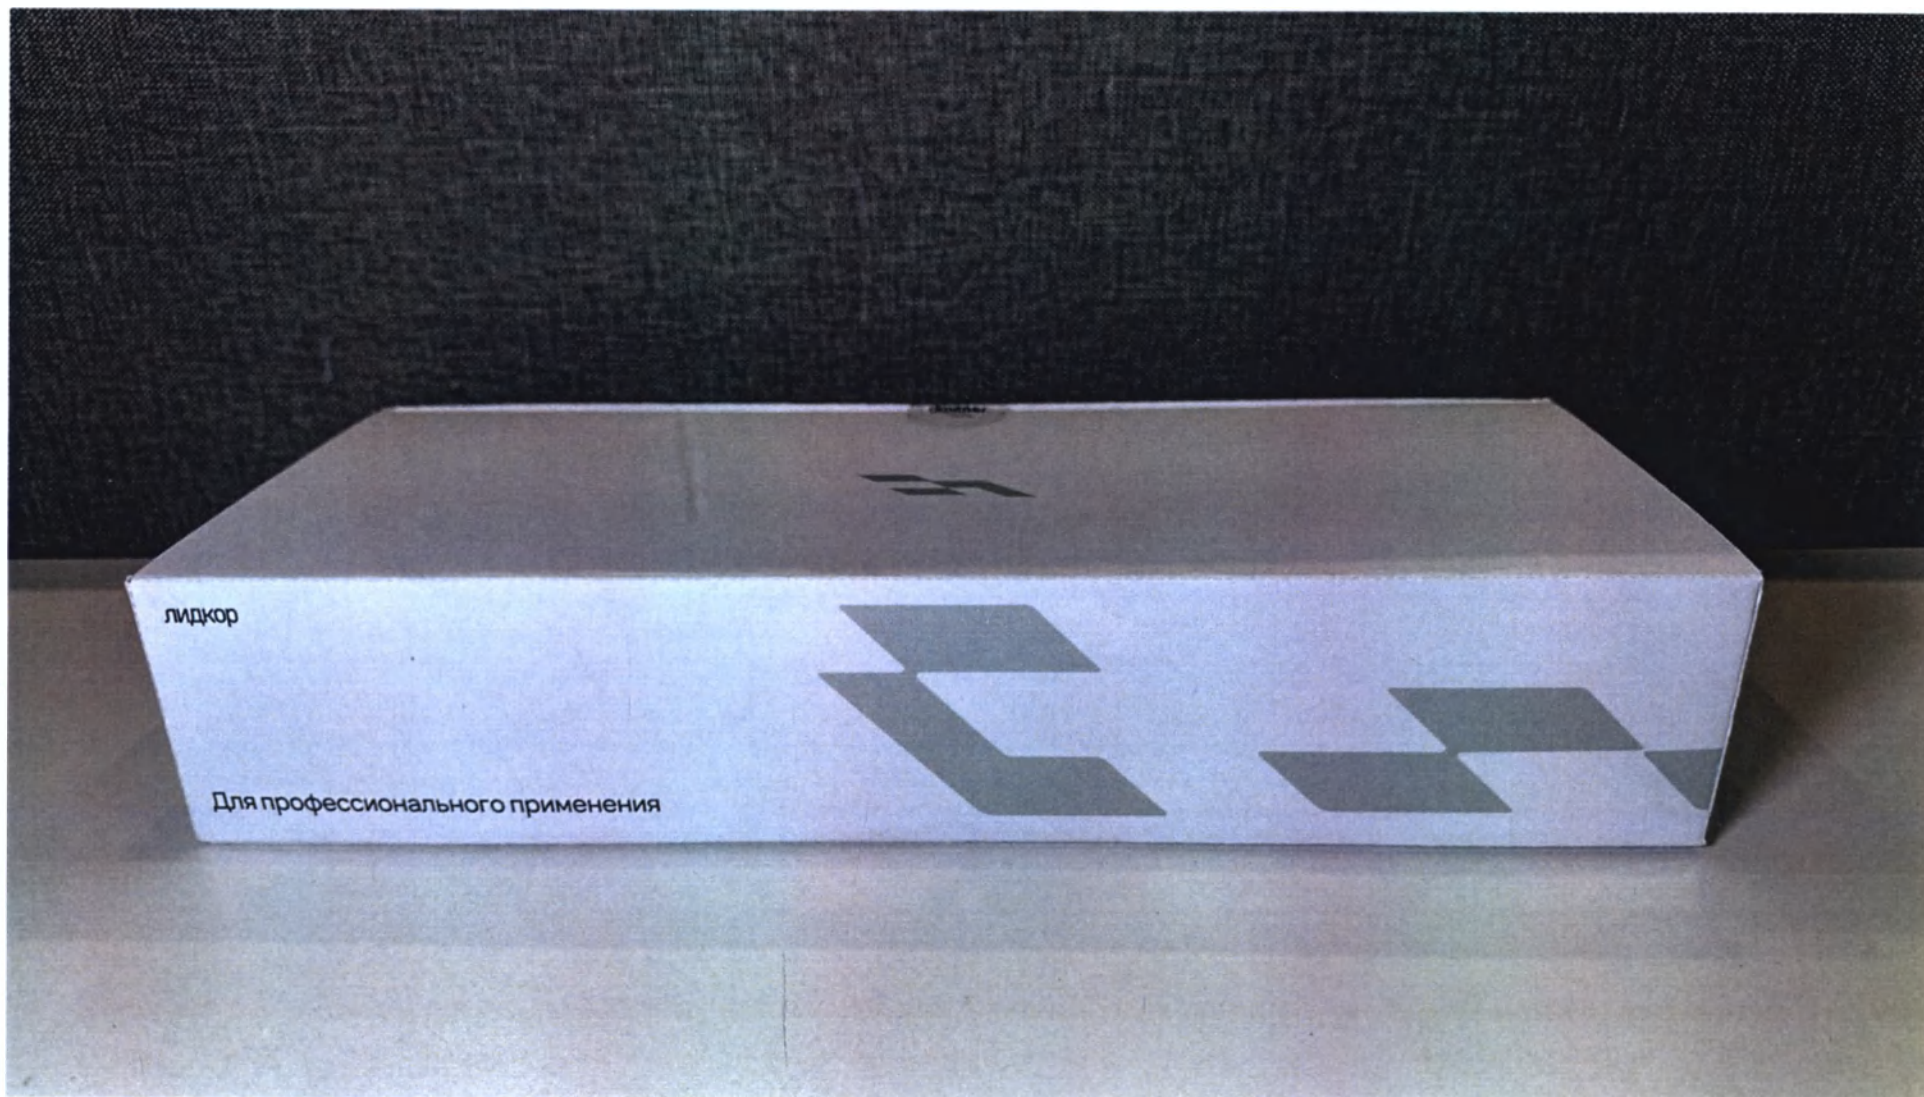

ЛИДКОР


лидлаб

Лидлаб Амур
ЕВ VCA IgG
Набор реагентов на 1000 тестов


Состав изделия

1. Карtridge со встроенным реагентом (картридж) (10) - 3,5 шт.
2. Реагент для определения антигена (2) - 3,5 шт.
3. Реагент для определения антитела (3) - 3,5 шт.
4. Карtridge со встроенным реагентом (4) - 3,5 шт.
5. Карtridge со встроенным реагентом (5) - 3,5 шт.
6. Карtridge со встроенным реагентом (6) - 3,5 шт.
7. Карtridge со встроенным реагентом (7) - 3,5 шт.
8. Карtridge со встроенным реагентом (8) - 3,5 шт.
9. Карtridge со встроенным реагентом (9) - 3,5 шт.
10. Карtridge со встроенным реагентом (10) - 3,5 шт.

Потребительская упаковка Набор реагентов на 1000 тестов. Вид сбоку

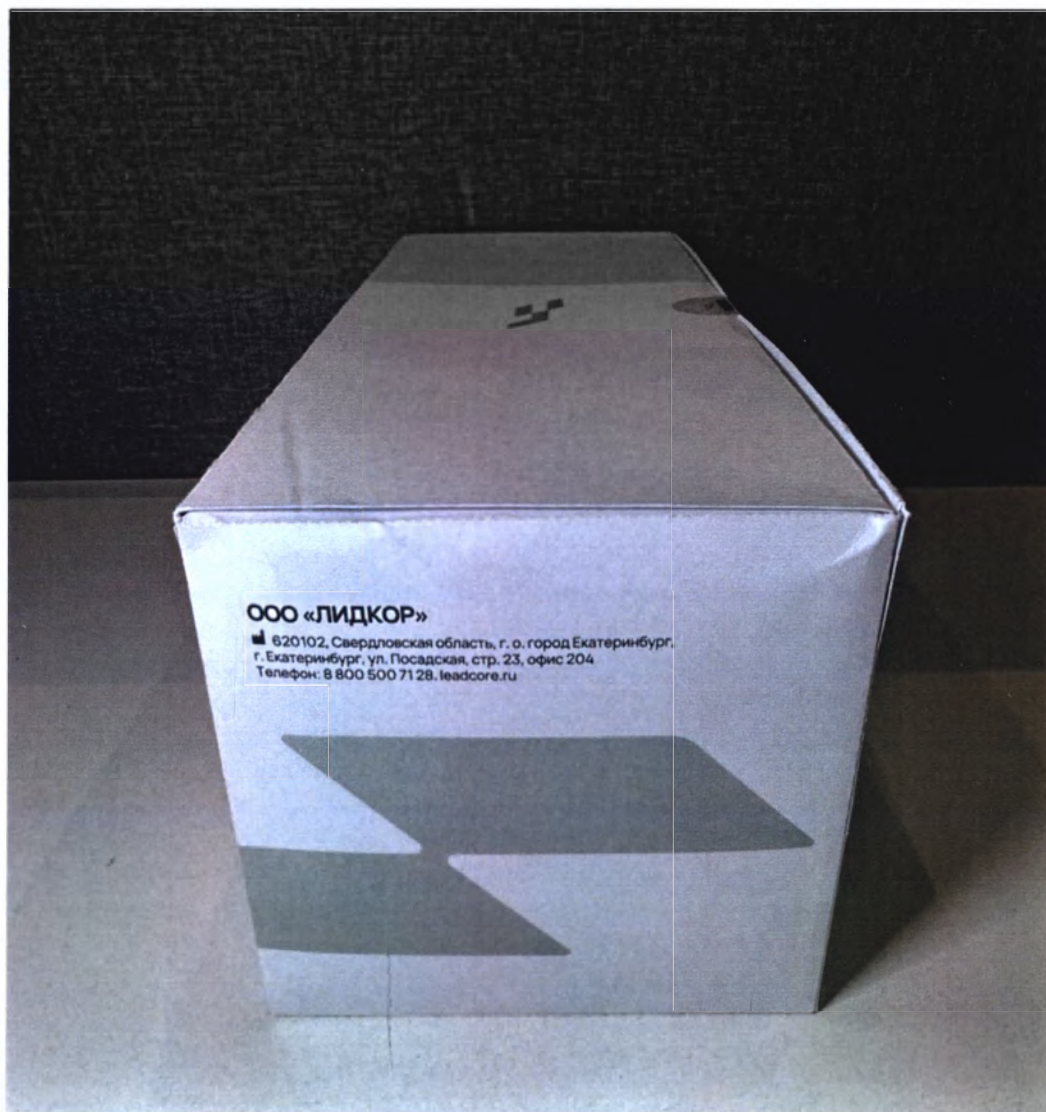

Потребительская упаковка Набор реагентов на 1000 тестов. Вид сзади

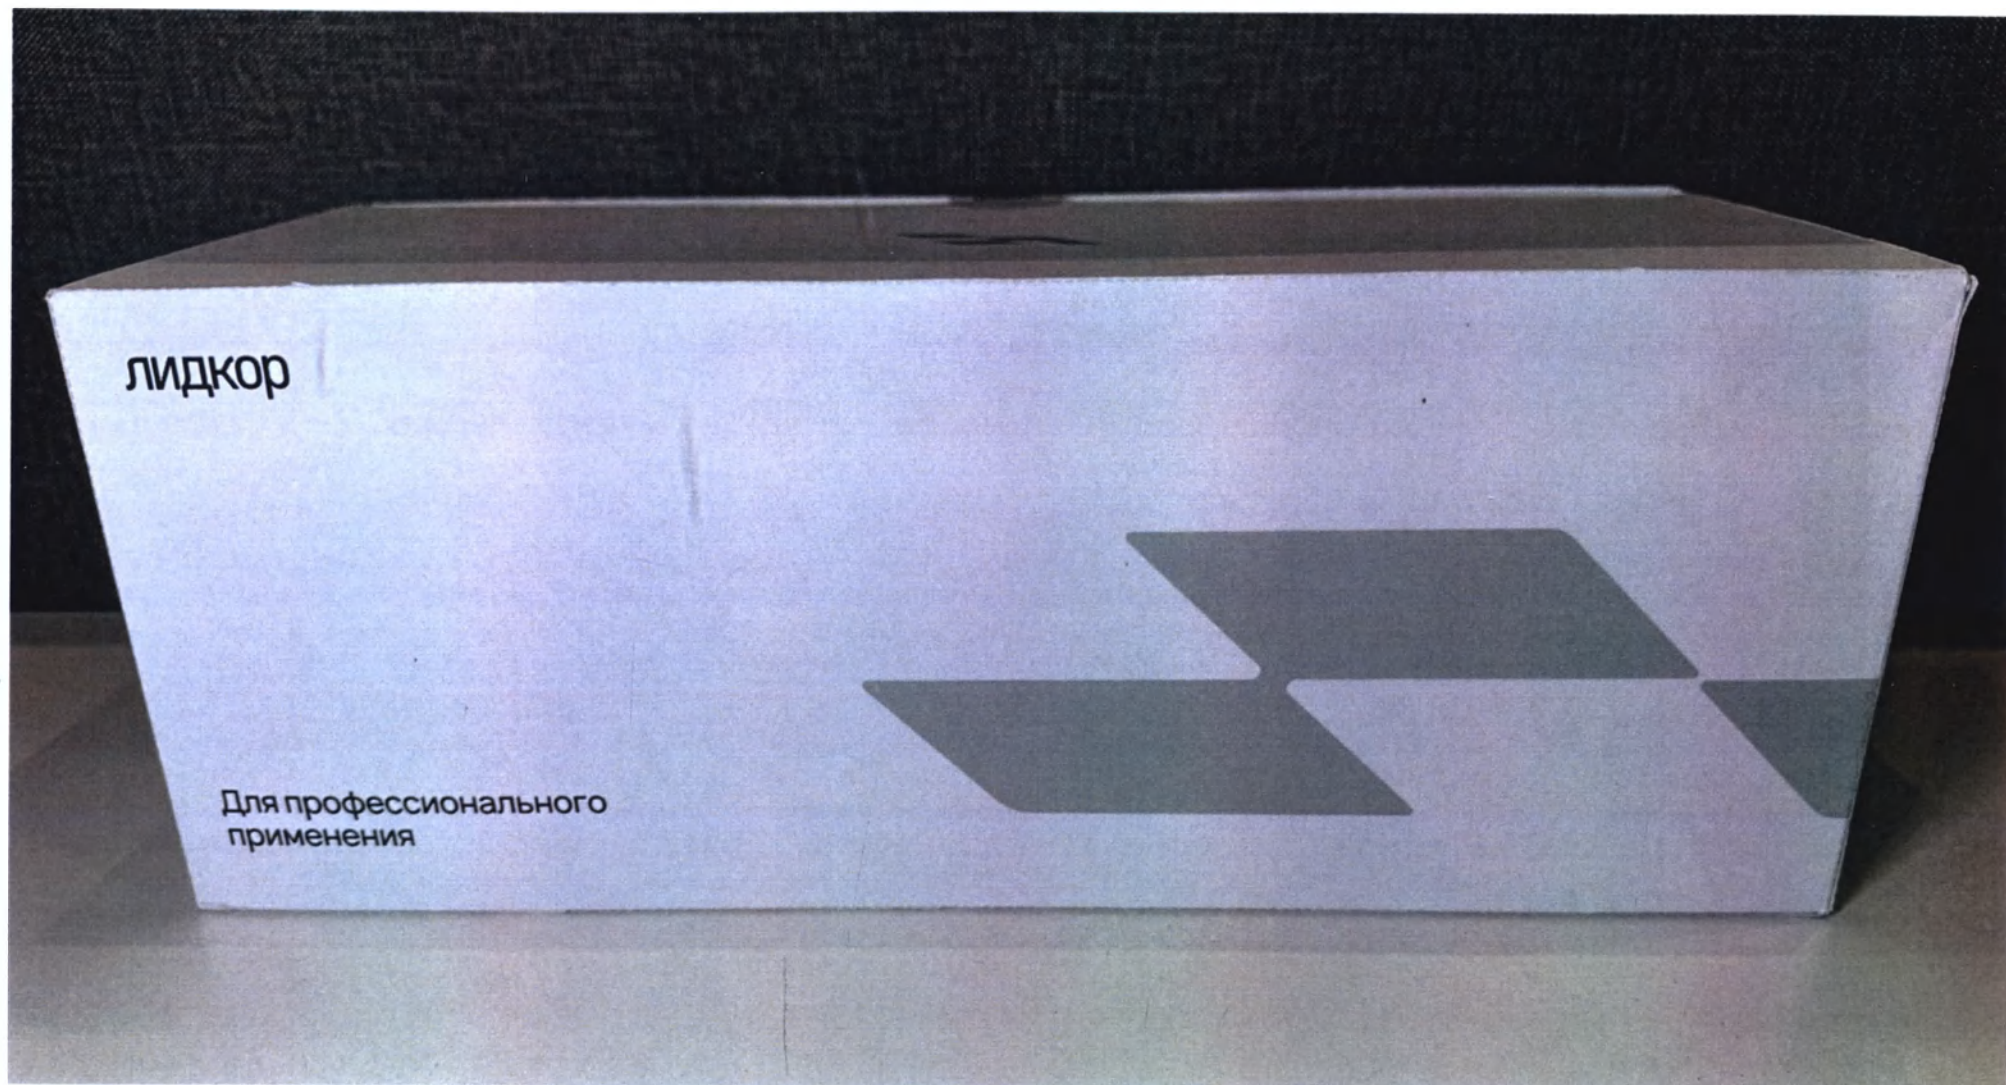

Общий вид медицинского изделия



Транспортная упаковка Набор реагентов на 100 тестов



Транспортная упаковка Набор реагентов на 200 тестов



Транспортная упаковка Набор реагентов на 500 тестов



Транспортная упаковка Набор реагентов на 1000 тестов



Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
23 (двадцать три) л.

Директор
ООО «ЛИДКОР»



_____/Е. Ю. Гохгут/