

PHILIPS

Руководитель по нормативному регулированию




ООО «ФИЛИПС»


Горкуша Д. В.

«12» мая 2023 г.


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

«Система флюороскопическая рентгеновская передвижная цифровая Zenition 10 с принадлежностями»

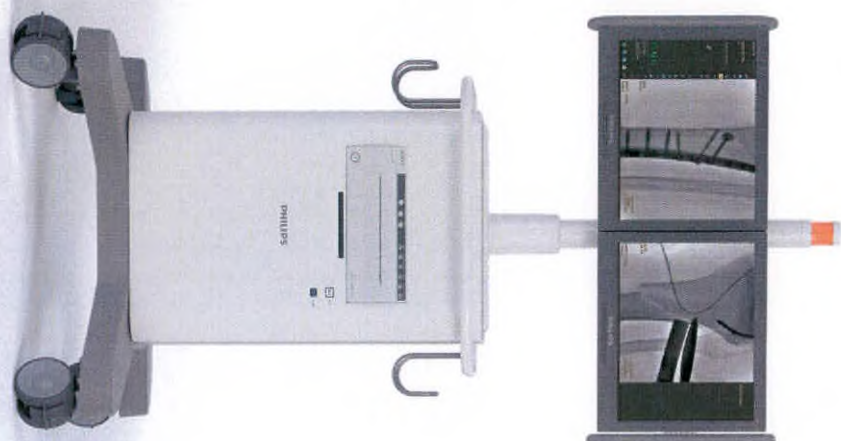

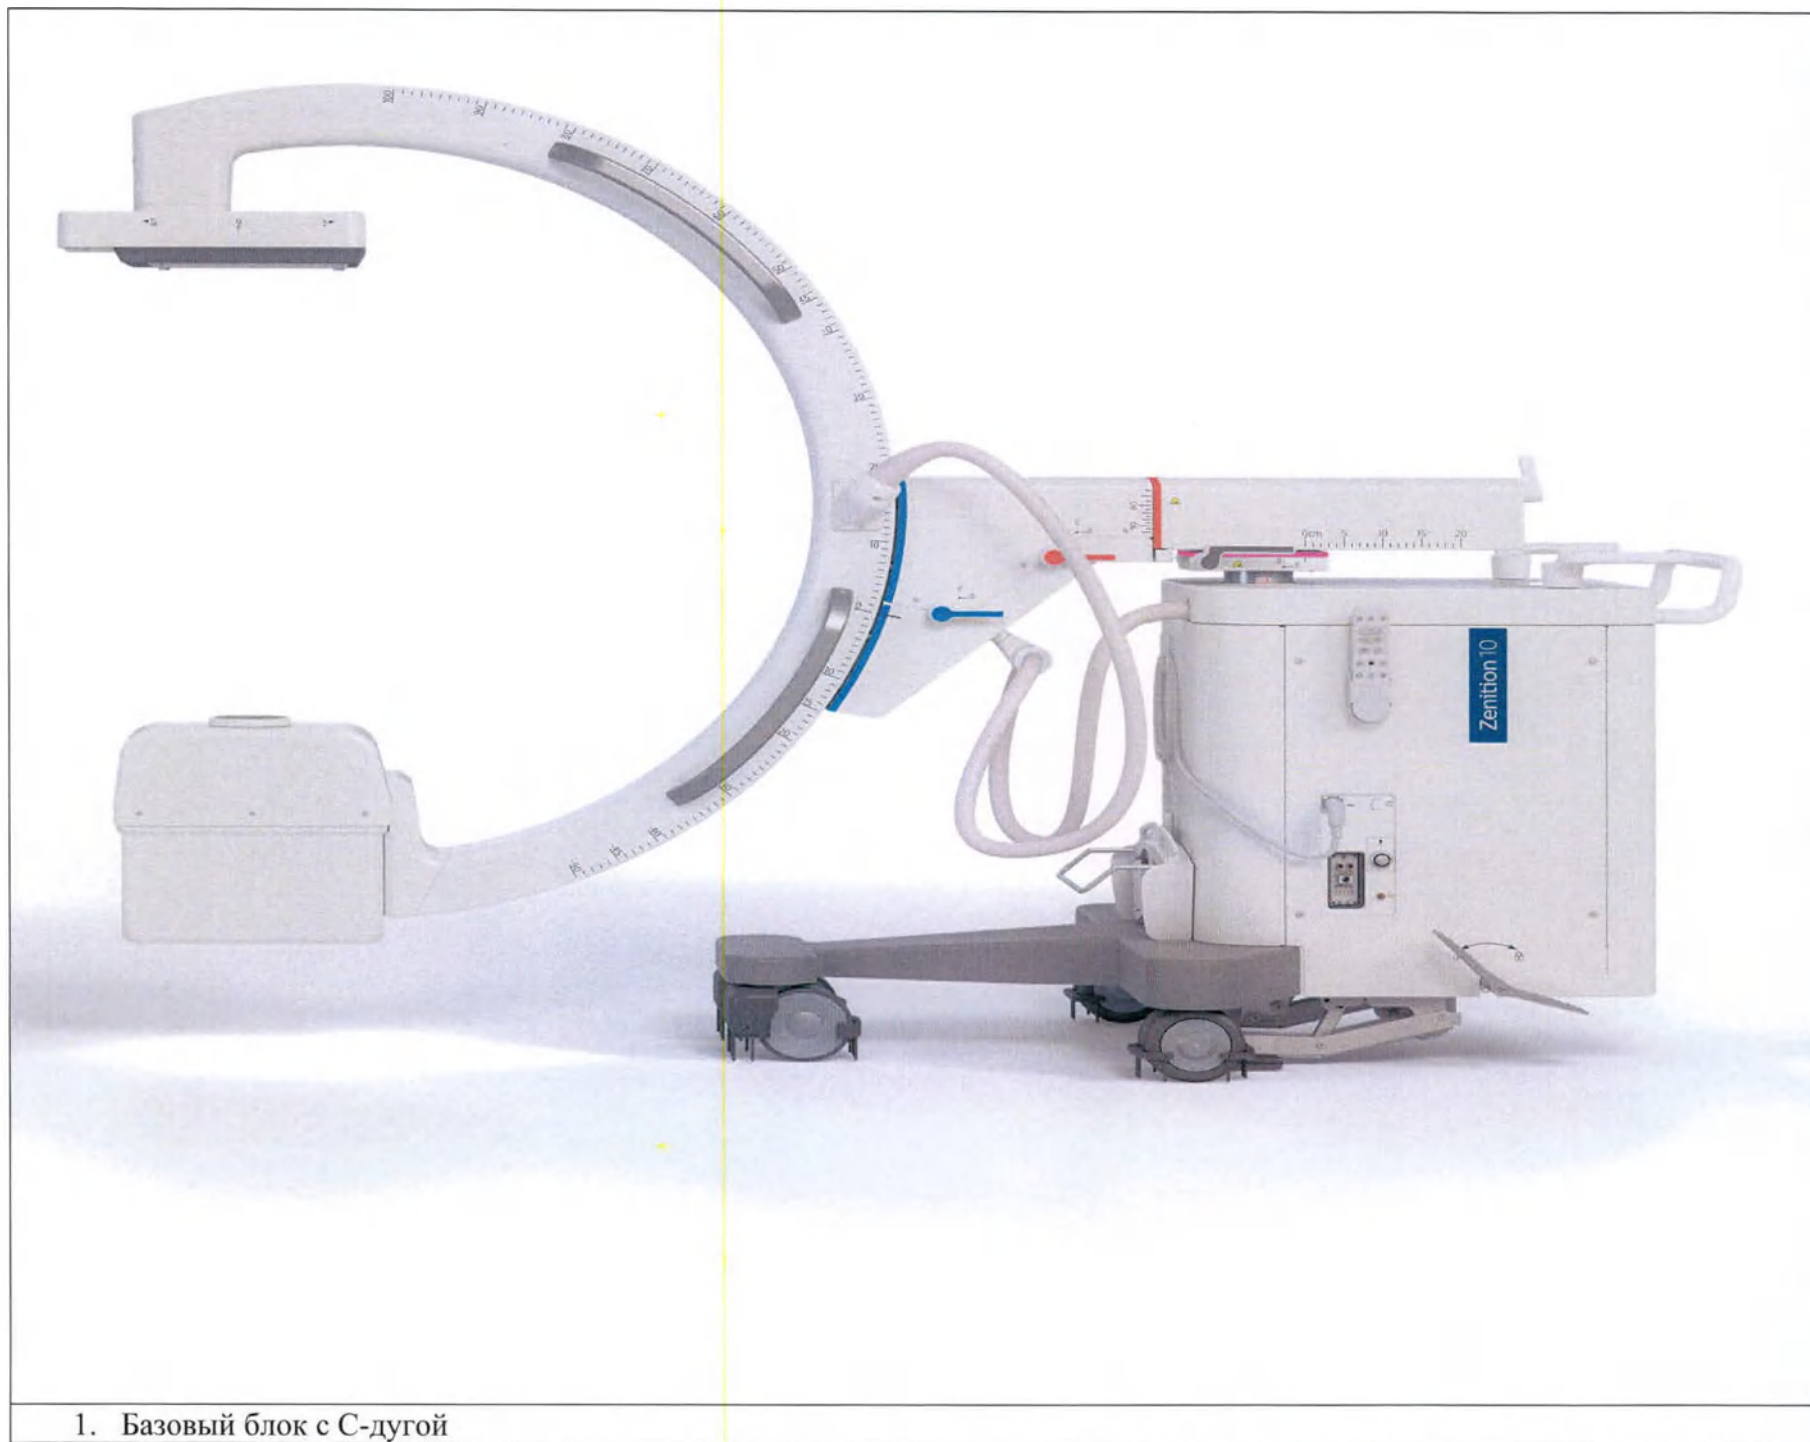


1. Базовый блок с С-дугой

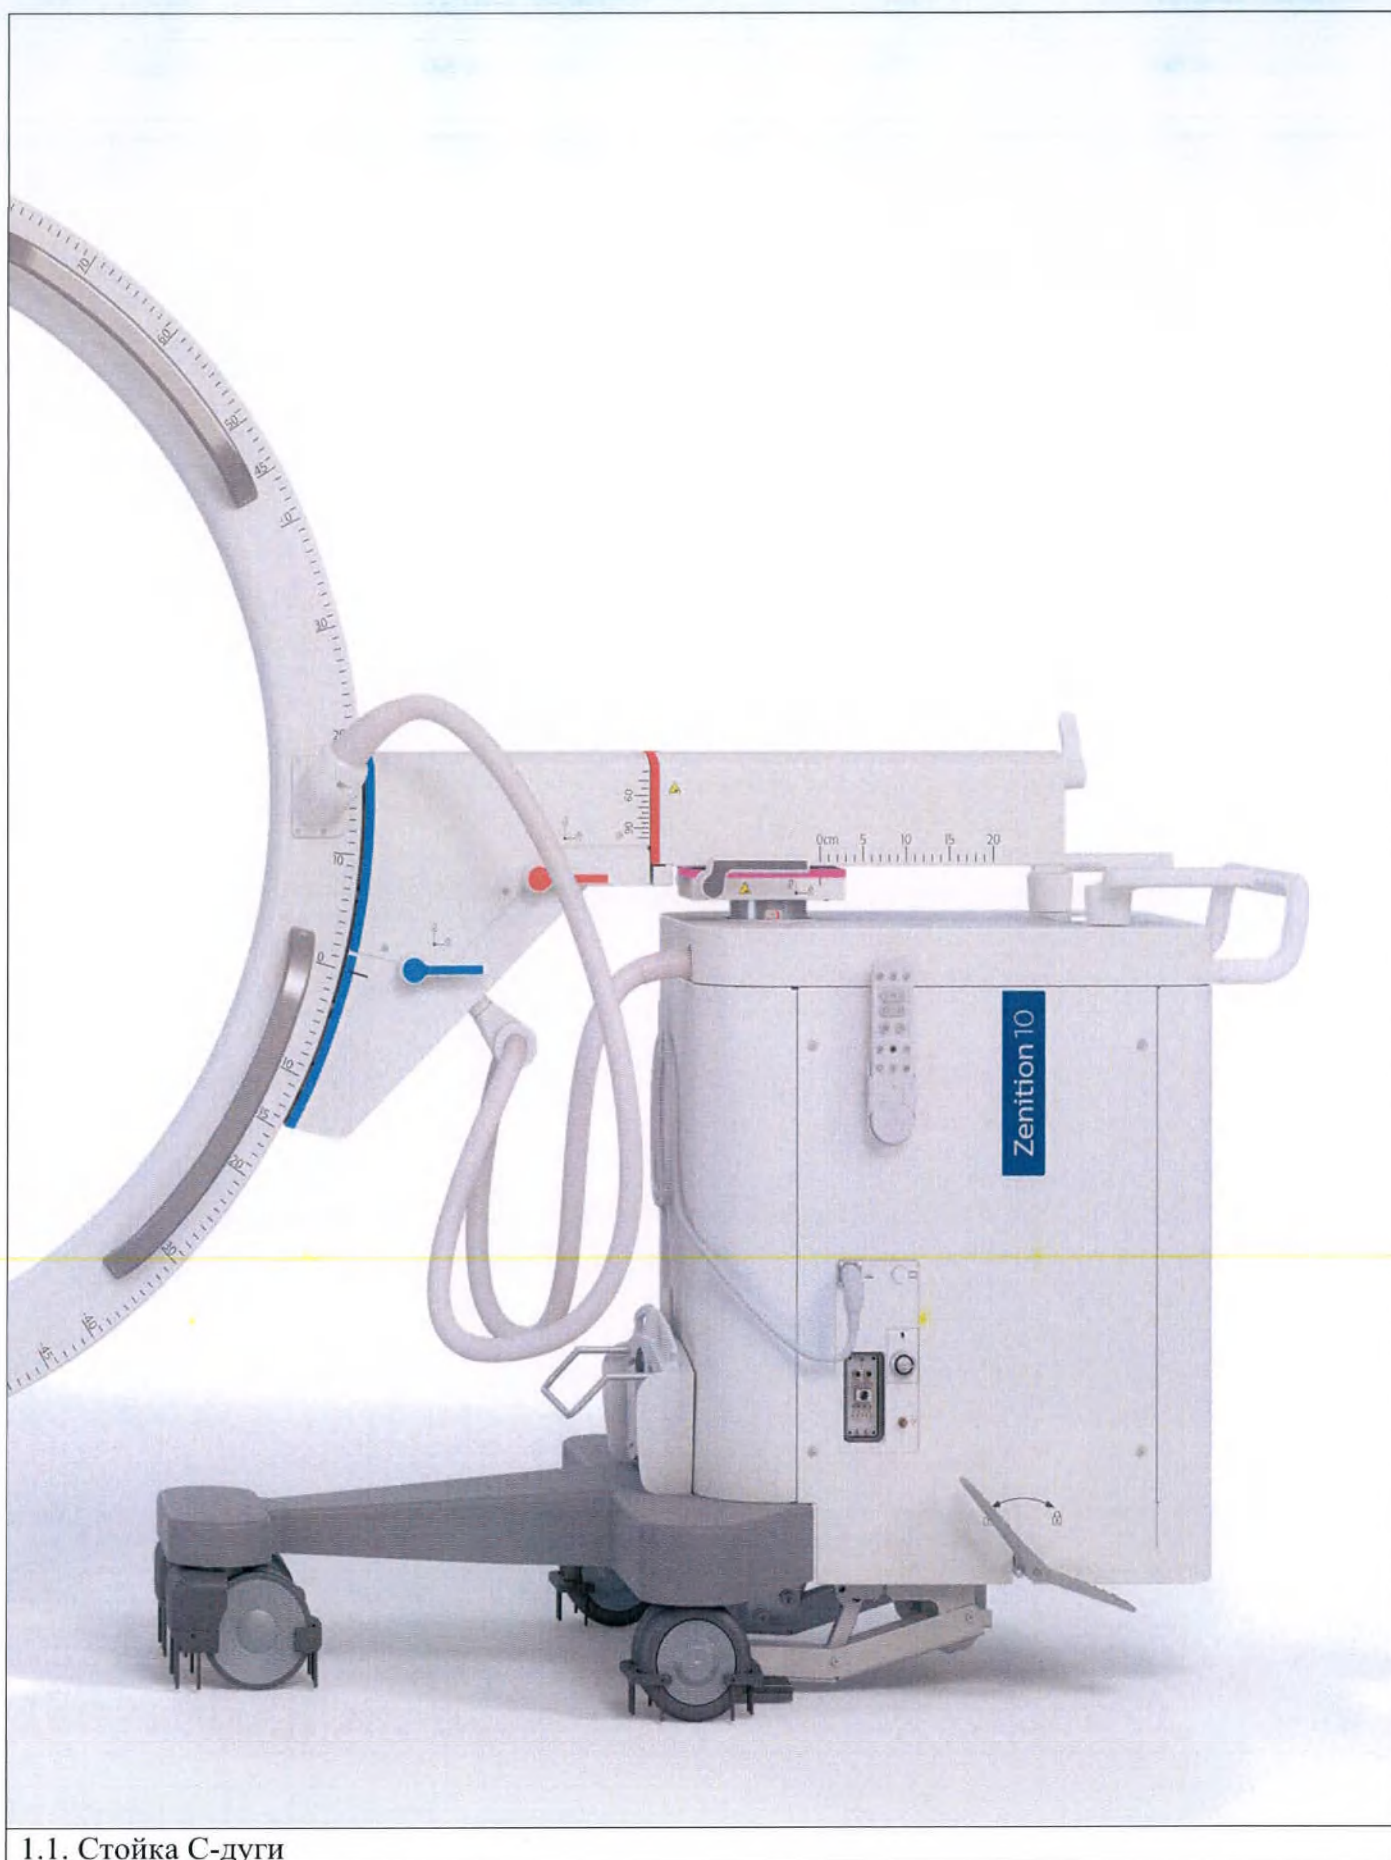

1.1. Стойка С-дуги




1.2. С-дуга

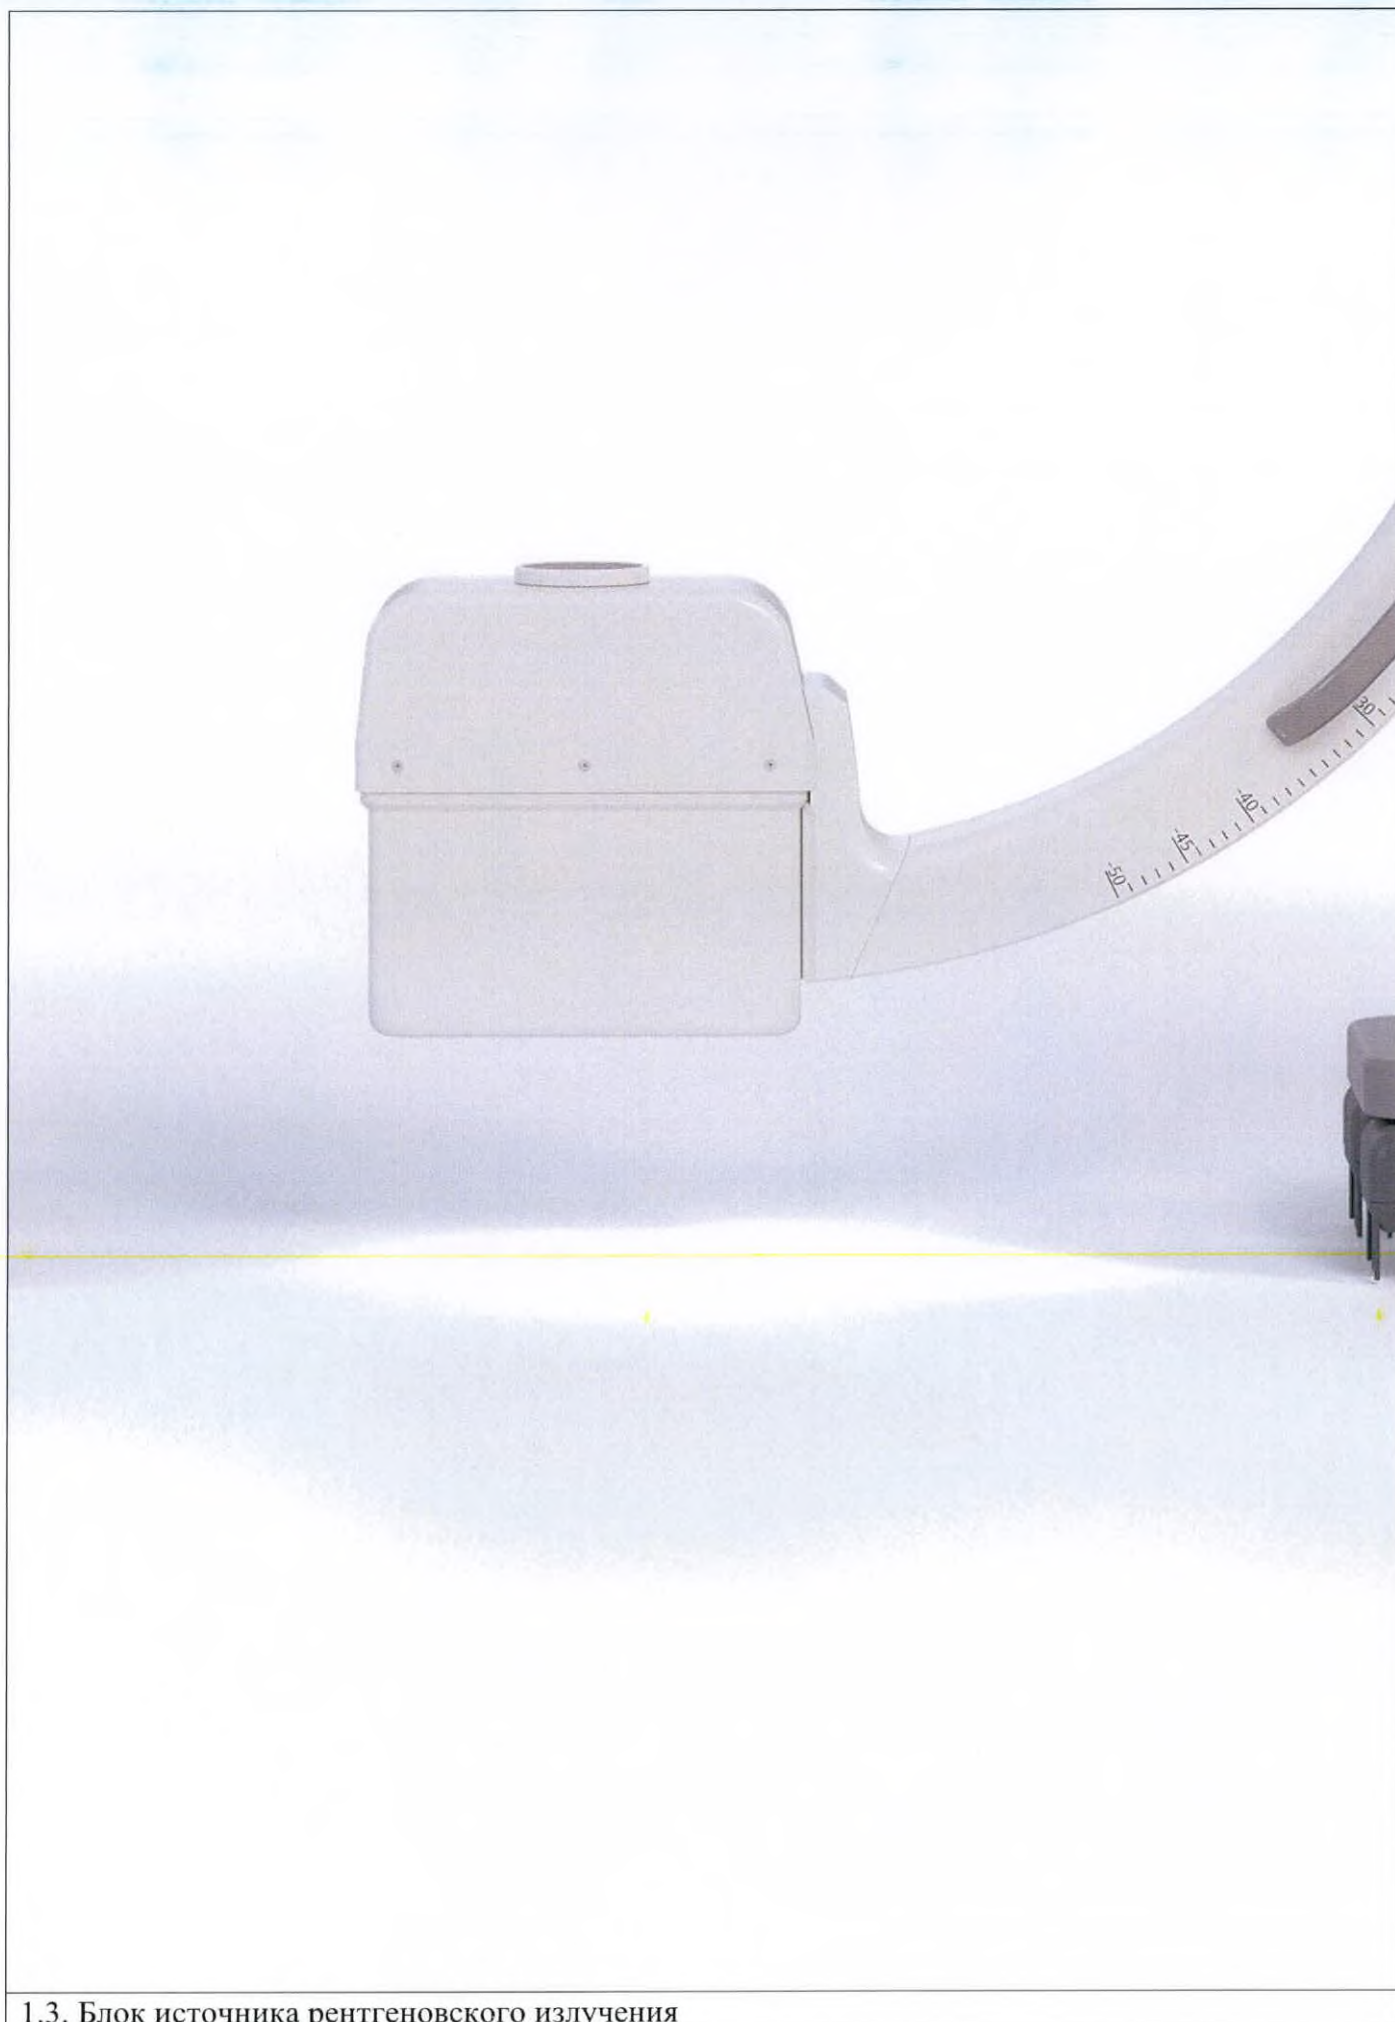


1.3. Блок источника рентгеновского излучения



1.4. Коллиматор

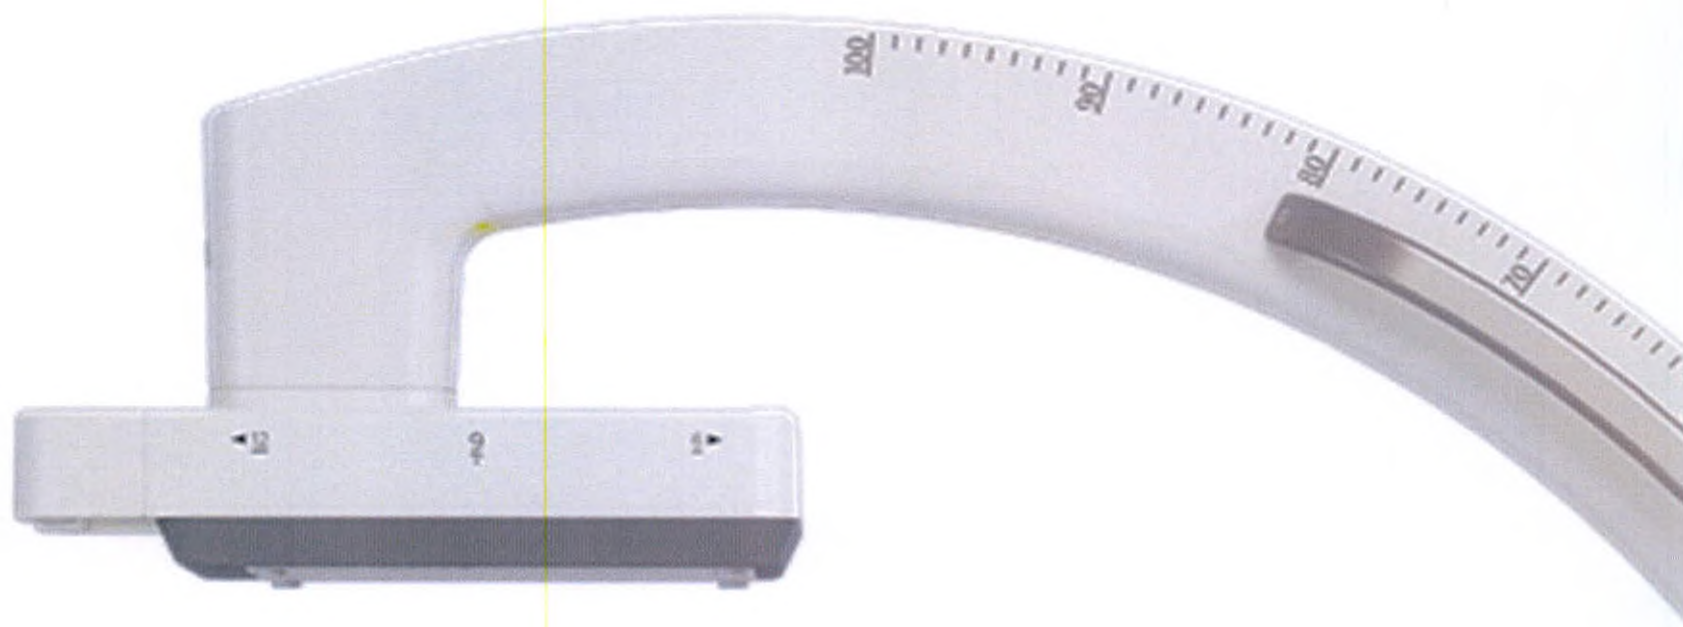


1.5. Детектор

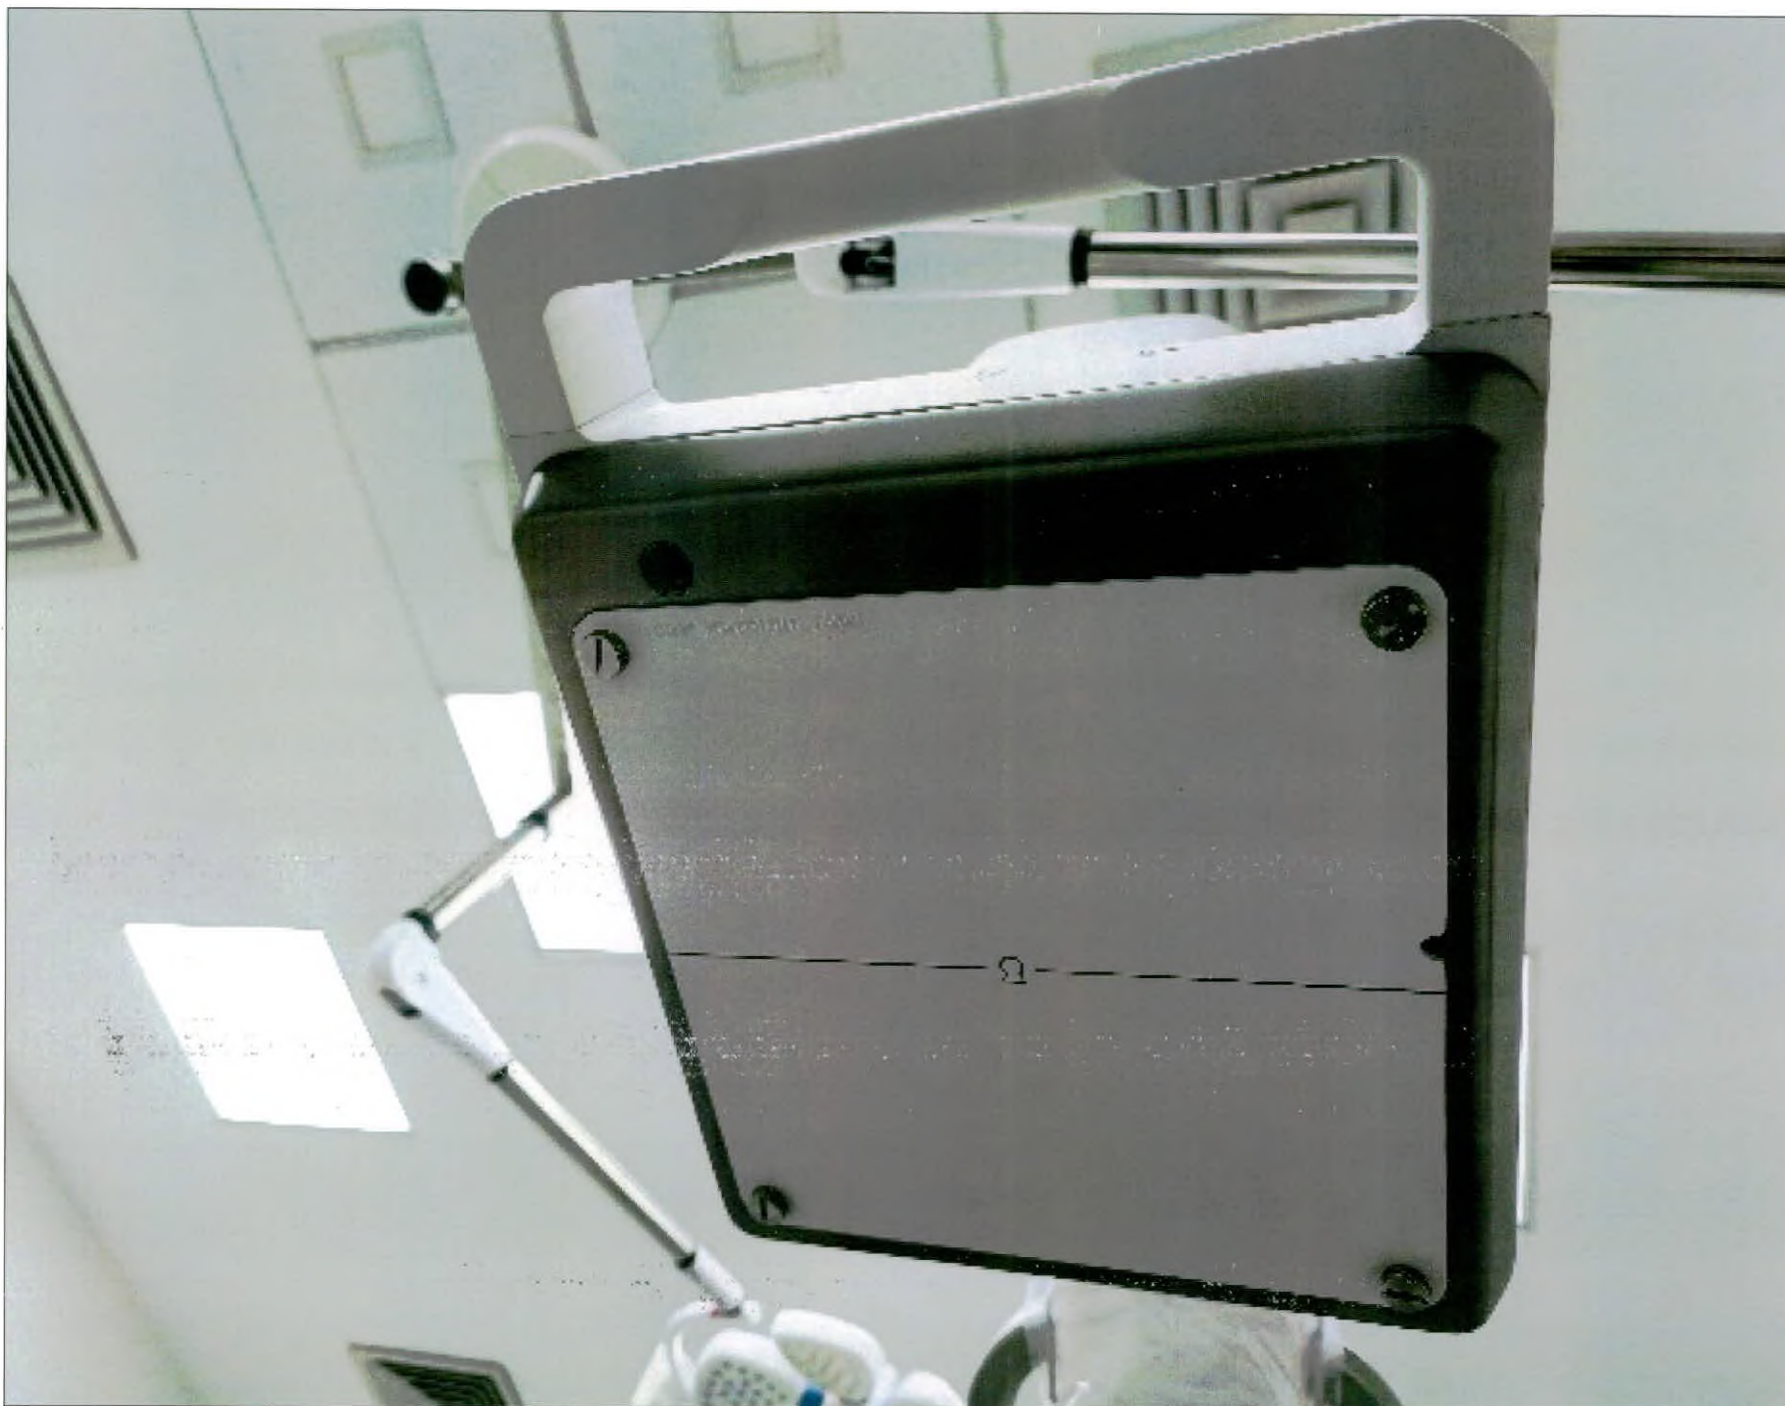


1.6. Отсеивающая решетка




2. Передвижная станция просмотра

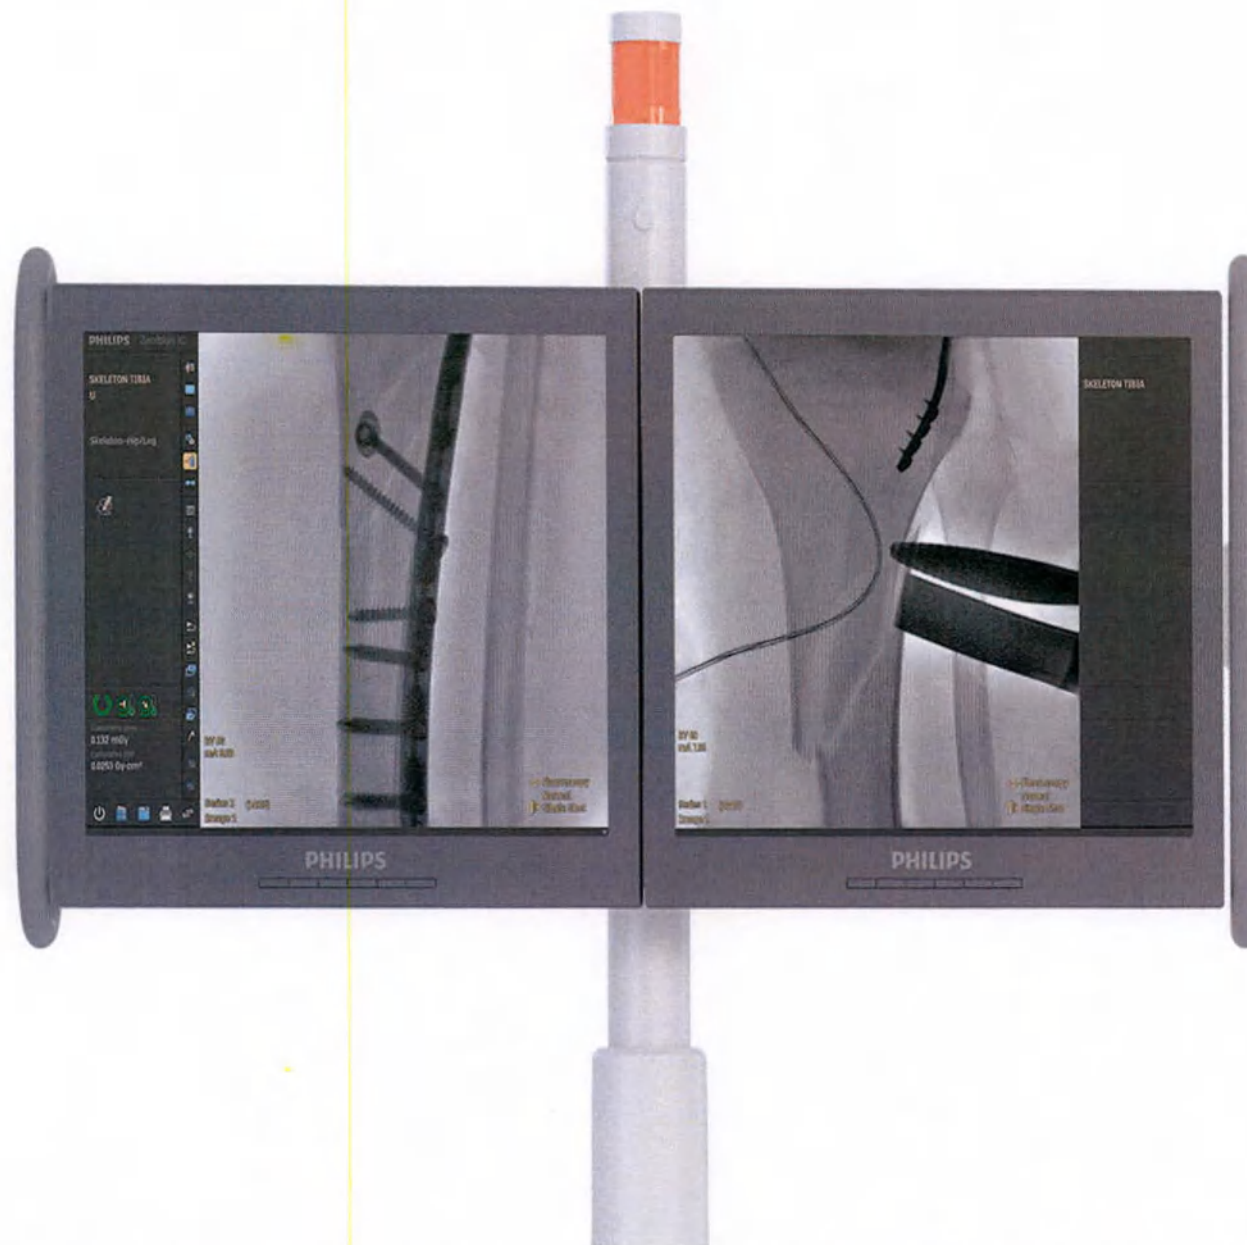

2.1. Монитор для исследований стандартной яркости или монитор для исследований высокой яркости

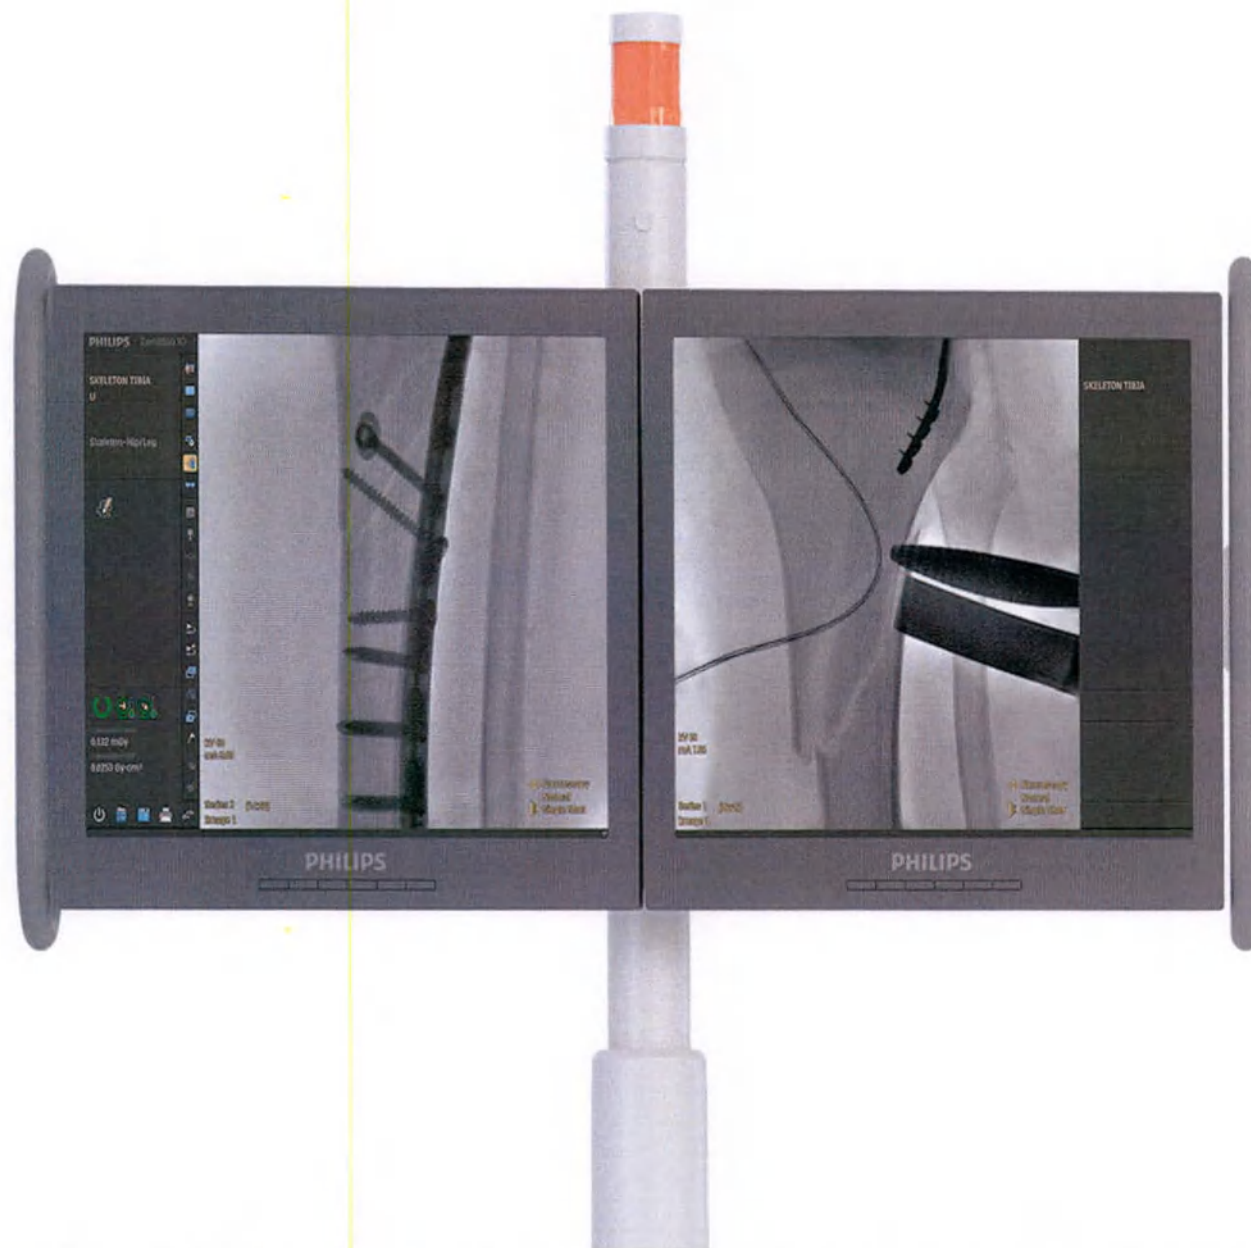

2.2. Контрольный монитор стандартной яркости или контрольный монитор высокой яркости

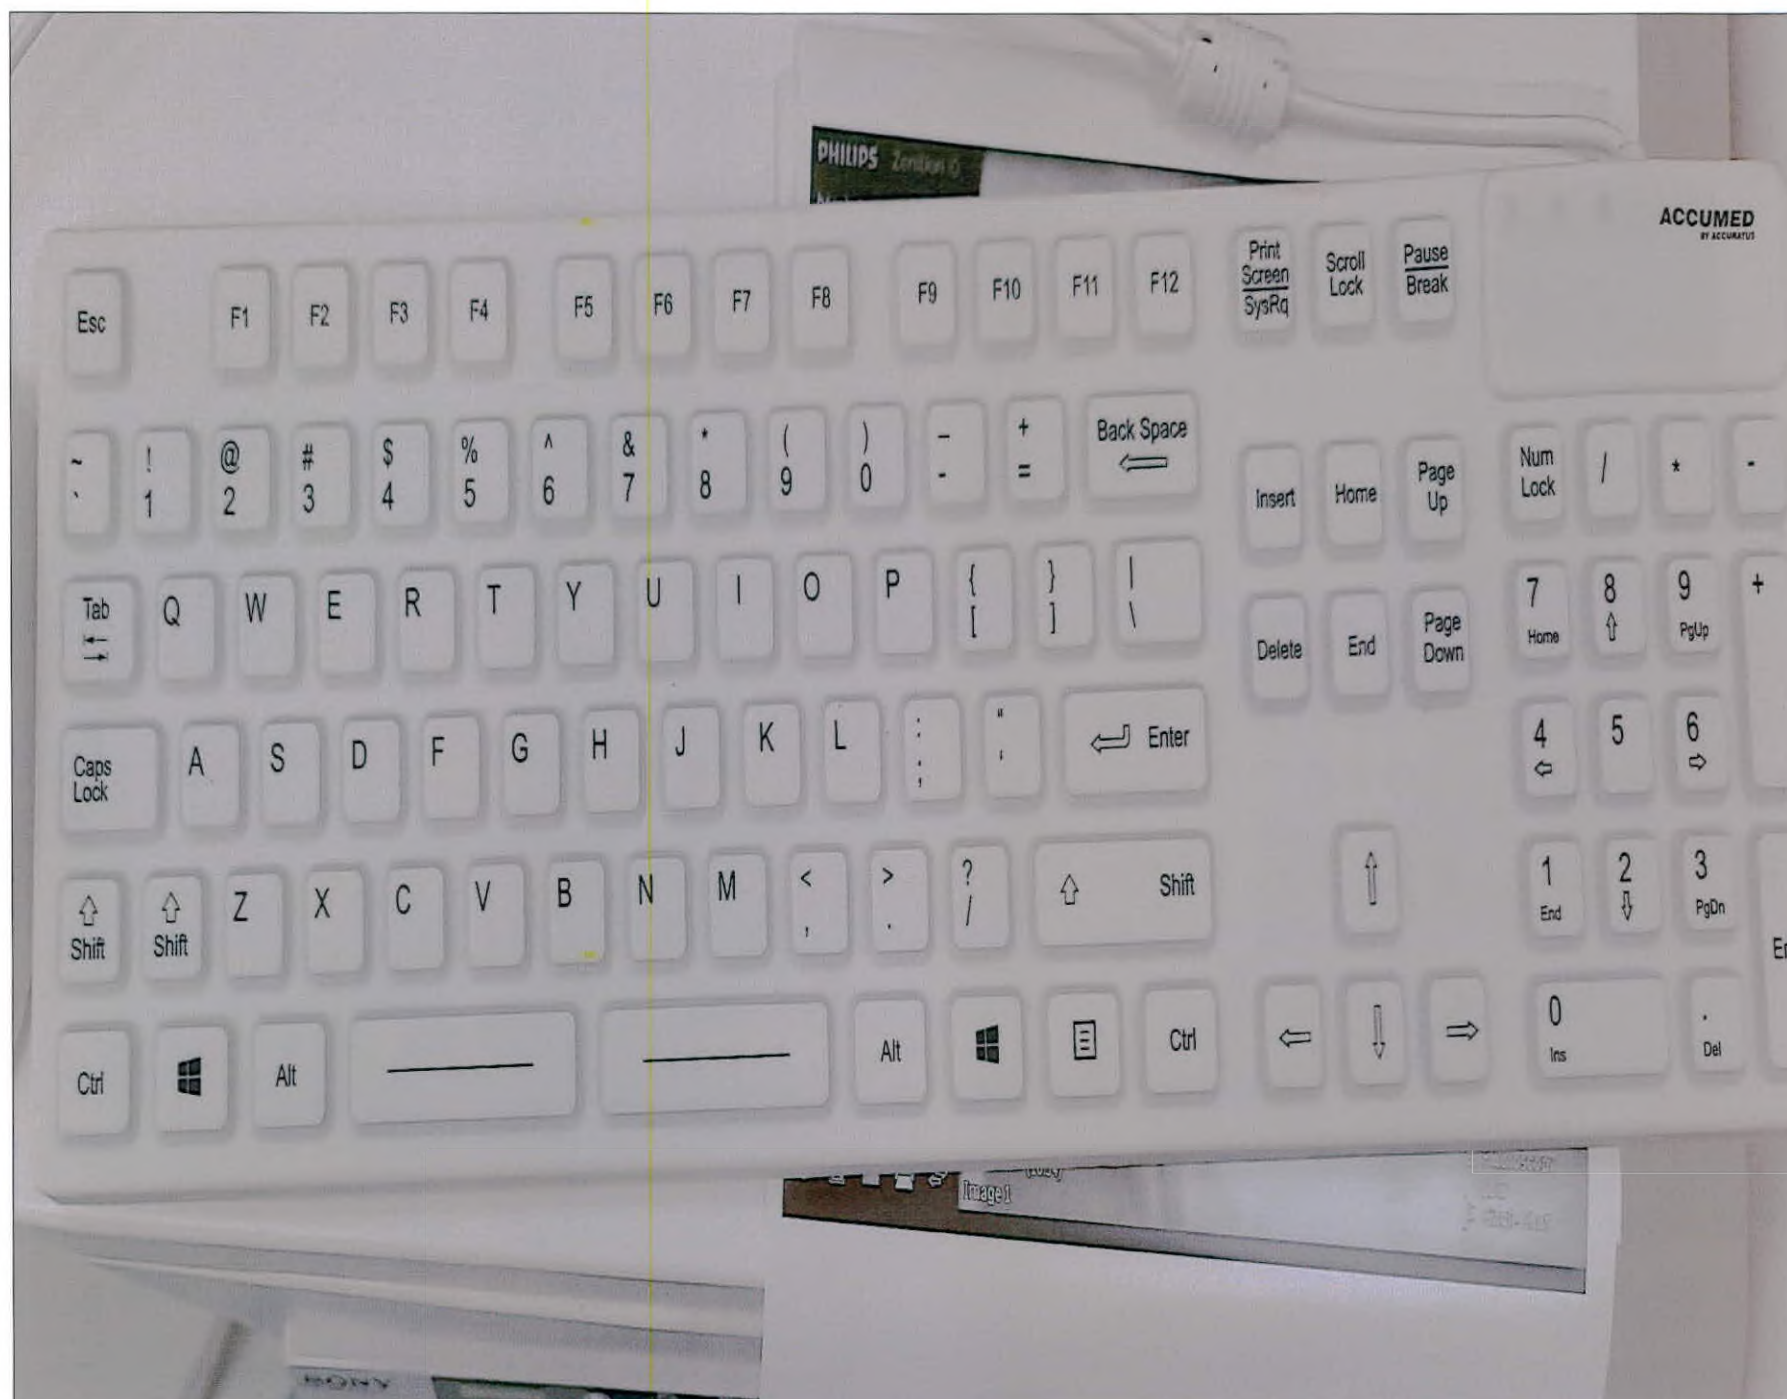

3. Клавиатура



4. Мышь.



5. Программное обеспечение для обработки изображений на электронных и/или оптических и/или виртуальных носителях



6. Ручной переключатель.



7. а) Ключ системного блокиратора





8. Проводной ножной переключатель



9. Кабель питания




PHILIPS

Руководство по
эксплуатации

Русский

4598 018 09191

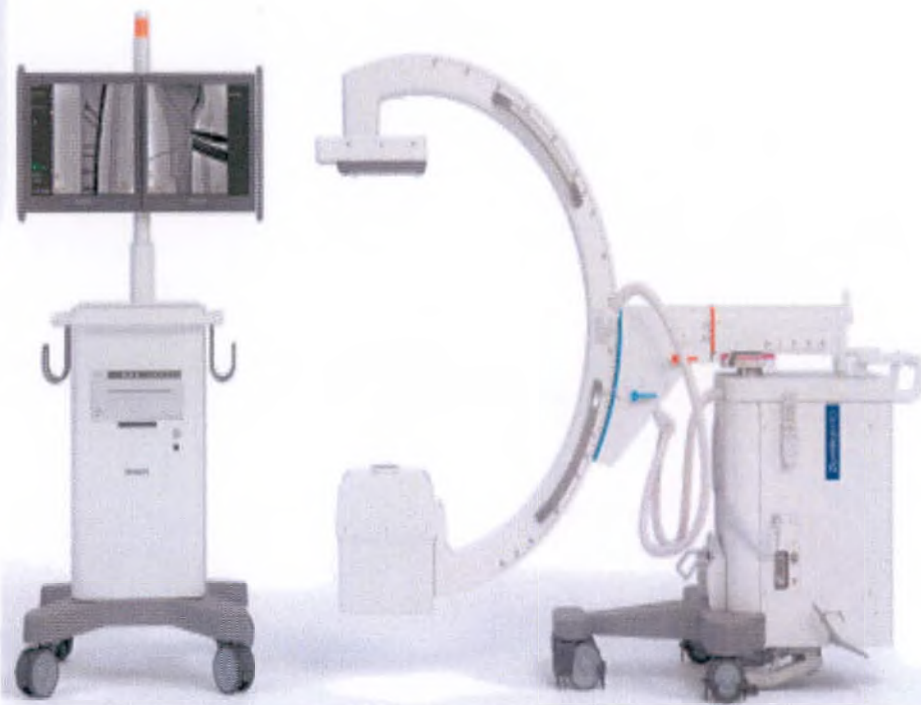


Philips Zenition 10


Версия 1.0

11. Руководство по эксплуатации на электронном и/или бумажном и/или виртуальном носителе.




1. Пульт дистанционного управления.

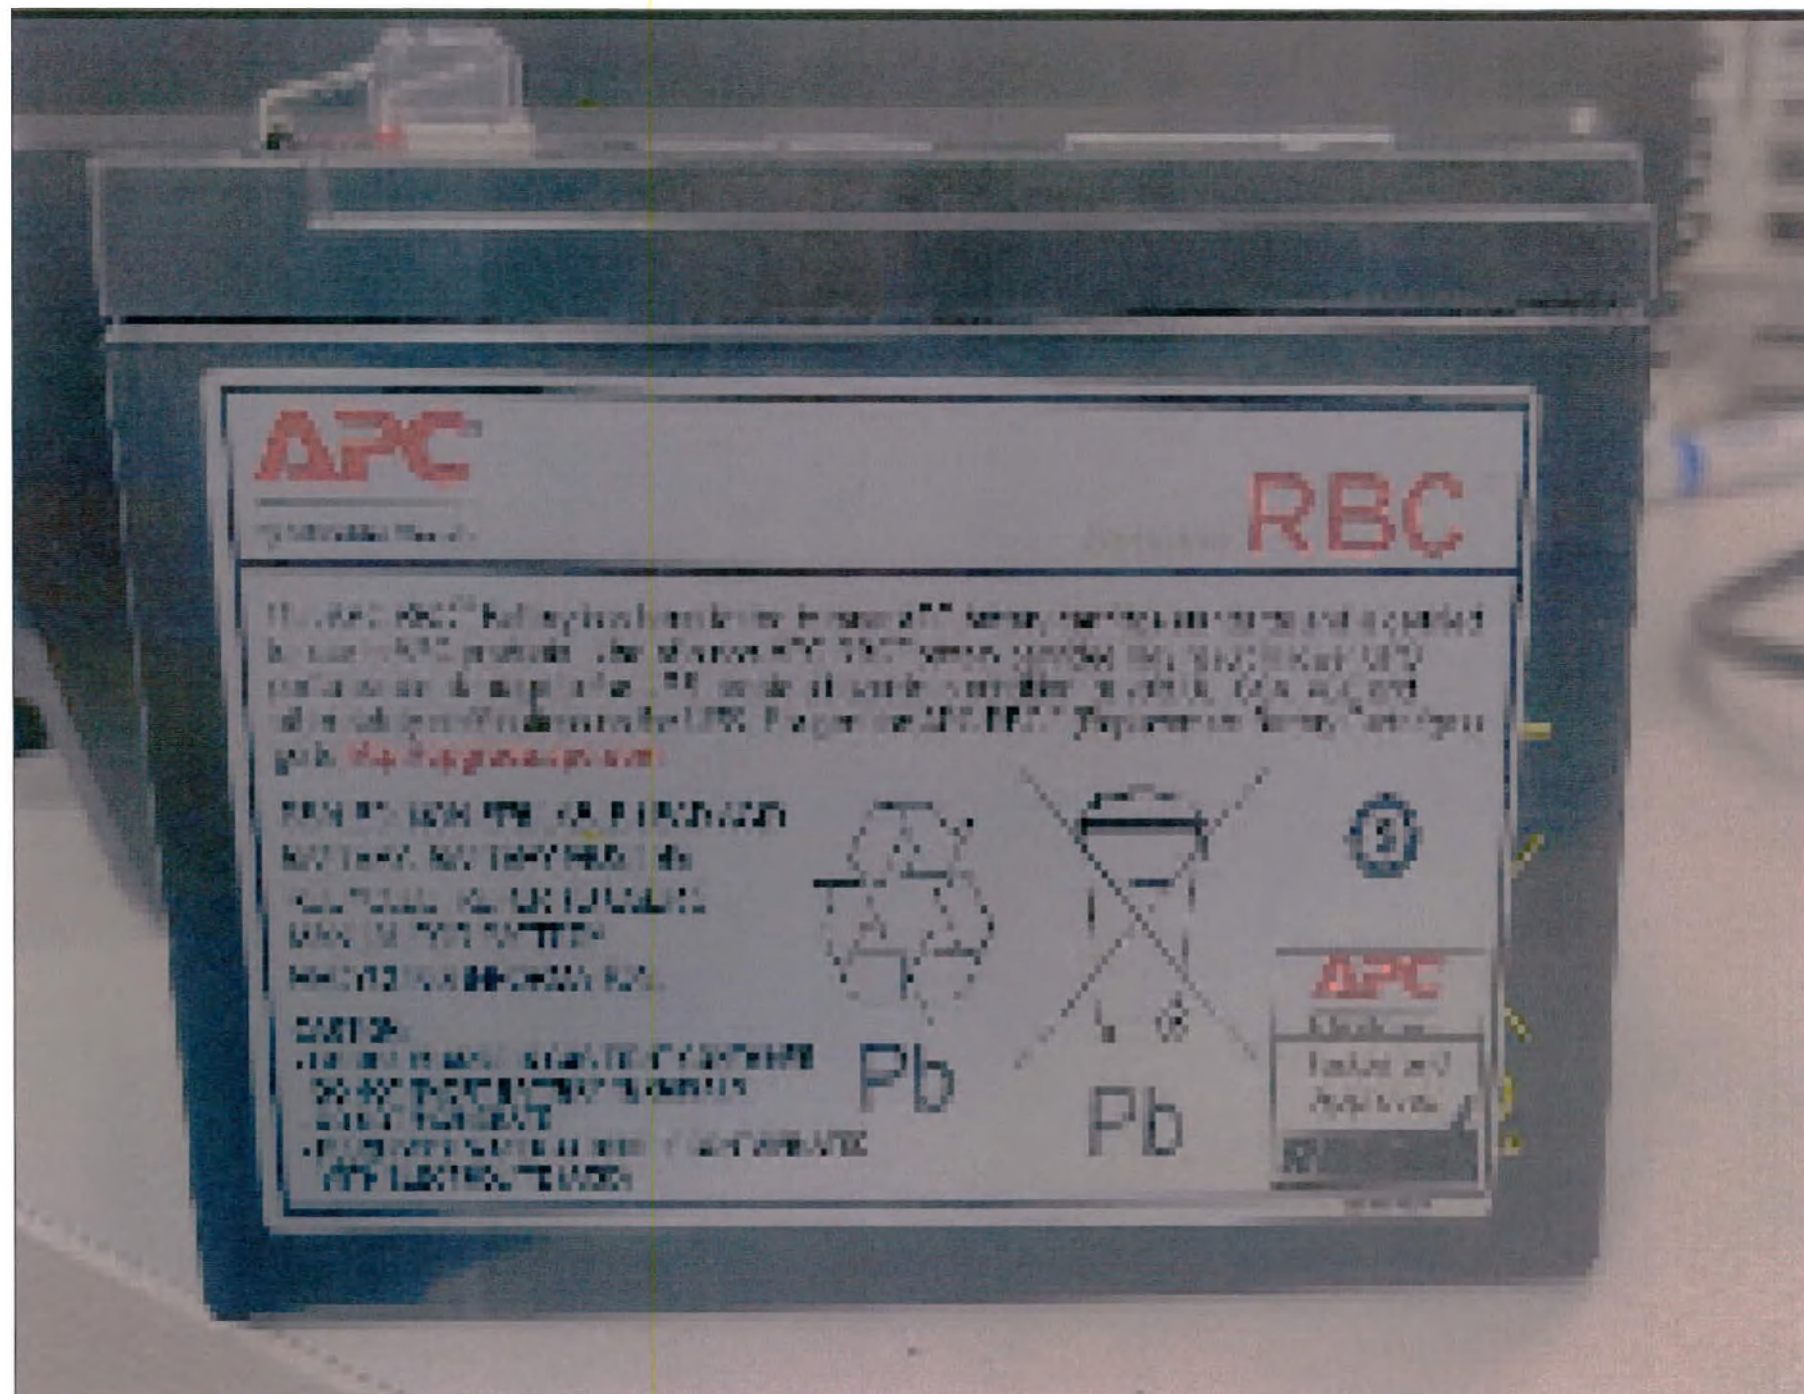

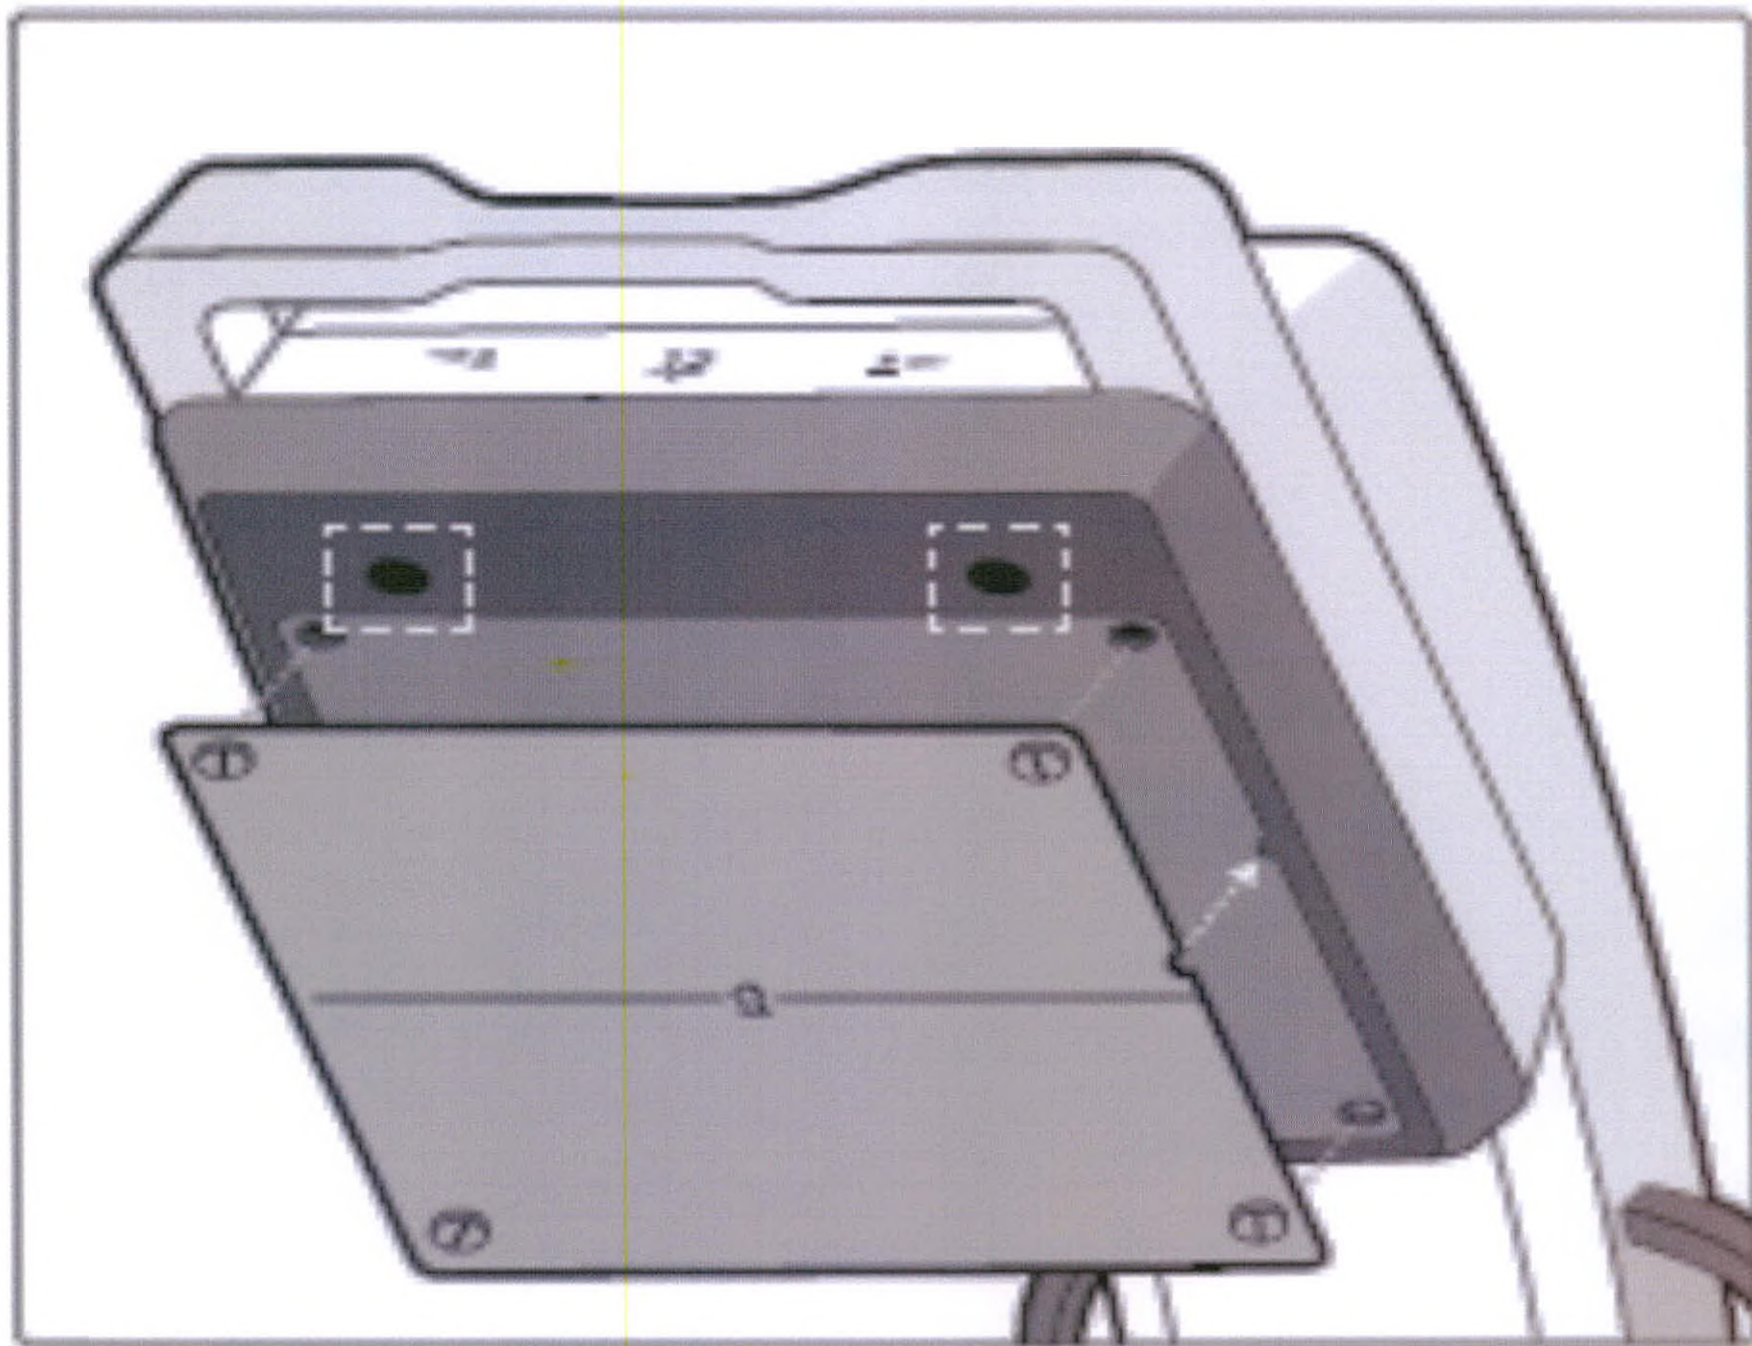


3.а) Лазерный прицел детектора.

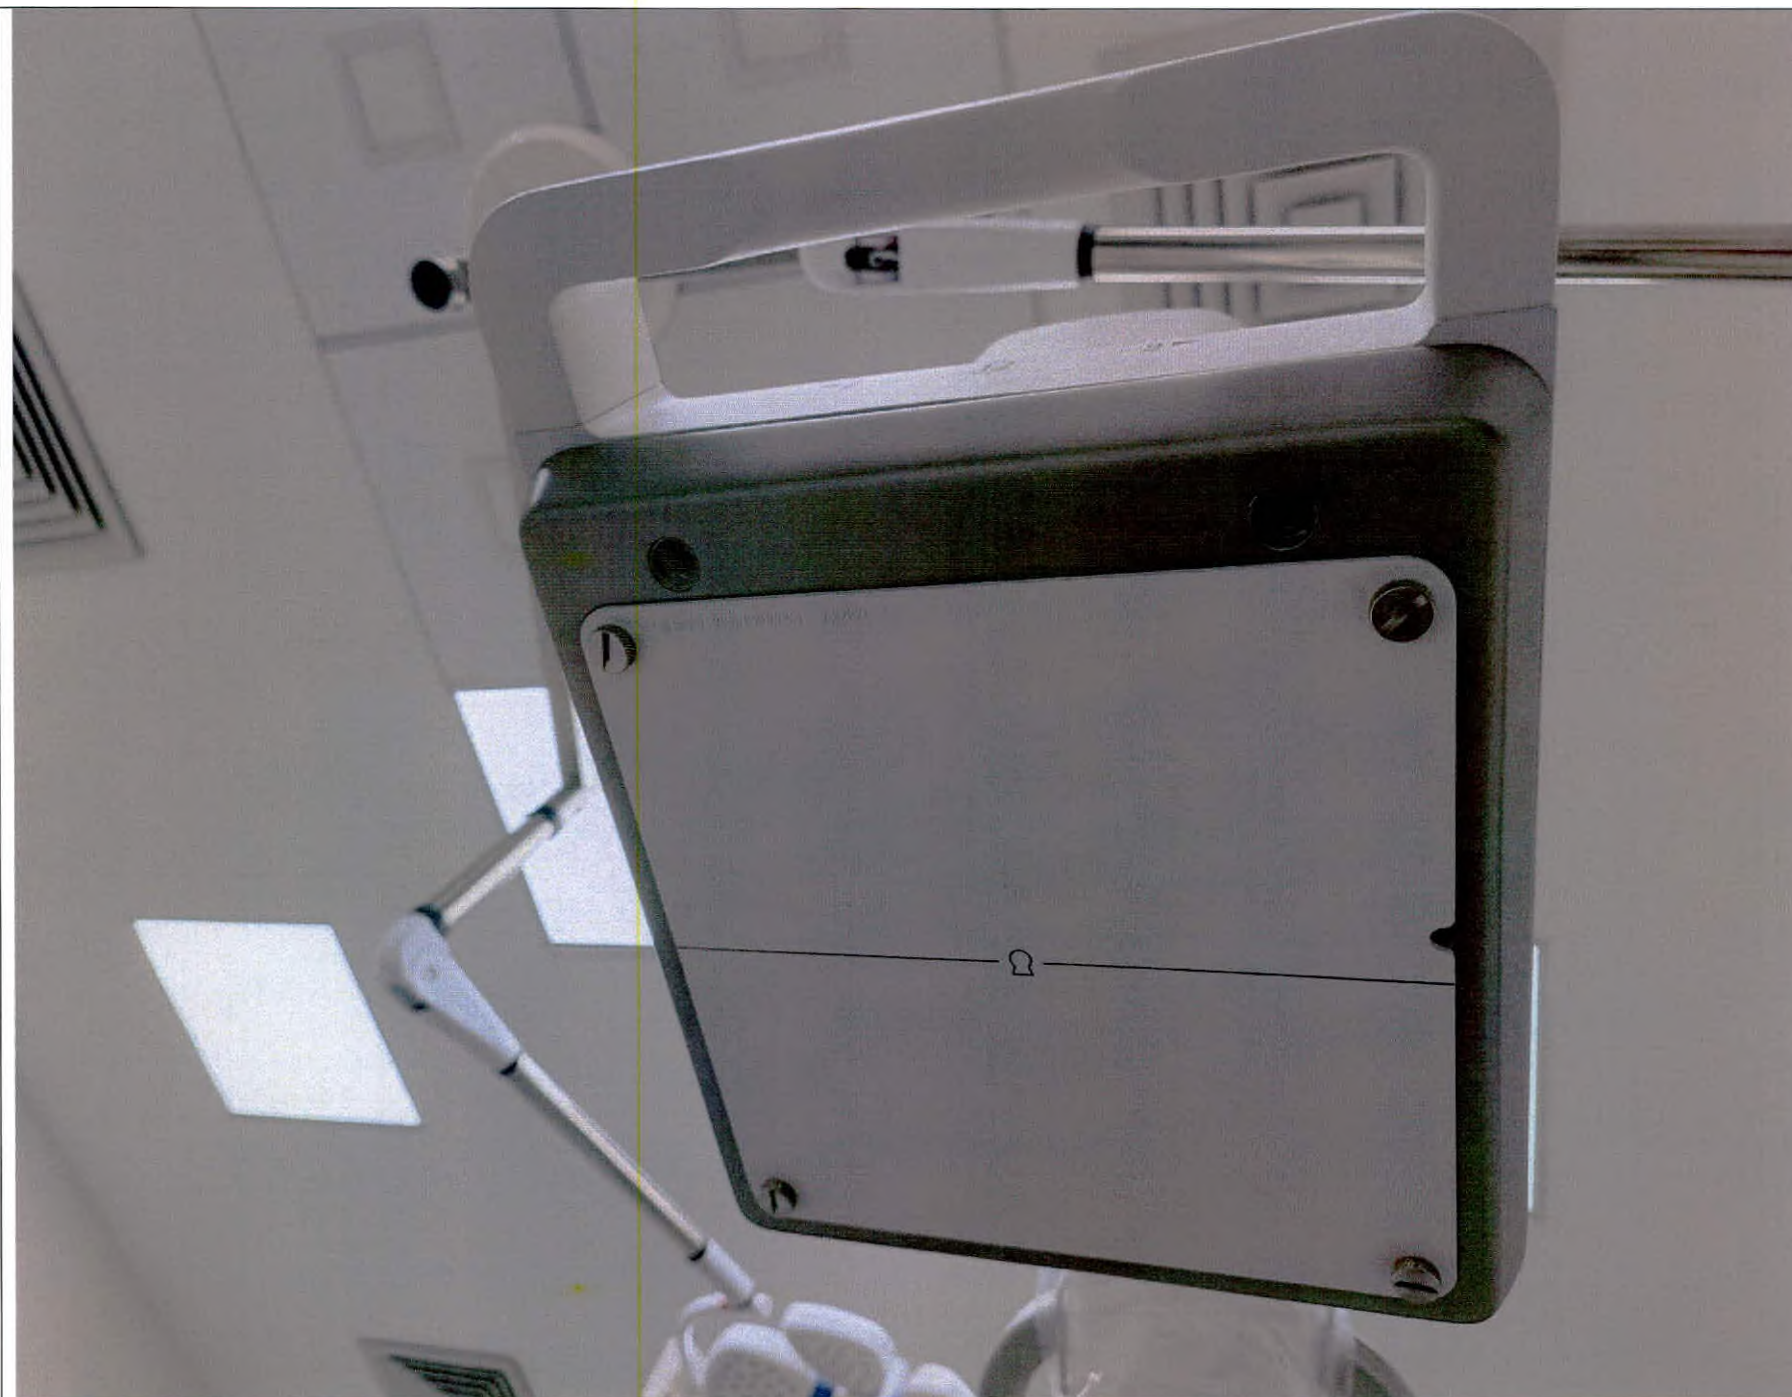


3.b) Лазерный прицел детектора.



4. Медицинский принтер Sony UP-971AD.

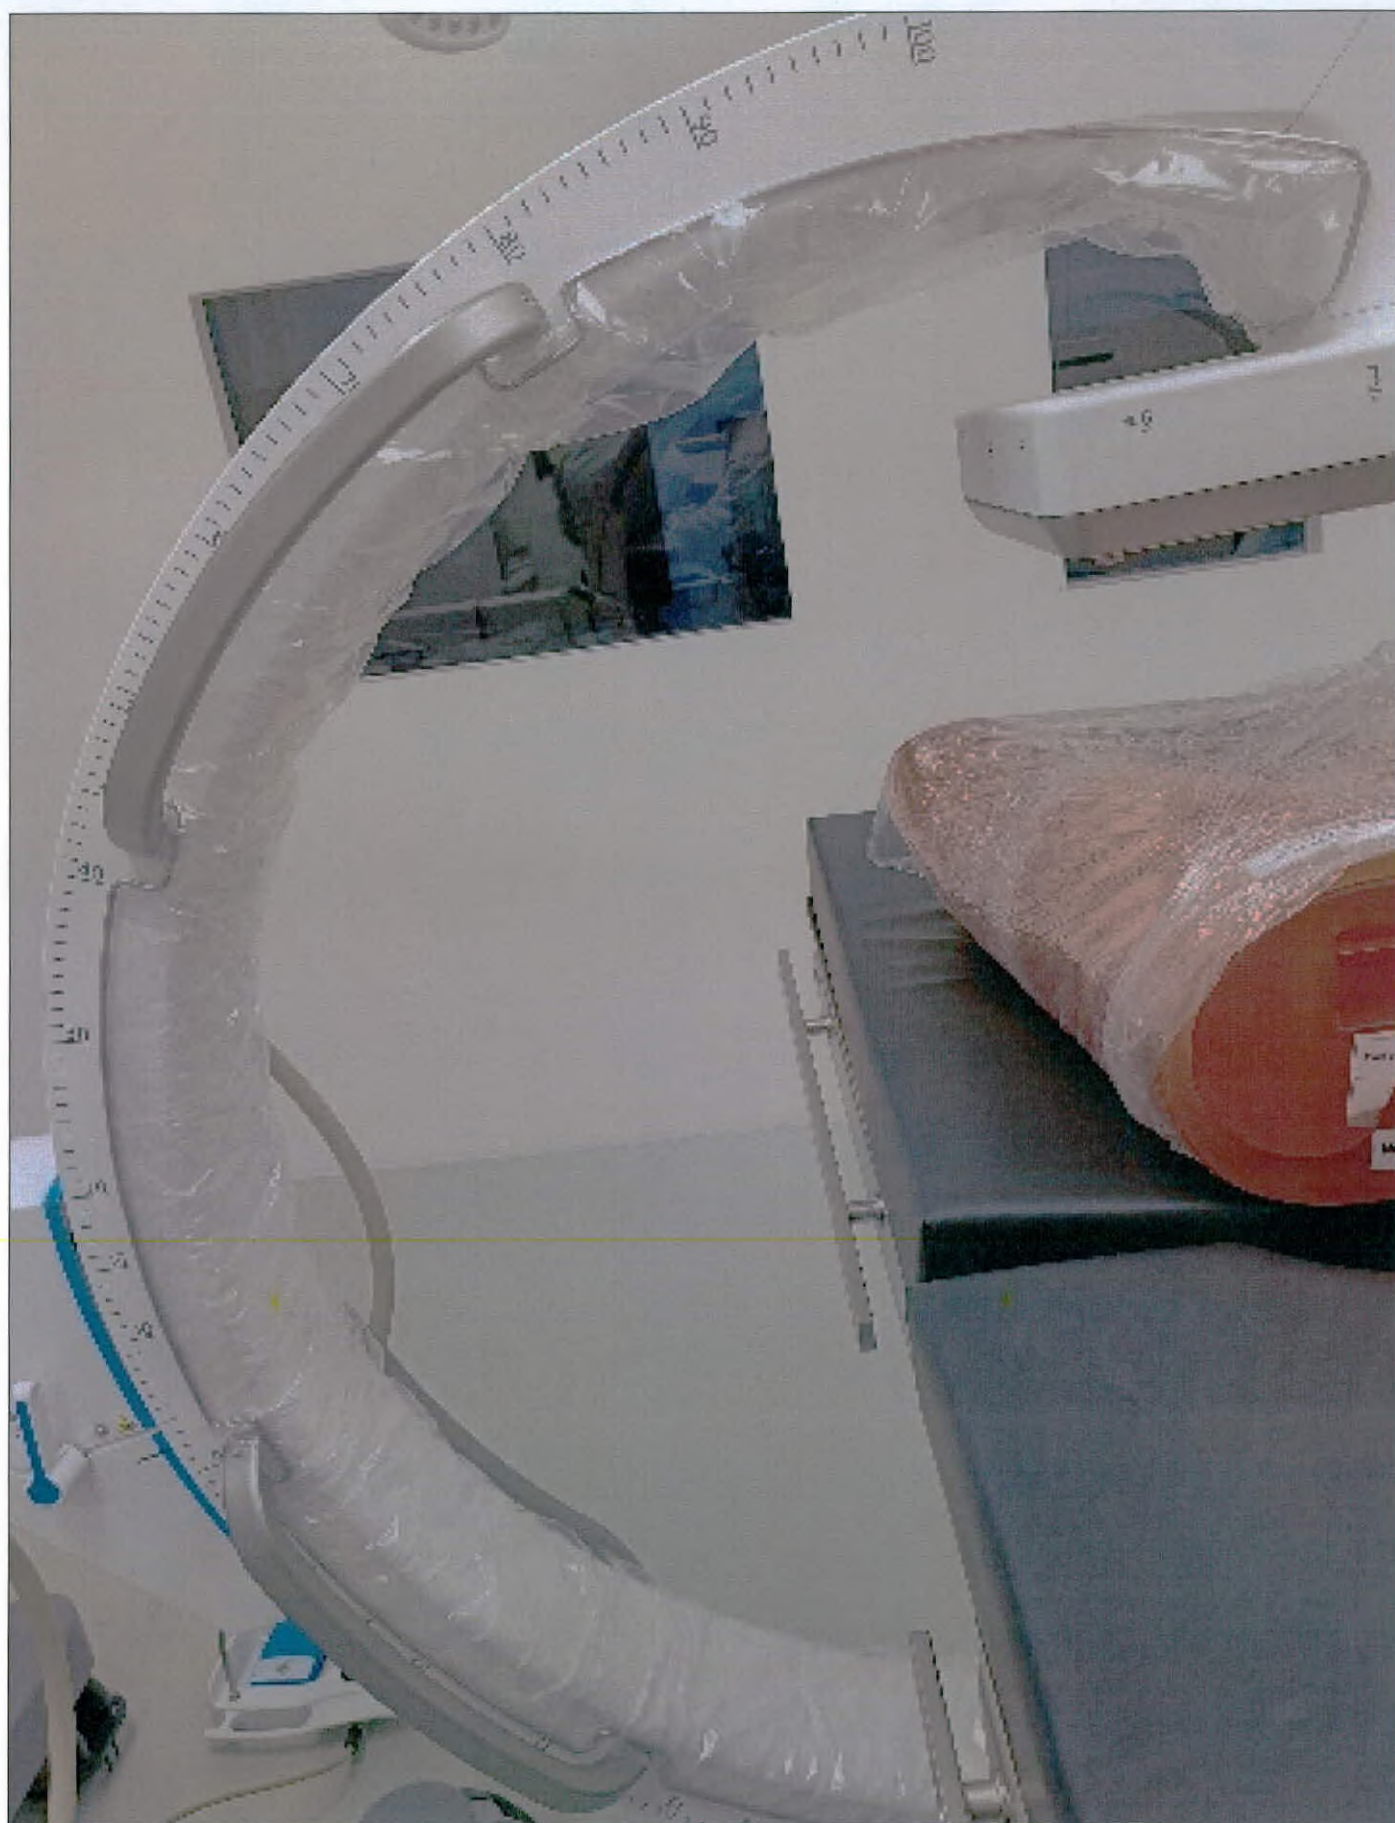

5. Подпружиненная дуга для чехлов С-дуги.

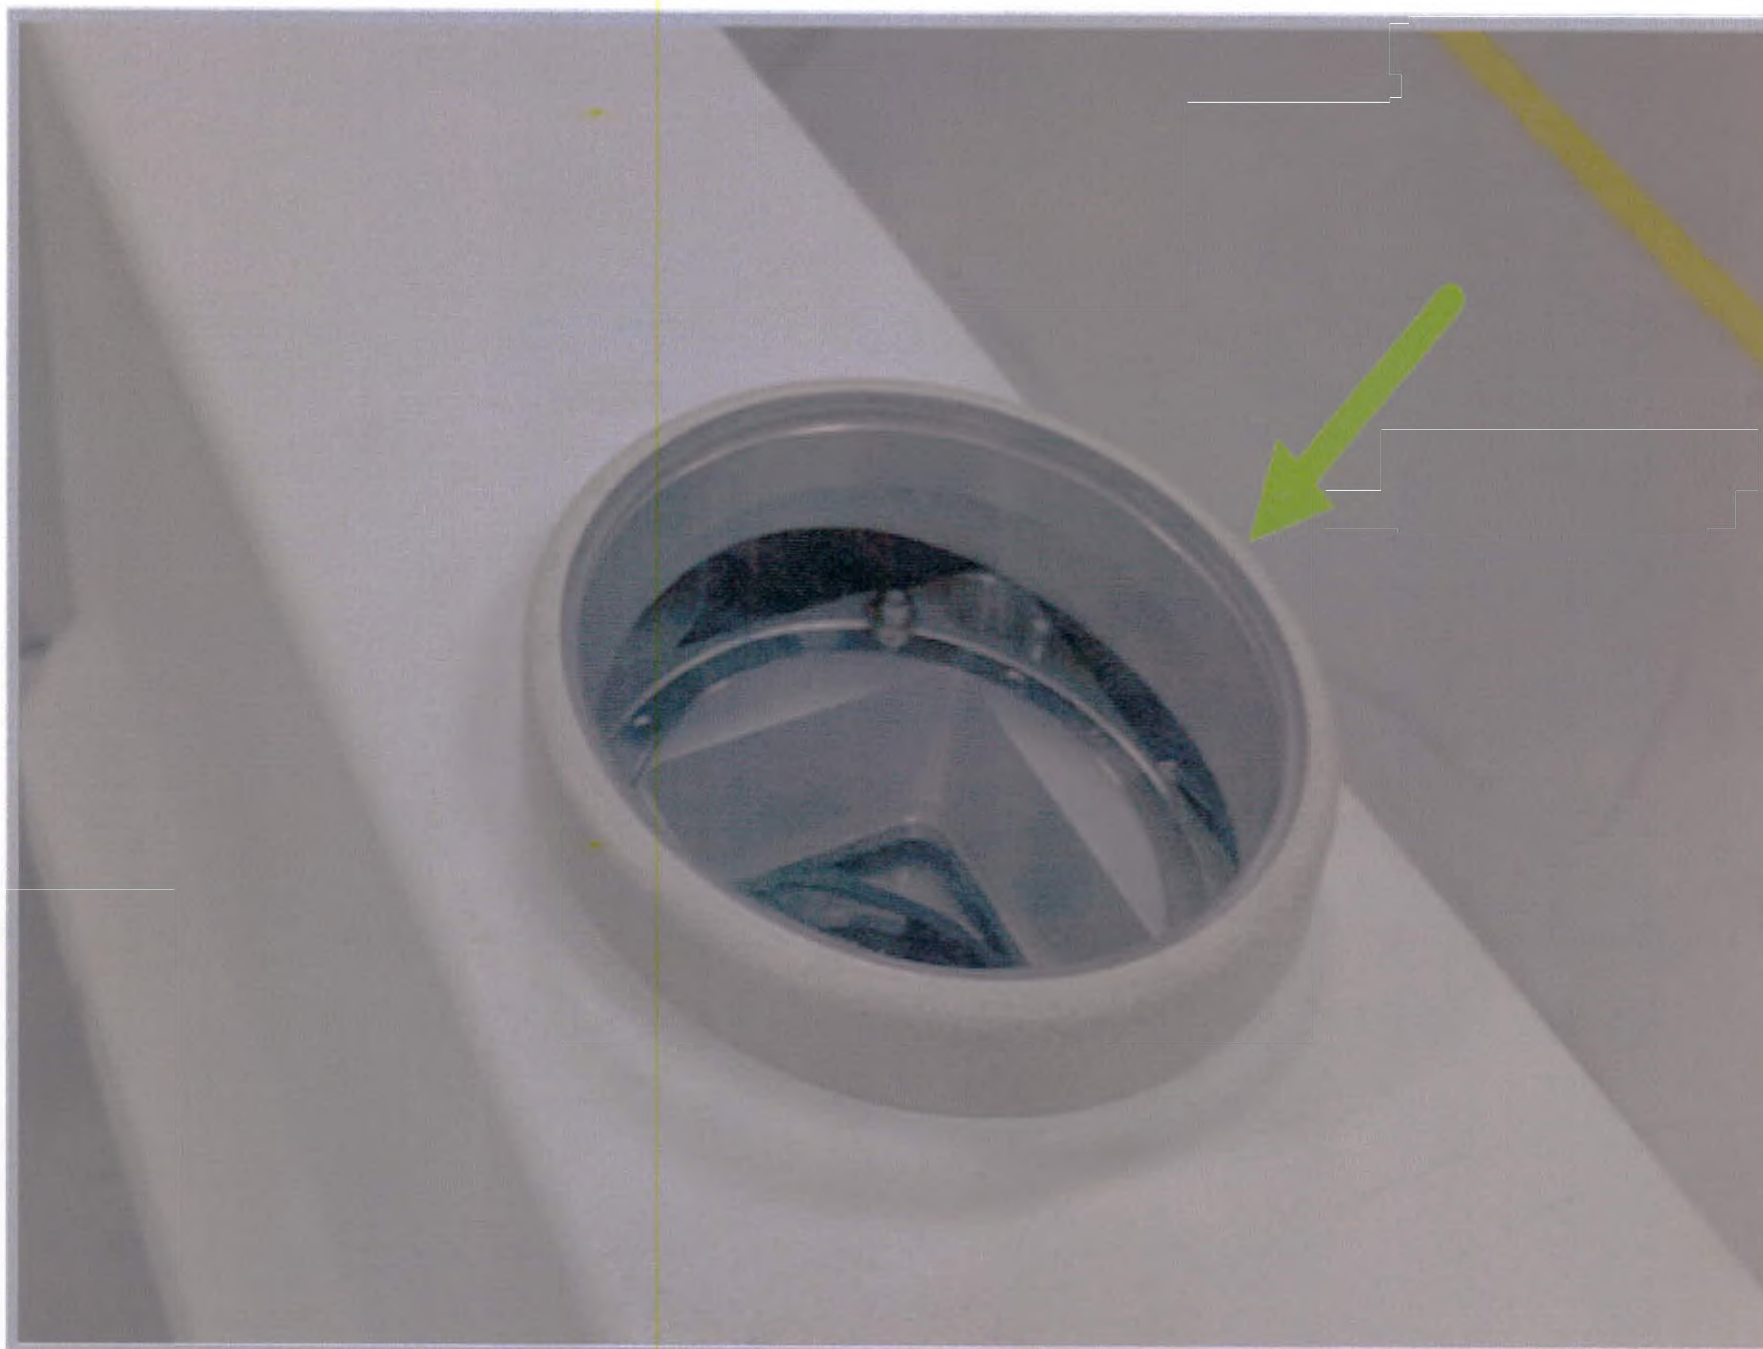

6. Насадка размером 30 см и/или 20 см.




7. а) Чехлы тканевые.



7. b) Чехлы тканевые.



7. с) Чехлы тканевые.

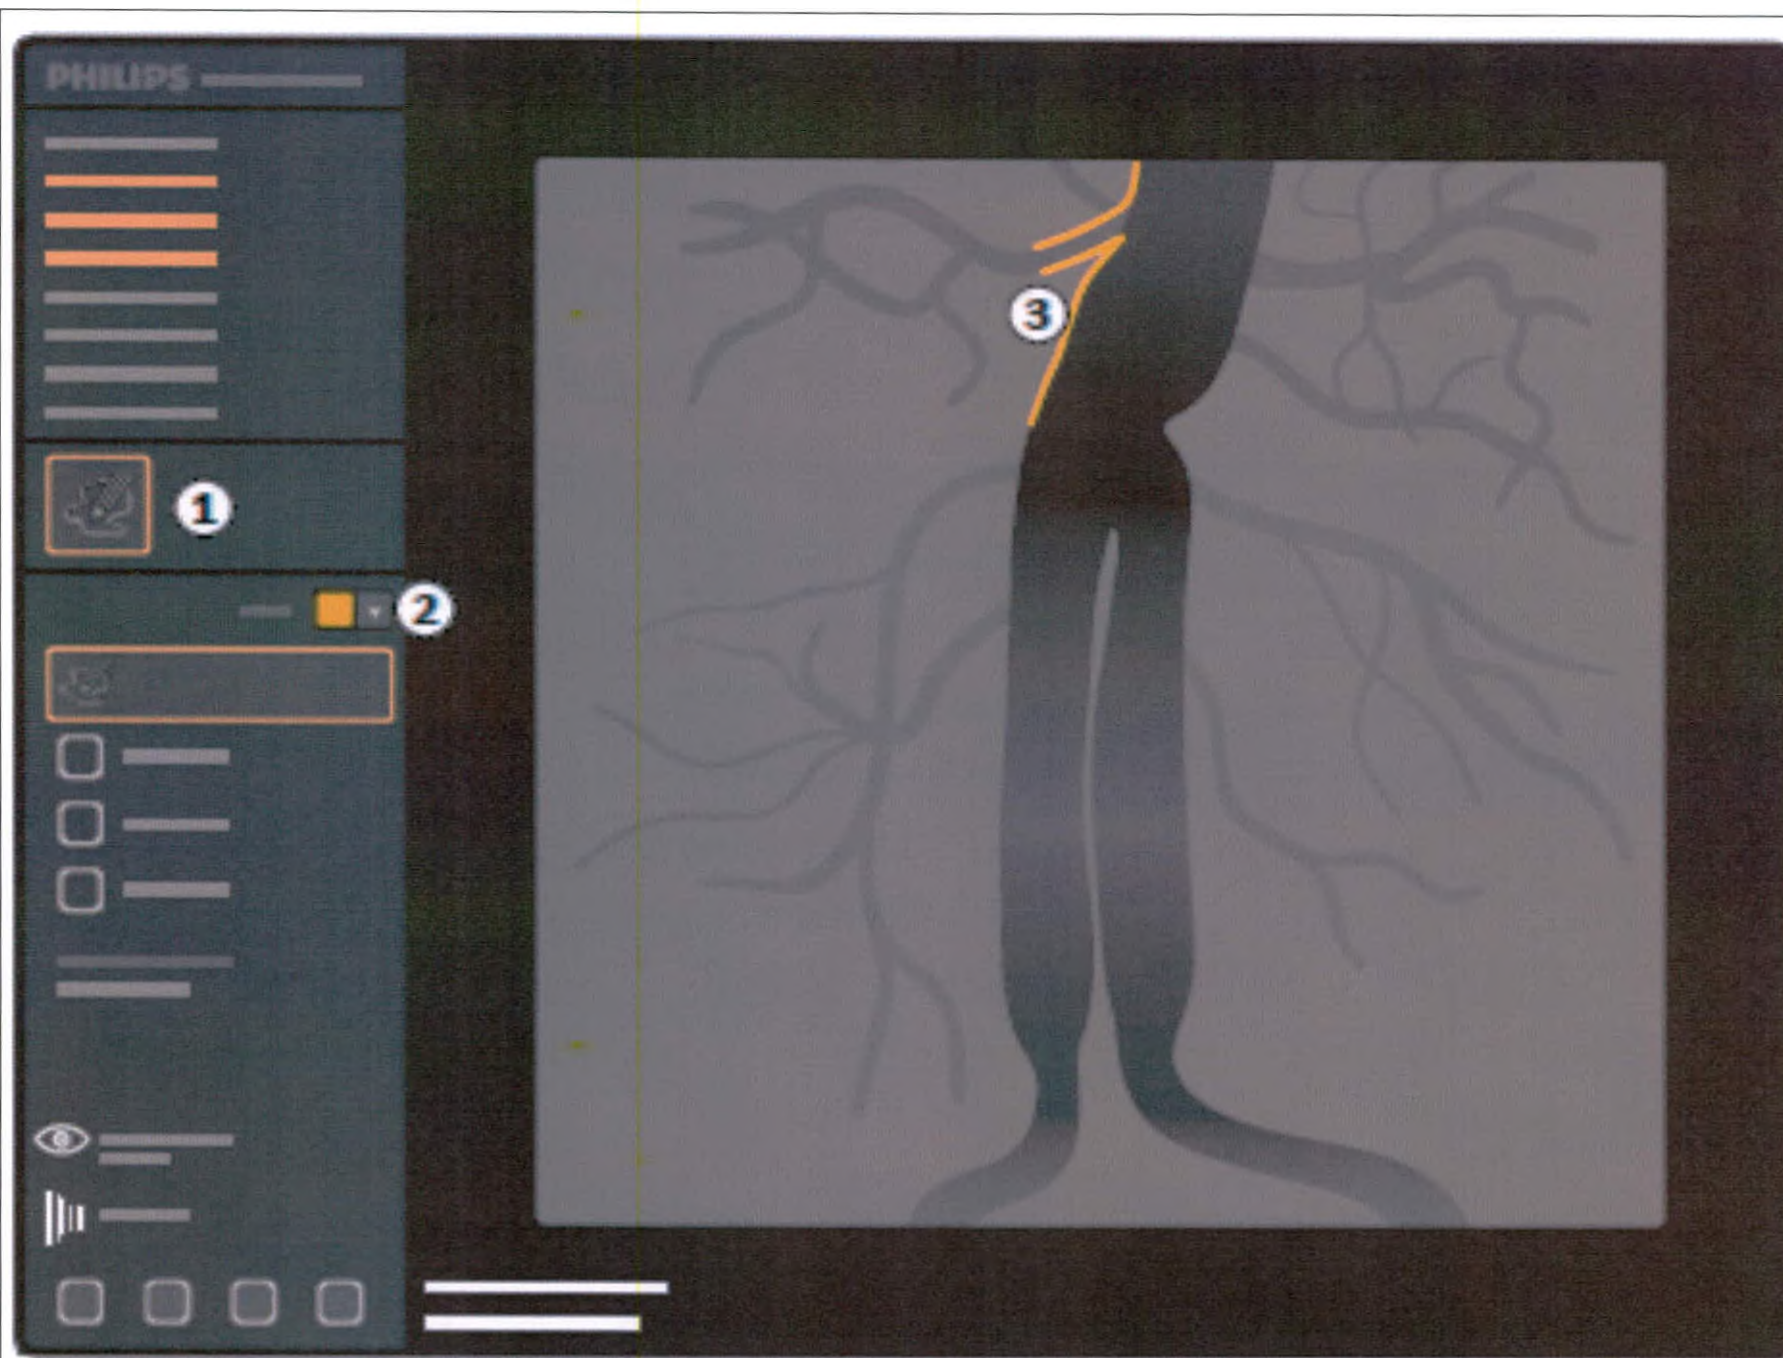

8. Модули программные. (8.1 Модуль программный: Инструмент очерчивания; 8.2 Модуль программный: Расширенное исследование болевого синдрома; 8.3 Модуль программный: Расширенная визуализация сосудов; 8.4 Модуль программный: Средство просмотра Multi-Modality Viewer; 8.5 Модуль программный: Дети)



8. Модули программные. (8.1 Модуль программный: Инструмент очерчивания; **8.2 Модуль программный: Расширенное исследование болевого синдрома**; 8.3 Модуль программный: Расширенная визуализация сосудов; 8.4 Модуль программный: Средство просмотра Multi-Modality Viewer; 8.5 Модуль программный: Дети)



8. Модули программные. (8.1 Модуль программный: Инструмент очерчивания; 8.2 Модуль программный: Расширенное исследование болевого синдрома; **8.3 Модуль программный: Расширенная визуализация сосудов**; 8.4 Модуль программный: Multi-Modality Viewer; 8.5 Модуль программный: Дети)




9. Лицензия DICOM.




10. Блок для сохранения и передачи данных.




11. Модуль сохранения на DVD-диск DICOM.

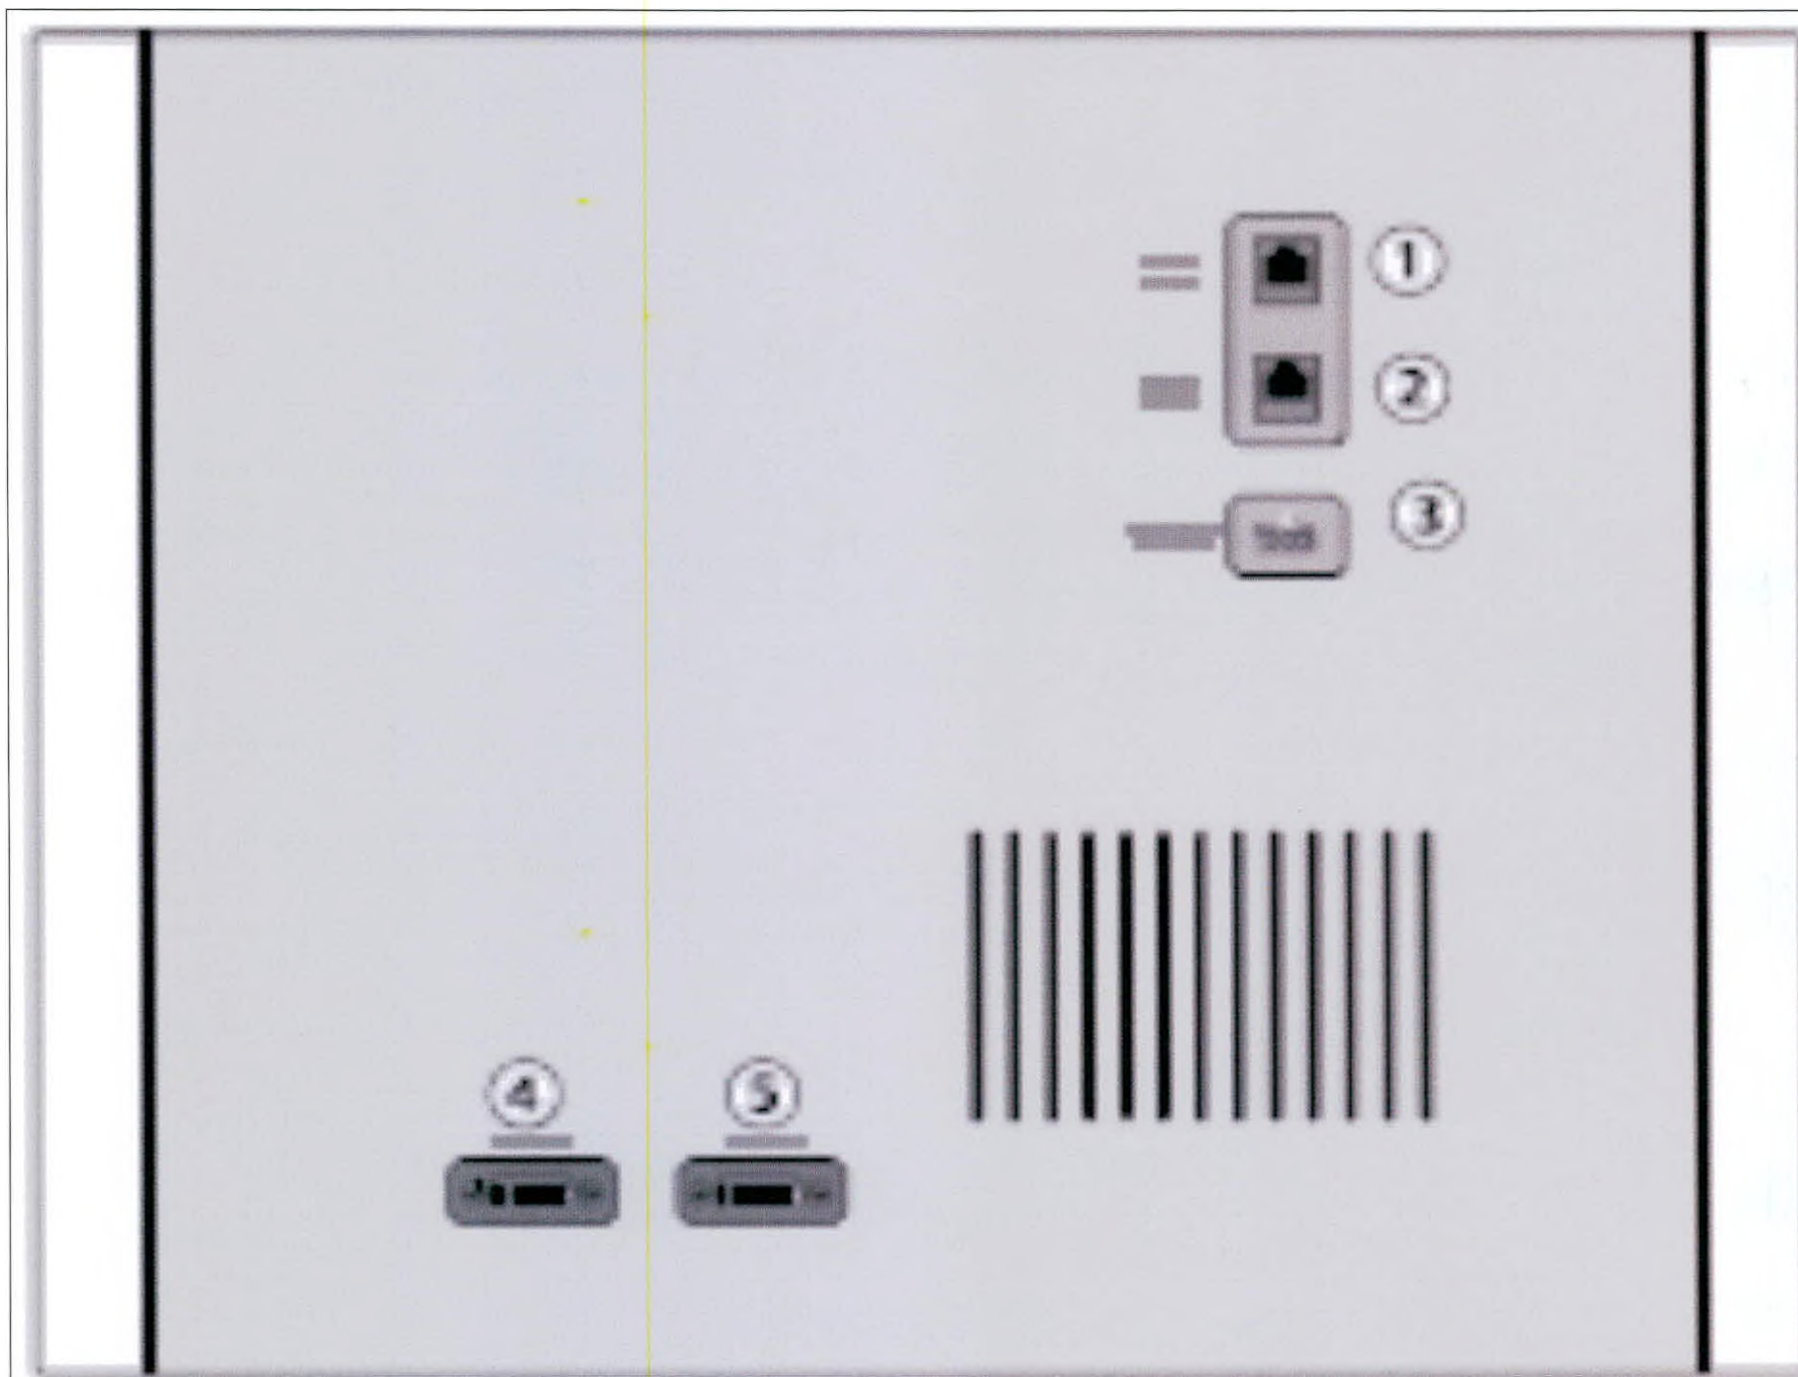

12. а) Вывод DVI.

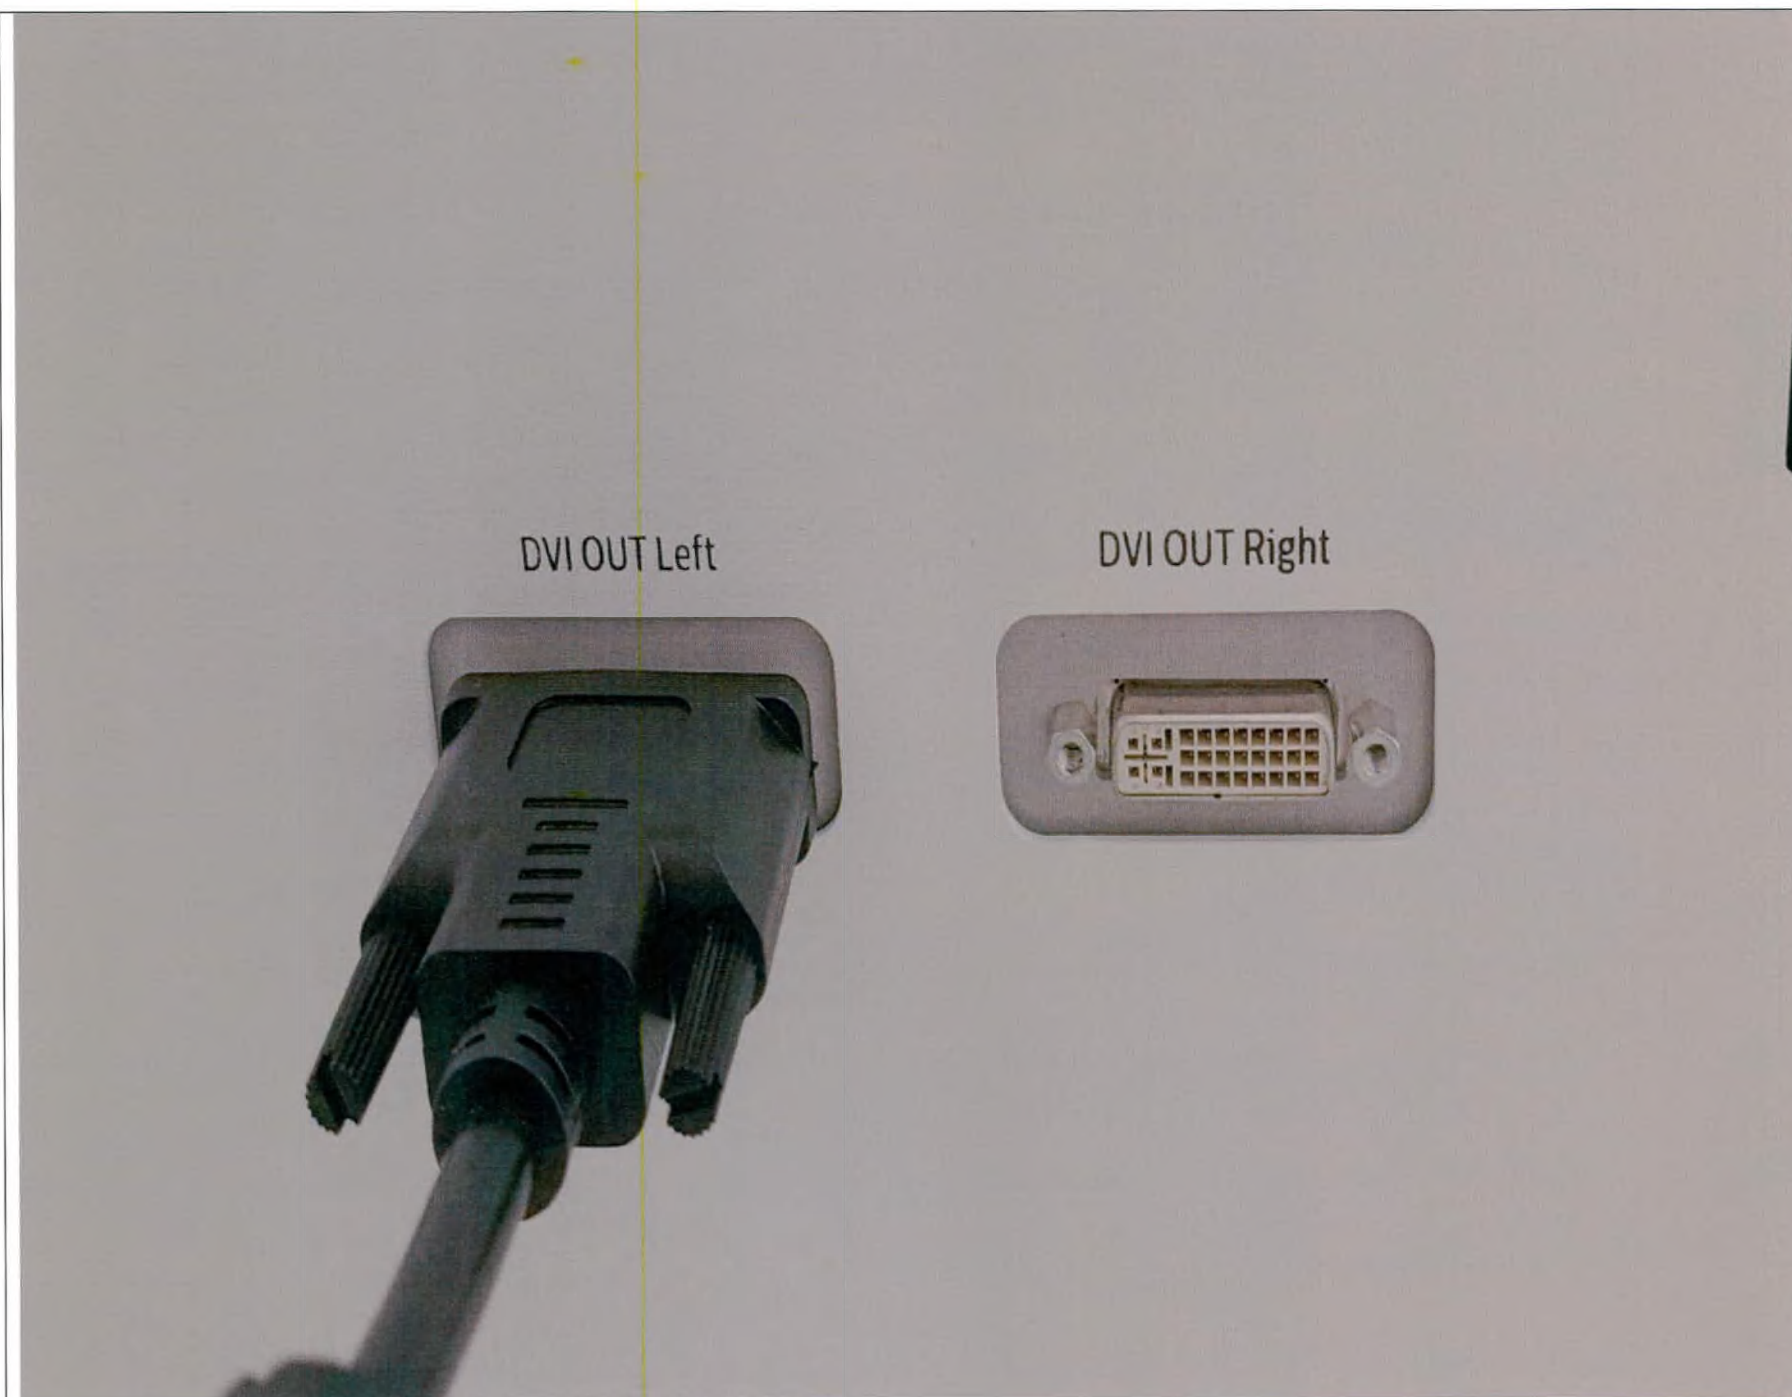


12. b) Видеовыход DVI.

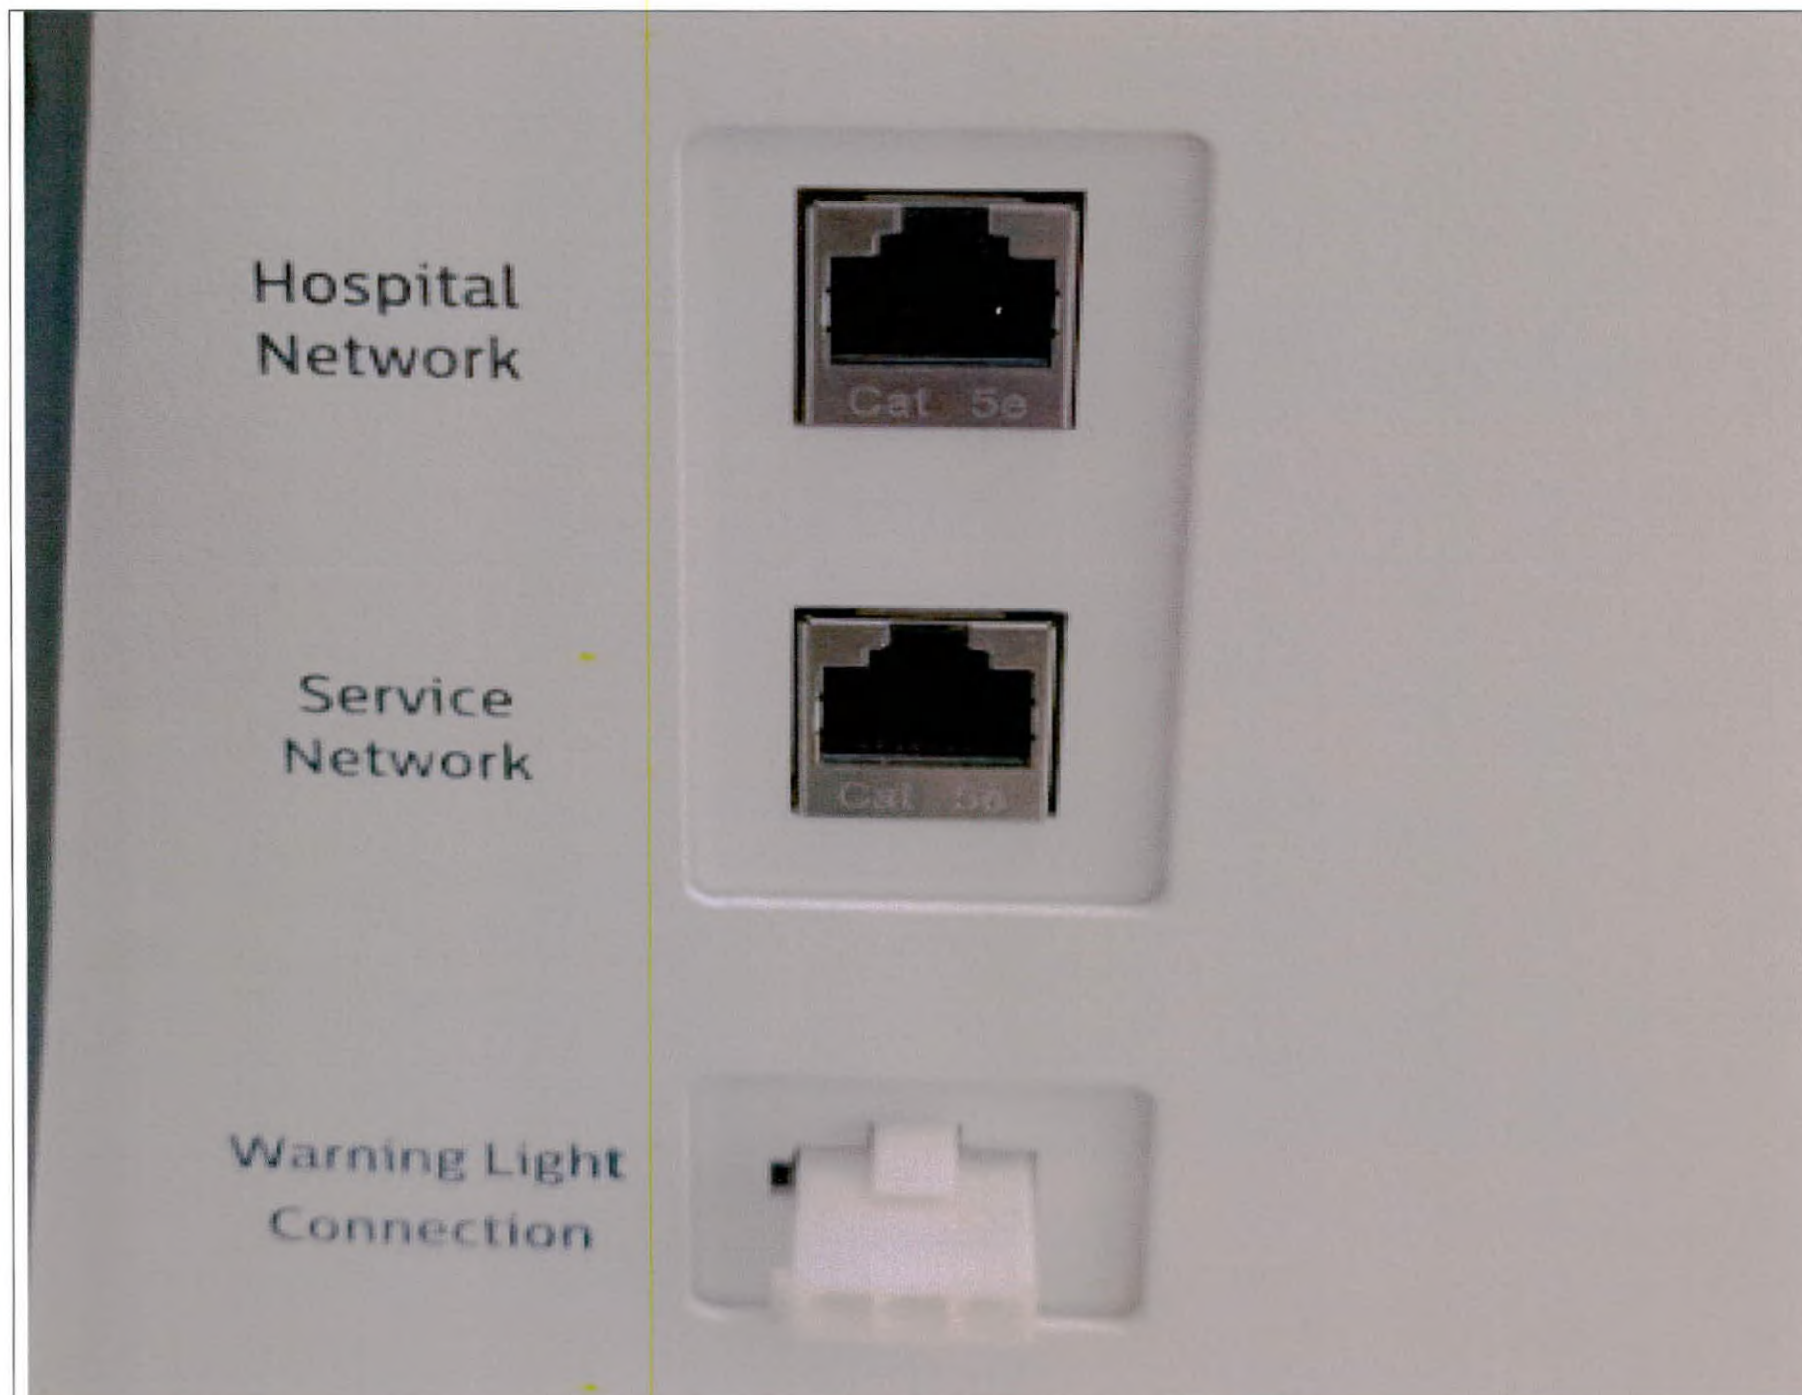

12. с) Видеовыход DVI.

Упаковка:

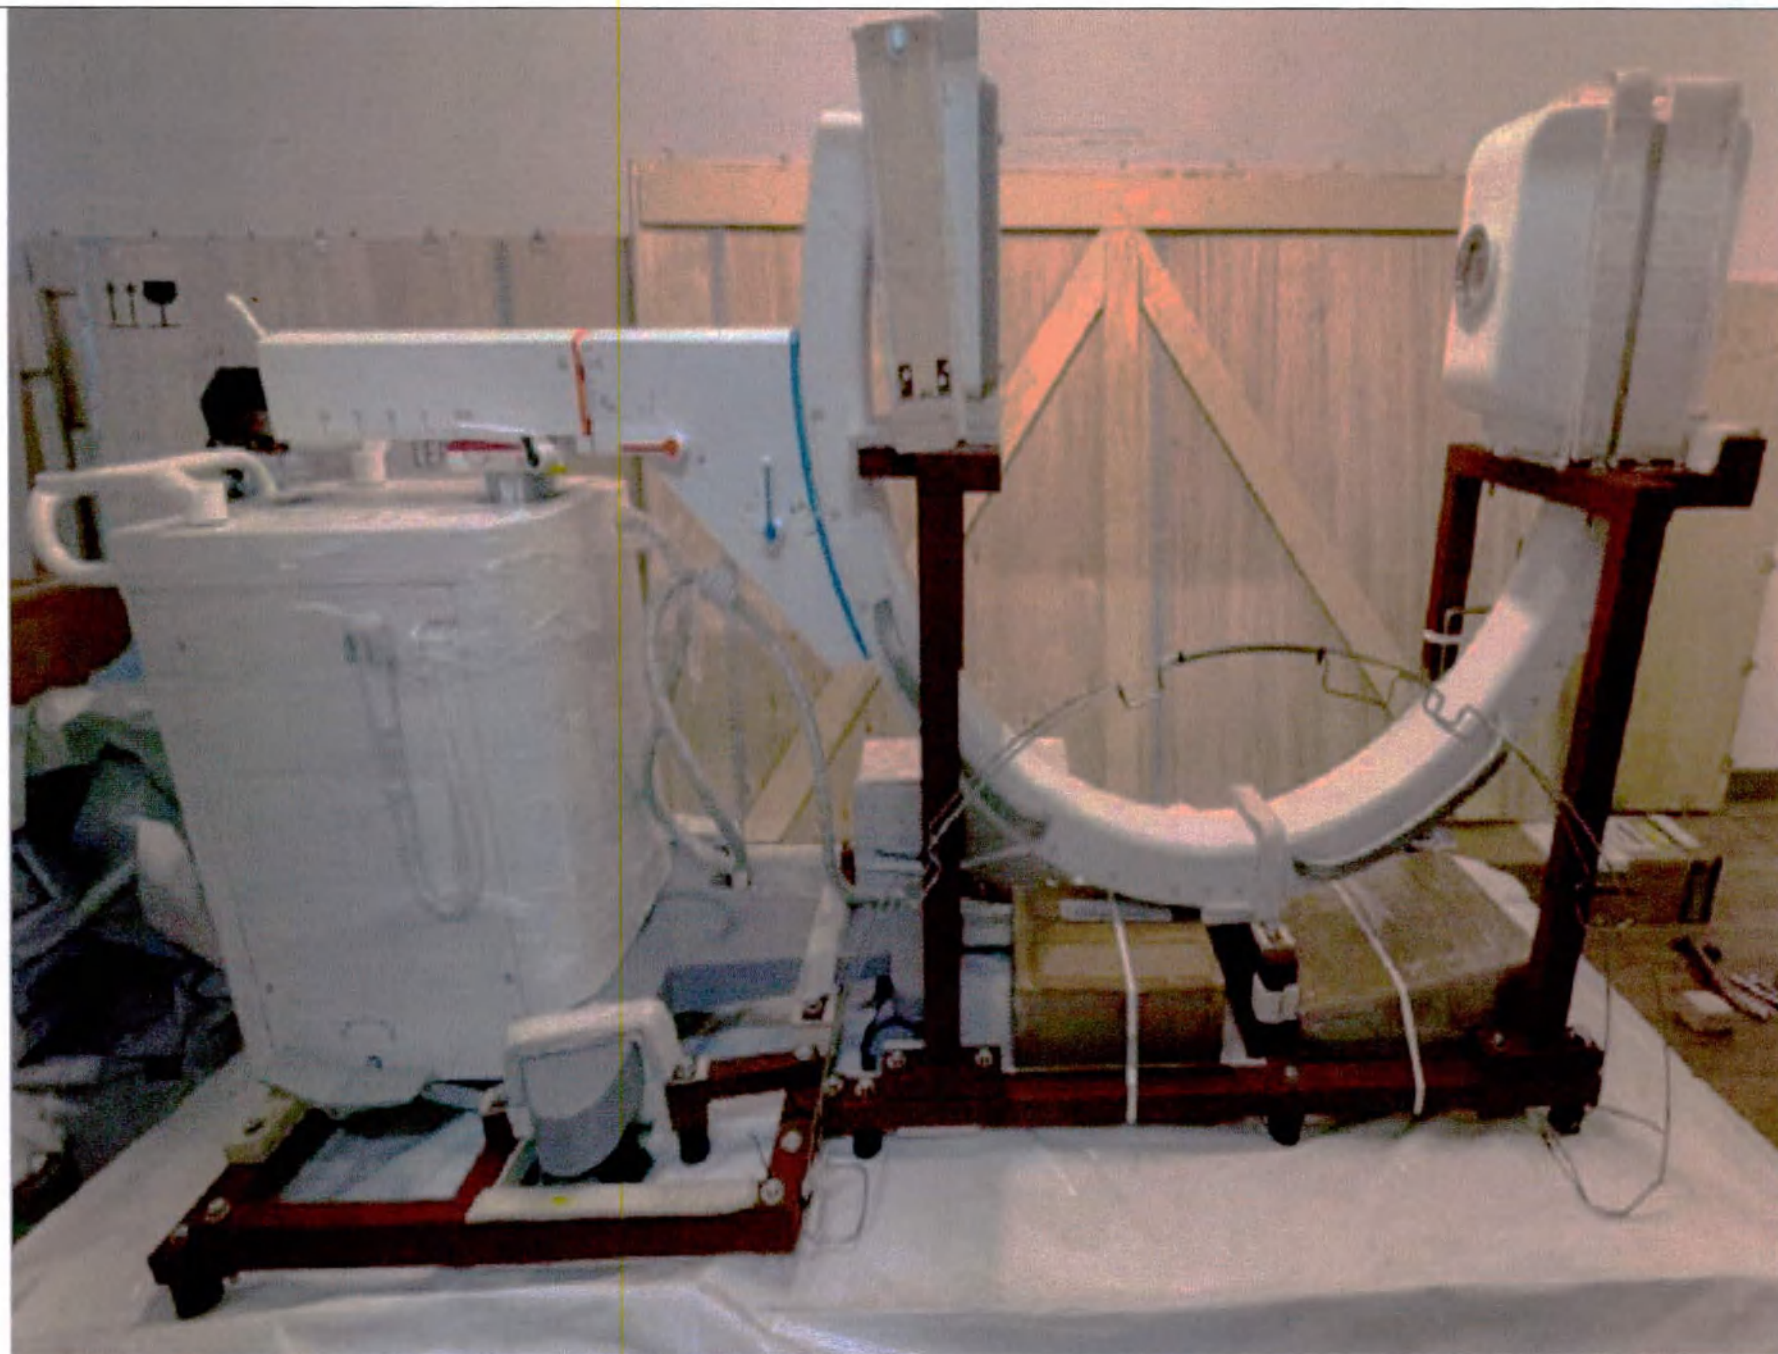

1. Пример расположения стойки С-дуги на поддоне




2. а) Накрытие алюминиевой фольгой и оборачивание пластиковой пленкой после процедуры вакуумизации




2. б) Накрытие алюминиевой фольгой и оборачивание пластиковой пленкой после процедуры вакуумизации



3. а) Деревянный ящик со стойкой С-дуги.

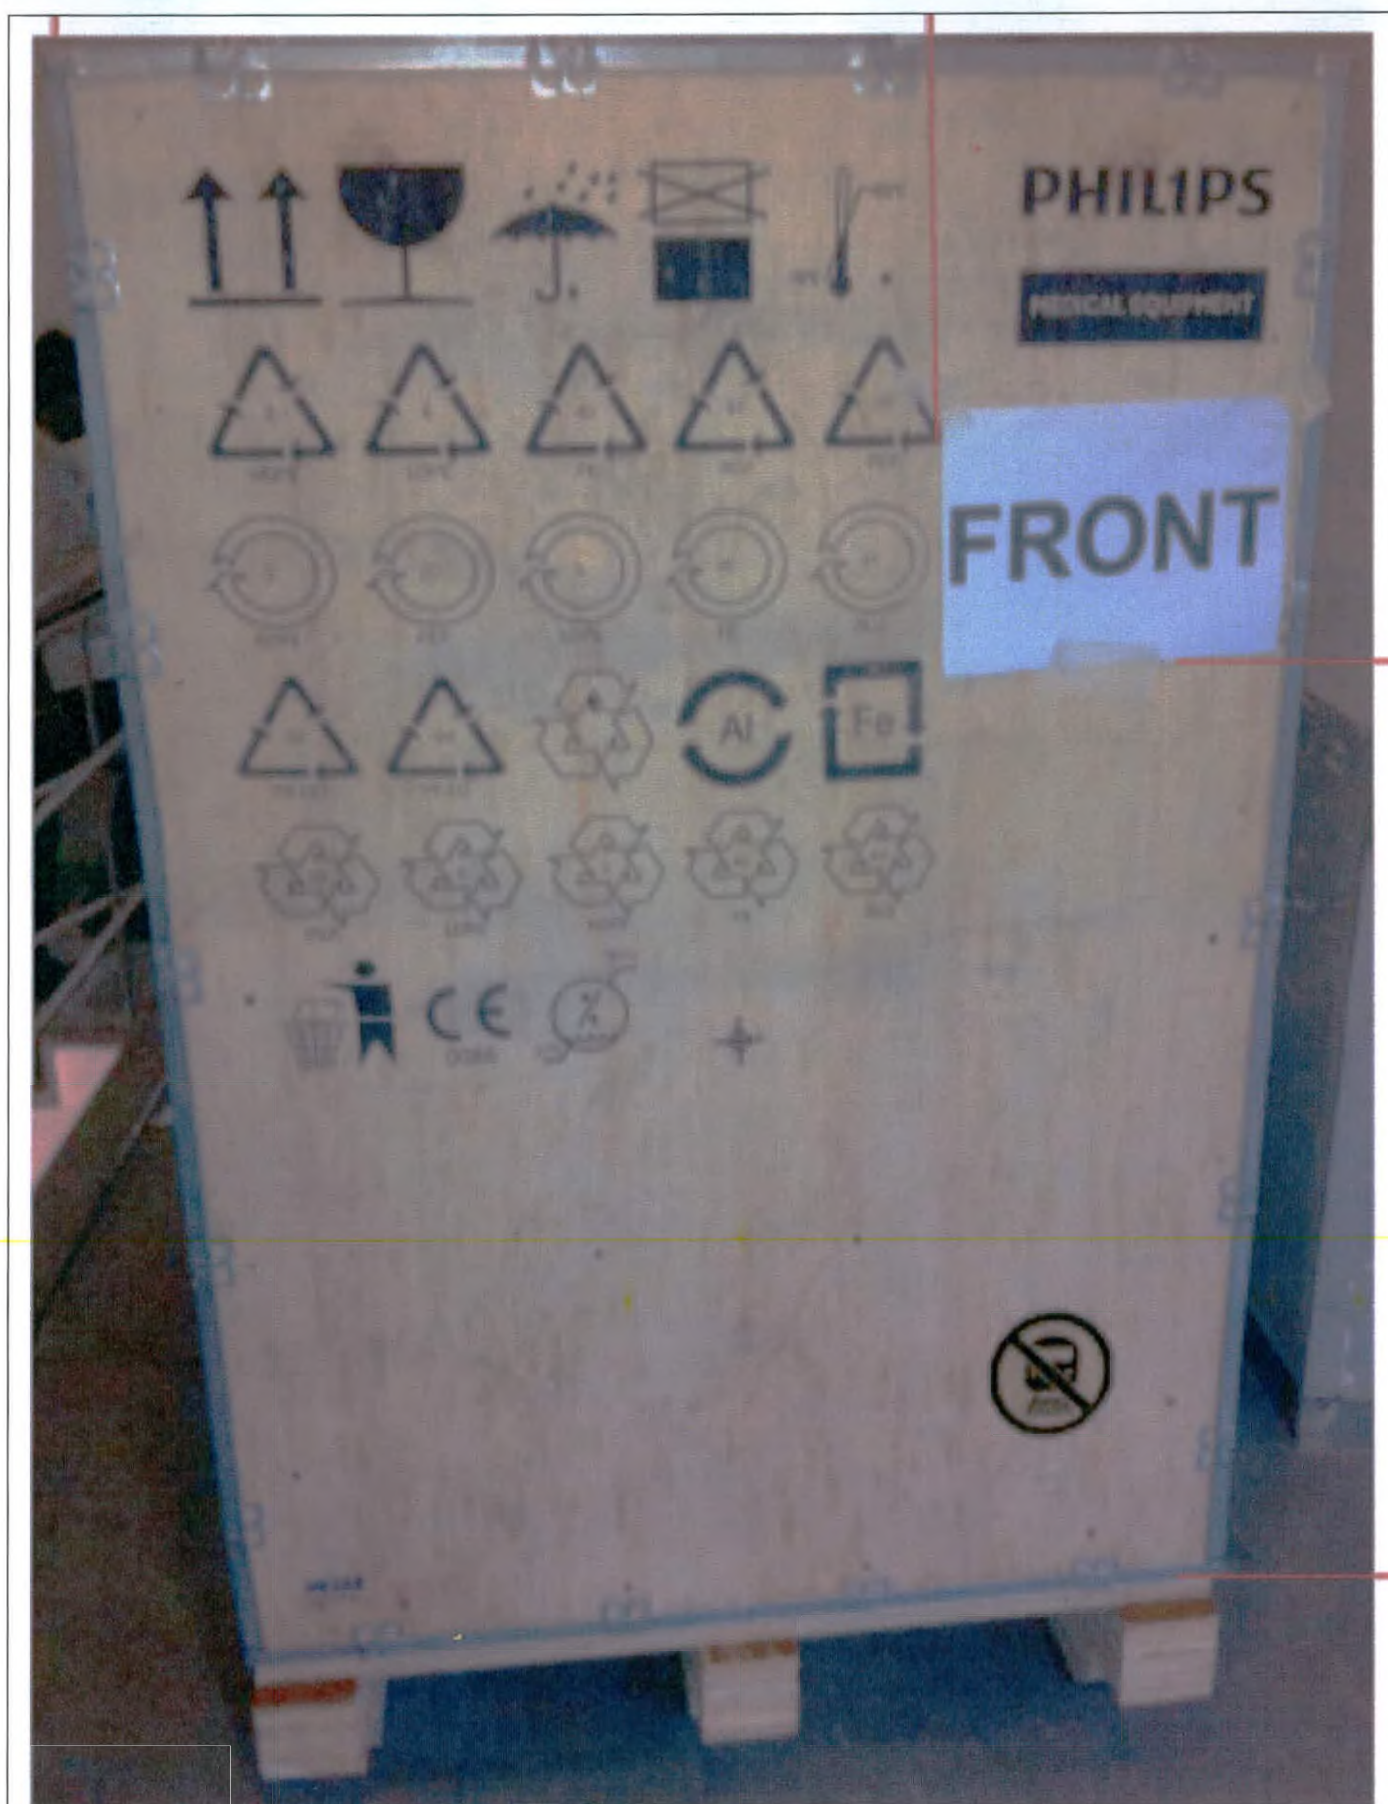

3. b) Деревянный ящик со стойкой С-дуги.

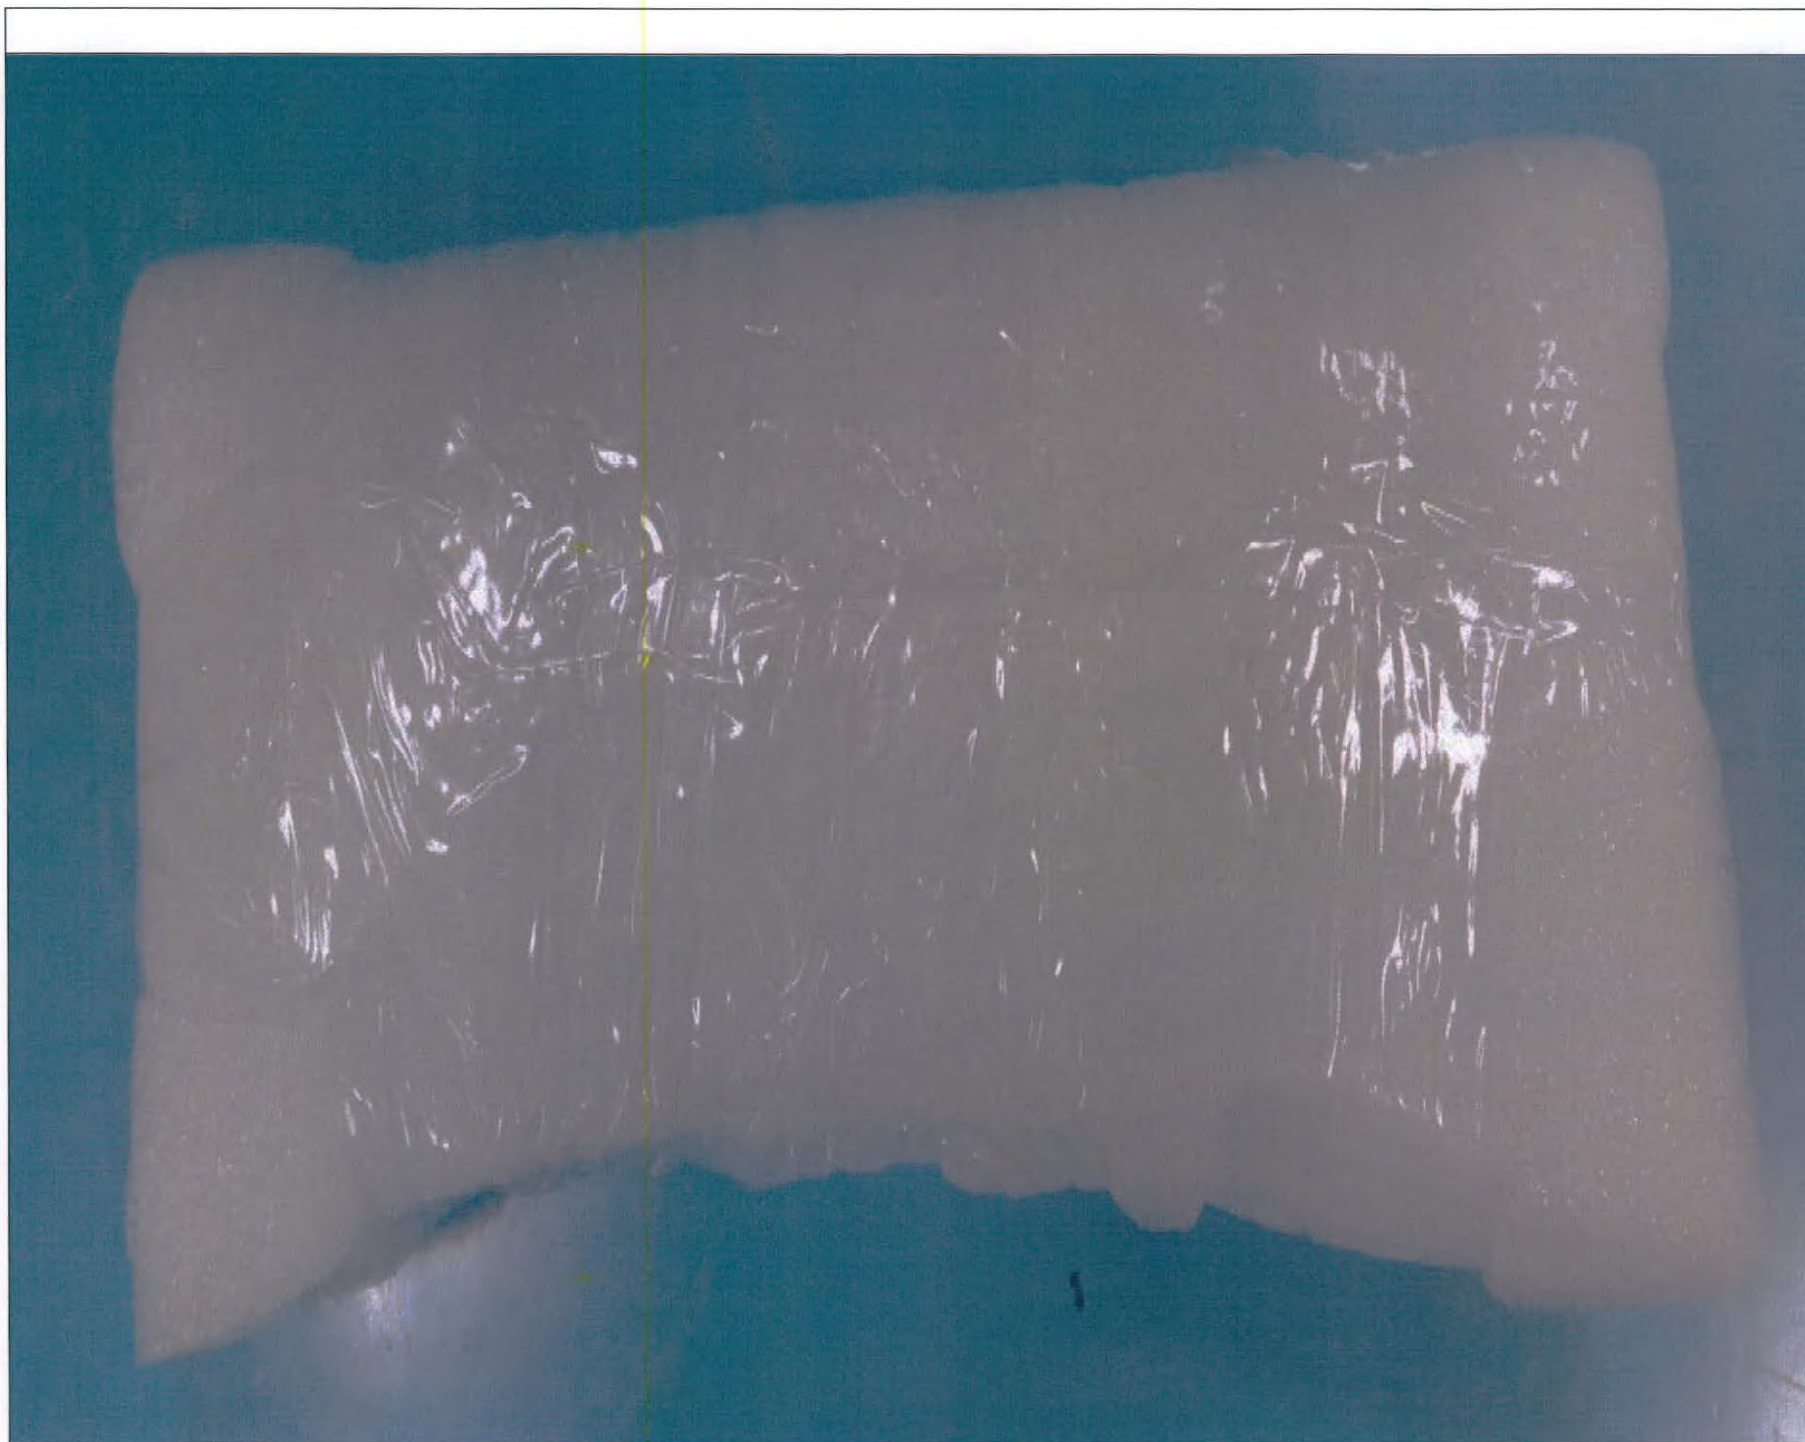



4. б) Упаковка пульта дистанционного контроля.



5. Коробка с принадлежностями.



6. а) Процесс упаковывания передвижной станции просмотра




6. b) Процесс упаковывания передвижной станции просмотра



6. с) Процесс упаковывания передвижной станции просмотра



7. Накрытие алюминиевой фольгой и оборачивание пластиковой пленкой после процедуры вакуумизации передвижной станции просмотра

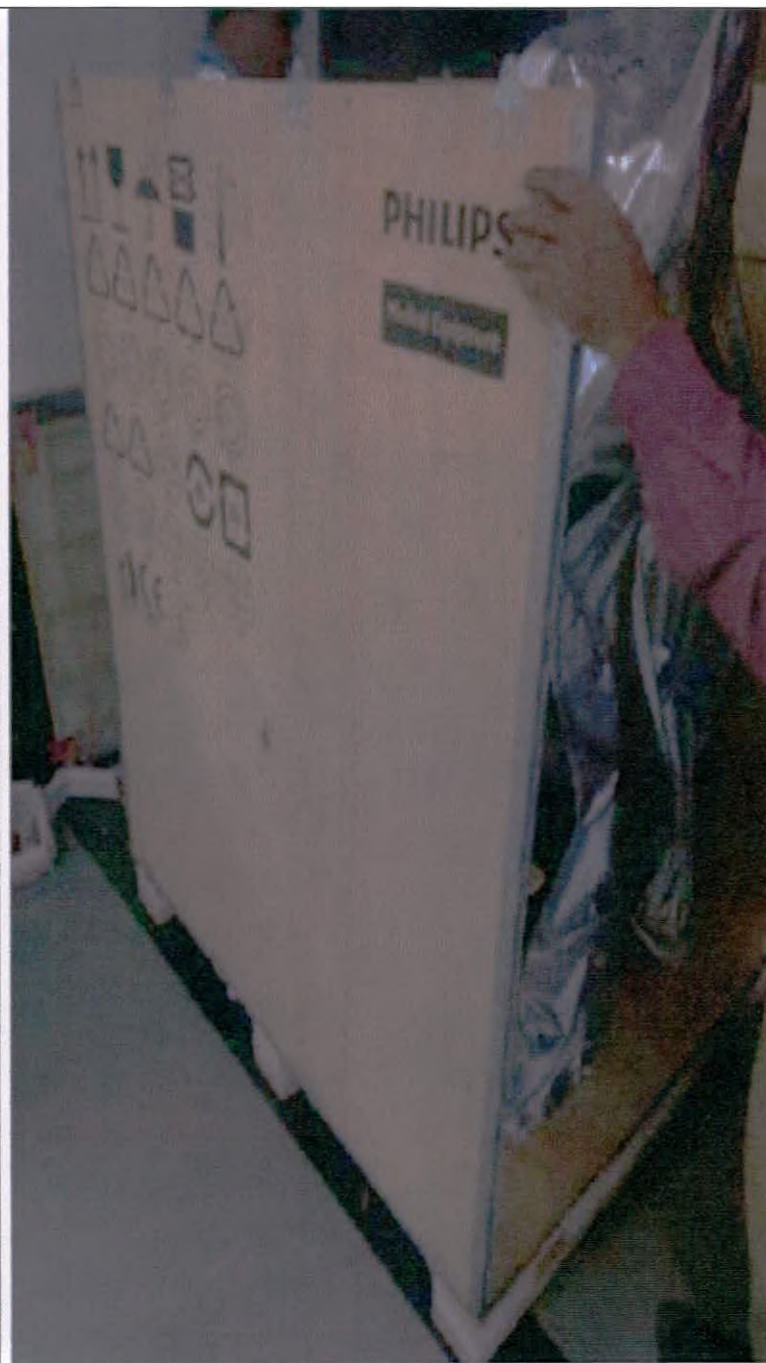

8. а) Деревянный ящик с передвижной станцией просмотра

Маркировка:



Zenition 10



Philips Medical Systems
Nederland B.V. Veenpluis 6
5684 PC Best The Netherlands
YYYY-MM-DD

CE 0344

Manufactured by : Philips India limited
Plot no. B-79, MIDC, Phase II
Chakan, Taluka - khed, Village - Savardari,
District: Pune 410501, Maharashtra, India

UDI



MD


(01) 00884838107205 (21) XXXXXXXXX

REF

718401

PN

718401



SN

XXXXXXXXXX

Made in India

Mains Rating

Momentary

Long Time

Max. (Ω)

ON : XXXXXX

100 / 110V~

30 A

15 A

0.1

120 / 127V~

28 A

14 A

0.2

220 / 230 / 240V~

20 A

10 A

0.6

Frequency - 50 / 60Hz Single phase

AERB TA NO. : 22-TA-828276



www.philips.com/doc_library



Rx only

4598 018 09241

Маркировка Zenition 10

Медицинское изделие: Zenition 10

Описание:

Система флюороскопическая рентгеновская
передвижная цифровая Zenition 10



Производитель:

«Филипс Медикал Системс Нидерланд Б.В.»

Нидерланды

Veenpluis 6, 5684 PC Best, The Netherlands

Место производства:


Филипс Индия Лимитед, Индия

Plot no. B-79, MIDC, Phase-II, Chakan

Taluka - khed, Village – Savardari


District: Pune Maharashtra, 410501, India

REF: 718401

Серийный номер: см. маркировку на английском языке 

Дата производства: см. маркировку на

английском языке



Основные технические характеристики:



Меры предосторожности:




Регистрационное удостоверение: XXXXXXX

4598 018 09721

Макет маркировки на русском языке

RAFI

RAFI GmbH & Co. KG
Ravensburger Str.
128 - 134
D-88276 Berg
Germany

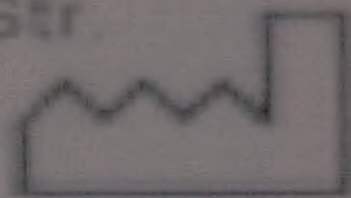


2019 - 11

Type 459801120601

REF	3.97.000.186/0000
SN	19RH000418

Viewpad MOS

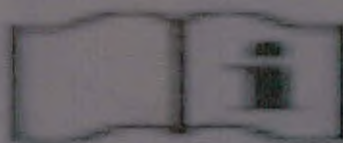

2x LR06 (AA)

IP X2



Макет маркировки пульта дистанционного управления.



BLAU

OPTOELEKTRONIK



FP-L-635-10-34-Philips-V2-C2 - Pin1: Vcc.

Pin2: GND

3024930.BK0006471.1112



CLASS 1 LASER
DIN EN 60825-1:2014

$P \approx 10 \text{ mW}$

$\lambda = 635 \text{ nm}$

Макет маркировки лазерной безопасности на детекторе.

Model no. MKF 2 1PW/1PW-
MED GP26 PHILIPS


Manufactured for
Philips Medical Systems
Nederland B.V., by
Steute Schaltgeräte GmbH Co.KG
Brückenstraße 91
32584 Löhne/Germany



Wired Footswitch

REF 4598 012 82661

SN 20000684

 2020 - 05


Max Voltage 25VAC / 60 VDC
IPX8




® MC180133



Макет маркировки проводного ножного переключателя.

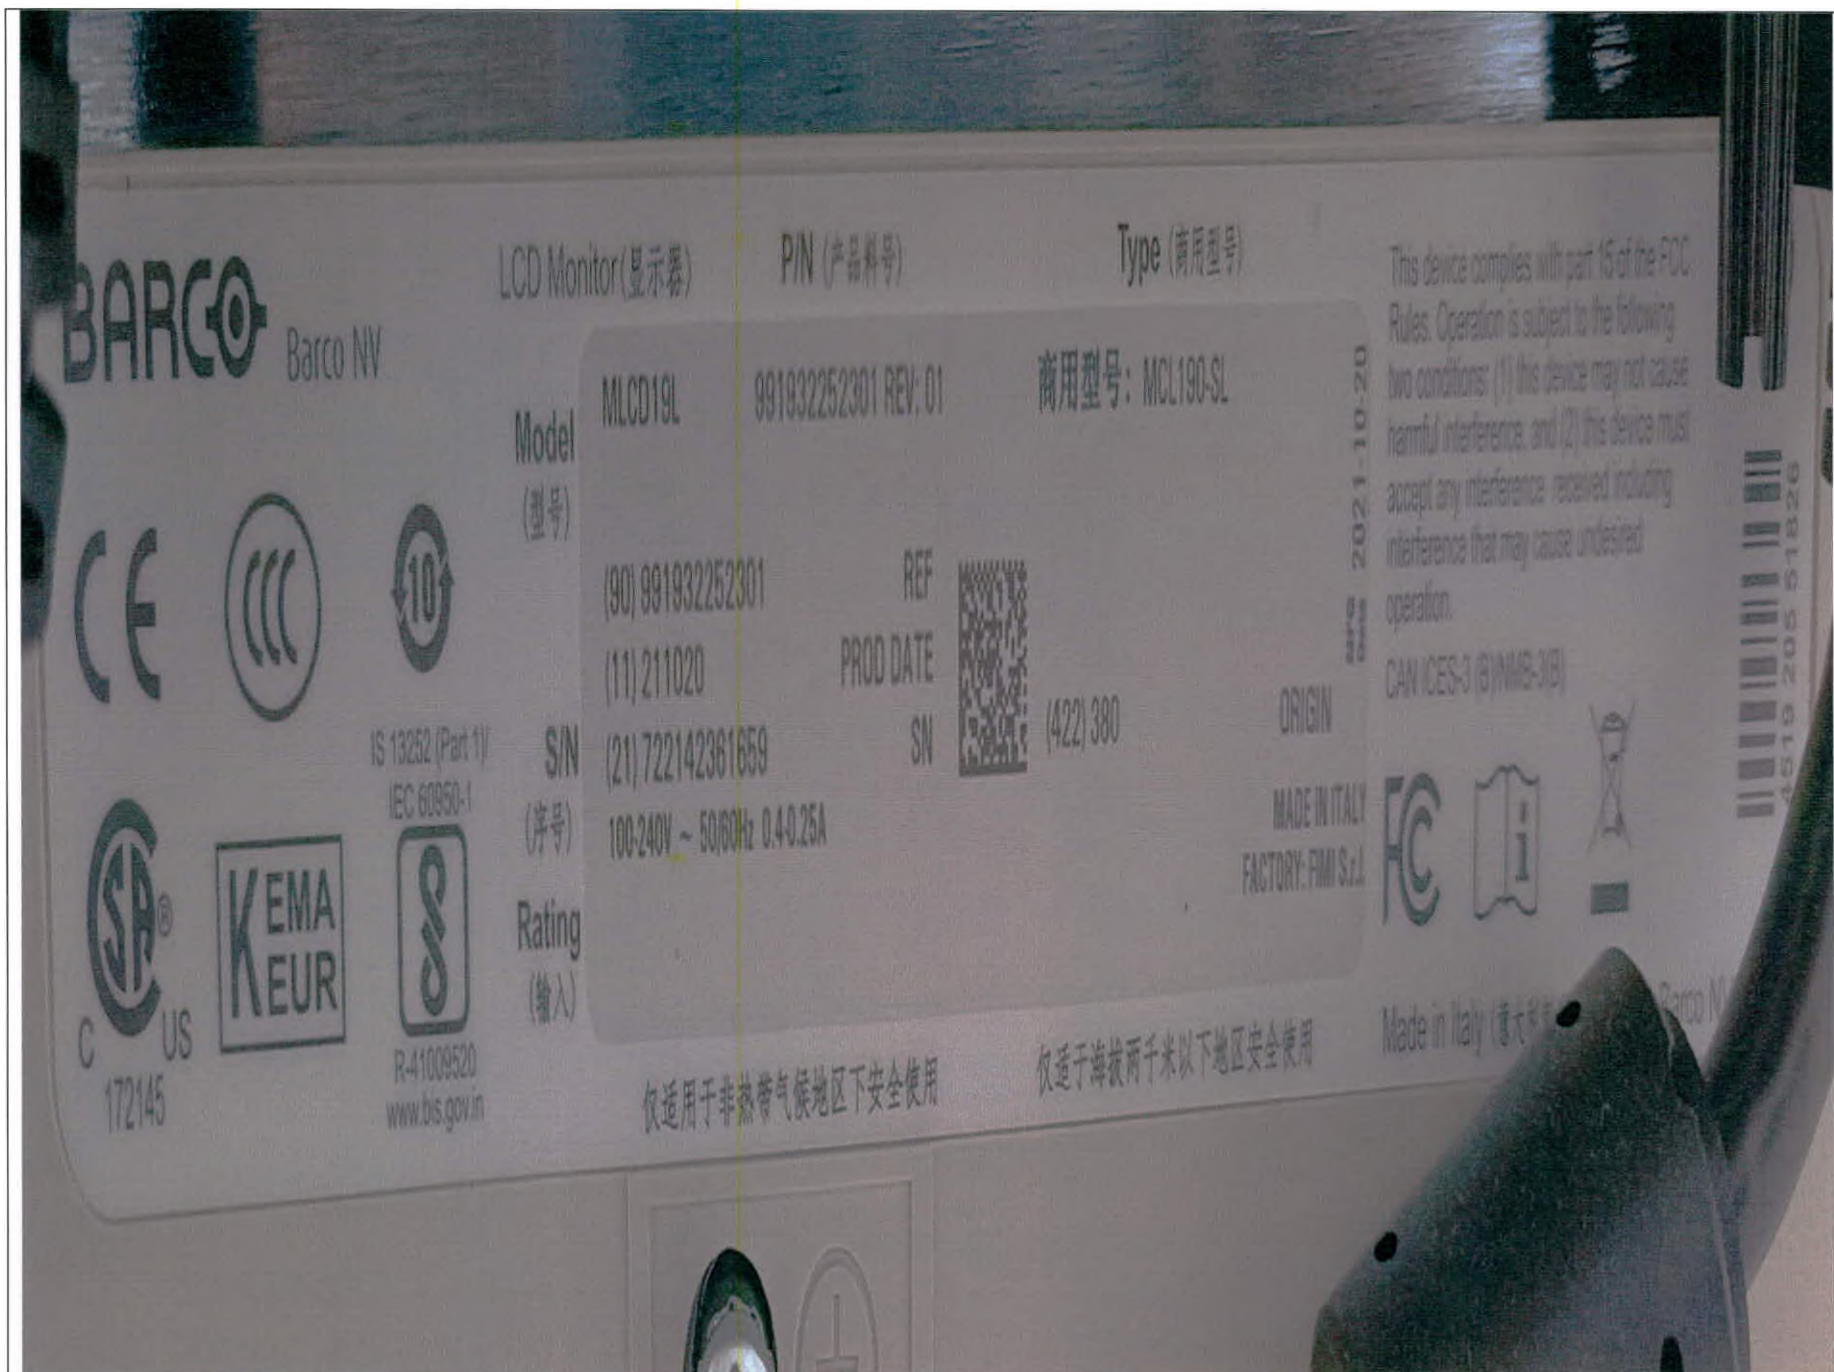

Макет маркировки монитора для исследований стандартной яркости.

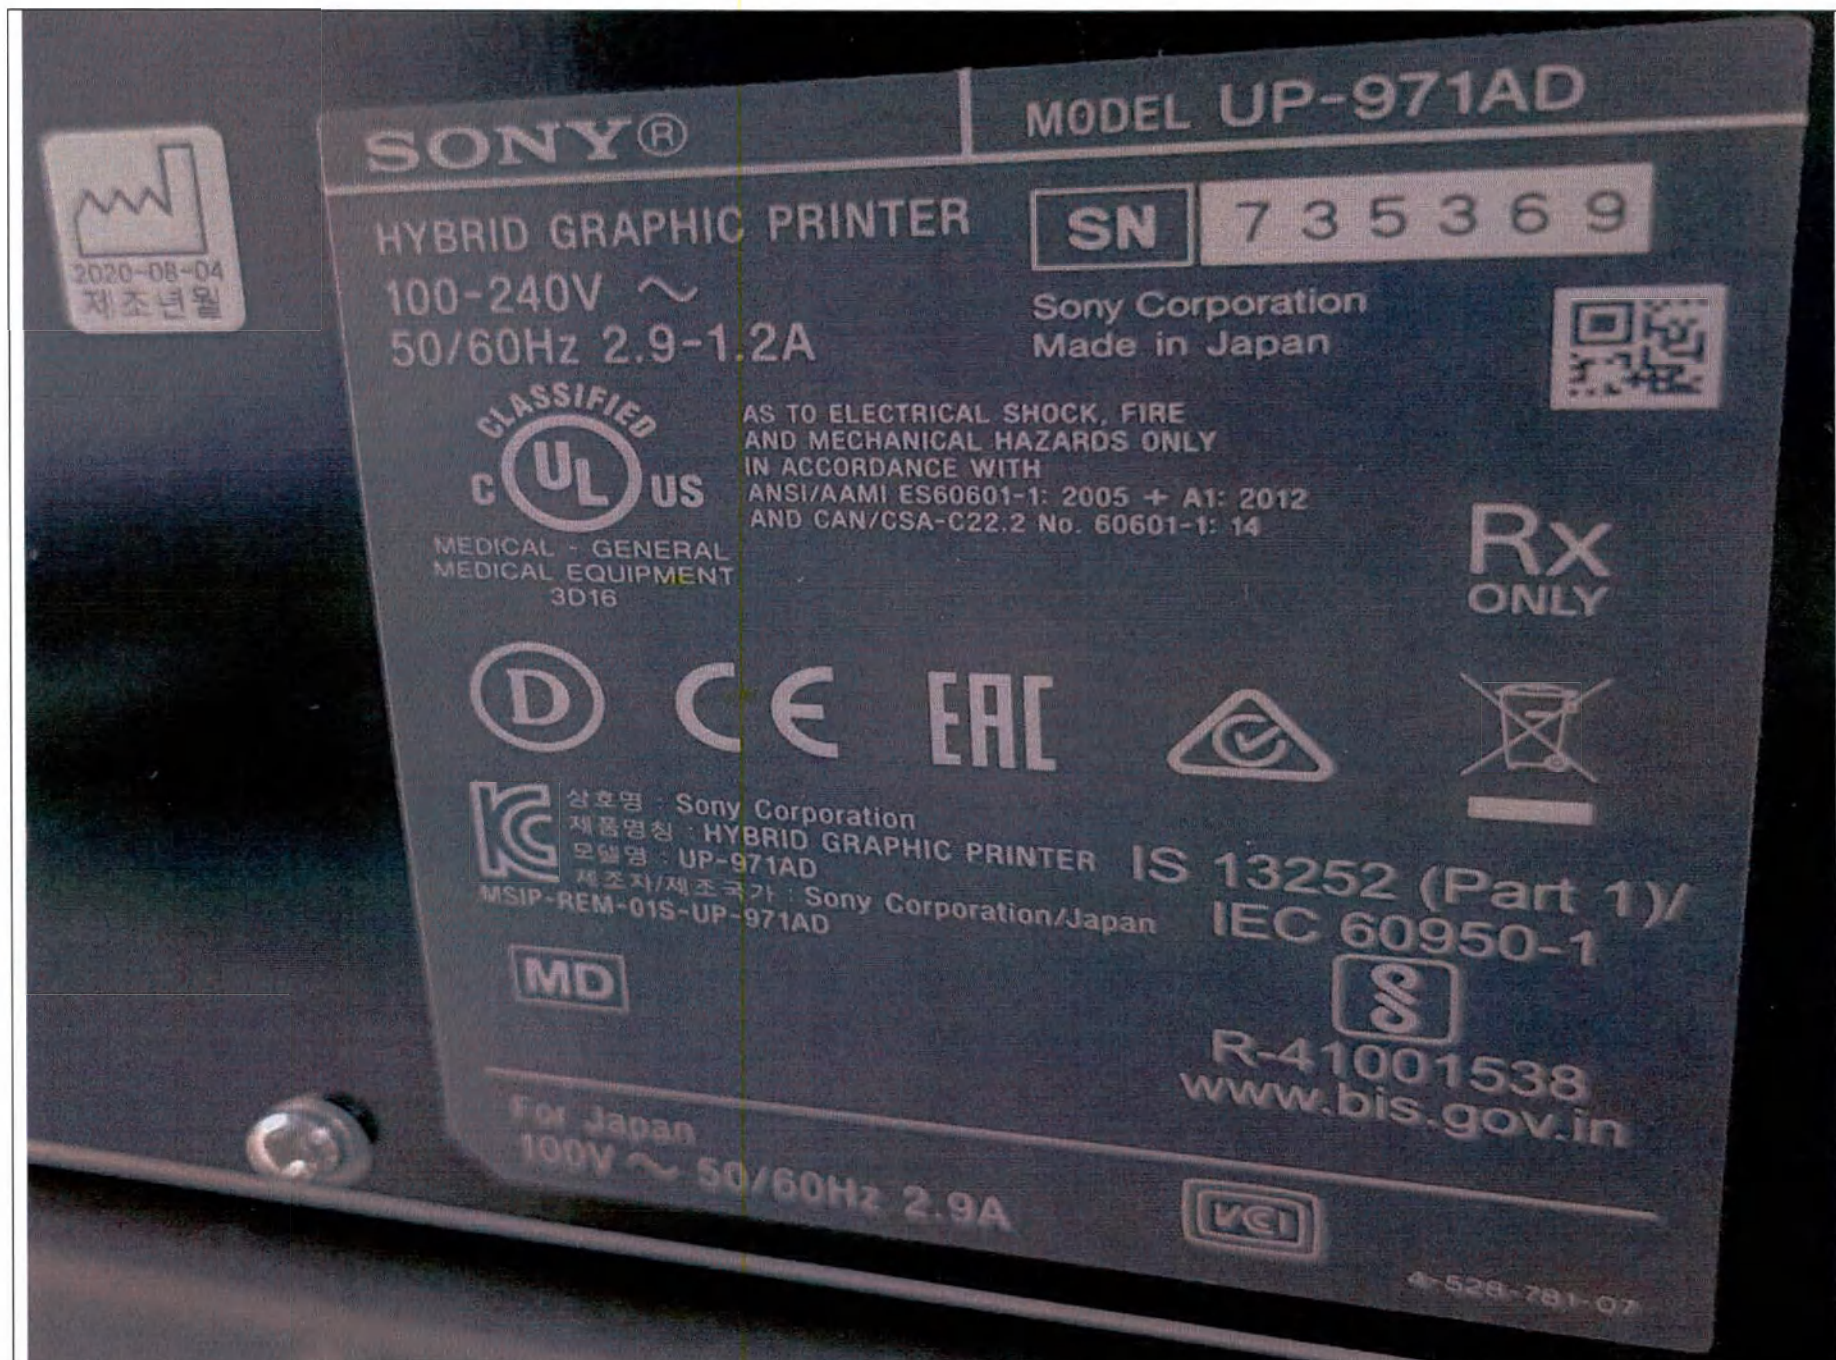

Макет маркировки медицинского принтера Sony UP-971AD.

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью 66 листа (ов)

ООО «Филипс»

