

PHILIPS

Менеджер по нормативному регулированию



ООО «ФИЛИПС»

Град А.А.

2023 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

**«Система флюороскопическая рентгеновская передвижная цифровая Zenition 70 с
принадлежностями»**

Общий вид







1. Базовый блок с С-дугой




1.1. Стойка С-дуги

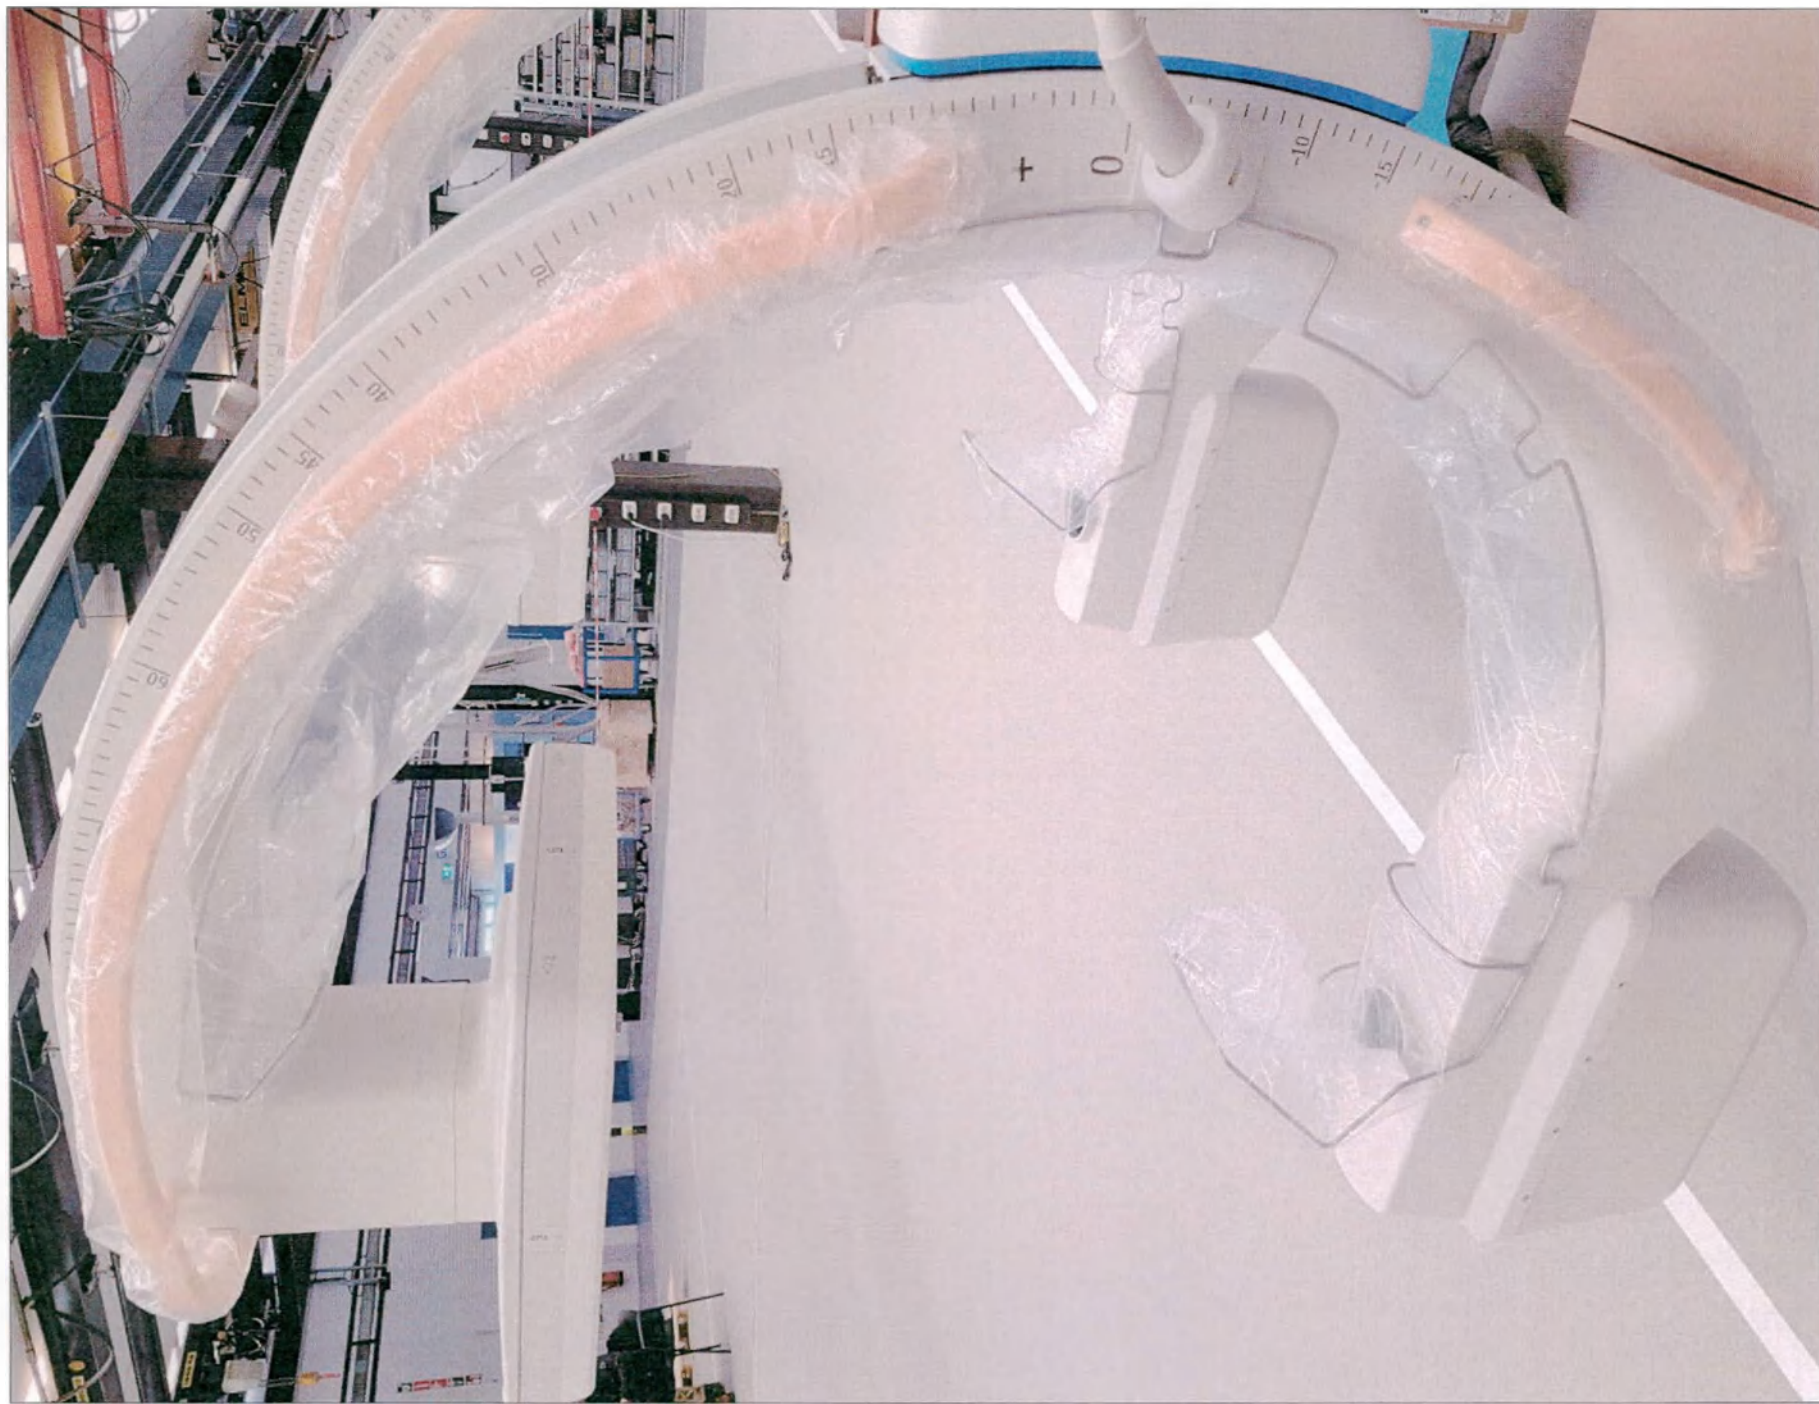

1.2. С-дуга

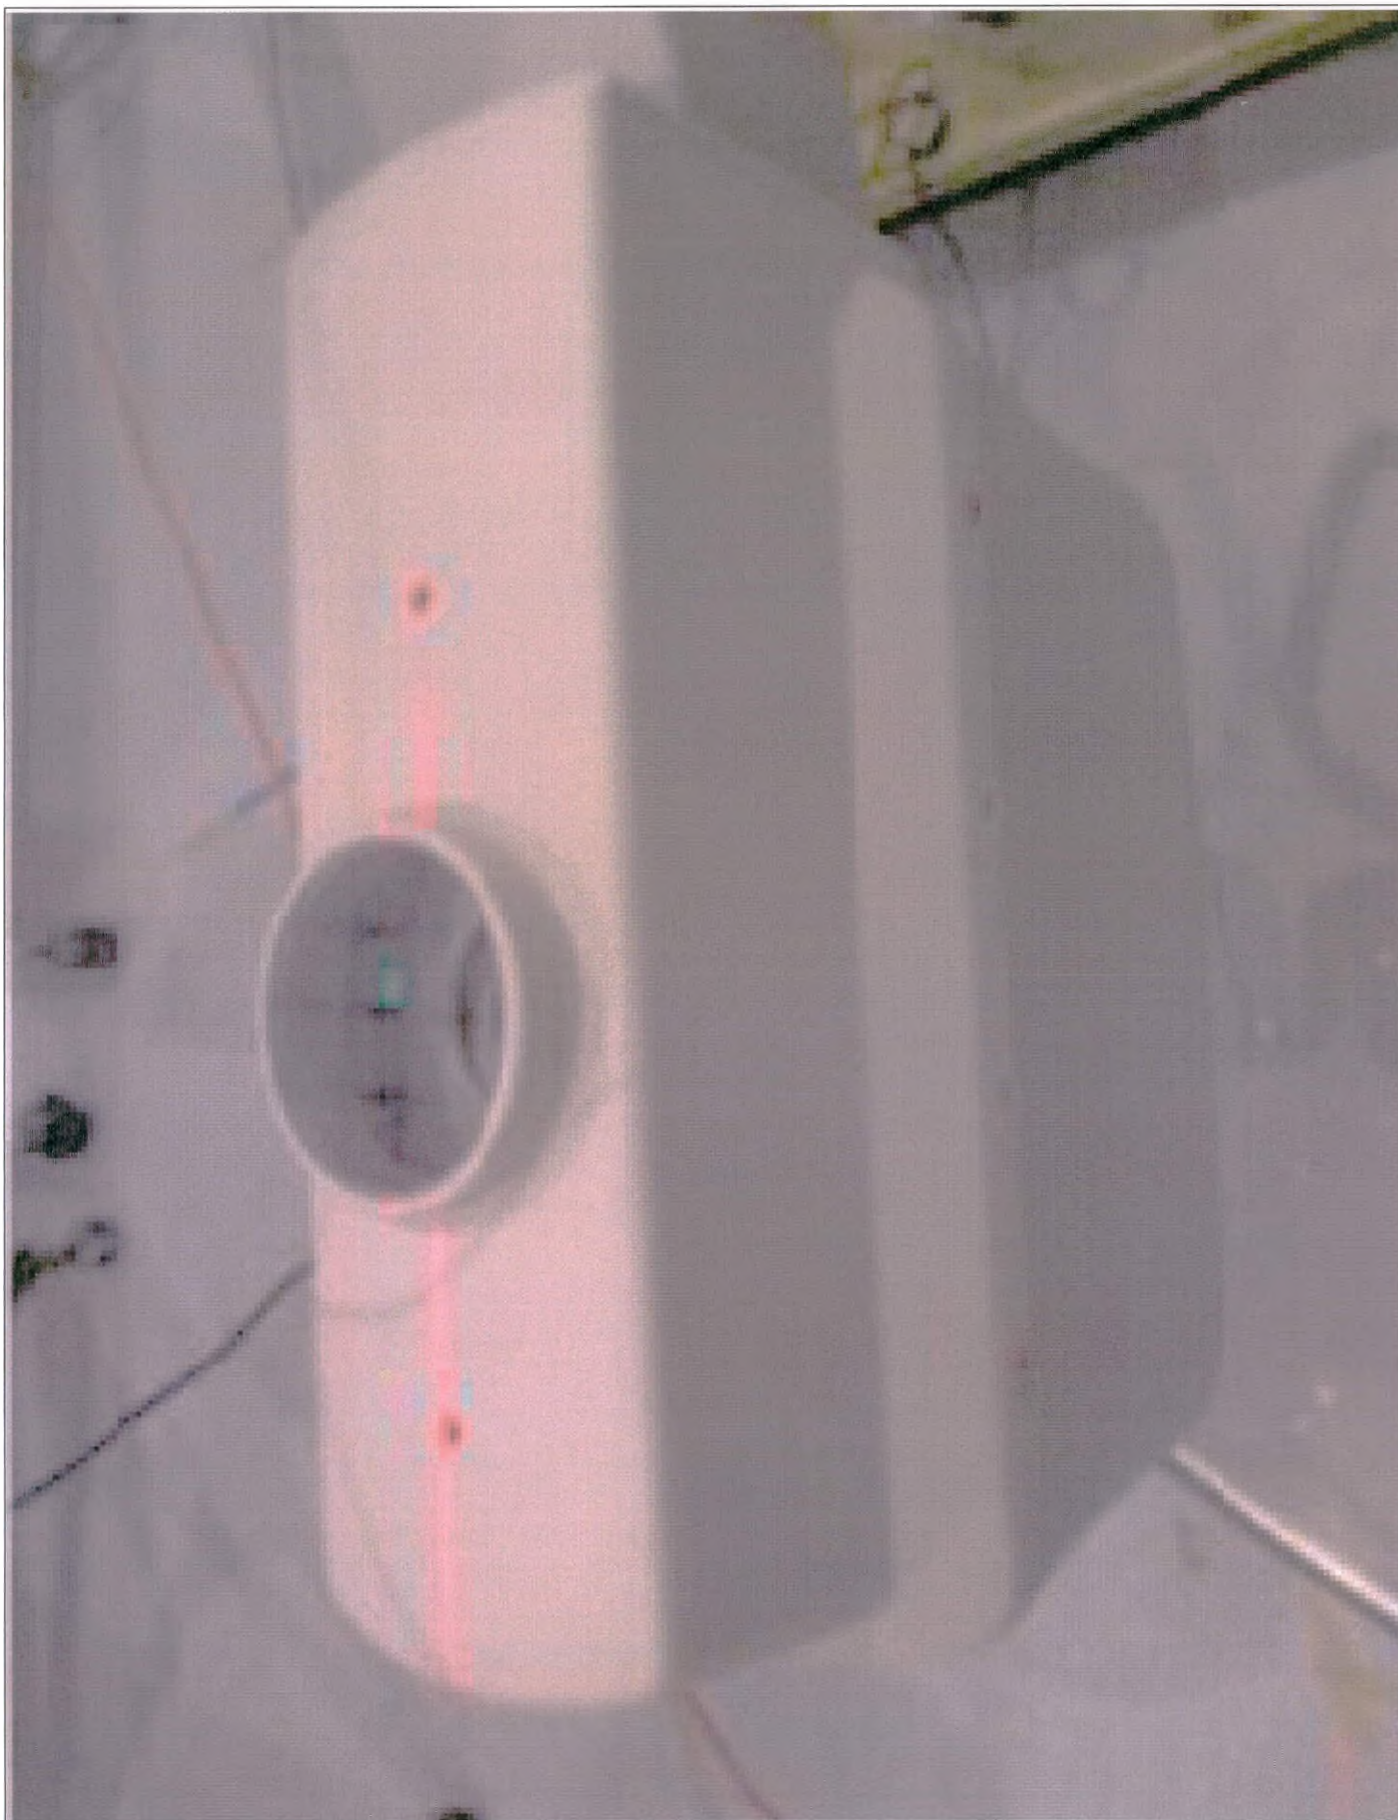


1.3. Блок источника рентгеновского излучения

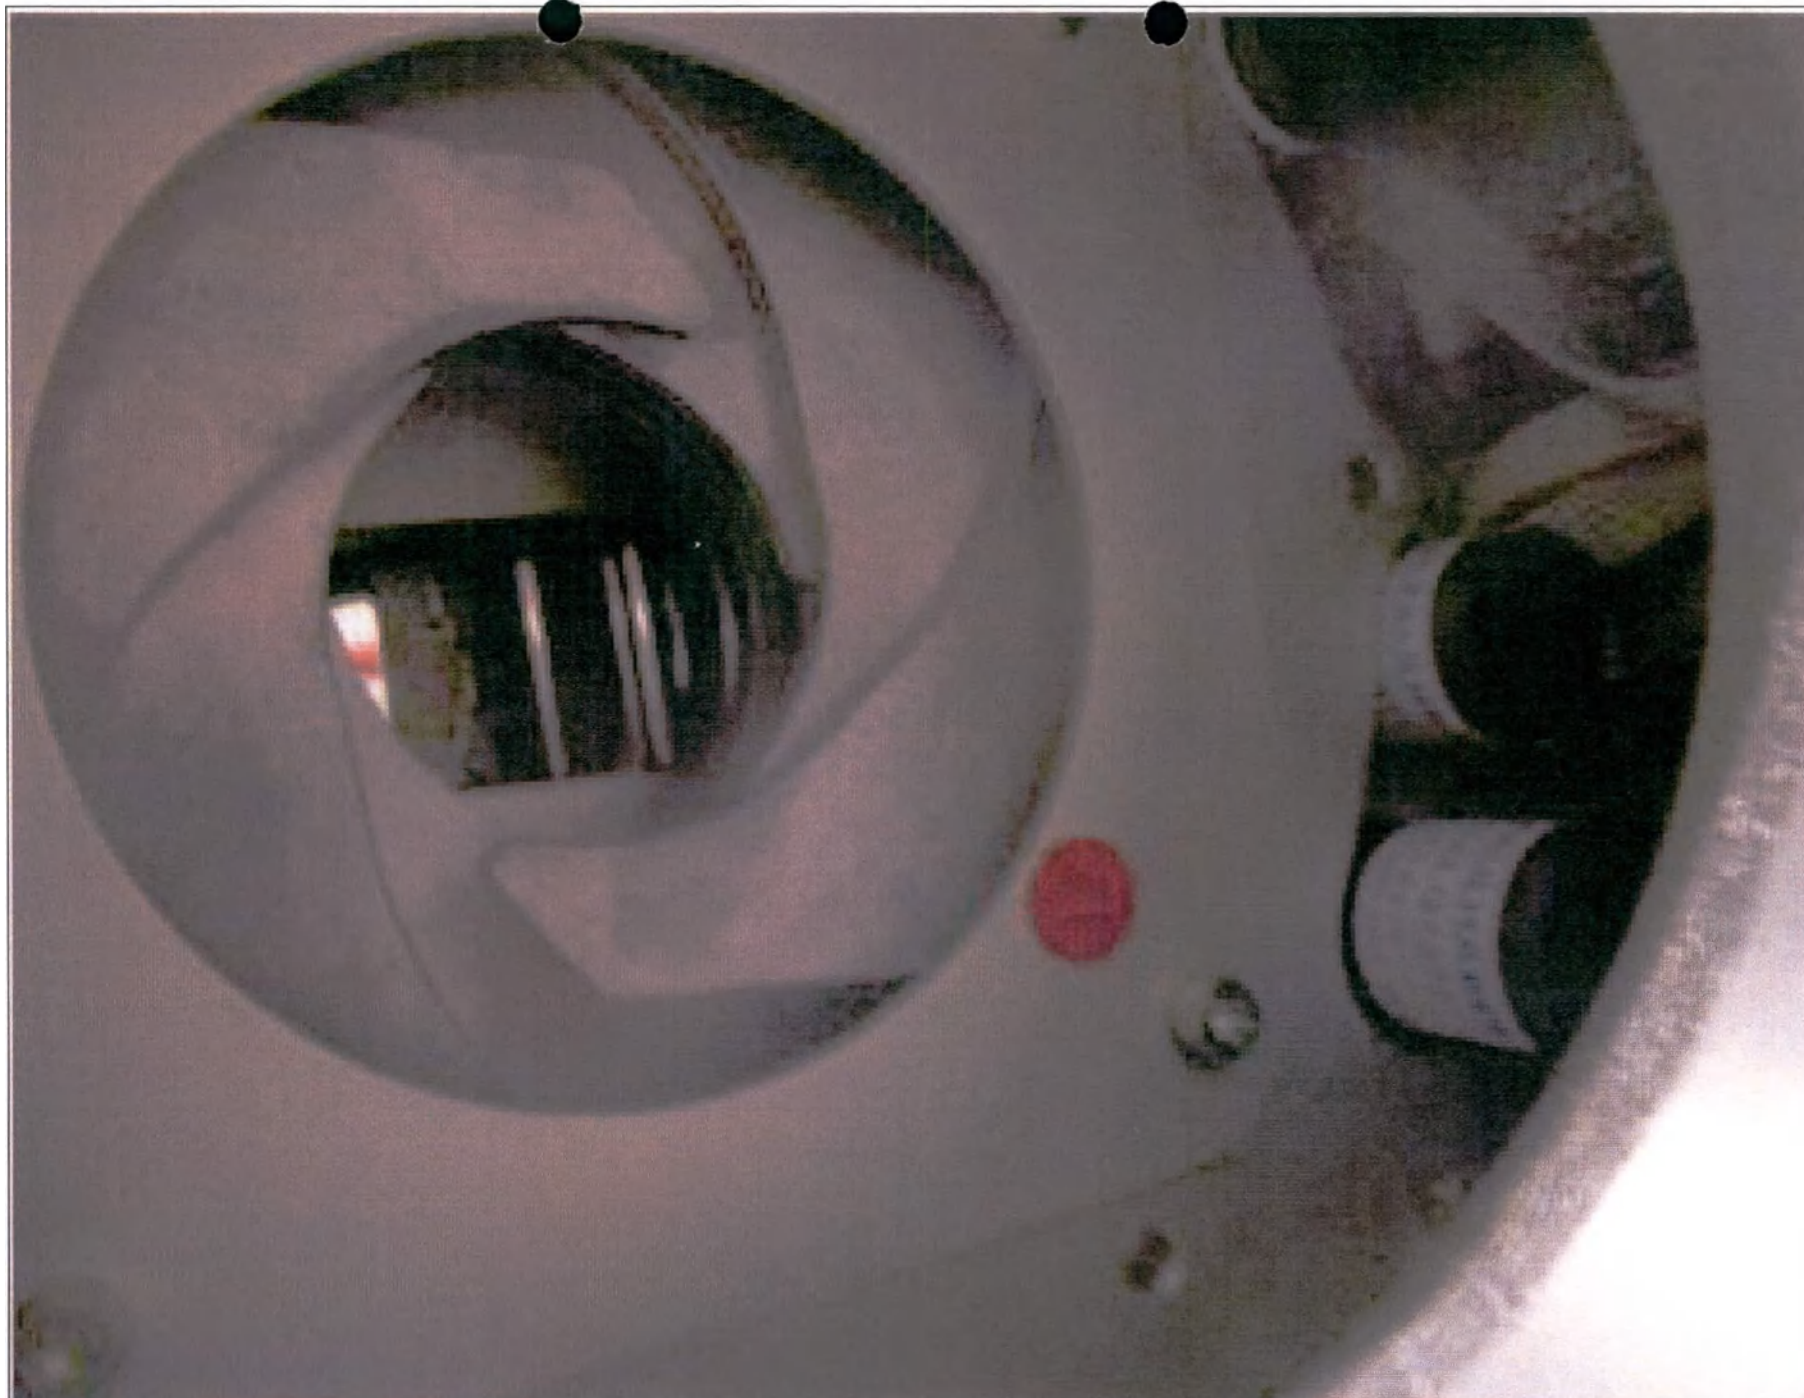


1.4. Коллиматор



1.5. а) Детектор FD12

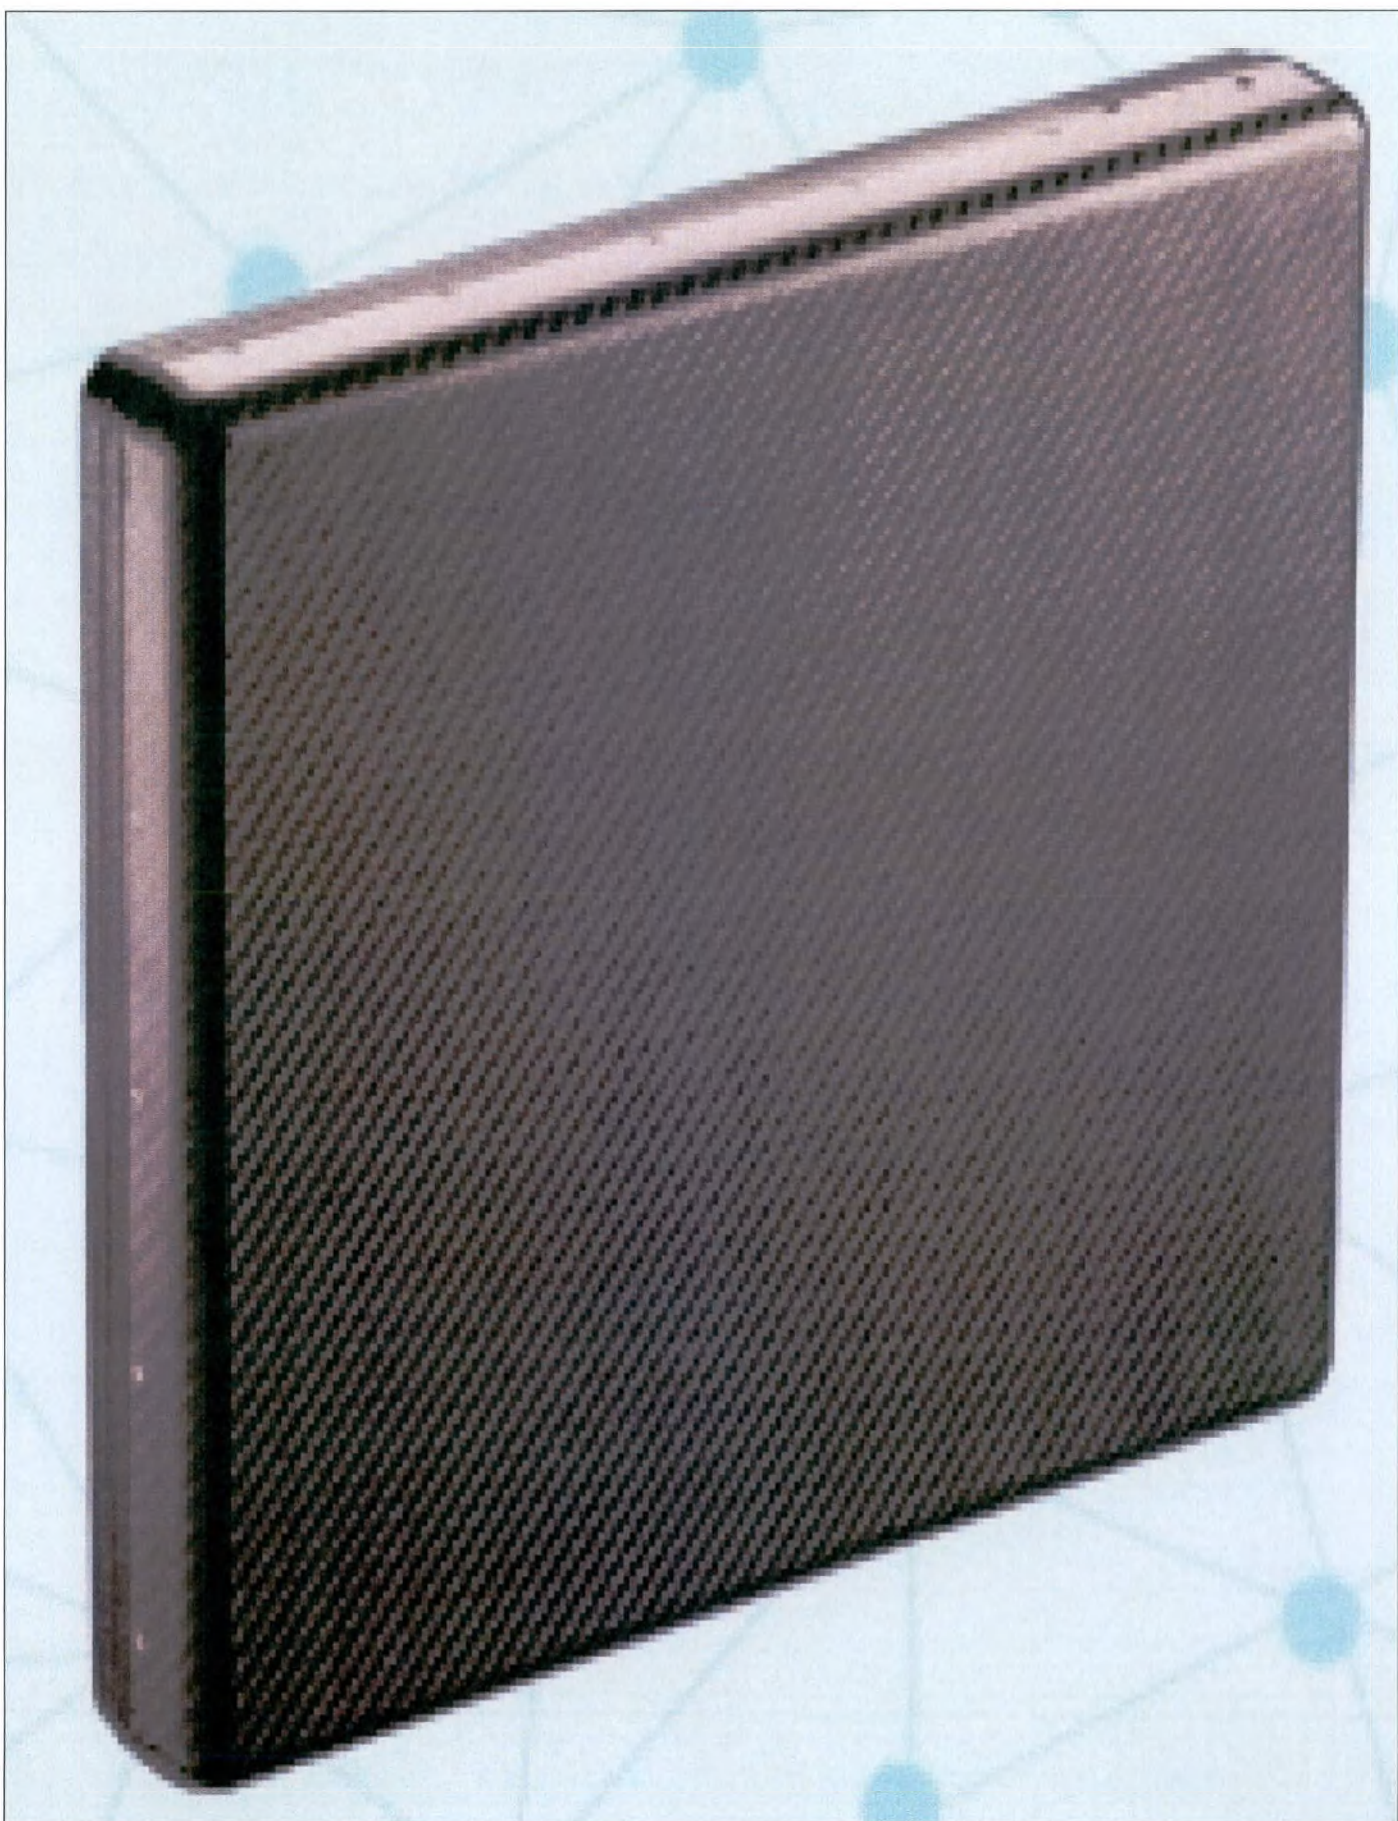


1.5. b) Детектор FD15

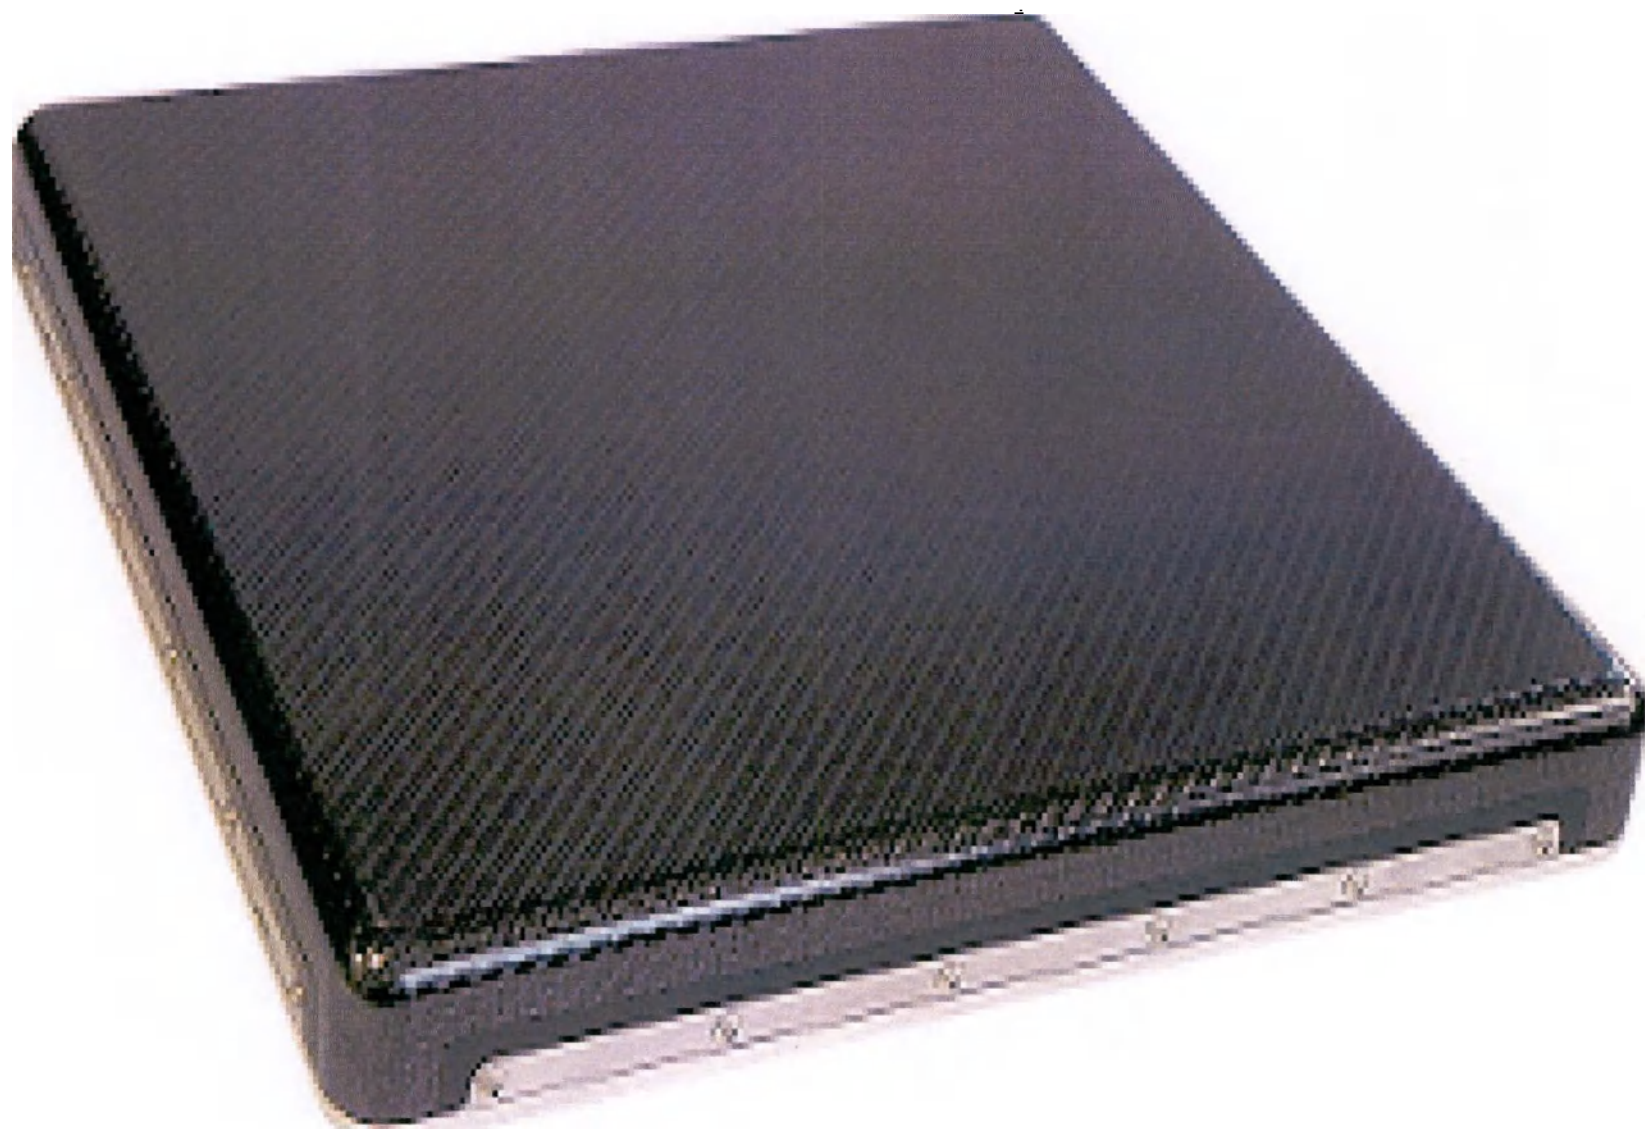


1.5. с) Детектор FD17



1.6. а) Отсеивающая решетка FD12.

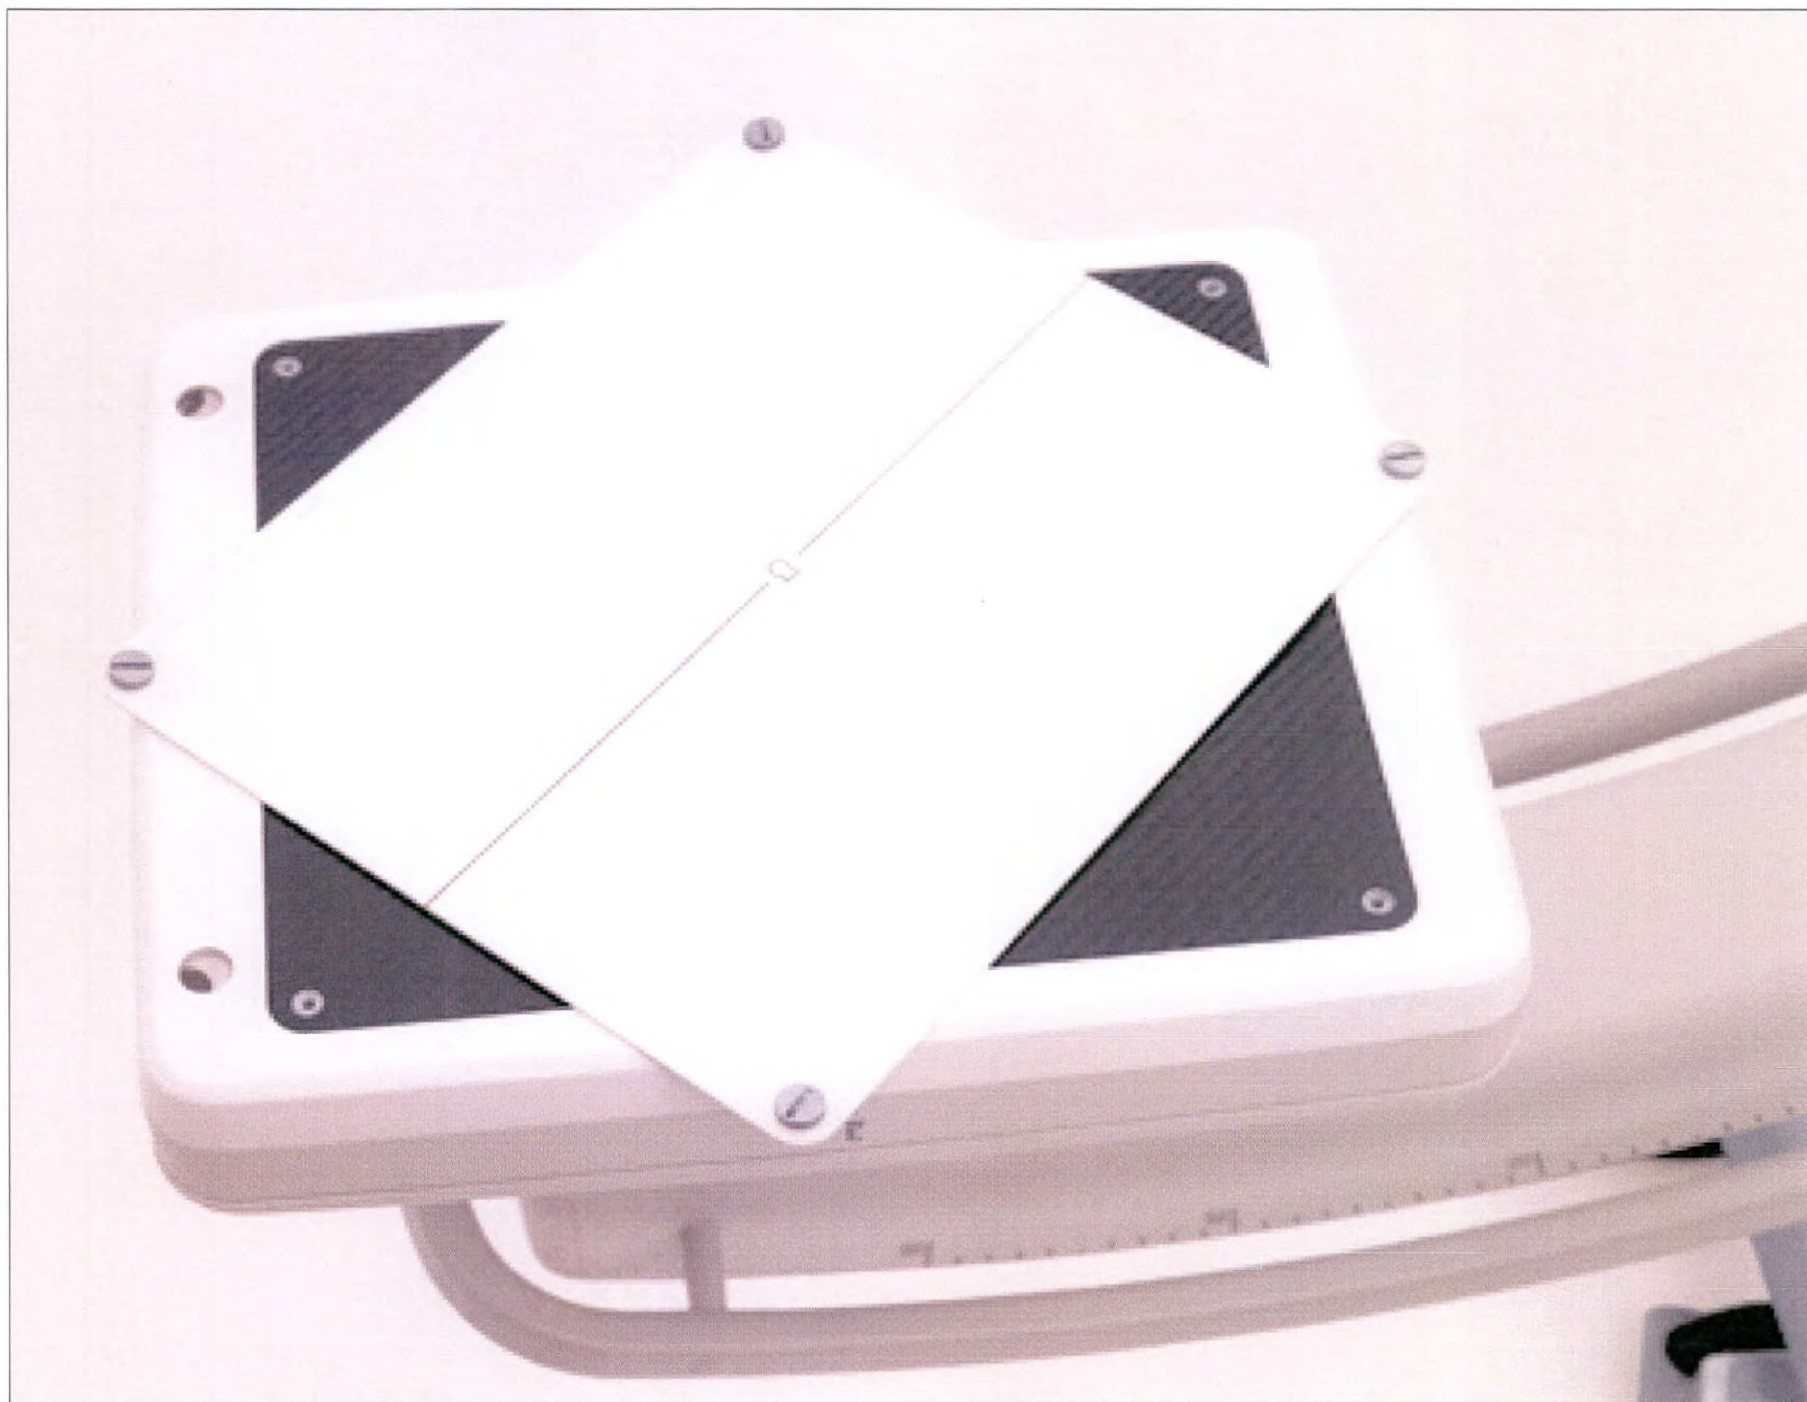


1.6. б) Отсеивающая решетка FD15.

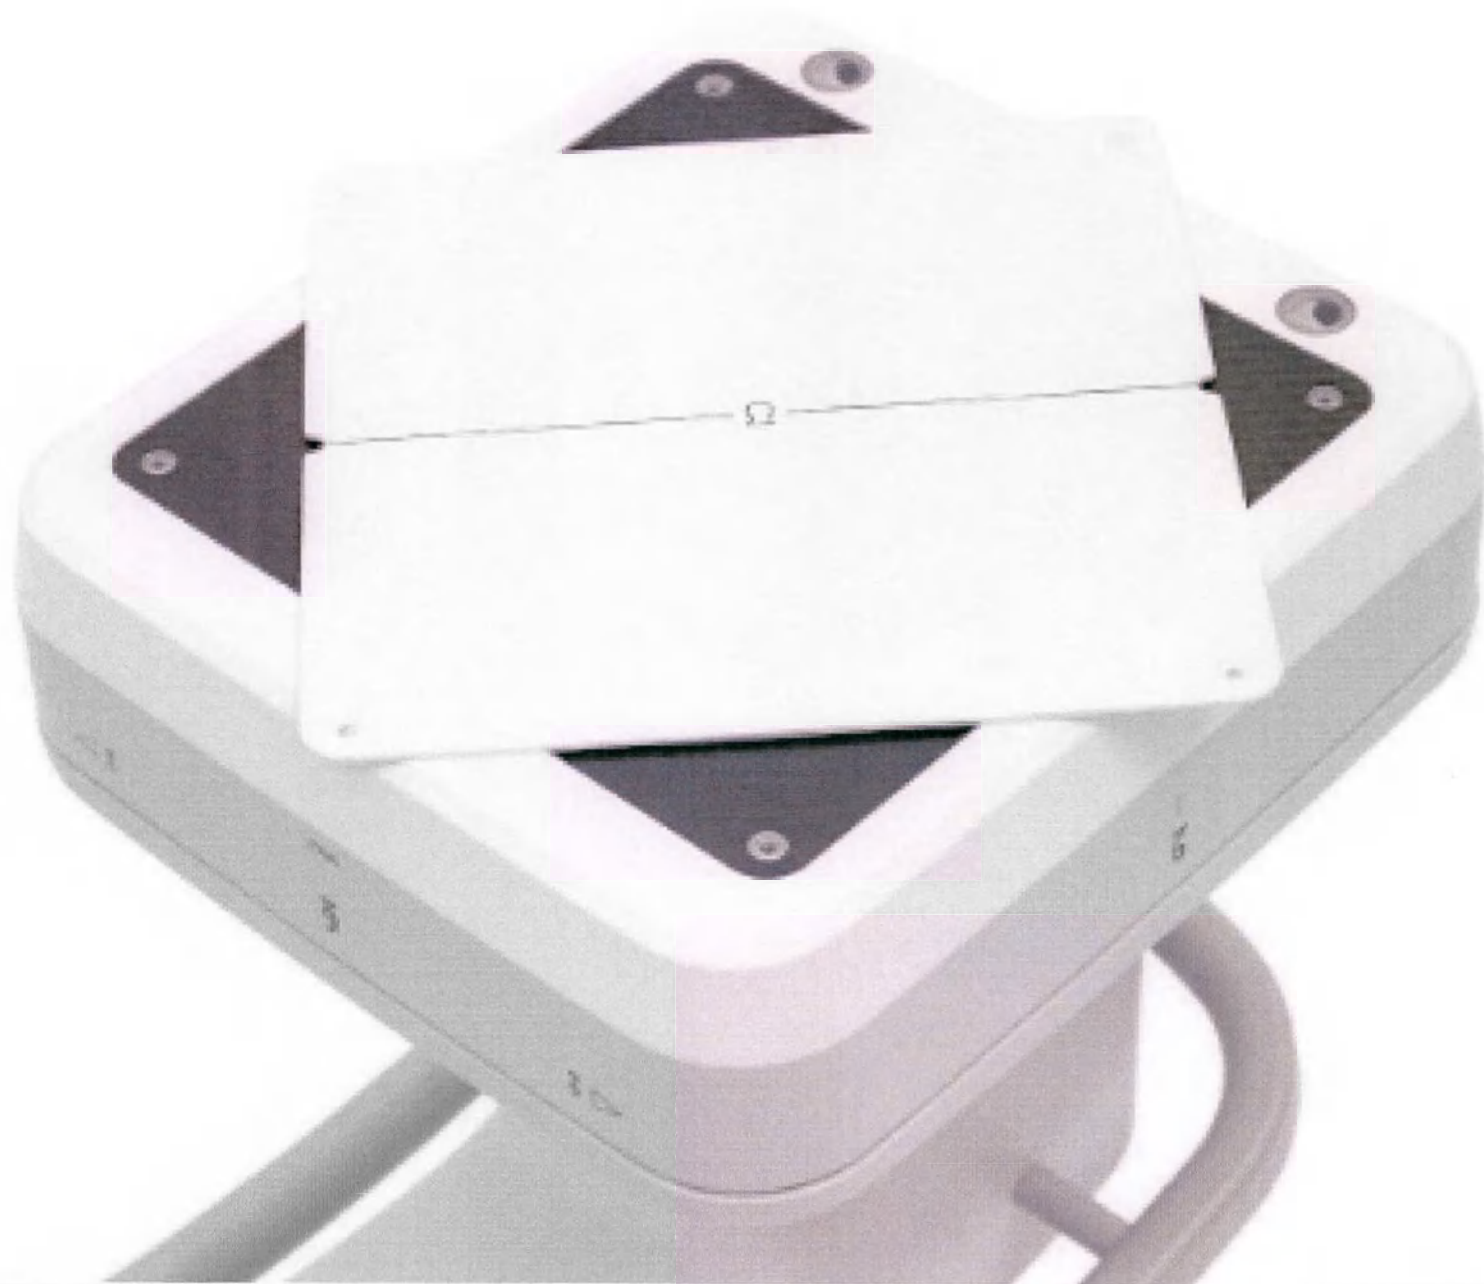


1.6. с) Отсеивающая решетка FD17.



1.7. Сенсорный экран типа HL1530.

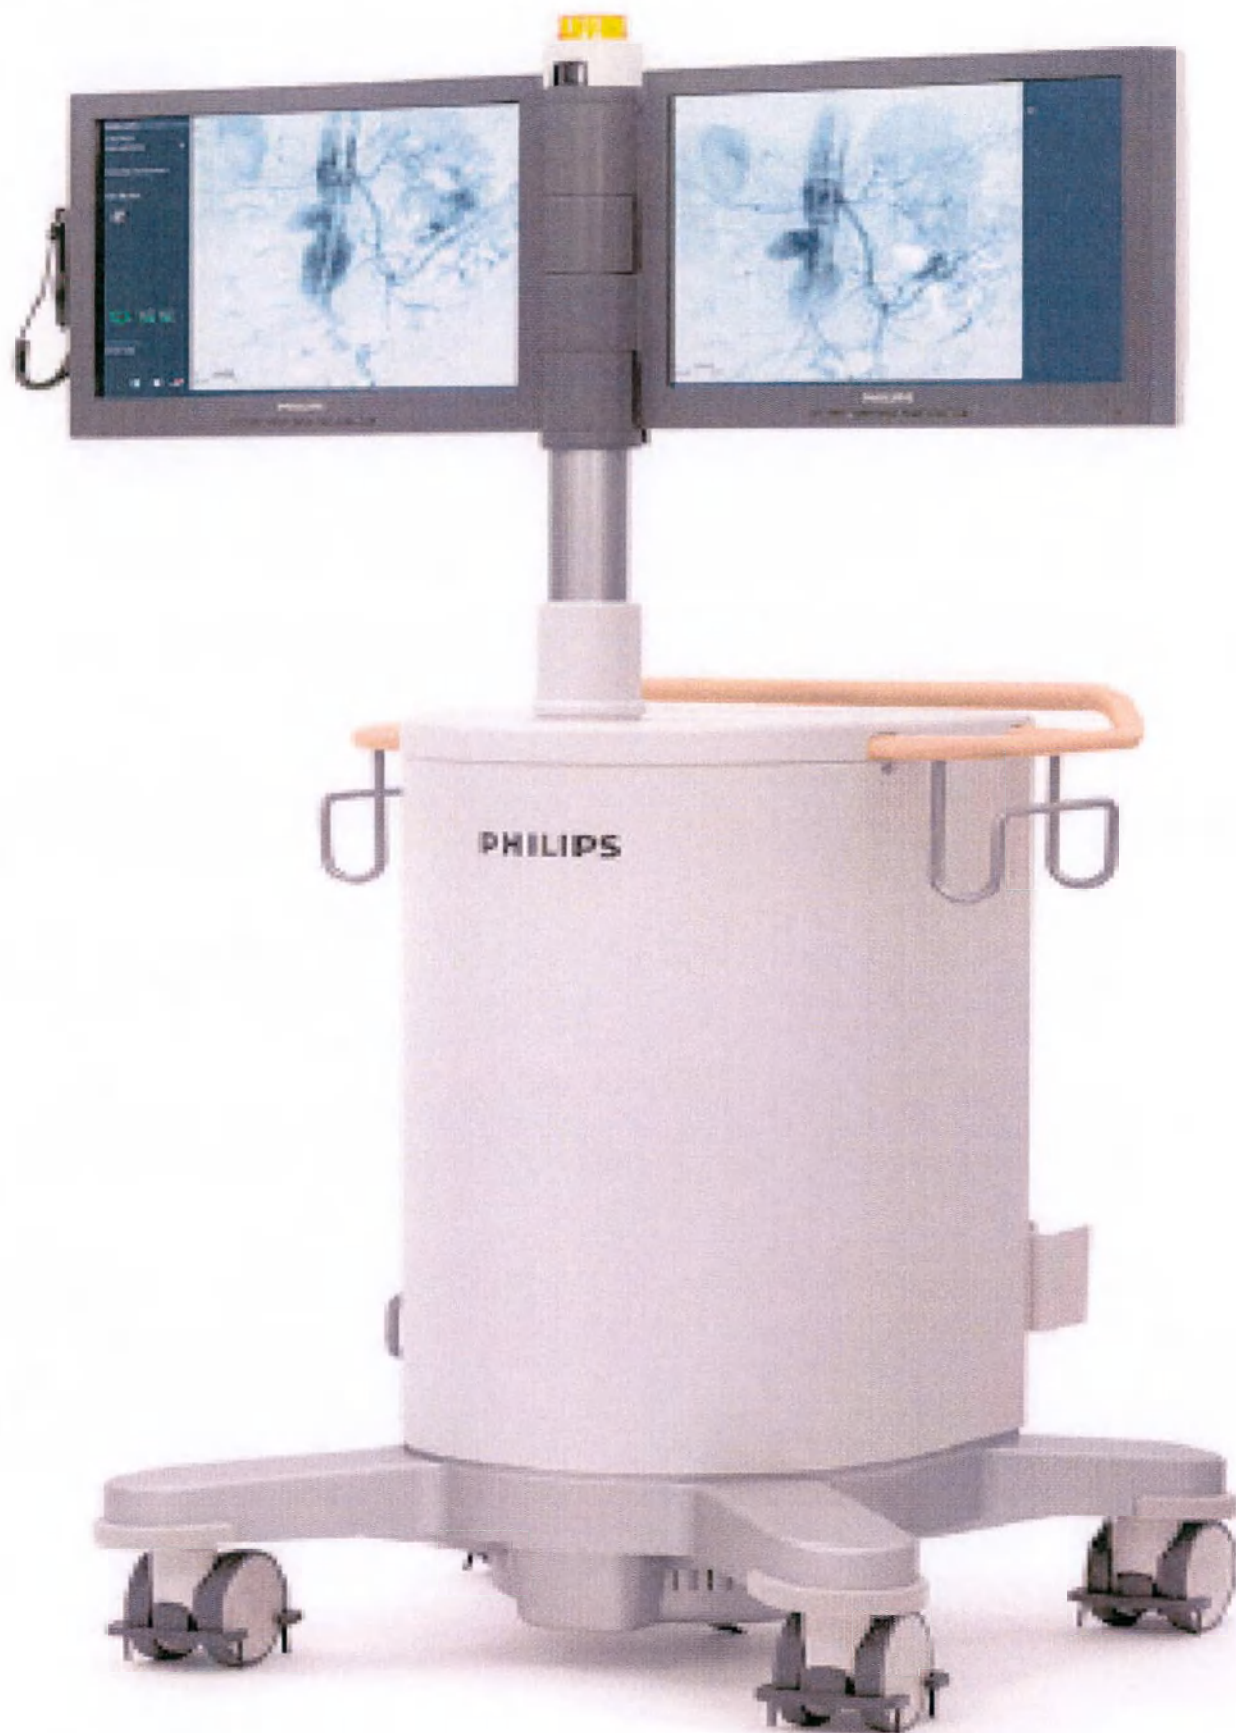


2. Передвижная станция просмотра

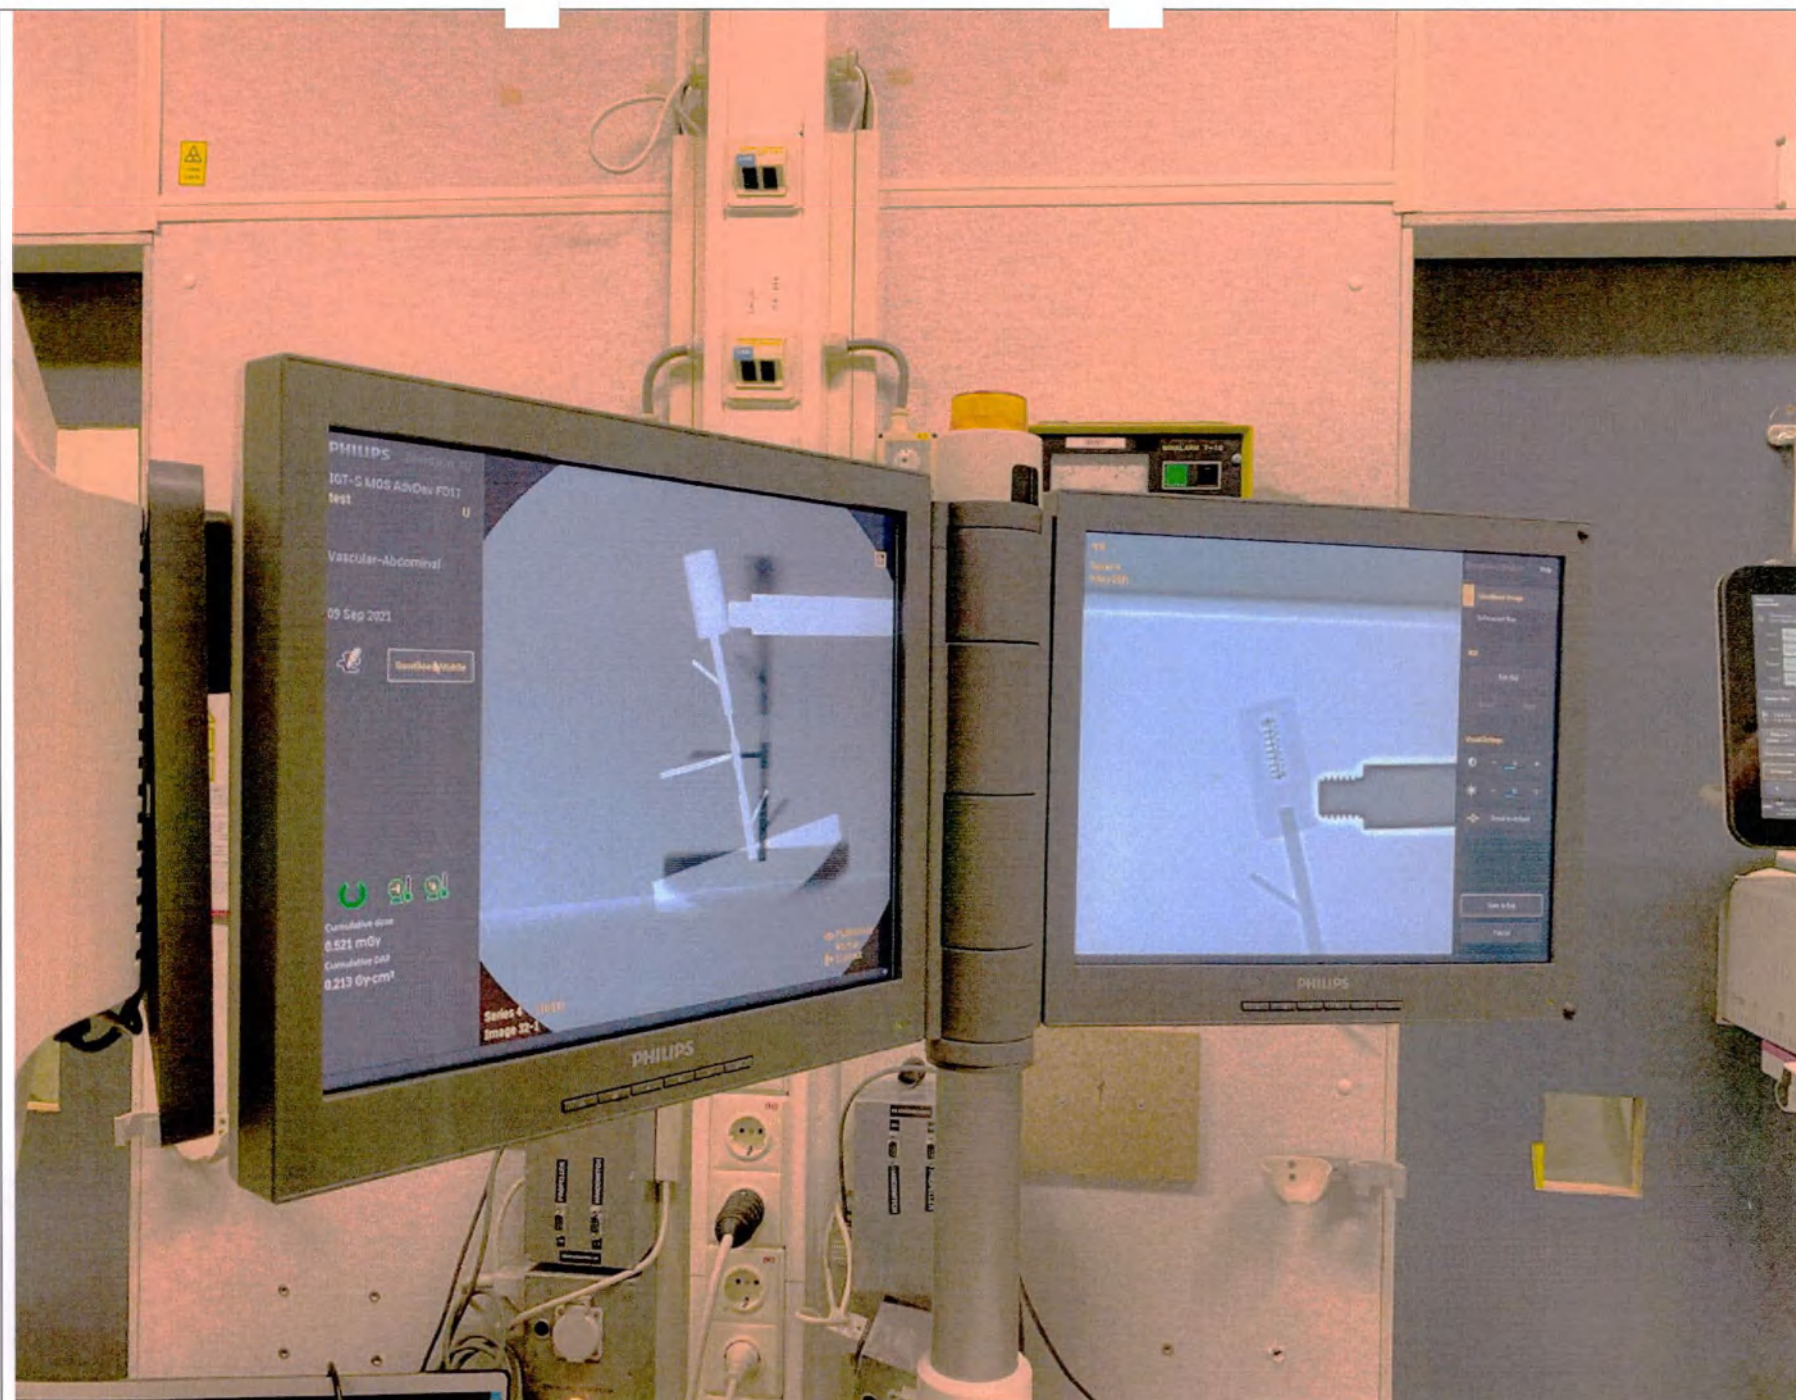


2.1 Монитор для исследований типа MLCD19, в вариантах исполнения:


2.1.1. Монитор для исследований типа MLCD19 стандартной яркости (слева).

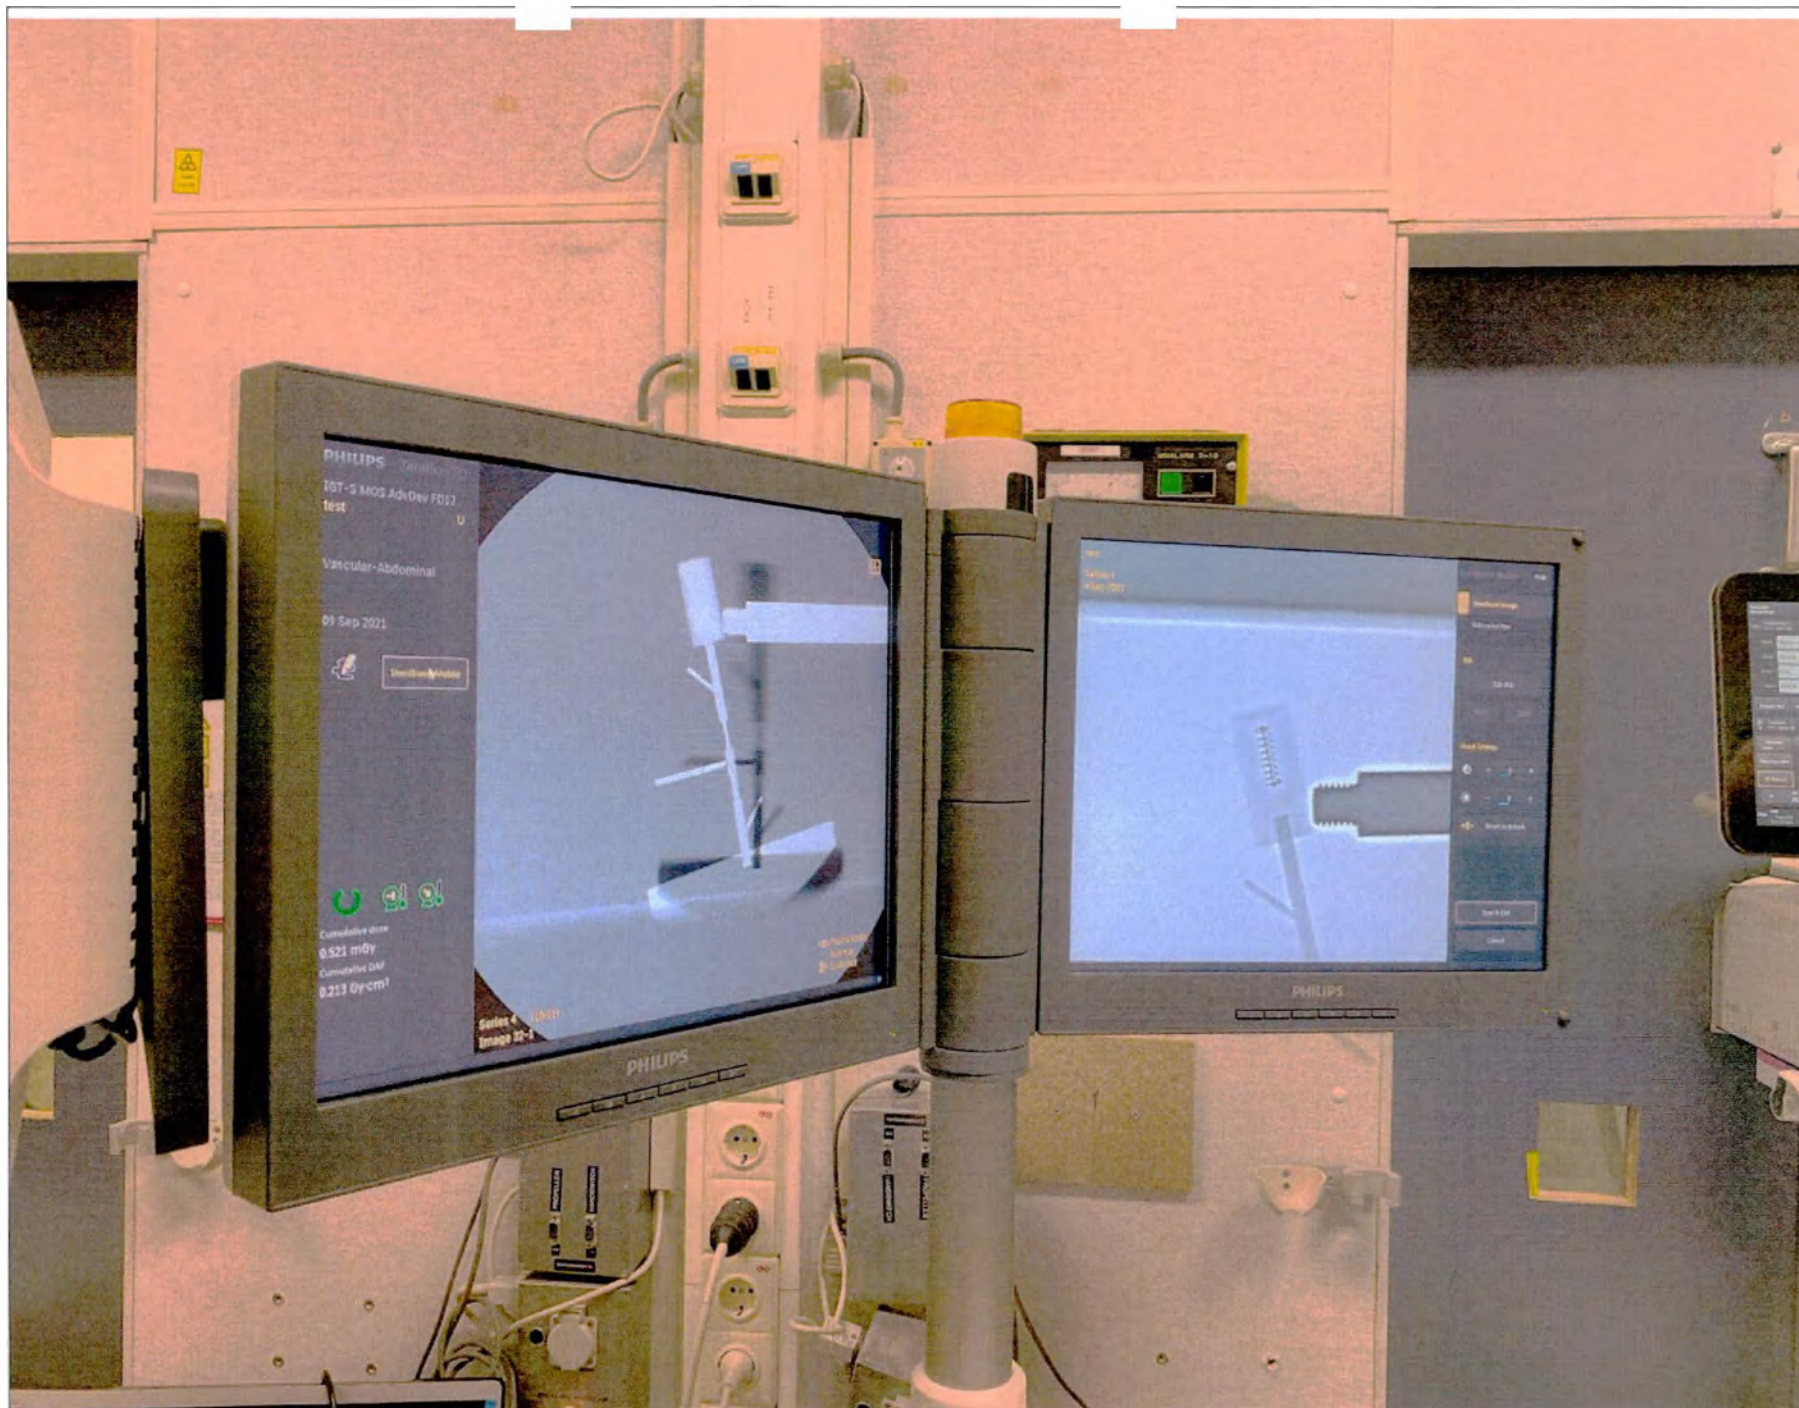

2.1.2. Монитор для исследований типа MLCD19 высокой яркости (слева).

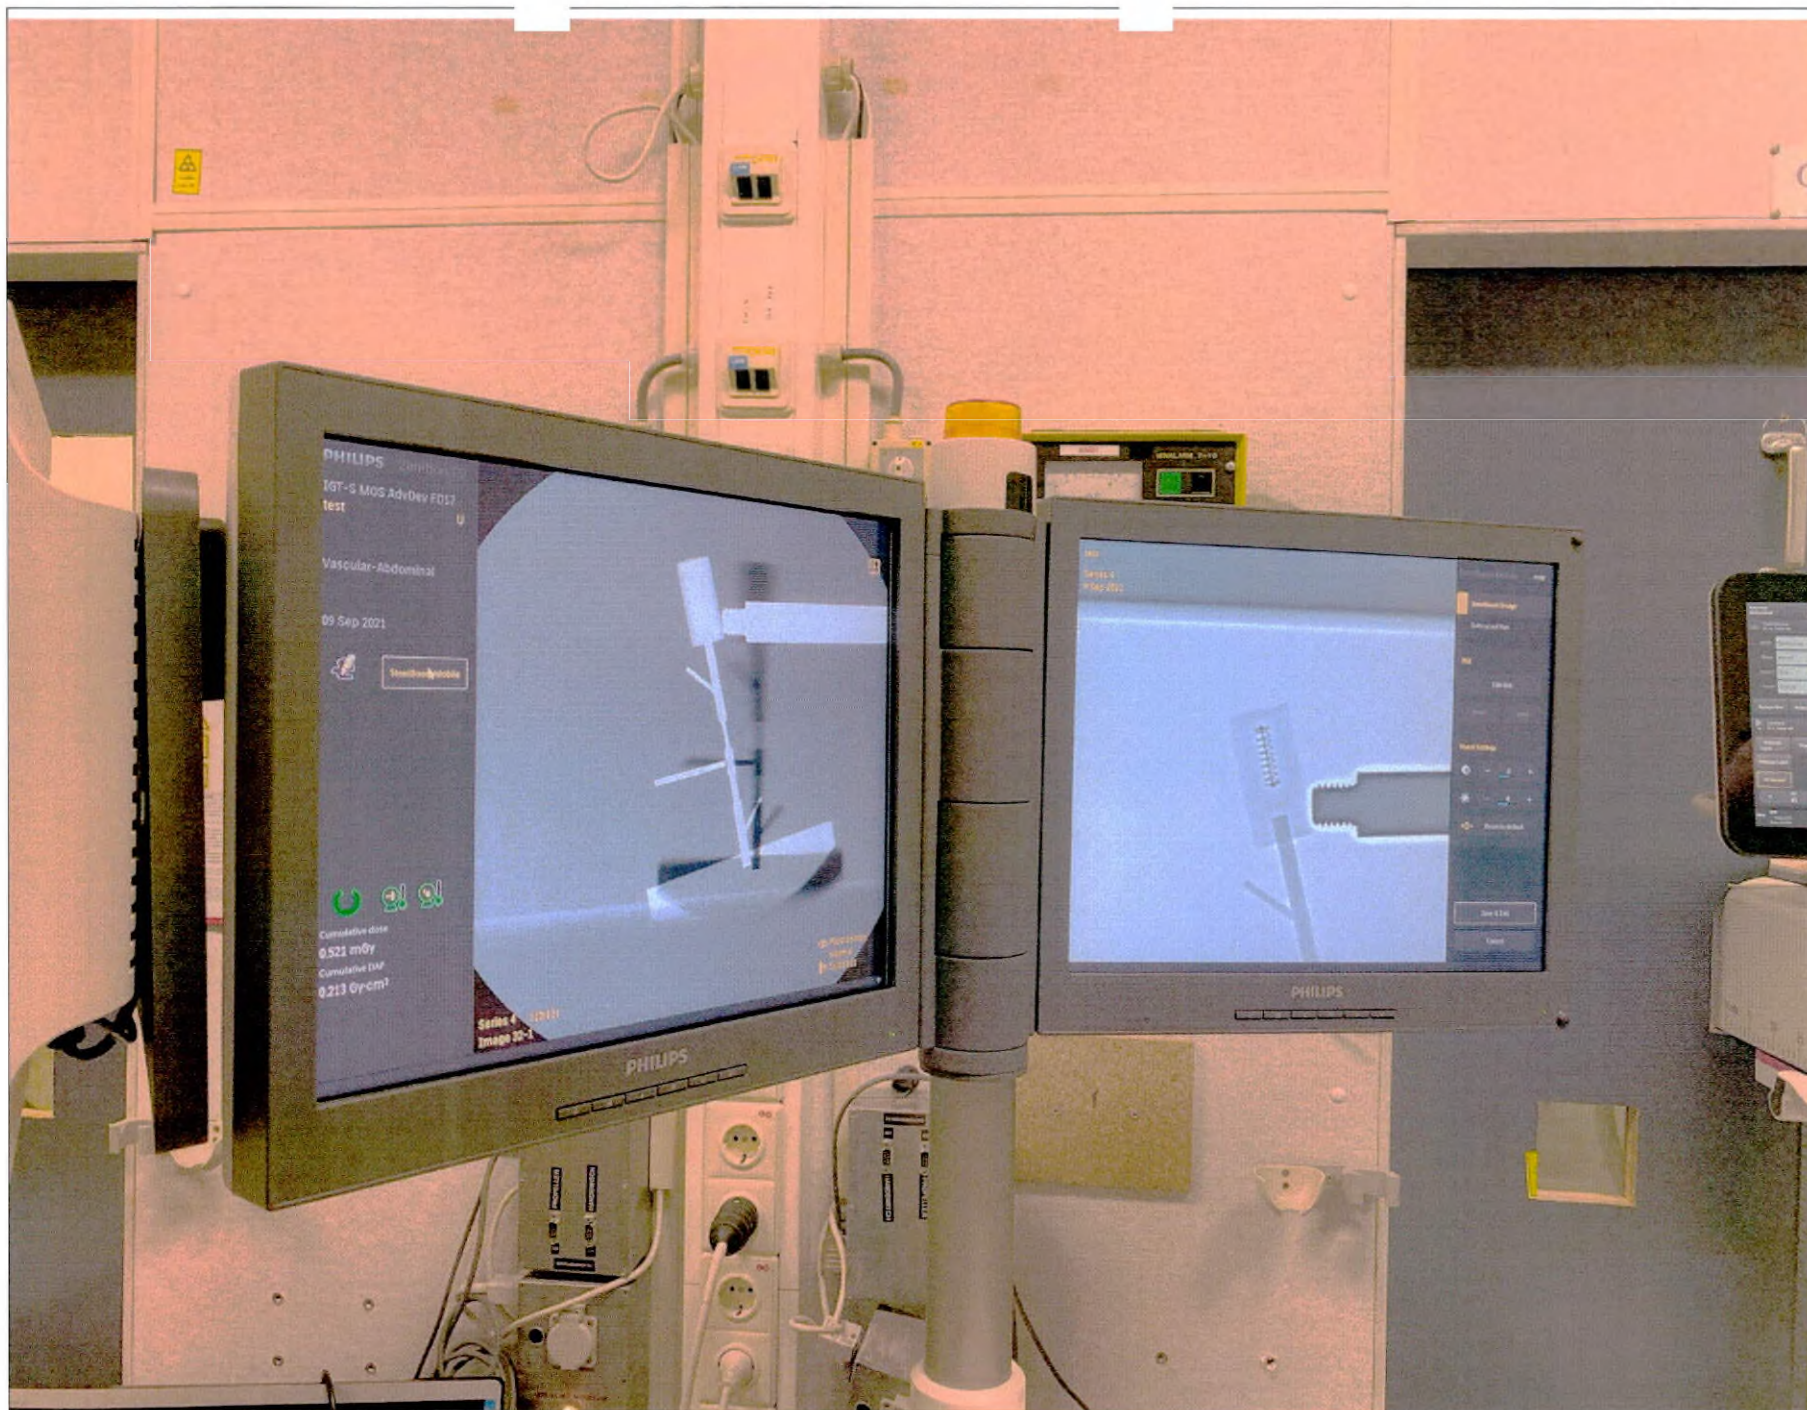

2.1.3. Монитор для исследования типа MLCD19 стандартной яркости с функцией сенсорного экрана (слева).

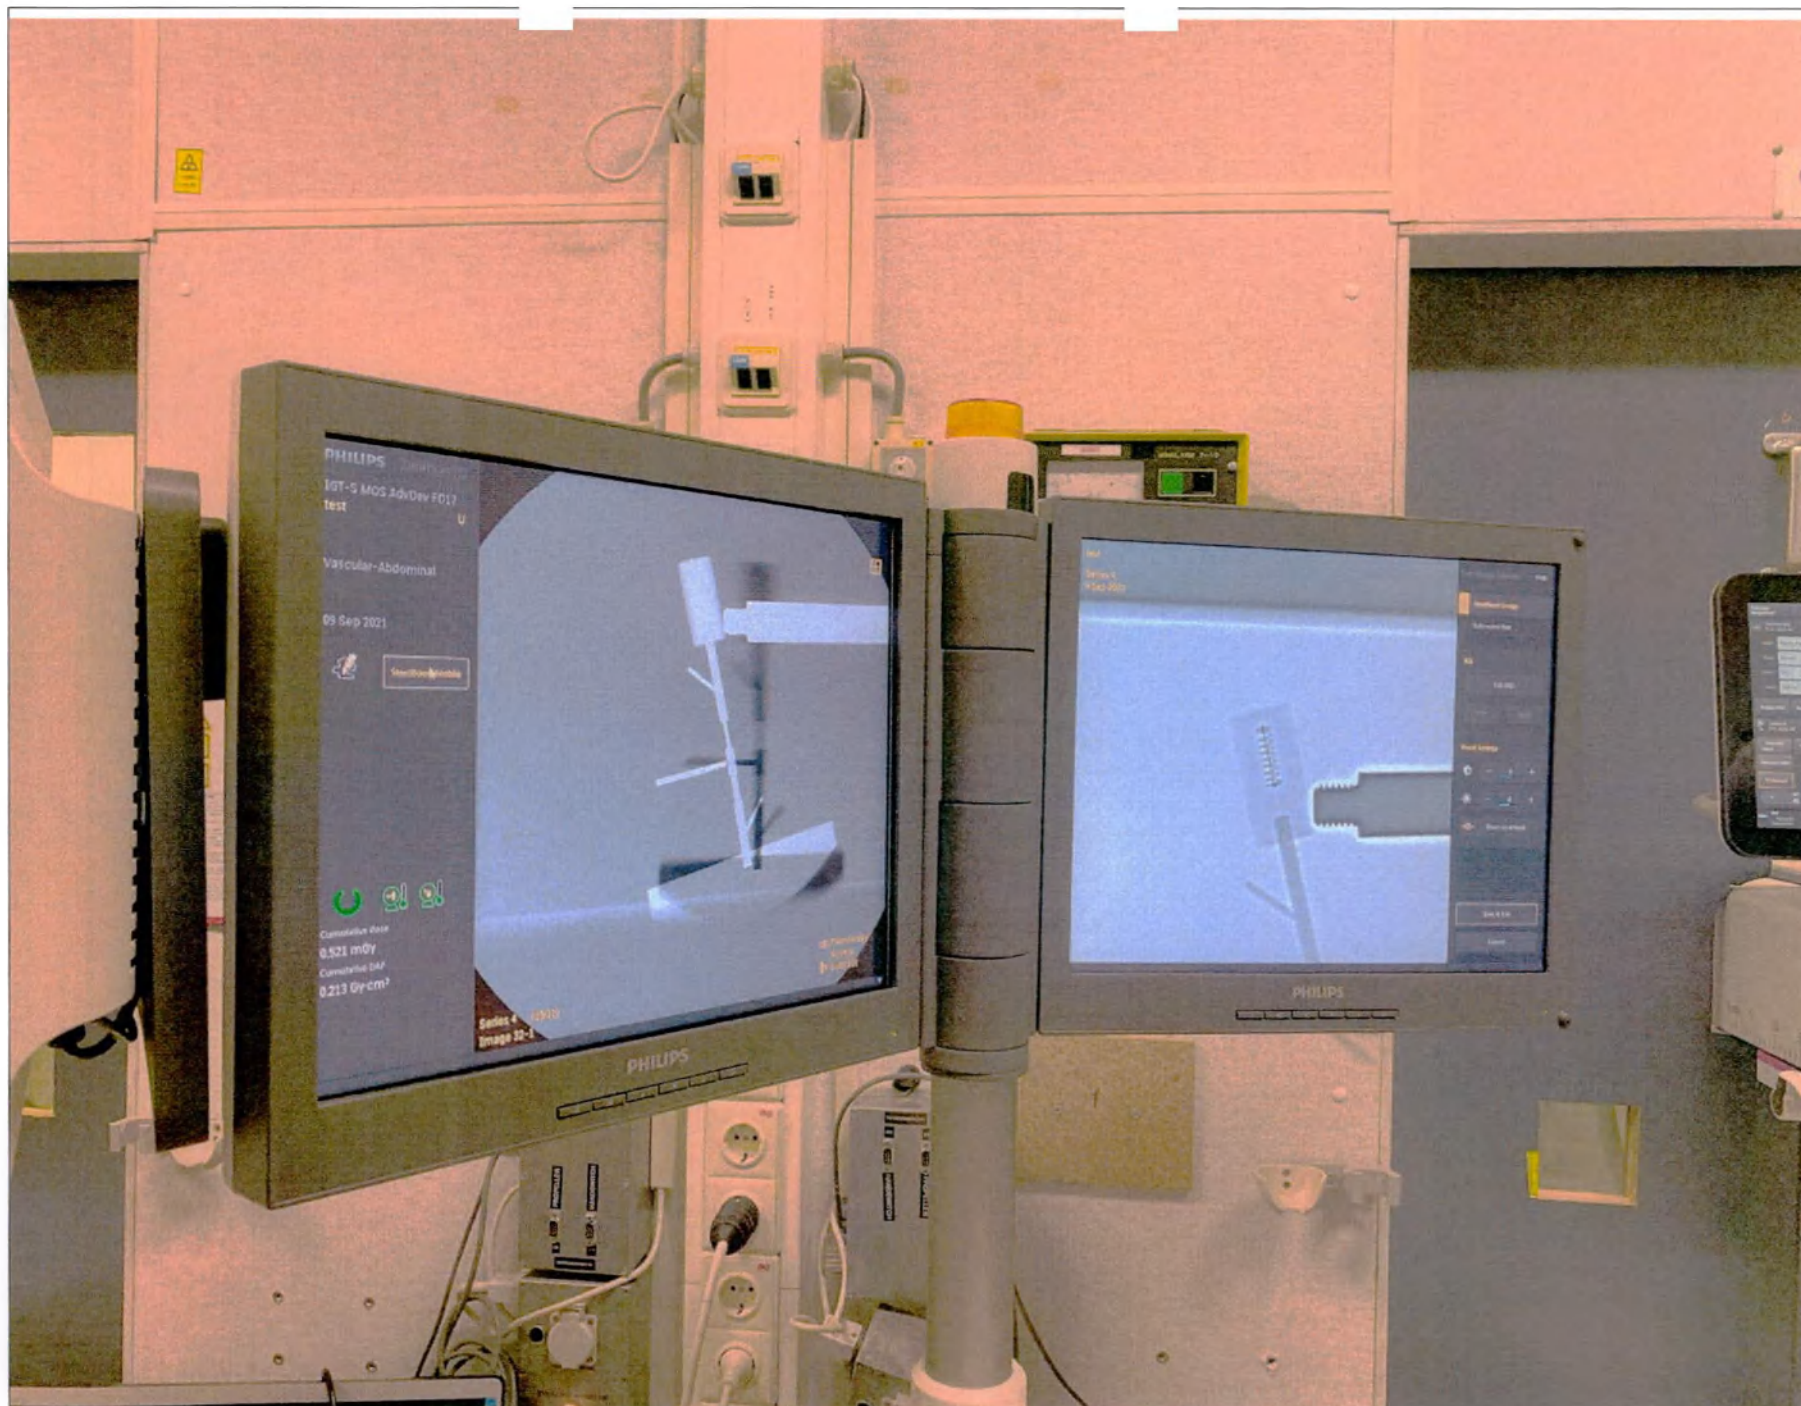

2.1.4. Монитор для исследований типа MLCD19 высокой яркости с функцией сенсорного экрана (слева).



2.2. Контрольный монитор типа MLCD19, в вариантах исполнения:




2.2.2. Контрольный монитор типа MLCD19 высокой яркости (справа).



3. Программное обеспечение для обработки изображений.



4. Ручной переключатель.

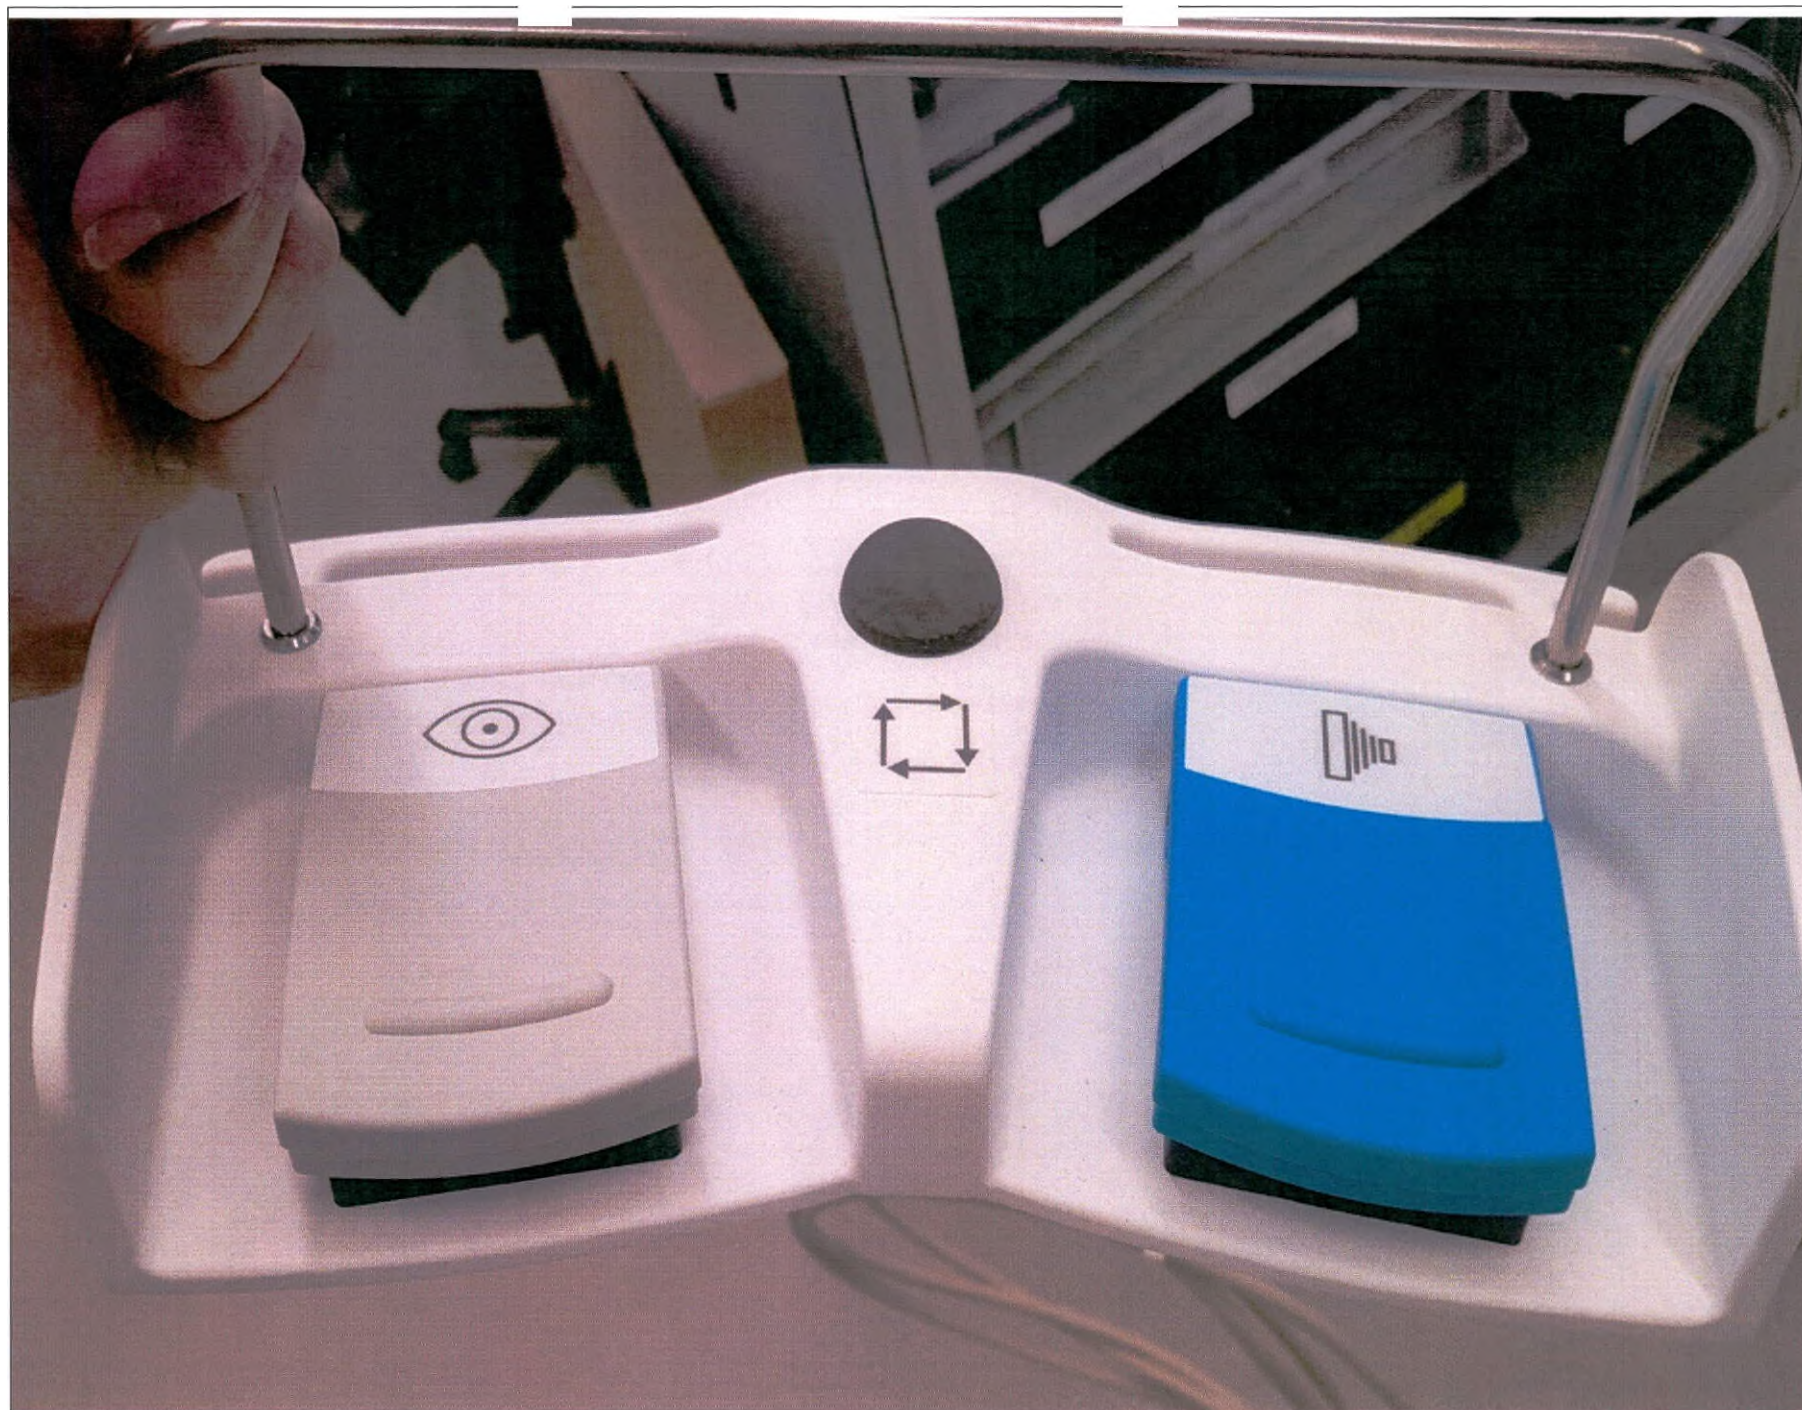

5. Ножной переключатель.



6. Кабель питания длиной 3м.

PHILIPS

Руководство по
эксплуатации

Русский

4598 013 56925



Philips Zenition 70

Версия 1.1


7. Эксплуатационная документация.

PHILIPS

Руководство по
эксплуатации

Русский

4598 018 36831

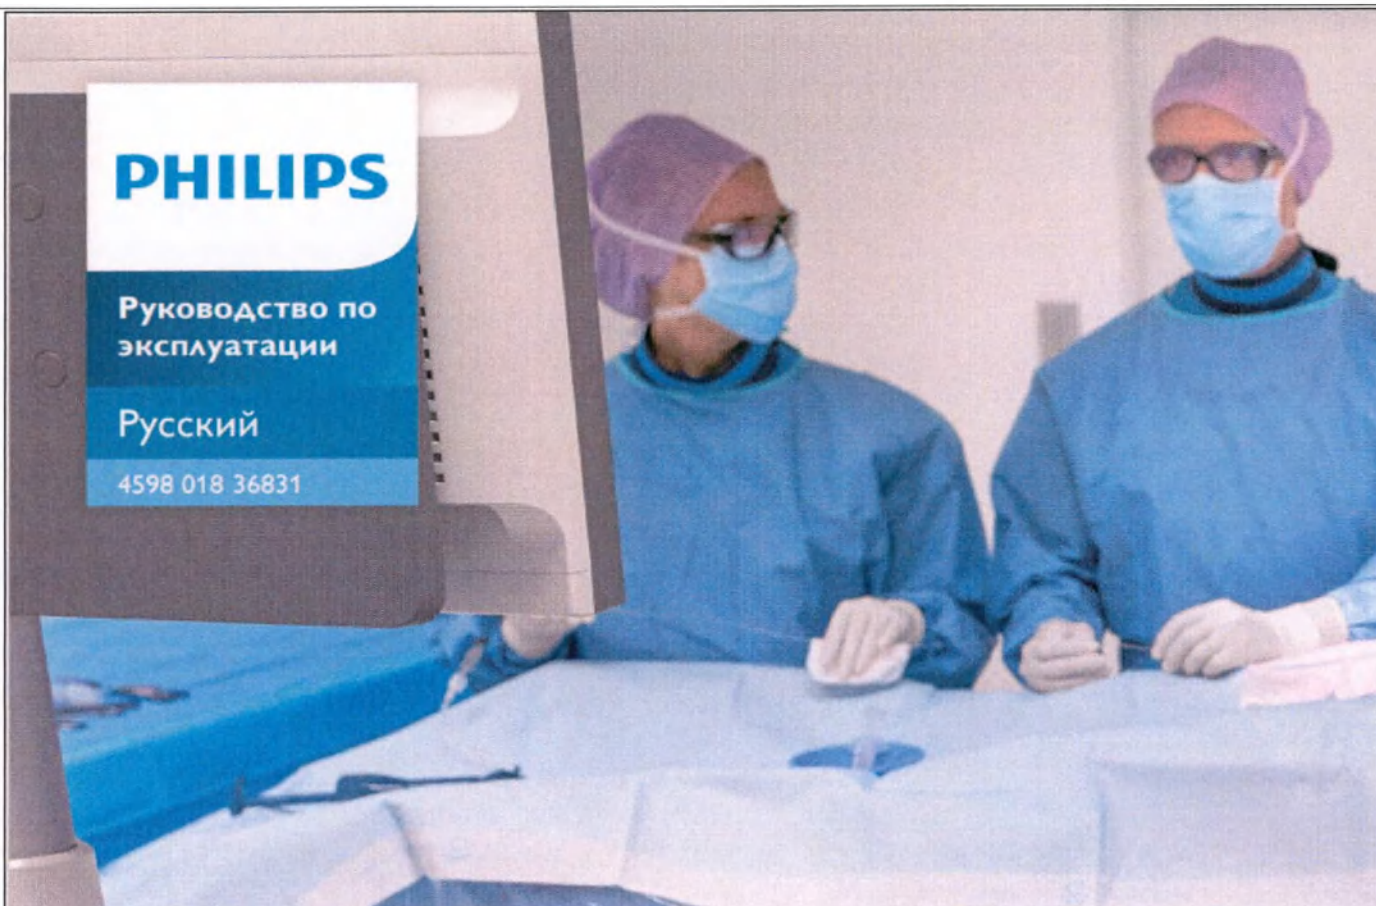

Philips StentBoost Mobile

Версия 1.0

7. Эксплуатационная документация.

PHILIPS

Addendum to the instruction for use of the medical device /

Приложение к руководству по эксплуатации на медицинское изделие

«Fluoroscopic X-ray mobile digital system Zenition 70 with accessories» /

Система флюороскопическая рентгеновская передвижная цифровая Zenition 70 с принадлежностями

Manufactured by

Philips Medical Systems Nederland B. V./
Филипс Медикал Системс Нидерланд Б.В.




Philips Medical Systems Nederland B.V.
Veenpluis 6, 5684 PC Best, the Netherlands
www.philips.com, Register No. 17060498

7. Эксплуатационная документация.



1. Пульт дистанционного управления.

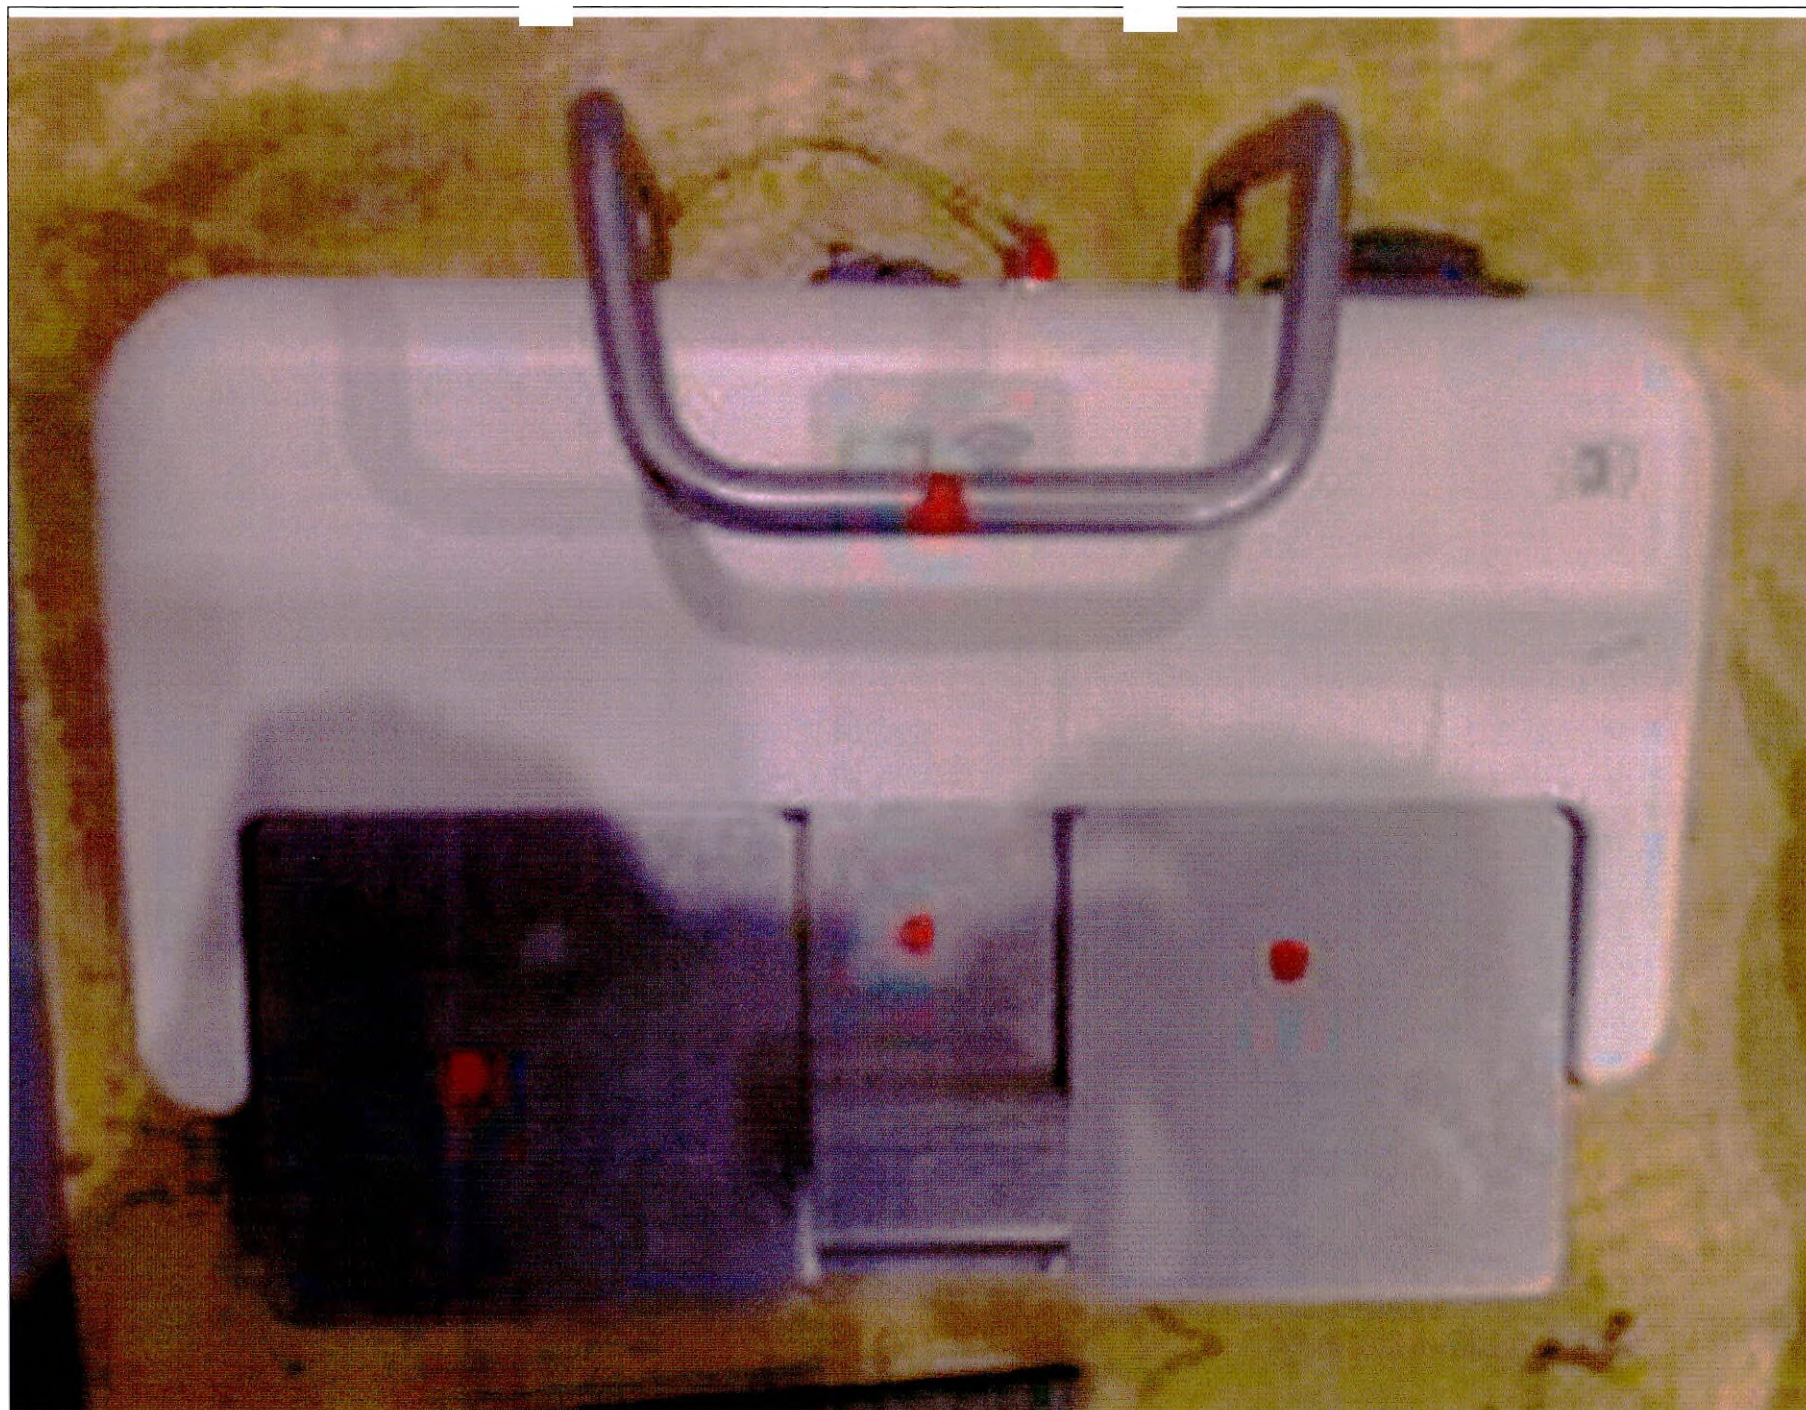


2. Беспроводной ножной переключатель.




3. а) Зарядное устройство беспроводного ножного переключателя.



3. b) Зарядное устройство беспроводного ножного переключателя.

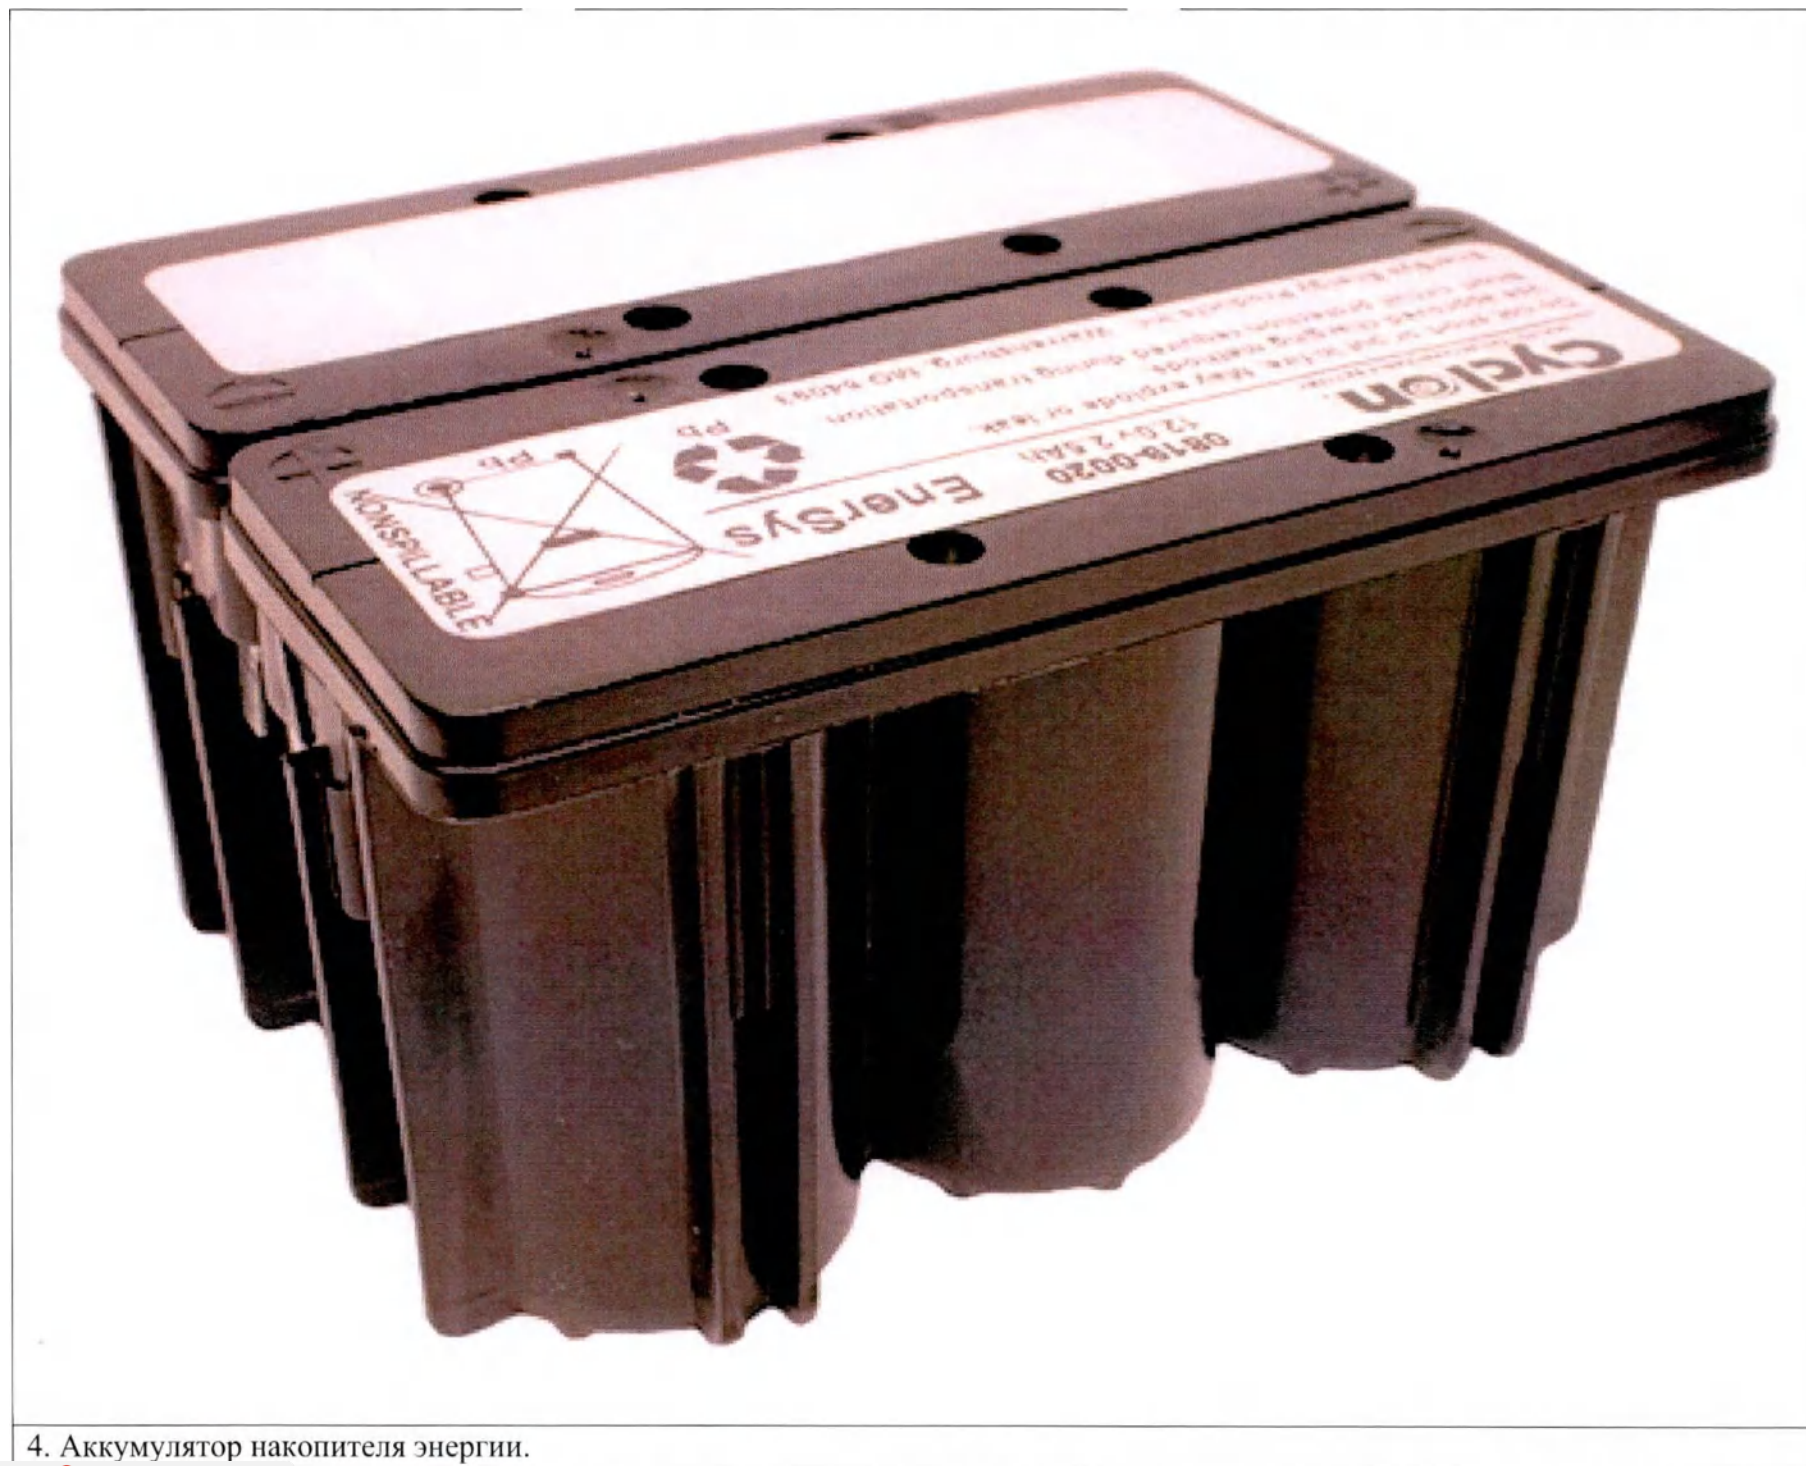


4. Аккумулятор накопителя энергии.

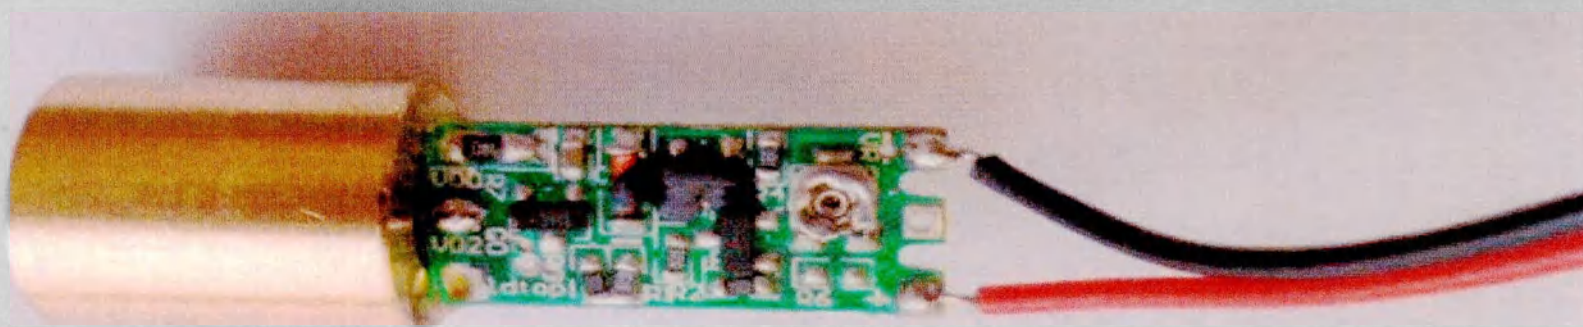

5. Лазерный прицел детектора.



6. Лазерный прицел трубки.

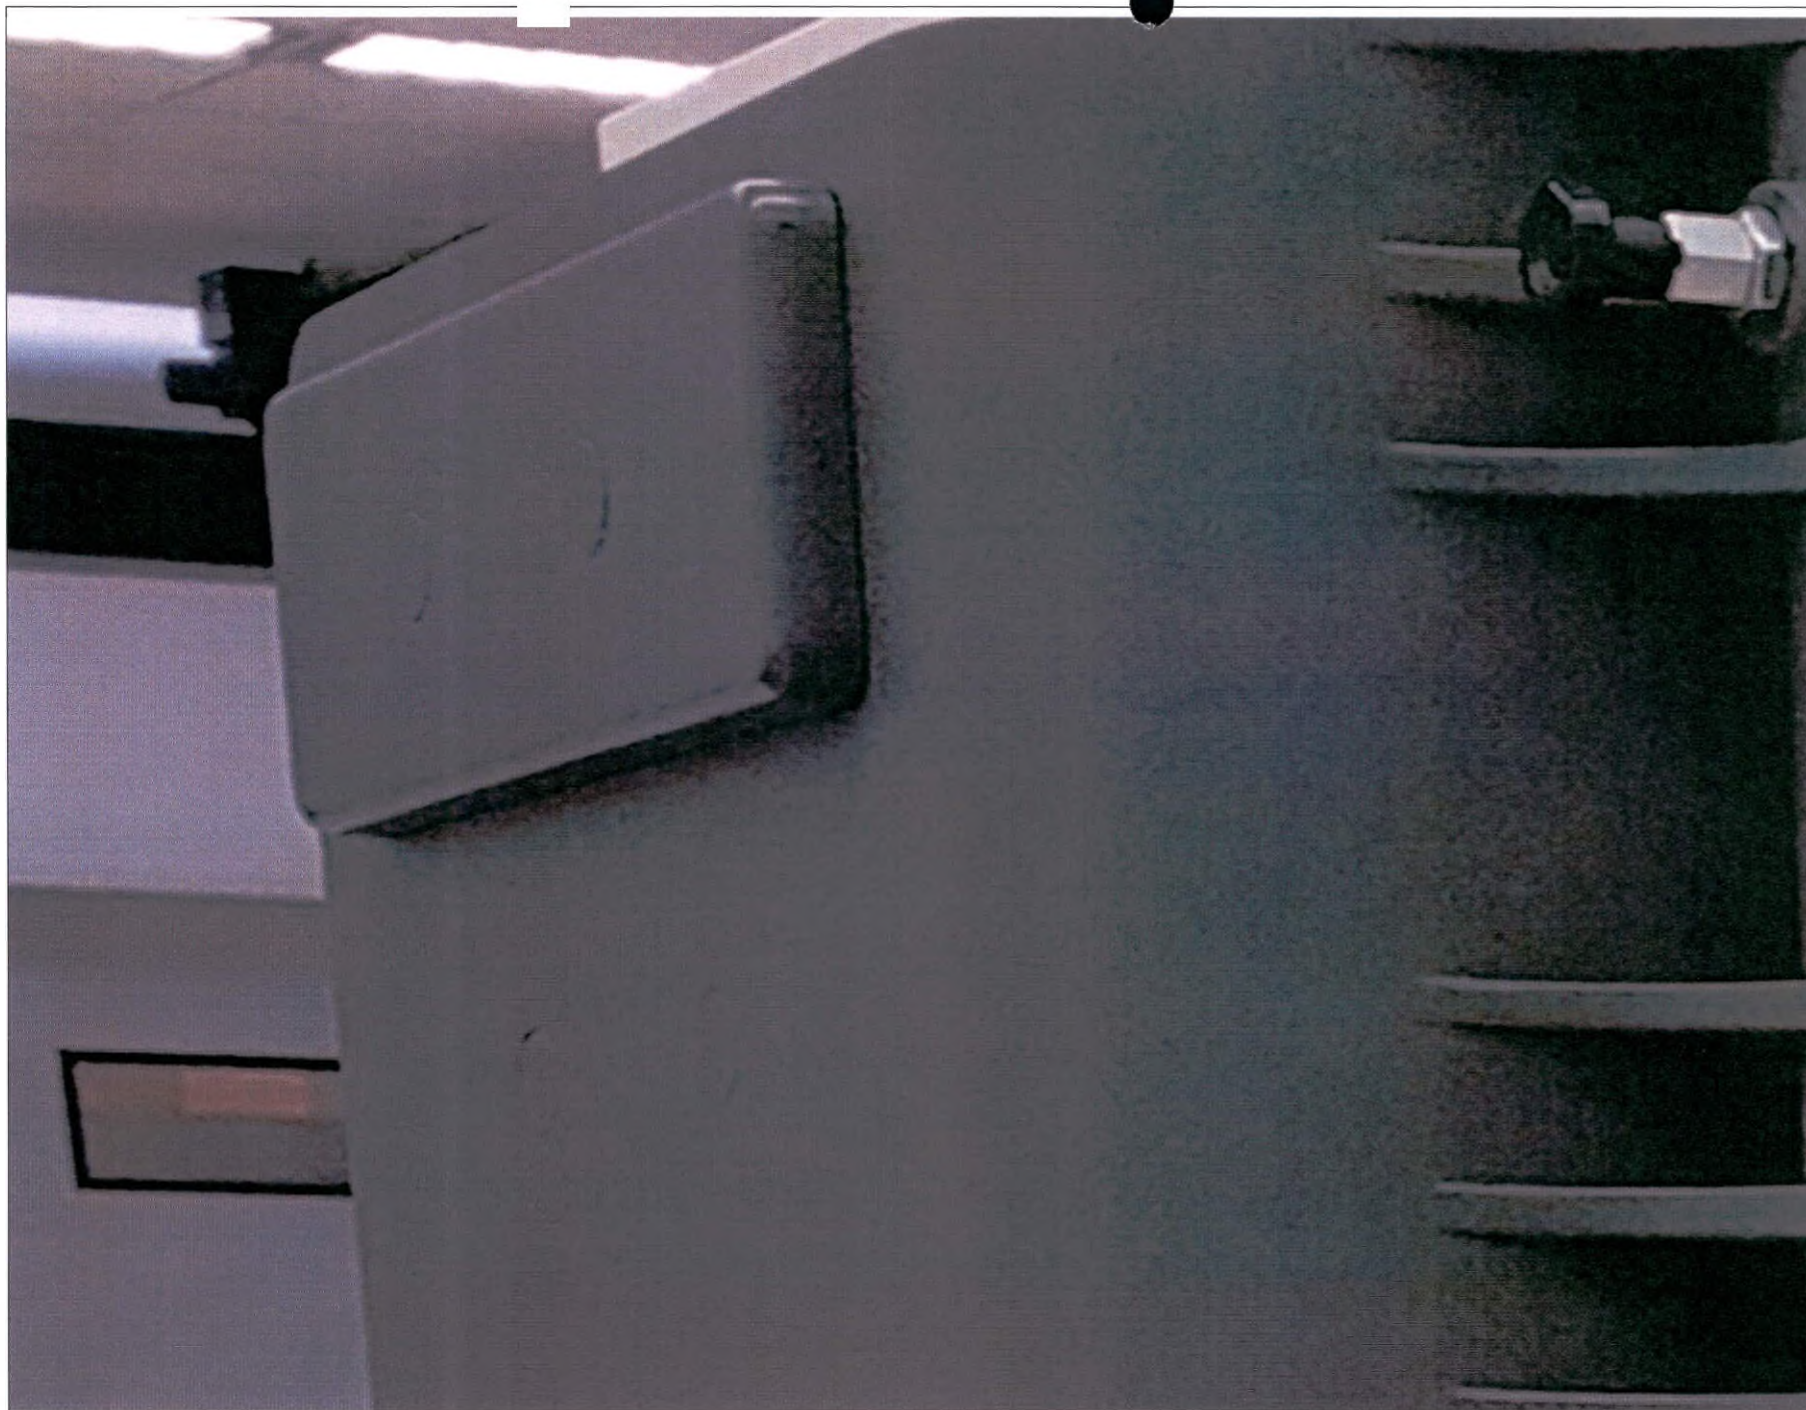

7. Антенны беспроводной связи



8. а) Чехлы тканевые.



8. b) Чехлы тканевые.



8. с) Чехлы тканевые.



9. Медицинский принтер Sony UP-971AD.



10. Медицинский принтер Sony UP-991AD.




11. а) Бумага для принтера.



11. б) Бумага для принтера.




11. с) Бумага для принтера.

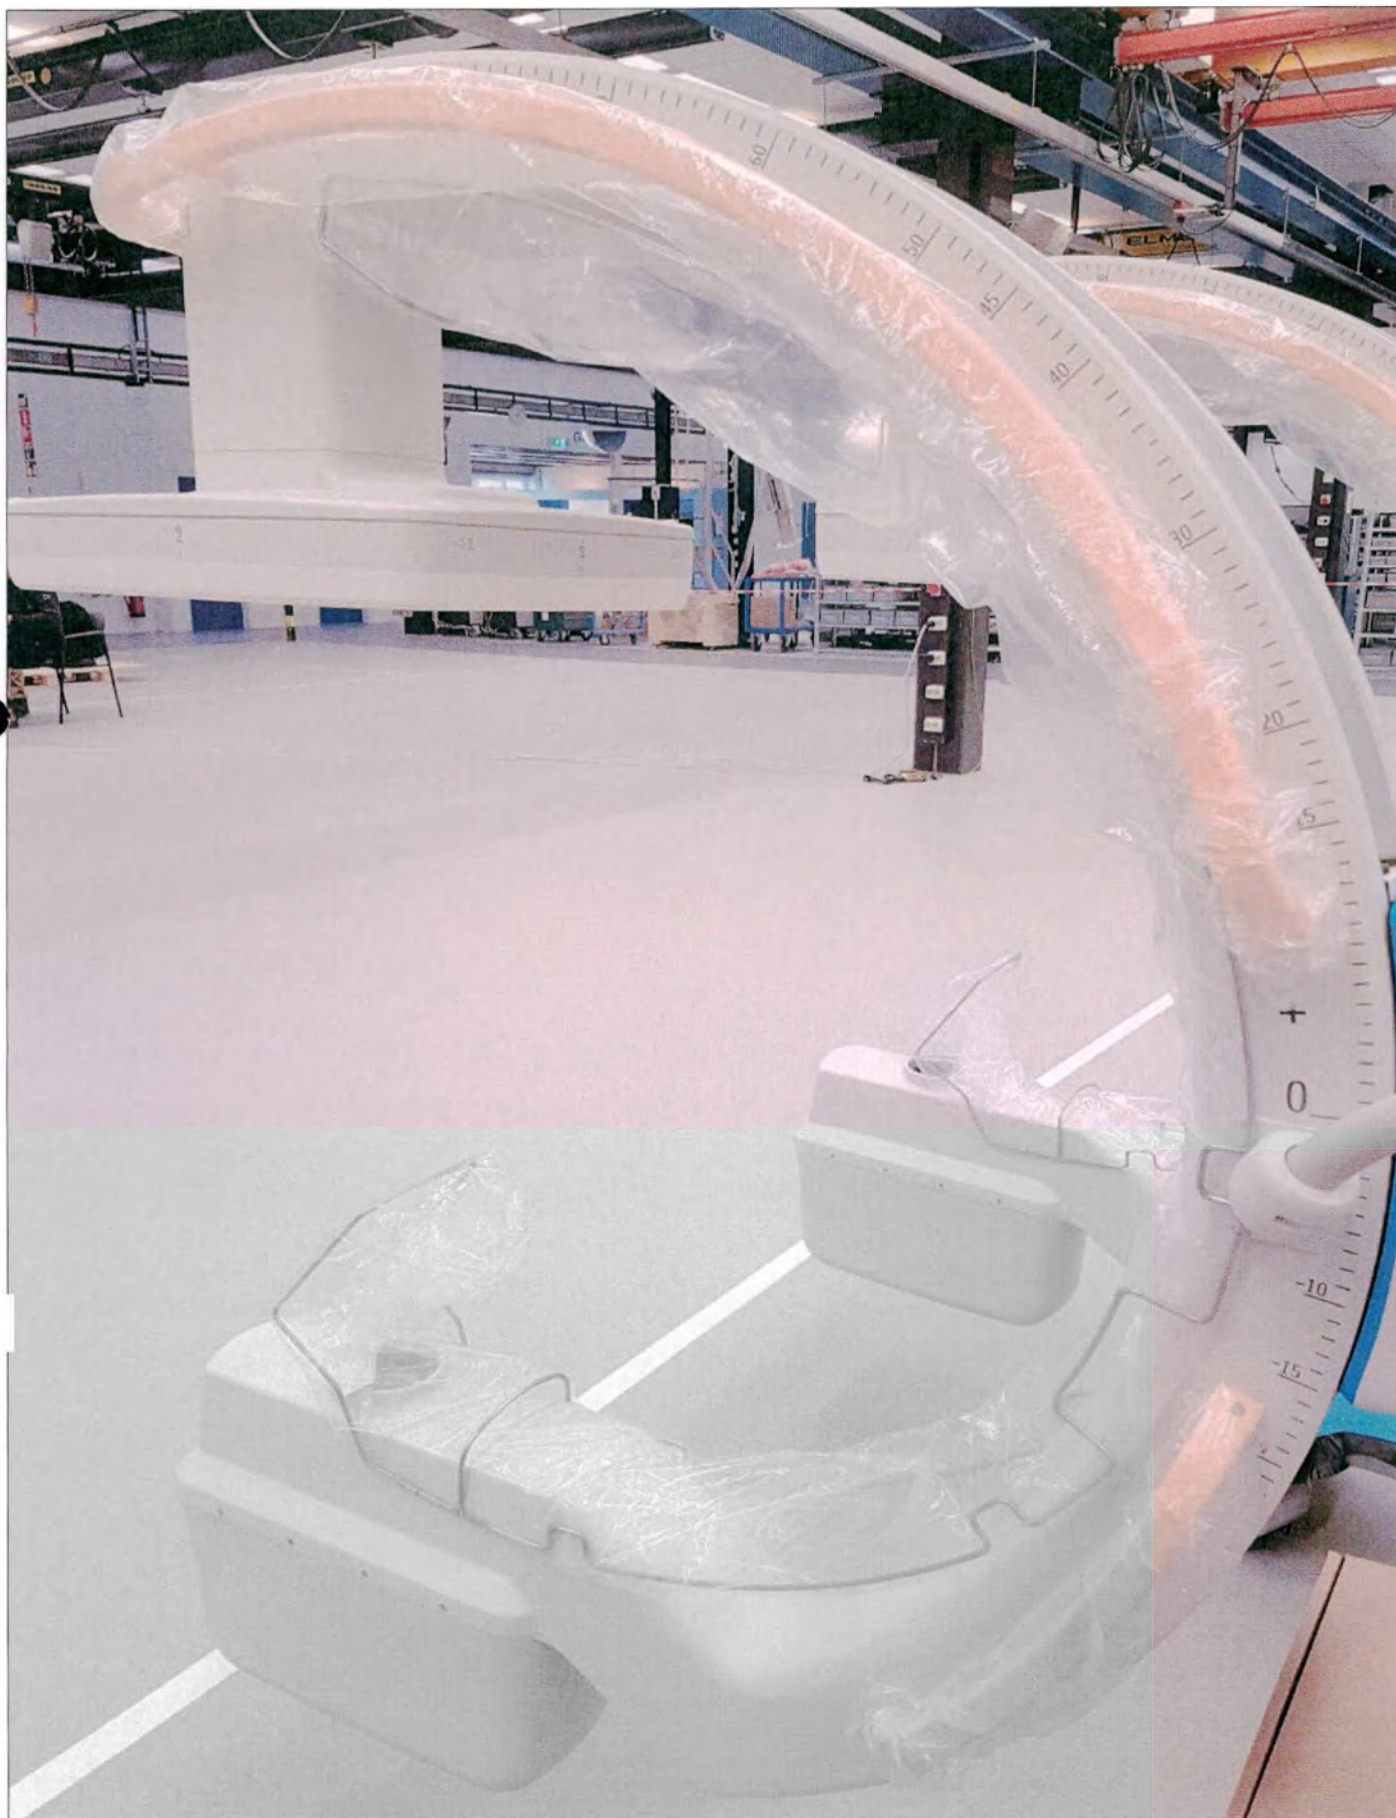

12. Подпружиненная дуга для чехлов С-дуги.



13. Модули программные .

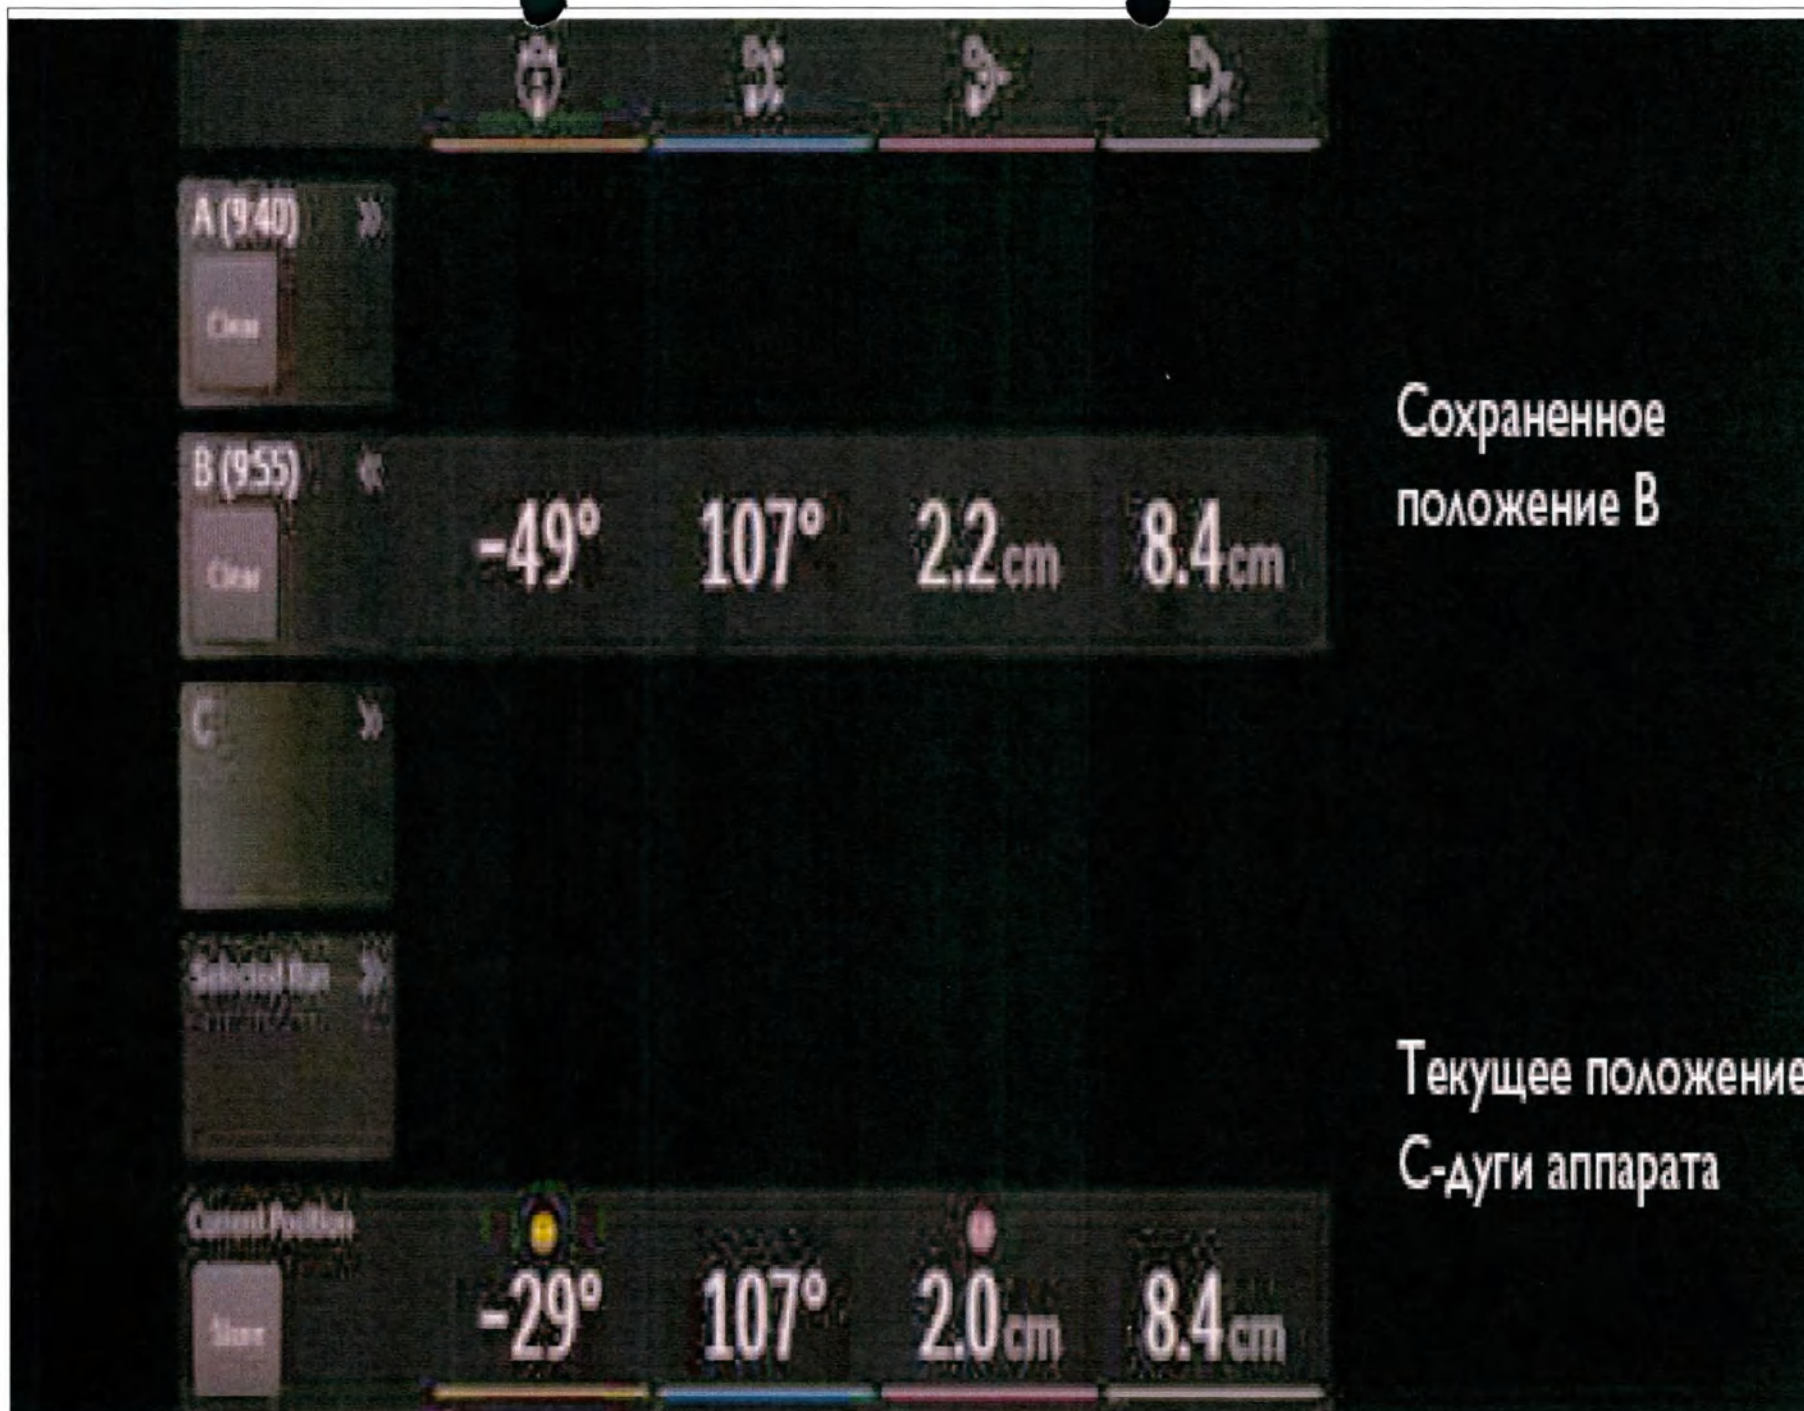


13.1 Модуль программный: Отслеживание положения




13.2 Модуль программный: Инструмент очерчивания




13.2 Модуль программный: Инструмент очерчивания

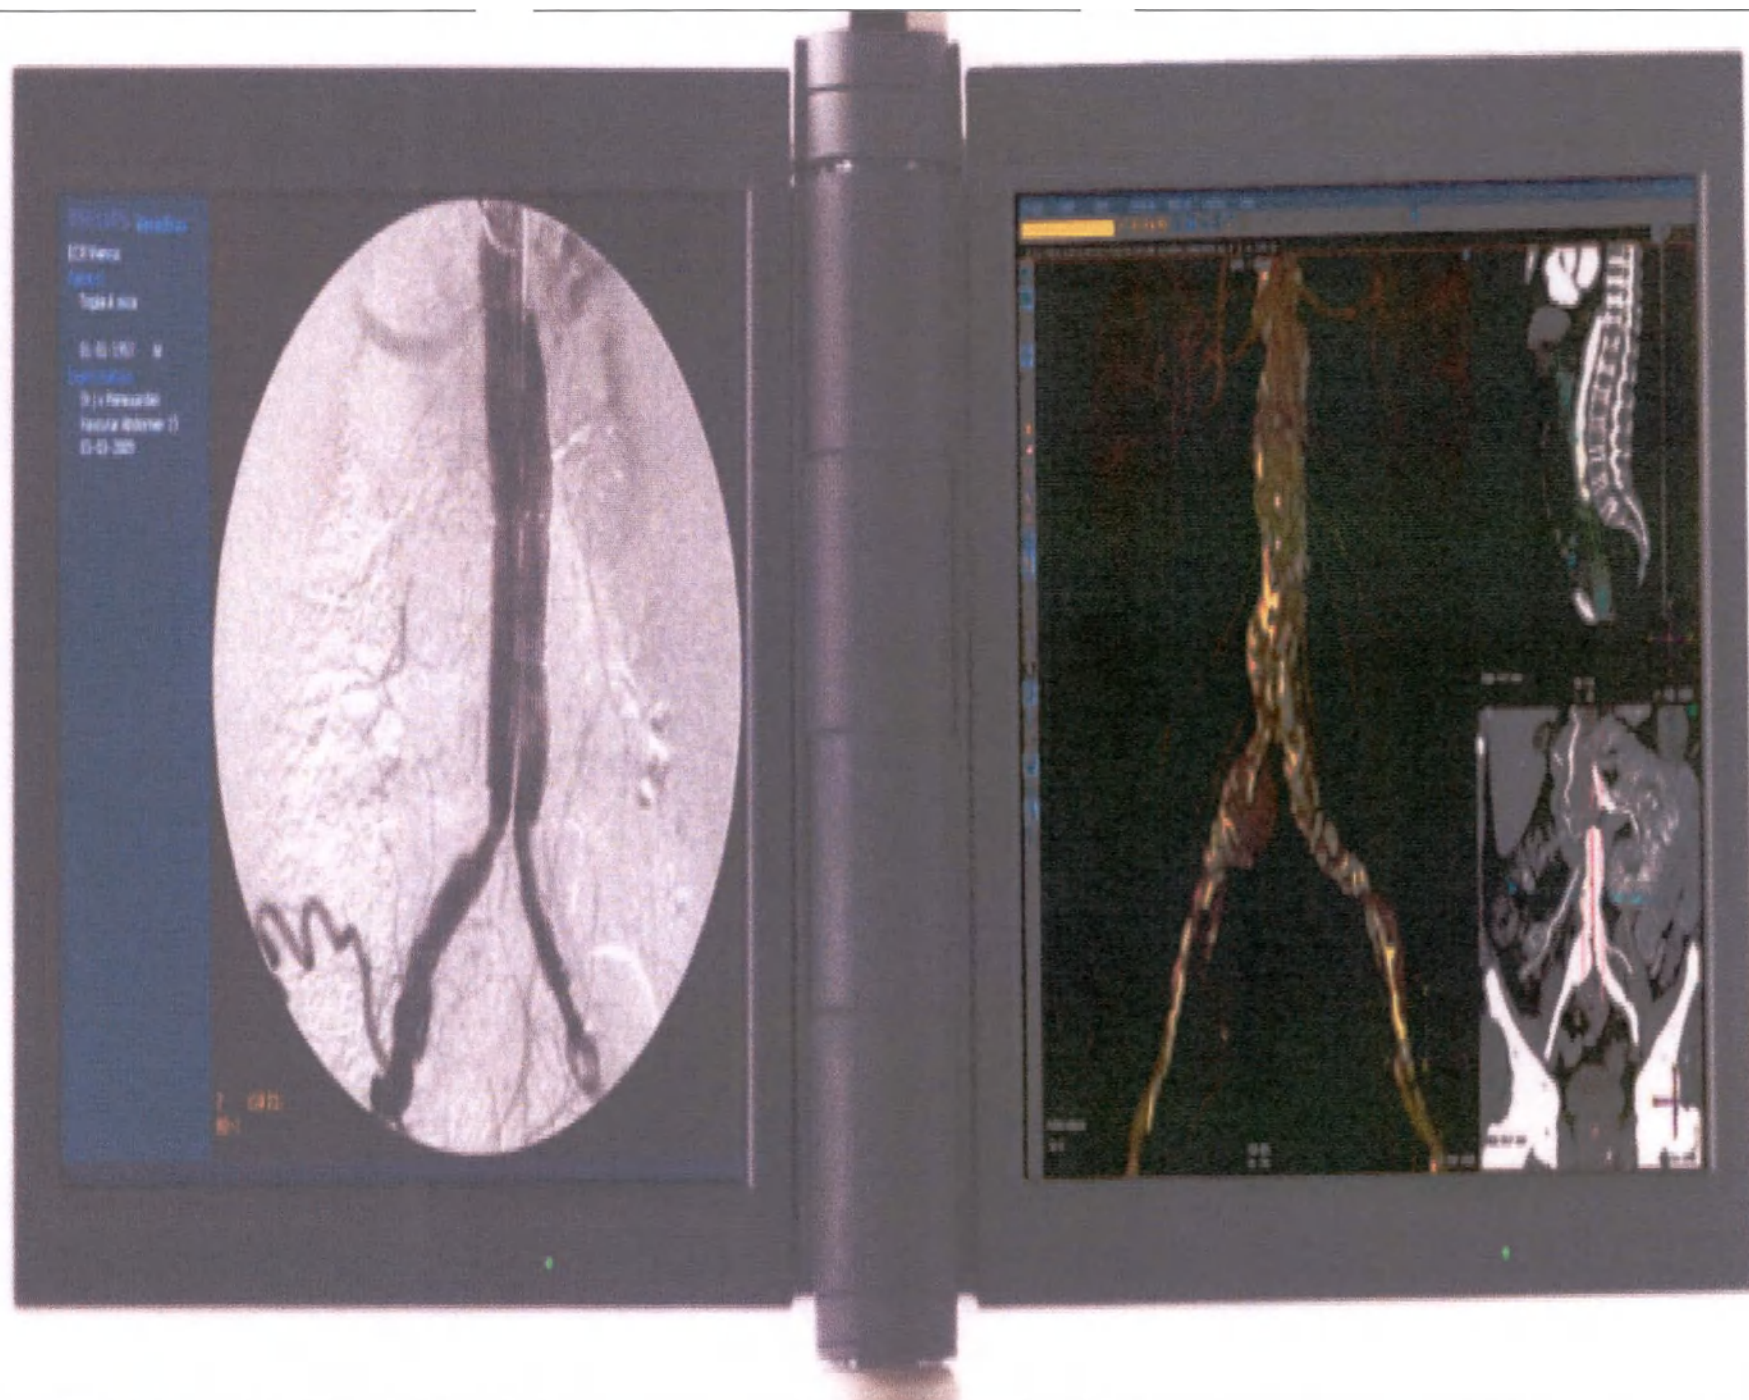


13.3 Модуль программный: Функция просмотр видеосигнала от внешних источников

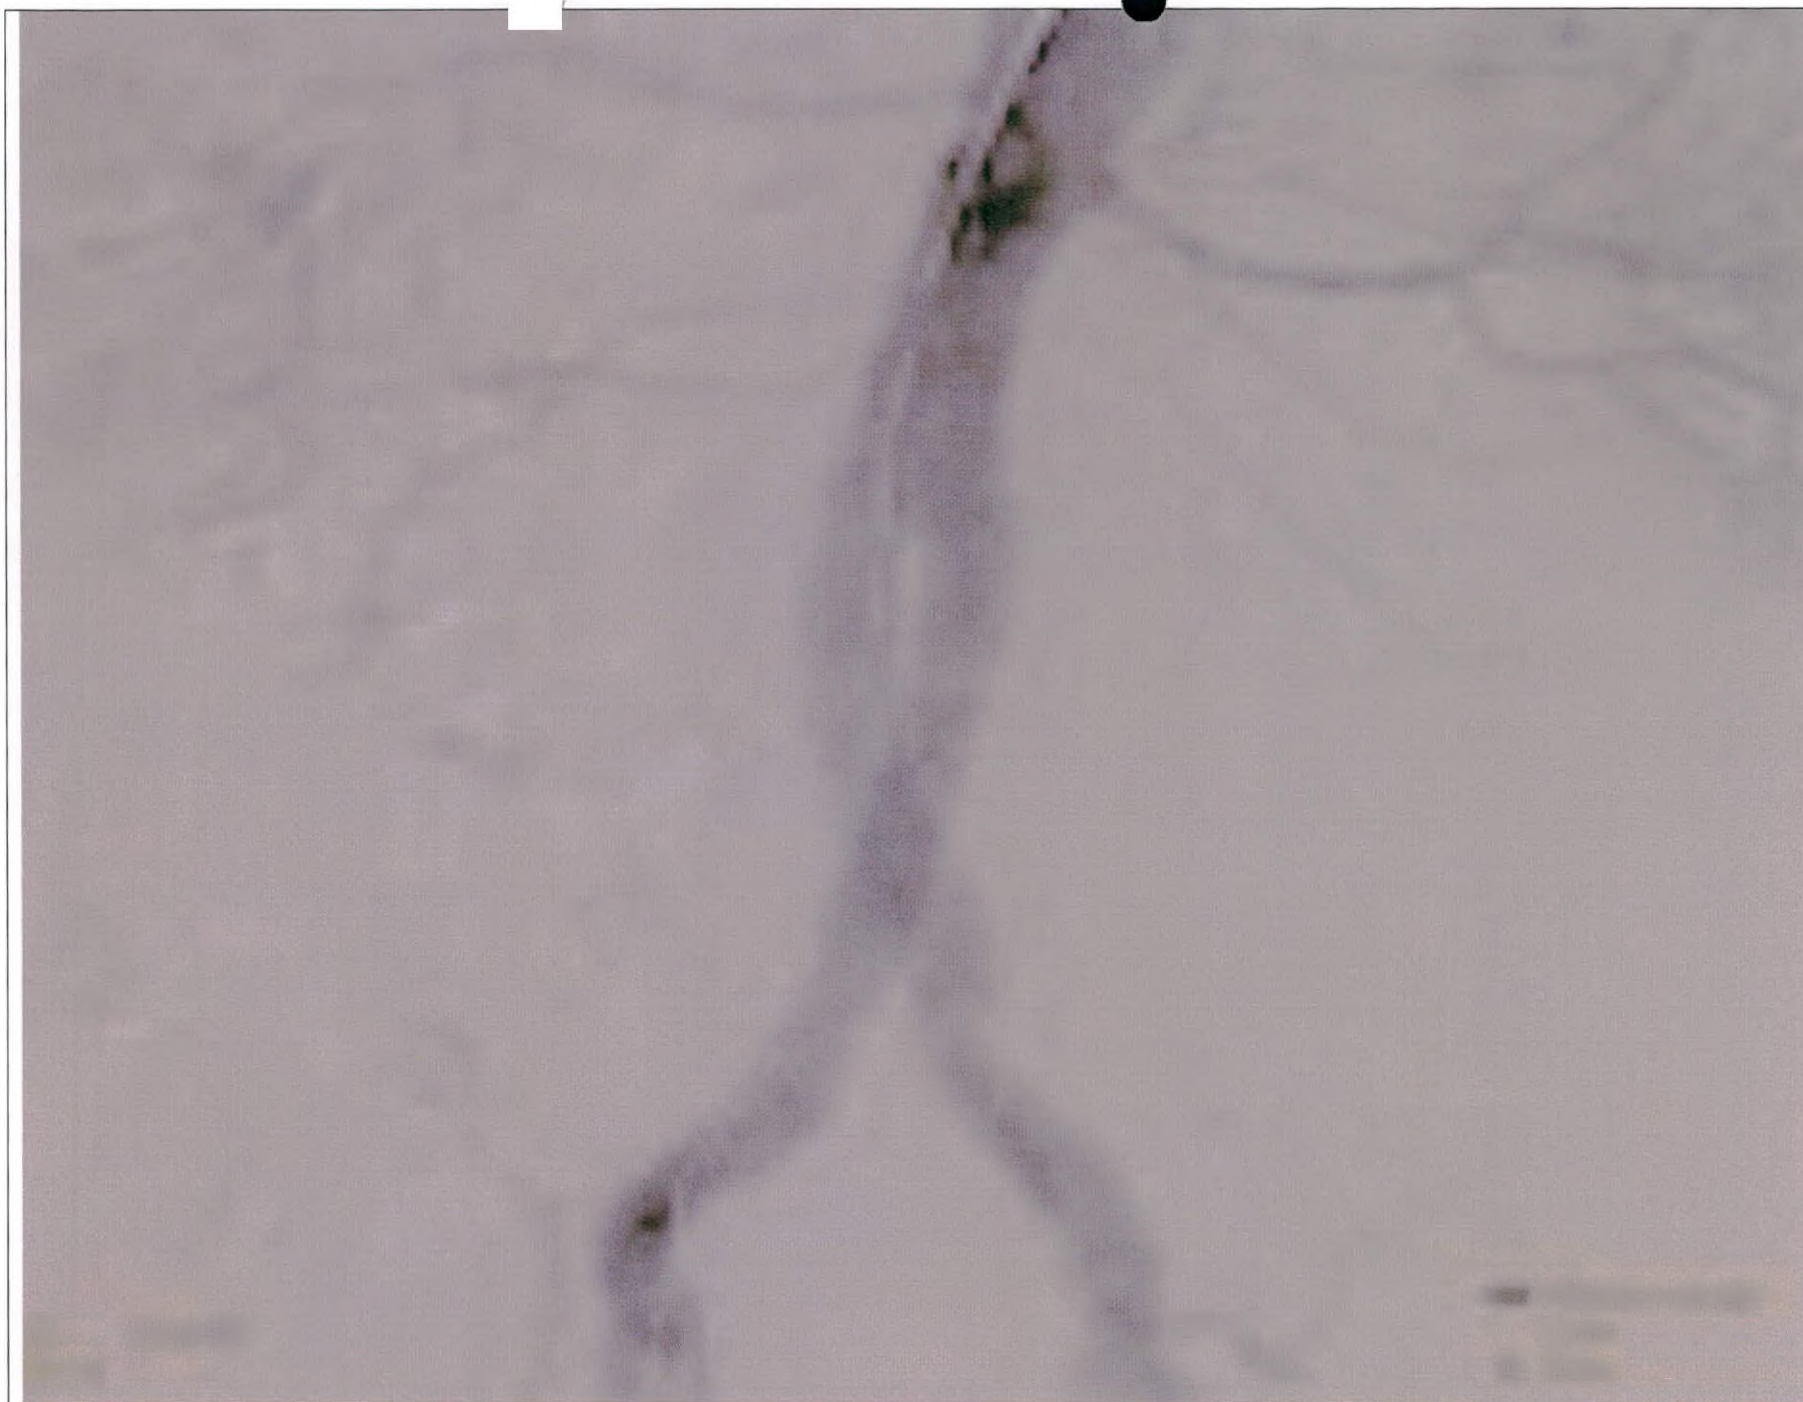

13.4 Модуль программный: Функция расширенной визуализации сосудов

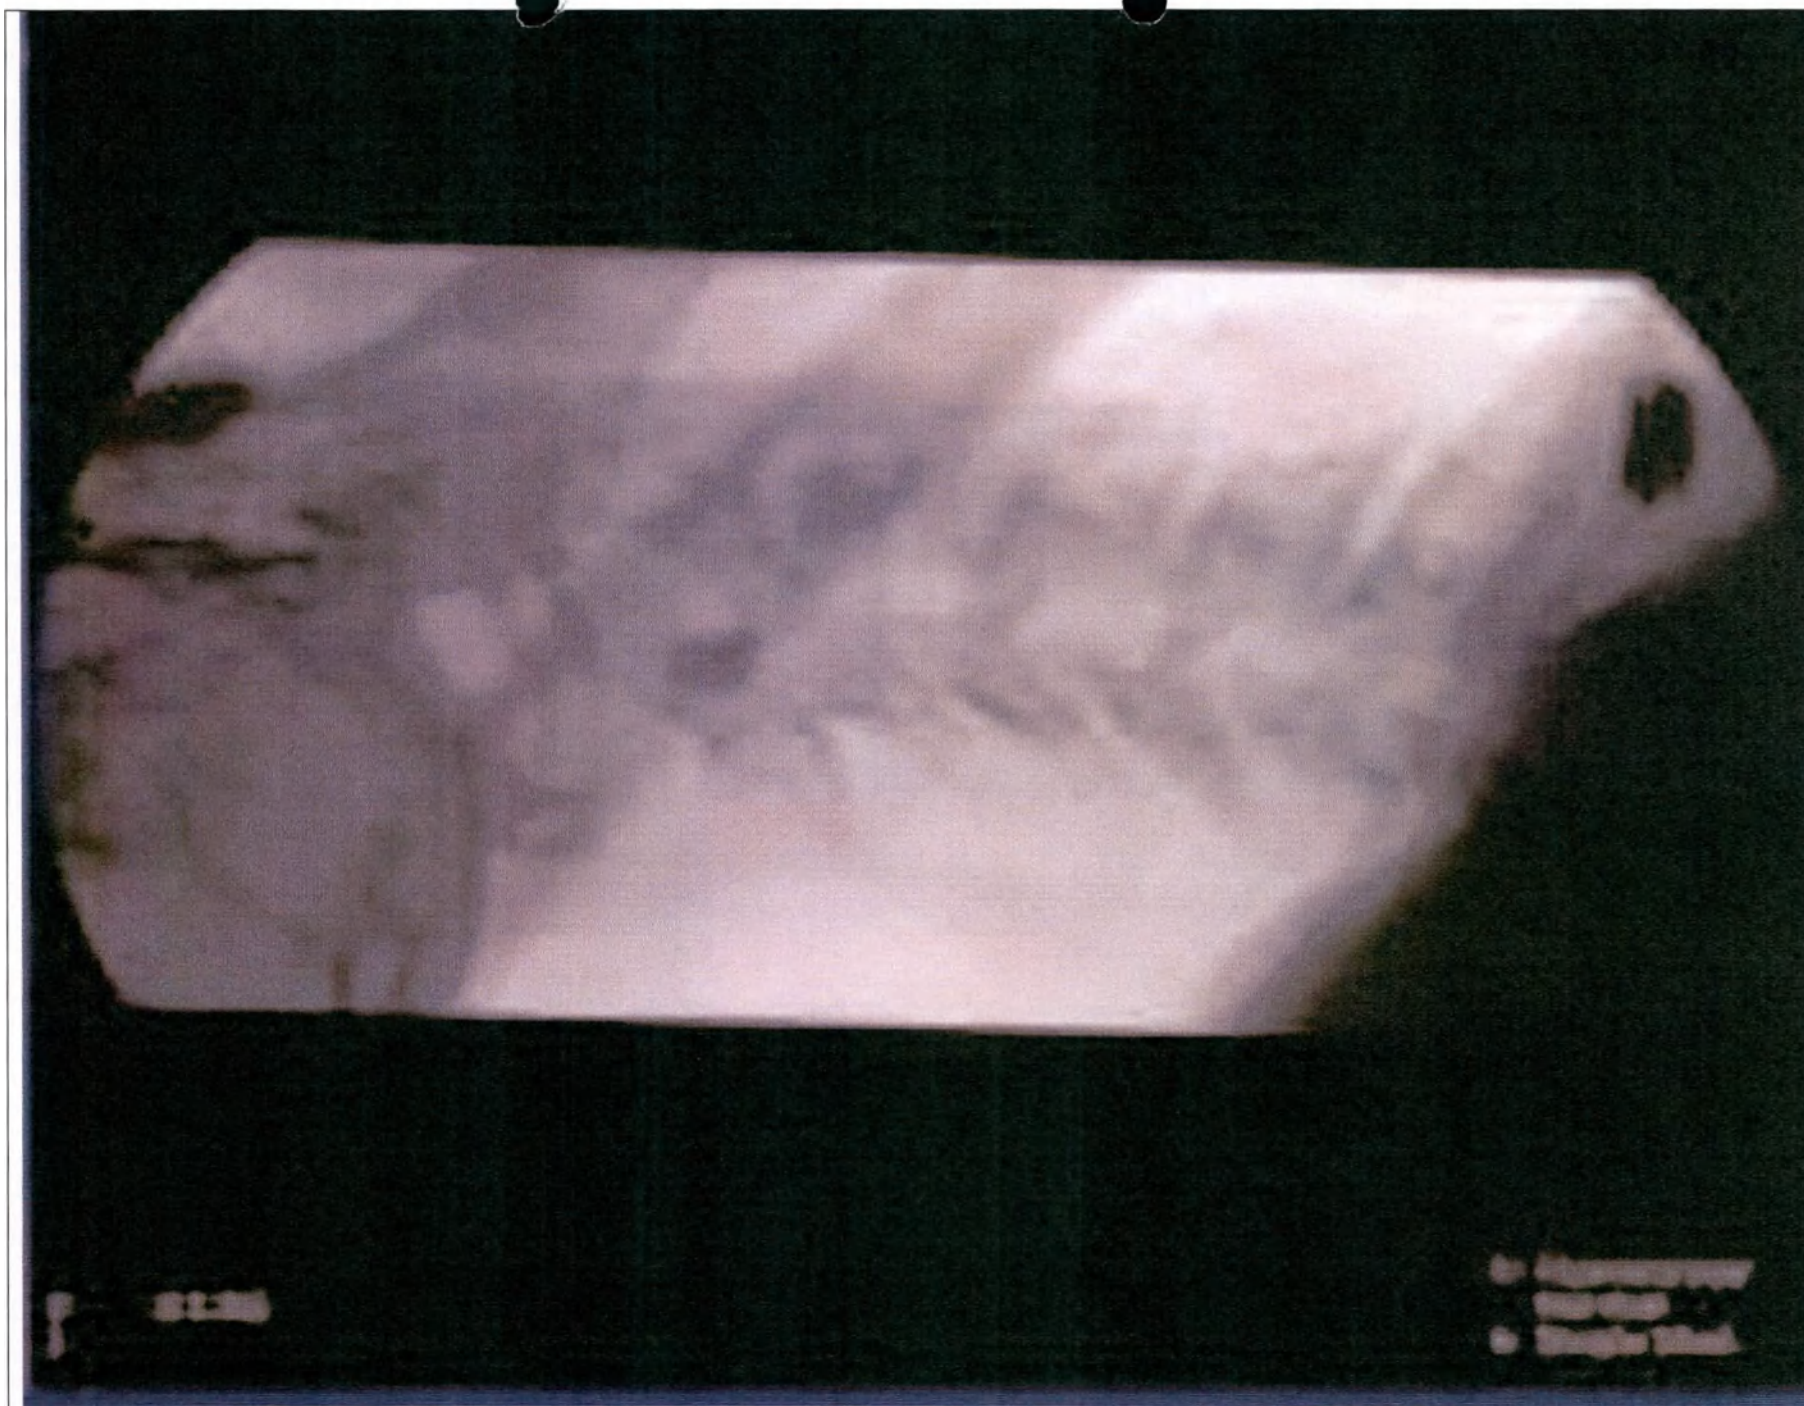


13.5 Модуль программный: Расширенное исследование болевого синдрома

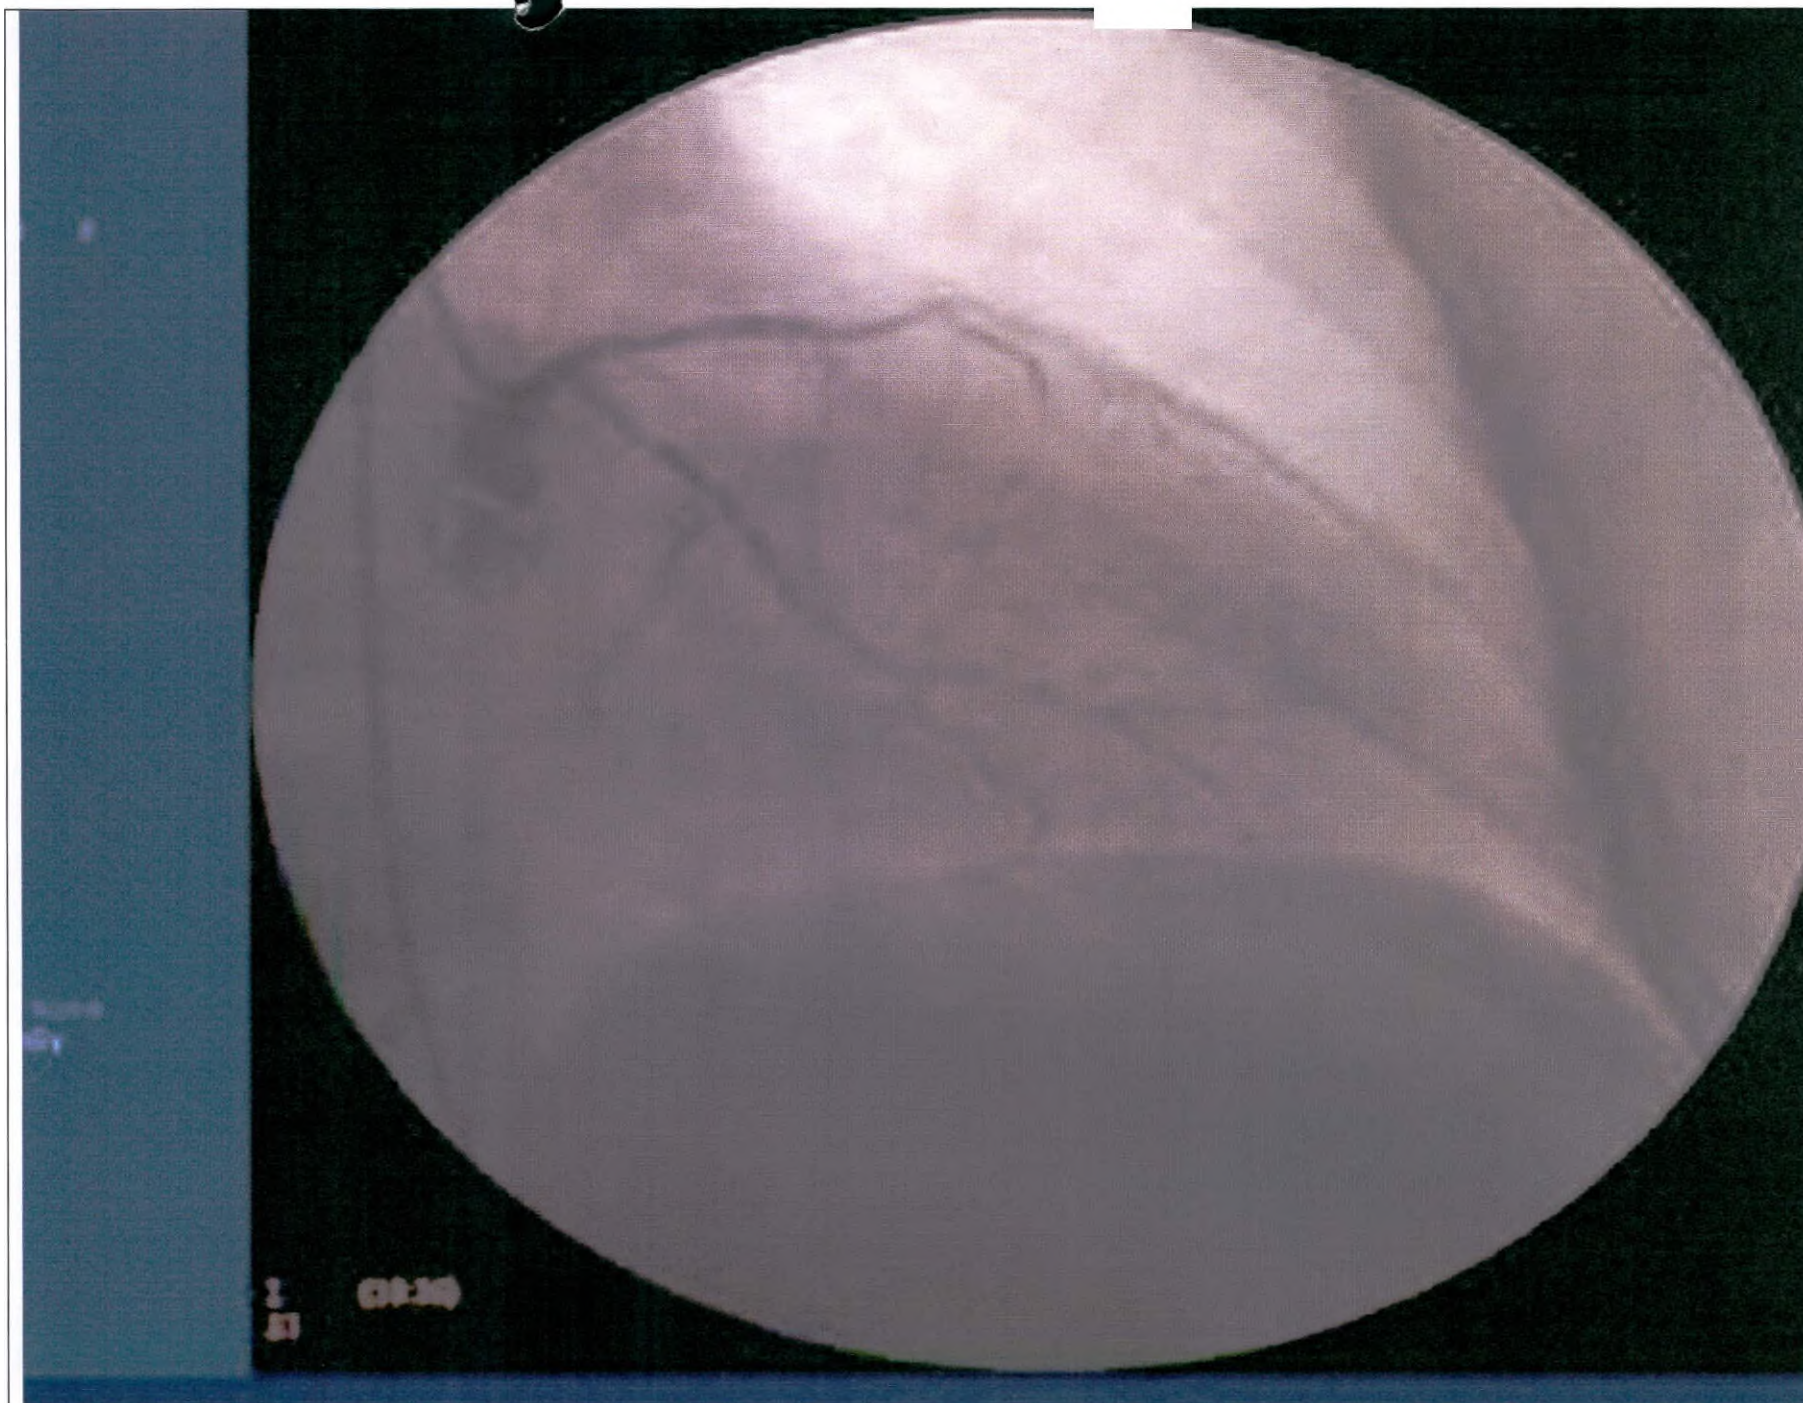

13.6 Модуль программный: Расширенная визуализация сердца



13.7 Модуль программный: Расширенная визуализация сердца и сосудов

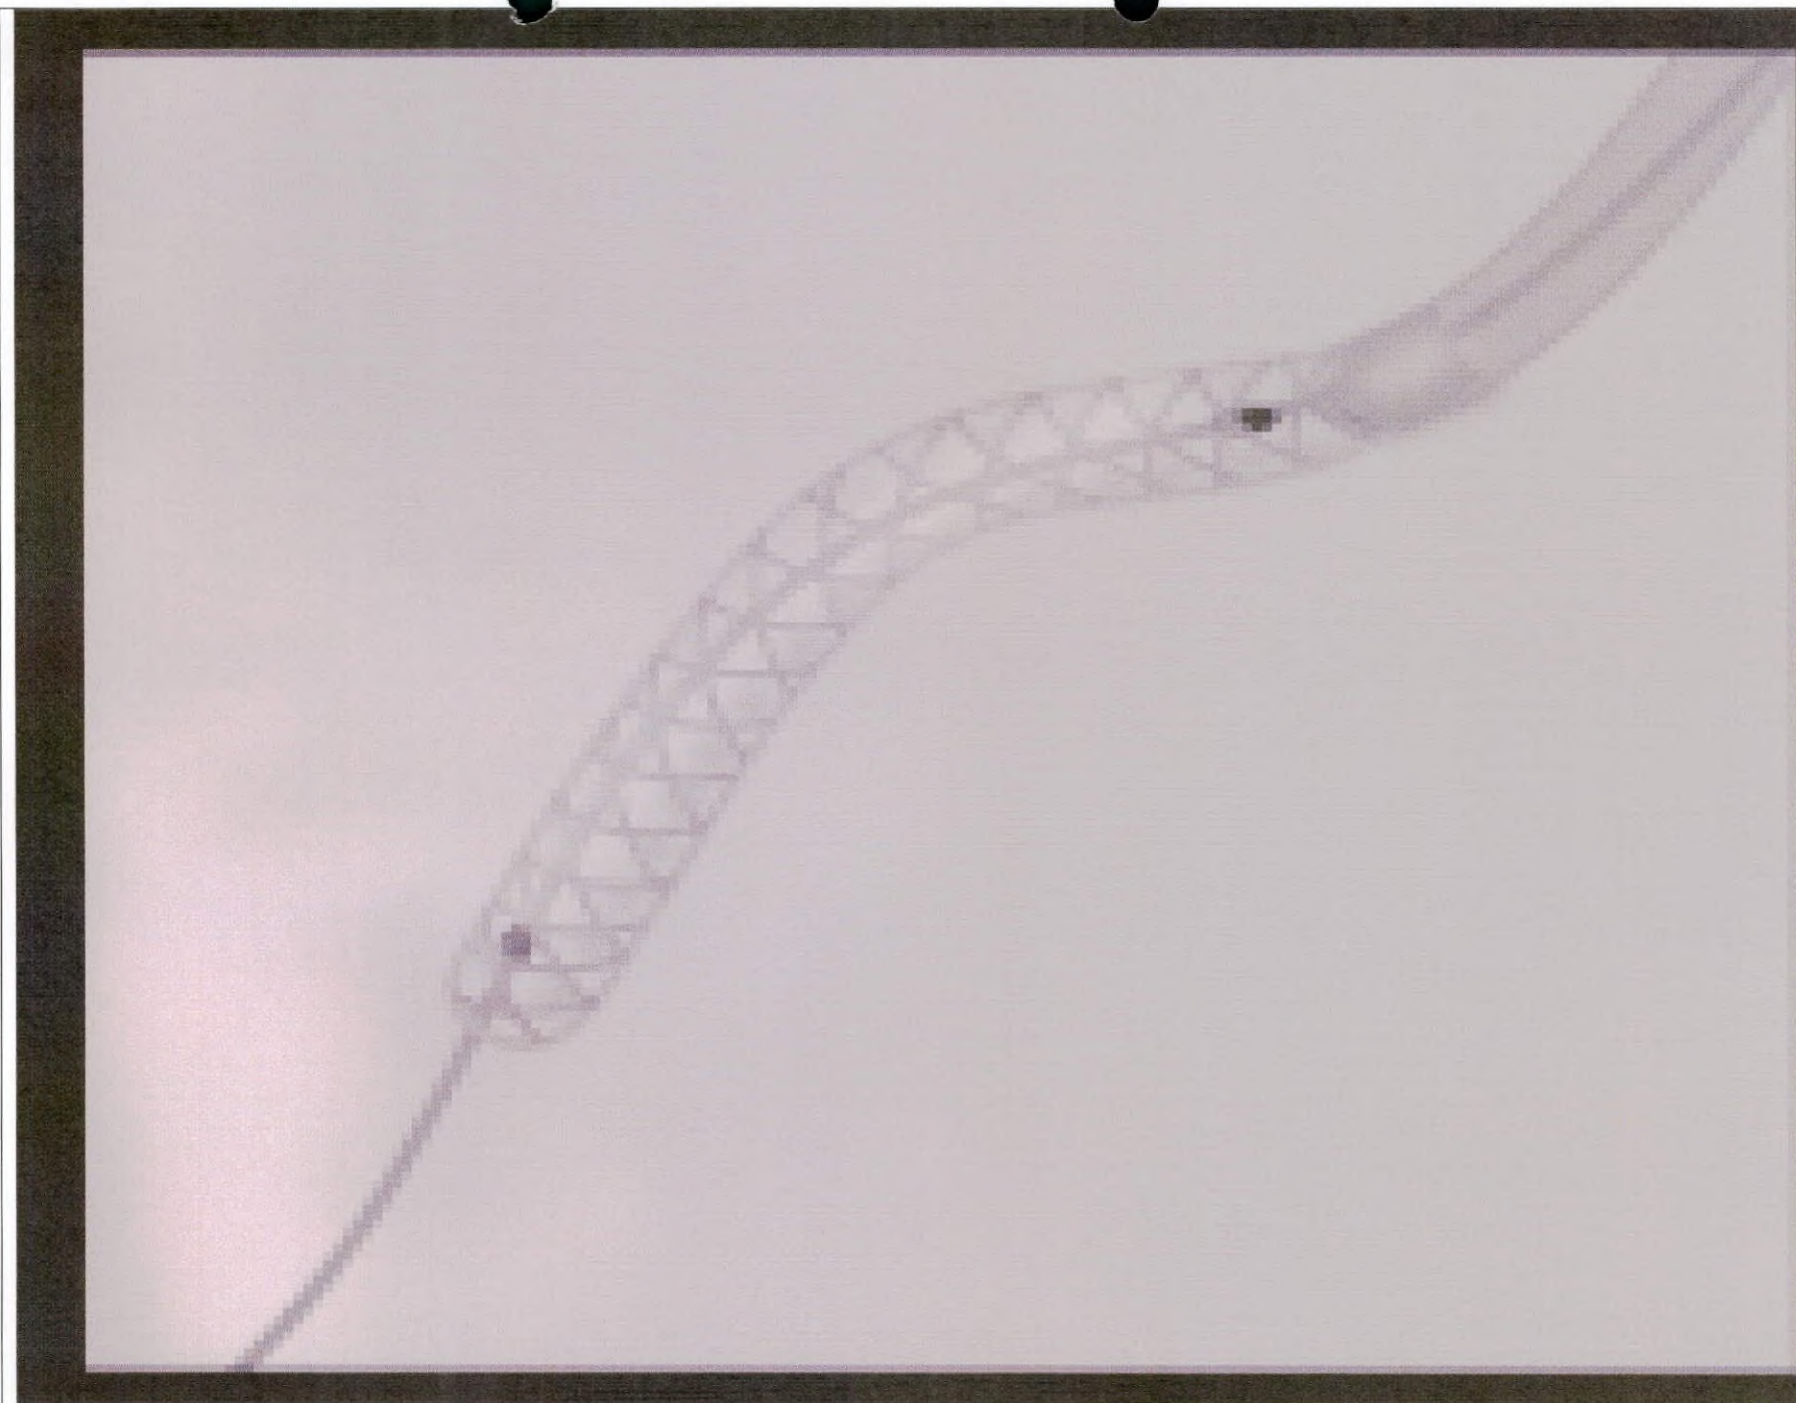

13.8 Модуль программный: Визуализации стентов в сосудах StentBoost Mobile




14. Лицензии DICOM.



15. Блок для сохранения и передачи данных.

Упаковка:

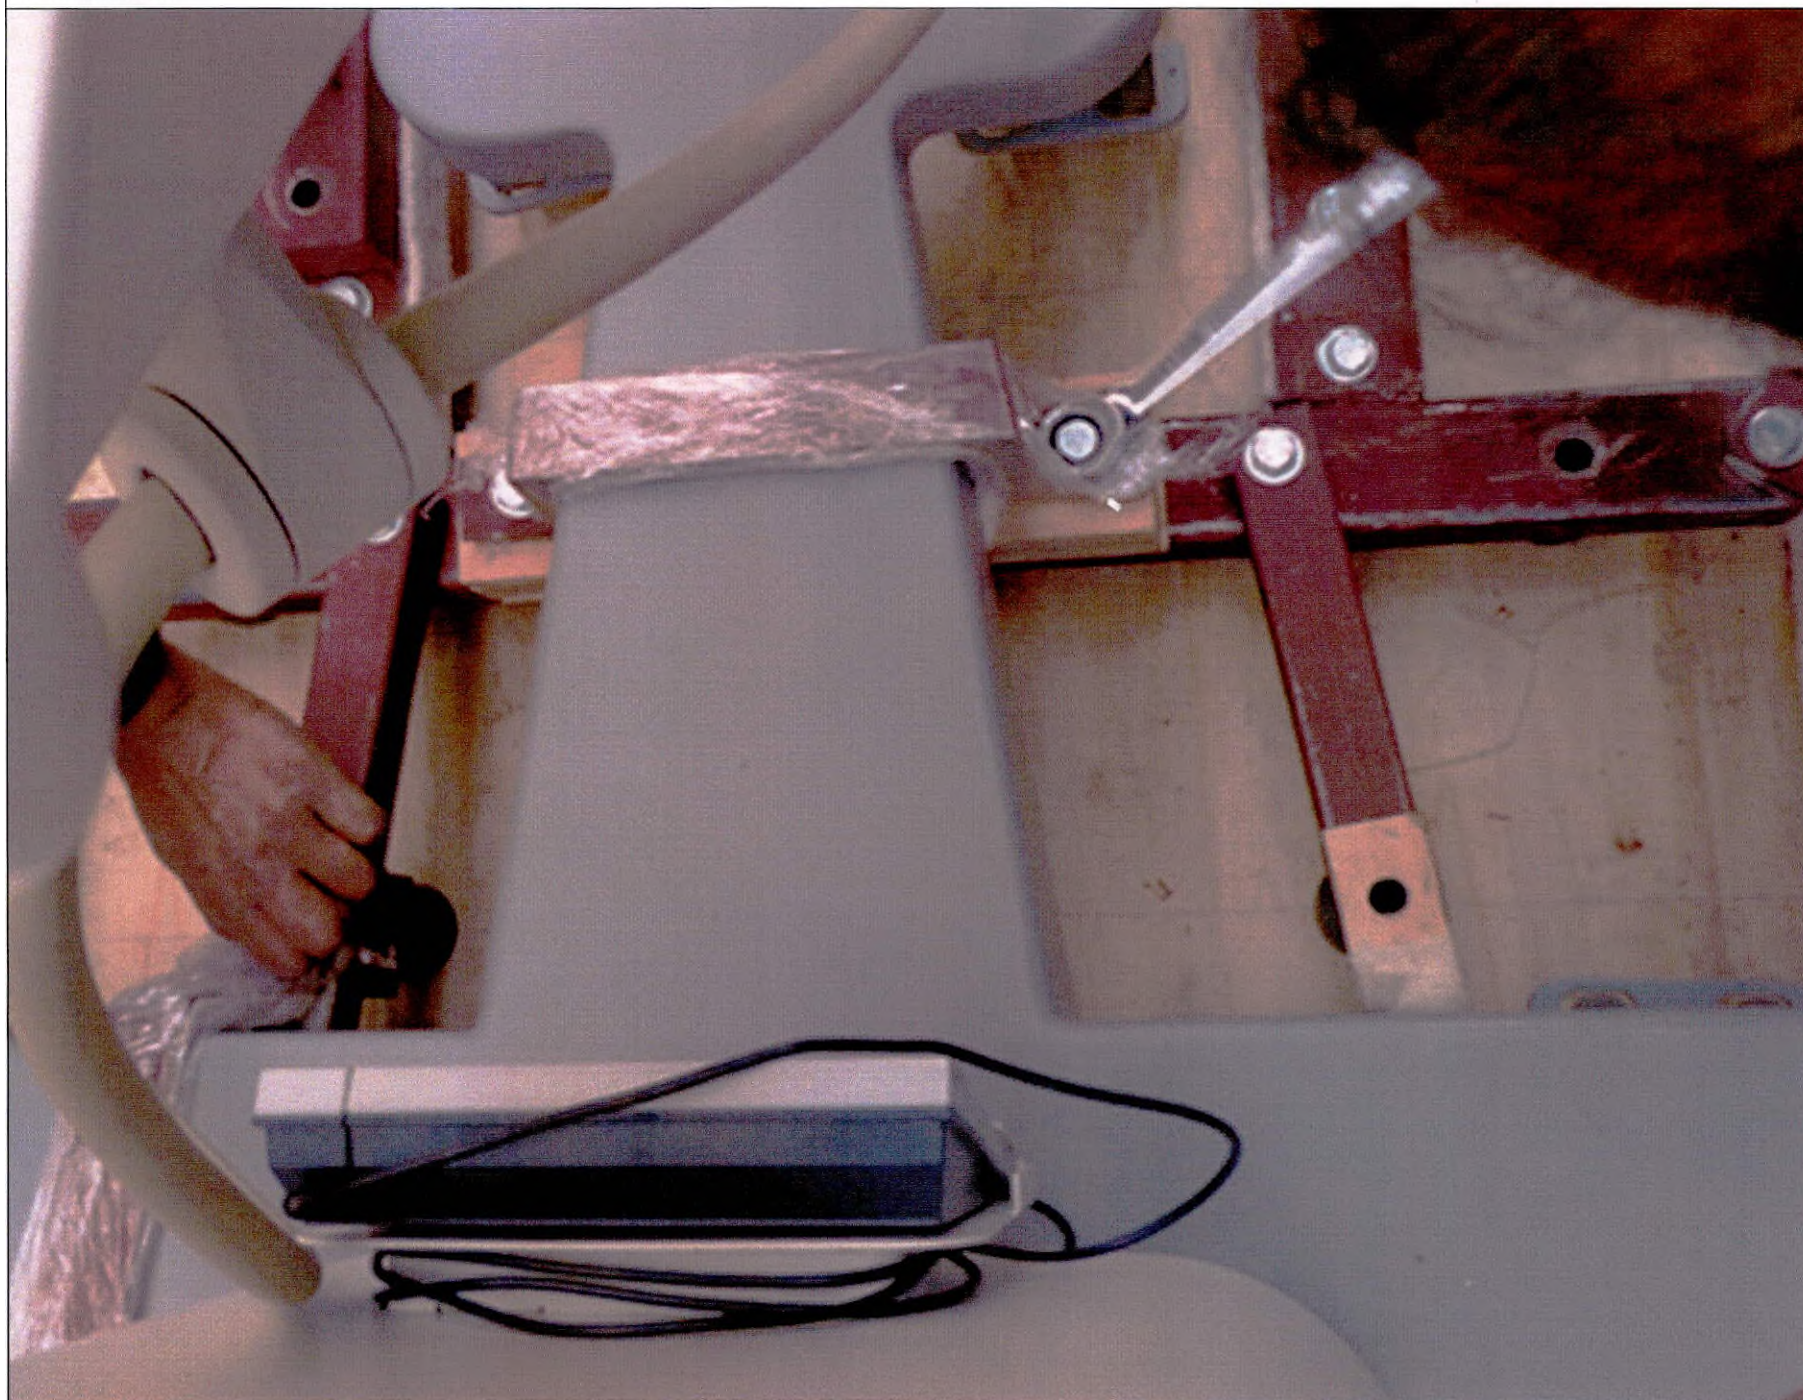




1. b) Закрепление стойки С-дуги на поддоне



2. б) Накрытие алюминиевой фольгой стойки С-дуги и оборачивание пластиковой пленкой после процедуры вакуумизации.



3. Деревянный ящик со стойкой С-дуги.

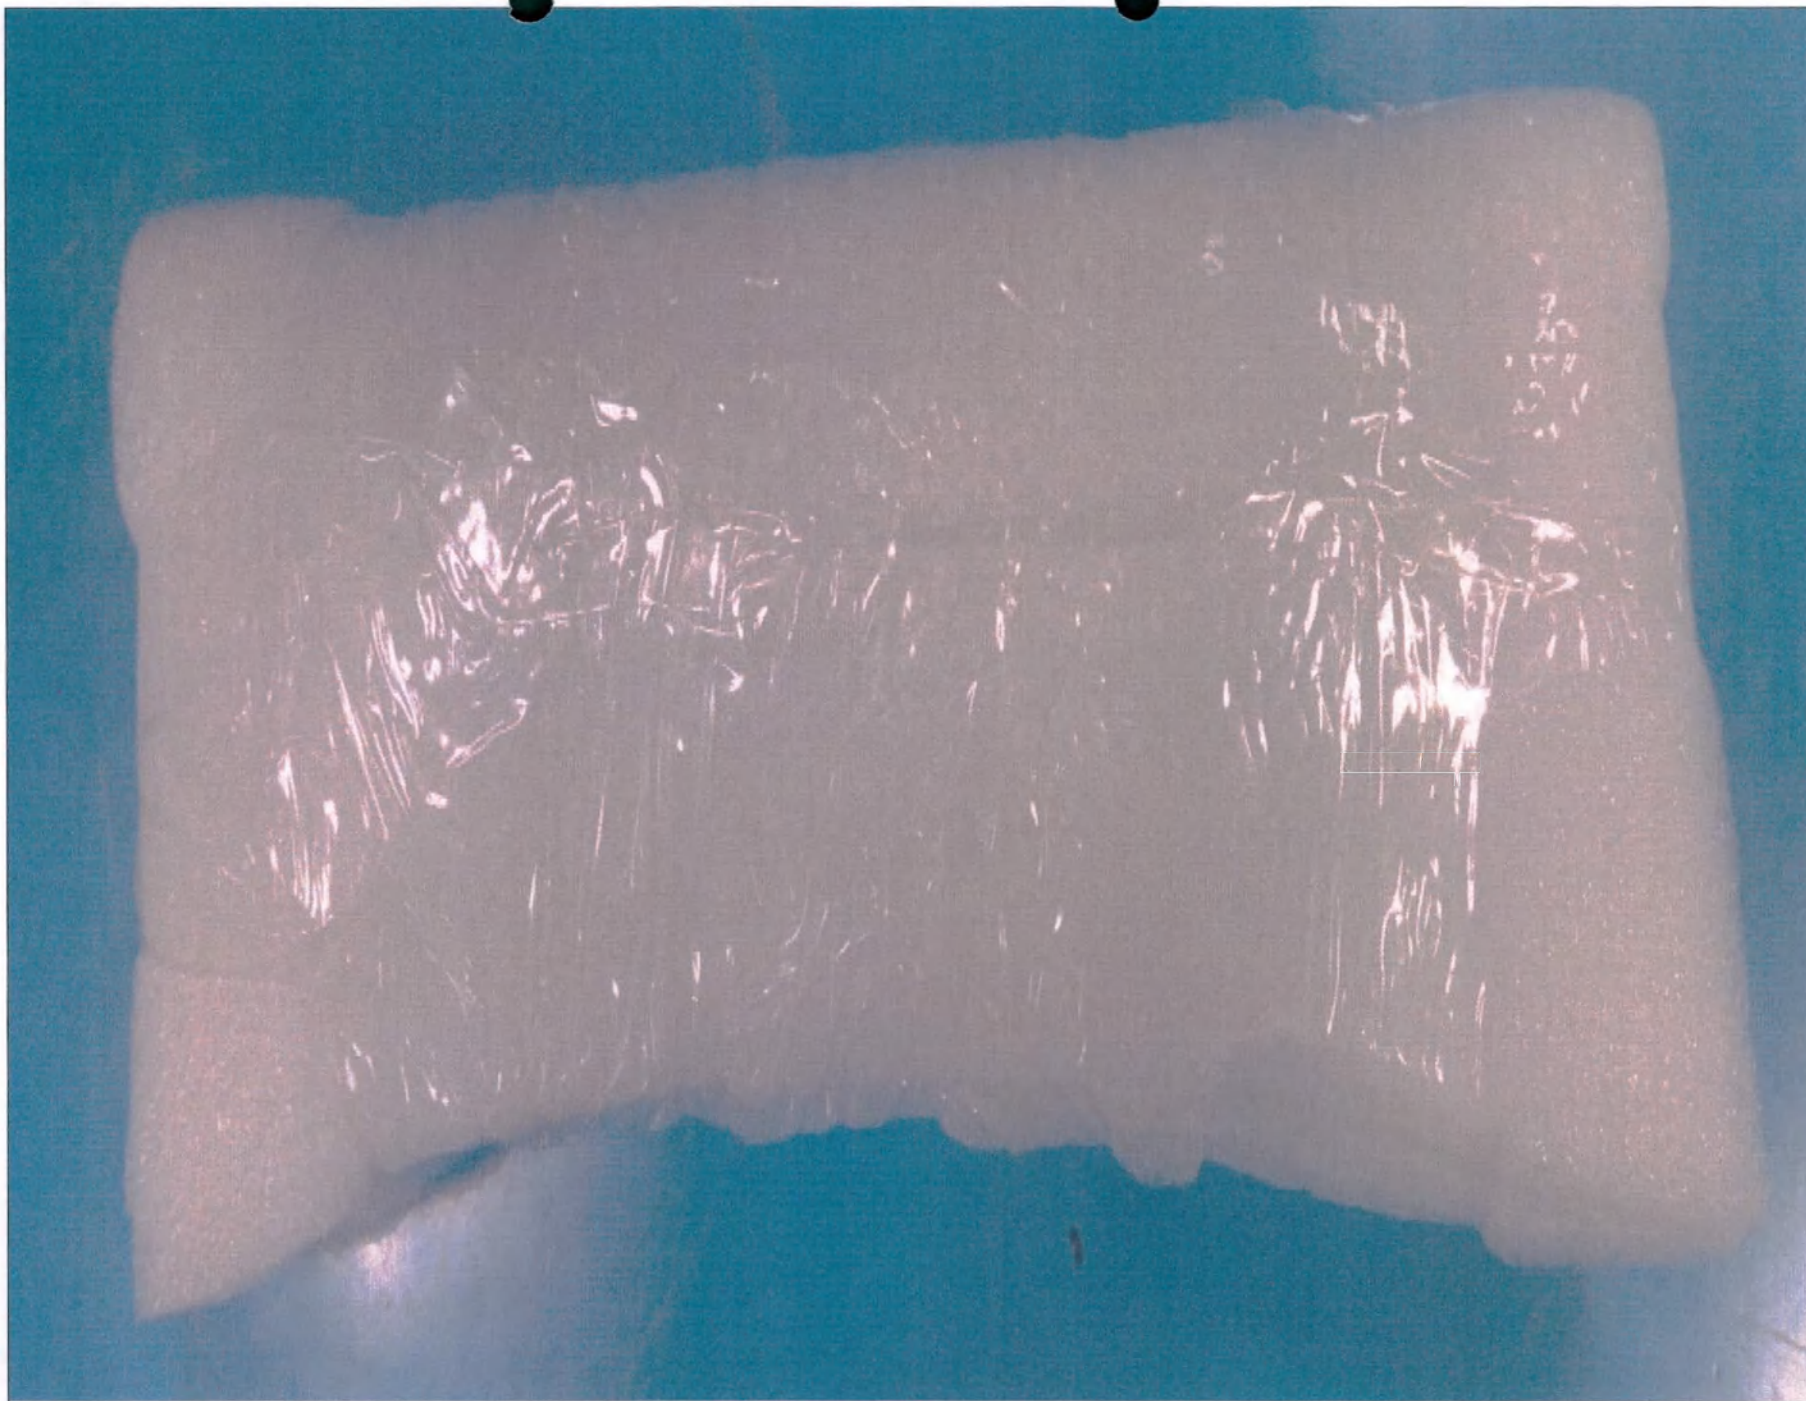

4. Упаковка пульта дистанционного контроля.



5. Коробка с принадлежностями.



7. Деревянный ящик с передвижной станцией просмотра



6. Размещение коробки с принадлежностями в ящике со стойкой С-дуги.

Макет вариантов маркировки на русском языке системы Zenition 70

Медицинское изделие:

Zenition 70

Описание:

Система флюороскопическая рентгеновская
передвижная цифровая Zenition 70 с
принадлежностями



Производитель:

«Филипс Медикал Системс Нидерланд Б.В.»

Нидерланды

Veenpluis 6, 5684 PC Best, The Netherlands

Место производства:

Филипс Индия Лимитед, Индия

Plot no. B-79, MIDC, Phase-II, Chakan Taluka - khed,

Village – Savardari

District: Pune Maharashtra, 410501, India

REF: 718133

Серийный номер: см. маркировку на английском

языке

Дата производства: см. маркировку на английском

языке

Основные технические характеристики:

Меры предосторожности:

Регистрационное удостоверение: РЗН 2020/9648

Медицинское изделие:

Zenition 70

Описание:

Система флюороскопическая рентгеновская
передвижная цифровая Zenition 70 с
принадлежностями



Производитель:

«Филипс Медикал Системс Нидерланд Б.В.»

Нидерланды

Veenpluis 6, 5684 PC Best, The Netherlands

Место производства:

Филипс Медикал Системс Нидерланд Б.В.

Нидерланды

Veenpluis 6, 5684 PC Best, The Netherlands

REF: 718133

Серийный номер: см. маркировку на английском

языке

Дата производства: см. маркировку на английском

языке

Основные технические характеристики:

Меры предосторожности:

Регистрационное удостоверение: РЗН 2020/9648

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью 66 листа (ов)

ООО «Филипс»

