

тов

с./

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «КаВо Дентал Руссланд»




[Signature]
А.А.Шавырин

«30» сентября 2020 г.
Генеральному Д-ру,
по доверенности
от 16.06.2020г.

ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Материал стоматологический композитный текучий светоотверждаемый Herculite XRV Ultra Flow в
вариантах исполнения

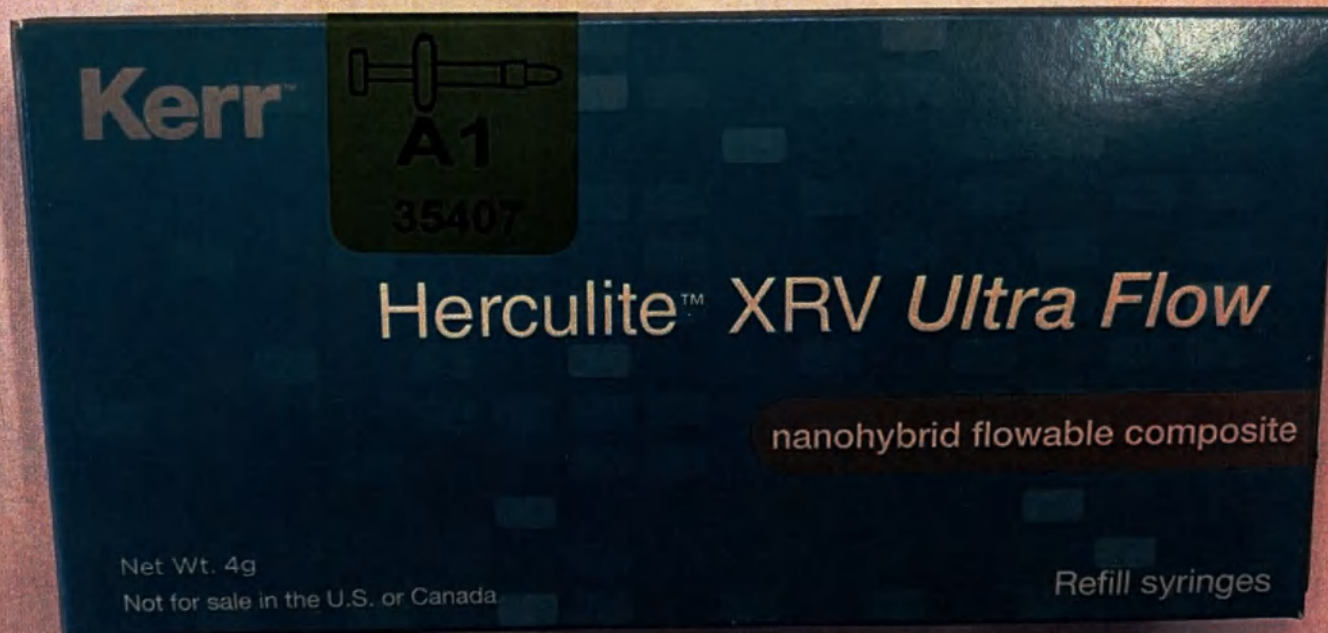

Herculite™ XRV *Ultra Flow*
Composite Material

Contents:
2 Syringes (2 g each)
20 Dispensing Tips

 Kerr Corporation
1717 W. Collins Ave.
Orange, CA 92687 USA
TEL: (800) KERR-123
TEL: +1-714-516-7400
kerrdental.com

Distributor:
KerrHawe SA
Via Strecce 4
CH-6934 Bioggio
+41-91-610-0505
kerrdental.eu
FreePhone:
00-800-41-050-505

EC REP

Kerr Italia S.r.l.
Via Passanti, 332
I-84018 Scafati
(SA) Italy
TEL: +39-081-850-8311
kerrdental.eu



STORE AT AMBIENT TEMPERATURE
CAUTION: Uncured methacryl
Avoid contact with the skin, eyes



18405



0086



For d

Kerr and Herculite are trademarks only
and are registered with various countries.
DMC0062 Rev 2

**35407 Материал стоматологический композитный текучий
светоотверждаемый Herculite XRV Ultra Flow A1**

Изготовитель: «Керр Корпорэйшн», США, Kerr Corporation 1717 West Collins
Avenue, Orange, California 92687, USA (США)

РУ РЗН № xxxx/xxxxxx от xx.xx.xxxx г.

Только для профессионального использования.

Срок годности указан на упаковке. Перед применением необходимо
ознакомиться с инструкцией.

Импортер: ООО «КаВо Дентал Руссланд» 195112 Санкт-Петербург,
Малоохтинский пр-т, д. 64В, т. (812)324-42-12

Изготовлено в США



REF 35407

Part No.

LOT 7461663

Use by
Date 2021-12-06



(01)10841396110624


(10)7461663



(17)211206


Herculite™ XRV *Ultra Flow*

CUT TO OPEN


Herculite™ XRV *Ultra Flow*
Composite Material



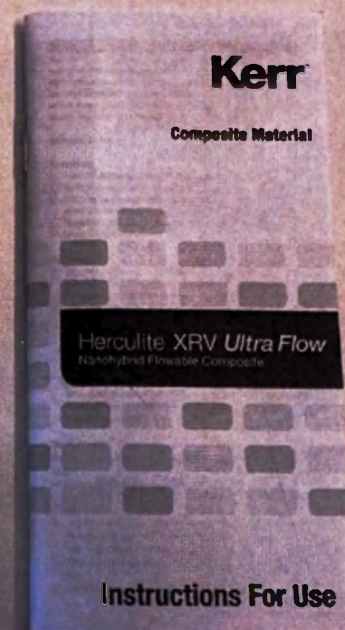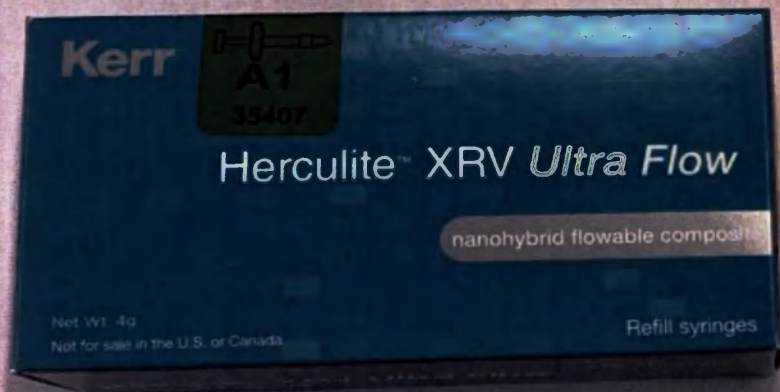

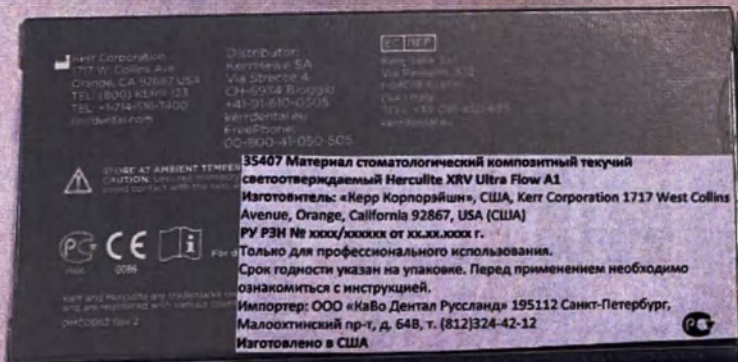


- Шприц в оттенке А1 (2 г.) – 2 шт;

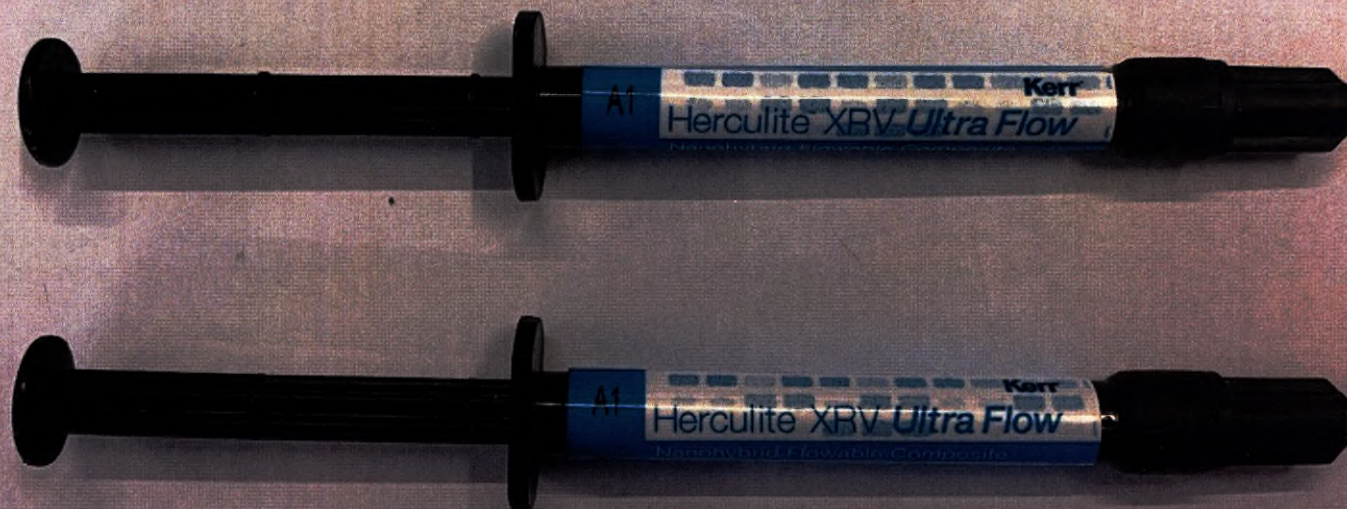







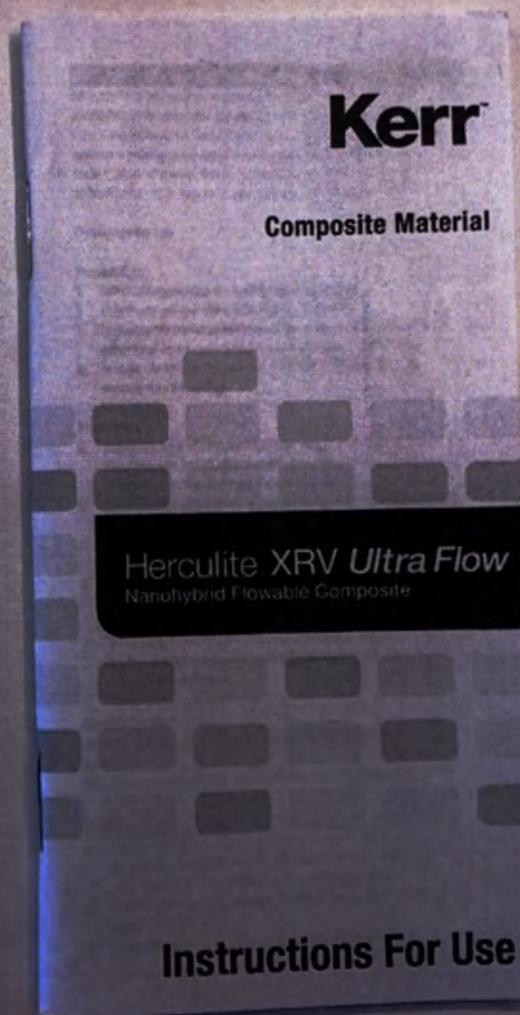

Kerr™

Kerr Corporation
1717 W Collins Ave.
Orange, CA 92867, U.S.A.
TEL (714) 516-7400
FAX (714) 516-7635
USA/Canada Toll Free
Customer Service
TEL: (800) KERR 123
FAX: (800) 537-7345
kerrdental.eu

Kerr Distribution Facility:

KerrHawe SA
Via Strecce 4
CH-6934 Bioggio
Switzerland
+41-91-610-0505
kerrdental.eu
FreePhone: 00-800-41-050-505


EC REP

Kerr Italia, S.r.l.
Via Passanti, 332
I-84018 Scafati (SA), Italy
+39-081-850-8311

For dental use only.

DMC0016 Rev 0
11/14



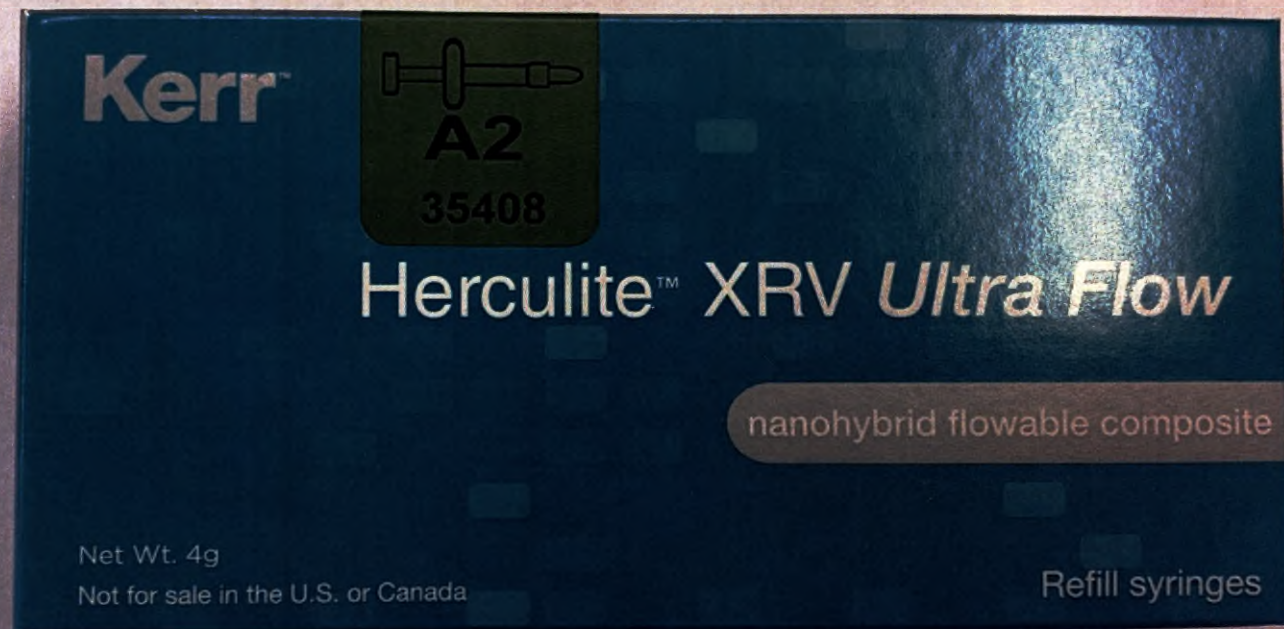

Herculite™ XRV Ultra Flow
Composite Material

Contents:
2 Syringes (2 g each)
20 Dispensing Tips

 Kerr Corporation
1717 W. Collins Ave.
Orange, CA 92667 USA
TEL: (800) KERR-123
TEL: +1-714-516-7400
kerrdental.com

Distributor:
KerrHawe SA
Via Strecce 4
CH-6934 Bioggio
+41-91-610-0505
kerrdental.eu
FreePhone:
00-800-41-050-505

 REP

Kerr Italia S.p.A.
Via Passanti, 372
I-34018 Sarnon
(SA) Italy
TEL: +39-081-850-6511
kerrdental.eu



STORE AT AMBIENT TEMPERATURE
CAUTION: Uncured material
Avoid contact with the skin



VMS



0086



Kerr and Herculite are trademarks
and are registered with various countries.
DMC0062 Rev 2

**35408 Материал стоматологический композитный текучий
светоотверждаемый Herculite XRV Ultra Flow A2**

Изготовитель: «Kerr Корпорэйшн», США, Kerr Corporation 1717 West Collins
Avenue, Orange, California 92667, USA (США)

РУ РЗН № xxxx/xxxxxx от xx.xx.xxxx г.

Только для профессионального использования.

Срок годности указан на упаковке. Перед применением необходимо
ознакомиться с инструкцией.

Импортёр: ООО «КаВо Дентал Руссланд» 195112 Санкт-Петербург,
Малоохтинский пр-т, д. 64В, т. (812)324-42-12

Изготовлено в США



REF 35408

Part No.

LOT 7459098

Use by
Date 2021-11-02



(01)10841396110631

(10)7459098

(17)211102

Refill



Herculite™ XRV UltraFlow



CUT TO OPEN

Herculite™ XRV *Ultra Flow*
Composite Material




A2
35408

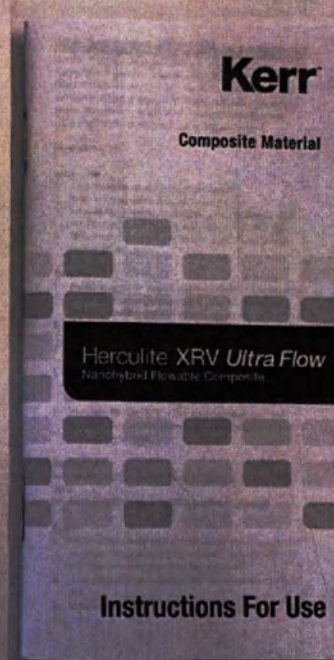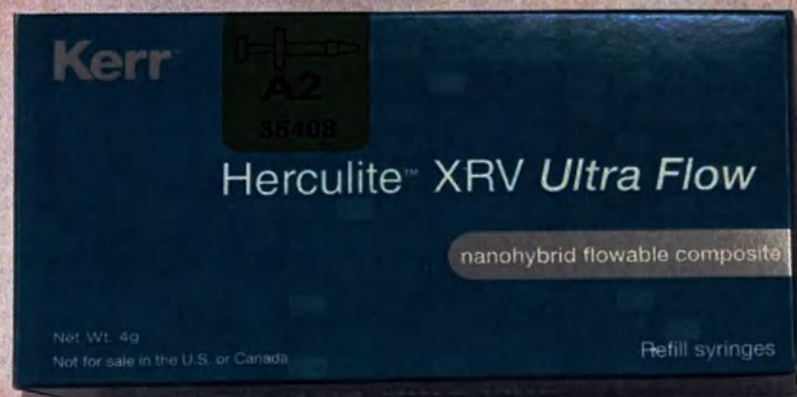

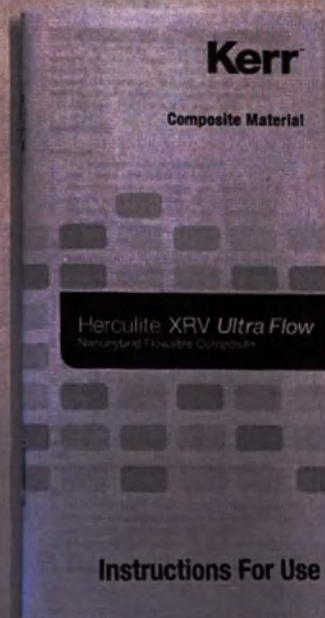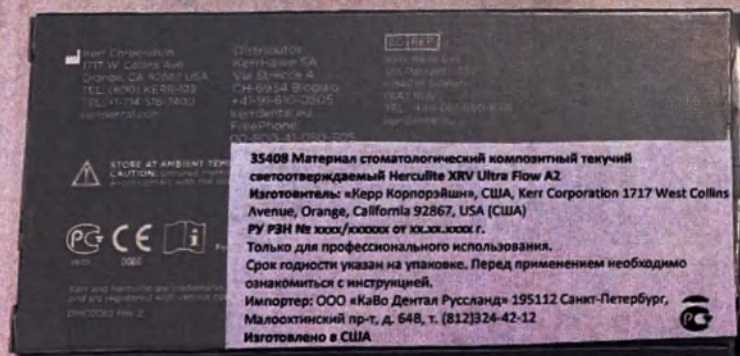


Шприц в оттенке А2 (2 г.) – 2 шт;

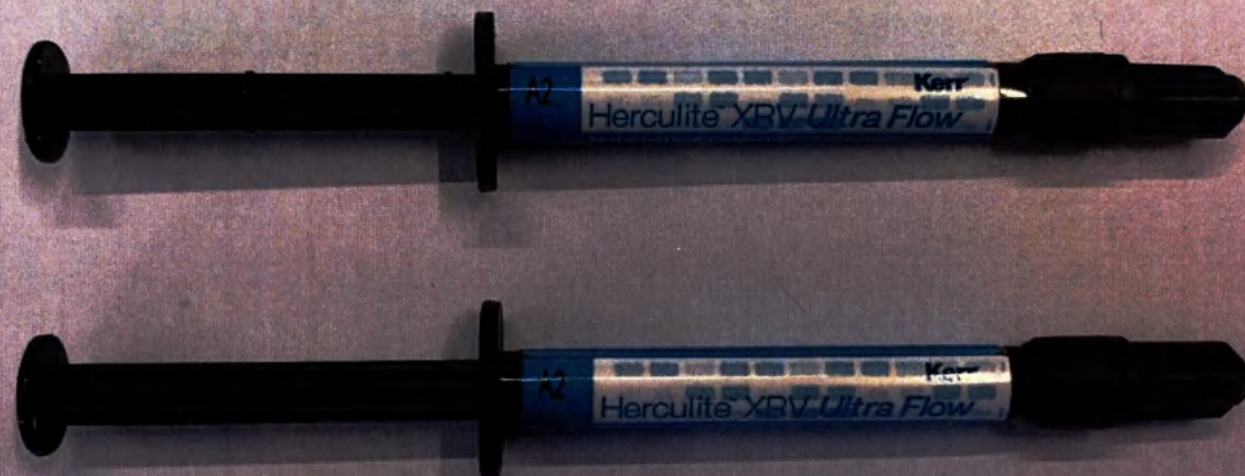







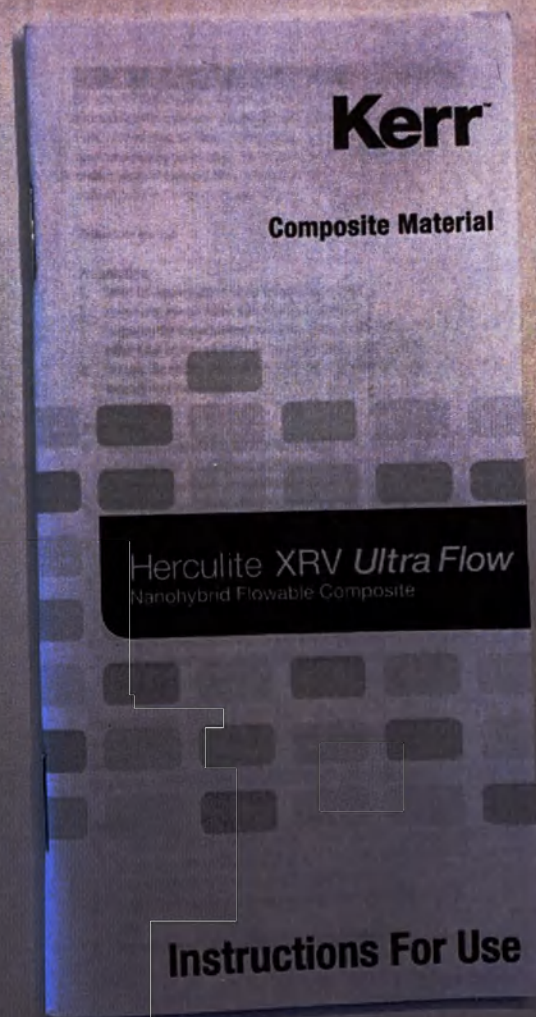

Kerr

Kerr Corporation
1717 W Collins Ave.
Orange, CA 92867, U.S.A.
TEL: (714) 516-7400
FAX: (714) 516-7635
USA/Canada Toll Free
Customer Service
TEL: (800) KERR 123
FAX: (800) 537-7345
kerrendental.eu

Kerr Distribution Facility:
KerrHawe SA
Via Strecce 4
CH-6934 Bioggio
Switzerland
+41-91-610-0505
kerrendental.eu
FreePhone: 00-800-41-050-505

EC REP

Kerr Italia, S.r.l.
Via Passanti, 332
I-84018 Scafati (SA), Italy
+39-081-850-8311

For dental use only.

DMC0016 Rev 0
11/14



3. **Материал стоматологический композитный текучий светоотверждаемый Herculite XRV Ultra Flow A3 в составе:**
- Шприц в оттенке А3 (2 г.) – 2 шт;
 - Дозирующие насадки для шприца – 20 шт;
 - Техническое руководство;
 - Инструкция по применению.
4. **Материал стоматологический композитный текучий светоотверждаемый Herculite XRV Ultra Flow A3.5 в составе:**
- Шприц в оттенке А3.5 (2 г.) – 2 шт;
 - Дозирующие насадки для шприца – 20 шт;
 - Инструкция по применению.
5. **Материал стоматологический композитный текучий светоотверждаемый Herculite XRV Ultra Flow A4 в составе:**
- Шприц в оттенке А4 (2 г.) – 2 шт;
 - Дозирующие насадки для шприца – 20 шт;
 - Инструкция по применению.
6. **Материал стоматологический композитный текучий светоотверждаемый Herculite XRV Ultra Flow B1 в составе:**
- Шприц в оттенке В1 (2 г.) – 2 шт;
 - Дозирующие насадки для шприца – 20 шт;
 - Инструкция по применению.
7. **Материал стоматологический композитный текучий светоотверждаемый Herculite XRV Ultra Flow B2 в составе:**
- Шприц в оттенке В2 (2 г.) – 2 шт;
 - Дозирующие насадки для шприца – 20 шт;
 - Инструкция по применению.
8. **Материал стоматологический композитный текучий светоотверждаемый Herculite XRV Ultra Flow C2 в составе:**
- Шприц в оттенке С2 (2 г.) – 2 шт;
 - Дозирующие насадки для шприца – 20 шт;
 - Инструкция по применению.
9. **Материал стоматологический композитный текучий светоотверждаемый Herculite XRV Ultra Flow D2 в составе:**
- Шприц в оттенке D2 (2 г.) – 2 шт;
 - Дозирующие насадки для шприца – 20 шт;
 - Инструкция по применению.
10. **Материал стоматологический композитный текучий светоотверждаемый Herculite XRV Ultra Flow XL1 в составе:**
- Шприц в оттенке XL1 (2 г.) – 2 шт;
 - Дозирующие насадки для шприца – 20 шт;
 - Инструкция по применению.

11. Материал стоматологический композитный текучий светоотверждаемый Herculite XRV Ultra Flow XL2 в составе:

- Шприц в оттенке XL2 (2 г.) – 2 шт;
- Дозирующие насадки для шприца – 20 шт;
- Инструкция по применению.

12. Материал стоматологический композитный текучий светоотверждаемый Herculite XRV Ultra Flow Universal Opaque в составе:

- Шприц в оттенке Universal Opaque – 2 шт;
- Дозирующие насадки для шприца – 20 шт;
- Инструкция по применению.

13. Материал стоматологический композитный текучий светоотверждаемый Herculite XRV Ultra Flow Sample A2 в составе:

- Шприц в оттенке A2 (1 г.) – 1 шт;
- Дозирующие насадки для шприца – 10 шт;
- Инструкция по применению.

14. Материал стоматологический композитный текучий светоотверждаемый Herculite XRV Ultra Flow Sample A3 в составе:

- Шприц в оттенке A3 (1 г.) – 1 шт;
- Дозирующие насадки для шприца – 10 шт;
- Инструкция по применению.

Прошито и пронумеровано.

Всего 31 (тридцать один) лист

Представитель по доверенности от 16.06.2020

Менеджер проектов по регистрации

ООО «КаВо Дентал Руссланд» А.И. /Ерм

