



Общество с ограниченной ответственностью "Эбботт Лэбораториз"
125171, Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, строение 1, БЦ "Метрополис"

Тел: (495) 258 42 80

Факс: (495) 258 42 81


abbott-russia@abbott.com

**Фотографические изображения общего вида
медицинского изделия**


**Калибраторы для обеспечения правильности количественного определения
липокалина, ассоциированного с желатиназой нейтрофилов,
иммунохемилюминесцентным методом в моче человека на
иммунохимических анализаторах Alinity i "NGAL в моче Калибраторы
(Alinity i Urine NGAL Calibrators)"**

Фотографическое изображение МИ NGAL в моче Калибраторы (Alinity i Urine NGAL Calibrators), упаковка, вид снаружи



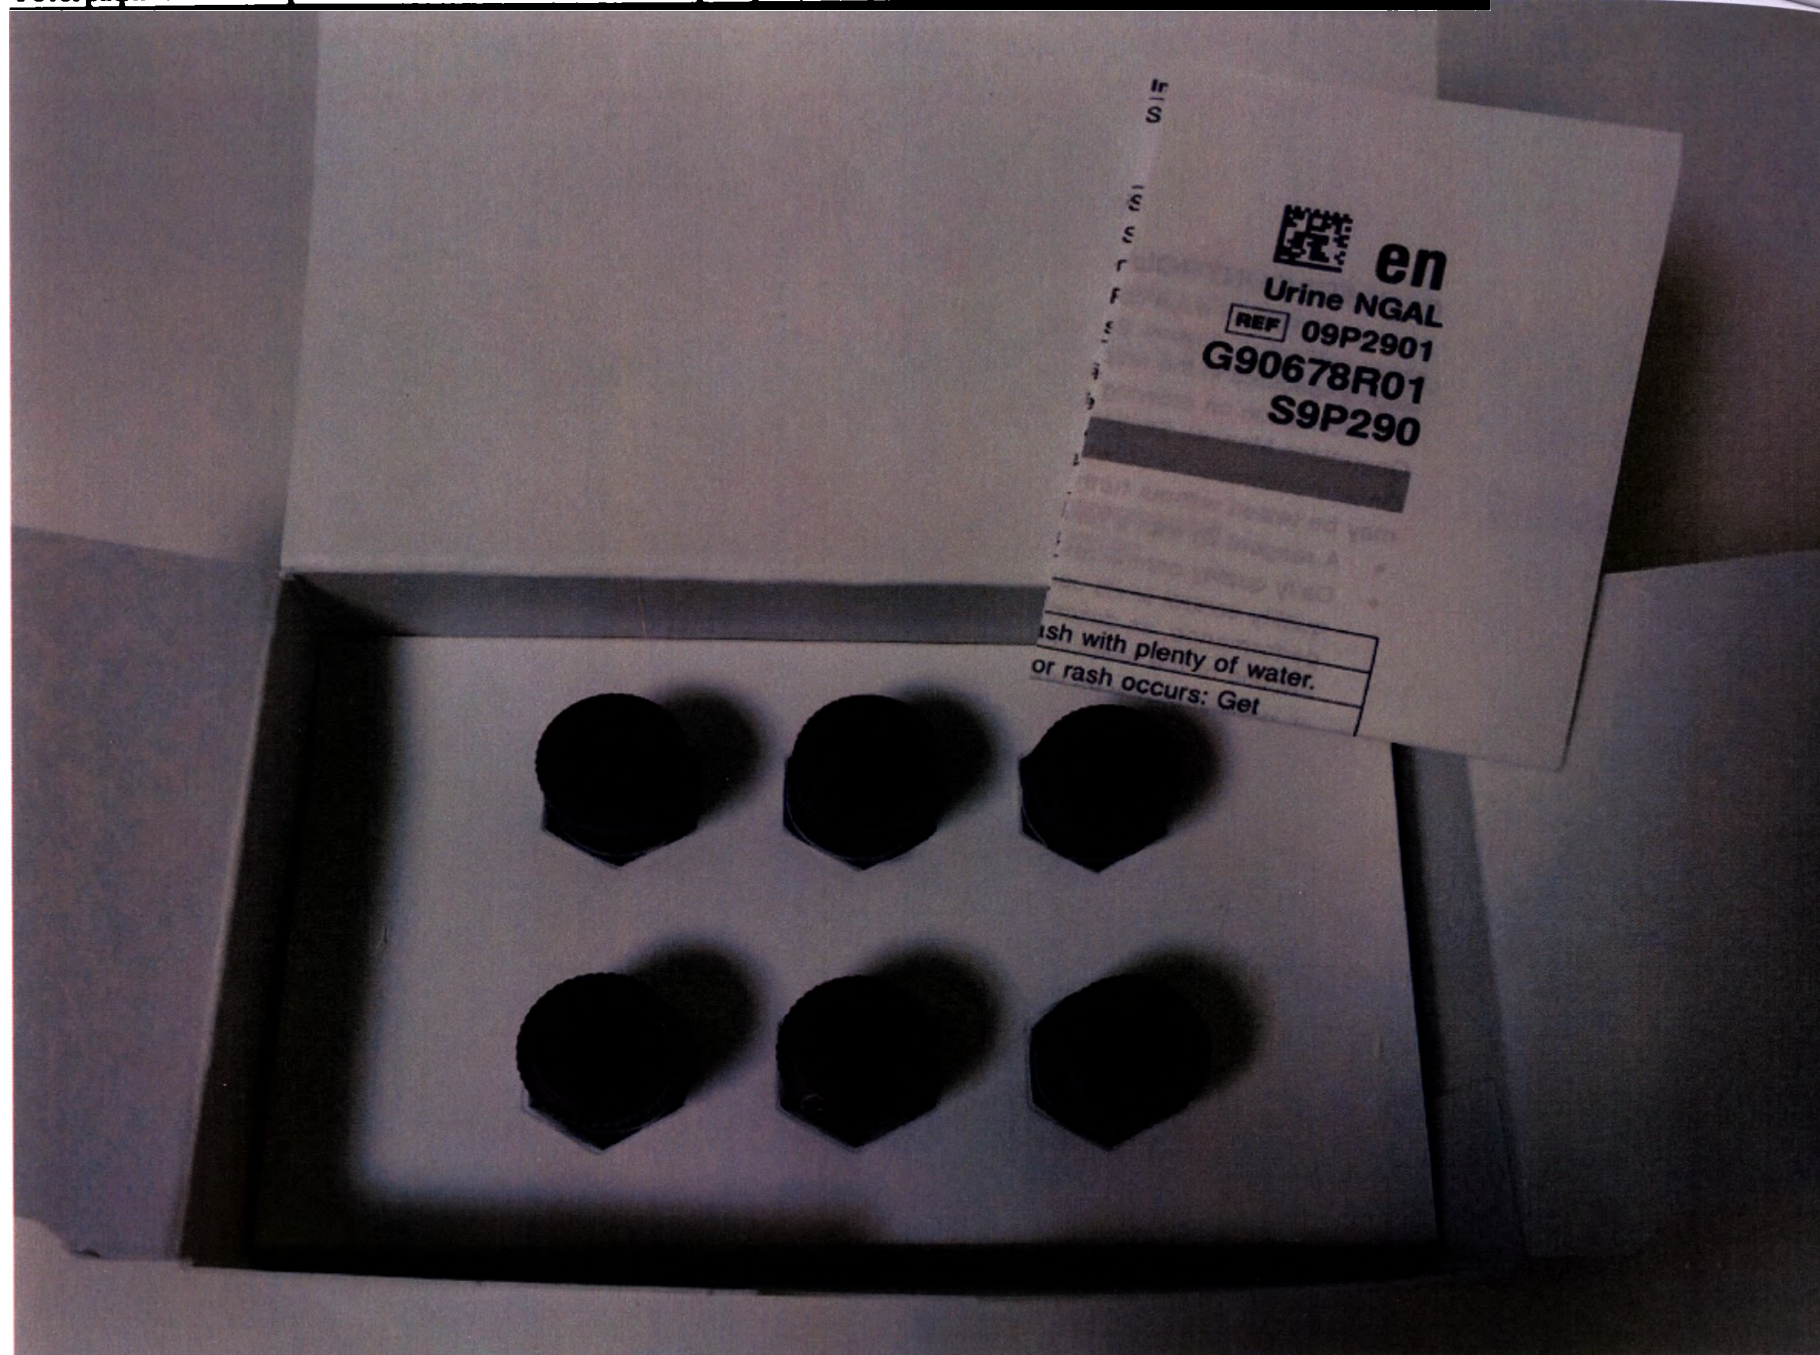

Фотографическое изображение МИ NGAL в моче Калибраторы (Alinity i Urine NGAL Calibrators), упаковка, состав

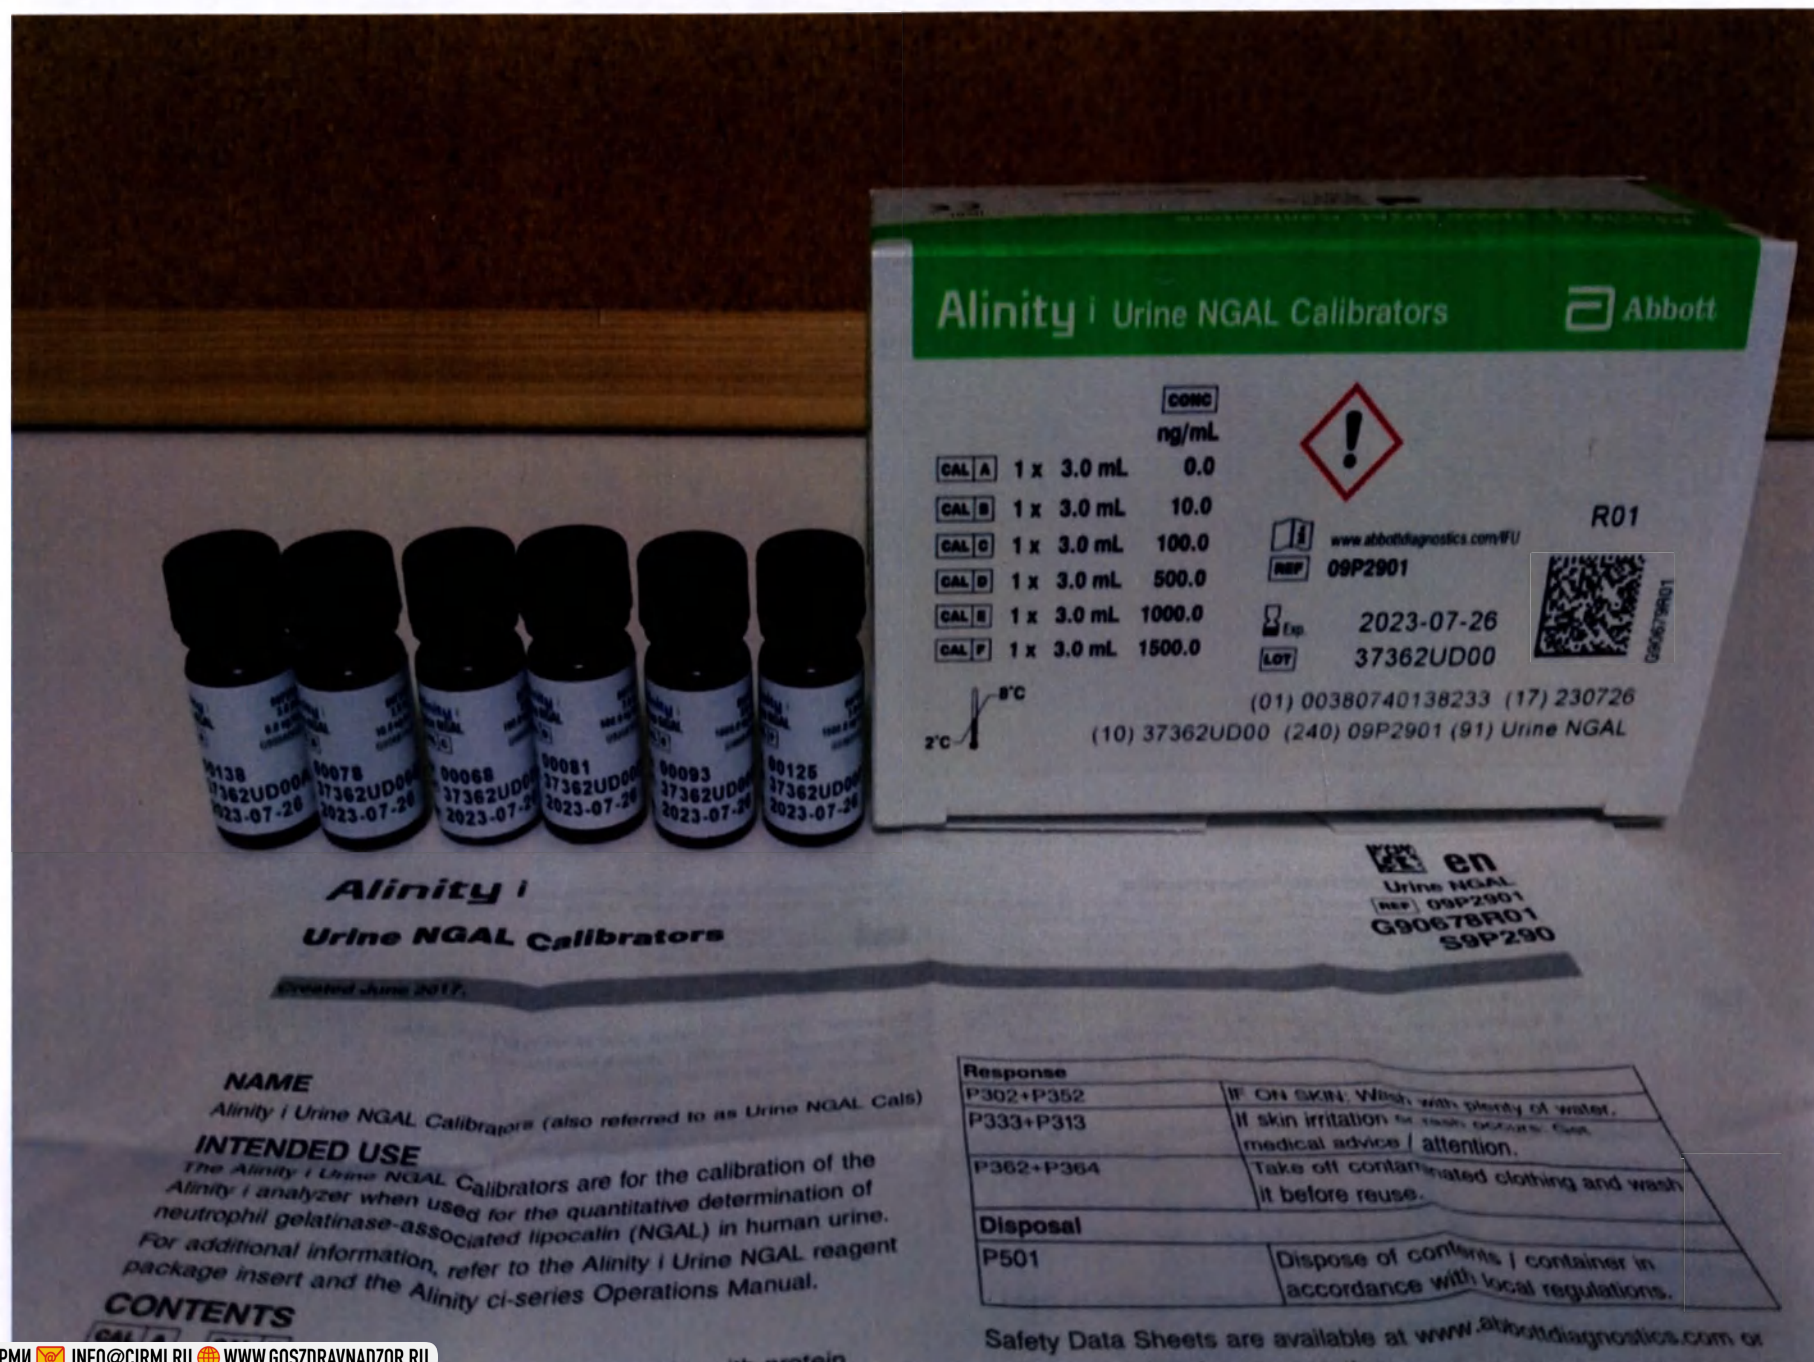





Подпись

[Handwritten signature]





Общество с ограниченной
ответственностью "Эбботт
Лэбораториз"
125171, Москва, Ленинградское
шоссе, 16 А., стр 1,
БЦ Метрополис
Тел: (495) 258 42 80

Макет маркировки на медицинское изделие

**Калибраторы для обеспечения правильности количественного определения
липокалина, ассоциированного с желатиназой нейтрофилов,
иммунохемилюминесцентным методом в моче человека на
иммунохимических анализаторах Alinity i "NGAL в моче Калибраторы
(Alinity i Urine NGAL Calibrators)"**

Макет маркировки медицинского изделия NGAL в моче Калибраторы (Alinity i Urine NGAL Calibrators), кат № 09P2901 для пользователей Российской Федерации



09P2901



Калибраторы для обеспечения правильности количественного определения липокалина, ассоциированного с желатиназой нейтрофилов, иммунохемилюминесцентным методом в моче человека на иммунохимических анализаторах Alinity i «NGAL в моче Калибраторы (Alinity i Urine NGAL Calibrators)»

в составе: - Калибратор А (Alinity i Urine NGAL Calibrator A) – 1 флакон х 3,0 мл; - Калибратор В (Alinity i Urine NGAL Calibrator B) – 1 флакон х 3,0 мл; - Калибратор С (Alinity i Urine NGAL Calibrator C) – 1 флакон х 3,0 мл; - Калибратор D (Alinity i Urine NGAL Calibrator D) – 1 флакон х 3,0 мл; - Калибратор E (Alinity i Urine NGAL Calibrator E) – 1 флакон х 3,0 мл; - Калибратор F (Alinity i Urine NGAL Calibrator F) – 1 флакон х 3,0 мл; Инструкция по применению – 1 шт.

Производитель: «Эбботт Ирландия Диагностическое подразделение» (Abbott Ireland, Ирландия Diagnostics Division), Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland, Ирландия / Место производства: «Эбботт Ирландия Диагностическое подразделение» (Abbott Ireland, Ирландия Diagnostics Division), Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland, Ирландия / Страна происхождения: Ирландия / РУ № ____/____ от ____ г. / Инструкция по применению на русском языке: www.corelaboratory.abbott/IFU / Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:
ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, строение 1
Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

NGAL


Маркировка медицинского изделия NGAL в моче Калибраторы (Alinity i Urine NGAL Calibrators), кат № 09P2901

G90679R02

LOT
EXP
REF
09P2901
www.abbott.com



CONC	ng/mL	
CAL A	1 x 3.0 mL	0.0
CAL B	1 x 3.0 mL	10.0
CAL C	1 x 3.0 mL	100.0
CAL D	1 x 3.0 mL	500.0
CAL E	1 x 3.0 mL	1000.0
CAL F	1 x 3.0 mL	1500.0



Abbott

Alinity i Urine NGAL Calibrators

Alinity i Urine NGAL Calibrators

Abbott

Abbott Ireland
Diagnostics Division
Lisnamock, Longford
Co. Longford
Ireland
+353-43-3331000

PRODUCT OF IRELAND


IVD
CE
0123

Urine NGAL
Cals




Маркировка компонентов медицинского изделия NGAL в моче Калибраторы (Alinity i Urine NGAL Calibrators), кат № 09P2901


Калибратор А (Alinity i Urine NGAL Calibrator A):

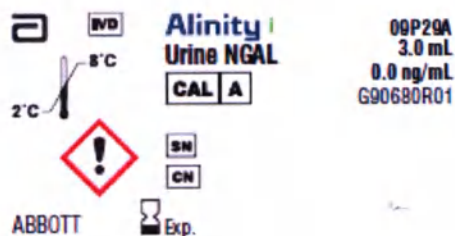


Калибратор В (Alinity i Urine NGAL Calibrator B):

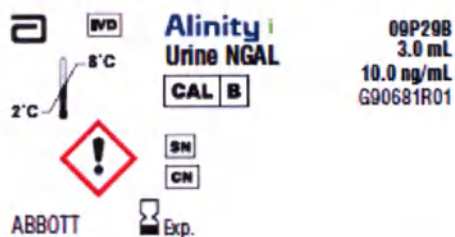


Калибратор С (Alinity i Urine NGAL Calibrator C):

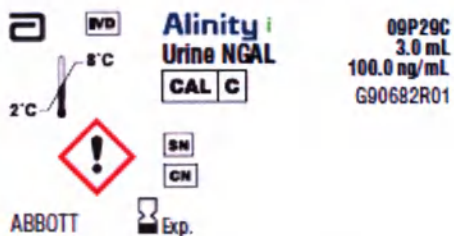

Калибратор D (Alinity i Urine NGAL Calibrator D):

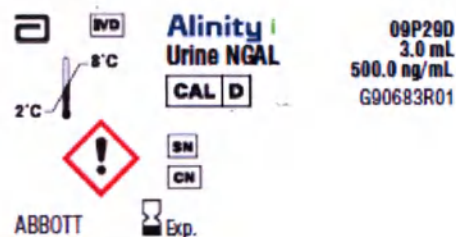


Калибратор Е (Alinity i Urine NGAL Calibrator E):

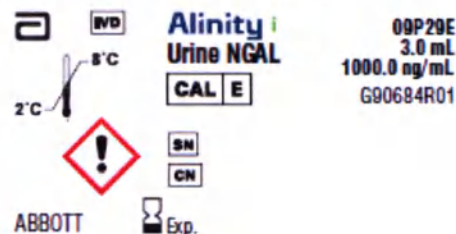

Alinity i Urine

Калибратор F (Alinity i Urine NGAL Calibrator F):

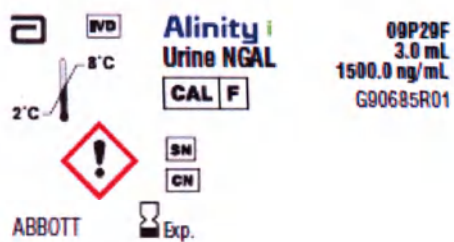

Производитель использует разработанные им символы, а также символы согласно ISO 15223:

Символы ISO 15223	
	См. инструкцию по применению
	Изготовитель
	Температурный диапазон
	Использовать до/Срок годности
	Медицинское изделие для диагностики <i>In Vitro</i>
	Номер серии
	Каталожный номер
	Серийный номер
Другие символы	
	Калибратор (A,B,C,D,E или F)
	Контрольный номер
	Концентрация
	Страна происхождения: Ирландия
	Европейское соответствие
	Опасный для здоровья

Подпись

