



Общество с ограниченной
ответственностью "Эбботт
Лэбораториз"
125171, Москва, Ленинградское
шоссе, 16 А., стр 1,
БЦ Метрополис
Тел: (495) 258 42 80

Макет маркировки на медицинское изделие

**Набор реагентов для количественного определения липокалина,
ассоциированного с желатиназой нейтрофилов, иммунохемилюминесцентным
методом в моче человека на иммунохимических анализаторах Alinity i "NGAL
в моче Реагенты (Alinity i Urine NGAL Reagent Kit)"**

Макет маркировки медицинского изделия NGAL в моче Реагенты (Alinity i Urine NGAL Reagent Kit), кат № 09P2920 для пользователей Российской Федерации



09P2920






Набор реагентов для количественного определения липокалина, ассоциированного с желатиназой нейтрофилов, иммунохемилюминесцентным методом в моче человека на иммунохимических анализаторах Alinity i «NGAL в моче Реагенты (Alinity i Urine NGAL Reagent Kit)»

2 картриджа по 100 тестов, в составе: -Микрочастицы (Alinity i Urine NGAL Microparticles) – 2 x 6,6 мл; - Конъюгат (Alinity i Urine NGAL Conjugate) – 2 x 6,1 мл; Инструкция по применению – 1 шт.


Производитель: «Эбботт Ирландия Диагностическое подразделение» (Abbott Ireland, Ирландия Diagnostics Division), Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland, Ирландия / Место производства: «Эбботт Ирландия Диагностическое подразделение» (Abbott Ireland, Ирландия Diagnostics Division), Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland, Ирландия / Страна происхождения: Ирландия / РУ № ____/____ от ____ г. / Инструкция по применению на русском языке: www.corelaboratory.abbott/IFU / Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:
ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, строение 1
Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

Маркировка медицинского изделия NGAL в моче Реагенты (Alinity i Urine NGAL Reagent Kit), кат № 09P2920

Urine NGAL		Alinity i		Urine NGAL Reagent Kit		Abbott	
   	REF 09P2920  2 x 100  www.corelaboratory.abbott/IFU	 MICROPARTICLES CONJUGATE	2 x 6.6 mL 2 x 6.1 mL	  Abbott Ireland Diagnostics Division Lissamuck, Longford Co. Longford Ireland +353-43-3331000	   0123		

Маркировка компонентов медицинского изделия NGAL в моче Реагенты (Alinity i Urine NGAL Reagent Kit), кат № 09P2920

 MICROPARTICLES 6.6 mL  G90676R01  ABBOTT AIDD Longford, Ireland	 CONJUGATE 6.1 mL  G90677R01 	Urine NGAL 09P2920  G90700R01   
---	--	---

Производитель использует разработанные им символы, а также символы согласно ISO 15223

Символы ISO 15223

	См. инструкцию по применению
	Изготовитель
	Достаточно для
	Температурный диапазон
	Использовать до/Срок годности
IVD	Медицинское изделие для диагностики <i>In Vitro</i>
LOT	Номер серии
REF	Каталожный номер
SN	Серийный номер

Другие символы

CONJUGATE	Конъюгат
INVERSIONS PERFORMED	Картридж был перевернут
MICROPARTICLES	Микрочастицы
PRODUCT OF IRELAND	Страна происхождения: Ирландия

 Знак соответствия основным требованиям директив и стандартов Европейского союза

 Обозначение русского языка маркировки

 Опасный для здоровья





Общество с ограниченной ответственностью "Эбботт Лэбораториз"
125171, Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, строение 1, БЦ "Метрополис"

Тел: (495) 258 42 80

Факс: (495) 258 42 81

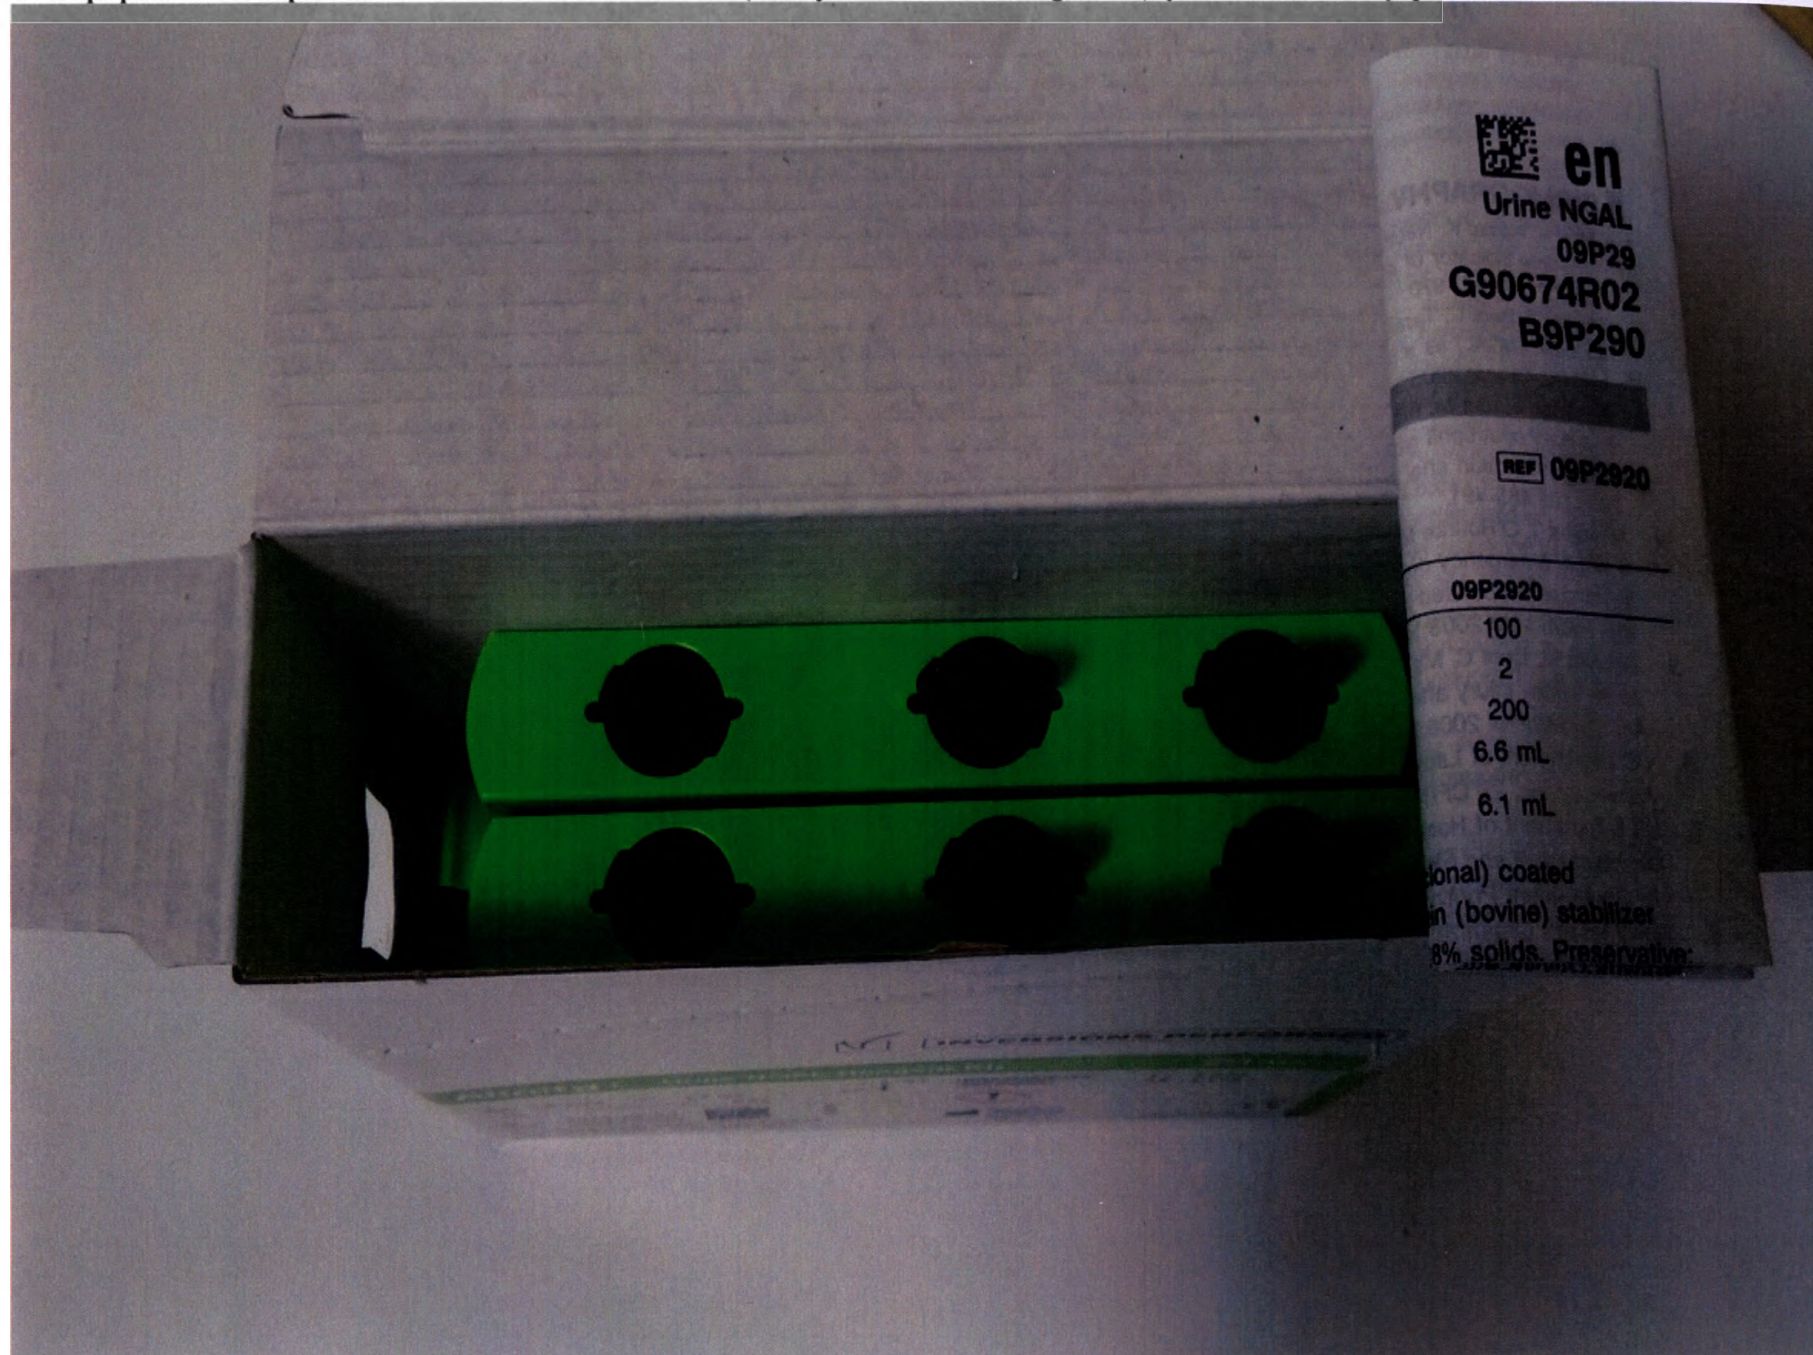
abbott-russia@abbott.com

**Фотографические изображения общего вида
медицинского изделия**

**Набор реагентов для количественного определения липокалина,
ассоциированного с желатиназой нейтрофилов,
иммунохемилюминесцентным методом в моче человека на
иммунохимических анализаторах Alinity i "NGAL в моче Реагенты (Alinity i
Urine NGAL Reagent Kit)"**

Фотографическое изображение МИ NGAL в моче Реагенты (Alinity i Urine NGAL Reagent Kit), упаковка, вид снаружи





Фотографическое изображение МИ NGAL в моче Реагенты (Alinity i Urine NGAL Reagent Kit), упаковка, состав





и скреплено печатью

3 ЛИСТОВ

Подпись

[Handwritten signature]

