

ООО «МЕАДЕНТ»

193315, Санкт-Петербург г, Новосёлов ул, д.49 литера Л, помещение 4-Н, офис №1,2,3

ОГРН 1157847059259

р/сч 40702810210001020273 в АО «Тинькофф Банк» БИК 044525974


корр/сч. 30101810145250000974

E-mail md@meadent.ru Телефон 8 (812) 448-38-78

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «МЕАДЕНТ»



Д.В. Яхнев

« 23 » Мая 2023 г.



Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

**«Набор для пломбирования и восстановления
зубов материалом светового отверждения, в
вариантах исполнения»**

Набор №1

Набор для пломбирования и восстановления зубов материалом светового отверждения.

Состав:

1. Адгезив во флаконе Any-Bond - 1шт.
2. Микроаппликаторы - 10шт.
3. Композит Any-Com оттенок A2 - 1шт.
4. Композит Any-Com оттенок A3 - 1шт.
5. Композит Any-Com оттенок A3,5 - 1шт.
6. Композит Any-Com оттенок OA2 - 1шт.
7. Композит Any-Com оттенок OA3 - 1шт.
8. Композит Any-Com Flow оттенок A2 - 1шт.
9. Композит Any-Com Flow оттенок A3 - 1шт.
10. Композит Any-Com Flow оттенок A3,5 - 1шт.
11. Одноразовый наконечник для Any-Com Flow - 6шт.
12. Гель Any-Etch - 2шт.
13. Композит Ezi-Crown оттенок A2 - 1шт.
14. Композит Once-Fil Flow - 1шт.
15. Двойной картридж с композитом Any-Core - 1шт.
16. Двойной картридж с цементирующей пастой Any-Temp NE - 1шт.
- 17.1 Одноразовый наконечник для Any-Etch - 4шт.
- 17.2 Одноразовый наконечник для Once-Fil Flow - 2шт.
18. Наконечник для смешивания для Any-Core - 3шт.
19. Экономаска для Any-Temp NE - 1шт.
20. Инструкция - 1шт.

designed for dentists



MDCLUS
MEDICLUS CO., LTD.



Фотографическое изображение 1 – Набор для пломбирования и восстановления зубов материалом светового отверждения, вариант исполнения Набор № 1. общий вид упаковки

Набор № 2

"Any-Com Small" в составе:

- | | |
|----------------------------------|---------|
| 1. Адгезив во флаконе Any-Bond | - 1шт. |
| 2. Микроаппликаторы | - 10шт. |
| 3. Композит Any-Com оттенок A2 | - 1шт. |
| 4. Композит Any-Com оттенок A3 | - 1шт. |
| 5. Композит Any-Com оттенок A3,5 | - 1шт. |
| 6. Инструкция | - 1шт. |

Any-Com

Light-cured, radiopaque nano hybrid zirconium composite material for the restorative treatment of anterior and posterior teeth.

Direct fillings of Class I to V
Restorations of traumatic defects of hard dental tissues
Directly manufactured aesthetic veneers
Shape and shade corrections
Intraoral repairs of veneered parts of fixed prosthetic restorations
Direct build-ups of vital as well as endodontically treated teeth

designed for dentists



ISO 4049

Restorative dental restorative material
(Resin based, light-cured)

ISO 9001 / ISO 13485

ООО "ИМАДЕНТ" № 14.3
141210, г. Санкт-Петербург, Технический район, д. 14, лит. А
Хандалов-Ст. Кооператив-40, Чугунов, Марш.
Тел: +7 (812) 215-5077
Регистрационное удостоверение: № 231.12.02.0000
Уполномоченный представитель:
ООО "ИМАДЕНТ", 192210, г. Санкт-Петербург,
ул. Пискаревский д. 20-02, лит. А, пом. 6-Б,
офис 1-0-3. Тел: +7 (812) 648-30-70
Обратиться к сопроводительной документации.
ТОЛЬКО ДЛЯ СТОМАТОЛОГОВ

신미수용합 복합 레진

Light-cured, radiopaque nano hybrid
zirconium composite resin

RESIN, TRANSPARENT, 100% FILL

светоотверждаемая, рентгеноконтрастная
гибридная композитная смола
photopolymersable, une resine
composite hybride radio-opaque

Contents:

#301-4 Any-Com Small Kit

4 g x 3 Syringes

Any-Bond SmI

Фотографическое изображение 3 – Набор для пломбирования и восстановления зубов
материалом светового отверждения, вариант исполнения Набор № 2 «Any-Com Small», общий
вид упаковки



Фотографическое изображение 4 – Набор для пломбирования и восстановления зубов материалом светового отверждения, вариант исполнения Набор № 2 «Any-Com Small», расположение составных частей в упаковке

Набор № 3

«Any-Com» в составе:

- | | |
|--|---------|
| 1. Адгезив во флаконе Any-Bond | - 1шт. |
| 2. Микроапликаторы | - 10шт. |
| 3. Композит Any-Com оттенок A2 | - 1шт. |
| 4. Композит Any-Com оттенок A3 | - 1шт. |
| 5. Композит Any-Com оттенок A3,5 | - 1шт. |
| 6. Композит Any-Com оттенок OA2 | - 1шт. |
| 7. Композит Any-Com оттенок OA3 | - 1шт. |
| 8. Гель Any-Etch | - 1шт. |
| 9. Одноразовый наконечник для Any-Etch | - 2шт. |
| 10. Инструкция | - 1шт. |



ISO 4049

Resin-based dental restorative material

Radio-opaque, light curing

ISO 9001 / ISO 13485



Any-Com

Nano Hybrid Zirconium Composite Resin Kit

Light cured, radiopaque nano-hybrid zirconium composite material for the restorative treatment of anterior and posterior teeth.

- Direct fillings of Class I to V
- Restorations of traumatic defects of hard dental tissues
- Directly manufactured aesthetic veneers
- Shape and shade corrections
- Intraoral repairs of veneered parts of fixed prosthetic restorations
- Direct build-ups of vital as well as endodontically treated teeth

- 심미수복용 복합 레진
- 光固化, 半透明성의 나노 복합 레진
- Light-cured, radiopaque Nano-hybrid composite resin
- 색조교정/재현용, рентгеноконтрастная гибридная композитная смола
- photopolymerizable, one resin composite hybriide radiopaque

Contents:
#001-1 Any-Com Kit 4g x 5syringes
Any-Bond 9ml / Any-Etch 3ml

Фотографическое изображение 5 – Набор для пломбирования и восстановления зубов материалом светового отверждения, вариант исполнения Набор № 3 «Any-Com», общий вид упаковки

длительное сильное течение воздуха. Предложите пациенту возможность дыхания за нос, т.е. через заднюю часть рта, чтобы избежать попадания беззубой губы дыхания (обычно на бок). Затем предложите возможность легкой струей воздуха в течение 30 сек. или более. Используйте вакуум-аспиратор для предотвращения разбрызгивания капли дентина.

• Сухойте разбрызгиваемый капил. дентина может привести к избыточно толстой или выветрившейся реставрации.

• Если дентин становится на дне или в угол полости и слой становится слишком толстым, так что его сложно вставить, выдвигайте струю, удаляя избыток дентина с помощью вакуума.

• Полимеризуйте перед началом воздействия легкой струей воздуха.

• В случае затвердевания комбинированного слоя дентина слайдом, щеткой или другим жестким инструментом протрите поверхность водой, смойте её и повторно нанесите новую порцию дентина.

9. Отрегулируйте мощность системы в течение 30 сек., регулировка должна соответствовать расстоянию не более 2мм от поверхности. Если мощность слишком высокая или слишком низкая, измените с помощью джойстика. Например, при МОД дефекте регулируйте область на участке и выровняйте каждый участок по отдельности.

Длина джойстика имеет мощность >300mW/cm².

10. Вставьте в полость трубу парами воздуха в соответствии с инструкцией по Any-Com.

Меры предосторожности:

1. НЕ ИСПОЛНИТЕ изделие в металле, но, соответственно, данной инструкции, строго в соответствии с предостережением. 2. Недавно предложено для проверки и использования только работоспособные индустриальные стоматологические клиники и не предназначены для использования не профессиональными стоматологами.

3. Не нарушайте труб от попадания слюны. 4. Если изделие выключает у пациента аллергическую реакцию или болезненность.

чувствительность, следует немедленно прекратить использование продукта.

3. Не допускайте попадания изделия в пищу, на слизистую оболочку, кожу и одежду.

4. Не используйте после срока годности.

Противопоказания к применению:

Нельзя применять на чувствительные материалы, естественное расширение и сжатия. Не используйте для лечения эвасиона, у которых имеется депрессия или инвазия.

Противопоказано в металлах и сплавах с ними, металлами или керамическими реставрациями и имплантатами.

Побочные действия:

Аллергическая реакция на составляющие материалы.

По потенциальному риску применения изделия относится к классу 2b. Не имеет противопоказаний для домашнего использования.

Условия хранения и транспортирования:

Изделие хранят в сухом прохладном месте в при температуре от +15°C до +30°C.

Неблизко к источникам тепла, температур, прямых солнечных лучей, сырости и открытого огня.

НЕ СЛЕДУЕТ использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Срок годности:

Гарантийный срок хранения при температуре от +15°C до +30°C - 2 года со дня изготовления. Гарантийный срок службы реставрации - 5 лет.

Примечание: MEDICLUS Co., Ltd. №1219 Seung Techno-vill, 124 Gyeonggi, Hwangbuk-gu, Seongnam-si, Gyeonggi, Korea Tel: +82(11)211-2877 www.mediclus.co.kr

Поставщик в РФ: ООО Медиклус 191315 Санкт-Петербург ул.Новоизбранная 49 оф.3-2-3 тел: +7(812)4493878 info@mediclus.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для выбора:

Any-Com small: any-com 4pr. - 2шт.; any-etch 3шт. - 1шт.; any-hand 5шт. - 1шт.

Any-Com MD: any-com 4pr. - 2шт.; any-etch 3шт. - 1шт.; any-hand 5шт. - 1шт.


Any-Com Light: any-com 4pr. - 2шт.; any-etch 3шт. - 1шт.; any-hand 5шт. - 1шт.

Any-Com Flow: any-com flow 2pr. - 2шт.; any-etch 3шт. - 1шт.

Комплект Any-Com. Any-Com представляет собой гибридную светотвердеваемую, реставрационную систему для твердых и мягких тканей реставрации. Any-Com - это усовершенствованный материал.

Включения в комплект:

- Прямой реставрационный материал в боксальной упаковке, классы I и II V.
- Реставрационная трансформация дефектов твердых тканей зубов.
- Нанокремниевый материал для восстановления эстетического внешнего вида.
- Коррекция формы и оттенка.
- Непрочные пластмассовые имплантаты частей фиксации ортодонтических реставраций.
- Прямые формирования имплантатов, а также эстетический обработка зубов.

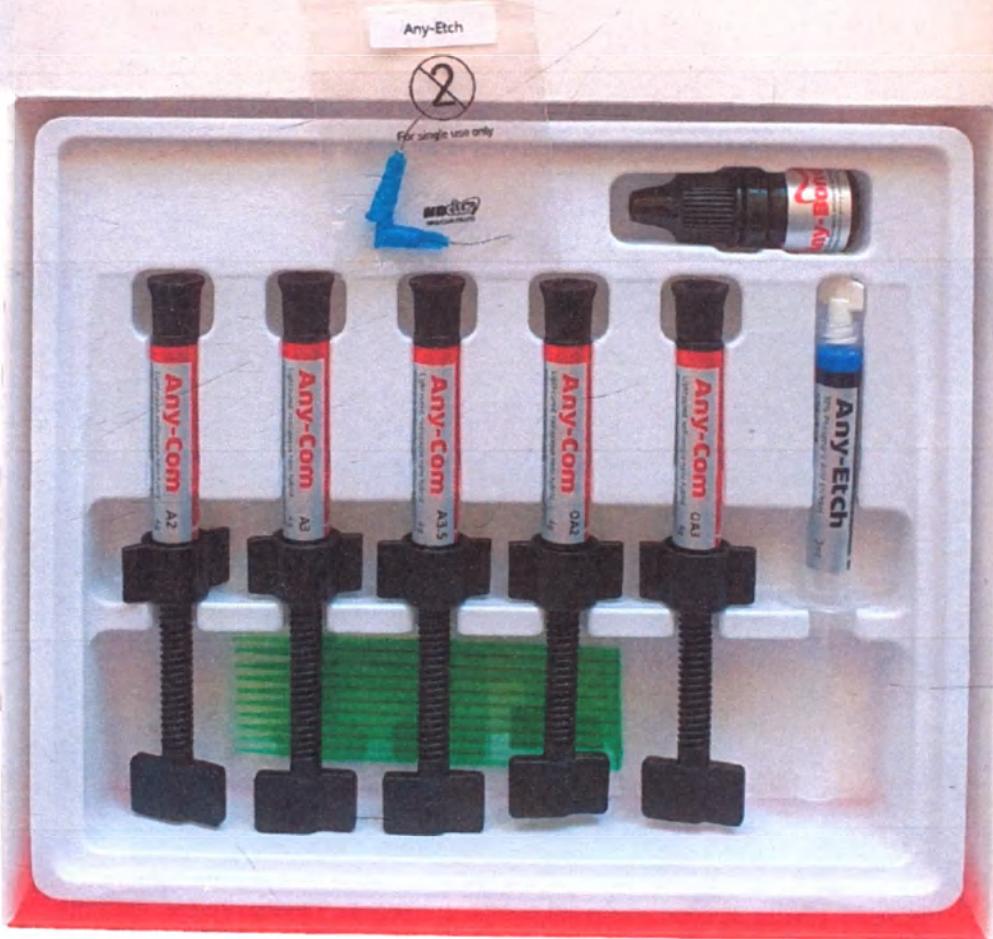

Фотографическое изображение 6 – Набор для пломбирования и восстановления зубов материалом светового отверждения, вариант исполнения Набор № 3 «Any-Com», расположение составных частей в упаковке



Фотографическое изображение 7 – Набор для пломбирования и восстановления зубов материалом светового отверждения, вариант исполнения Набор № 4 «Any-Com Flow», общий вид упаковки



Фотографическое изображение 8 – Набор для пломбирования и восстановления зубов материалом светового отверждения, вариант исполнения Набор № 4 «Any-Com Flow», расположение составных частей в упаковке

designed for dentists

Набор №5

«Any-Com UNIVERSAL» в составе:

1. Адгезив во флаконе Any-Bond - 1шт.
2. Микроапликаторы - 10шт.
3. Композит Any-Com оттенок А2 - 1шт.
4. Композит Any-Com оттенок А3 - 1шт.
5. Композит Any-Com оттенок А3,5 - 1шт.
6. Композит Any-Com Flow оттенок А2 - 1шт.
7. Композит Any-Com Flow оттенок А3 - 1шт.
8. Композит Any-Com Flow оттенок А3,5 - 1шт.
9. Одноразовый наконечник для Any-Com Flow - 6шт.
10. Гель Any-Etch - 1шт.
11. Одноразовый наконечник для Any-Etch - 2шт.
12. Инструкция - 1шт.




- Direct fillings of Class I to V
- Restorations of traumatic defects of hard dental tissues
- Directly manufactured aesthetic veneers
- Shape and shade corrections
- Intraoral repairs of veneered parts of fixed prosthetic restorations
- Direct build-ups of vital as well as endodontically treated teeth

MEDICLUS
MEDICLUS CO.,LTD.



Фотографическое изображение 9 – Набор для пломбирования и восстановления зубов
материалом светового отверждения, вариант исполнения Набор № 5 «Any-Com UNIVERSAL»,
общий вид упаковки

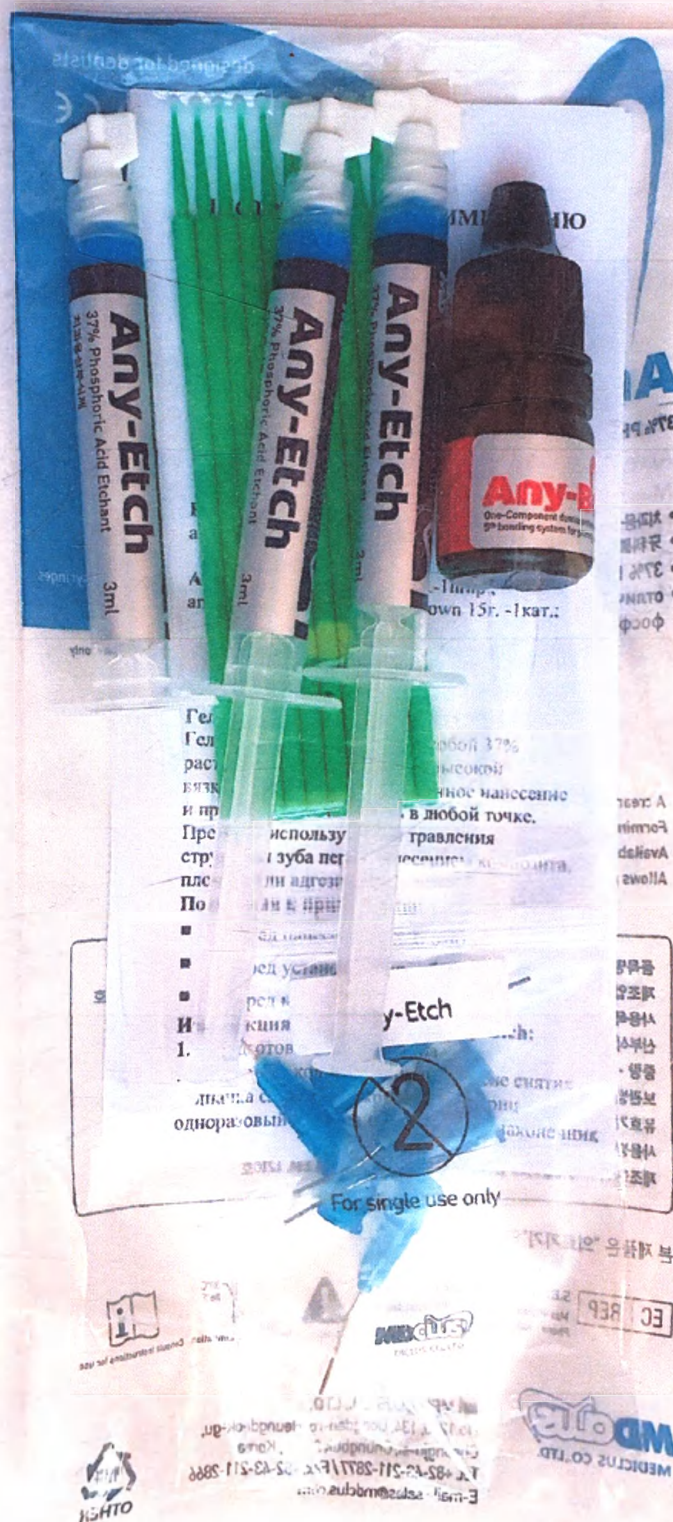

Фотографическое изображение 11 – Набор для пломбирования и восстановления зубов материалом светового отверждения, вариант исполнения Набор № 6 «Any-Etch», общий вид упаковки



Any-Etch
 2
 For single use only



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

для наборов:
 Any-Etch kit: any-etch 3мл. -3шт.; any-bond 5мл. -1фл.
 Once-Fill Flow kit: once-fill flow 1,2мл. -3шт.; any-etch 3мл. -1шт.; any-bond 5мл. -1фл.
 Any-Temp kit: any-temp 10г. -2шт.; any-etch 3мл. -1шт.
 Ezi-Crown kit: ezi-crown 15г. -2шт.; any-etch 3мл. -1шт.; once-fill flow 1,2мл. -1шт.
 Any-Core kit: any-core 9г. -1шт.; any-temp 10г. -2шт.; ezi-crown 15г. -1шт.;

Гель Any-Etch.
 Гель Any-Etch представляет собой 37% раствор фосфорной кислоты высокой чистоты. Он обеспечивает точное нанесение и превосходный контроль в любой точке. Препарат используют для травления структуры зуба перед нанесением композита, пломбы или адгезива.
 Показания к применению:
 ■ Перед нанесением композита;
 ■ Перед установкой пломбы;
 ■ Перед нанесением адгезива.
 Инструкция по применению Any-Etch:
 1. Подготовить полость зуба.
 2. Снимите колпачок шприца. После снятия колпачка следует прикрутить на шприц одноразовый наконечник. Вращайте наконечник

designed for dentists

Any-Etch®

Набор №6 «Any-Etch» в составе:

1. Адгезив во флаконе Any-Bond	- 1шт.
2. Микроапликаторы	- 10шт.
3. Гель Any-Etch	- 3шт.
4. Одноразовый наконечник для Any-Etch	- 6шт.
5. Инструкция	- 1 шт.

фосфорная кислота.

For professional dental use only
 Store in a cool place
 MDB-AE01-02
 Made in Korea

A cream-typed etchant preventing corrosion
 Forming the best etching depth
 Available for both in dentin and enamel
 Allows precise placement in any location

МЕДИКЛАС К.А. LTD. MEDICLUS Co., Ltd.
 1210, Sadang-ro, Gyeonggi-do, Korea
 1210, Sadang-ro, Gyeonggi-do, Korea
 Tel: +82-43-211-2877
 Регистратура, приемное отделение: тел. 238-1325/3668

Any-Etch HV
 등록허가번호: 대한 제신 12-03 호
 기위에서 법당질물

For information, please contact:
 ООО "МЕДИКАЛ", 123254, Санкт-Петербург,
 ул. Комсомола д. 40-41, 4-й этаж, 4-Б,
 офис 1-2-3. Тел: +7(812) 468-06-78
 Обратитесь к сертифицированному дистриктеру.

ТОЛЬКО ДЛЯ СТОМАТОЛОГОВ

본 제품은 "의료기기"임.

EC REP S.B. PHARMA GMBH
 Max-Planck str. 25a D-50858, Köln, Germany
 Phone: +49 2224-980-1521

MEDICLUS CO., LTD.
 No. 1210, 134, Gogdan-ro, Heungdeok-gu,
 Cheongju-si, Chungbuk 28576, Korea
 Tel: +82-43-211-2877 / Fax: +82-43-211-2866
 E-mail: sales@wdctm.com

Фотографическое изображение 12 – Набор для пломбирования и восстановления зубов материалом светового отверждения, вариант исполнения Набор № 6 «Any-Etch», составные части и в упаковка



Фотографическое изображение 13 – Набор для пломбирования и восстановления зубов материалом светового отверждения, вариант исполнения Набор № 7 «Once-Fil Flow», общий вид упаковки



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

для наборов:
Any-Etch kit: any-etch 3мл, -3шт.; any-bond 5мл, -1шт.
Once-Fil Flow kit: once-fil flow 1,2мл, -3шт.; any-bond 5мл, -1шт.
Any-Temp kit: any-temp 10г, -2шт.; any-etch 3мл, -1шт.
Ez3-Crown kit: ez3-crown 15г, -2шт.; any-etch 3мл, -1шт.; once-fil flow 1,2мл, -1шт.
Any-Core kit: any-core 9г, -1шт.; any-temp 10г, -2шт.; ez3-crown 15г, -1шт.

Гель Any-Etch.
Гель Any-Etch представляет собой 37% раствор фосфорной кислоты высокой вязкости. Он обеспечивает тонкое нанесение и превосходный контроль в любой точке. Препарат используют для травления структуры зуба перед нанесением композита, пломбы или адгезива.
Показания к применению:
■ Перед нанесением композита;
■ Перед установкой пломбы;
■ Перед нанесением адгезива.
Инструкция по применению Any-Etch:
1. Подготовить полость зуба. После снятия колпачка следует прикрутить на шприц одноразовый наконечник. Вращайте наконечник

Once-Fil Flow



For single use only



Any-Etch



For single use only



- Набор №7 «Once-Fil Flow» в составе:
1. Адгезив во флаконе Any-Bond - 1шт.
 2. Микроапликаторы - 10шт.
 3. Гель Any-Etch - 1шт.
 4. Композит Once-Fil Flow - 3шт.
 5. Одноразовый наконечник для Any-Etch - 2шт.
 6. Одноразовый наконечник для Once-Fil Flow - 6шт.
 7. Инструкция - 1шт.

For professional dental use only
Store in a cool place

MDB-AE01-02
Made in Korea

A cream-typed etchant preventing corrosion
Forming the best etching depth
Available for both in dentin and enamel
Allows precise placement in any location

МЕДИКЛУС КО., ЛТД. (MEDICLUS CO., LTD.)
No.1210, Gongsan-ro, Heungdeok-gu, Seoul, Korea
Tel. +82-43-211-2877 / Fax. +82-43-211-2866
Регистрационное удостоверение: № P.21.12.02.1450

Уполномоченный представитель:
ООО "МЕДЛЕНТ", 193210, г. Санкт-Петербург,
ул. Вавилова д. 30-40, лит. А, пом. 6-Н,
офис 1-0-А. Тел.: +7(812) 640-20-70
Обратитесь к официальному дистрибутору.

ТОЛЬКО ДЛЯ СТОМАТОЛОВ

Any-Etch HV
등록허가번호: 대한 제신 12-33 호
기 위해서 발명됨

제형: M, 1210호

본 제품은 "의료기기"임.

EC REP S.B. PHARMA GmbH
Max-Planck str. 27a D-52080, Aachen, Germany
Phone: +49 241 2236-999-1521



MEDICLUS CO., LTD.
No.1210, 134, Gongsan-ro, Heungdeok-gu,
Cheongju-si, Chungbuk 28576, Korea
Tel. +82-43-211-2877 / Fax. +82-43-211-2866
E-mail: sales@medclus.com



Фотографическое изображение 14 – Набор для пломбирования и восстановления зубов материалом светового отверждения, вариант исполнения Набор №7 «Once-Fil Flow», составные части и в упаковка



Фотографическое изображение 15 – Набор для пломбирования и восстановления зубов материалом светового отверждения, вариант исполнения Набор № 8 «Any-Temp NE», общий вид упаковки

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

для наборов:
Any-Etch kit: any-etch 3мл. - 3шпр.;
any-bond 5мл. - 1фл.

Once-Fil Flow kit: once-fil flow 1,2мл. - 3шпр.;
any-etch 3мл. - 1шпр.; any-bond 5мл. - 1фл.

Any-Temp kit: any-temp 10р. - 2шпр.;
any-etch 3мл. - 1шпр.

Ezi-Crown kit: ezi-crown 15р. - 2кат.;
any-etch 3мл. - 1шпр.; once-fil flow 1,2мл. - 1шпр.

Any-Core kit: any-core 9р. - 1шпр.;
any-temp 10р. - 2шпр.; ezi-crown 15р. - 1кат.

Гель Any-Etch.


Гель Any-Etch представляет собой 37% раствор фосфорной кислоты высокой вязкости. Он обеспечивает точное нанесение и превосходный контроль в любой точке. Препарат используют для травления структуры зуба перед нанесением композита, пломбы или адгезива.

Показания к применению:


- Перед нанесением композита;
- Перед установкой пломбы;
- Перед нанесением адгезива.

Инструкция по применению Any-Etch:

1. Подготовить полость зуба.
2. Снимите колпачок шприца. После снятия колпачка следует прикрутить на шприц одноразовый наконечник. Вращайте наконечник

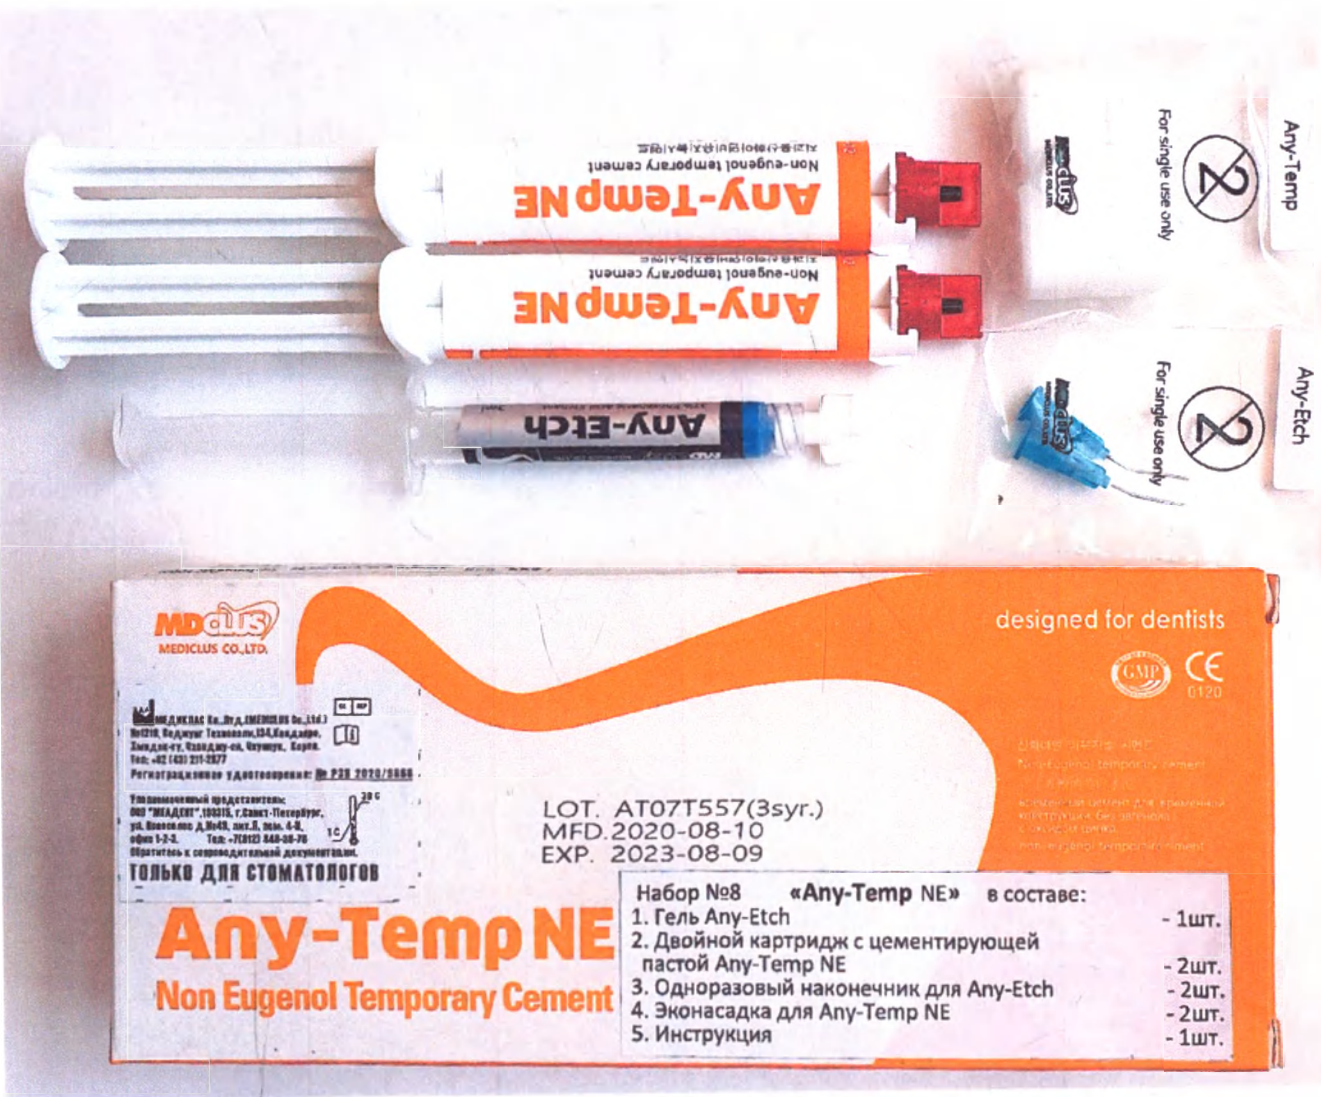

Фотографическое изображение 16 – Набор для пломбирования и восстановления зубов материалом светового отверждения, вариант исполнения Набор №8 «Any-Temp NE», состав части и упаковка

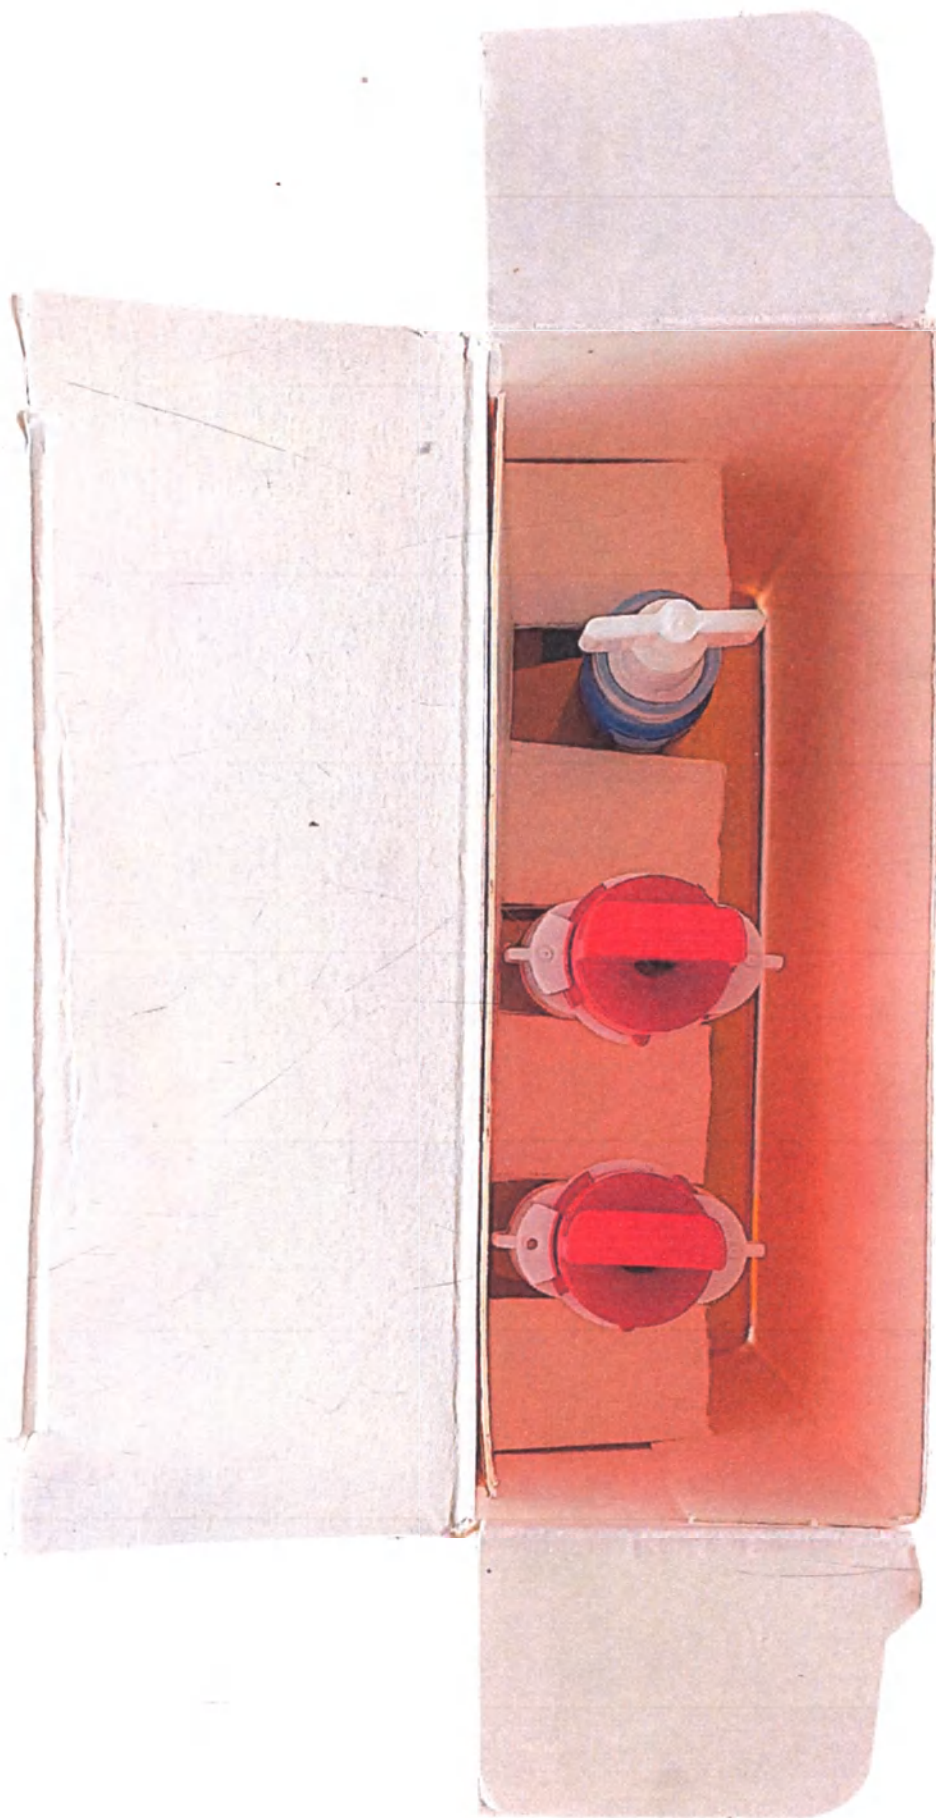

*Фотографическое изображение 17 – Набор для пломбирования и восстановления зубов
материалом светового отверждения, вариант исполнения Набор № 8 «Апу-Темр NE»,
расположение составных частей в упаковке*

Фотографическое изображение 18 – Набор для пломбирования и восстановления зубов
материалом светового отверждения, вариант исполнения Набор № 9 «Ezi-Crown», общий вид
упаковки





Фотографическое изображение 19 – Набор для пломбирования и восстановления зубов материалом светового отверждения, вариант исполнения Набор № 9 «Ezi-Crown», составные части и упаковка



*Фотографическое изображение 20 – Набор для пломбирования и восстановления зубов
материалом светового отверждения, вариант исполнения Набор № 9 «Ezi-Crown»,
расположение составных частей в упаковке*



Фотографическое изображение 21 – Набор для пломбирования и восстановления зубов материалом светового отверждения, вариант исполнения Набор № 10 «Any-Core», общий вид упаковки

Фотографическое изображение 22 – Набор для пломбирования и восстановления зубов
материалом светового отверждения, вариант исполнения Набор № 10 «Amu-Sore», составные
части и утаковка



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

для наборов:
Any-Etch kit: any-etch 3мл. -3штпр.;
any-bond 5мл. -1фл.

Once-Fil Flow kit: once-fil flow 1,2мл. -3шпр.;
any-etch 3мл. -1шпр.; any-bond 5мл. -1фл.

Any-Temp kit: any-temp 10r.-2wmp.;
any-etch 3ml. -1wmp.

Ezi-Crown kit: ezi-crown 15r.-2kat.;
any-etch 3мл.-1шпр.; once-fil flow 1,2мл.-1шпр.

Any-Core kit: any-core 9r.-1wmp.;
any-temp 10r.-2wmp.; czi-crown 15r.-1kat.7

Гель Any-Etch.

Гель Aну-Etch.
Гель Aну-Etch представляет собой 37% раствор фосфорной кислоты высокой вязкости. Он обеспечивает точное нанесение и превосходный контроль в любой точке. Препарат используется для травления структуры зуба перед нанесением композита, пломбы или адгезива.

Показания к применению:

- Перед нанесением композита;
- Перед установкой пломбы;
- Перед нанесением адгезива.

Инструкции по применению Aply-Etch:

1. Подготовить полость зуба.
2. Снимите колпачок шприца. После снятия колпачка следует прикрутить на шприц одноразовый наконечник. Вращайте наконечник



*Фотографическое изображение 23 – Набор для пломбирования и восстановления зубов
материалом светового отверждения, вариант исполнения Набор № 10 «Any-Core»,
расположение составных частей в упаковке*



Фотографическое изображение 24 – Адгезив во флаконе Any-Bond



Фотографическое изображение 25 – Микроаппликатор



Фотографическое изображение 26 – Композит Ану-Сот оттенок А2



Фотографическое изображение 27 – Композит Any-Com оттенок А3



Фотографическое изображение 28 – Композит Any-Com оттенок А3,5



Фотографическое изображение 29 – Композит Ану-Сот оттенок ОА2



Фотографическое изображение 30 – Композит Апу-Сот оттенок ОА3



Фотографическое изображение 31 – Композит Any-Com Flow оттенок A2



Фотографическое изображение 32 – Композит Any-Com Flow оттенок А3



Фотографическое изображение 33 – Композит Any-Com Flow оттенок A3,5

Фотозрафическое изображение 34 – Одноразовый наконечник для Any-Com Flow





Фотографическое изображение 35 – Гель Any-Etch



Фотографическое изображение 36 – Композит Ezi-Crown оттенок A2



Фотографическое изображение 37 – Композит Once-Fil Flow



Фотографическое изображение 38 – Двойной картридж с композитом Any-Core




Фотографическое изображение 39 – Двойной картридж с цементирующей пастой Ану-Темп NE



Фотографическое изображение 40 – Одноразовый наконечник для Apy-Etch



Фотографическое изображение 41 – Одноразовый наконечник для Once-Fil Flow

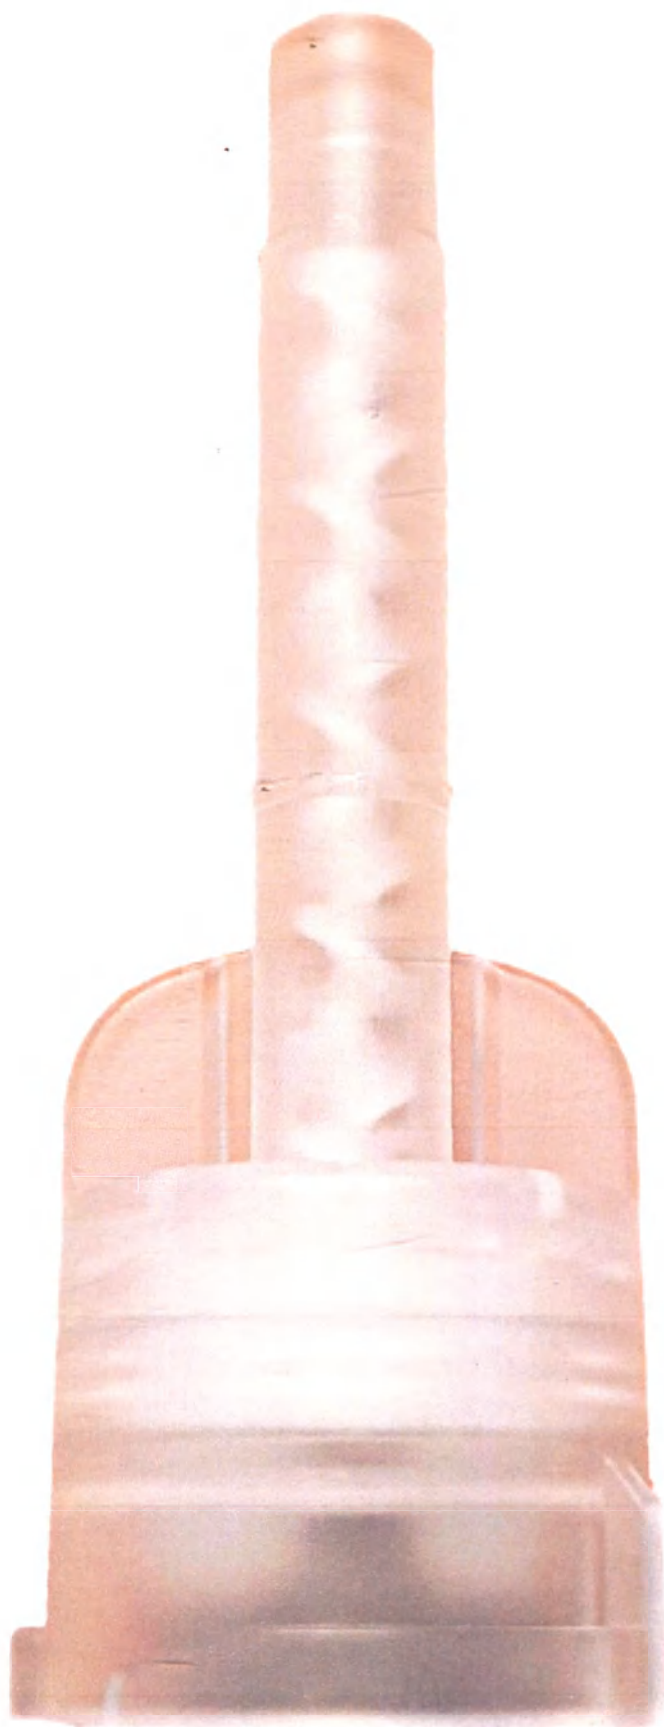

Фотографическое изображение 42 – Наконечник для смешивания для Anu-Core



Фотографическое изображение 43 – Эконасадка для Апу-Тепр NE

ООО «МЕАДЕНТ»

Итого в настоящем документе

44 сорок
четыре листа (ов)

Генеральный директор

Яхнев Д. В.

