



**Фотографические изображения  
медицинского изделия  
Система для неинвазивного измерения  
жидкости в лёгких ReDS Pro, модель С**



Рис.1. Система для неинвазивного измерения жидкости в лёгких ReDS Pro, модель C\*  
(компьютер с сенсорным дисплеем, блок датчиков, тройной кабель,  
установлено на передвижную тележку), вид спереди

\* Прим.: на фото представлена Система для неинвазивного измерения жидкости в лёгких ReDS Pro, модель C PPU. Система для неинвазивного измерения жидкости в лёгких ReDS Pro, модель C, в вариантах исполнения «Система для неинвазивного измерения жидкости в лёгких ReDS Pro, модель C» и «Система для неинвазивного измерения жидкости в лёгких ReDS Pro, модель C PPU» полностью идентичны по внешнему виду медицинского изделия и его комплектующих.



Рис.2. Система для неинвазивного измерения жидкости в лёгких ReDS Pro, модель С (компьютер с сенсорным дисплеем, блок датчиков, тройной кабель, установлено на передвижную тележку), вид сзади



Рис.3. Настольная подставка



Рис.4. Транспортировочный кейс



Рис.5. Транспортировочный кейс (в раскрытом виде)



Рис.6. Рулетка для измерения полуобхвата груди



Рис.7. USB-модем



Рис.8. USB-ключ «пакет исследований», в вариантах 100 / 250 / 500 исследований

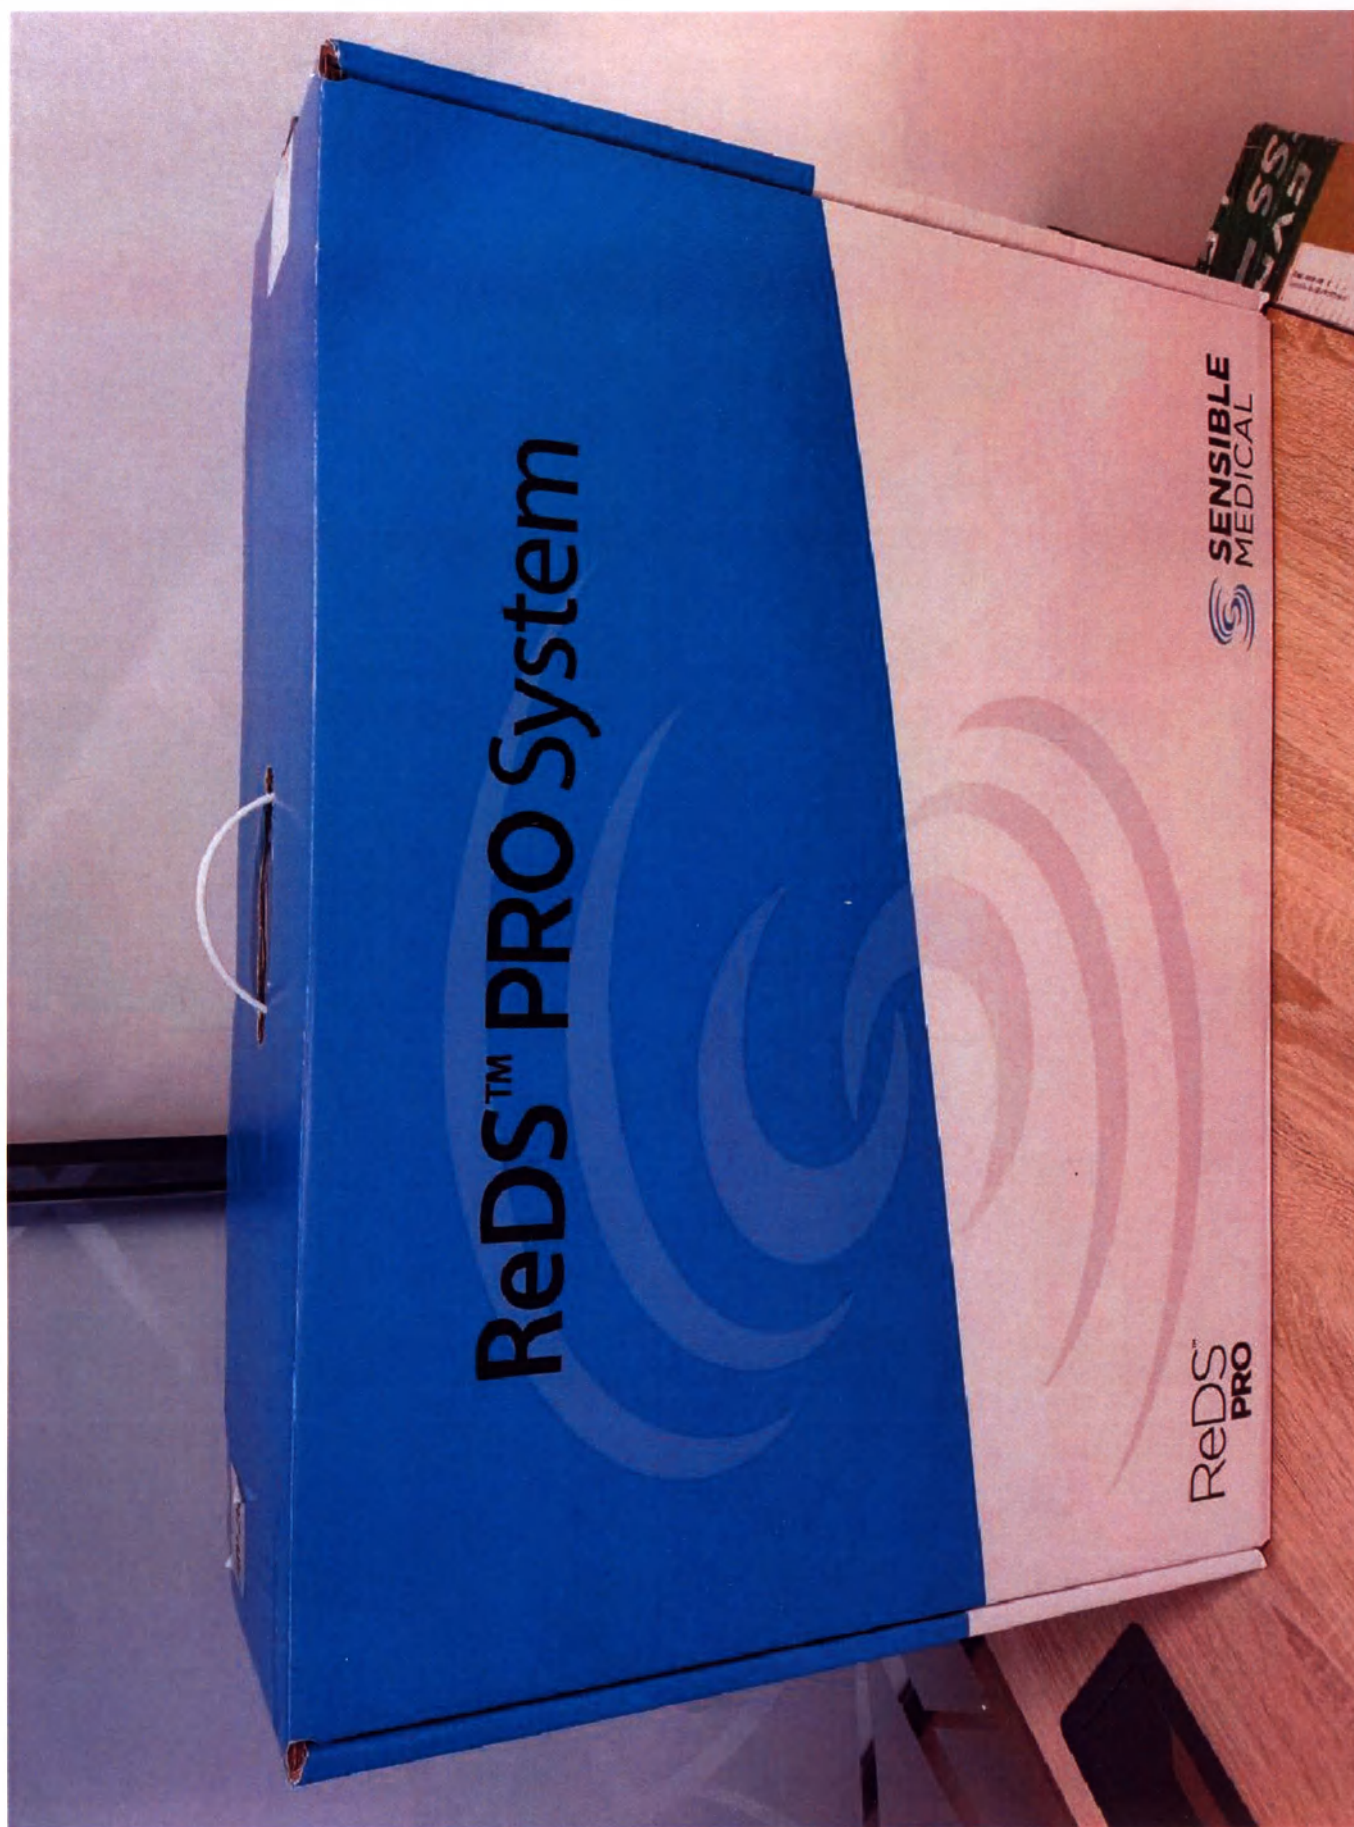


Рис.9. Коробка для транспортировки системы



**SENSIBLE  
MEDICAL**

**ReDS Pro System  
Fluid Status Monitor**



IEC 60601-1:2005 and IEC 60601-1-11:2015

Operating temperature: 41°F / 5°C / 95°F / 35°C

IP22 100-240V-50-60Hz



**Sensible Medical Innovations**  
6 Meir Ariel, Netanya  
4250364 Israel

**Made In Israel**

LBL0203 Rev B

**ReDS™ Pro System V2.7**

**Rx  
ONLY**

**REF** GAS0047

FCCID: 2ACNF-27C01

GTIN: 07290110070243

This device complies with part 15 of the FCC Rules.  
Operation is subject to the following two conditions:  
(1) this device may not cause harmful interference, and  
(2) this device must accept any interference received,  
including interference that may cause undesired  
operation.

[www.sensible-medical.com/Patents](http://www.sensible-medical.com/Patents)  
other patents pending



**SN** 2113EAJG80

(01)07290110070243

**MFG** 2022-06-13

(11)220613

MFG PN: GAS0047-US

(21)2113EAJG80

LBL0221 rev D

Рис.10. Маркировка Системы для неинвазивного измерения жидкости в лёгких ReDS Pro, модель C  
(прикроватная консоль с программным обеспечением)

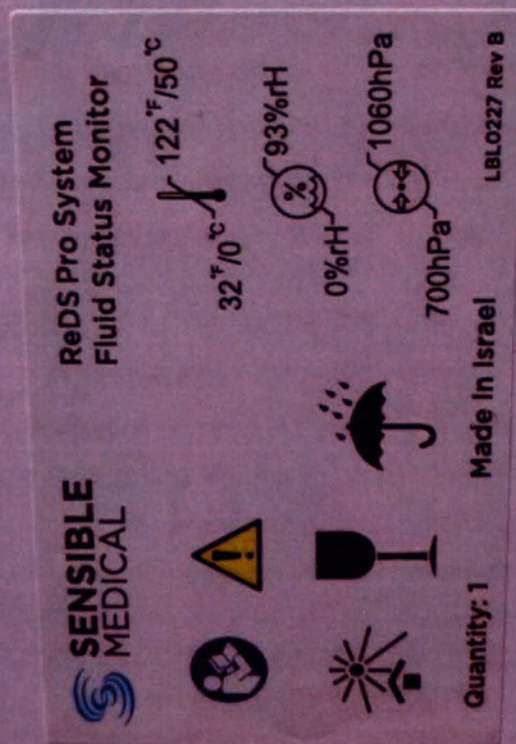


Рис.11. Маркировка Системы для неинвазивного измерения жидкости в лёгких ReDS Pro, модель C (коробка для транспортировки системы)

Всего прошито, пронумеровано,  
скреплено печатью

12 листа(ов)

Генеральный директор  
АО «Компания «Грин Лиф Фарма»



В.В. Ленская