



Рис. 1. Ларингофарингоскоп жесткий НОРКИНС в вариантах исполнения с принадлежностями. Транспортная упаковка.



Рис. 2. Ларингофарингоскоп жесткий НОРKINS в вариантах исполнения с принадлежностями. Маркировка на транспортной упаковке.



**Рис. 3. Ларингофарингоскоп жесткий НОРКИНС с угловым окуляром, направление наблюдения 15°, диаметр 4 мм, длина 17 см.
Упаковка.**



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE

REF 8575AV

SN 1000X6

QTY 1

HOPKINS® Optik 15°, 4 mm, 17 cm
HOPKINS® Telescope 15°, 4 mm, 17 cm
Optique HOPKINS® 15°, 4mm, 17cm
Sist. ottico HOPKINS® 15°, 4 mm, 17 cm
Óptica HOPKINS® 15°, 4 mm, 17 cm
Ótica HOPKINS® 15°, 4 mm, 17 cm



(01)04048551 210833(240)8575AV(21)1000X6

CE 0123

Рис. 4. Ларингофарингоскоп жесткий HOPKINS с угловым окуляром, направление наблюдения 15°, диаметр 4 мм, длина 17 см.
Маркировка на упаковке.

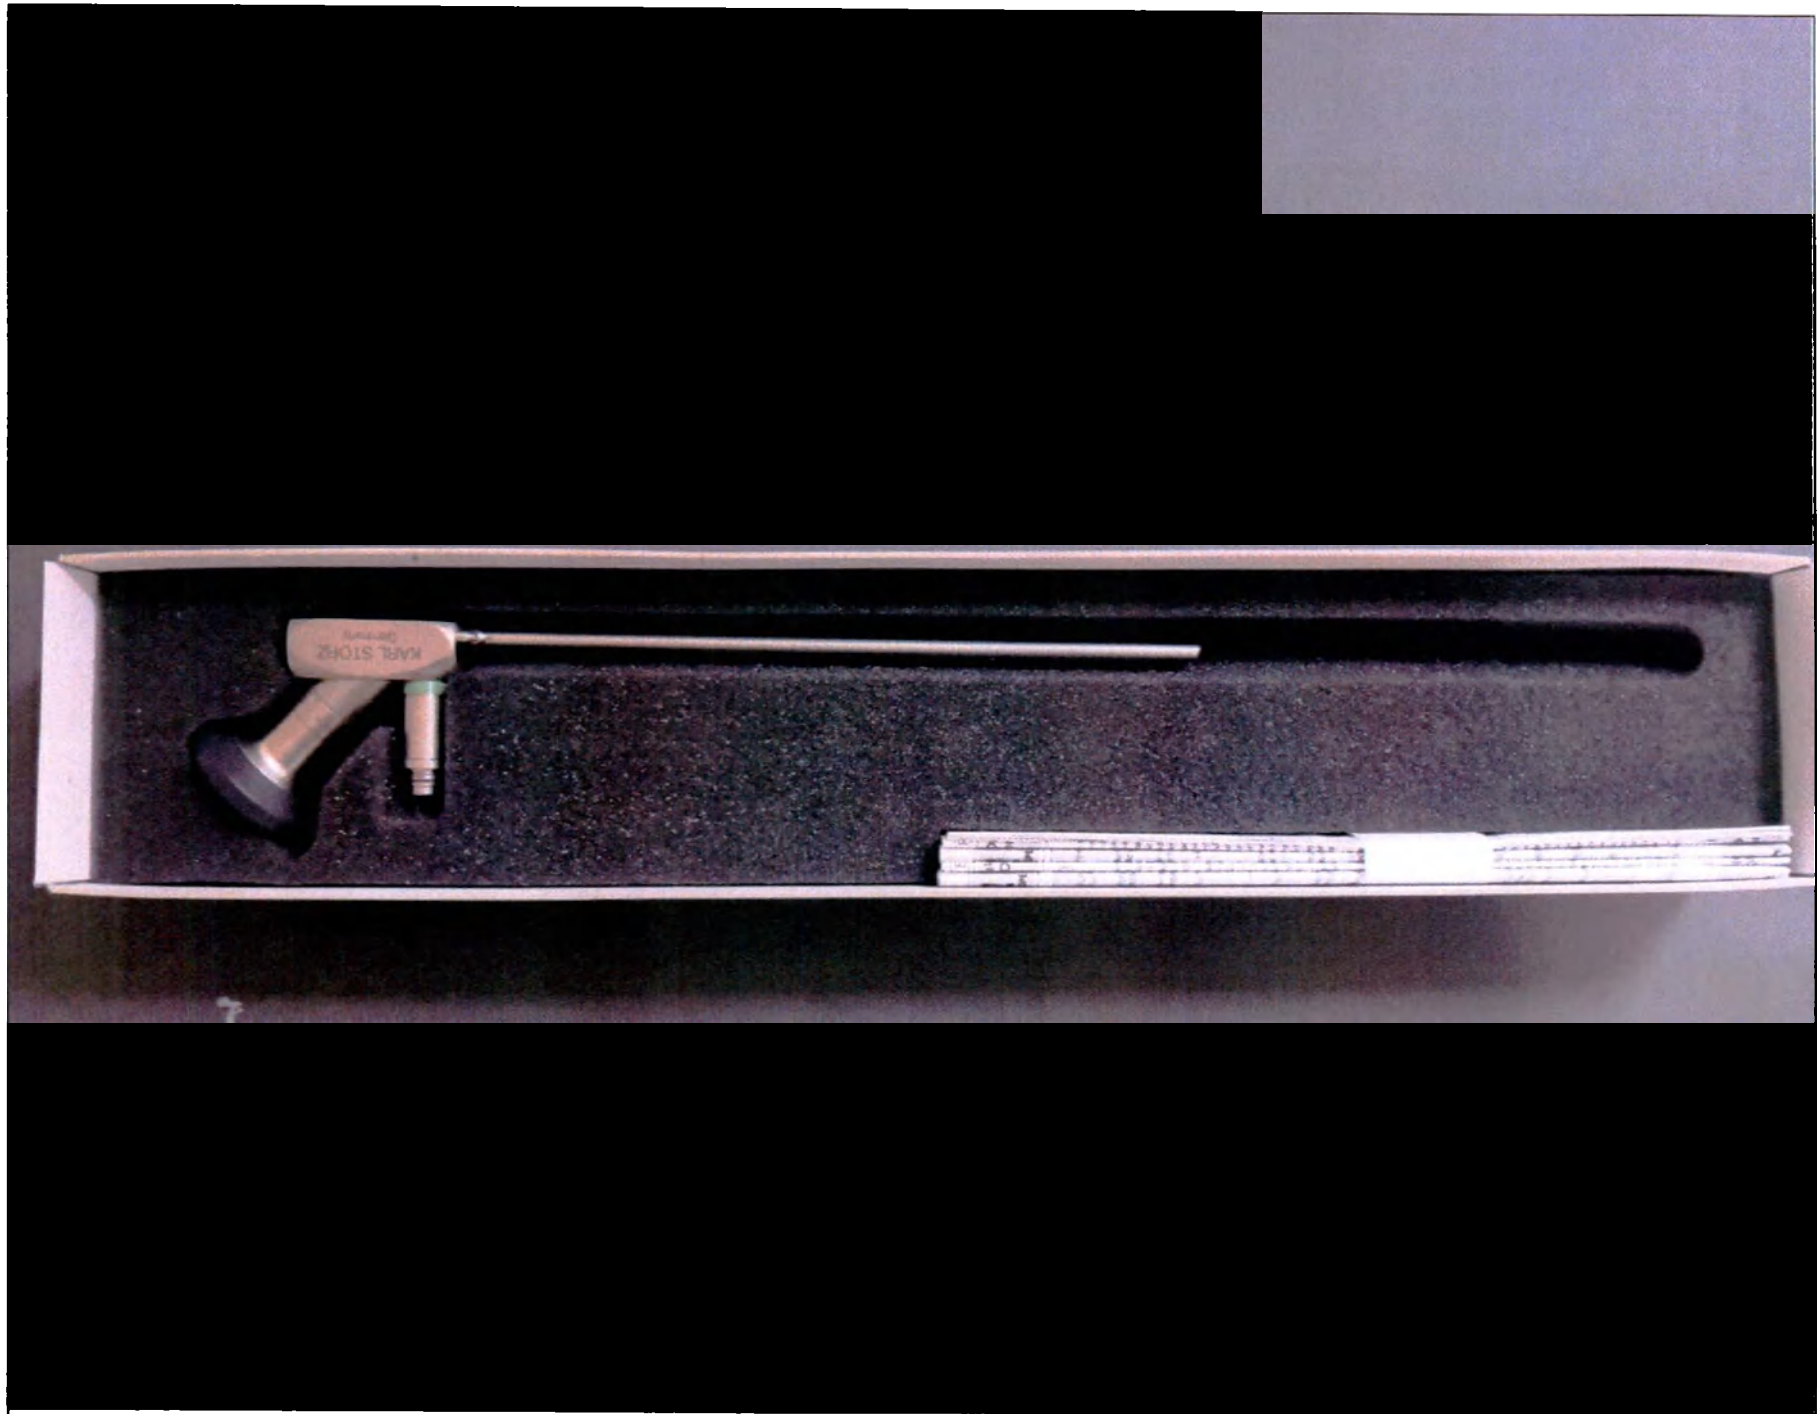


Рис. 5. Ларингофарингоскоп жесткий НОРКИНС с угловым окуляром, направление наблюдения 15°, диаметр 4 мм, длина 17 см.

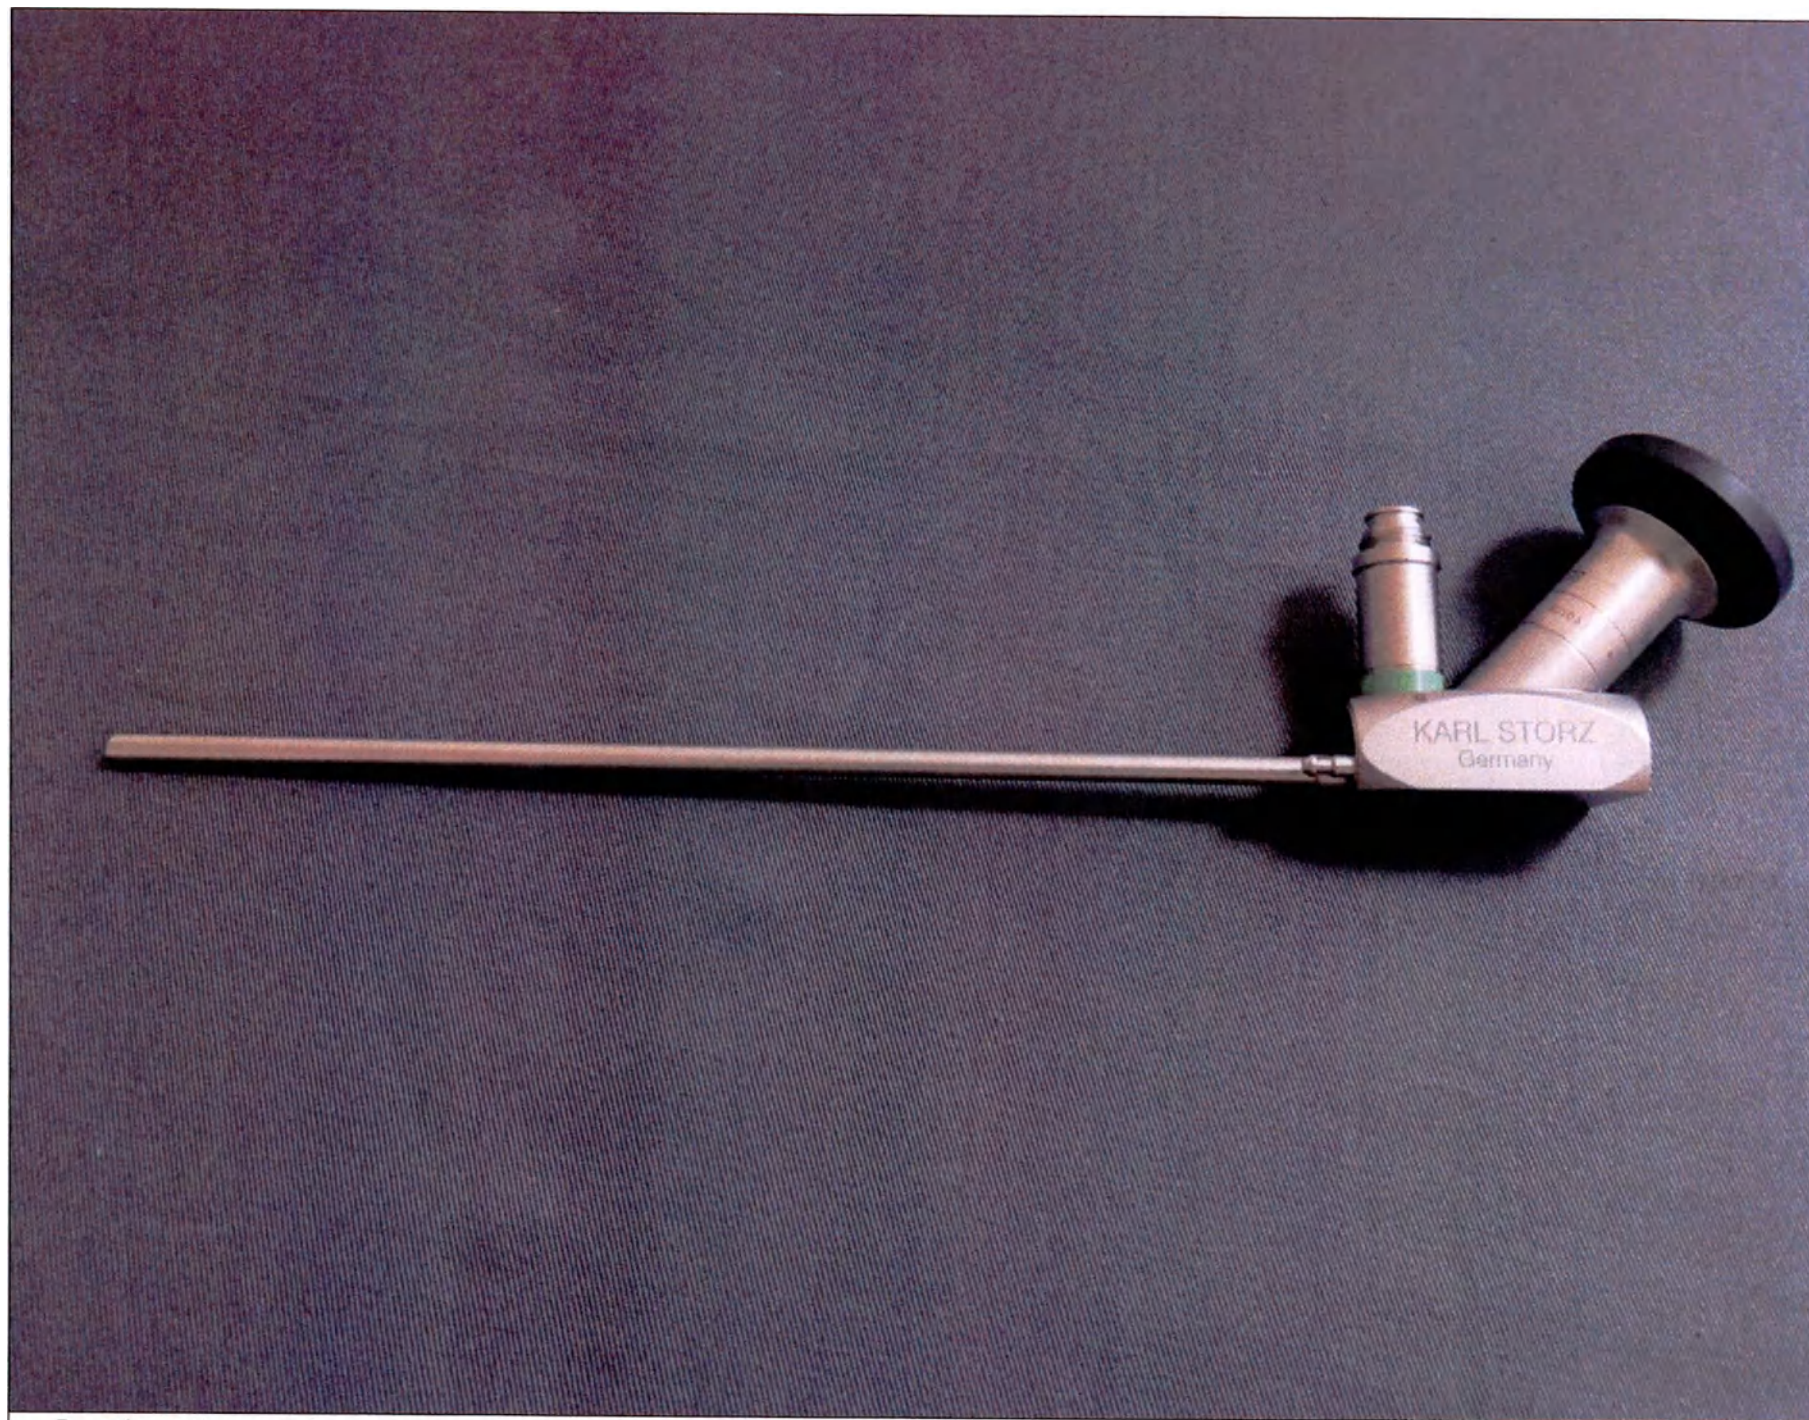


Рис. 6. Ларингофарингоскоп



Рис. 7. Ларингофарингоскоп



Рис. 8. Ларингофарингоскоп

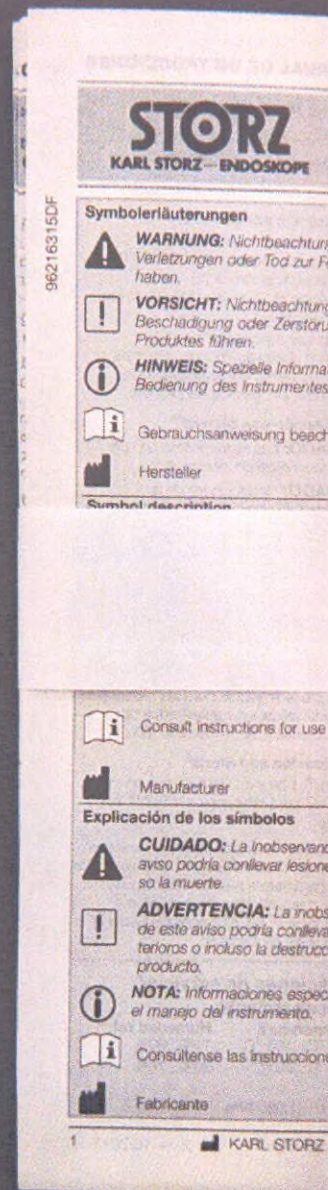


Рис. 9. Инструкция по эксплуатации. Конечный вид может быть изменен, содержание будет приведено в соответствие с документом в регистрационном досье.



Рис. 10. Ларингофарингоскоп жесткий HOPKINS с 4-кратным увеличением, направление наблюдения 90°, диаметр 10 мм, длина 15 см. Упаковка



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ – ENDOSKOPE

REF 8707DA

SN 10014E

QTY 1



de Tele-Laryngo-Pharyngoskop 90°, 15 cm
en Tele-Laryngo-Pharyngoscope 90°, 15 cm
fr Télé-laryngo-pharyngoscope, 90°, 15 cm
it Tele-laringo-faringoscopia 90°, 15 cm
es Telelaringofaringoscopia 90°, 15 cm
pt Telelaringofaringoscópio 90°, 15 cm



020002



Rx only

MD



2021-06-22



www.karlstorz.com/ifu

UDI (01)04048551216538(11)210622(21)10014E(422)276




Рис. 11. Ларингофарингоскоп жесткий НОРКИНС с 4-кратным увеличением, направление наблюдения 90°, диаметр 10 мм, длина 15 см. Маркировка на упаковке.

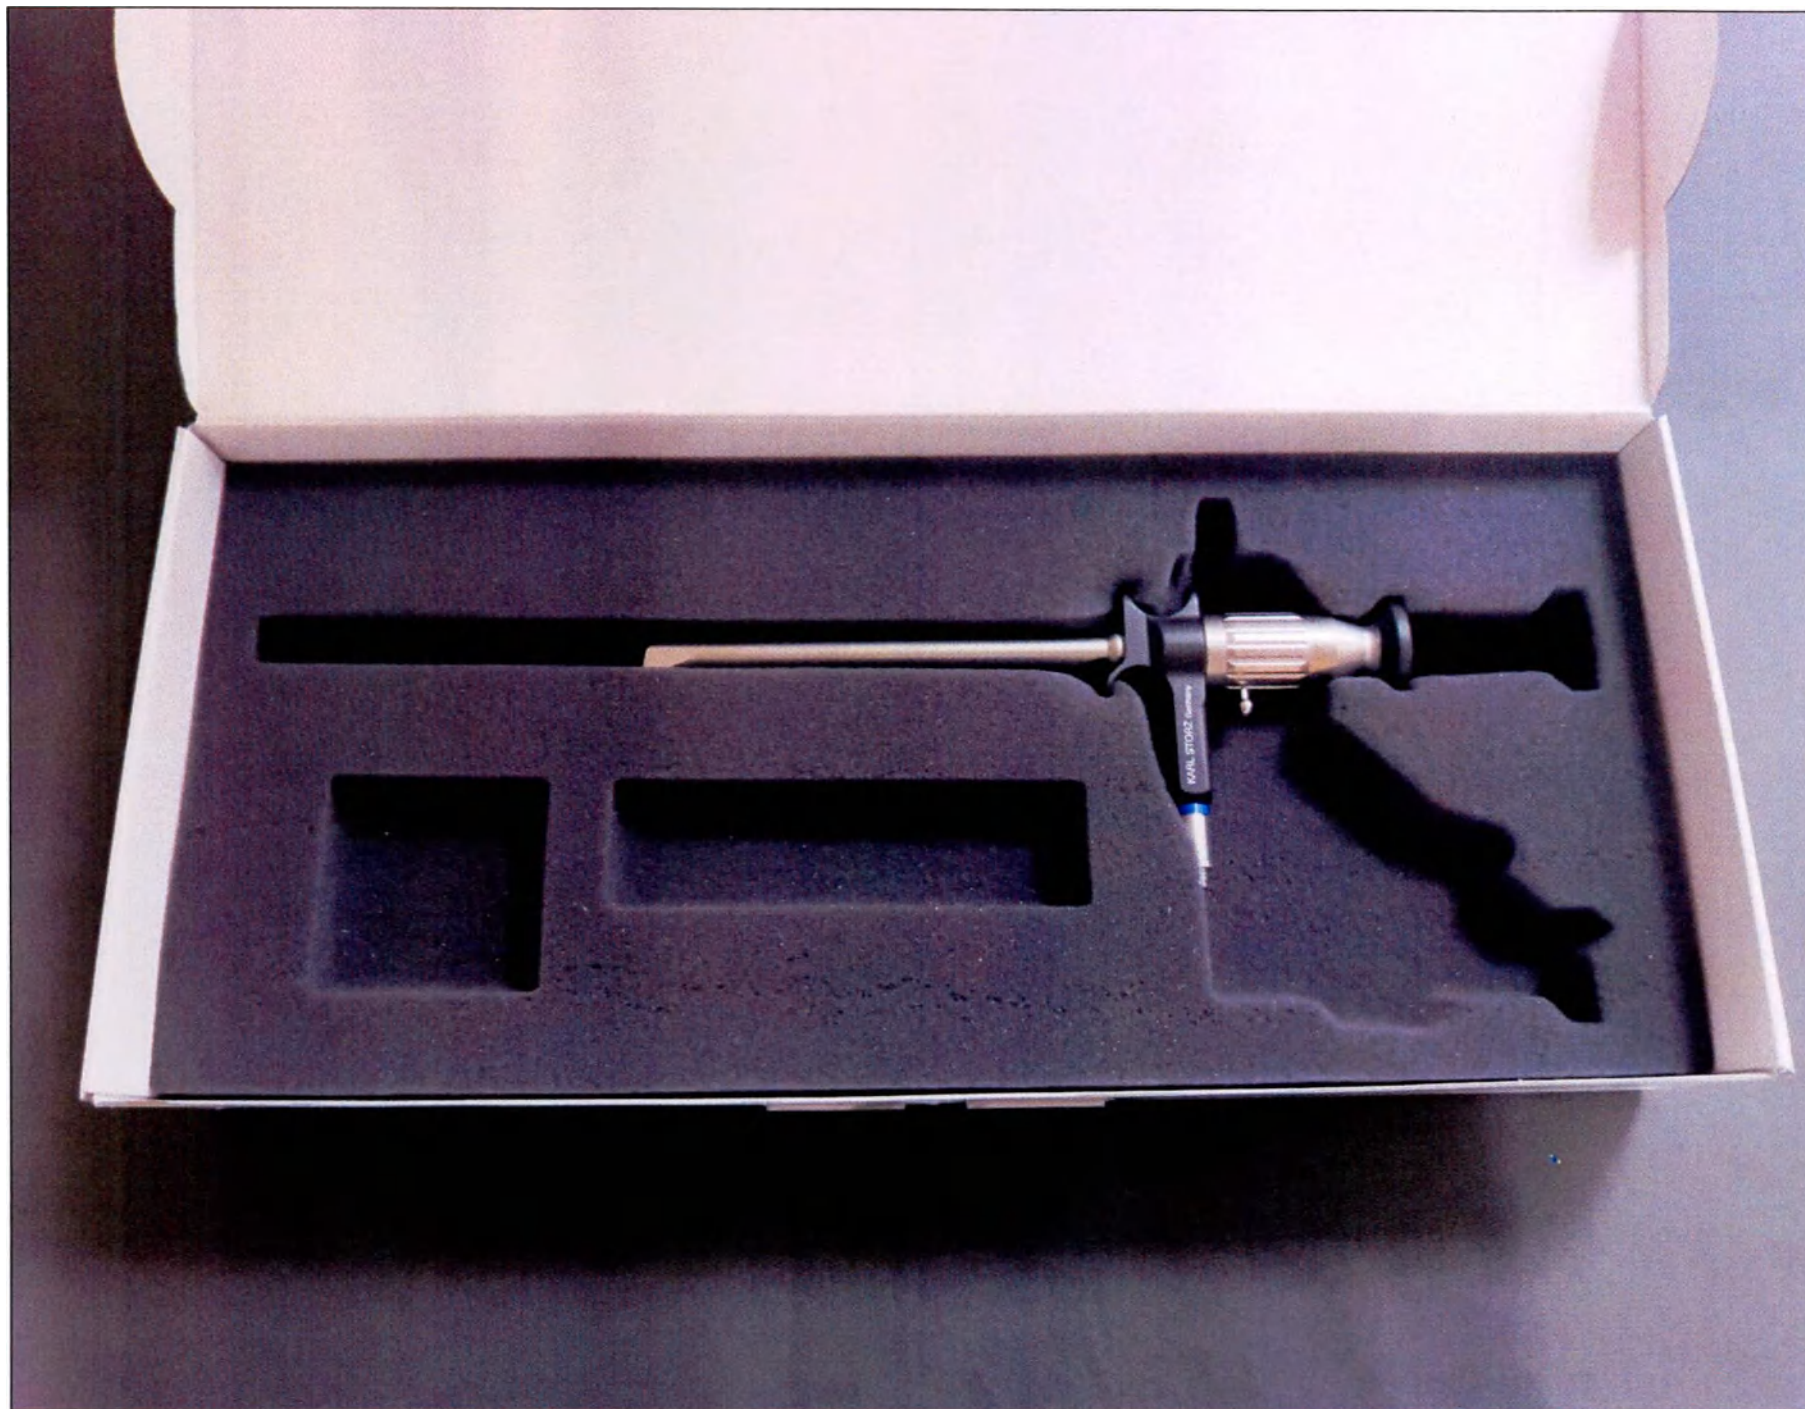


Рис. 12. Ларингофарингоскоп жесткий HOPKINS с 4-кратным увеличением, направление наблюдения 90°, диаметр 10 мм, длина 15 см.

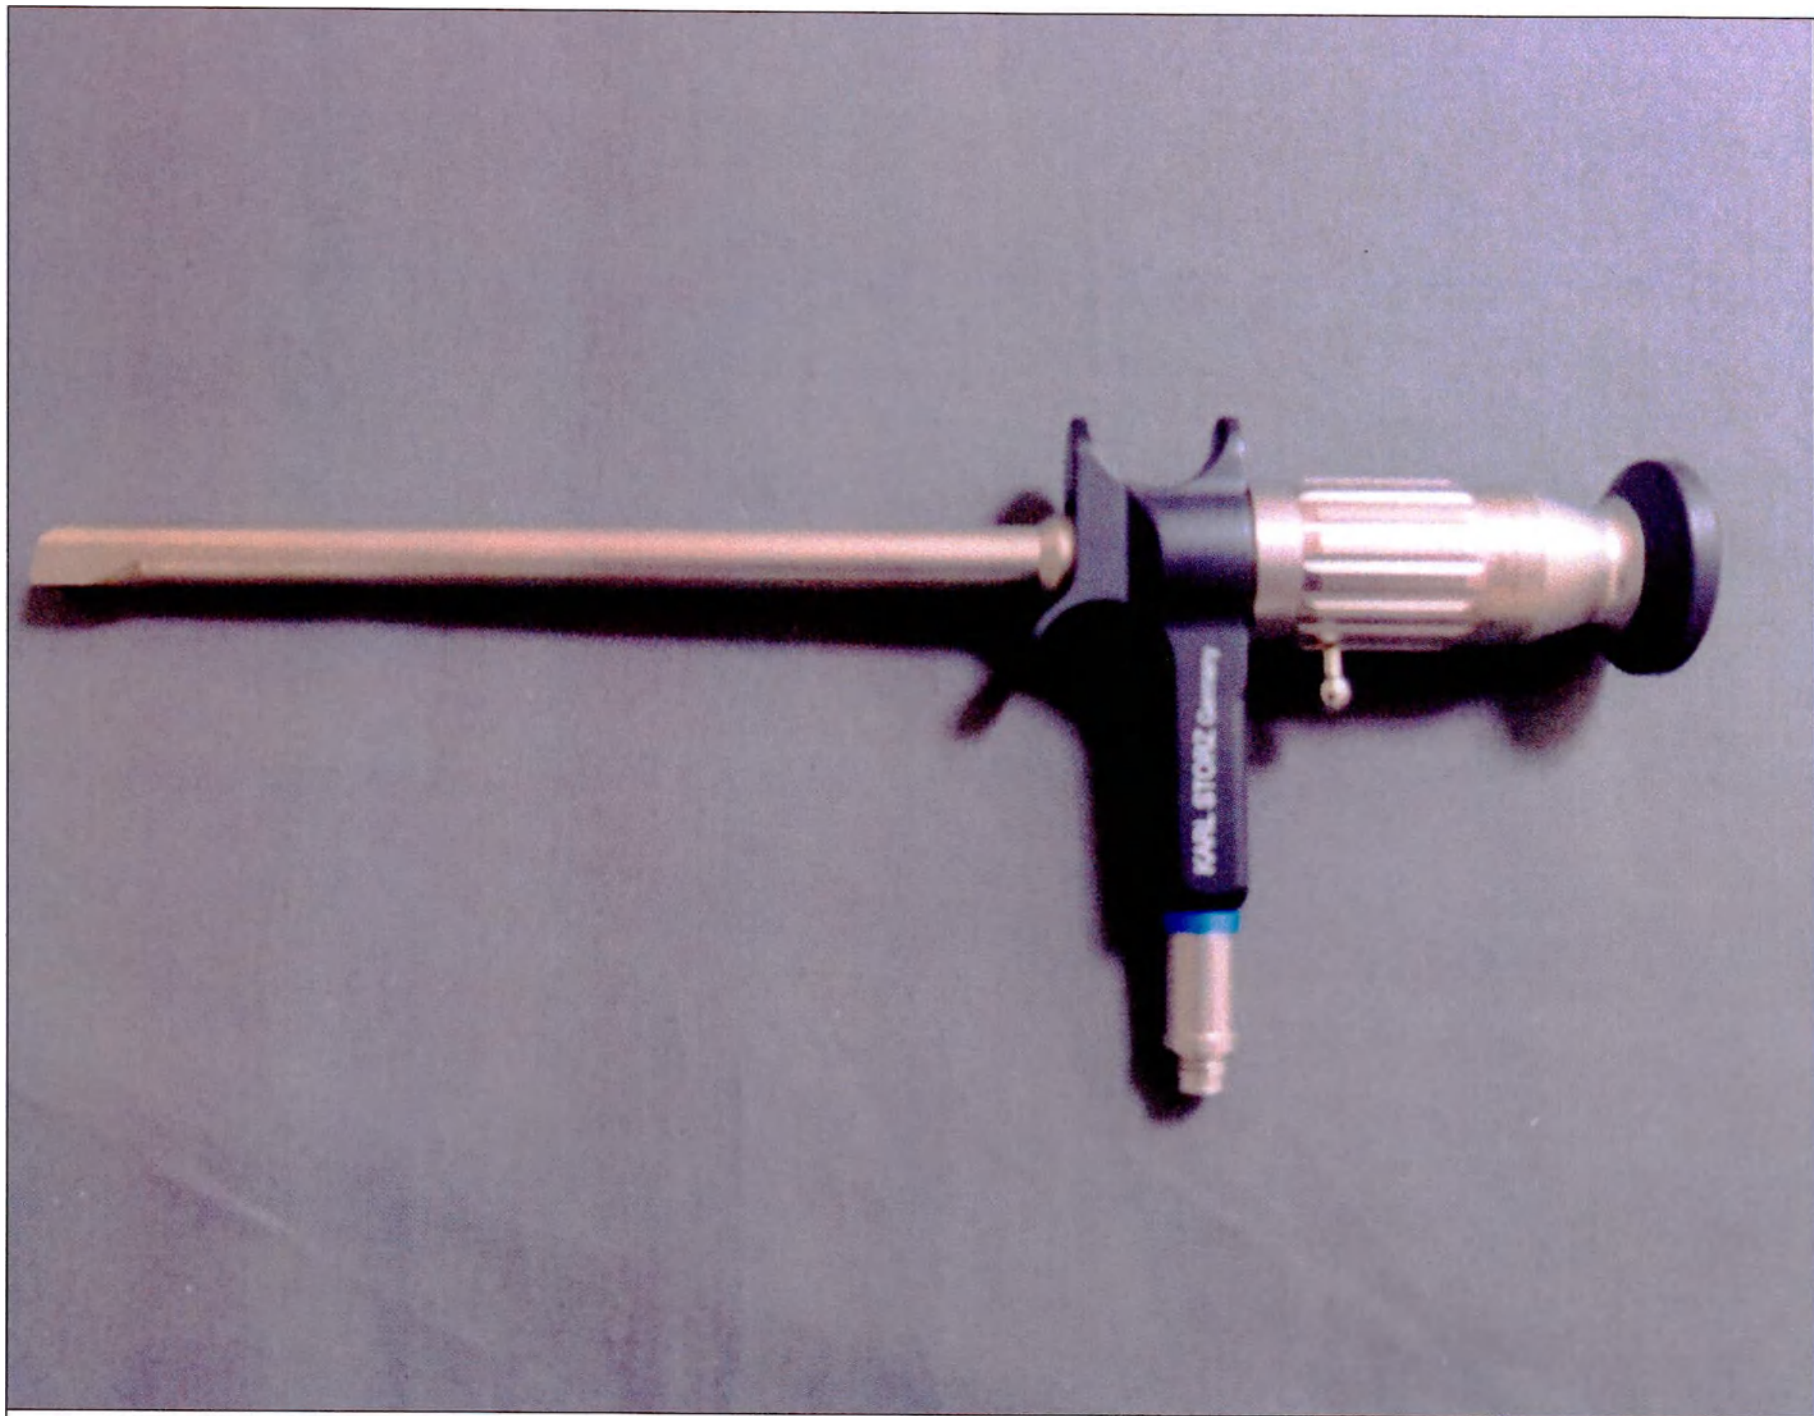


Рис. 13. Ларингофарингоскоп



Рис. 14. Ларингофарингоскоп



Рис. 15. Ларингофарингоскоп

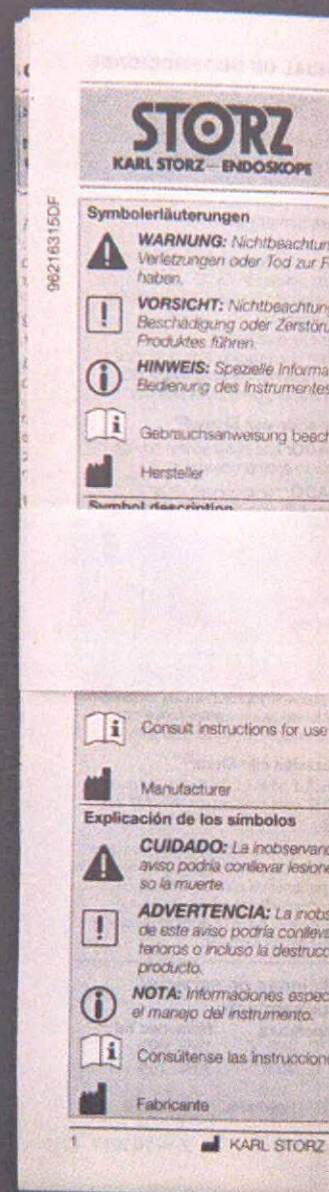


Рис. 16. Инструкция по эксплуатации. Конечный вид может быть изменен, содержание будет приведено в соответствие с документом в регистрационном досье.



Рис. 17. Ларингофарингоскоп жесткий НОРKINS для стробоскопии, направление наблюдения 70° , с овальным тубусом 7,2 x 9,3 мм, длина 17 см. Упаковка.



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ – ENDOSKOPE

SN 1000VY



REF 8706CA

QTY 1

de Strobo-Laryngoskop 70°, 17 cm
en Strobo-Laryngoscope 70°, 17 cm
fr Strobo-Laryngoscope 70°, 17 cm
it Strobo-laringoscopio 70°, 17 cm
es Estrobolaringscopio, 70°, 17 cm
pt Estrobolaringscópio 70°, 17 cm



Rx only

MD



2021-07-13



www.karlstorz.com/ifu

UDI (01)04048551216521(11)210713(21)1000VY(422)276



Рис. 18. Ларингофарингоскоп жесткий НОРКИНС для стробоскопии, направление наблюдения 70°, с овальным тубусом 7,2 x 9,3 мм, длина 17 см. Маркировка на упаковке.

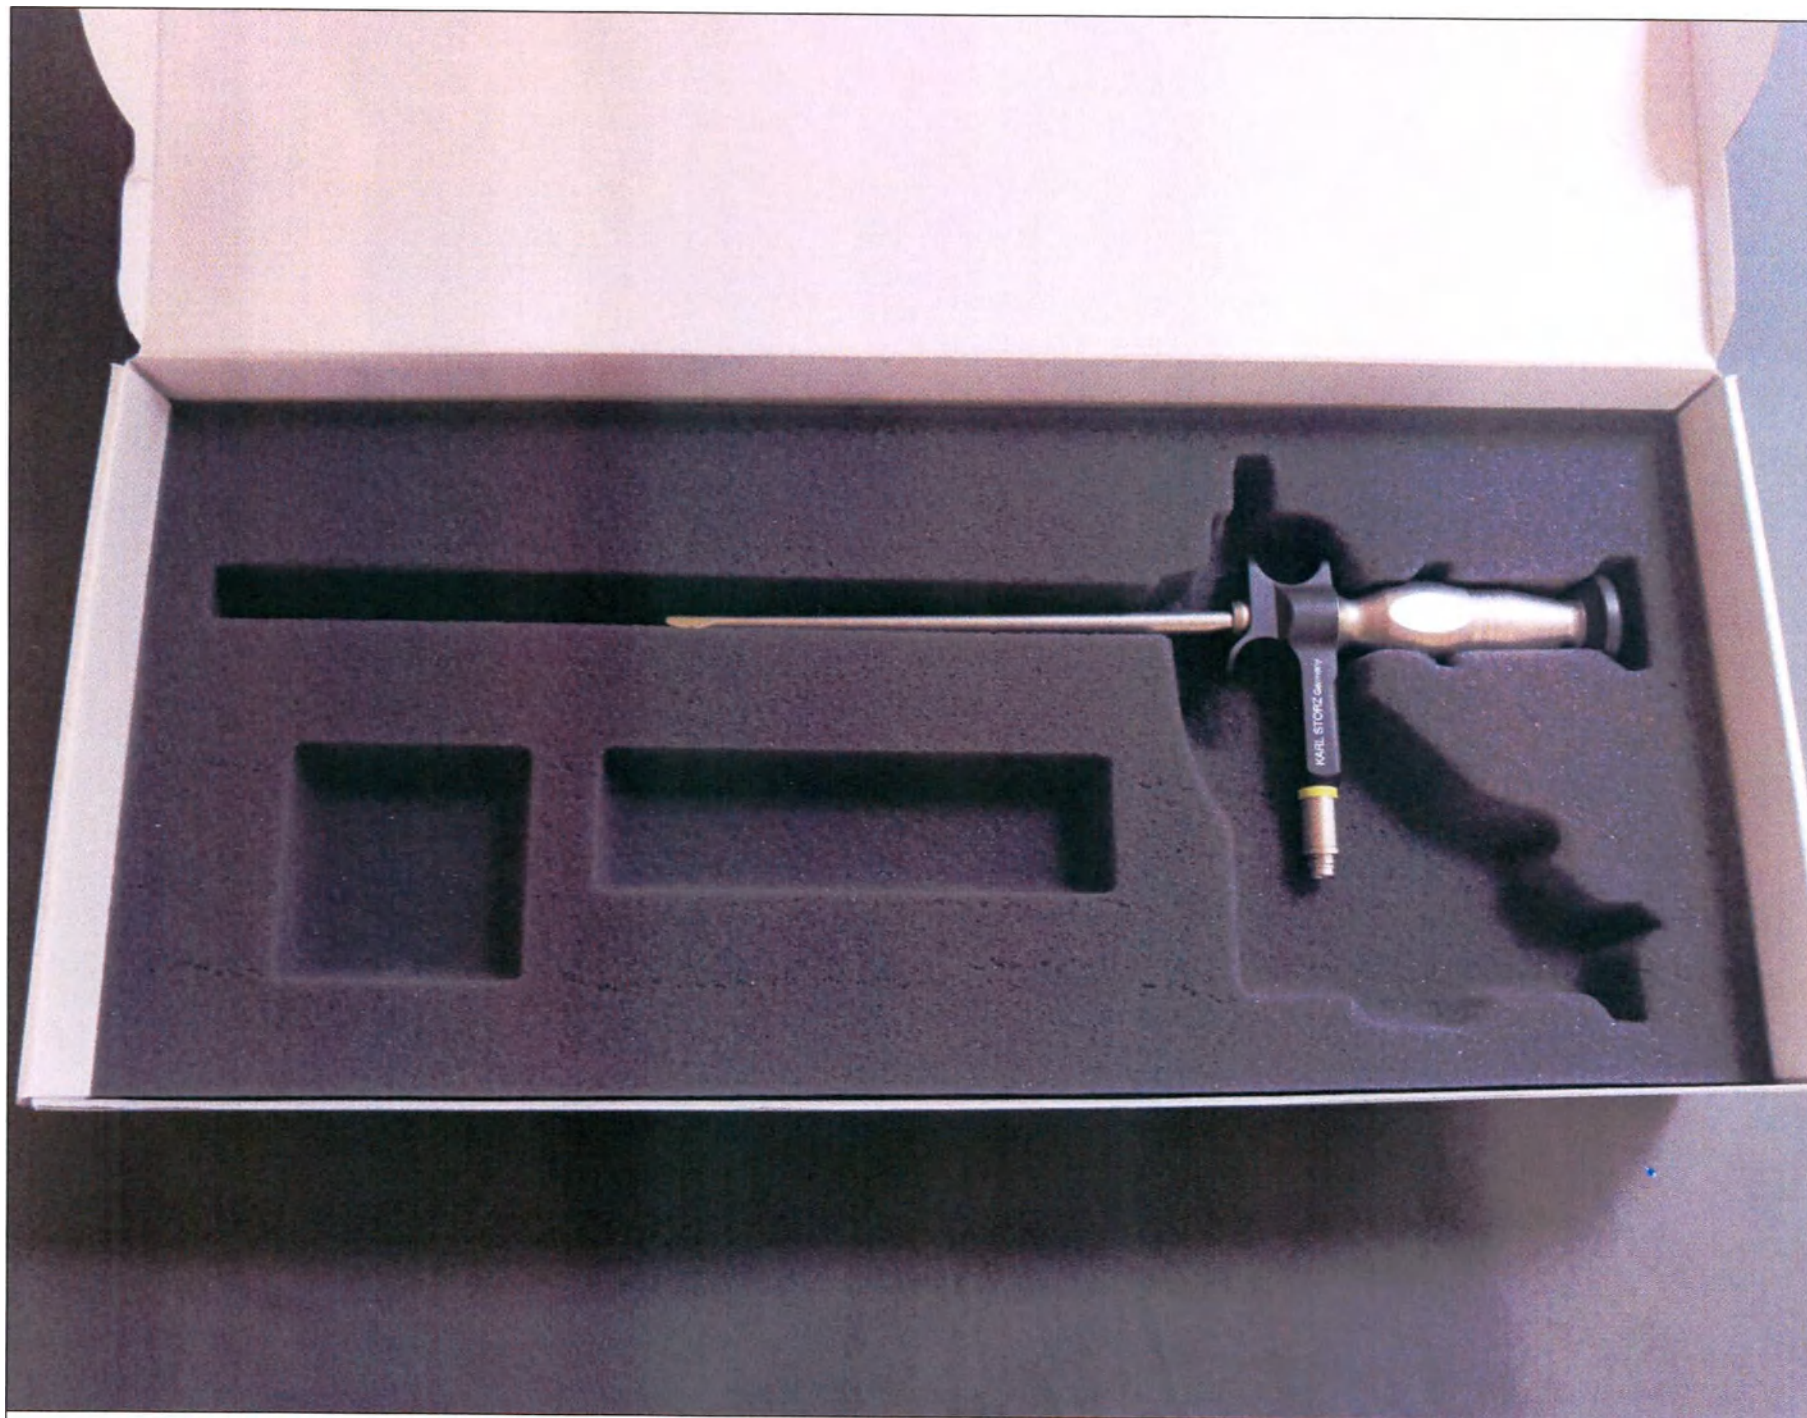


Рис. 19. Ларингофарингоскоп жесткий HOPKINS для стробоскопии, направление наблюдения 70°, с овальным тубусом 7,2 x 9,3 мм, длина 17 см

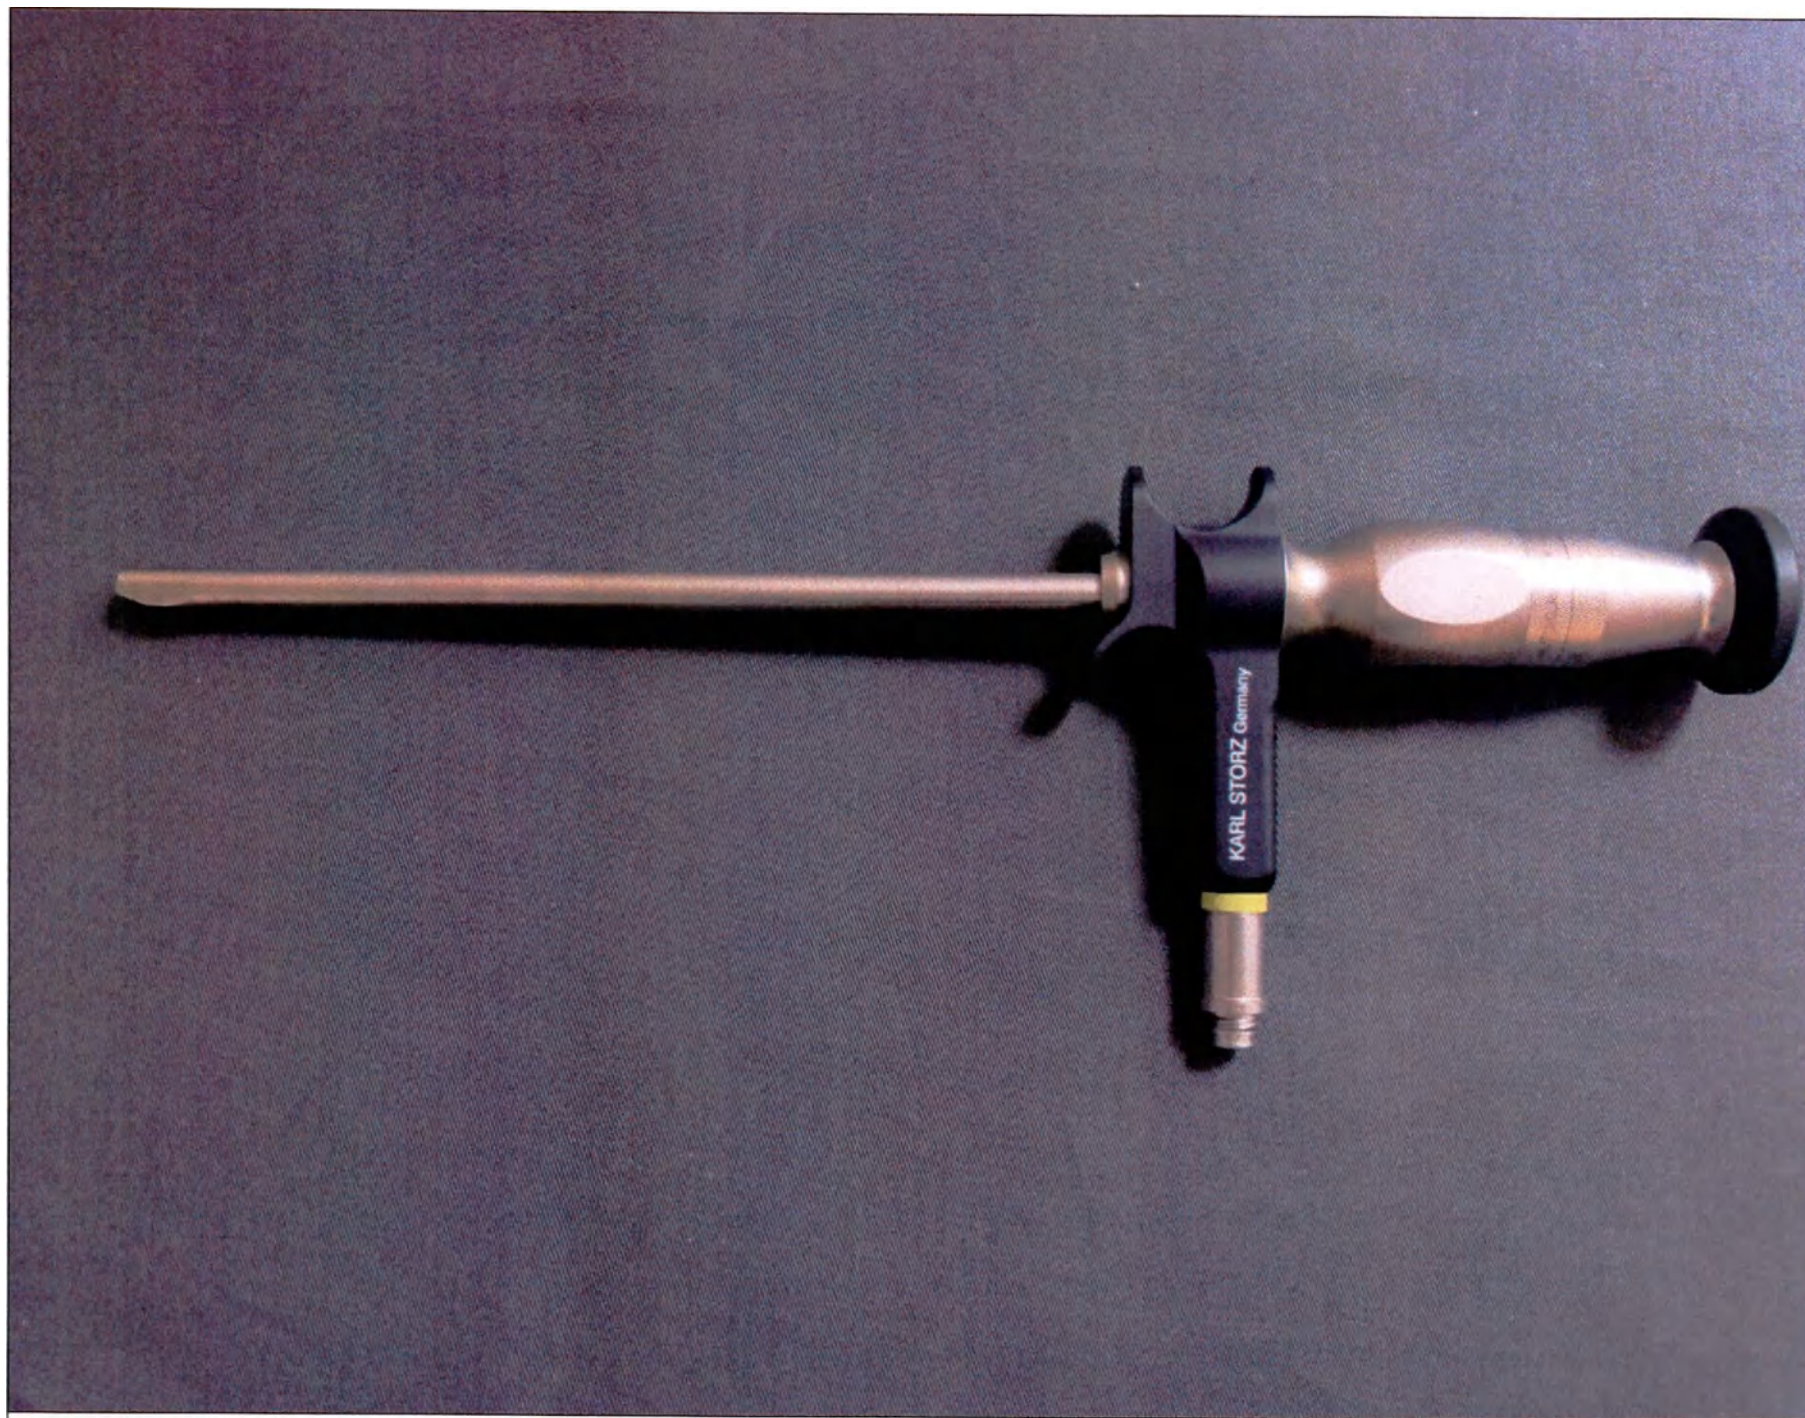


Рис. 20. Ларингофарингоскоп



Рис. 21. Ларингофарингоскоп



Рис. 22. Ларингофарингоскоп



Рис. 23. Ларингофарингоскоп

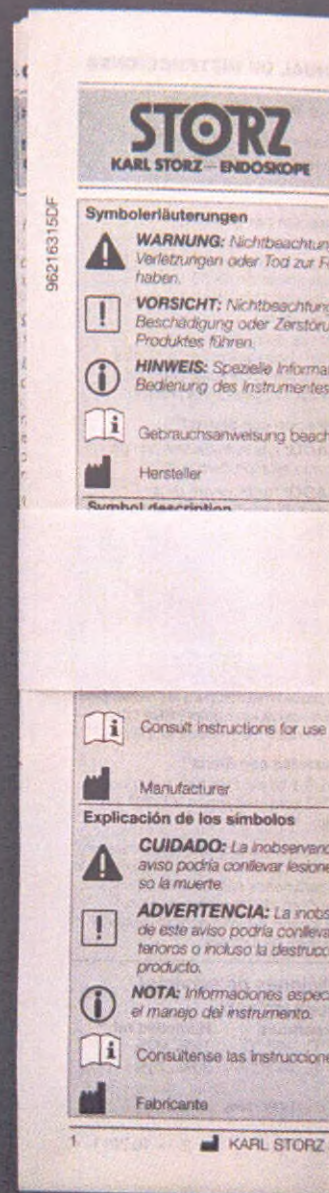


Рис. 24. Инструкция по эксплуатации. Конечный вид может быть изменен, содержание будет приведено в соответствии с документом в регистрационном досье.



Рис. 25. Ларингофарингоскоп жесткий HOPKINS для фотодинамической диагностики (PDD) с 4-кратным увеличением, направление наблюдения 90°, диаметр 10 мм, длина 15 см. Упаковка.

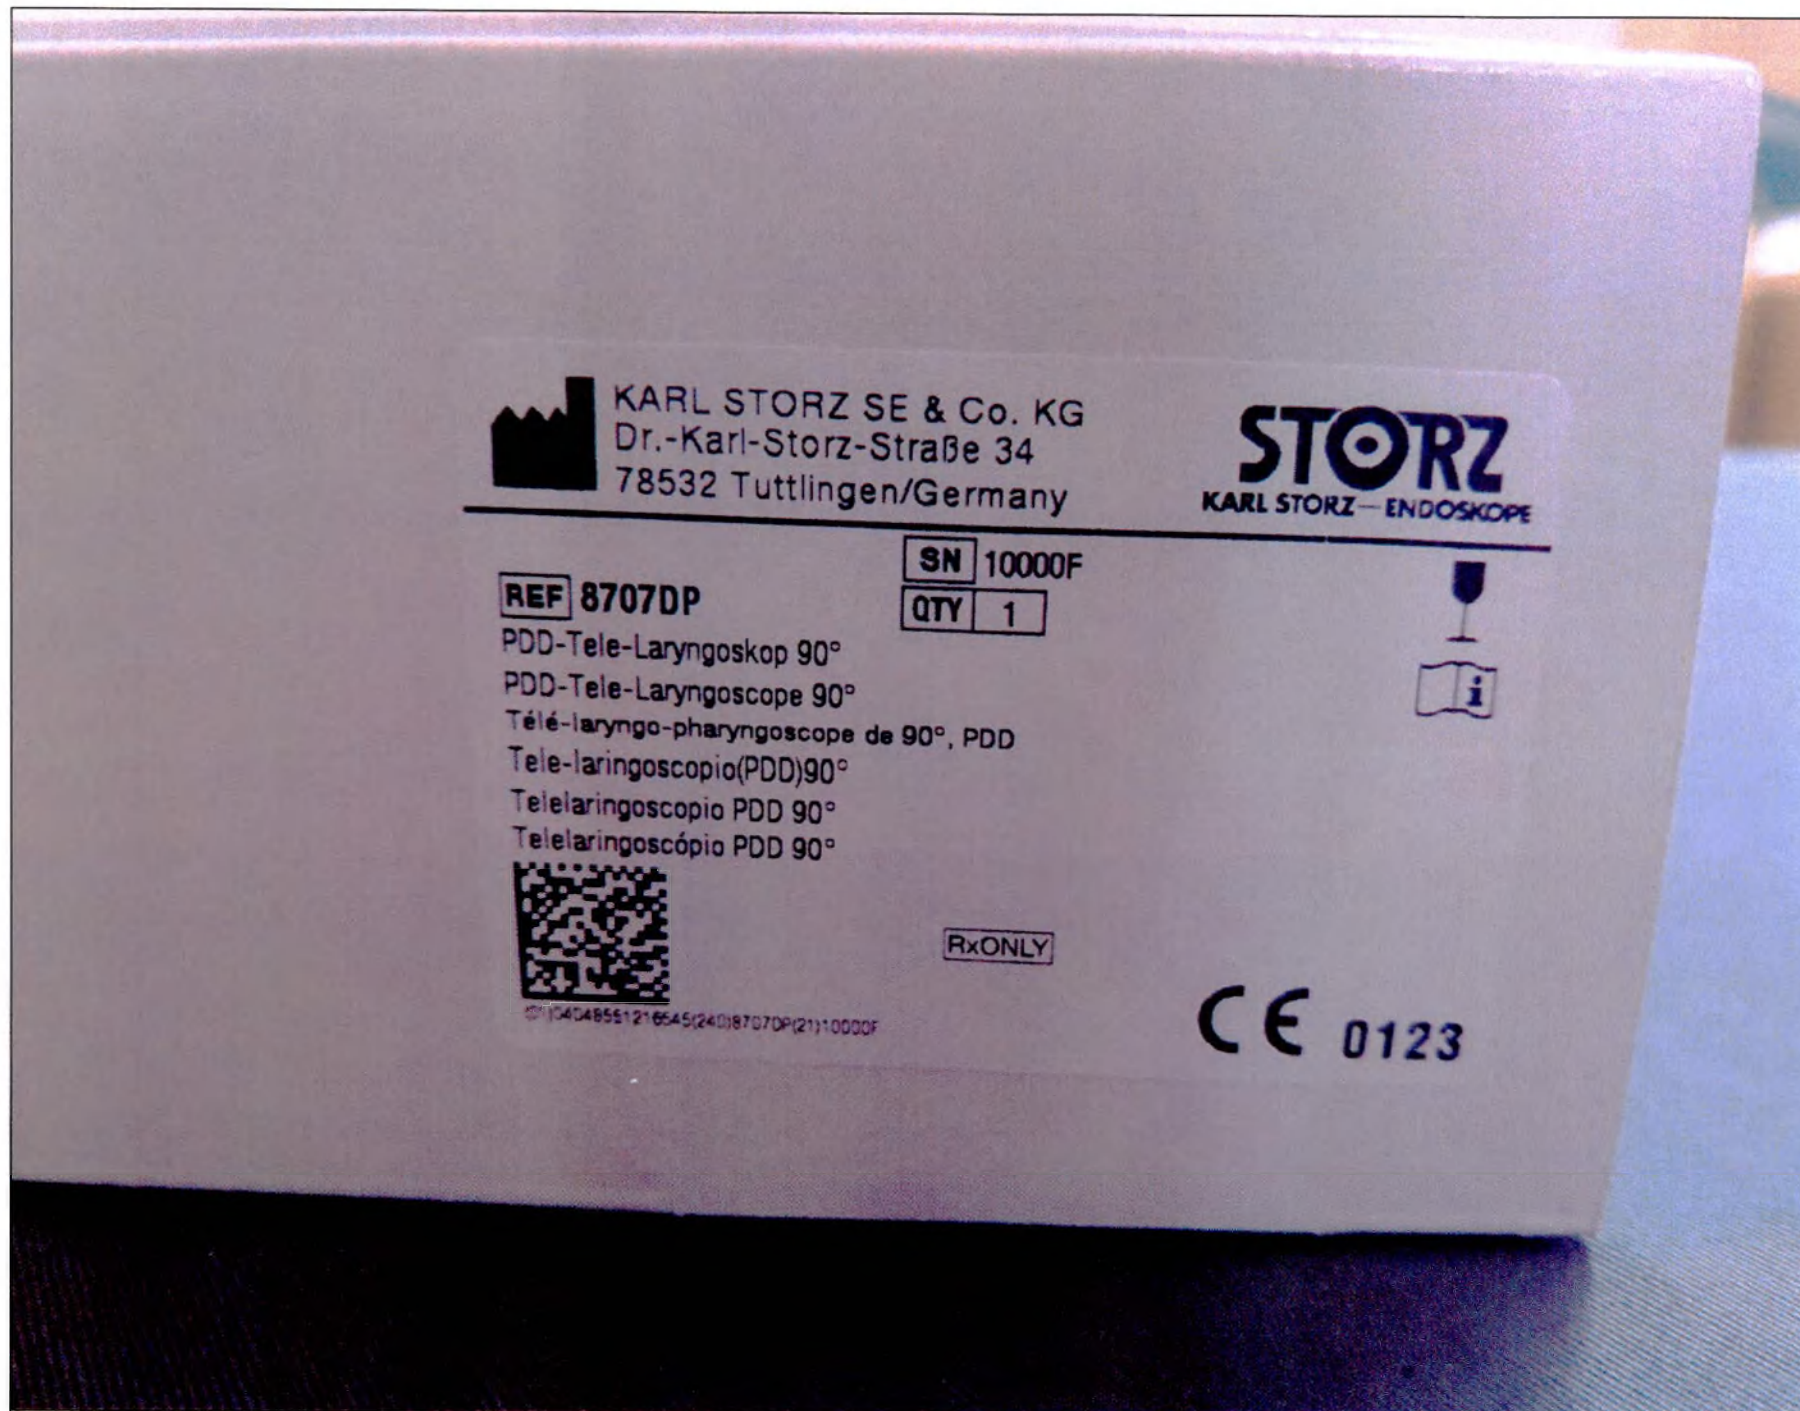


Рис. 26. Ларингофарингоскоп жесткий НОРКИНС для фотодинамической диагностики (PDD) с 4-кратным увеличением, направление наблюдения 90°, диаметр 10 мм, длина 15 см. Маркировка на упаковке.

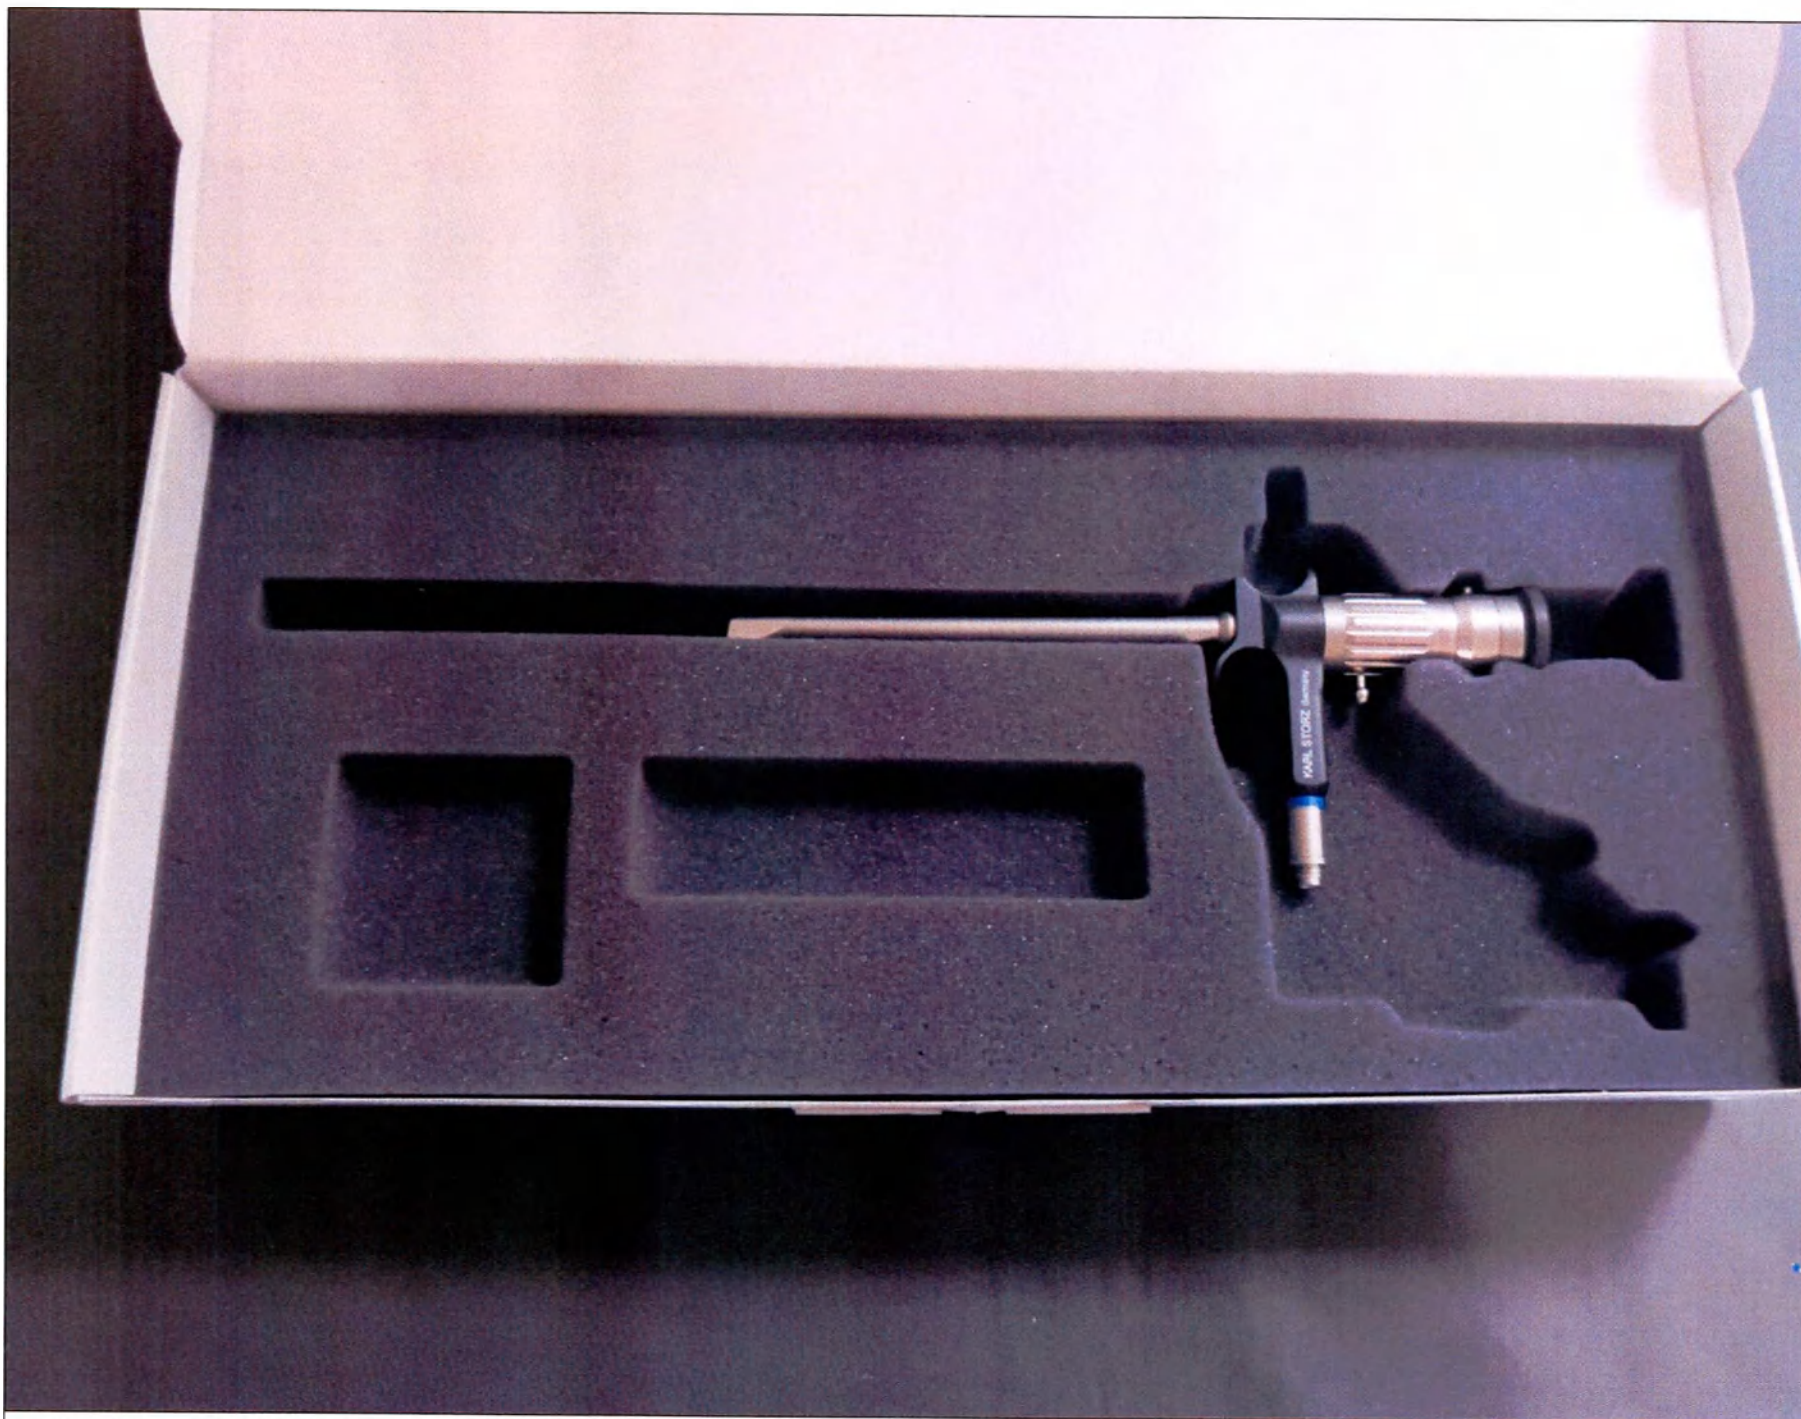


Рис. 27. Ларингофарингоскоп жесткий HOPKINS для фотодинамической диагностики (PDD) с 4-кратным увеличением, направление наблюдения 90°, диаметр 10 мм, длина 15 см.

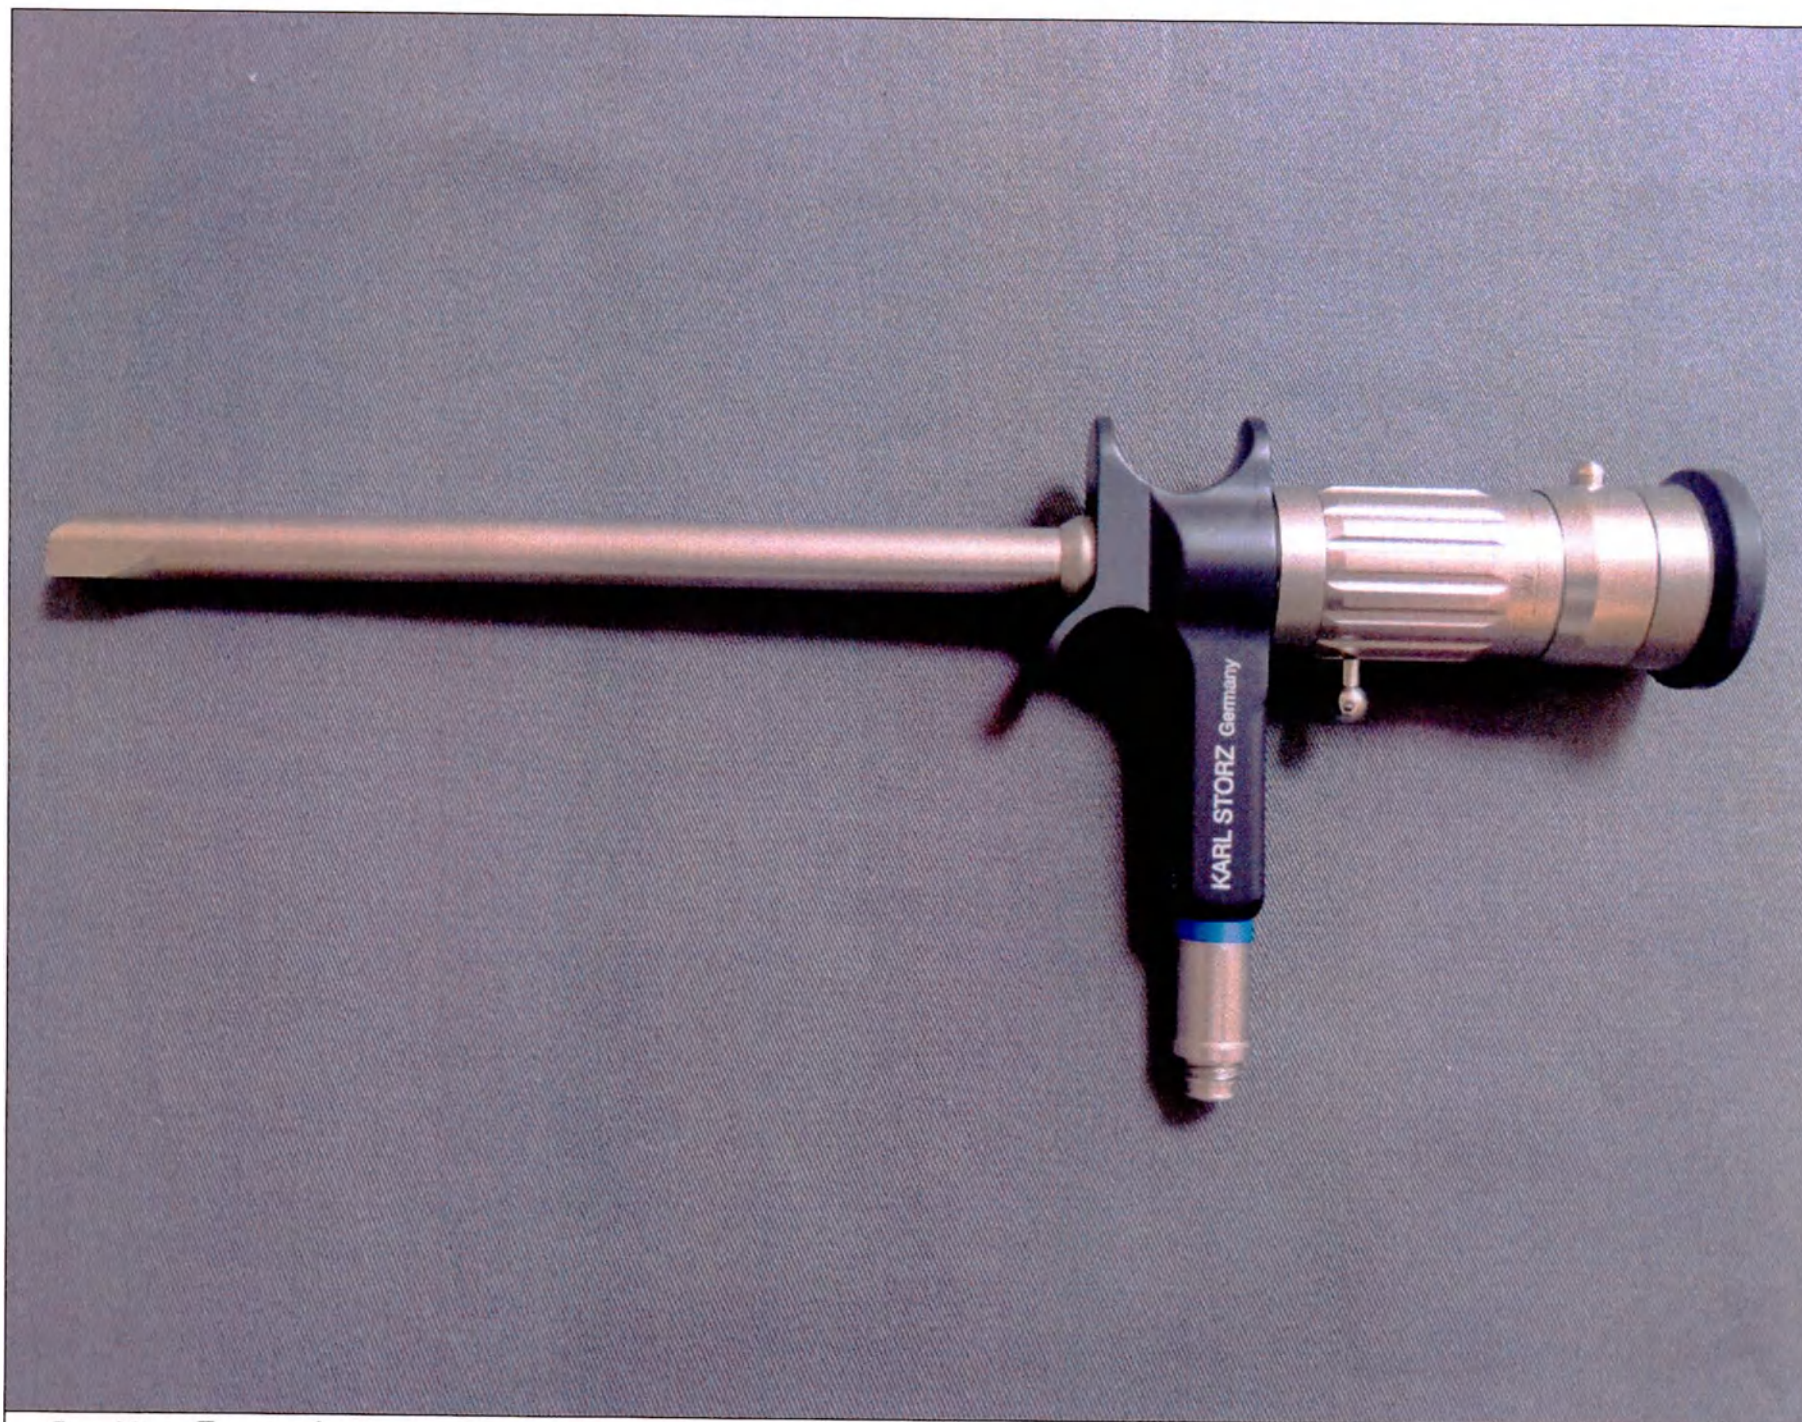


Рис. 28. Ларингофарингоскоп



Рис. 29. Ларингофарингоскоп

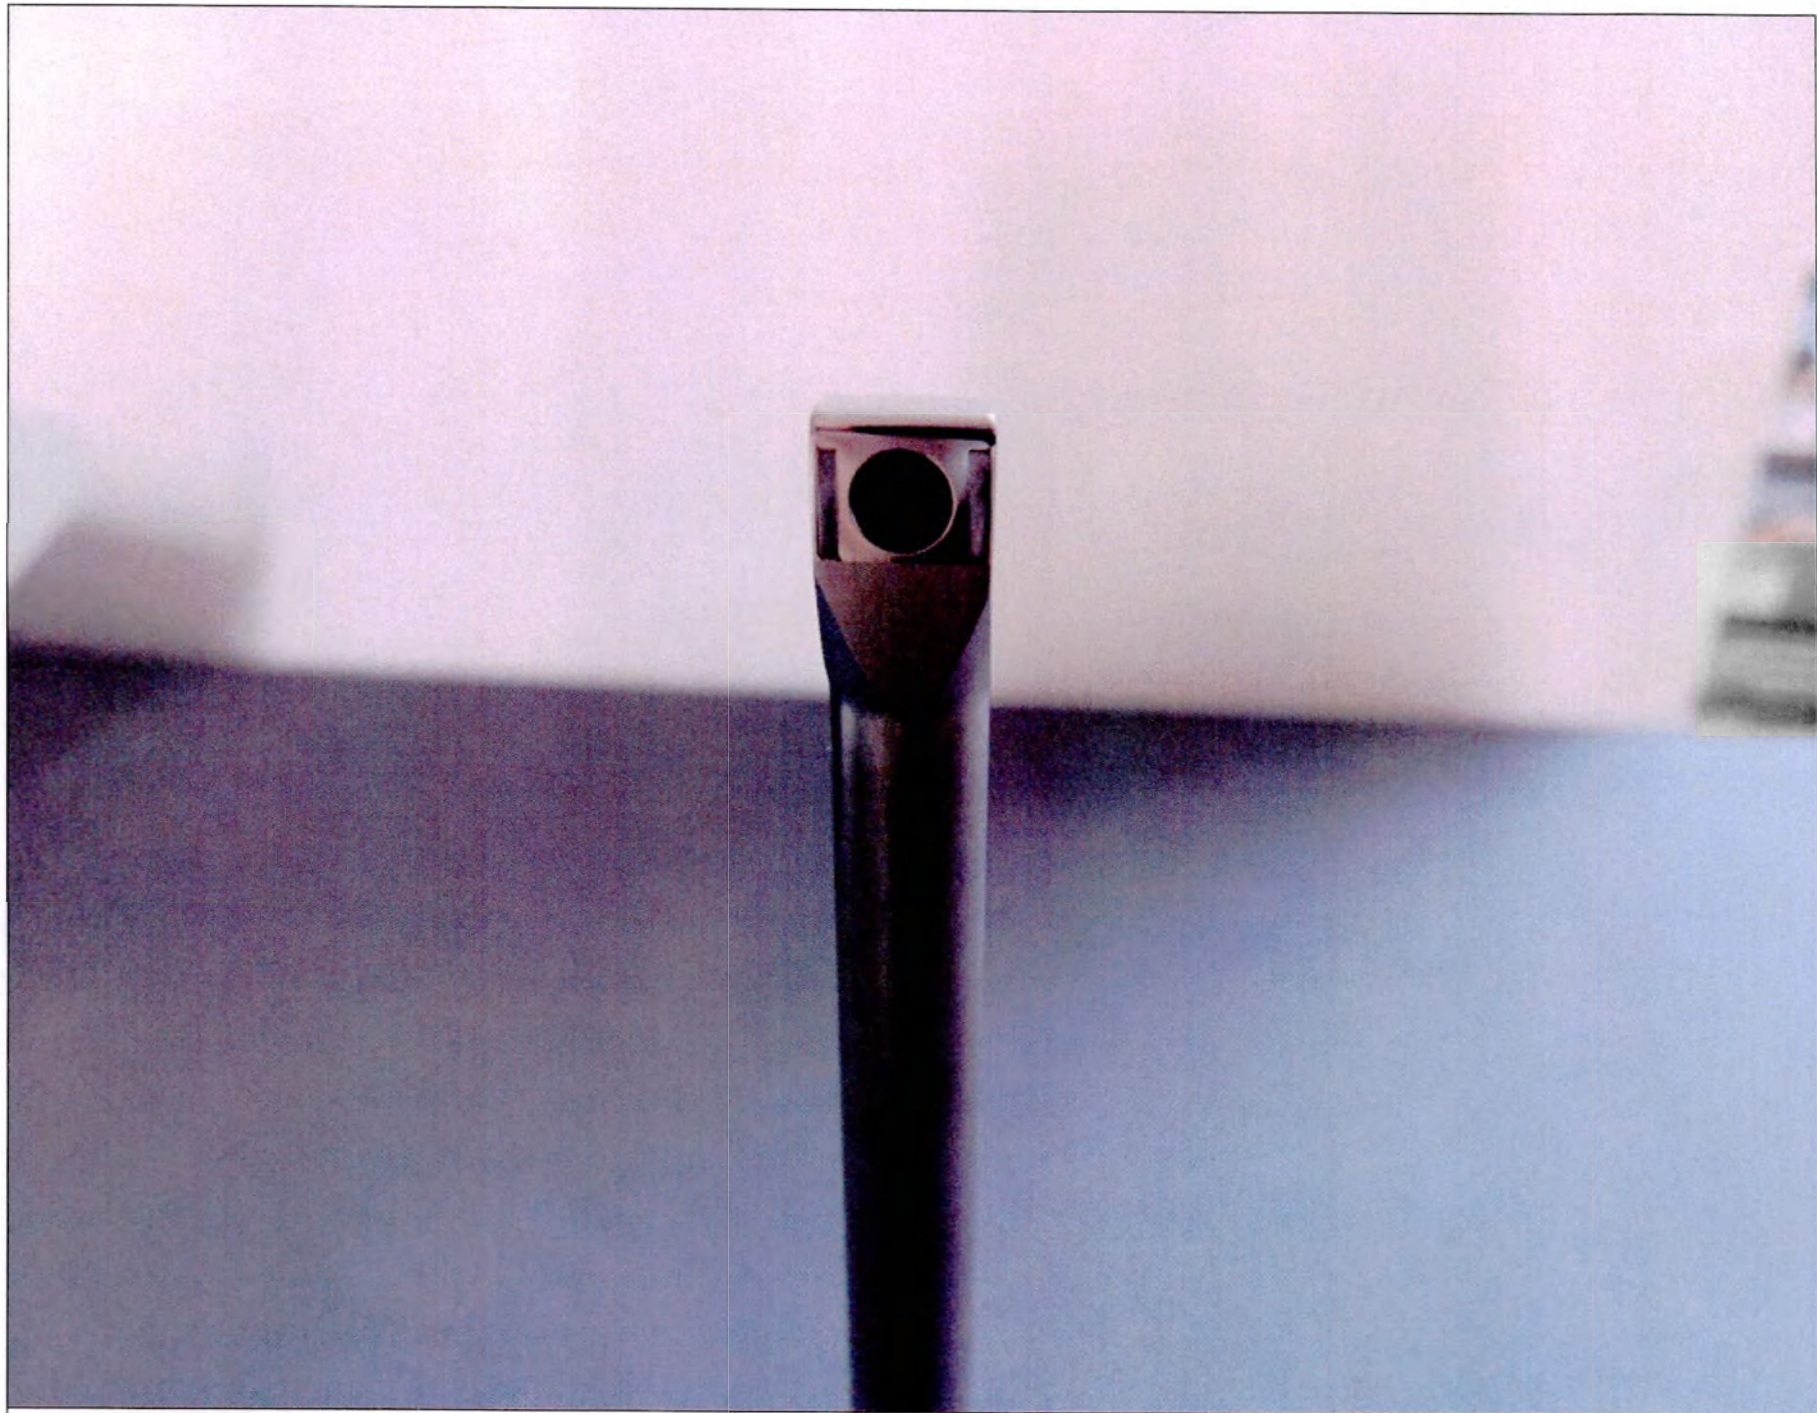


Рис. 30. Ларингофарингоскоп



Рис. 31. Ларингофарингоскоп

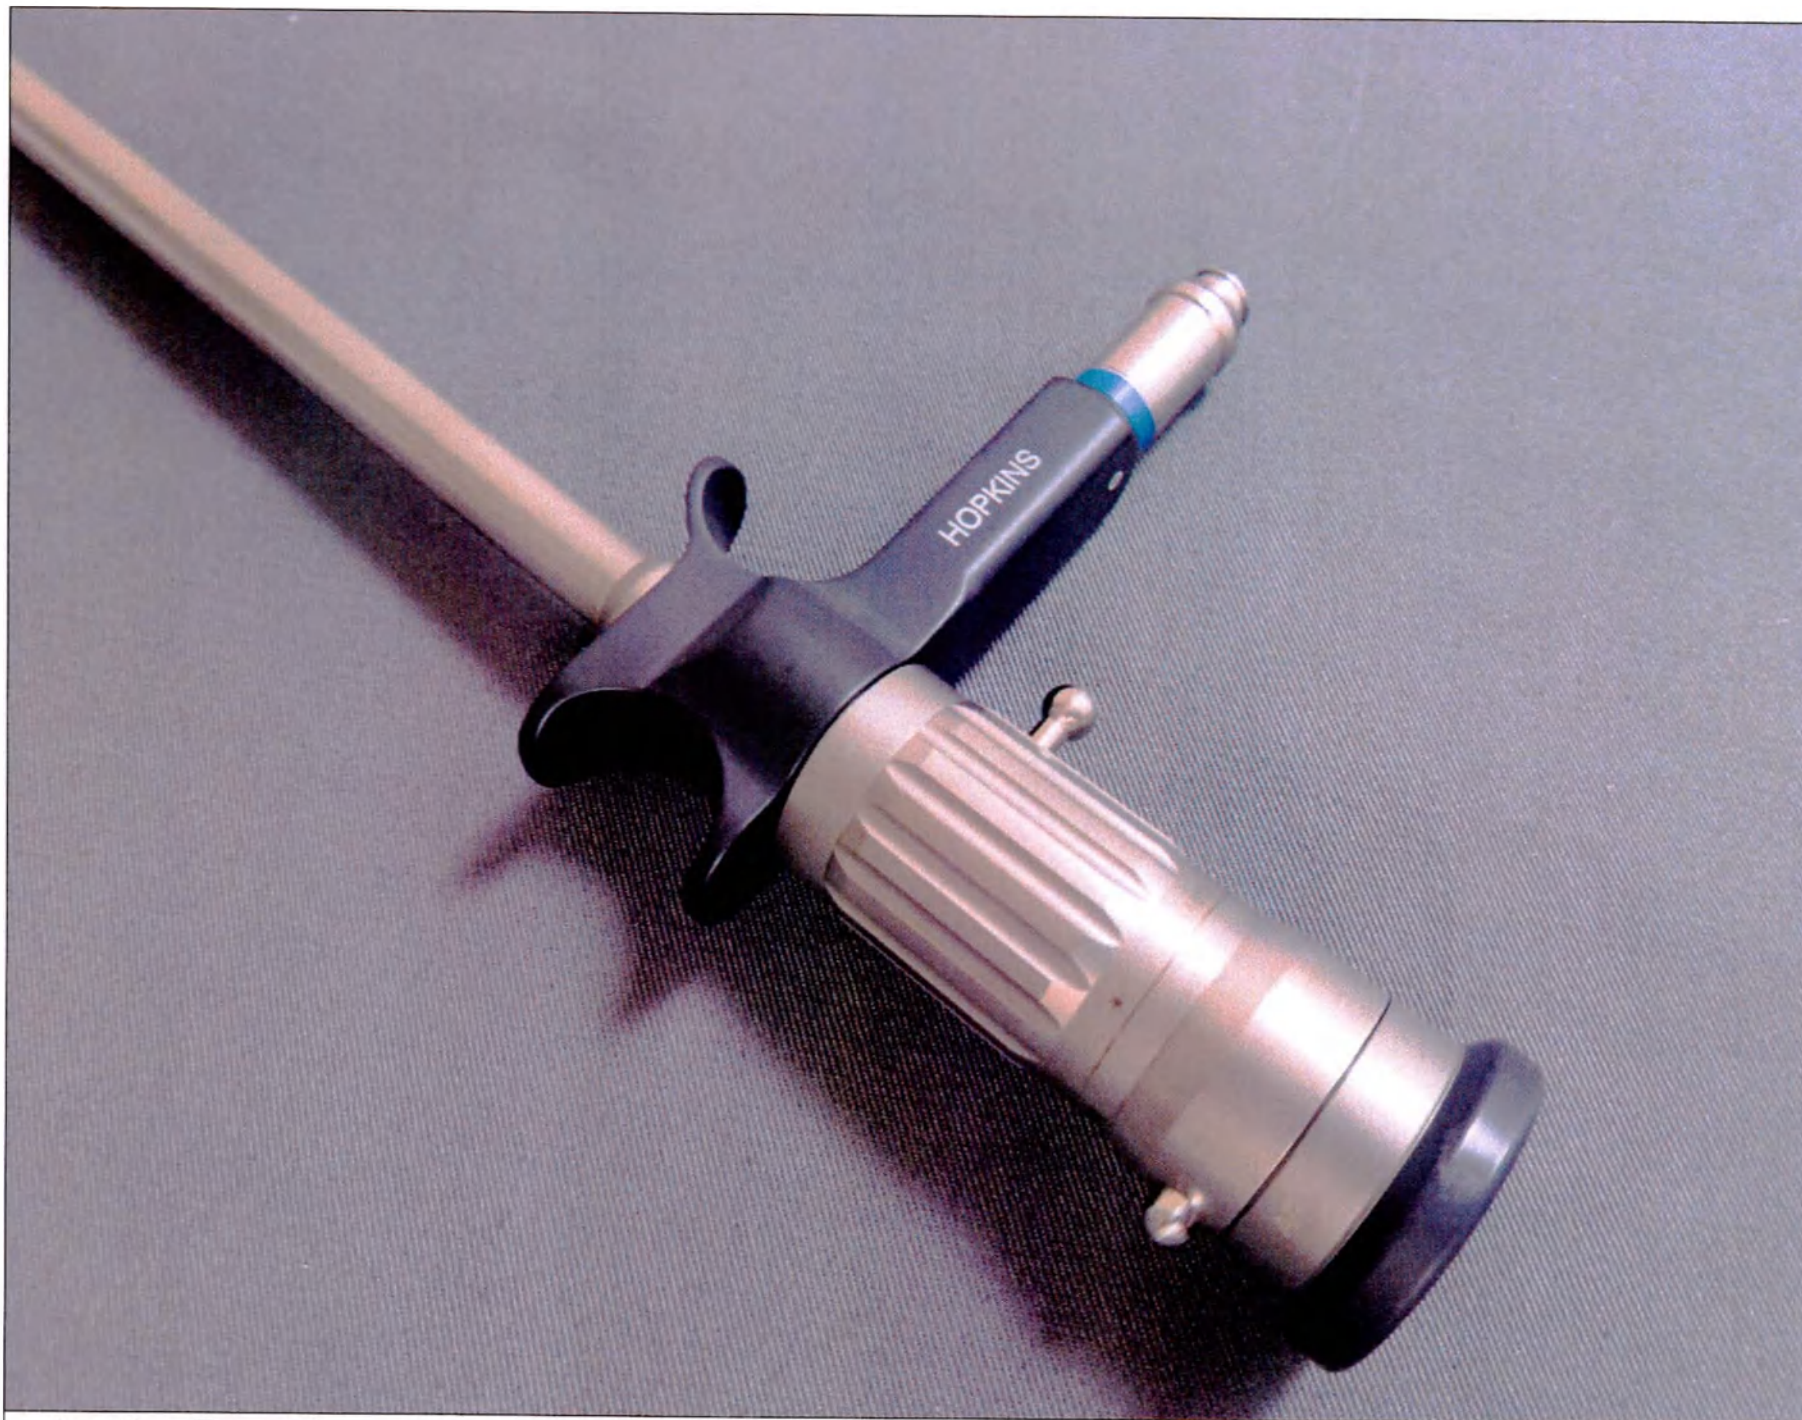


Рис. 32. Ларингофарингоскоп

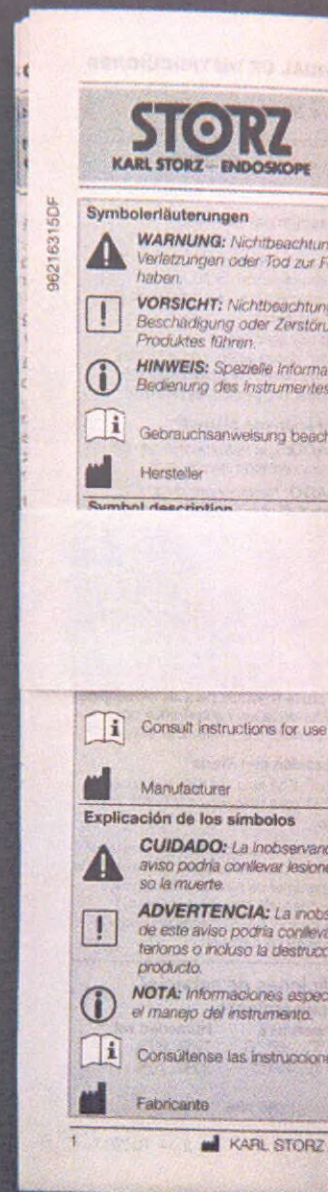


Рис. 33. Инструкция по эксплуатации. Конечный вид может быть изменен, содержание будет приведено в соответствие с документом в регистрационном досье.



**Рис. 34. Ларингофарингоскоп жесткий HOPKINS, типоразмер: направление наблюдения 0°, диаметр 5 мм, длина 29 см.
Упаковка.**

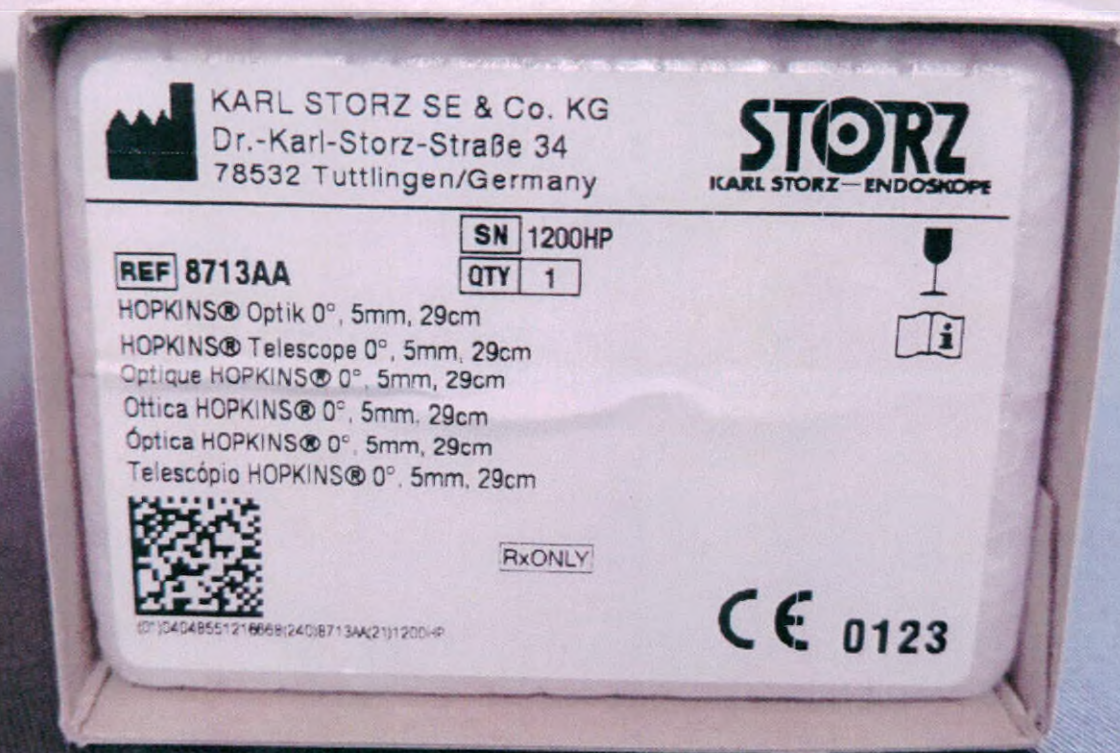


Рис. 35. Ларингофарингоскоп жесткий HOPKINS, типоразмер: направление наблюдения 0°, диаметр 5 мм, длина 29 см.
Маркировка на упаковке.



Рис. 36. Ларингофарингоскоп жесткий НОРКИНС, типоразмер: направление наблюдения 0°, диаметр 5 мм, длина 29 см.

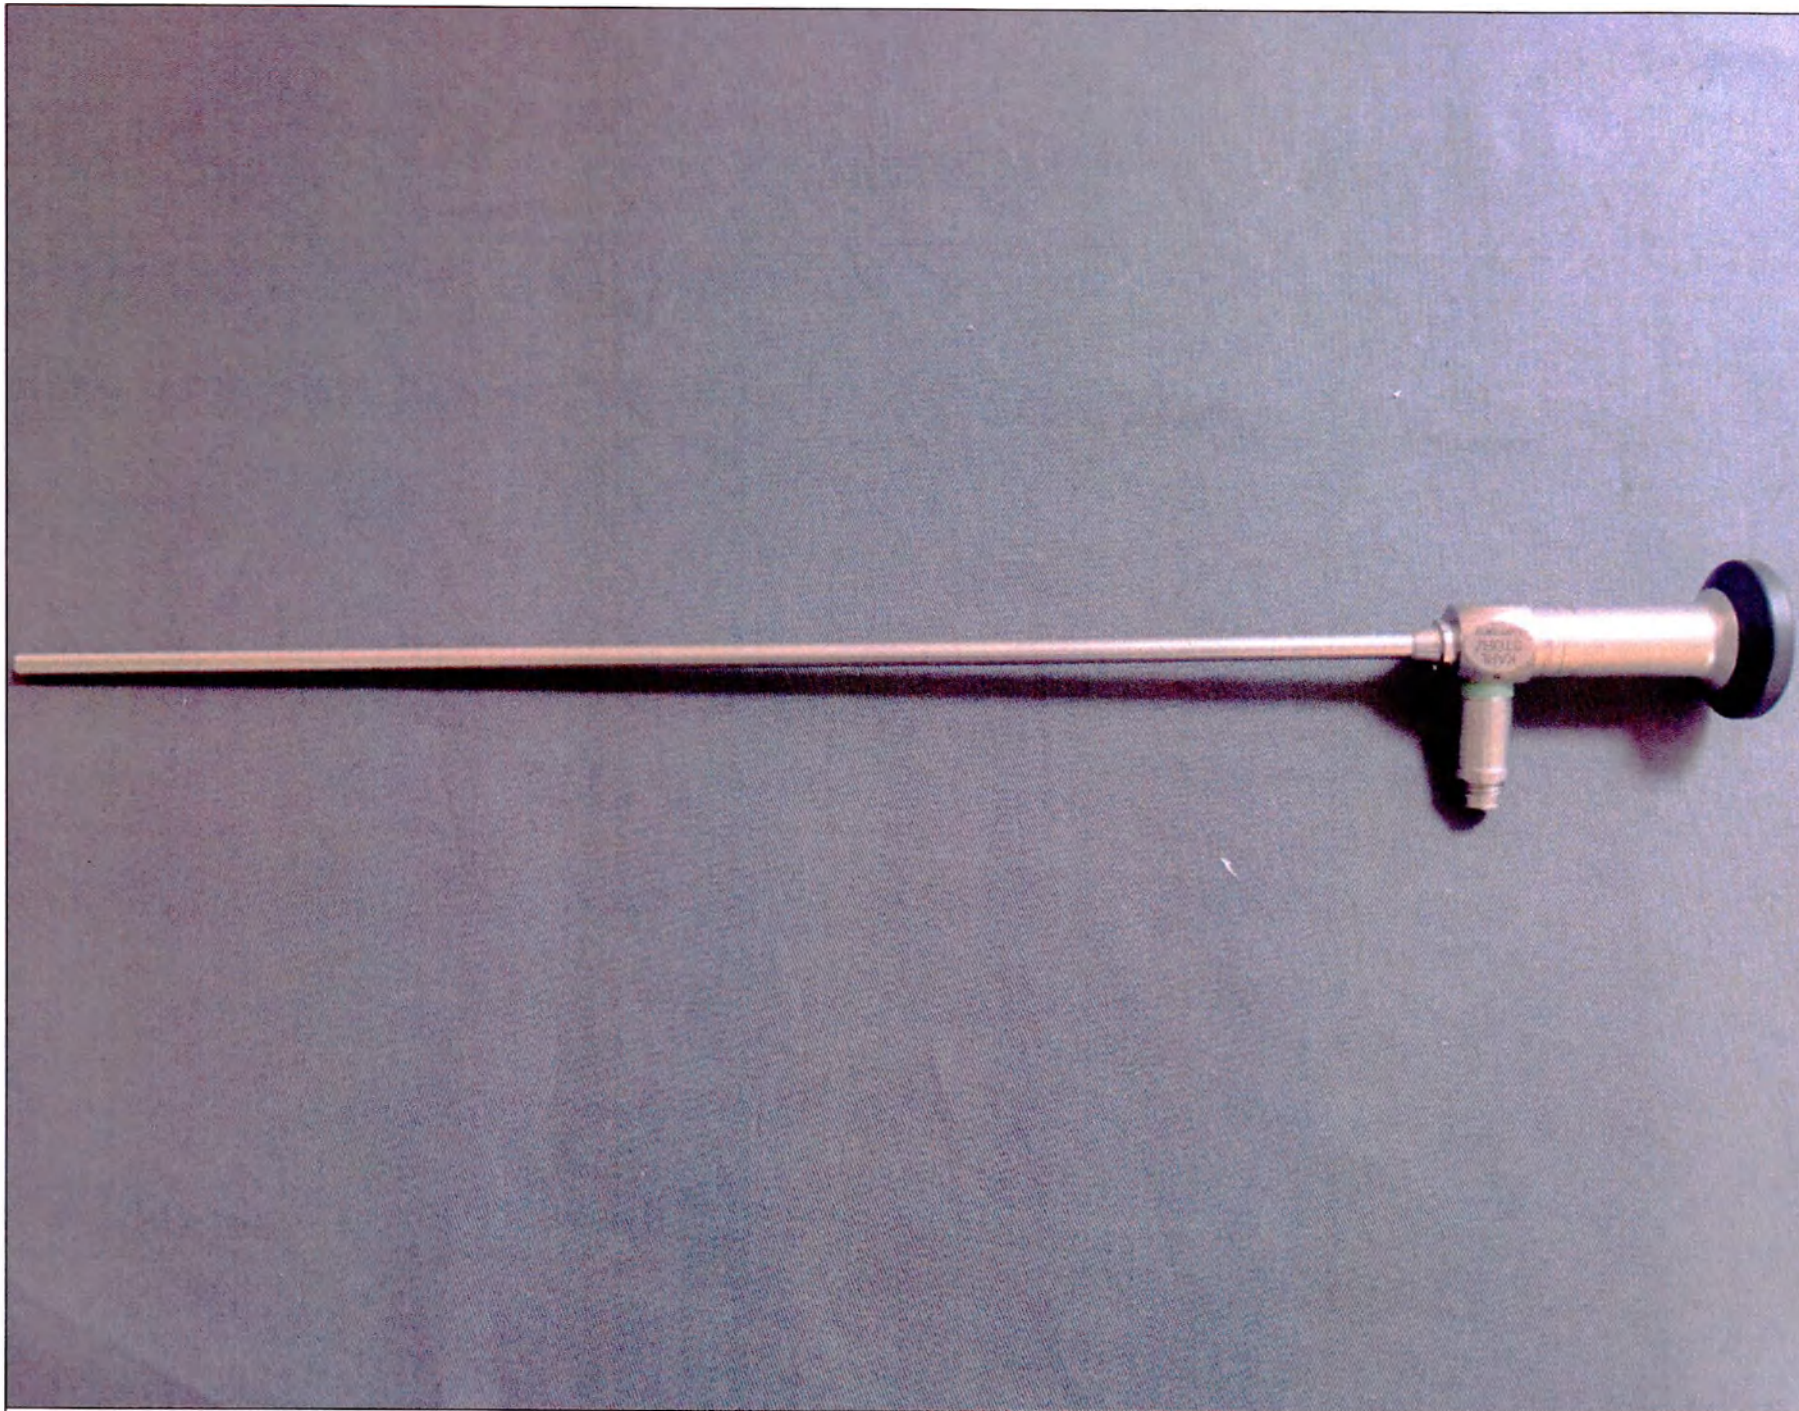


Рис. 37. Ларингофарингоскоп



Рис. 38. Ларингофарингоскоп



Рис. 39. Ларингофарингоскоп



Рис. 40. Ларингофарингоскоп.

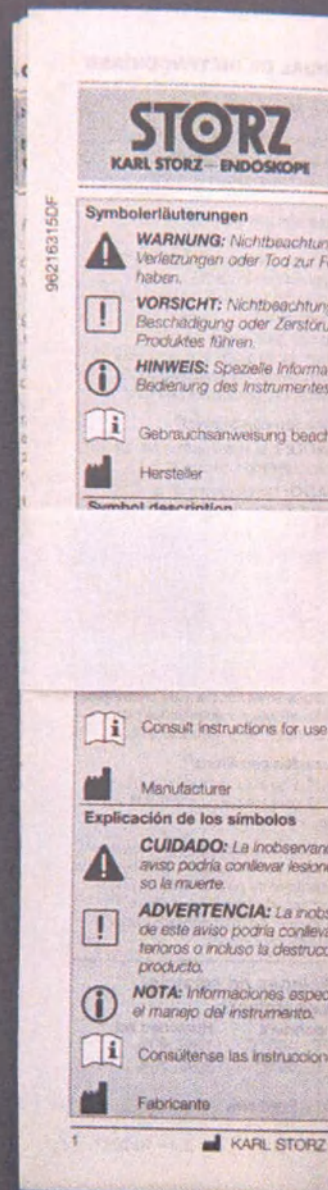


Рис. 41. Инструкция по эксплуатации. Конечный вид может быть изменен, содержание будет приведено в соответствие с документом в регистрационном досье.



Рис. 42. Ларингофарингоскоп жесткий HOPKINS для фотодинамической диагностики (PDD), типоразмер: направление наблюдения 70°, диаметр 5 мм, длина 24 см. Упаковка.



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ — ENDOSCOPE

REF 8712CP

SN 10000P

QTY 1

PDD HOPKINS® Optik 70°, 5mm, 24cm
PDD HOPKINS® Telescope 70°, 5mm, 24cm
PDD Optique HOPKINS® 70°, 5mm, 24cm
PDD Ottica HOPKINS® 70°, 5mm, 24cm
PDD Óptica HOPKINS® 70°, 5mm, 24cm
PDD Telescópio HOPKINS® 70°, 5mm, 24cm



RxONLY

CE 0123

0104048551216544(240)8712CP(21)10000P



Рис. 43. Ларингофарингоскоп жесткий HOPKINS для фотодинамической диагностики (PDD), типоразмер: направление наблюдения 70°, диаметр 5 мм, длина 24 см. Маркировка на упаковке.



Рис. 44. Ларингофарингоскоп жесткий HOPKINS для фотодинамической диагностики (PDD), типоразмер: направление наблюдения 70°, диаметр 5 мм, длина 24 см.

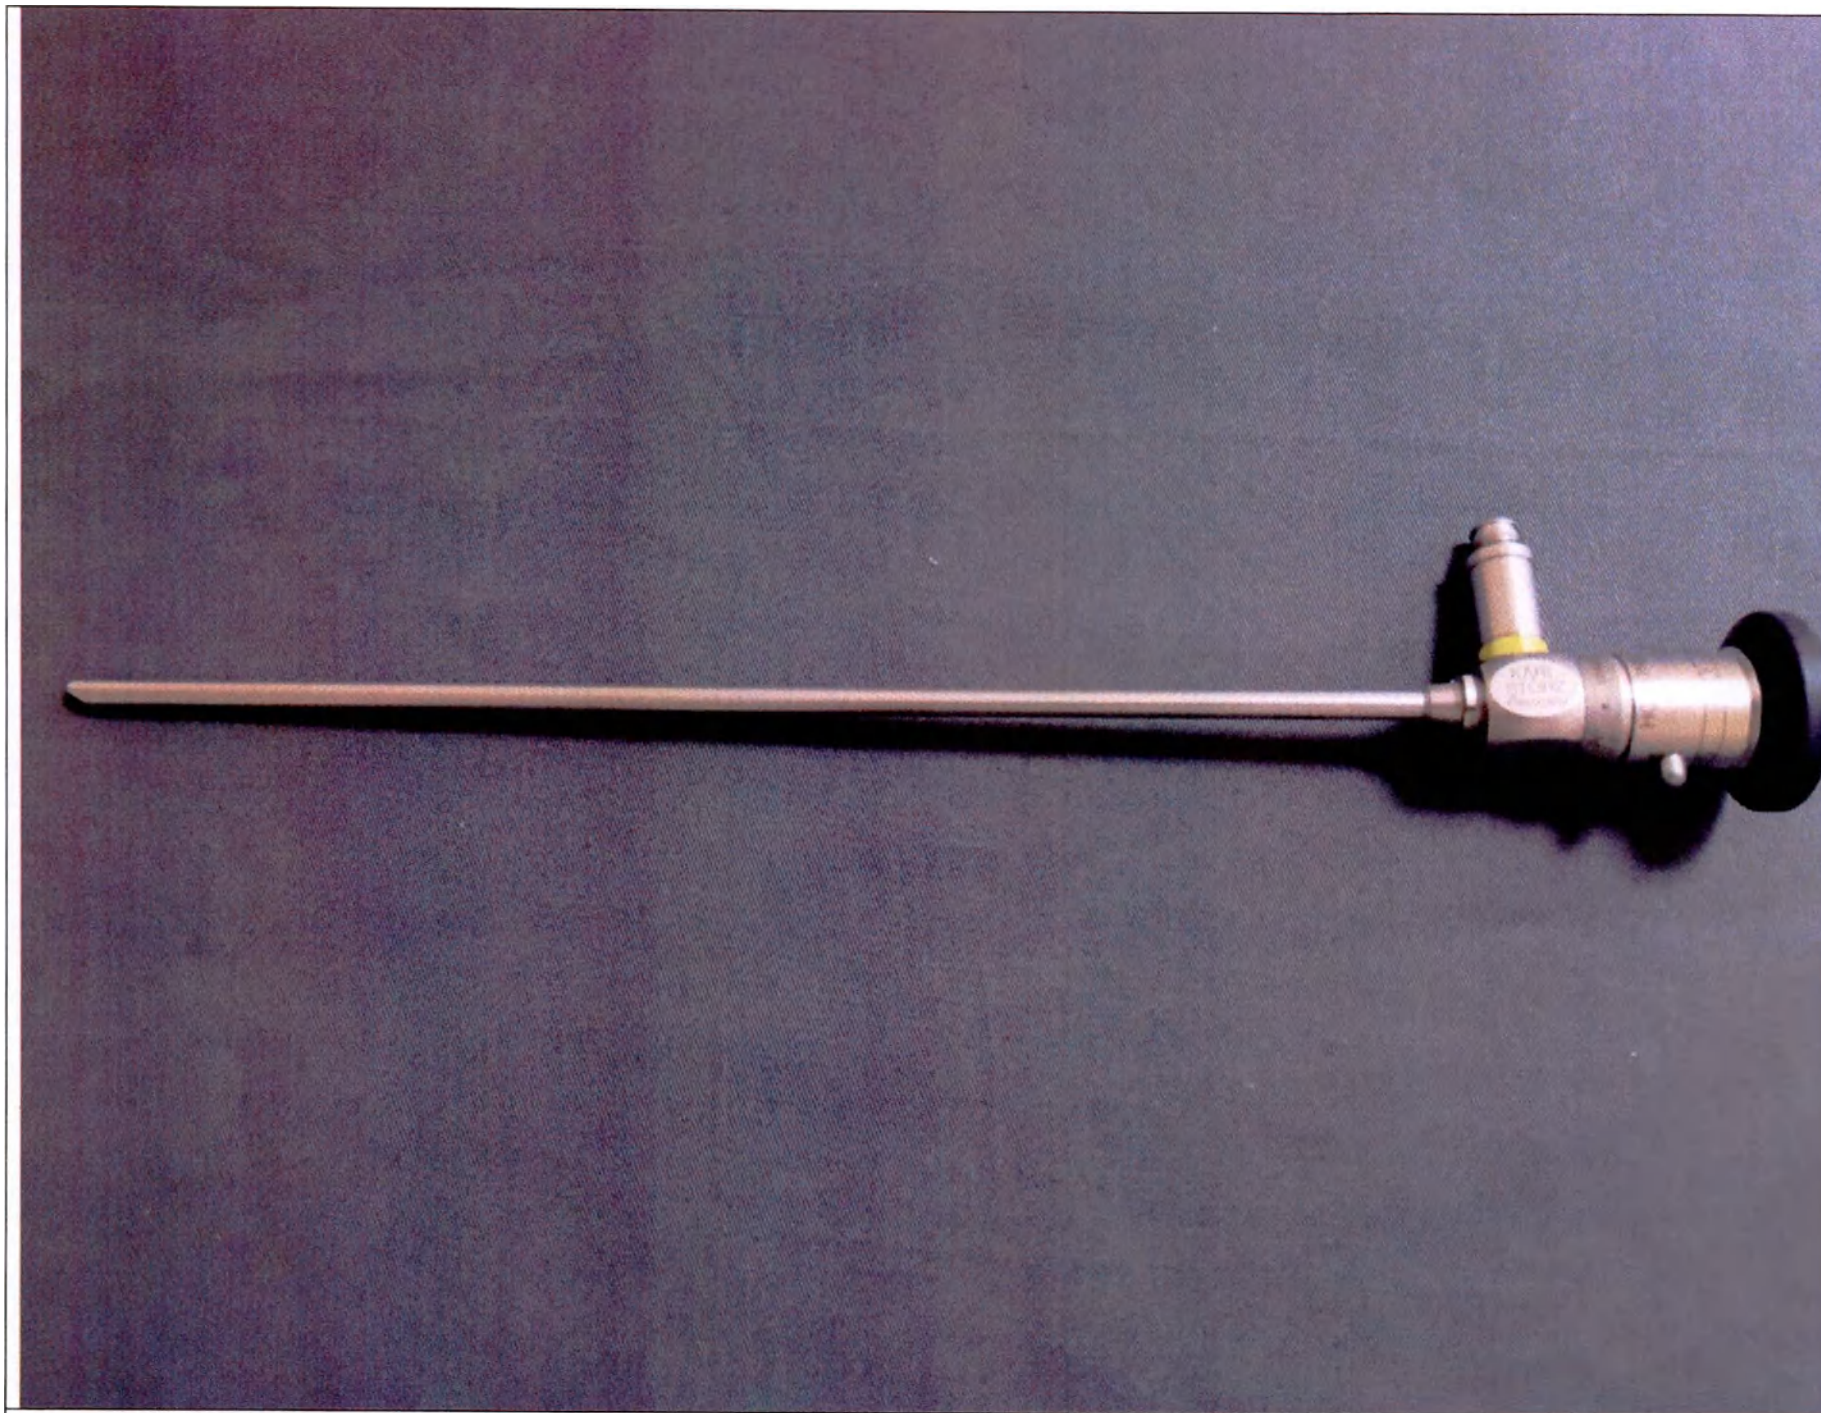


Рис. 45. Ларингофарингоскоп

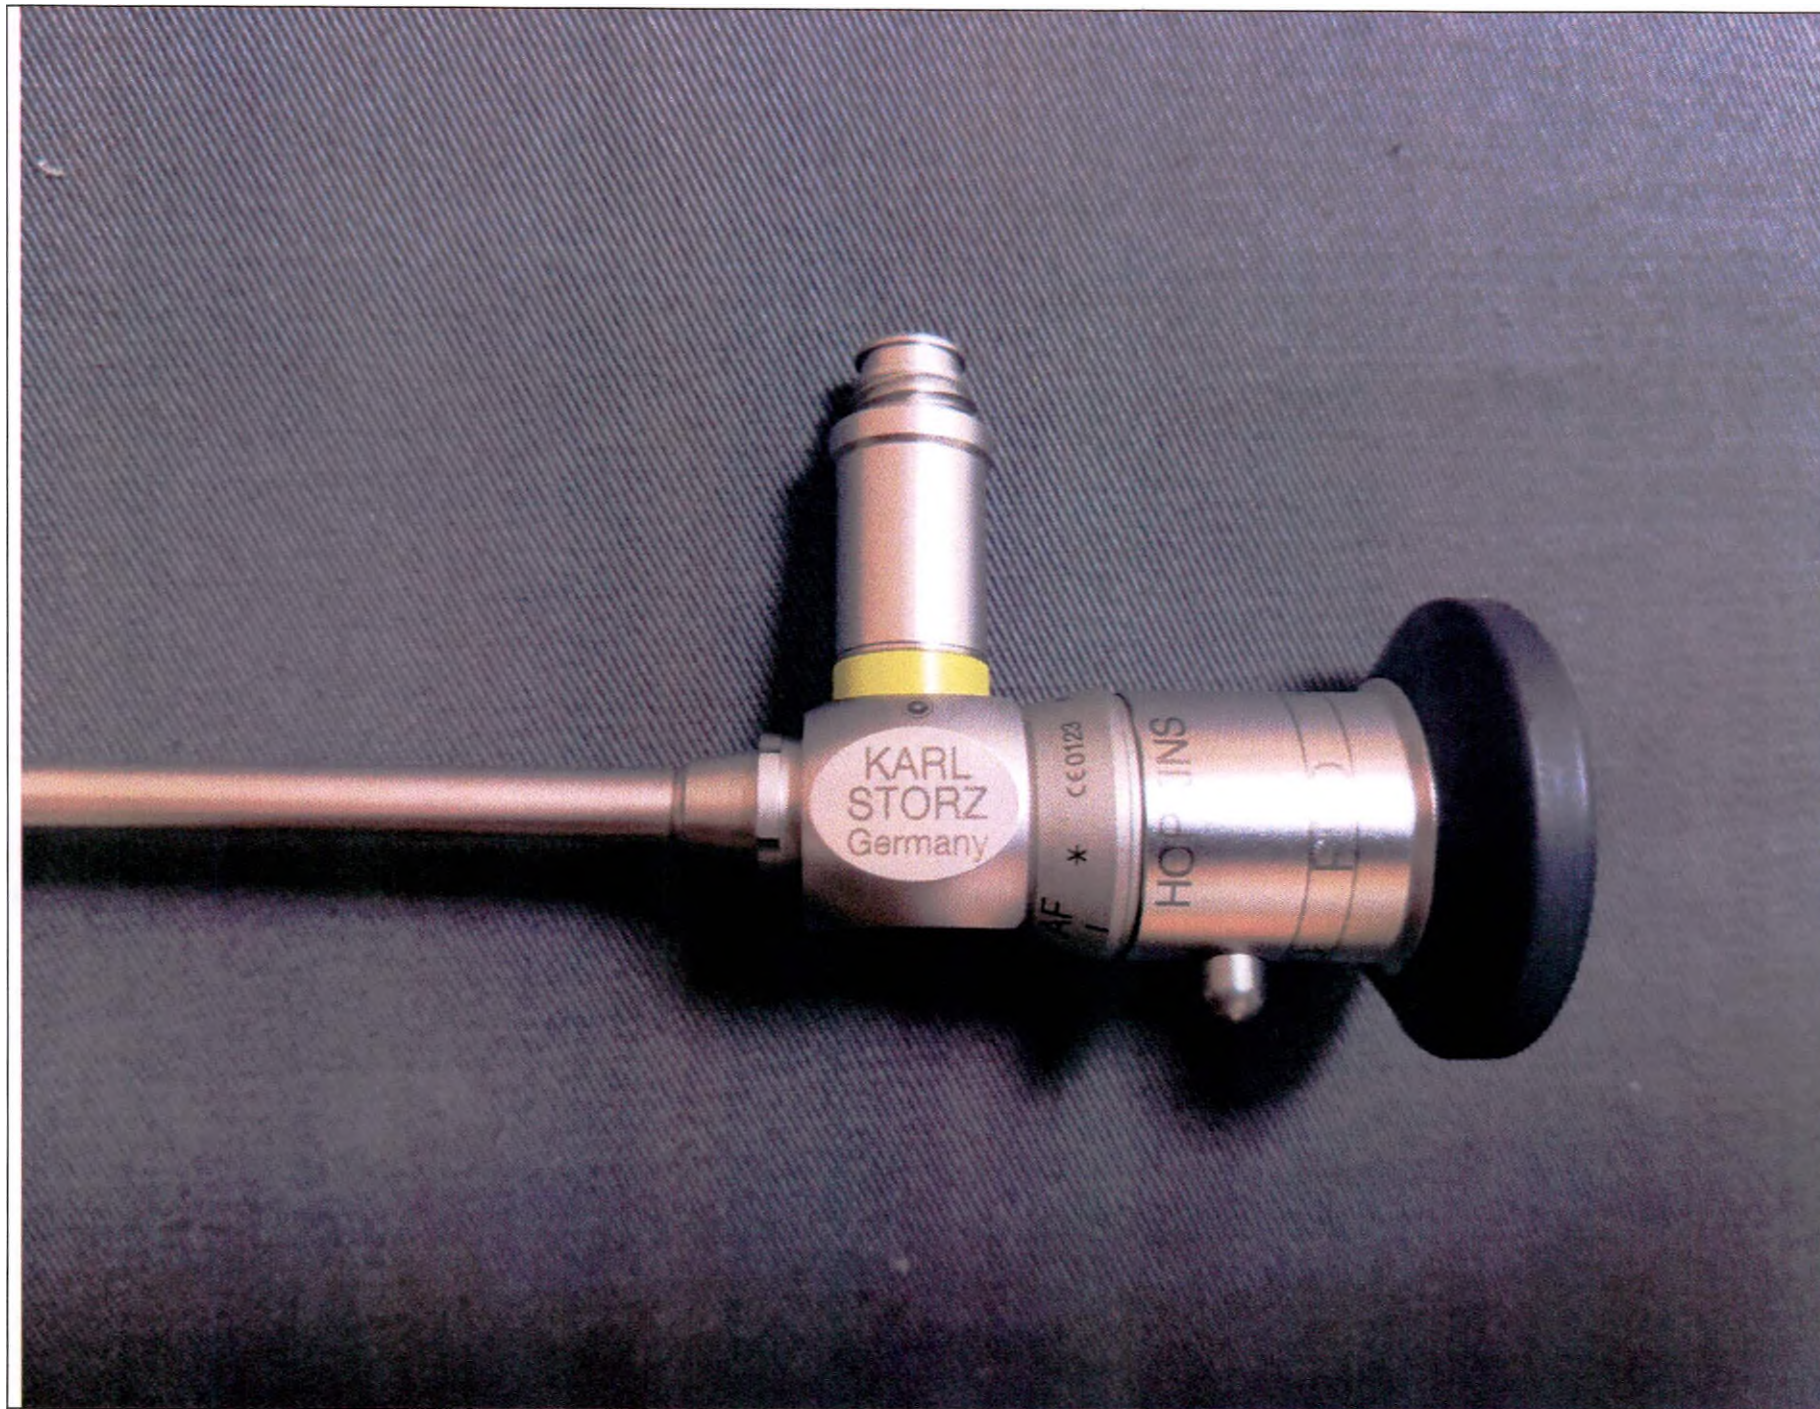


Рис. 46. Ларингофарингоскоп



Рис. 47. Ларингофарингоскоп

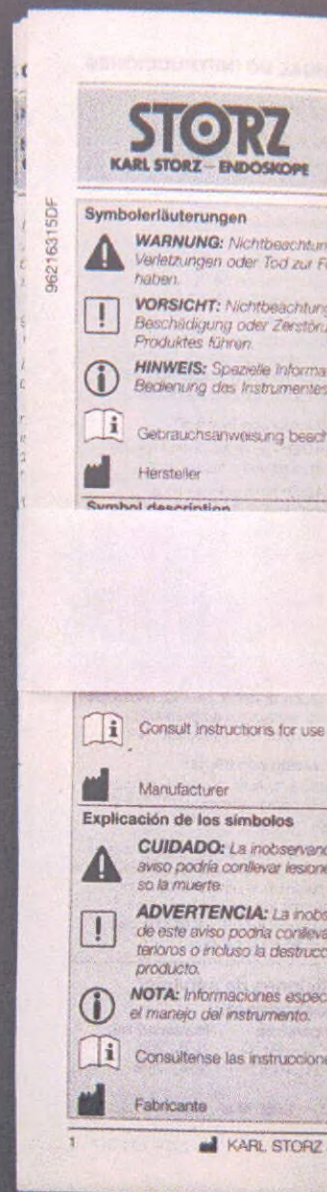


Рис. 48. Инструкция по эксплуатации. Конечный вид может быть изменен, содержание будет приведено в соответствие с документом в регистрационном досье.



Рис. 49. Ларингофарингоскоп жесткий HOPKINS с регулируемым увеличением, типоразмер: направление наблюдения 30°, диаметр 5,5 мм, длина 23 см. Упаковка.



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany


STORZ
KARL STORZ – ENDOSKOPE

REF 8715BA

SN 4156811

QTY 1

Kontakt-Mikro-Laryngoskop, 30°
Contact-Micro-Laryngoscope 30°
Micro-laryngoscope de contact de 30°
Micro-laringoscopio a contatto, 30°
Laringoscopio de contacto, 30°
Laringoscópio de contato 30°



RxONLY

001040485512167120240187159A214156811

CE 0123

Рис. 50. Ларингофарингоскоп жесткий HOPKINS с регулируемым увеличением, типоразмер: направление наблюдения 30°, диаметр 5,5 мм, длина 23 см. Маркировка на упаковке.



Рис. 51. Ларингофарингоскоп жесткий HOPKINS с регулируемым увеличением, типоразмер: направление наблюдения 30°, диаметр 5,5 мм, длина 23 см

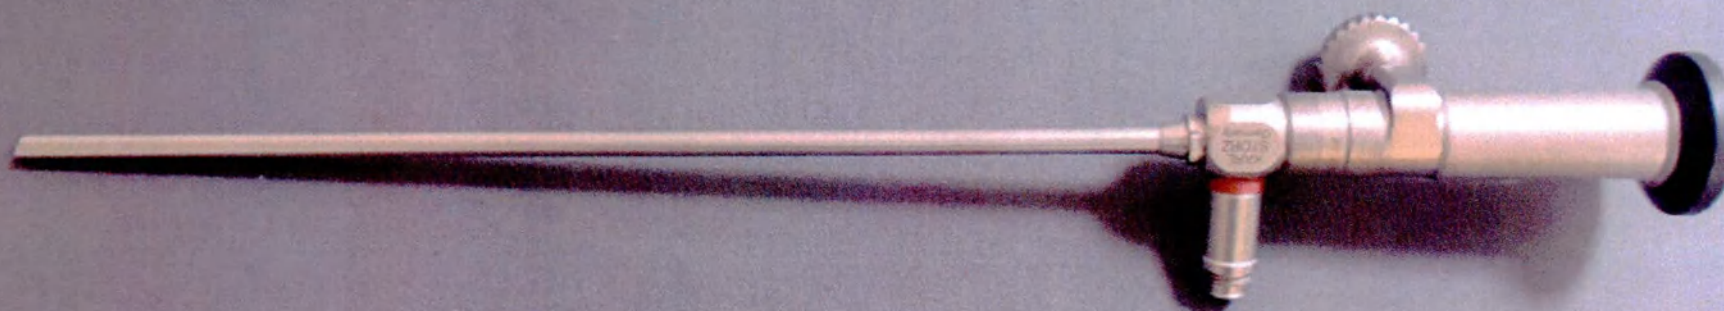


Рис. 52. Ларингофарингоскоп

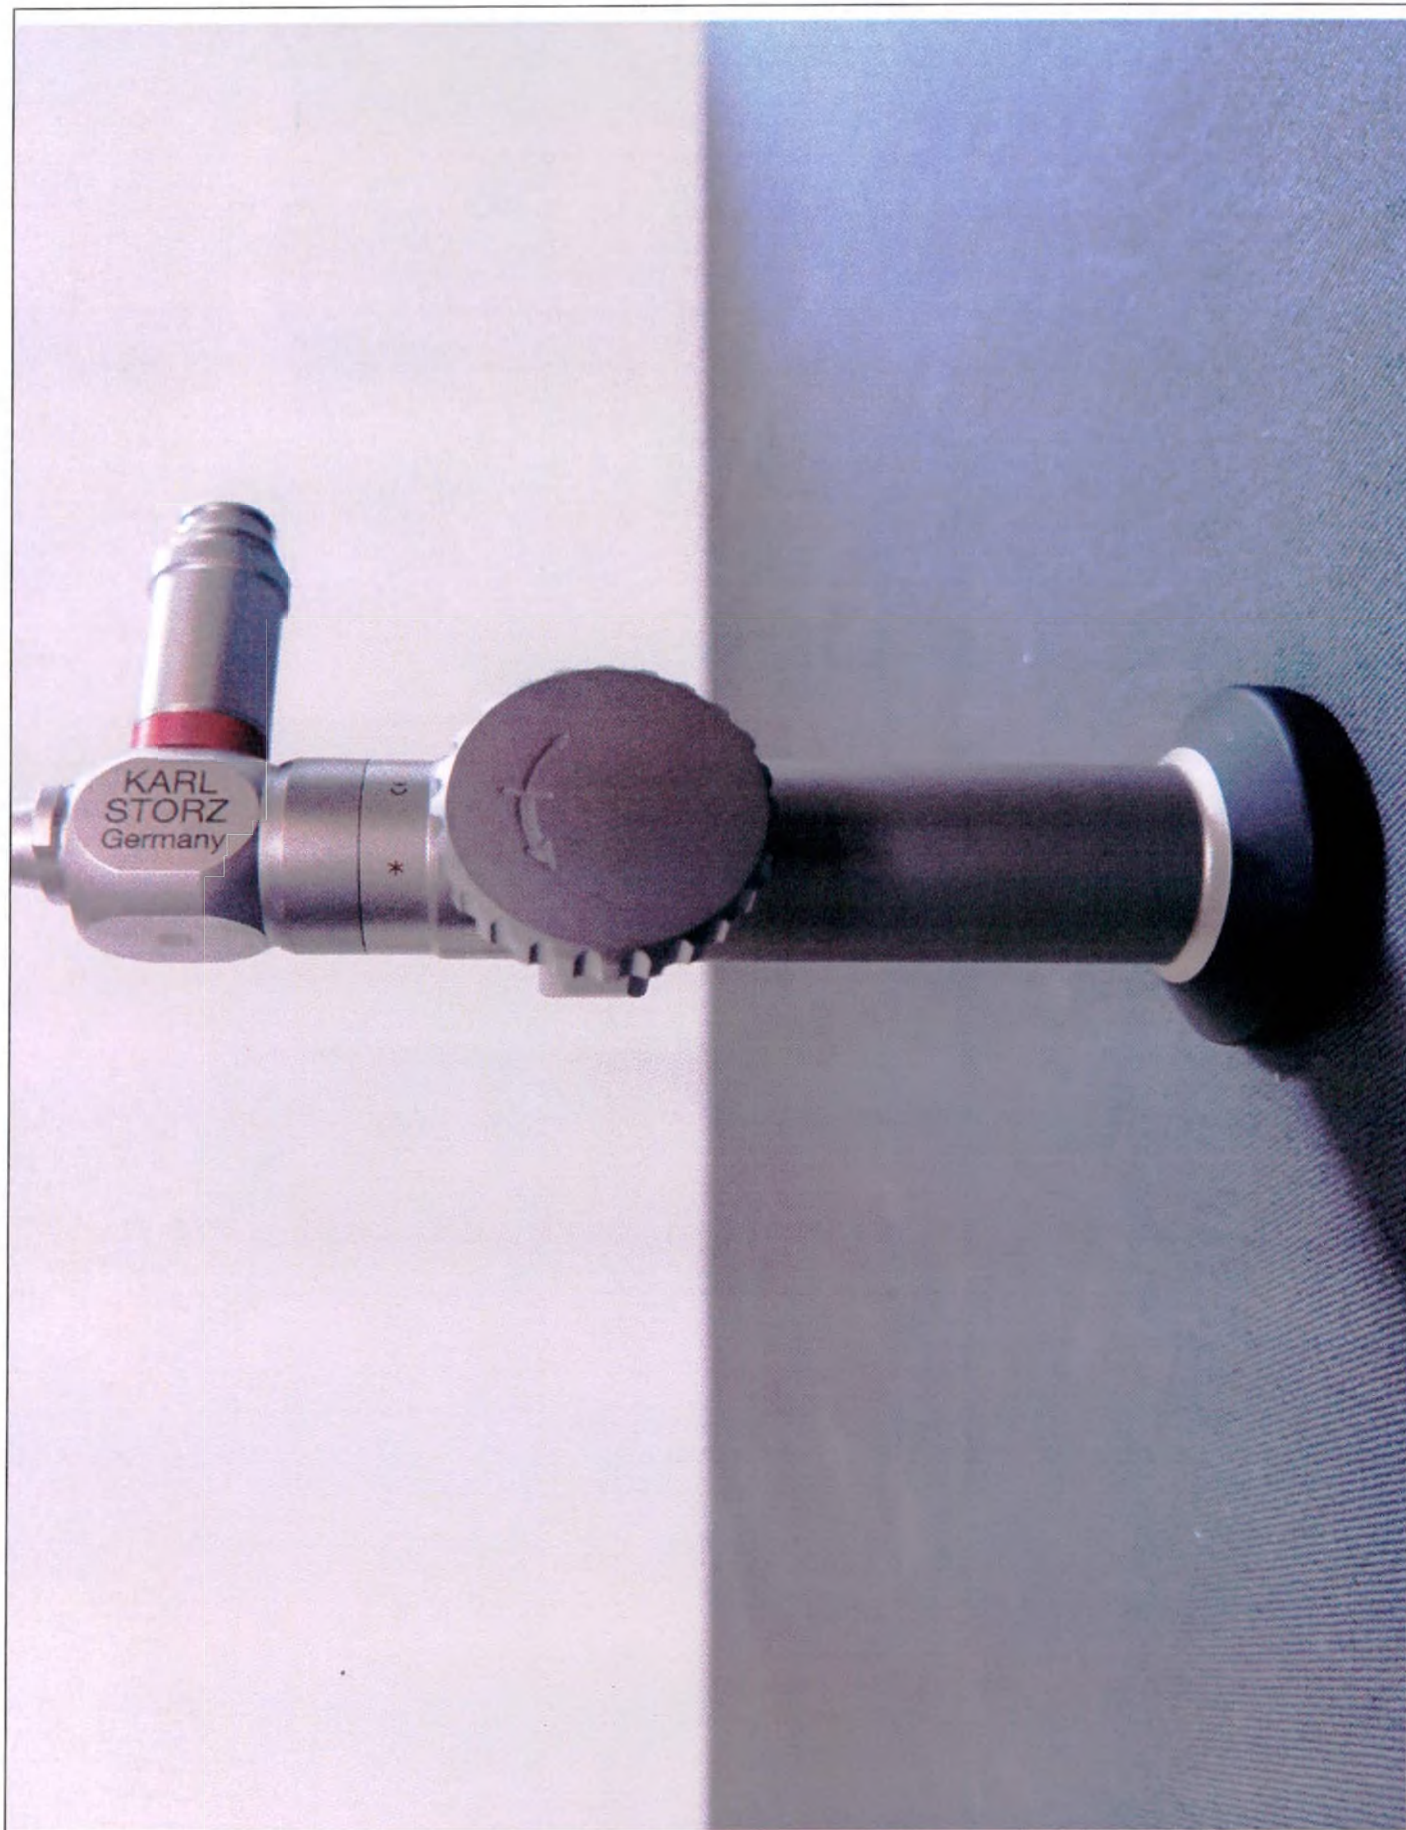


Рис. 53. Ларингофарингоскоп



Рис. 54. Ларингофарингоскоп



Рис. 55. Ларингофарингоскоп

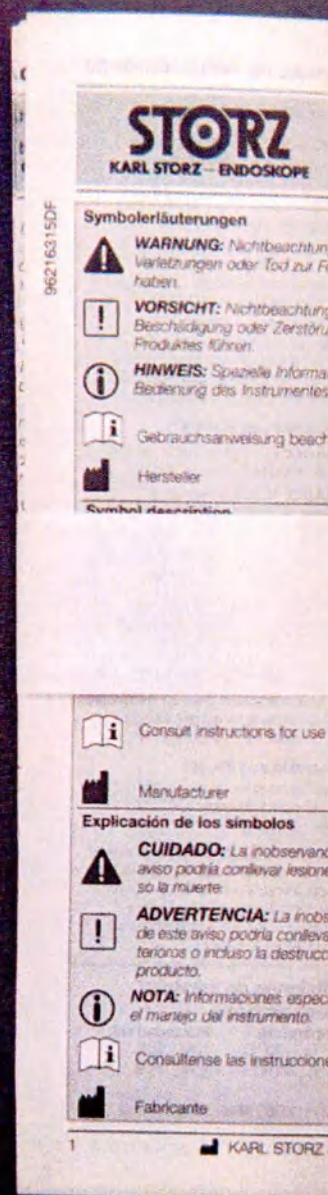


Рис. 56. Инструкция по эксплуатации. Конечный вид может быть изменен, содержание будет приведено в соответствие с документом в регистрационном досье.



Рис. 57. Ларингофарингоскоп жесткий HOPKINS для аутофлуоресцентной диагностики и диагностики в белом цвете (ICG), типоразмер: направление наблюдения 0°, диаметр 10 мм, длина 20 см. Упаковка.



Рис. 58. Ларингофарингоскоп жесткий HOPKINS для аутофлуоресцентной диагностики и диагностики в белом цвете (ICG), типоразмер: направление наблюдения 0°, диаметр 10 мм, длина 20 см. Маркировка на упаковке.

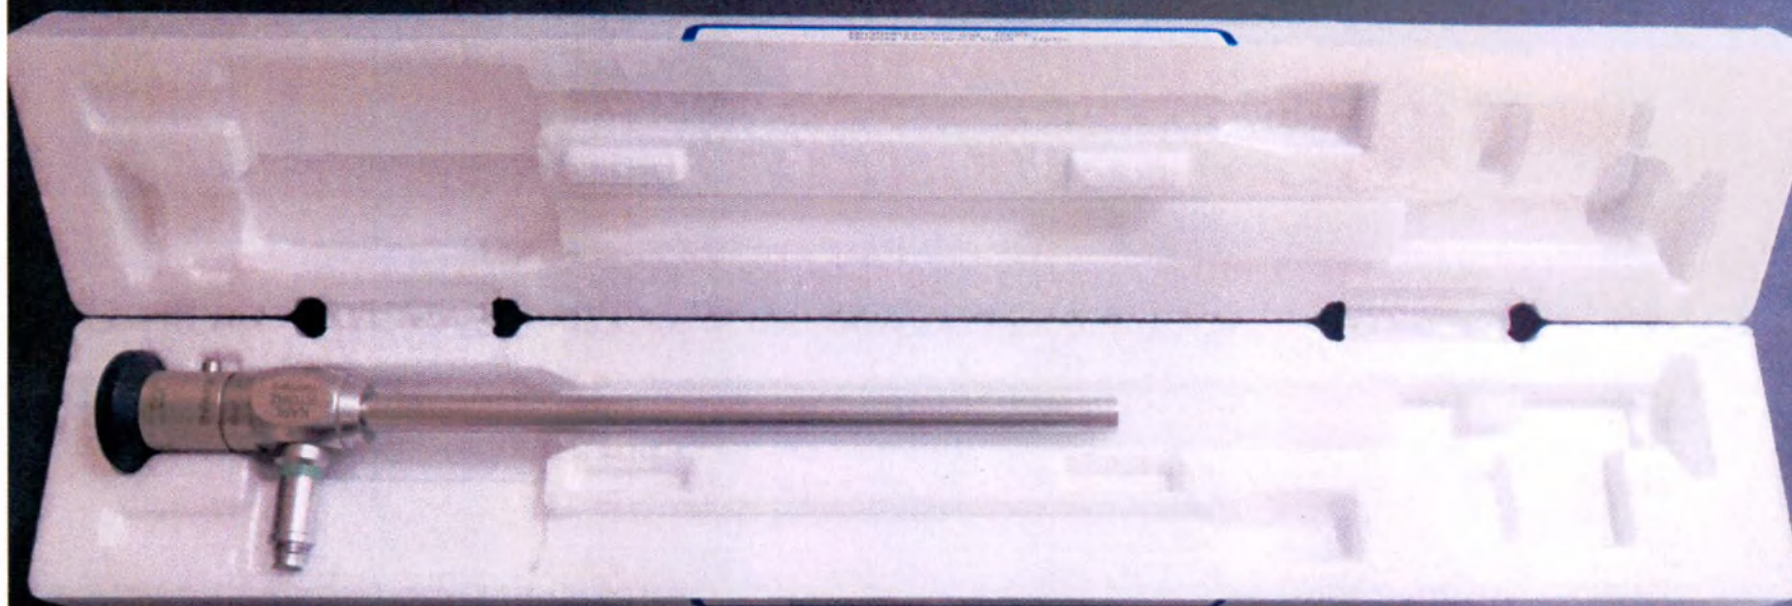


Рис. 59. Ларингофарингоскоп жесткий HOPKINS для аутофлуоресцентной диагностики и диагностики в белом цвете (ICG), типоразмер: направление наблюдения 0°, диаметр 10 мм, длина 20 см.

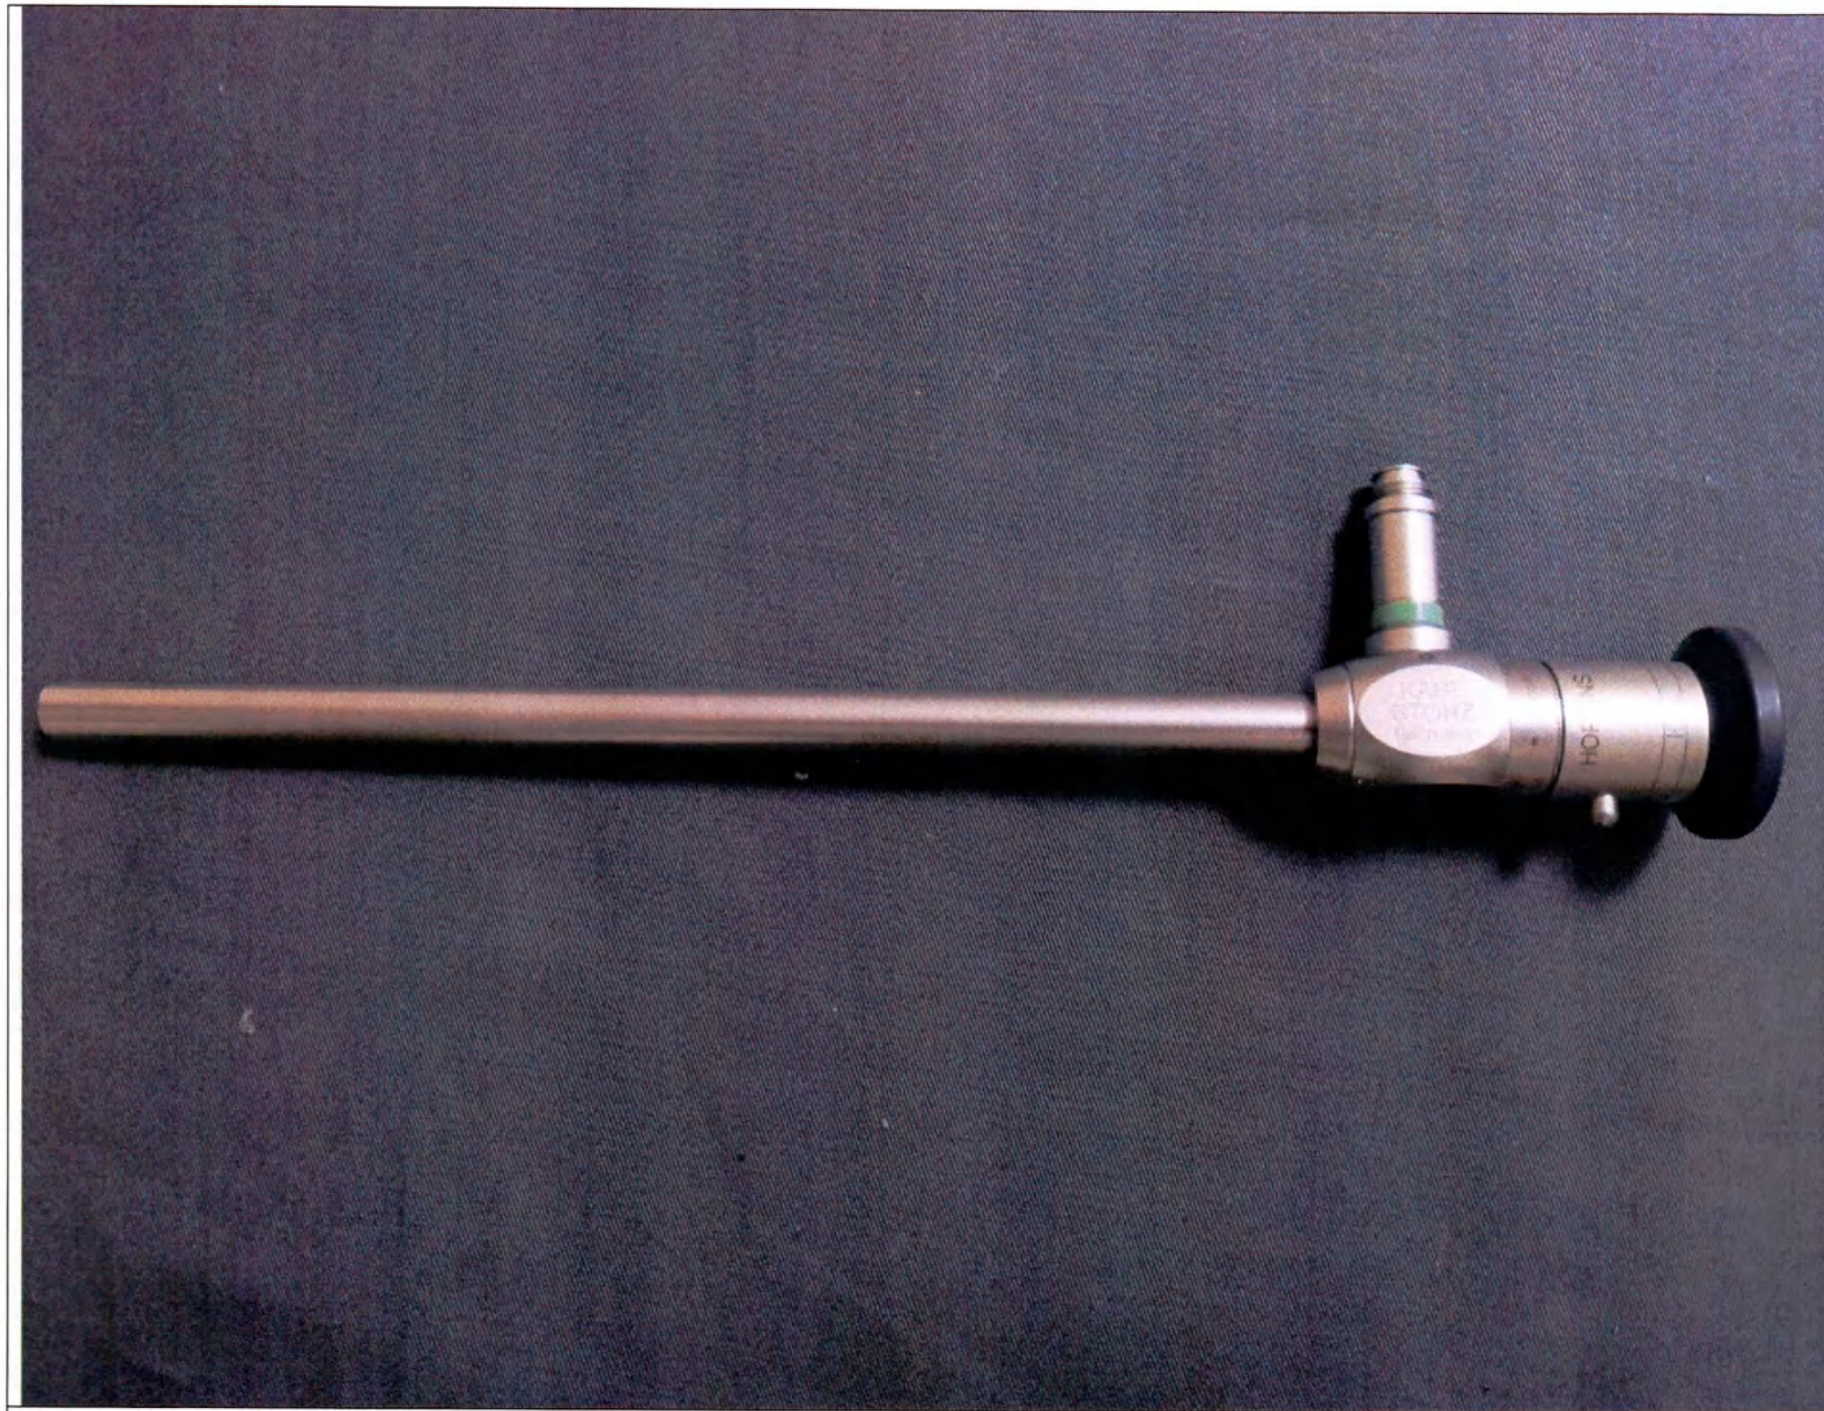


Рис. 60. Ларингофарингоскоп



Рис. 61. Ларингофарингоскоп



Рис. 62. Ларингофарингоскоп

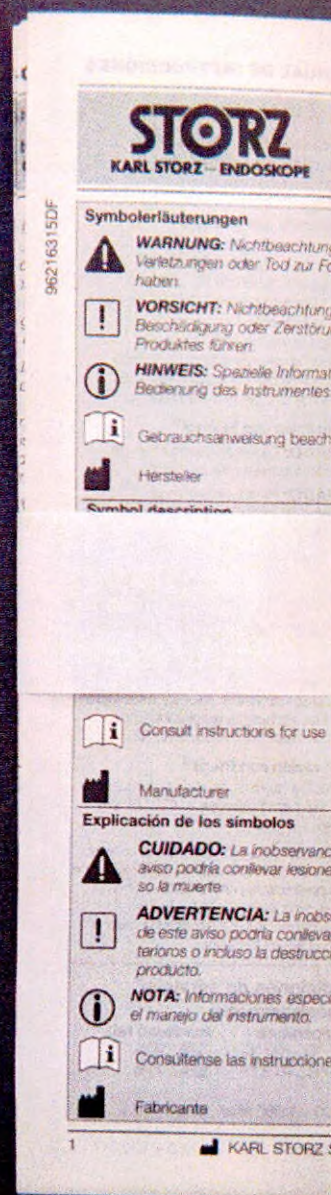


Рис. 63. Инструкция по эксплуатации. Конечный вид может быть изменен, содержание будет приведено в соответствие с документом в регистрационном досье.

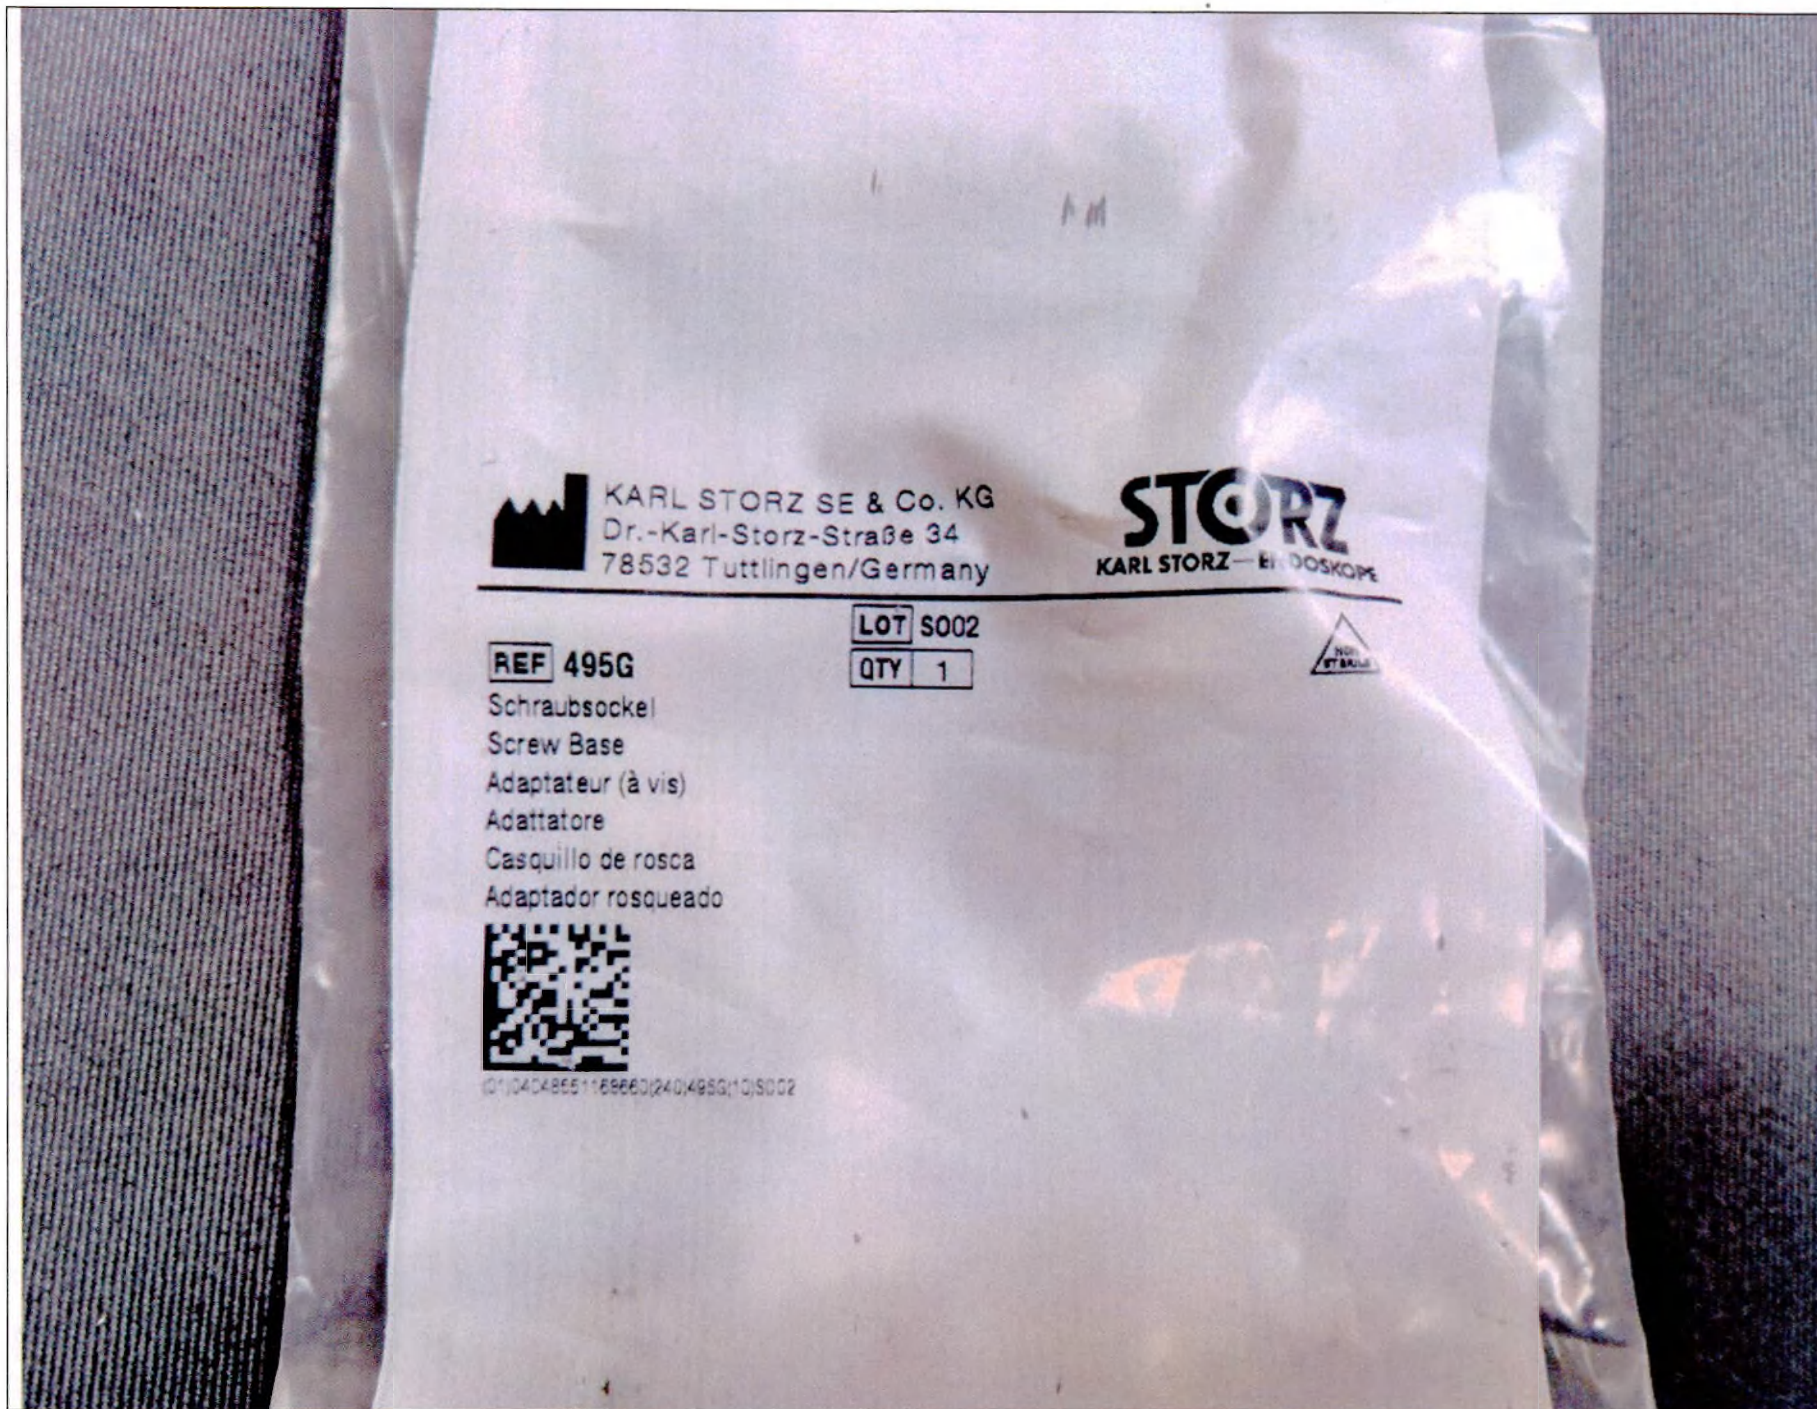


Рис. 64. Адаптер световодов KARL STORZ и Olympus. Первичная упаковка.

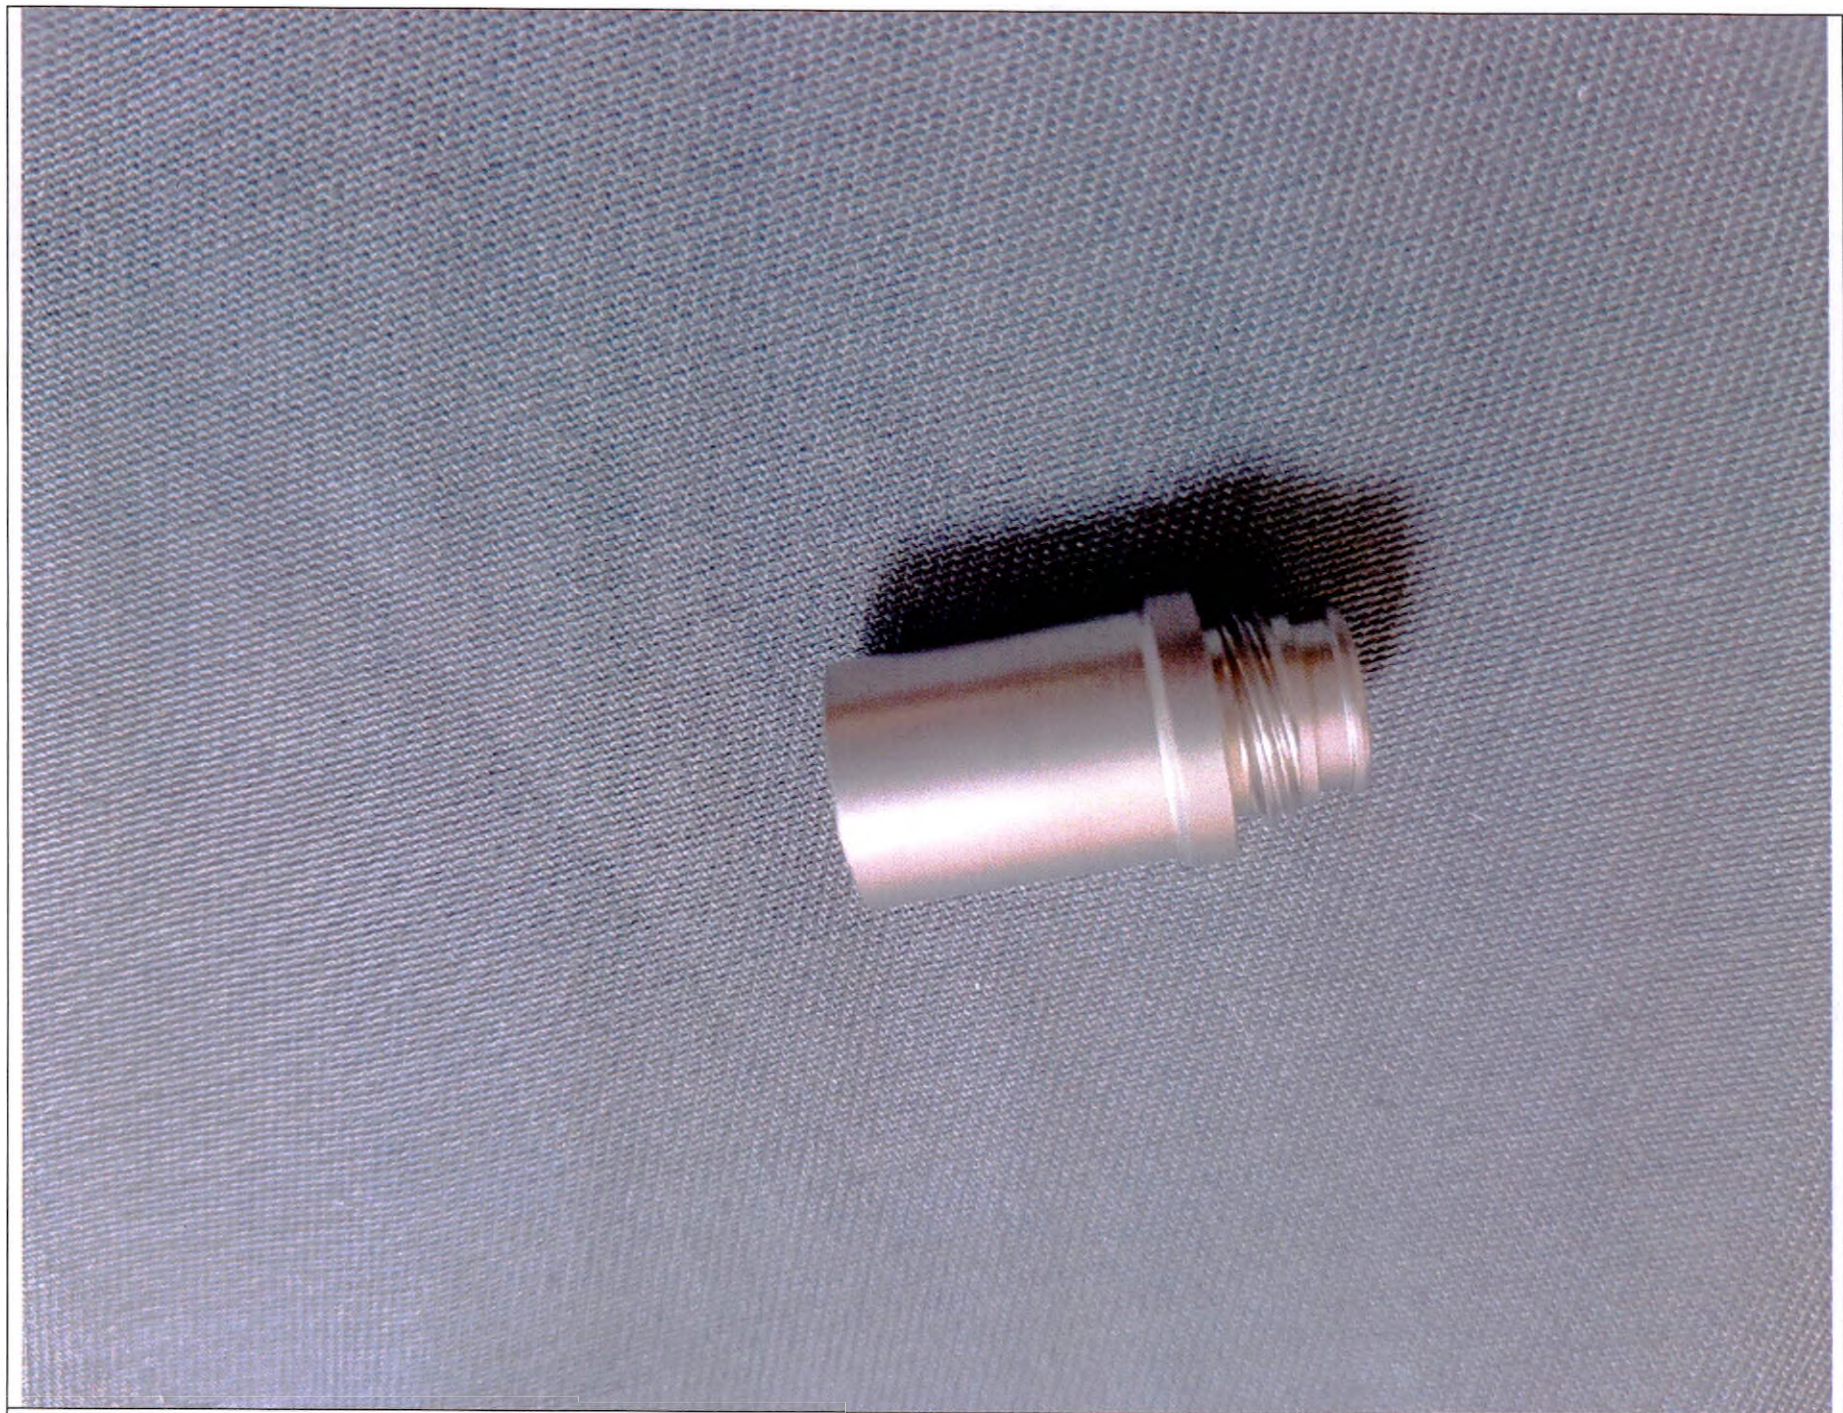


Рис. 65. Адаптер световодов KARL STORZ и Olympus.

 **KARL STORZ SE & Co. KG**
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE

LOT S006

QTY 1

REF 495F

Stecksockel, 9 mm ø
Attachm. for cable STORZ-Wolf
Culot à emboîter, ø 9 mm
Bussola, 9 mm Ø
Base enchufable, 9 mm.
adaptad.p/cabo de luz fria



(01)04048551168585(240)495F(10)S006

Рис. 66. Адаптер световодов Richard Wolf. Первичная упаковка.

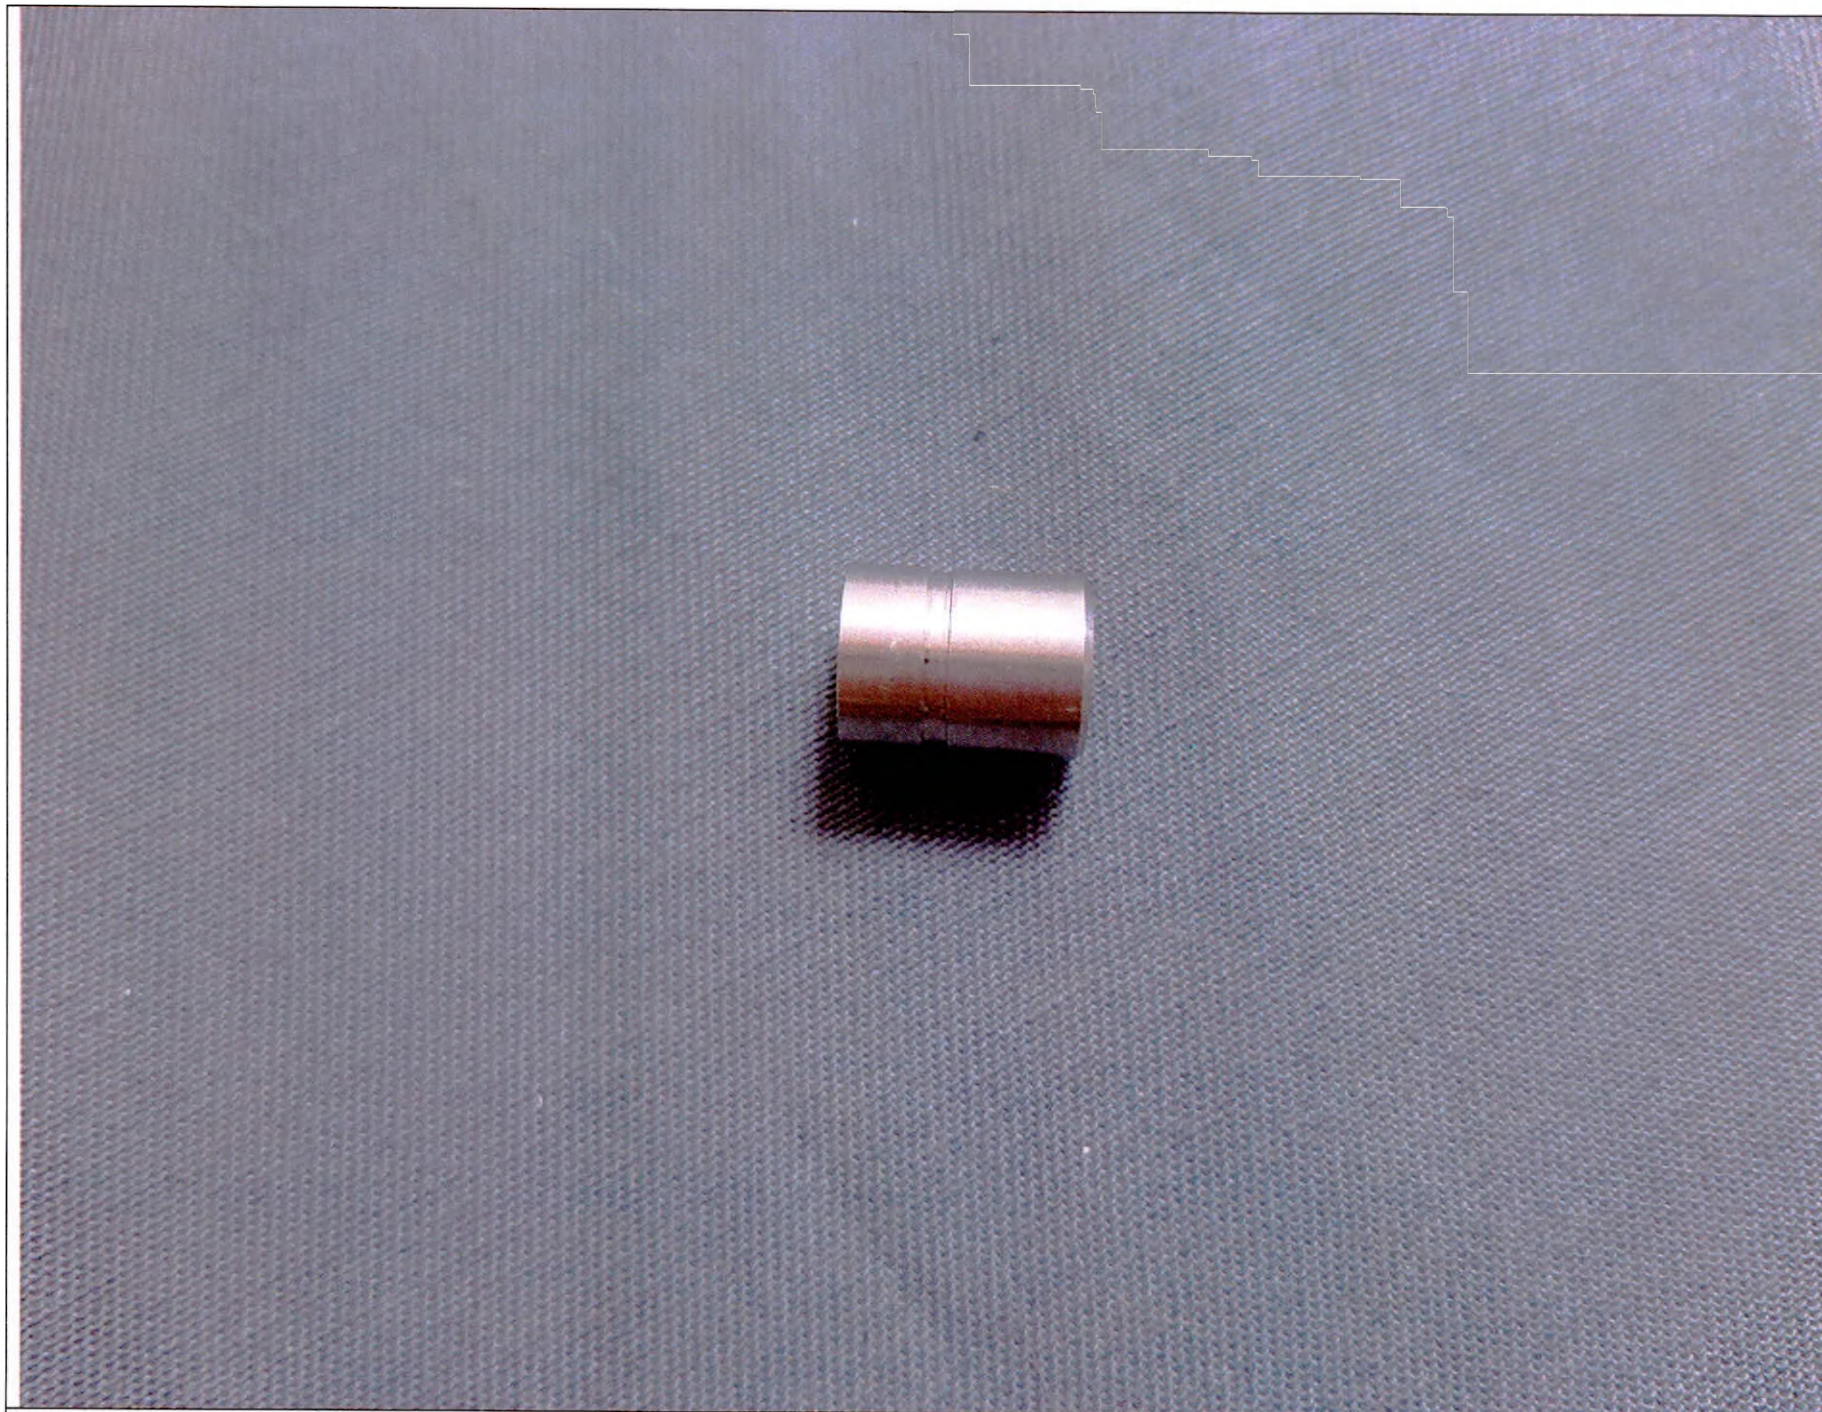


Рис. 67. Адаптер световодов Richard Wolf



Рис. 68. Рукоятка для ларингофарингоскопа. Вторичная упаковка.



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE

LOT T001

REF 8700H

QTY 1

de Griff, für Tele-Laryngoskope
en Handle, for tele-laryngoscope
fr Poignée pour télé-laryngoscope
it Impugnatura, per tele-laringoscopi
es Mango, para telelaringoscopios
pt Empunhadura para telelaringoscópio



020002

Rx only

MD



2021-06-14



www.karlstorz.com/ifu

UDI (01)0404855(2)16480(1)210614(0)T001(422)276



Рис. 69. Рукоятка для ларингофарингоскопа. Маркировка на вторичной упаковке.



Рис. 70. Рукоятка для ларингофарингоскопа. Первичная упаковка.

 KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ SE & CO. KG

LOT T001

QTY 1

REF 8700H

de Griff, für Tele-Laryngoskope
en Handle, for tele-laryngoscope
fr Poignée pour télé-laryngoscope
it Impugnatura, per tele-laringoscopi
es Mango, para telelaringoscopios
pt Empunhadura para telelaringoscópio

NON
STERILE



Rx only

MD



2021-06-14



www.karlstorz.com/ifu

UDI 0104048551216480(11)210614(10)T001(422)276

CE

Рис. 71. Рукоятка для ларингофарингоскопа. Маркировка на первичной упаковке.



Рис. 72. Рукоятка для ларингофарингоскопа

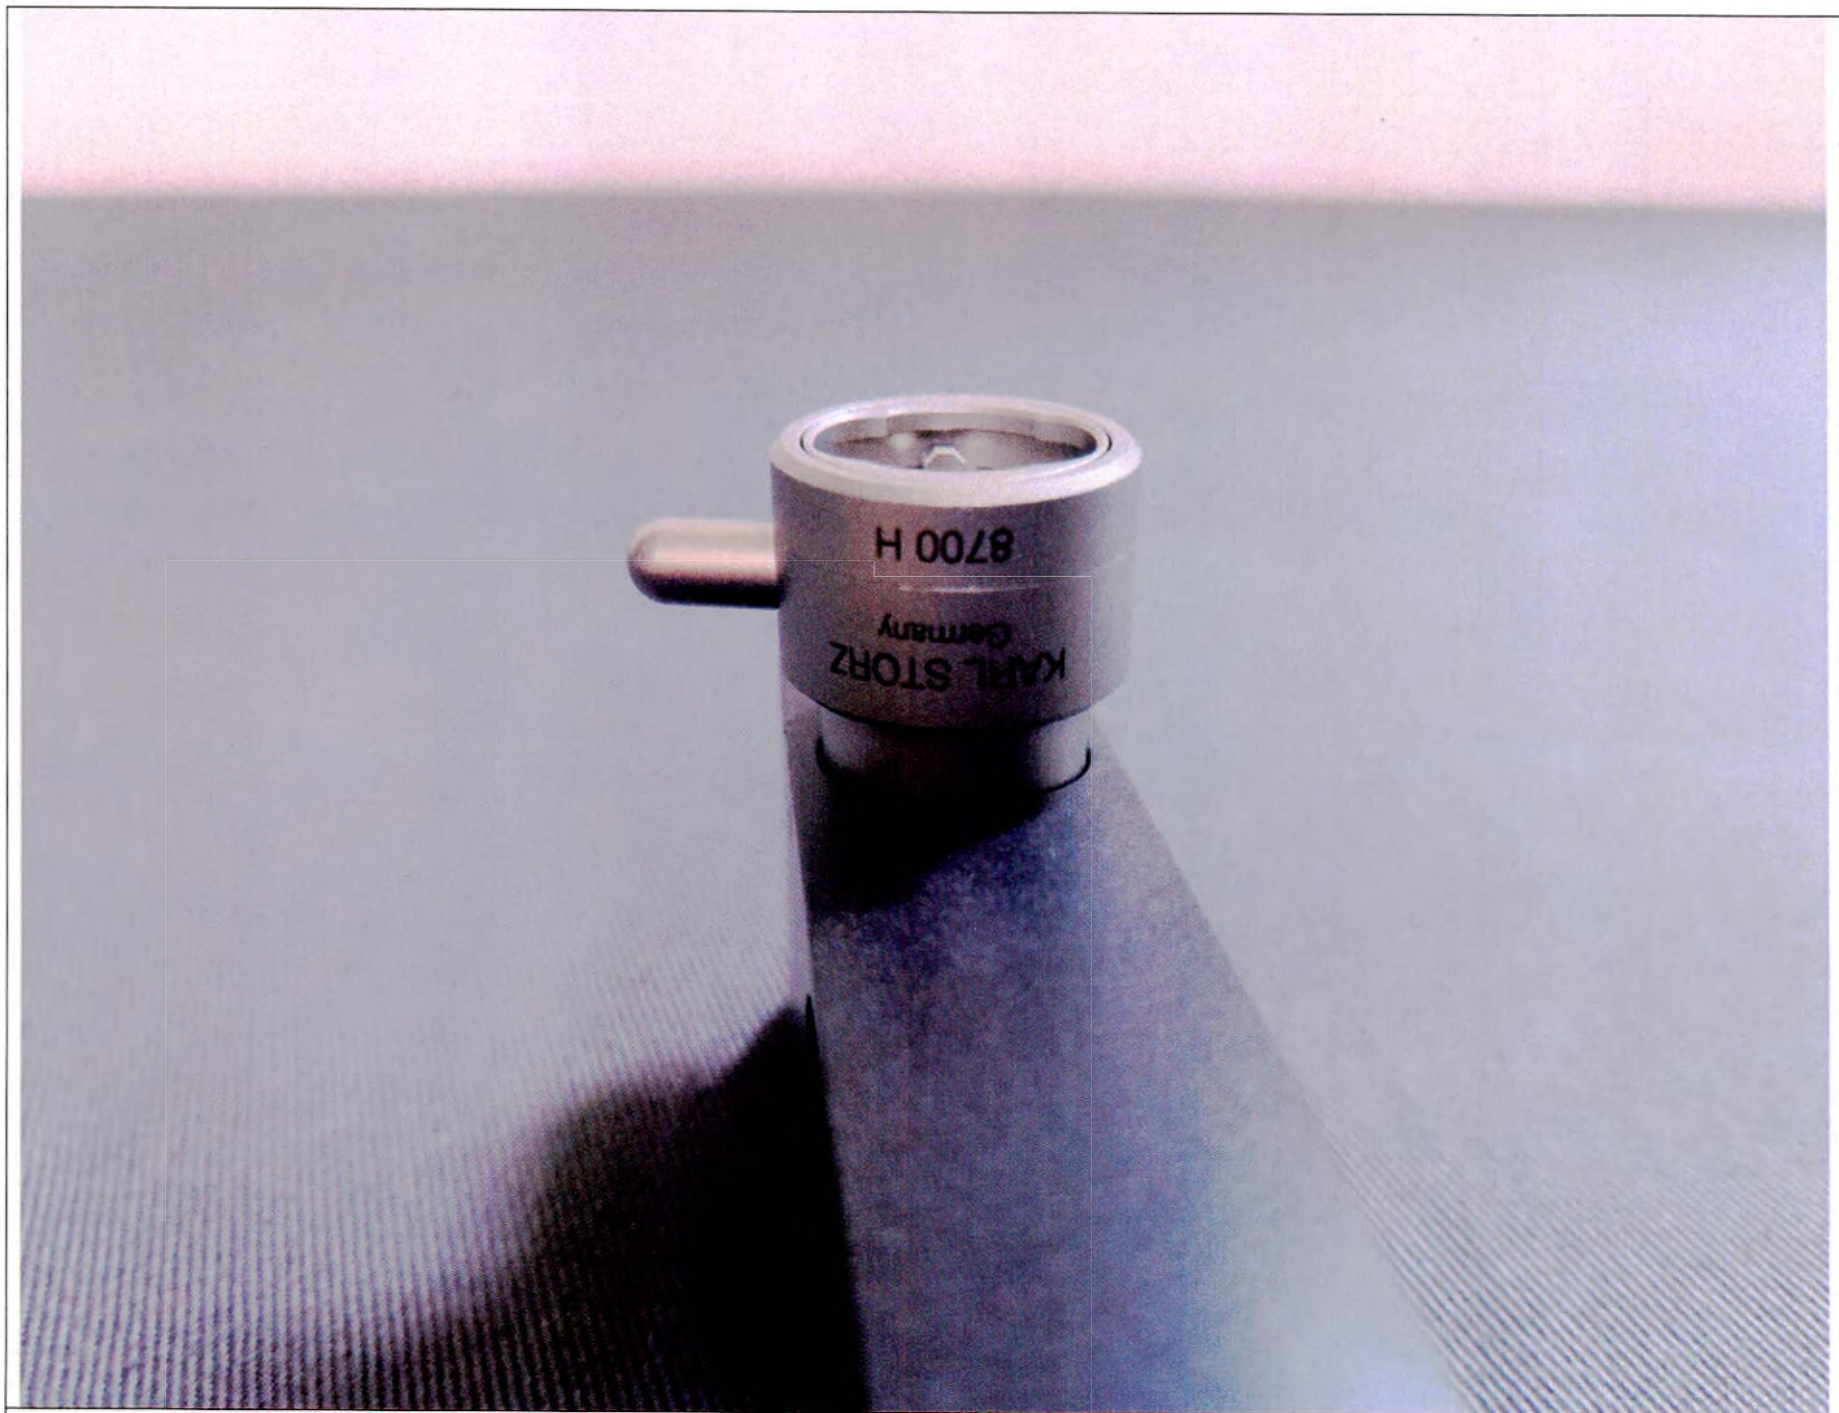


Рис. 73. Рукоятка для ларингофарингоскопа

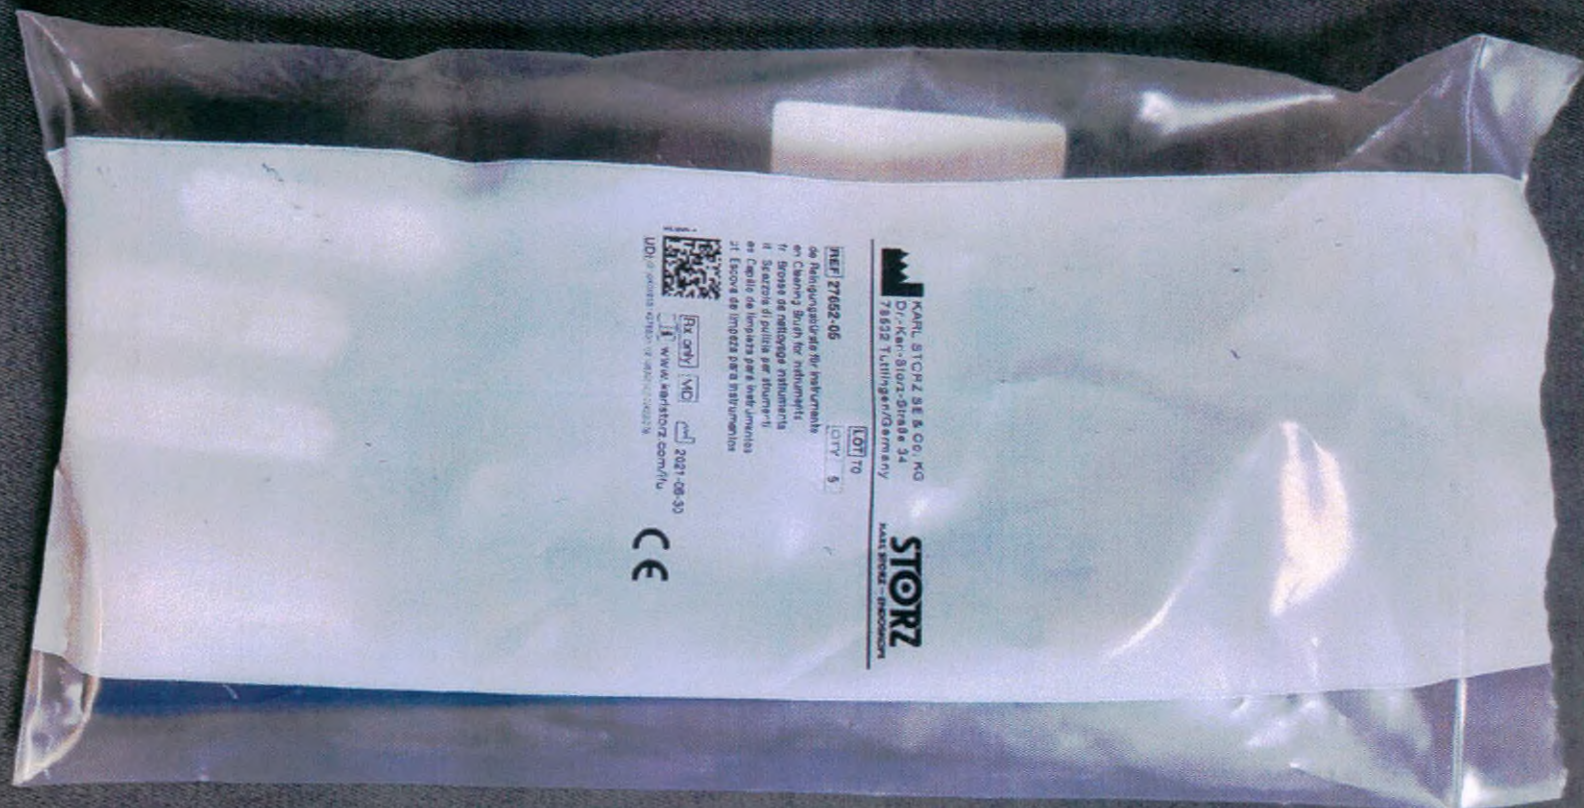


Рис. 74. Щетка плоская для очистки - 5 шт./уп. Первичная упаковка.



Рис. 75. Щетка плоская для очистки - 5 шт./уп

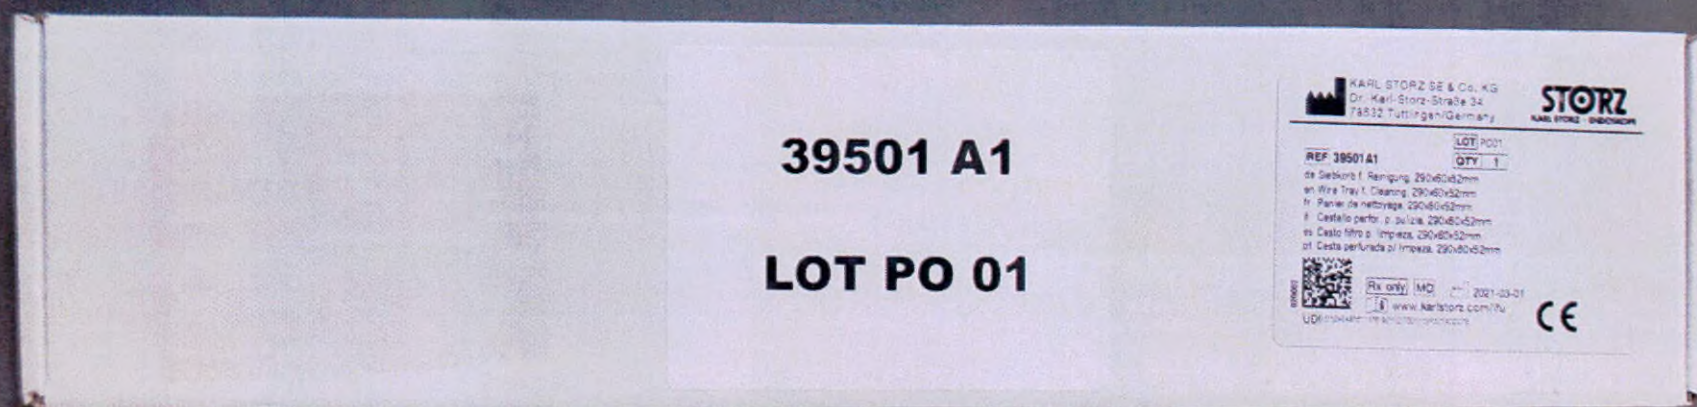


Рис. 76. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 290 x 60 x 52 мм/ Первичная упаковка.



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ – ENDOSKOPE

LOT P001

REF 39501A1

QTY 1

de Siebkorb f. Reinigung, 290x60x52mm
en Wire Tray f. Cleaning, 290x60x52mm
fr Panier de nettoyage, 290x60x52mm
it Cestello perfor. p. pulizia, 290x60x52mm
es Cesto filtro p. limpieza, 290x60x52mm
pt Cesta perfurada p/ limpeza, 290x60x52mm



020002

Rx only


MD



2021-03-01



www.karlstorz.com/ifu



UDI | 01004048551157612(11)210301(10)P001(422)276

Рис. 77. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 290 x 60 x 52 мм. Маркировка на первичной упаковке.



Рис. 78. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 290 x 60 x 52 мм

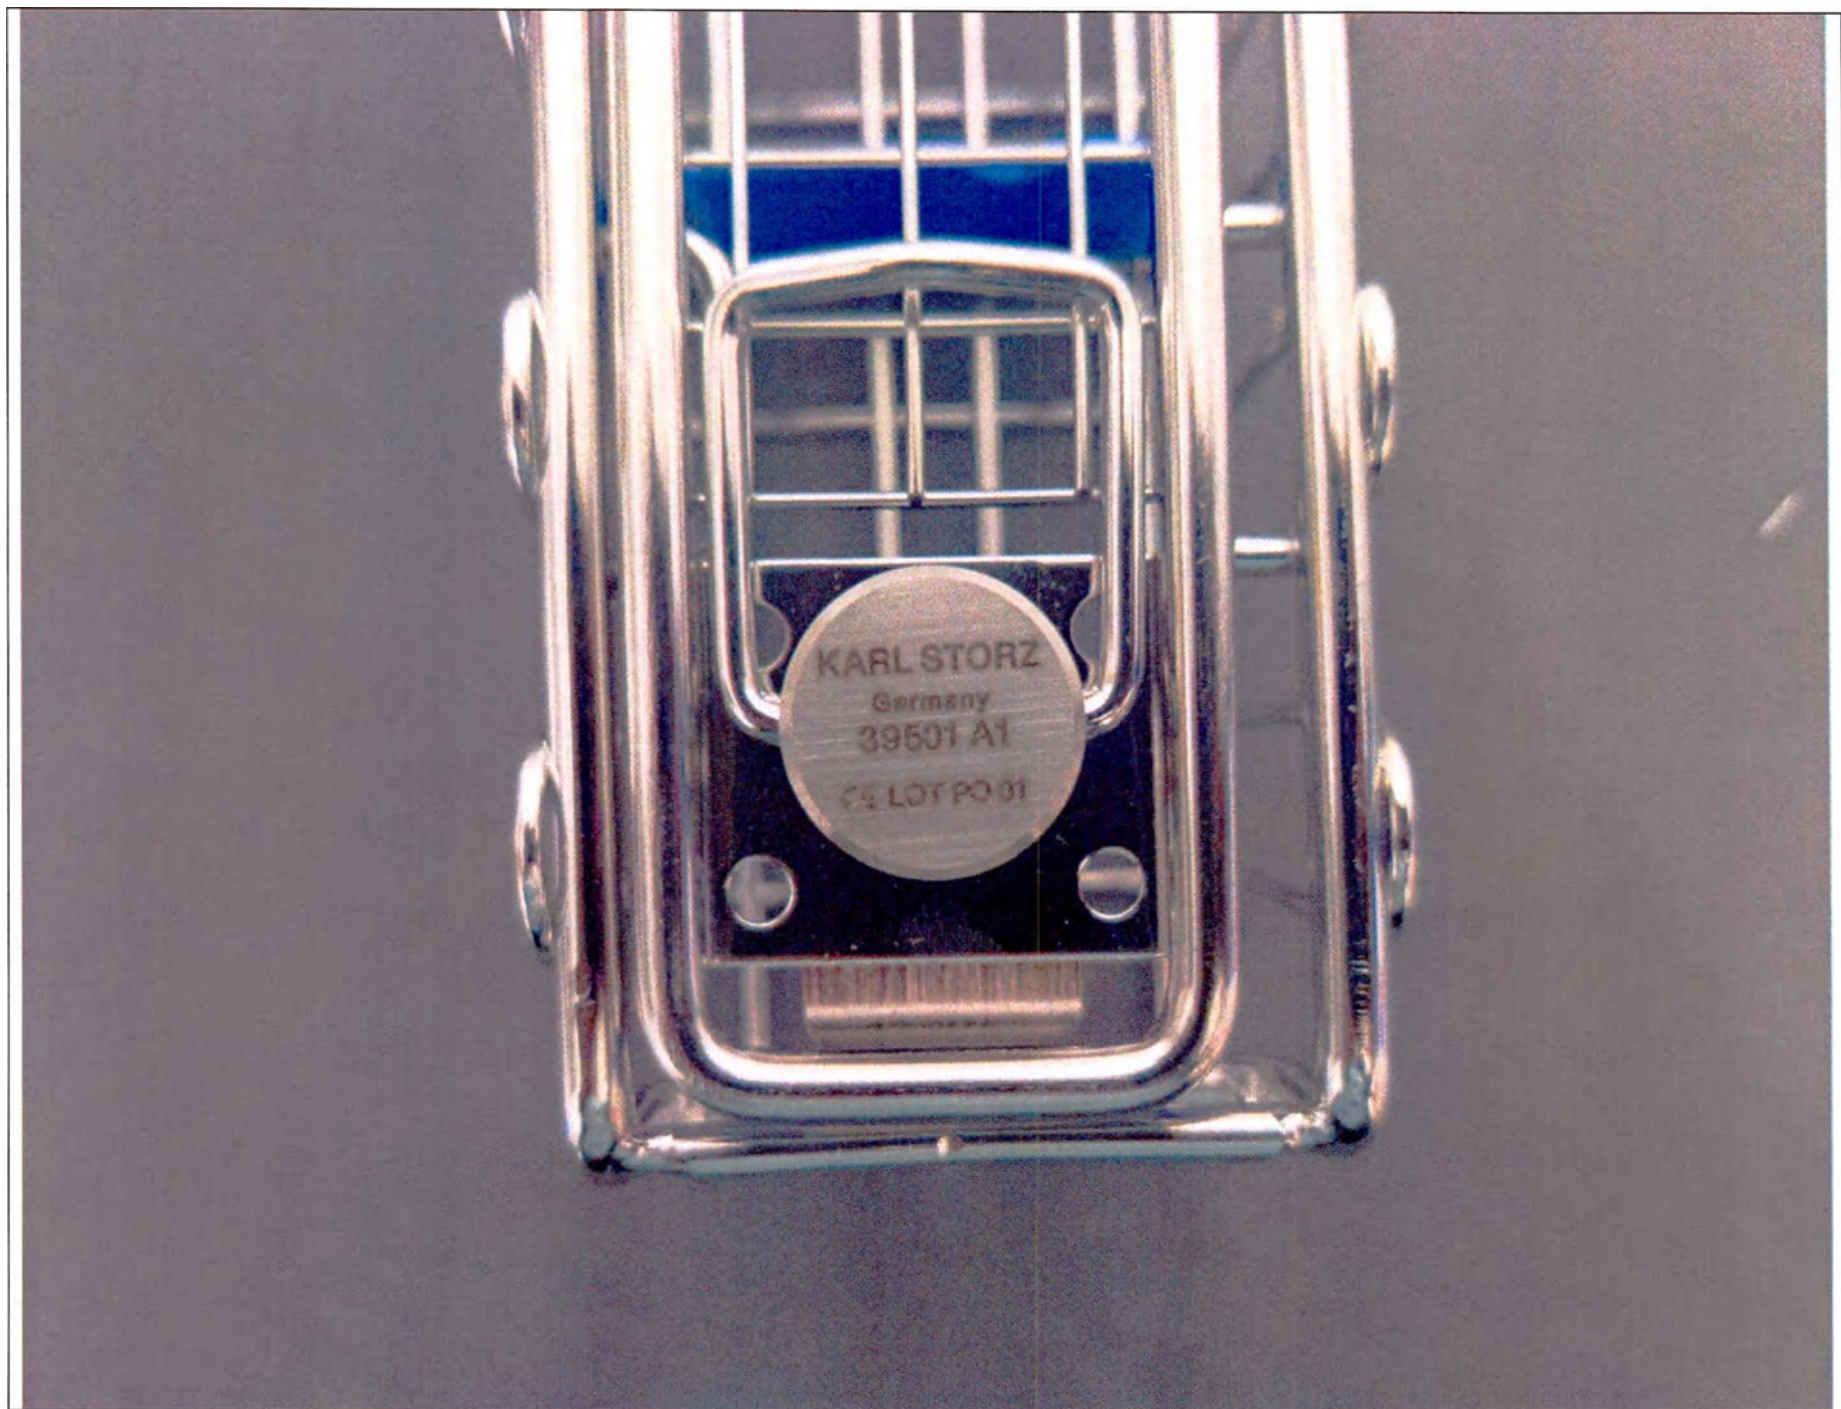


Рис. 79. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 290 x 60 x 52 мм

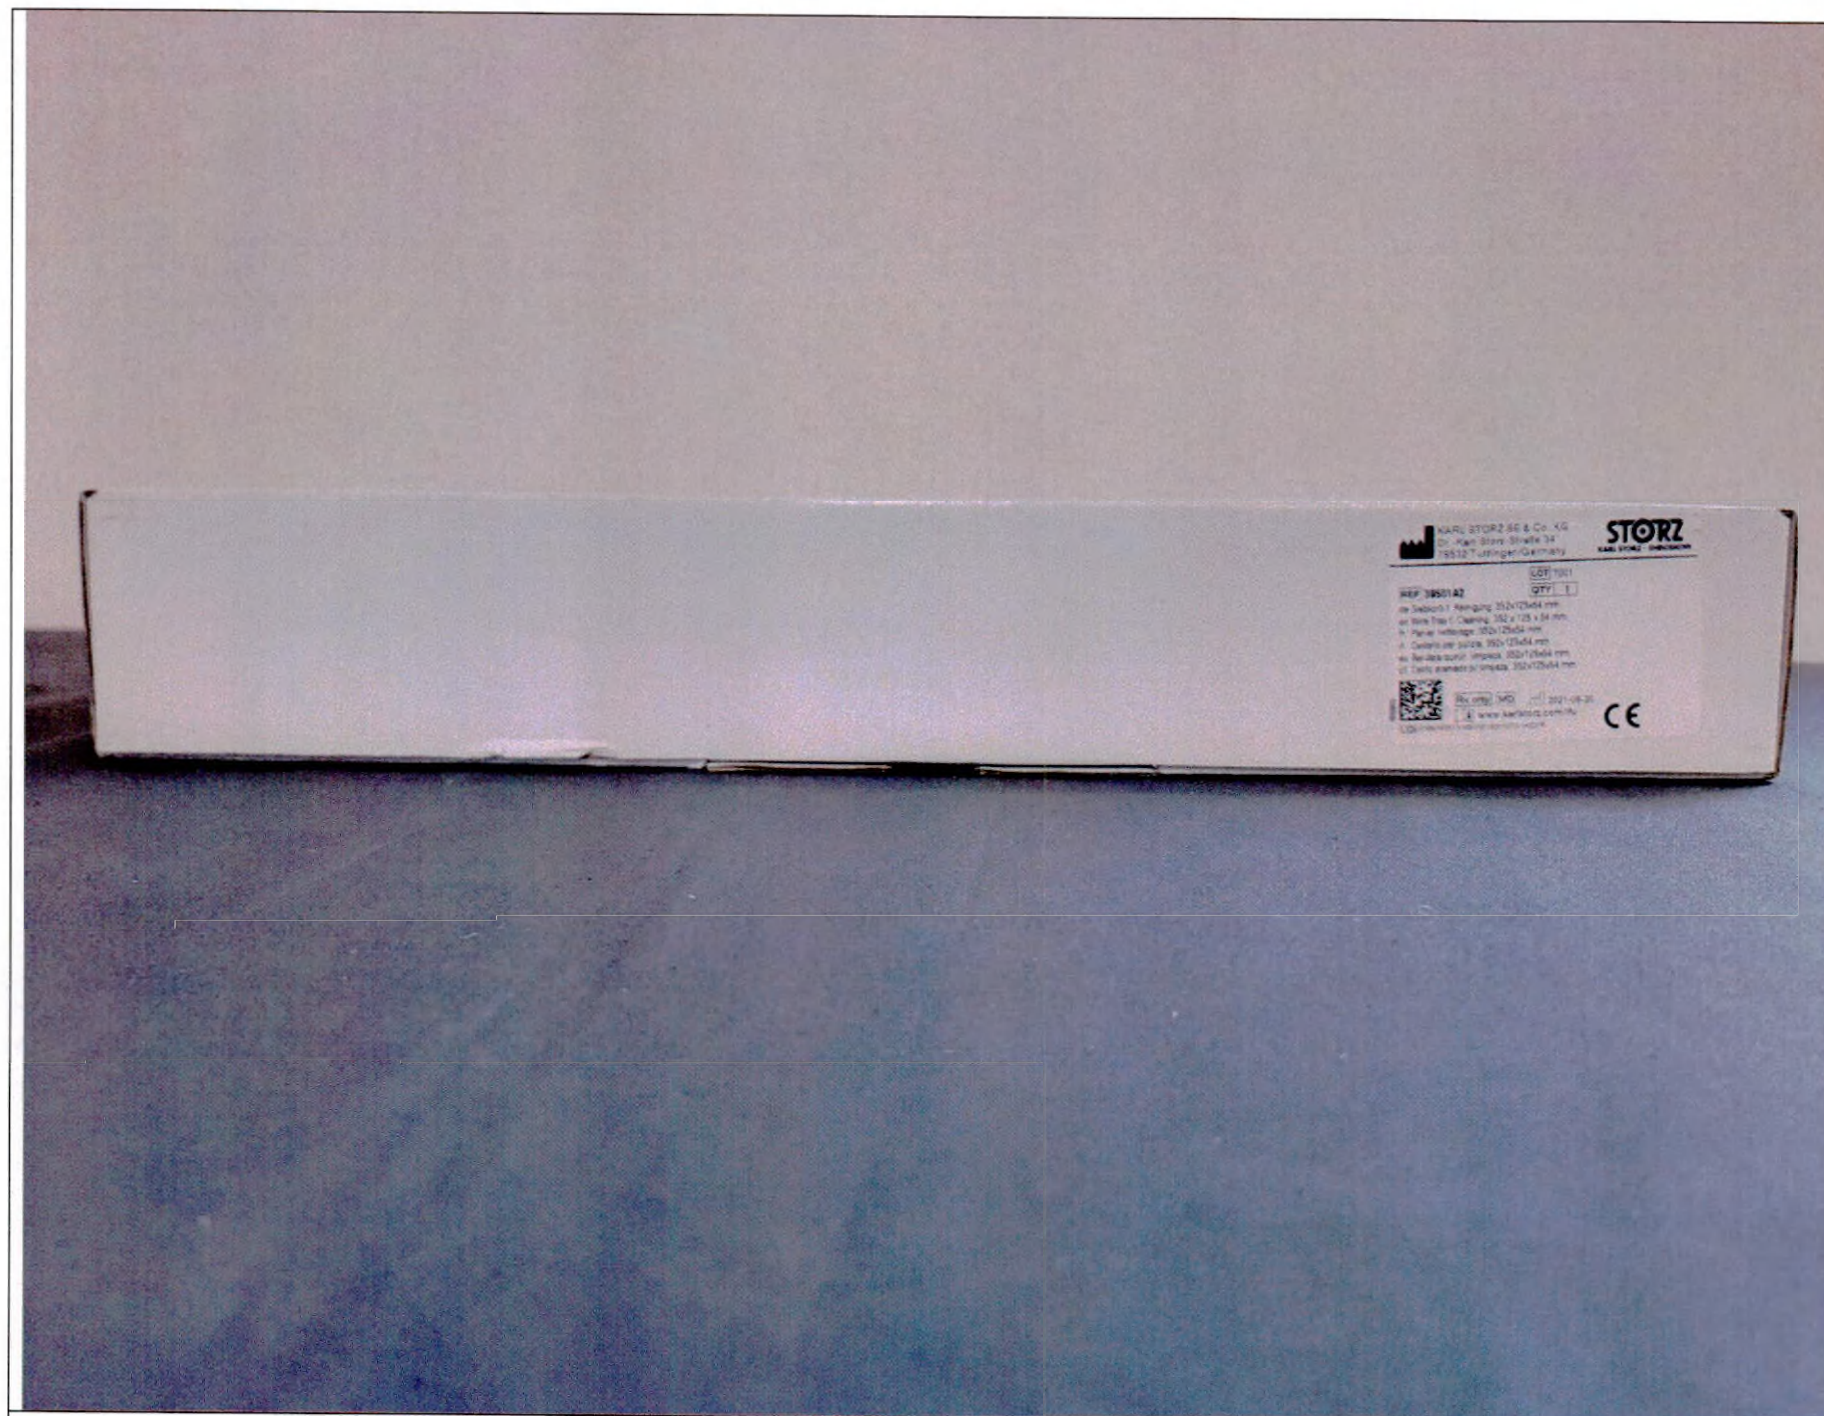


Рис. 80. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 352 x 125 x 54 мм. Первичная упаковка.



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ – ENDOSKOPE

LOT T001

REF 39501A2

QTY 1

de Siebkorb f. Reinigung, 352x125x54 mm
en Wire Tray f. Cleaning, 352 x 125 x 54 mm
fr Panier nettoyage, 352x125x54 mm
it Cestello per pulizia, 352x125x54 mm
es Bandeja quirúr. limpieza, 352x125x54 mm
pt Cesto aramado p/ limpeza, 352x125x54 mm



Rx only

MD



2021-06-30



www.karlstorz.com/ifu

UDI (01)04048551157626(11)210830(10)T001(422)276




Рис. 81. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 352 x 125 x 54 мм. Маркировка на первичной упаковке.

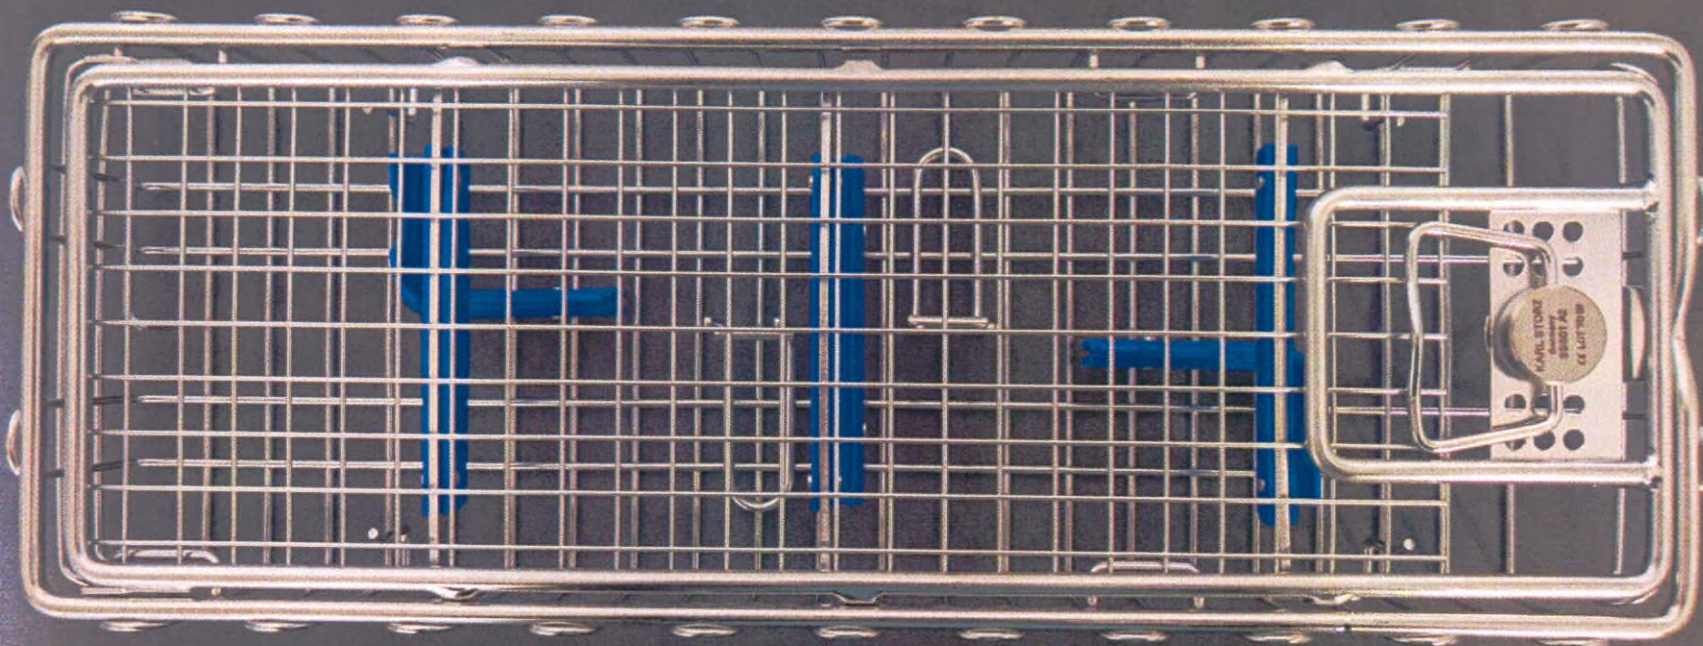


Рис. 82. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 352 x 125 x 54 мм



Рис. 83. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 352 x 125 x 54 мм

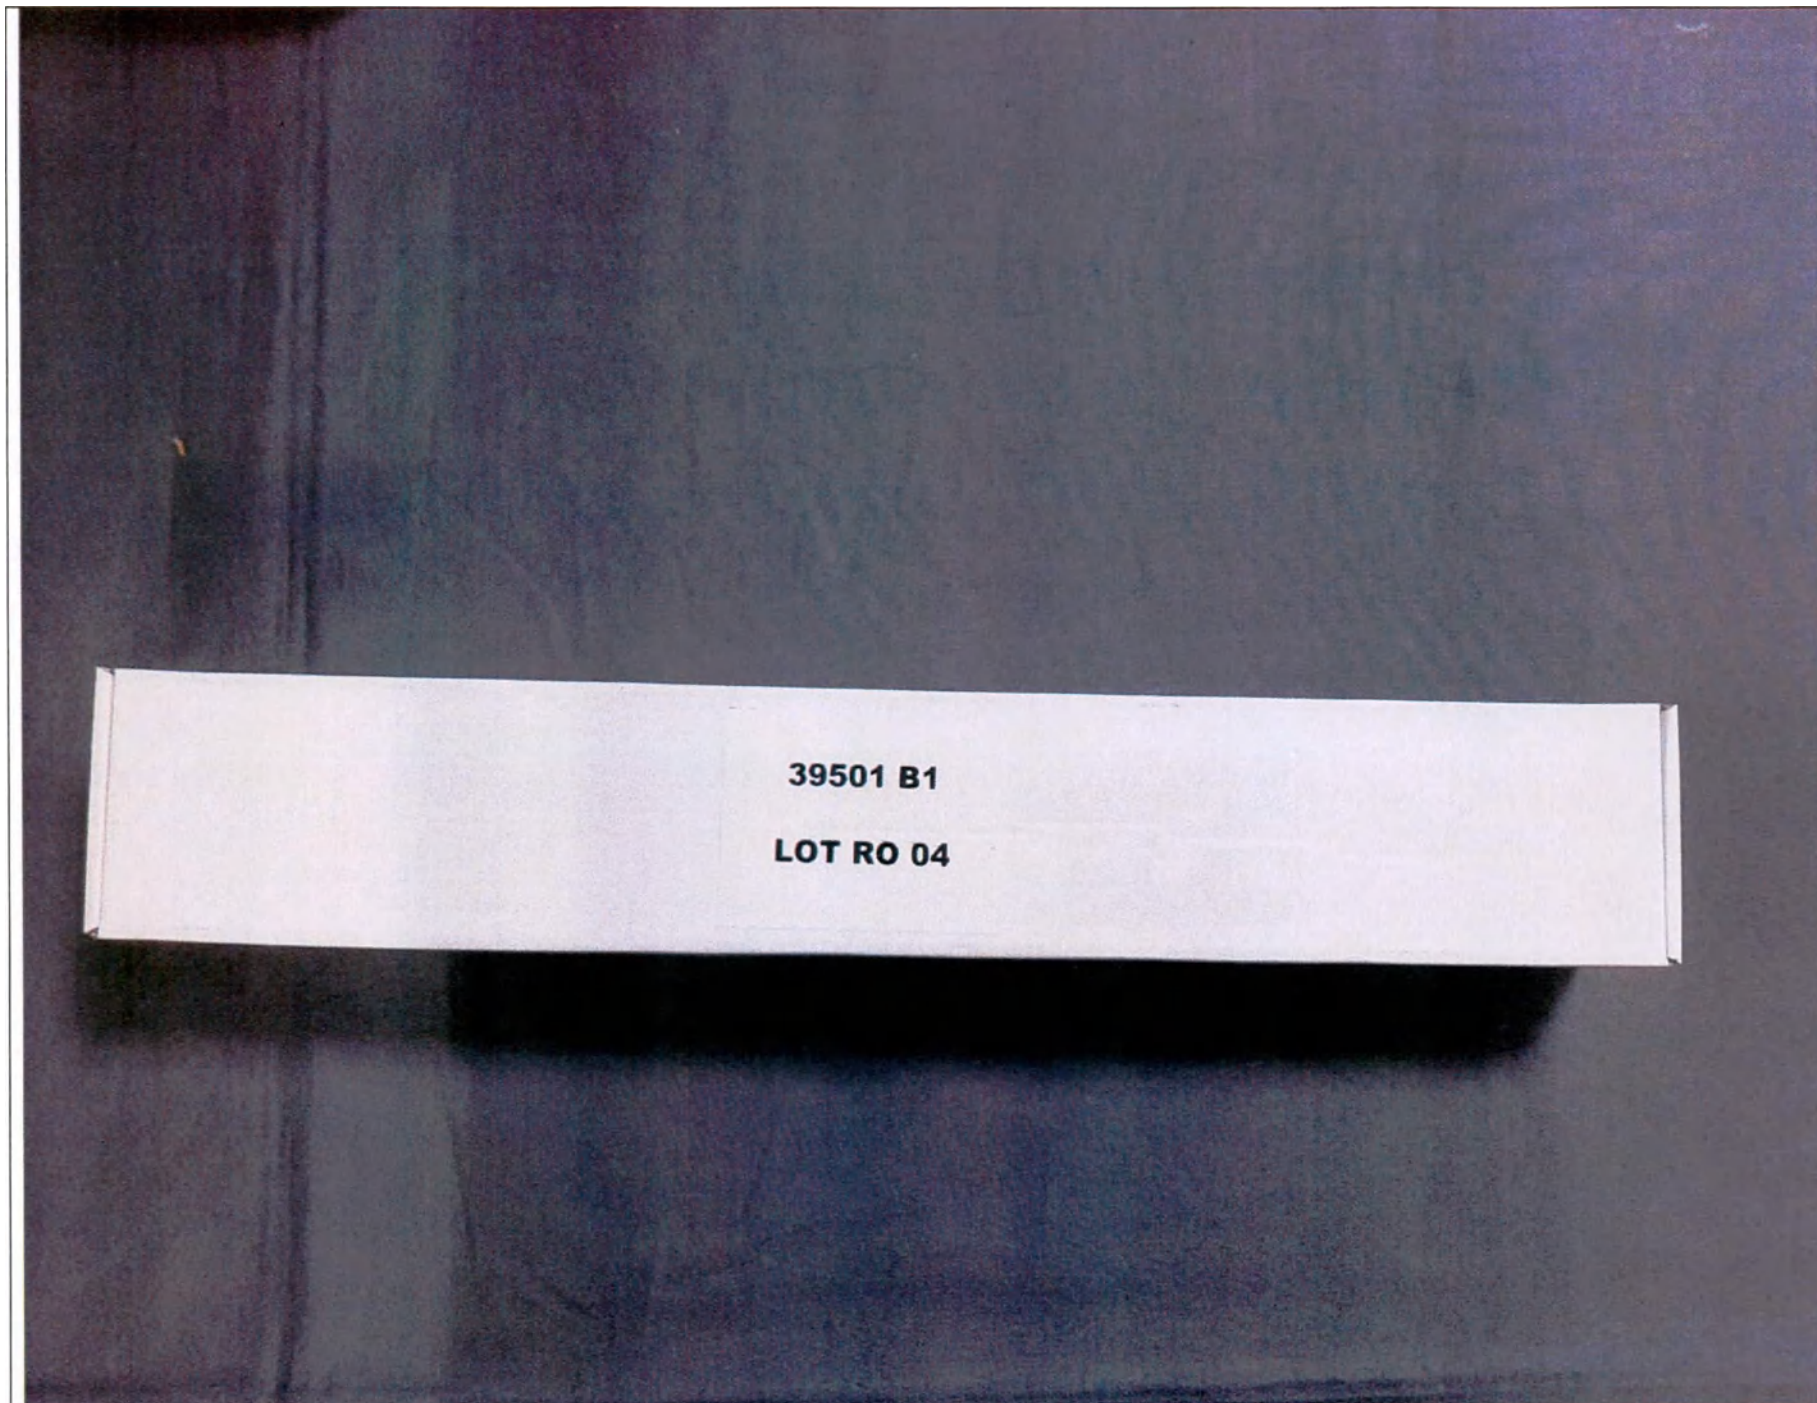


Рис. 84. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 430 х 65 х 52 мм. Упаковка.



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ – ENDOSKOPE

LOT R004

REF 39501B1

QTY 1

de Siebkorb f. Reinigung, 430x65x52mm
en Wire Tray f. Cleaning, 430x65x52mm
fr Panier de nettoyage, 430x65x52mm
it Cestello perfor. p. pulizia, 430x65x52mm
es Cesto filtro p. limpieza, 430x65x52mm
pt Cesta perforada p/ limpeza, 430x65x52mm



020002

Rx only

MD



2021-04-30



www.karlstorz.com/ifu

UDI (01)04048551157640(11)210430(10)R004(422)276



Рис. 85. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 430 x 65 x 52 мм. Маркировка на упаковке

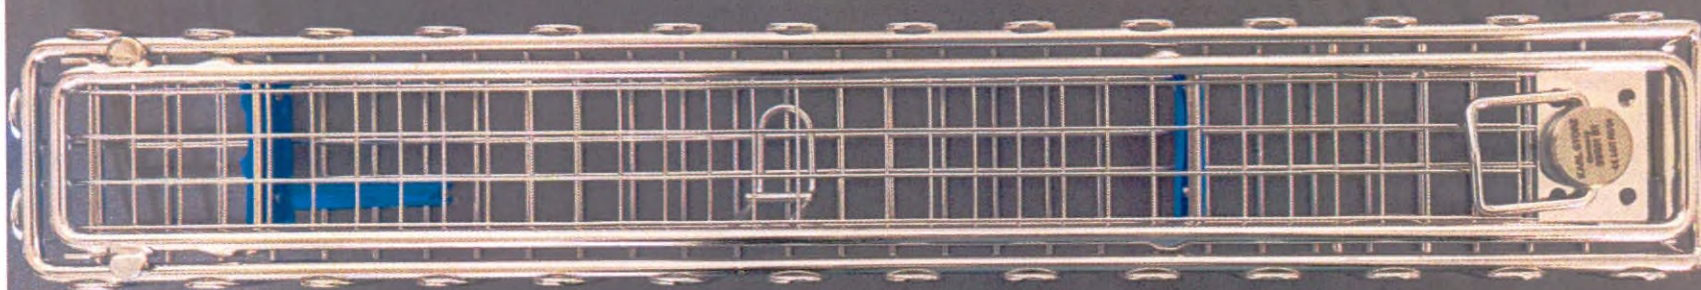


Рис. 86. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 430 x 65 x 52 мм.



Рис. 87. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 430 x 65 x 52 мм.

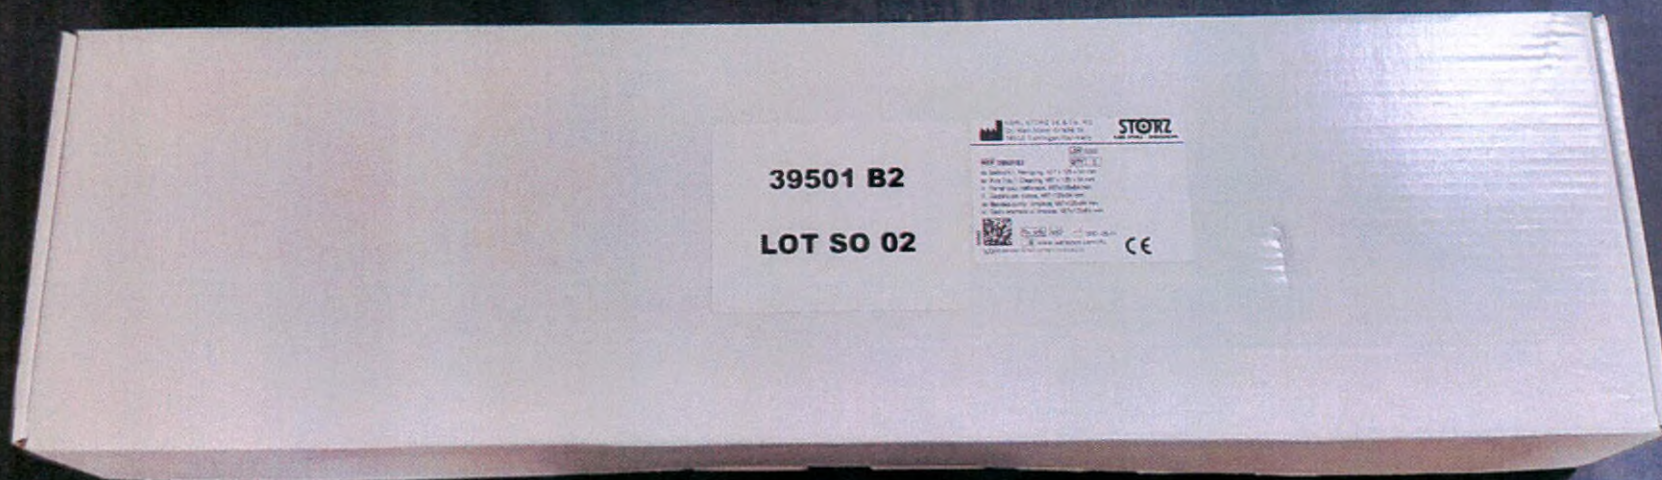


Рис. 88. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 487 x 125 x 54 мм. Упаковка.

39501 B2

LOT SO 02



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ – ENDOSKOPE

LOT S002

REF 39501B2

QTY 1

de Siebkorb f. Reinigung, 487 x 125 x 54 mm
en Wire Tray f. Cleaning, 487 x 125 x 54 mm
fr Panier pour nettoyage, 487x125x54 mm
it Cestello per pulizia, 487x125x54 mm
es Bandeja quirúr. limpieza, 487x125x54 mm
pt Cesto aramado p/ limpeza, 487x125x54 mm



020002

Rx only

MD



2021-05-01



www.karlstorz.com/ifu

UDI 102104048551157667(11)210501(1)000021422076

CE

Рис. 89. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 352 x 125 x 54 мм. Маркировка на упаковке.



Рис. 90. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 352 x 125 x 54 мм.



Рис. 91. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 352 x 125 x 54 мм.

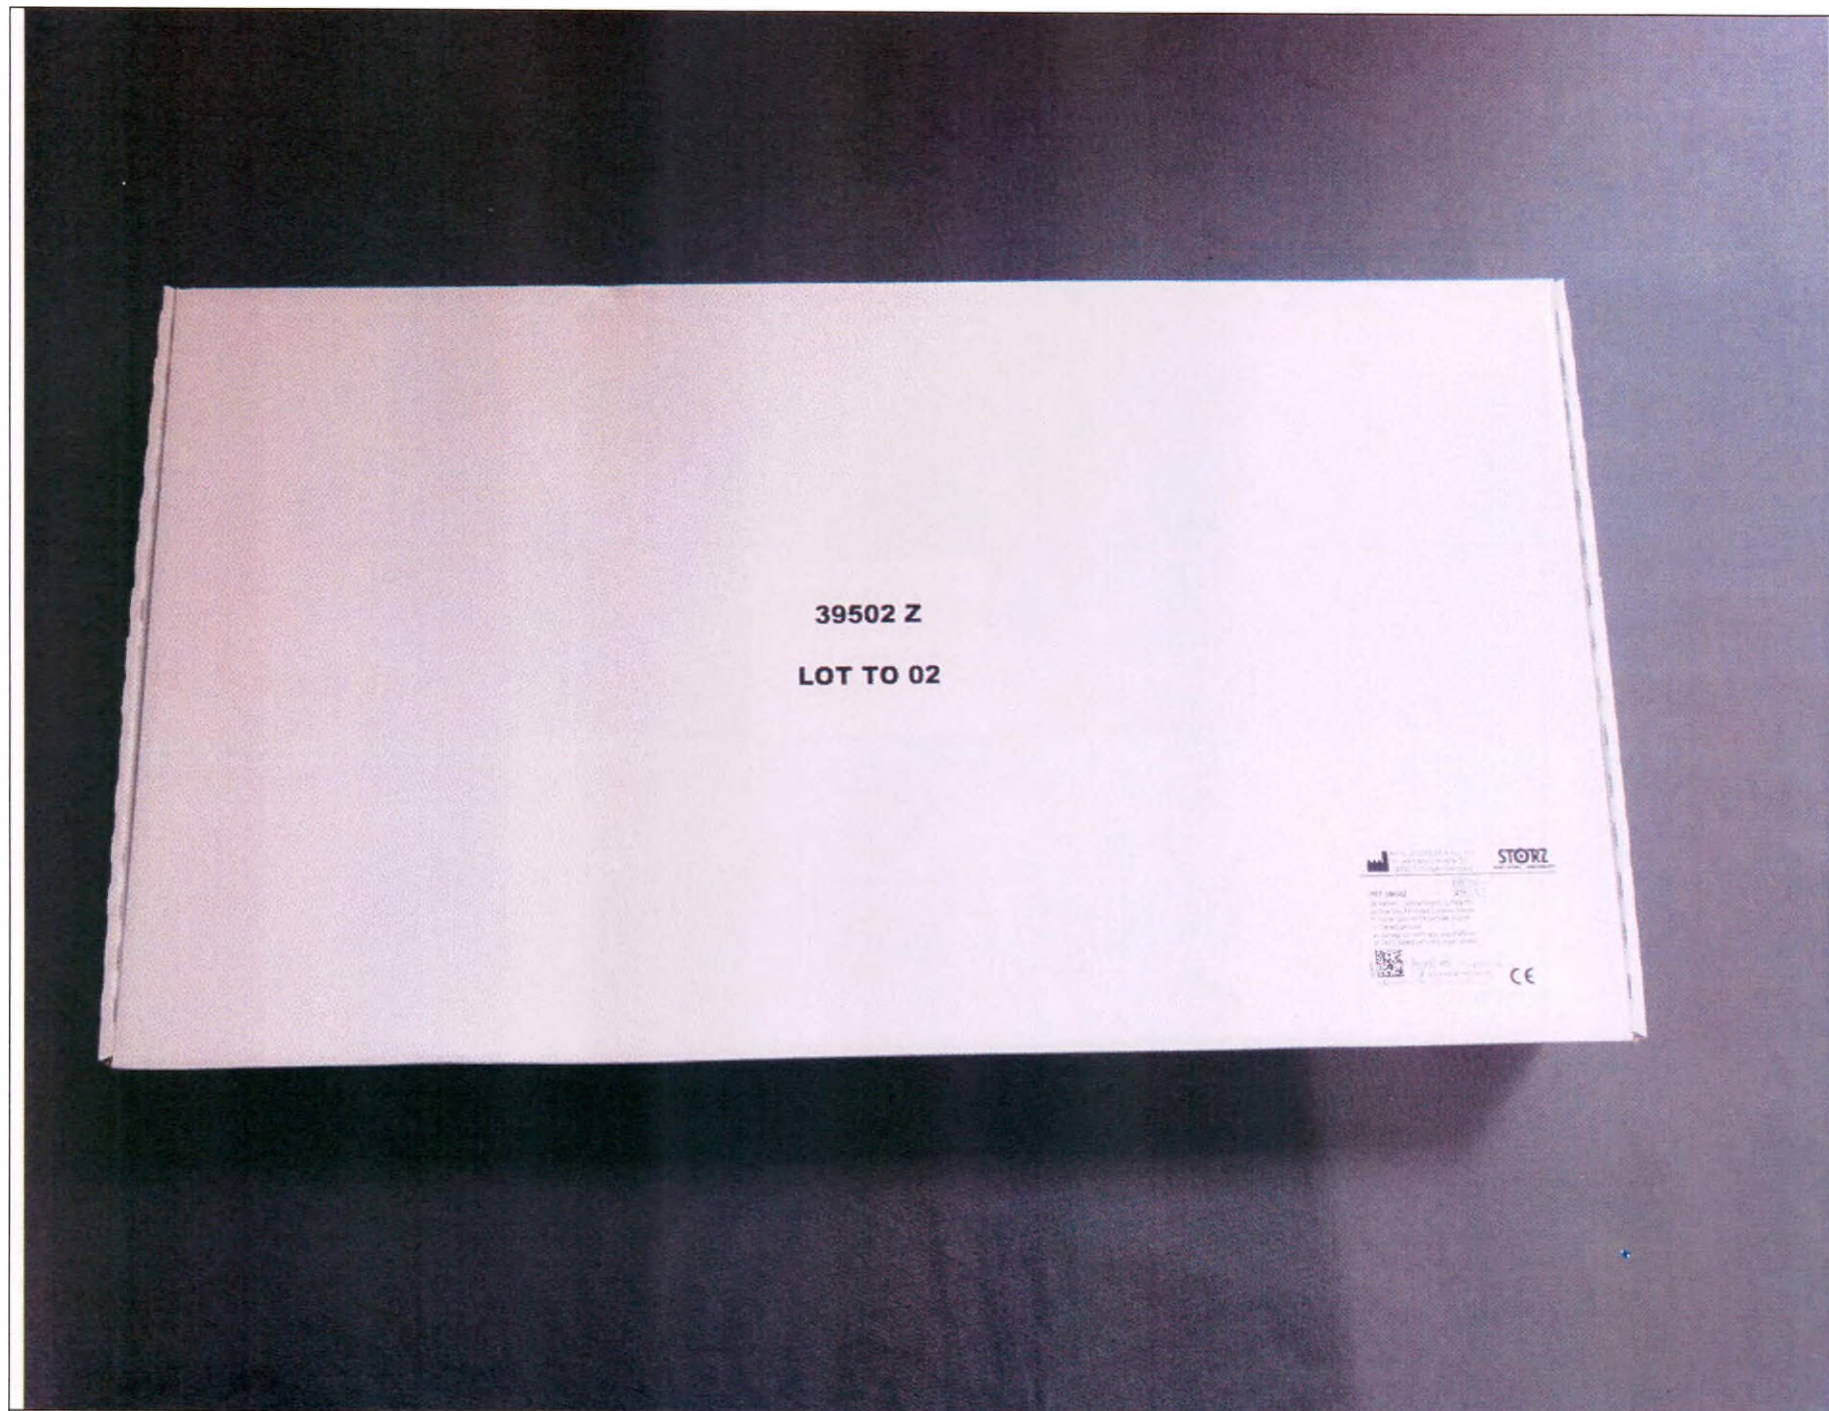


Рис. 92. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 480 x 250 x 66 мм. Упаковка.



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE

REF 39502Z

LOT T002

QTY 1

de Siebkorb, Lochblechwandung, Fallgriffe
en Wire Tray, Perforated, Foldaway Handles
fr Panier, paroi en tôle perforée, poignée
it Cestello perforato
es Bandeja quir, perforada, asas abatibles
pt Cesto, parede perfurada, pegas retráteis

020003



Rx only

MD



2021-07-05



www.karlstorz.com/ifu

CE

UDI (01)04048551157848(11)210705(10)T002(422)276

Рис. 93. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 480 x 250 x 66 мм. Маркировка на упаковке.

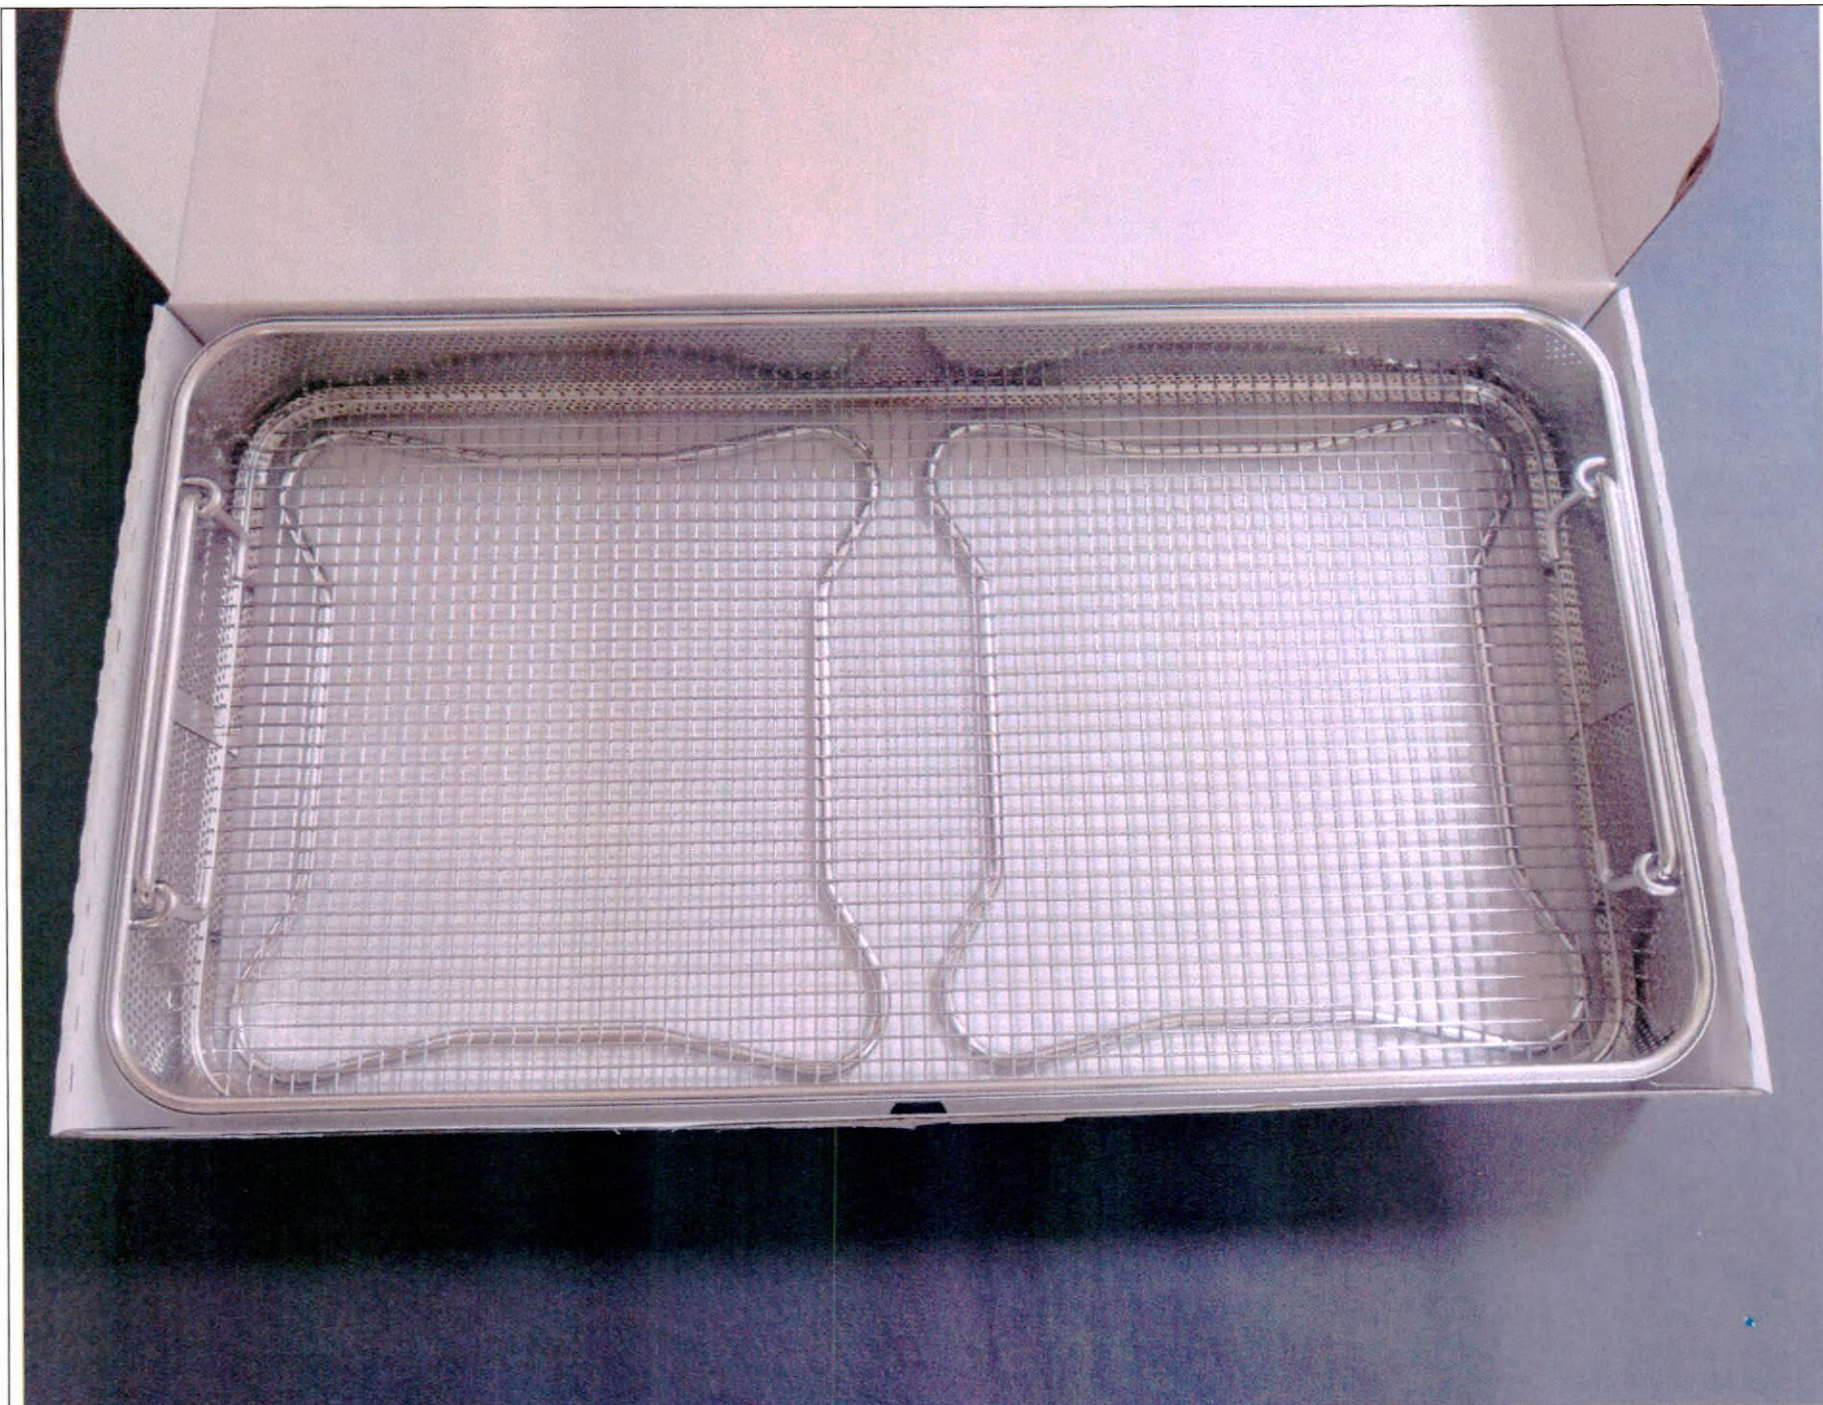


Рис. 94. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 480 x 250 x 66 мм

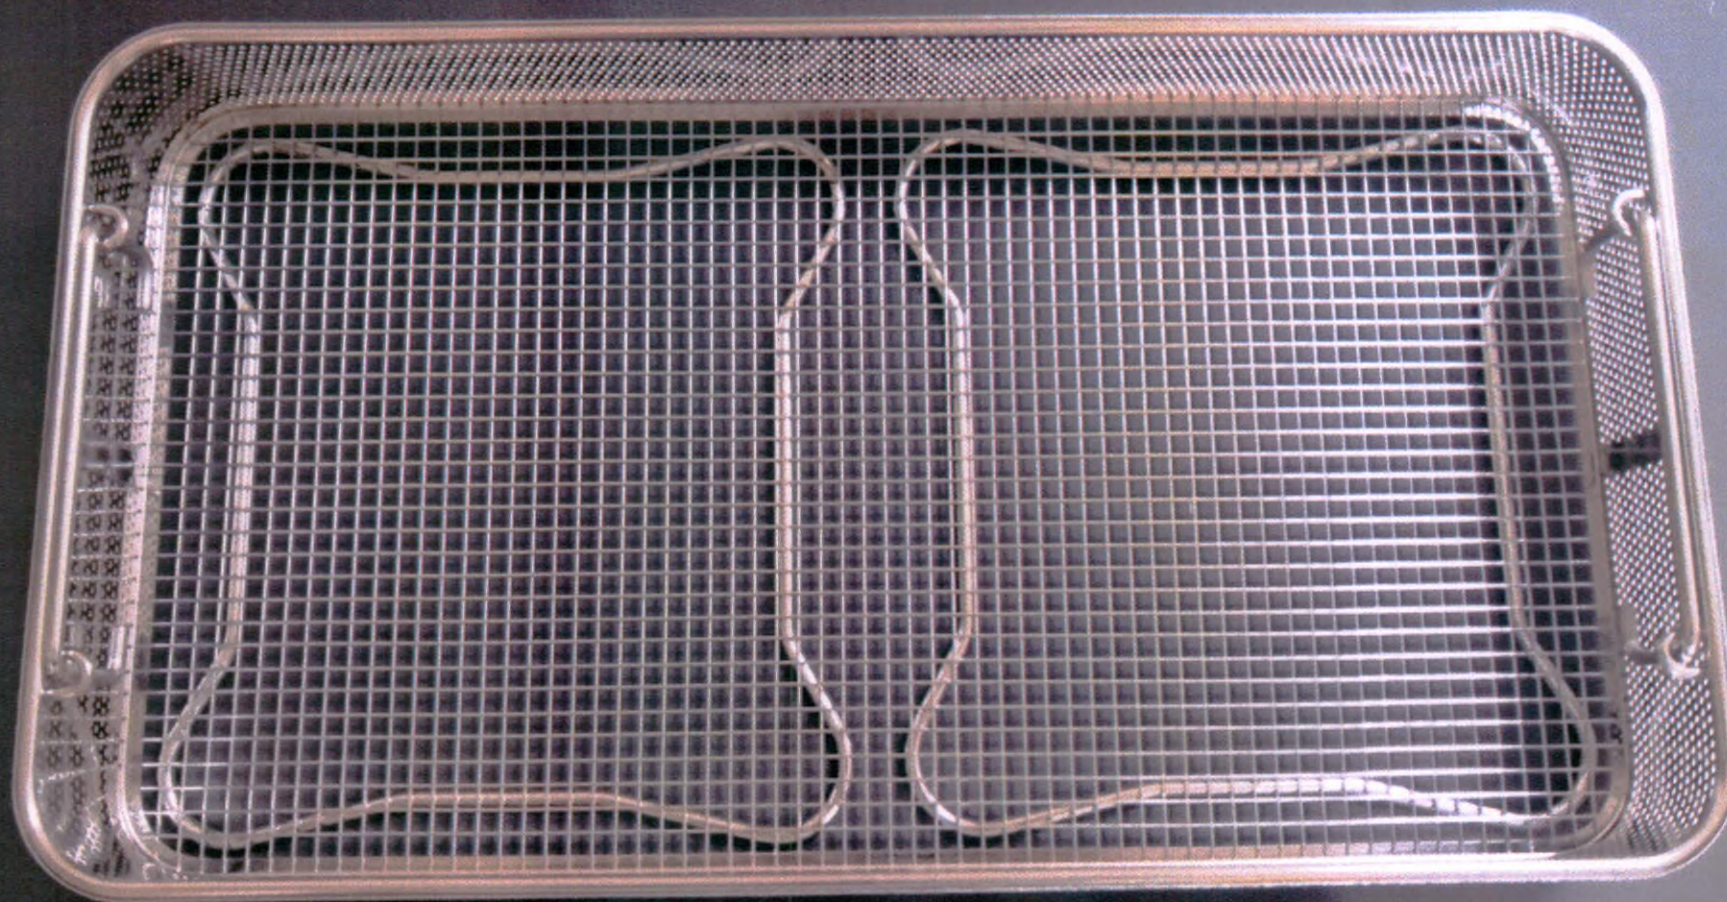


Рис. 95. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 480 x 250 x 66 мм

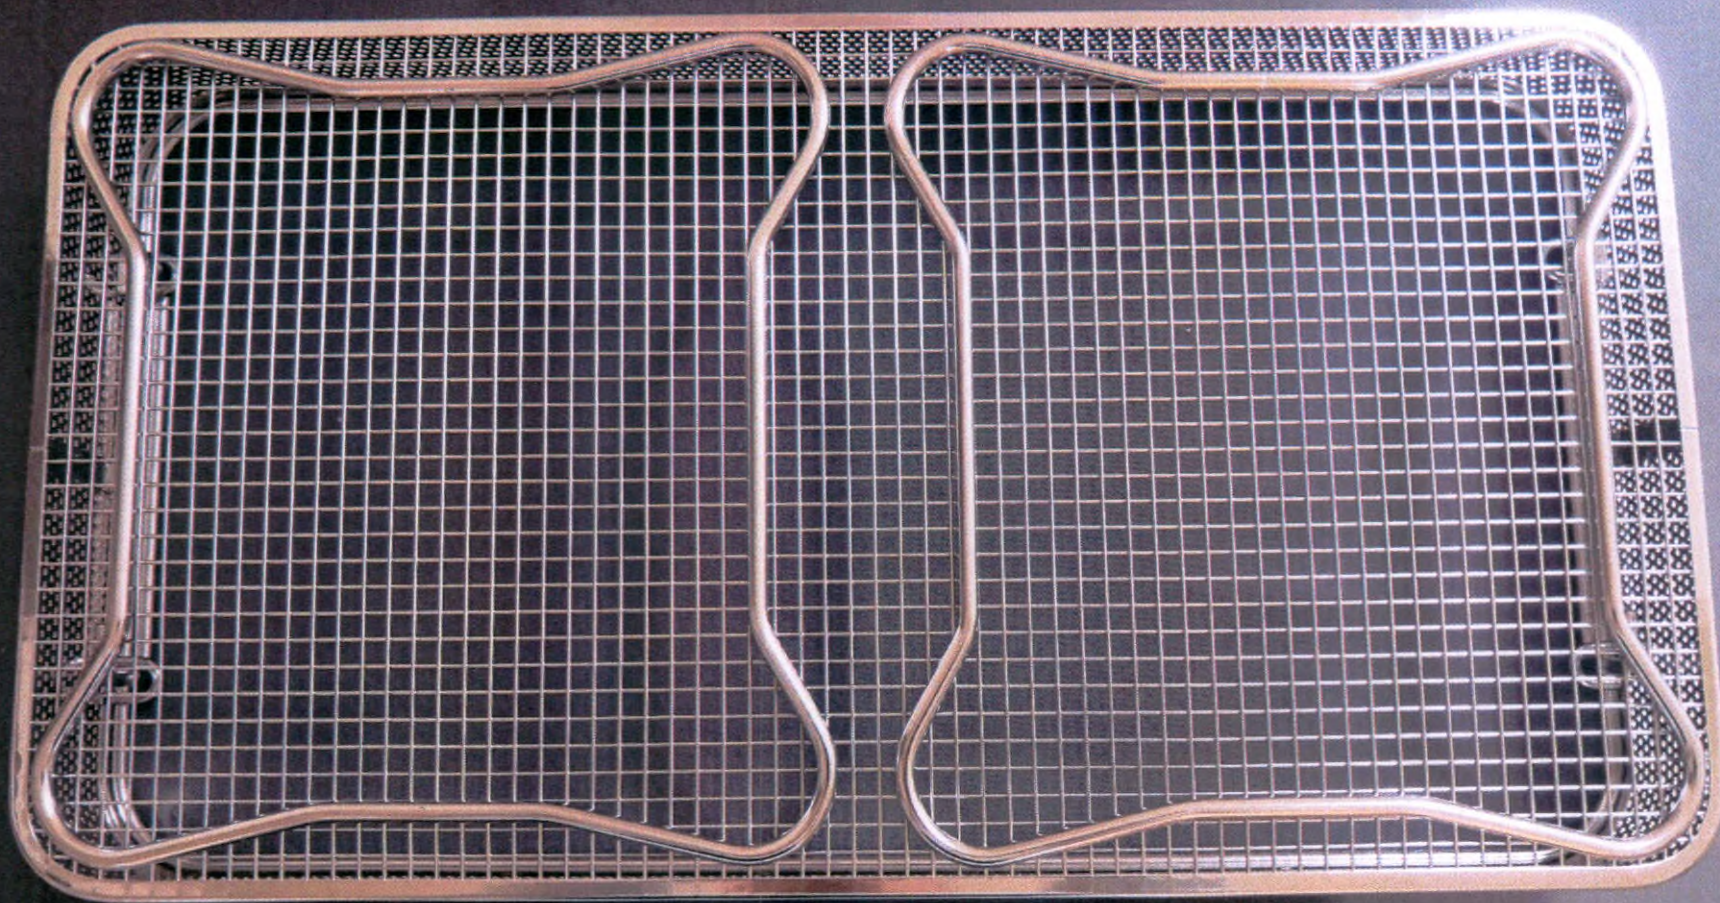


Рис. 96. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 480 x 250 x 66 мм



Рис. 97. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 352 x 125 x 54 мм. Упаковка.



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ – ENDOSKOPPE

LOT NP01

REF 39501AL

QTY 1

de Siebkorb für Tele-/Strobo-Laryngoskope
en Wire Tray for Tele-/Strobo-Laryngoscopes
fr Panier pour télé-/strobo-laryngoscopes
it Cestello perforato per laringoscopi
es Bandeja quir. tele/estrobolaringoscopia
pt Cesto aramado p/ tele/estrobolaringosc.

020002



Rx only

MD



2020-01-01



www.karlstorz.com/ifu

UDI (01)04048551157633(11)200101(10)NP01(422)276



Рис. 98. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 352 x 125 x 54 мм. Маркировка на упаковке.



Рис. 99. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 352 x 125 x 54 мм

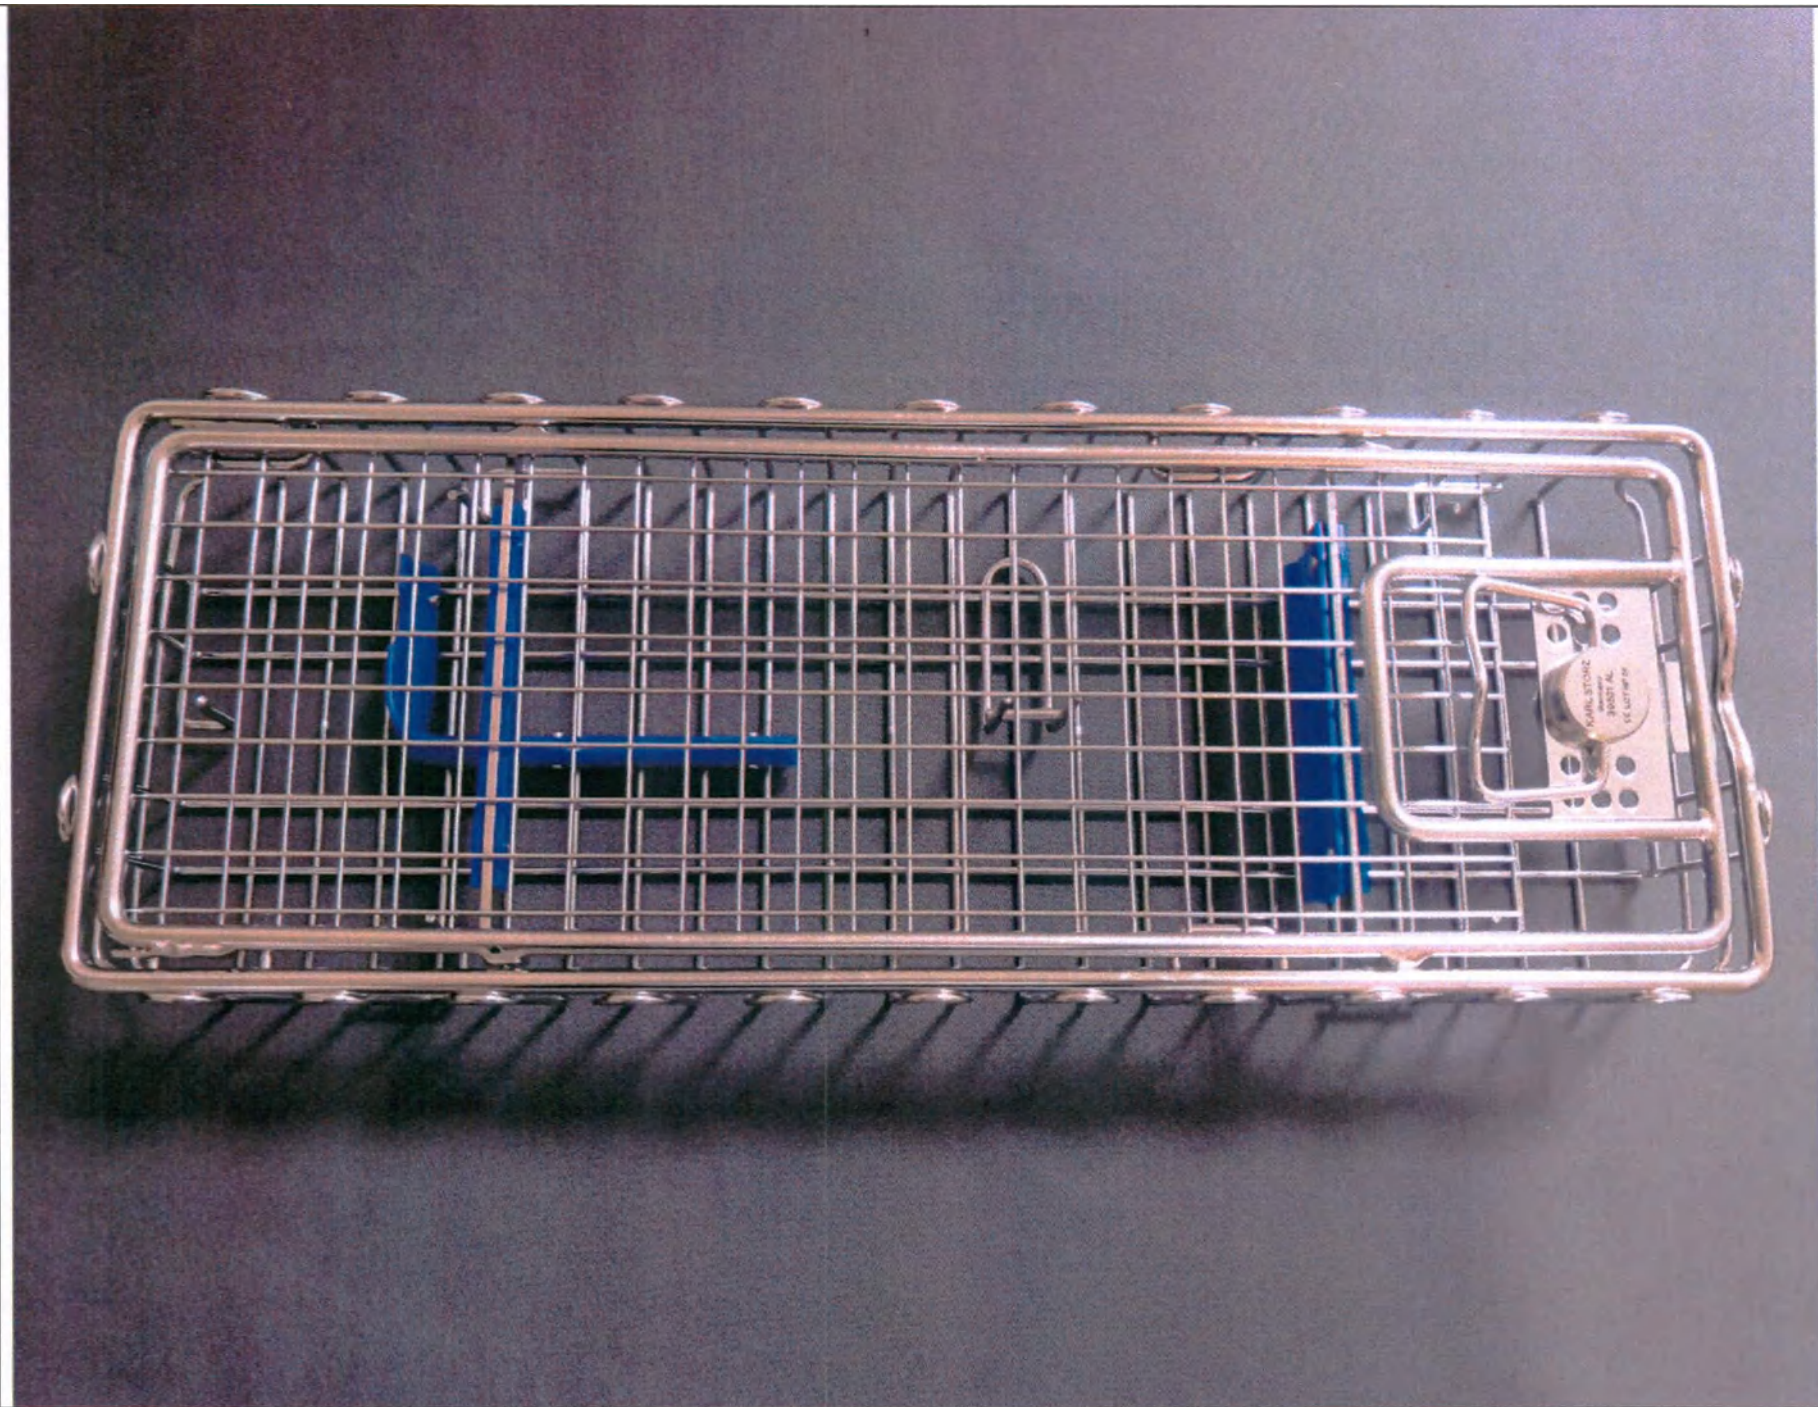


Рис. 100. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 352 x 125 x 54 мм



Рис. 101. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 352 x 125 x 54 мм

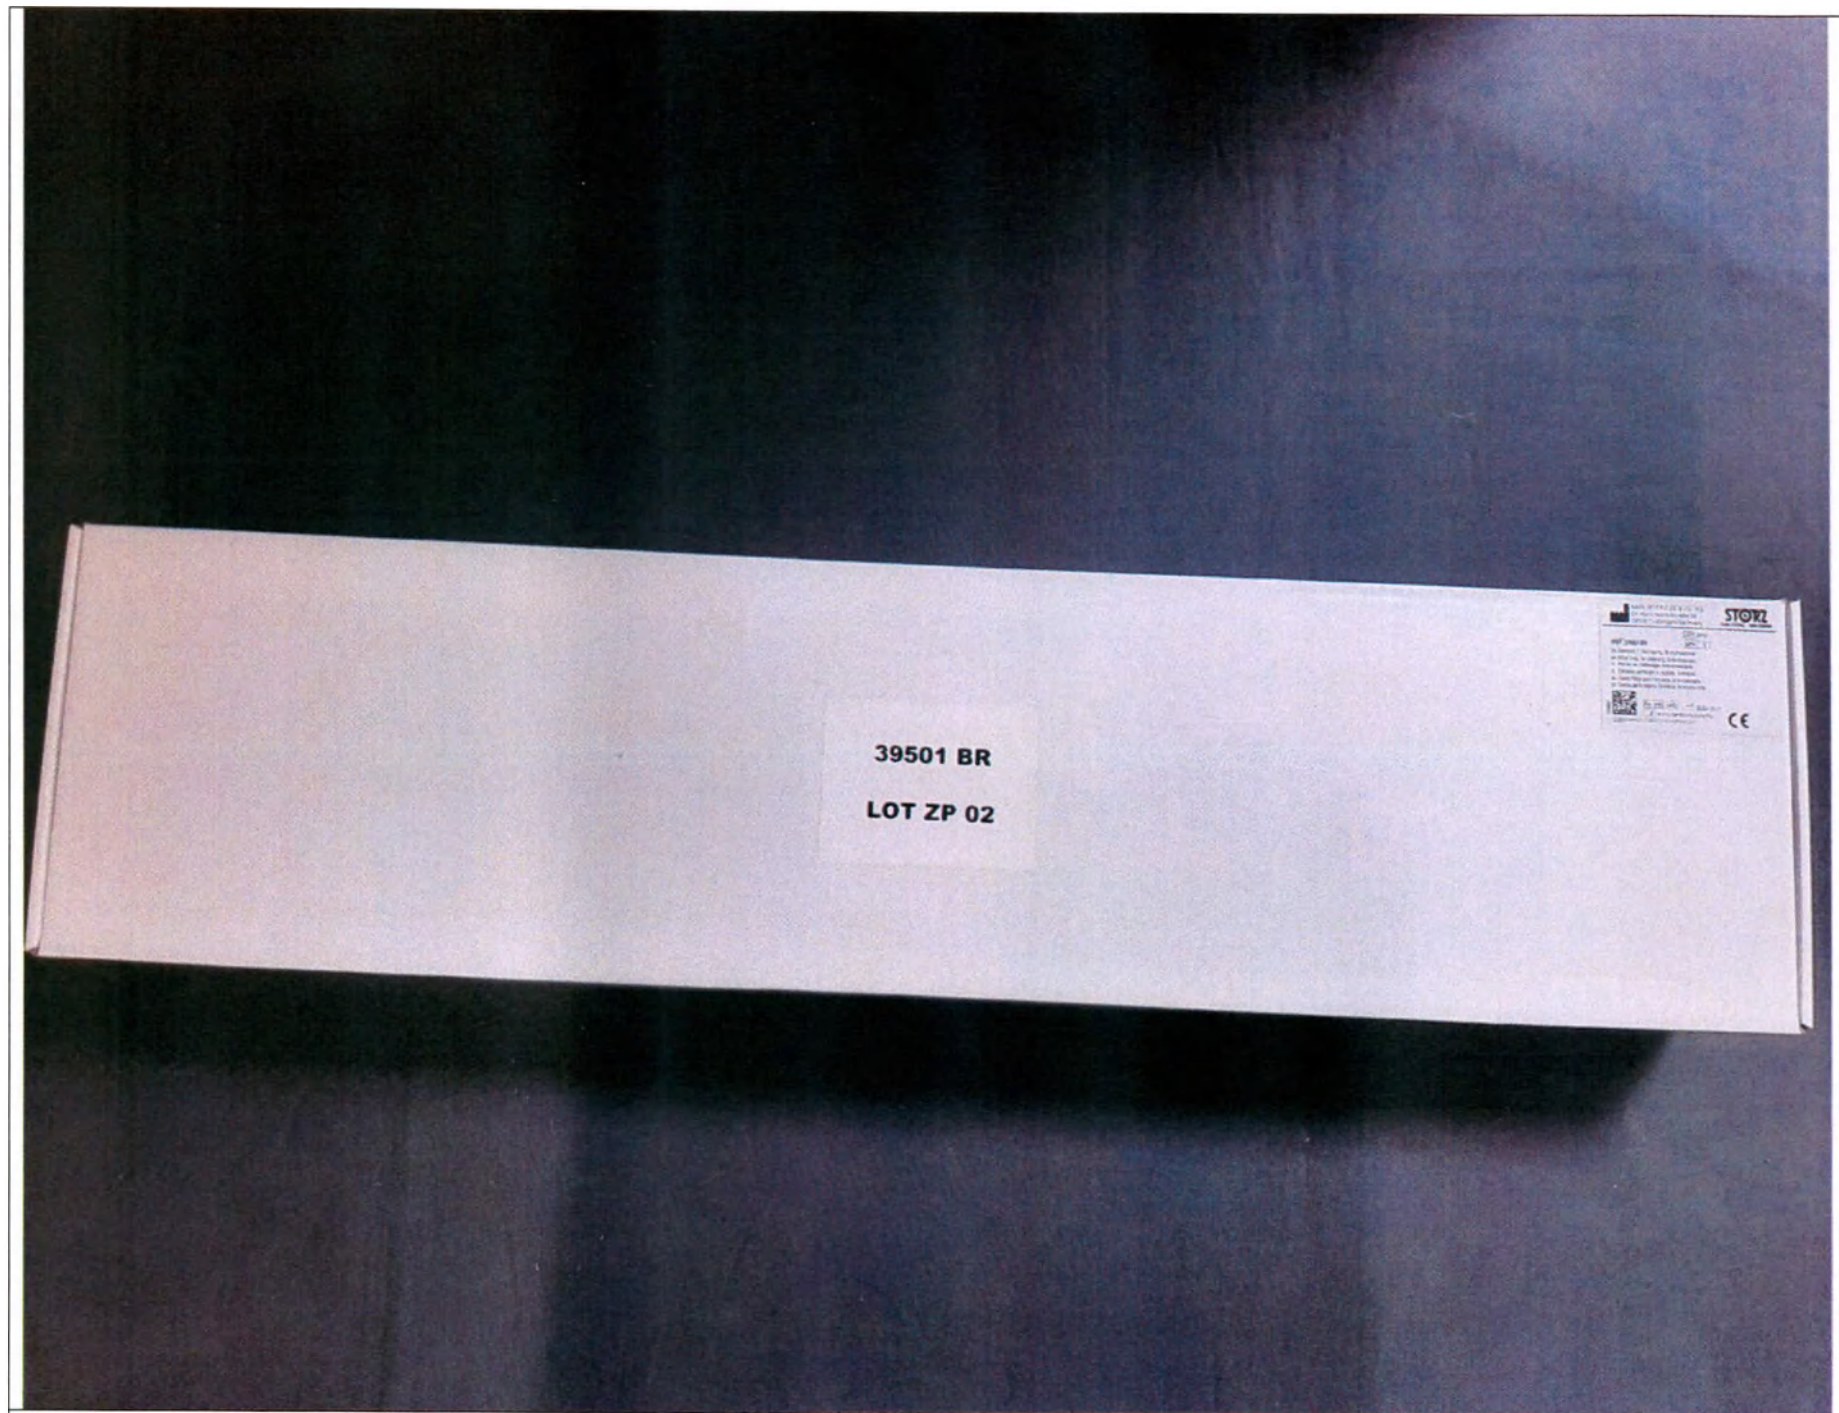


Рис. 102. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 622 x 150 x 78 мм. Упаковка.



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ — ENDOSCOPE

LOT ZP02

REF 39501BR

QTY 1

de Siebkorb f. Reinigung, Bronchoskopie
en Wire Tray, for cleaning, bronchoscopy
fr Panier de nettoyage, bronchoscopie
it Cestello perforato p. pulizia, broncosc.
es Cesto filtro para limpieza, broncoscopia
pt Cesta perfurada p/ limpeza, broncoscopia

020002



Rx only

MD



2020-12-01



www.karlstorz.com/ifu

UDI (01)04048551157664(11)201201(10)ZP02(422)276

CE

Рис. 103. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 622 x 150 x 78 мм. Маркировка на упаковке.

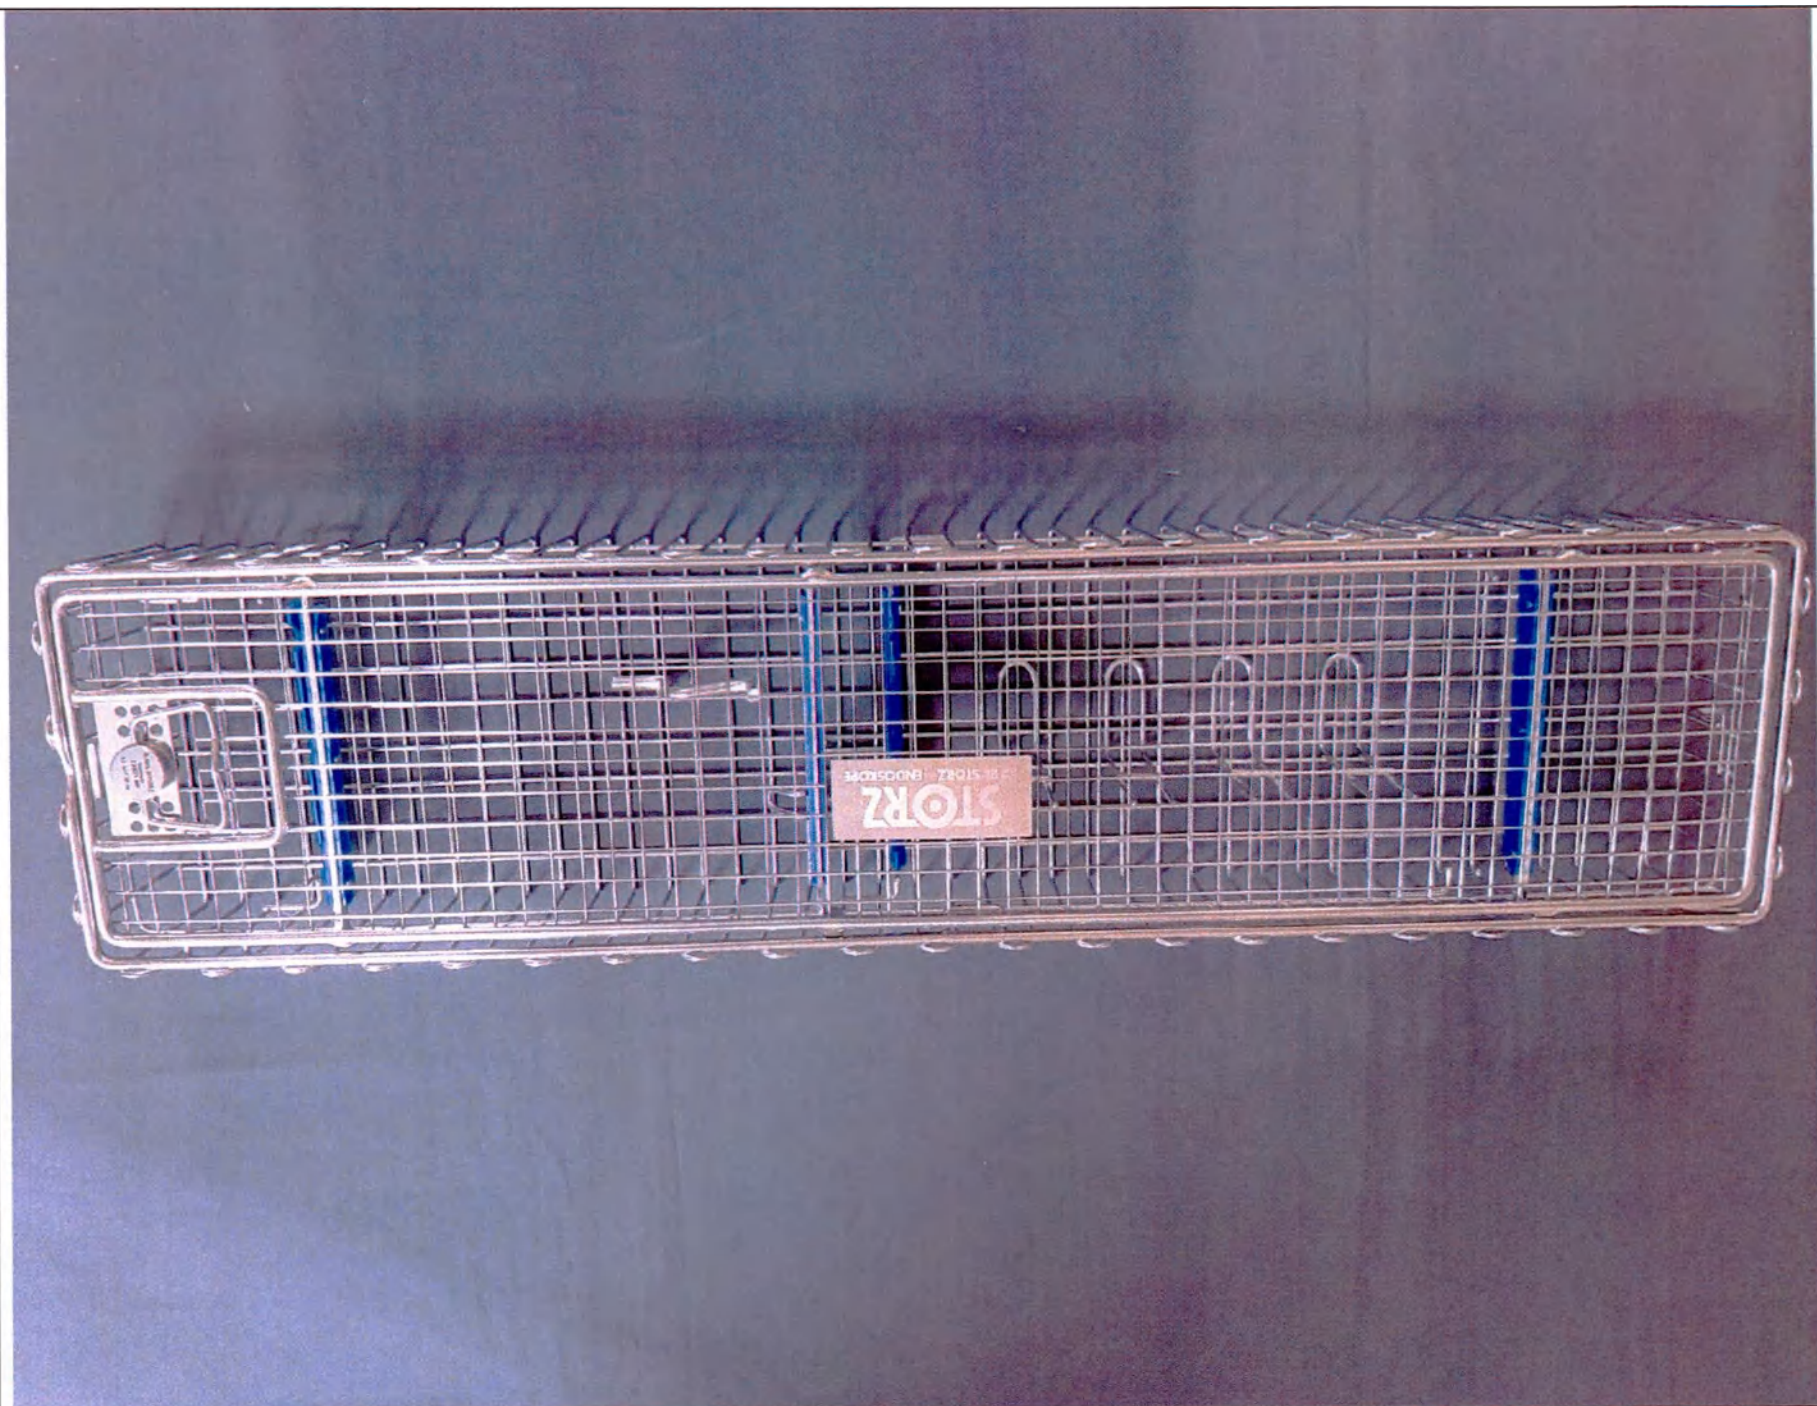


Рис. 104. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 622 x 150 x 78 мм.



Рис. 105. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 622 x 150 x 78 мм.

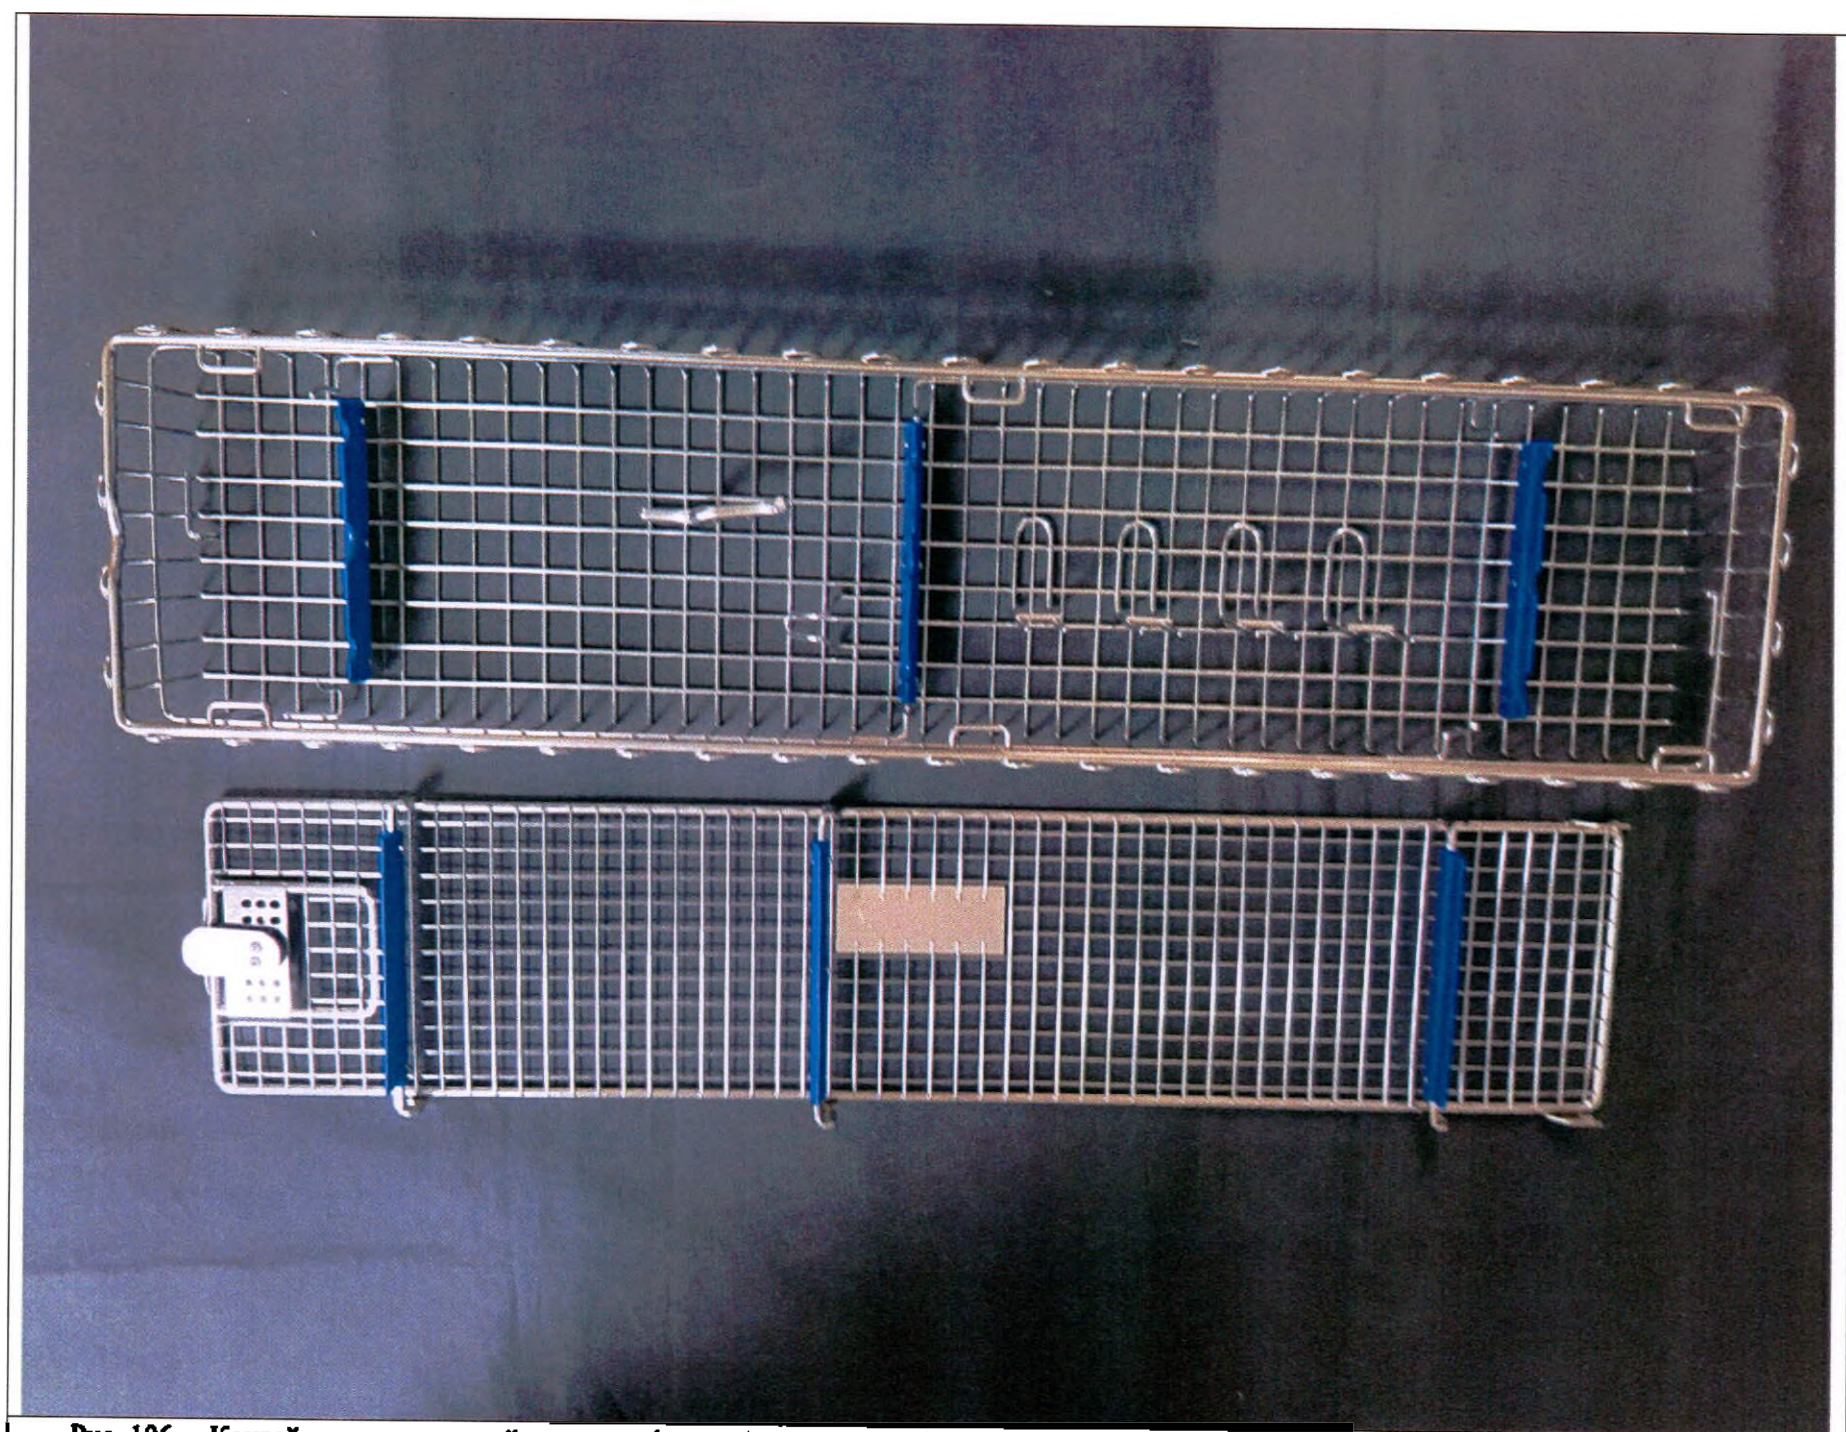


Рис. 106. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 622 x 150 x 78 мм.

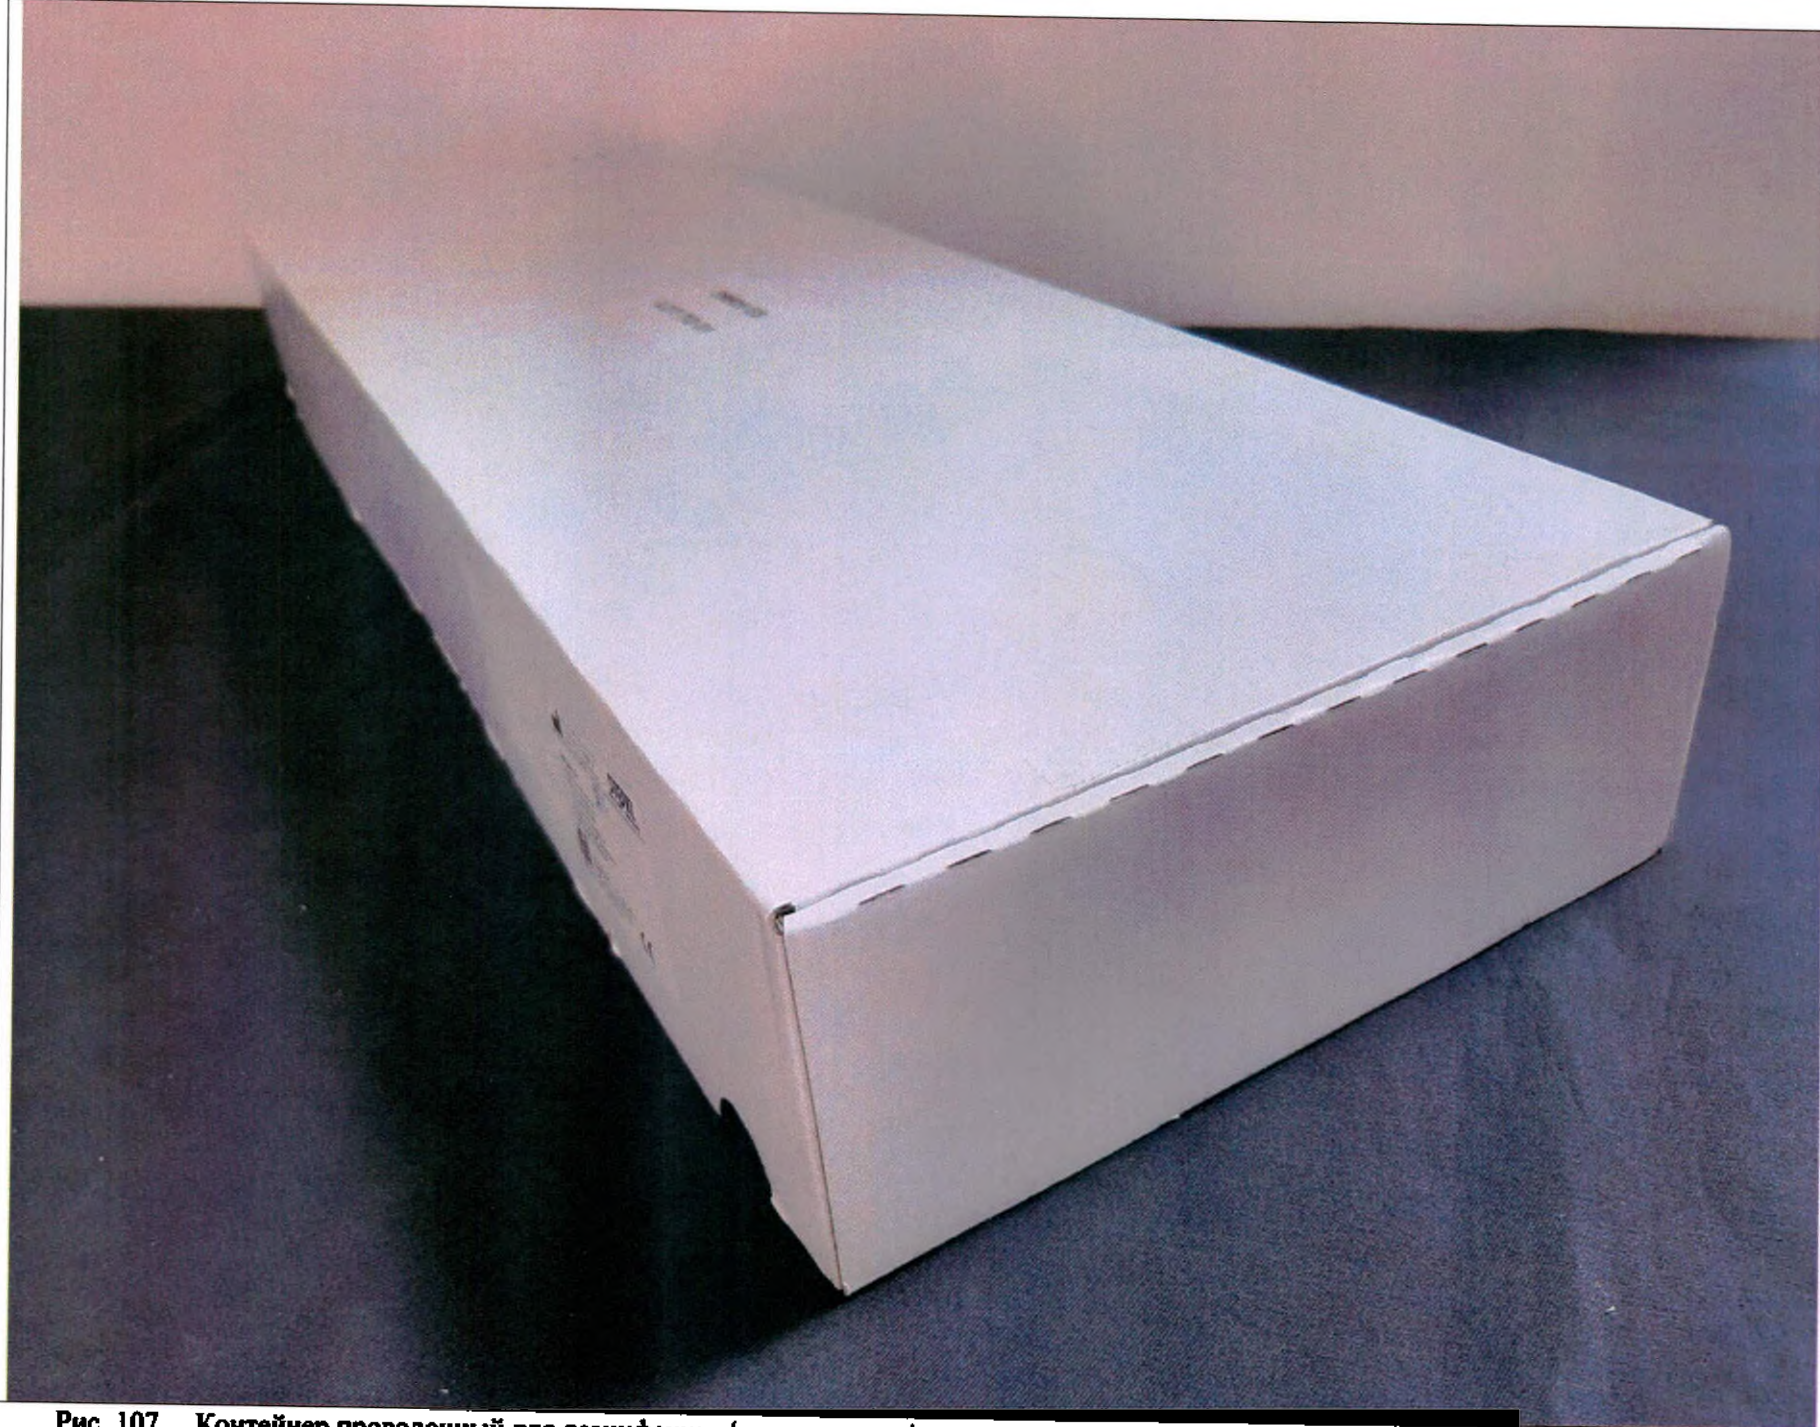


Рис. 107. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 640 x 216 x 78 мм. Упаковка.

 **KARL STORZ SE & Co. KG**
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE

LOT T001

QTY 1

REF 39501ES

de Siebkorb, Oesophagoskopie
en Wire Tray, Esophagoscopia
fr Panier, oesophagoscopia
it Cestello perforato, esofagoscopia
es Bandeja quirúrgica perf., esofagoscopia
pt Cesto aramado, esofagoscopia



Rx only

MD



2021-06-01



www.karlstorz.com/ifu

CE

UDI(01)04048551157688(11)210601(10)T001(422)276

Рис. 108. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 640 x 216 x 78 мм. Маркировка на упаковке.



Рис. 109. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 640 x 216 x 78 мм.



Рис. 110. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 640 x 216 x 78 мм.



Рис. 111. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 640 x 216 x 78 мм.



Рис. 112. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 460 x 80 x 52 мм. Упаковка.



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ – ENDOSKOPE

LOT 0001

REF 39501BAE

QTY 1

de Siebkorb f. Reinigung, 460x80x52mm
en Wire Tray f. Cleaning, 460x80x52mm
fr Panier de nettoyage, 460x80x52mm
it Cestello perforato p pulizia, 460x80x52mm
es Cesto filtro p. limpieza, 460x80x52mm
pt Cesta perfurada p/ limpeza, 460x80x52mm



020002

Rx only


MD



2021-02-01



www.karlstorz.com/ifu



UDI 0110404855130958211102102011000014221276

Рис. 113. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 460 x 80 x 52 мм. Маркировка на упаковке.



Рис. 114. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 460 x 80 x 52 мм

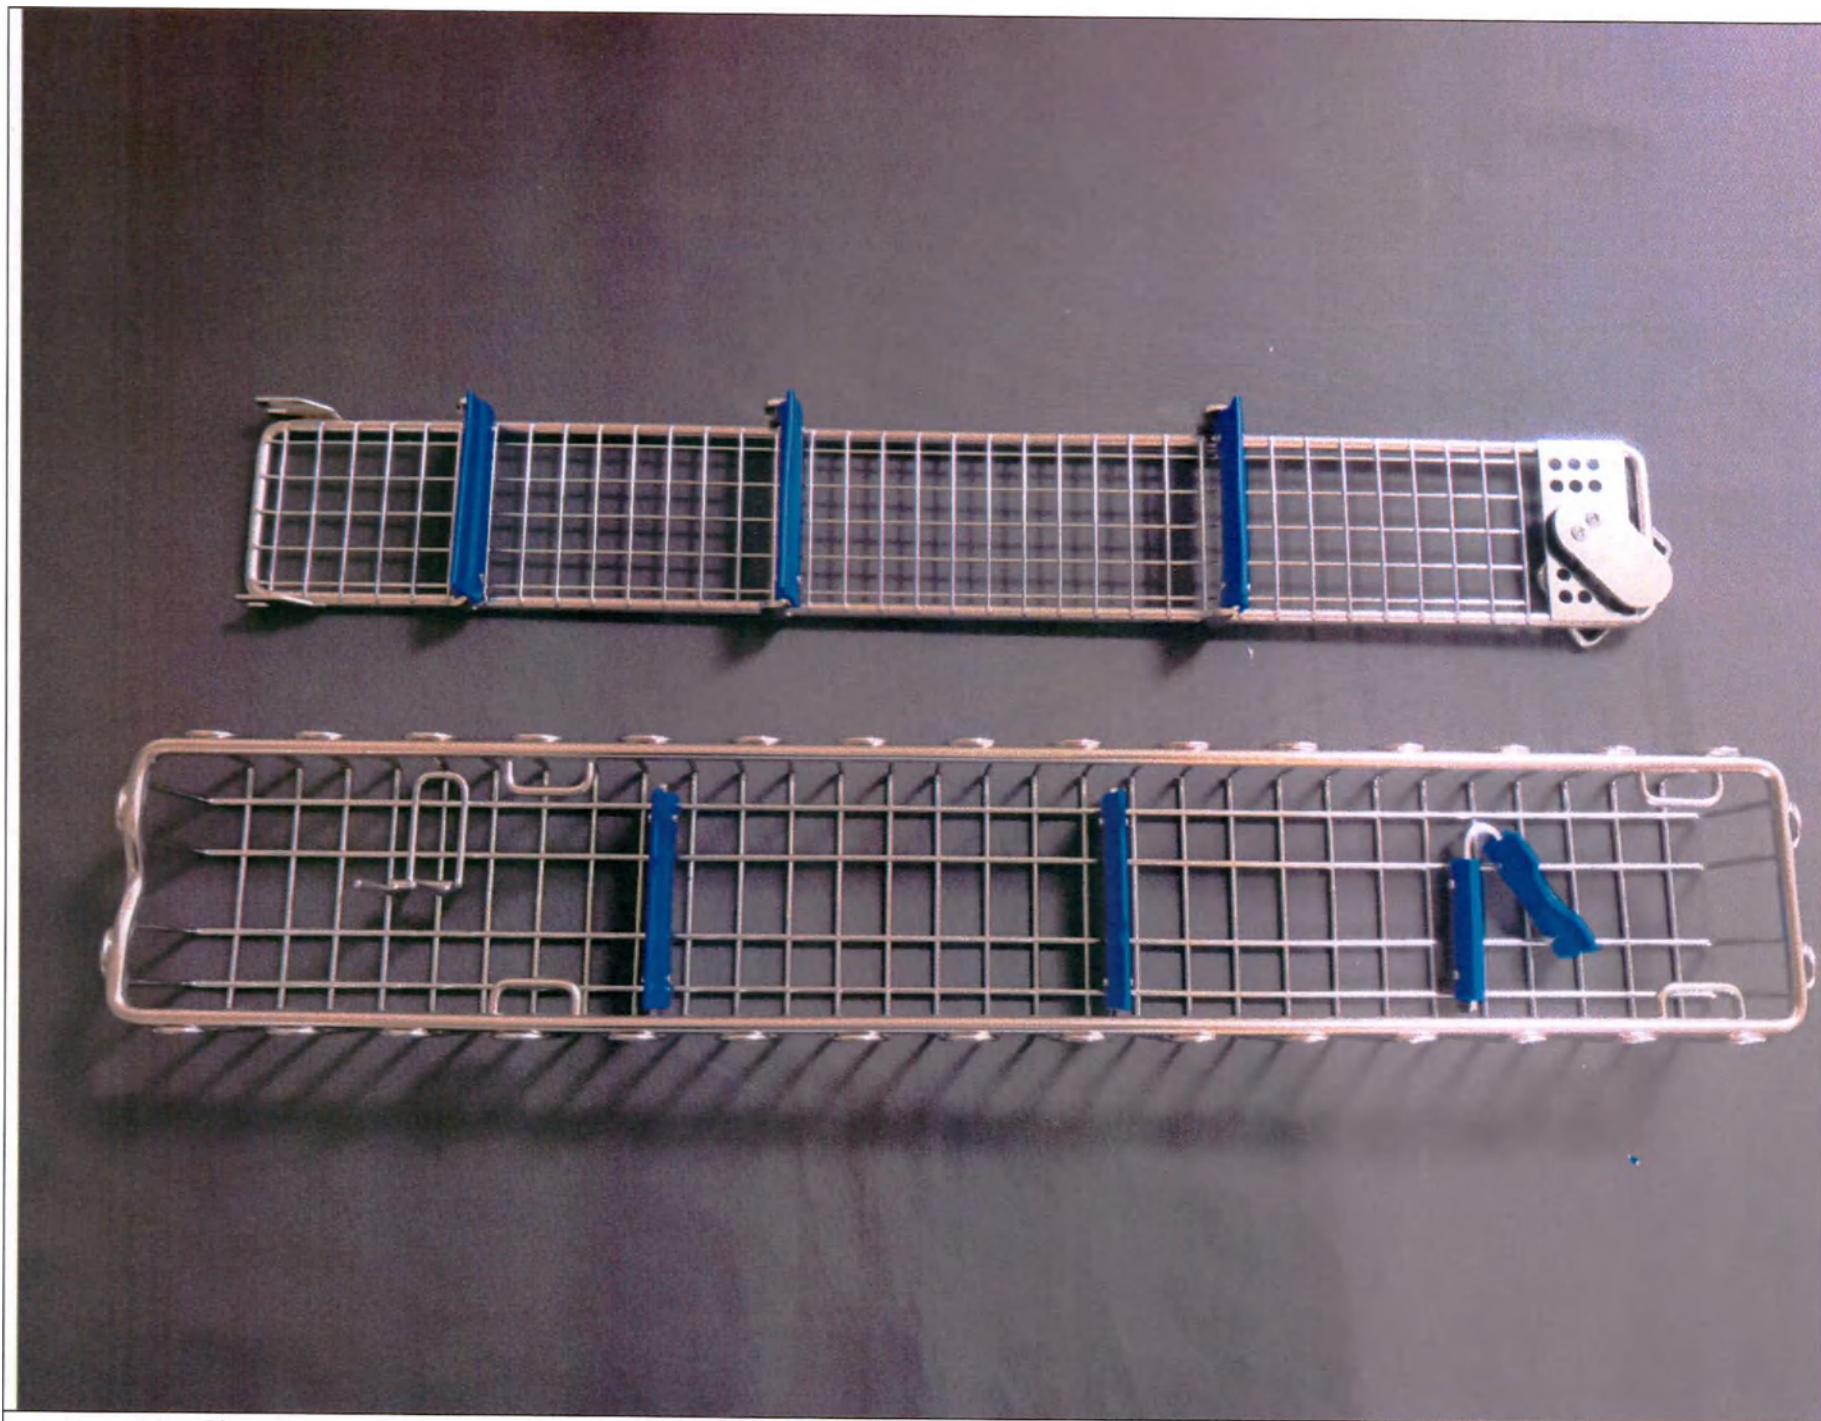


Рис. 115. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 460 x 80 x 52 мм



Рис. 116. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 460 x 80 x 52 мм

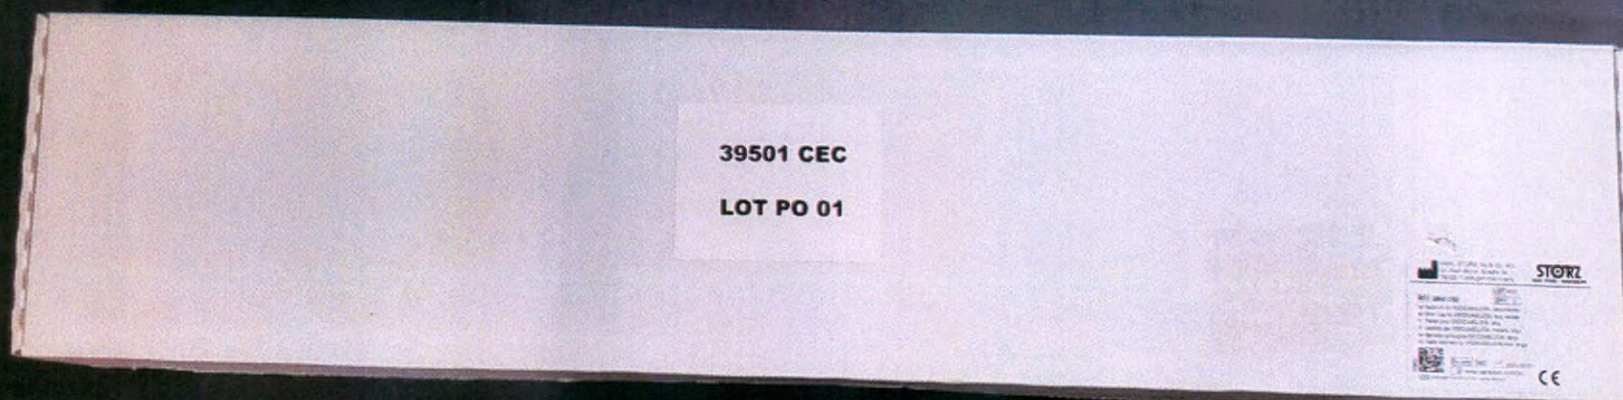


Рис. 117. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 604 x 125 x 54 мм. Упаковка.



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ – ENDOSKOPE


LOT P001

REF 39501CEC

QTY 1

de Siebkorb für ENDOCAMELEON, Lang-Version
en Wire Tray for ENDOCAMELEON, long version
fr Panier pour ENDOCAMELEON, long
it Cestello per ENDOCAMELEON, modello lungo
es Bandeja quirúrgica ENDOCAMELEON, larga
pt Cesto aramado p/ ENDOCAMELEON, mod. longo

020002



Rx only

MD



2021-03-01



www.karlstorz.com/ifu

UDI (01)04048551254158(11)210301(10)P001(422)276

CE

Рис. 118. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 604 x 125 x 54 мм. Маркировка на упаковке.

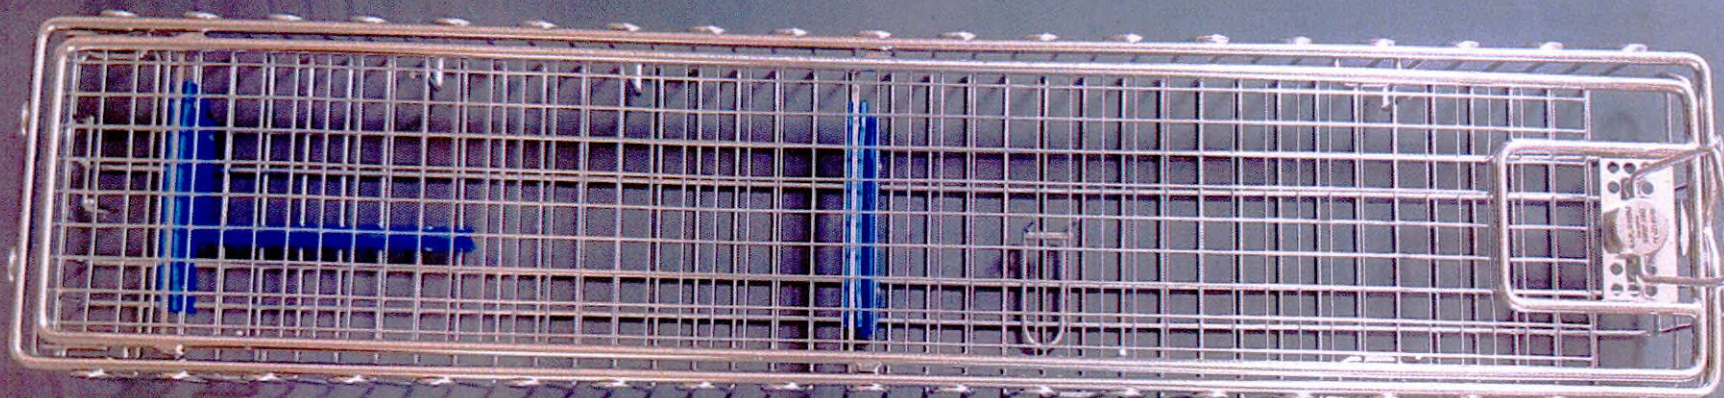


Рис. 119. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 604 x 125 x 54 мм.



Рис. 120. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 604 x 125 x 54 мм.

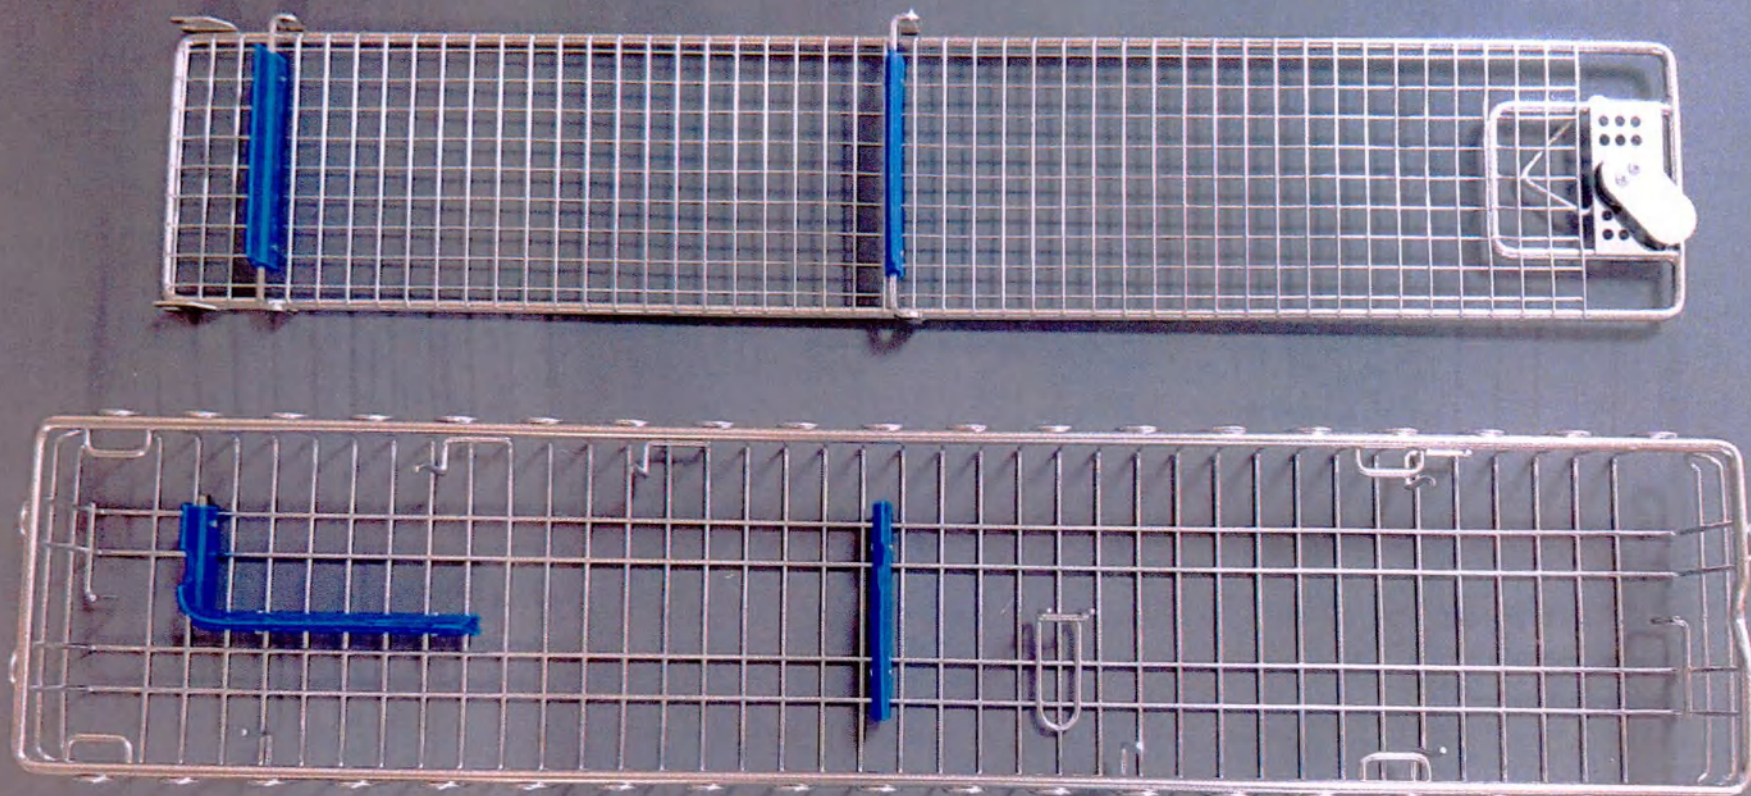


Рис. 121. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 604 x 125 x 54 мм.

8575AV

STORZ
KARL STORZ – ENDOSKOP

Ларингофарингоскоп жесткий HOPKINS в вариантах исполнения с принадлежностями.

Ларингофарингоскоп жесткий HOPKINS с угловым окуляром, направление наблюдения 15°, диаметр 4 мм, длина 17 см

РУ № _____ ОТ _____

Информация о сроке службы – см. инструкцию по эксплуатации

Производитель KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532
Tuttlingen / Germany (Германия)

Уполномоченный представитель на территории РФ Общество с ограниченной ответственностью
КАРЛ ШТОРЦ – Эндоскопы ВОСТОК
(ООО КШТЭ ВОСТОК)
Россия, 115114, г. Москва,
Дербеневская набережная, 7, стр. 4

Рис. 122. Пример макета русскоязычной маркировки, на примере варианта исполнения: Ларингофарингоскоп жесткий HOPKINS с угловым окуляром, типоразмер: направление наблюдения 15°, диаметр 4 мм, длина 17 см.

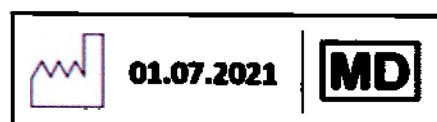


Рис. 123. Пример стикера с символами «Медицинское изделие» и «Дата изготовления», которыми дополняется маркировка изделия



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 124
_____ листах

