

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Компания Совтех»




О.Е. Кондрашова

« 26 » октября 2022 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
ОБЩЕГО ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАЛИВОЧНЫЕ ФОРМЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ**


ТУ 32.50.50-010-48072026-2021

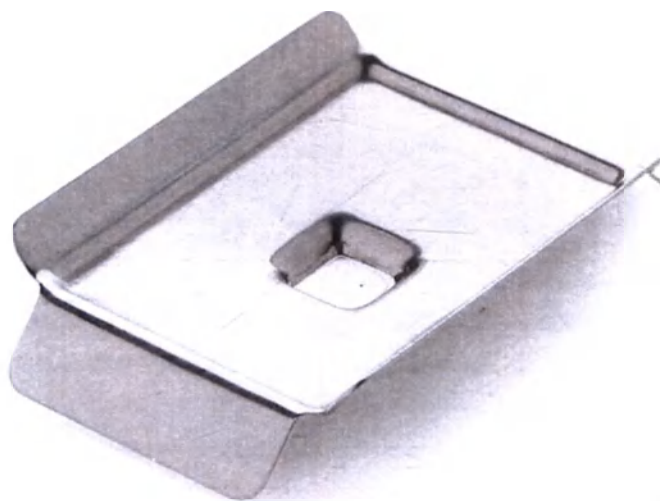

Заливочная форма (вид 1)




Заливочная форма (вид 2)

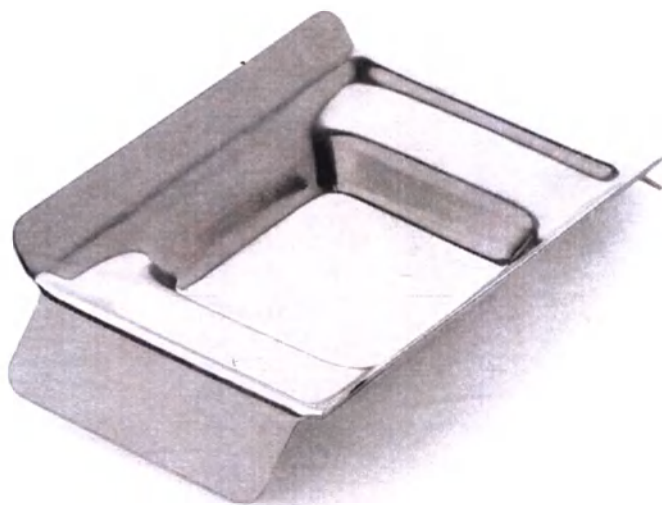

Заливочная форма (вид 3)



Заливочная форма (вид 4)

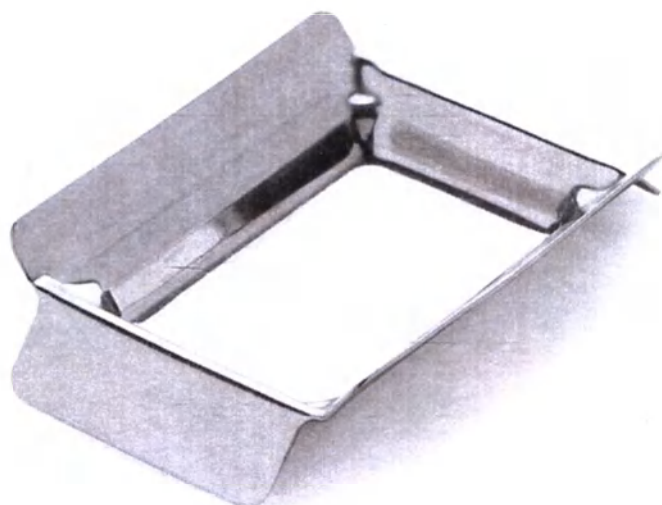

Заливочная форма (вид 5)

WWW.SOVTEH2012.RU

Гистологические заливочные формы из нержавеющей
стали ТУ 32.50.50-010-48072026-2021

Заливочная форма (вид 1)

ПУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX

 ООО «Компания Совтех»
633009, Новосибирская область, Г.О. город Бердск,
г. Бердск, ул. Звездная, д. 4, кв. 43

 06.2021  06.2026

 010621 Количество: 10 шт.

Хранить при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С
и относительной влажности воздуха до 90%. Нестерильно.



www.sovteh2012.ru

SOVTECH
расходные материалы для лабораторий



SOVTECH
расходные материалы для лабораторий

Заливочная форма (вид 1)

Лист 3 из 8



Заливочная форма (вид 2)

WWW.SOVTEH2012.RU

Гистологические заливочные формы из нержавеющей
стали ТУ 32.50.50-010-48072026-2021

Заливочная форма (вид 3)

ПУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX

 ООО «Компания Совтех»
633009, Новосибирская область, Г.О. город Бердск,
г. Бердск, ул. Звездная, д. 4, кв. 48

 06.2021  06.2026

 010621 Количество: 10 шт.

Хранить при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С
и относительной влажности воздуха до 90%. Нестерильно.



www.sovtech2012.ru

SOVTECH
расходные материалы для лабораторий



SOVTECH
расходные материалы для лабораторий

Заливочная форма (вид 3)

Лист 5 из 8

WWW.SOVTEH2012.RU

Гистологические заливочные формы из нержавеющей
стали ТУ 32.50.50-010-48072026-2021

Заливочная форма (вид 4)

ПУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «Компания Совтех»
633009, Новосибирская область, Г.О. город Бердск,
г. Бердск, ул. Звездная, д. 4, кв. 48



06.2021




06.2026



LOT 010621 Количество: 10 шт.

Хранить при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С
и относительной влажности воздуха до 90%. Нестерильно.



www.sovteh2012.ru

SOVTECH
расходные материалы для лабораторий



SOVTECH
расходные материалы для лабораторий

Заливочная форма (вид 4)

Лист 6 из 8

WWW.SOVTEH2012.RU

Гистологические заливочные формы из нержавеющей
стали ТУ 32.50.50-010-48072026-2021

Заливочная форма (вид 5)

ПУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX

 ООО «Компания Совтех»
633009, Новосибирская область, Г.О. город Бердск,
г. Бердск, ул. Звездная, д. 4, кв. 48

 06.2021  06.2026

 010621 Количество: 10 шт.

Хранить при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С
и относительной влажности воздуха до 90%. Нестерильно.



www.sovteh2012.ru


SOVTECH
расходные материалы для лабораторий



SOVTECH
расходные материалы для лабораторий

Заливочная форма (вид 5)

Лист 7 из 8

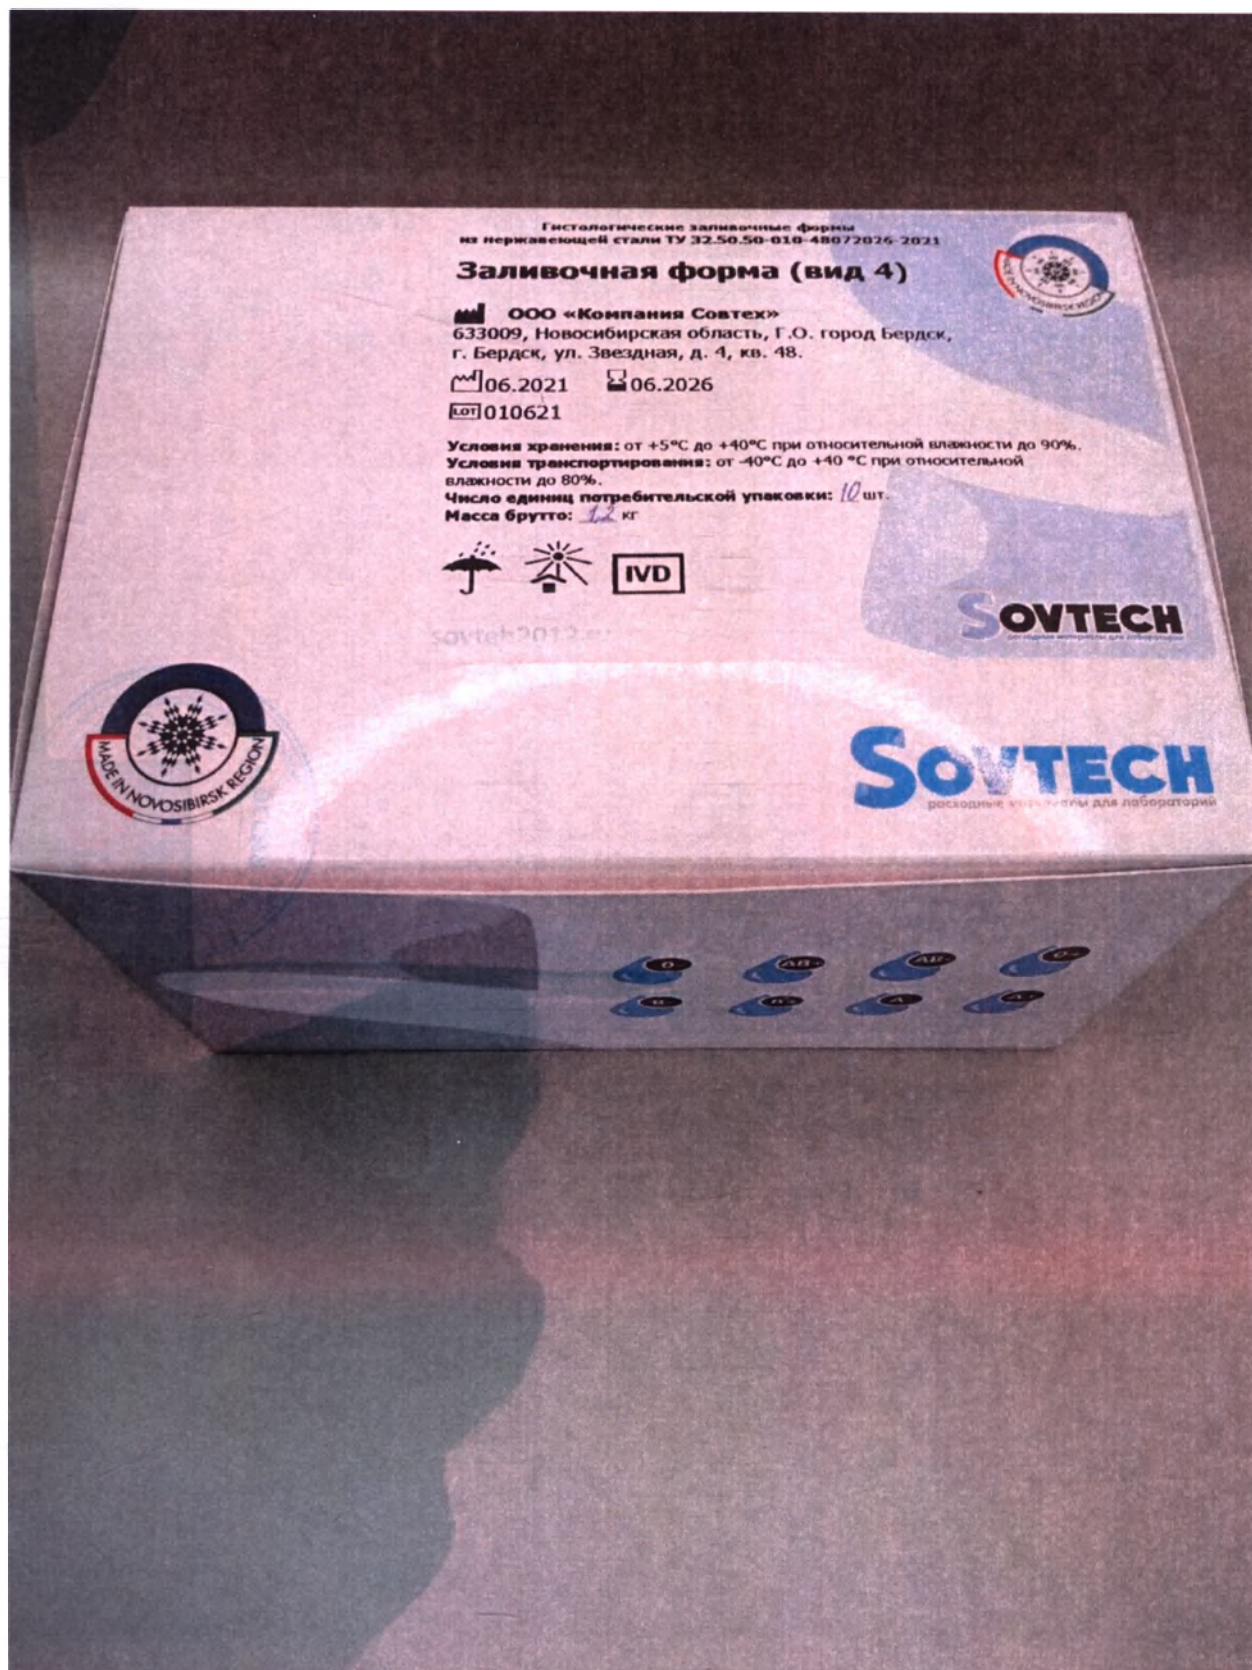

Заливочная форма (вид 4)

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью на 8 (восемь) листах
Директор ООО «Компания Совтех»

 О.Е. Кондрашова



УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Компания Совтех»



О.Е. Кондрашова

«26» сентября 2022 г.

ОБРАЗЦЫ МАРКИРОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАЛИВОЧНЫЕ ФОРМЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ТУ 32.50.50-010-48072026-2021

1. Маркировка потребительской этикетки медицинского изделия

Гистологические заливочные формы из нержавеющей стали ТУ 32.50.50-010-48072026-2021

Заливочная форма (вид 1)

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX

 ООО «Компания Совтех»
633009, Новосибирская область, Г.О. город Бердск,
г. Бердск, ул. Звездная, д. 4, кв. 48

 ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ

 XXMMГГ Количество: XX шт.

Хранить при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С
и относительной влажности воздуха до 90%. Нестерильно.

Гистологические заливочные формы из нержавеющей стали ТУ 32.50.50-010-48072026-2021

Заливочная форма (вид 2)

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX

 ООО «Компания Совтех»
633009, Новосибирская область, Г.О. город Бердск,
г. Бердск, ул. Звездная, д. 4, кв. 48

 ММ.ГГГГ  ММ.ГГГГ

 XXMMГГ Количество: XX шт.

Хранить при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С
и относительной влажности воздуха до 90%. Нестерильно.

Примечание: на маркировке указывается вместо X – символ (может быть удален или добавлен со смещением последующего на строке текста), ММ – месяц, ГГГГ и ГГ – год. Горизонтальное и вертикальное смещение маркировки относительно границ этикетки не

Гистологические заливочные формы из нержавеющей стали ТУ 32.50.50-010-48072026-2021

Заливочная форма (вид 3)

РУ № XXXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «Компания Совтех»

633009, Новосибирская область, Г.О. город Бердск,
г. Бердск, ул. Звездная, д. 4, кв. 48



ММ.ГГГГ



ММ.ГГГГ



XXMMГГ Количество: XX шт.

Хранить при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С
и относительной влажности воздуха до 90%. Нестерильно.



Гистологические заливочные формы из нержавеющей стали ТУ 32.50.50-010-48072026-2021

Заливочная форма (вид 4)

РУ № XXXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «Компания Совтех»

633009, Новосибирская область, Г.О. город Бердск,
г. Бердск, ул. Звездная, д. 4, кв. 48



ММ.ГГГГ



ММ.ГГГГ



XXMMГГ Количество: XX шт.

Хранить при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С
и относительной влажности воздуха до 90%. Нестерильно.



Гистологические заливочные формы из нержавеющей стали ТУ 32.50.50-010-48072026-2021

Заливочная форма (вид 5)

РУ № XXXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «Компания Совтех»

633009, Новосибирская область, Г.О. город Бердск,
г. Бердск, ул. Звездная, д. 4, кв. 48



ММ.ГГГГ



ММ.ГГГГ



XXMMГГ Количество: XX шт.

Хранить при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С
и относительной влажности воздуха до 90%. Нестерильно.



Примечание: на маркировке указывается вместо X – символ (может быть удален или добавлен со смещением последующего на строке текста), ММ – месяц, ГГГГ и ГГ – год. Горизонтальное и вертикальное смещение маркировки относительно границ этикетки не нормировано.

2. Маркировка транспортной (групповой) этикетки медицинского изделия

Гистологические заливочные формы
из нержавеющей стали ТУ 32.50.50-010-48072026-2021

Заливочная форма (вид Y)



ООО «Компания Совтех»

633009, Новосибирская область, Г.О. город Бердск,
г. Бердск, ул. Звездная, д. 4, кв. 48.



ММ.ГГГГ



ММ.ГГГГ



XXMMГГ

Условия хранения: от +5°C до +40°C при относительной влажности до 90%.

Условия транспортирования: от -40°C до +40 °C при относительной влажности до 80%.

Число единиц потребительской упаковки: XX шт.

Масса брутто: XXXX кг



Примечание: где Y – 1/ 2/ 3/ 4/ 5.

Значения в **Число единиц потребительской упаковки** и **Масса брутто** допускается указывать от руки или с помощью клише. Расположение информации и символов не нормировано. Расположение манипуляционных знаков должно соответствовать ГОСТ 14192.

3. Этикетка медицинского изделия

Указанная в настоящем документе маркировка печатается на этикетке без фона или с фоном. Примеры этикеток с фоном:



Примечание: на маркировке указывается вместо X – символ (может быть удален или добавлен со смещением последующего на строке текста), ММ – месяц, ГГГГ и ГГ – год. Горизонтальное и вертикальное смещение маркировки относительно границ этикетки не нормировано.

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью на 3 (*три*) листах
Директор ООО «Компания Совтех»

[Signature]
О.Е. Кондрашова

