

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «ИМБИАН»




МАКЕТ МАРКИРОВКИ


Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения белка трансферрина в образцах кала «Трансферрин-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-056-39271034-2023

2023 г.


1. Маркировка фольгированного пакета с тест-кассетой:

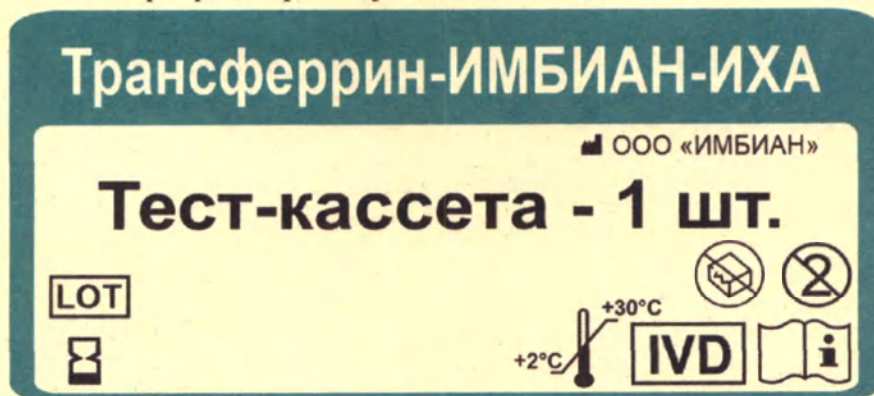

2. Маркировка буферного раствора, 1,0 мл (Комплект 1):

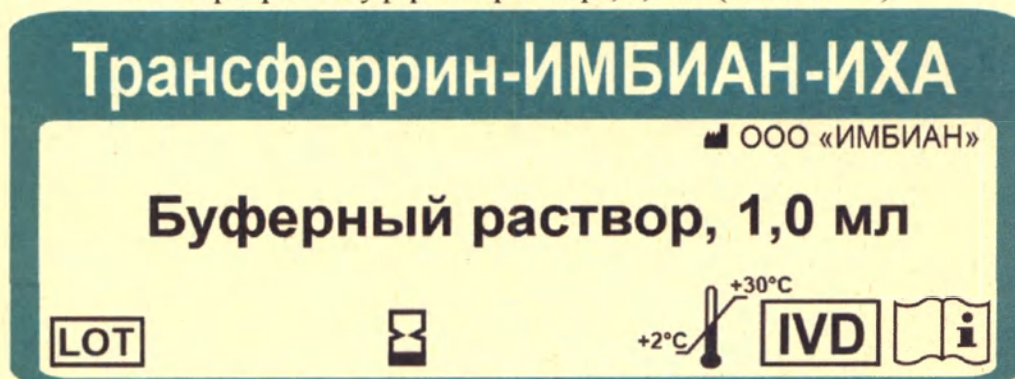

3. Маркировка буферного раствора, 1,0 мл (Комплект 2):

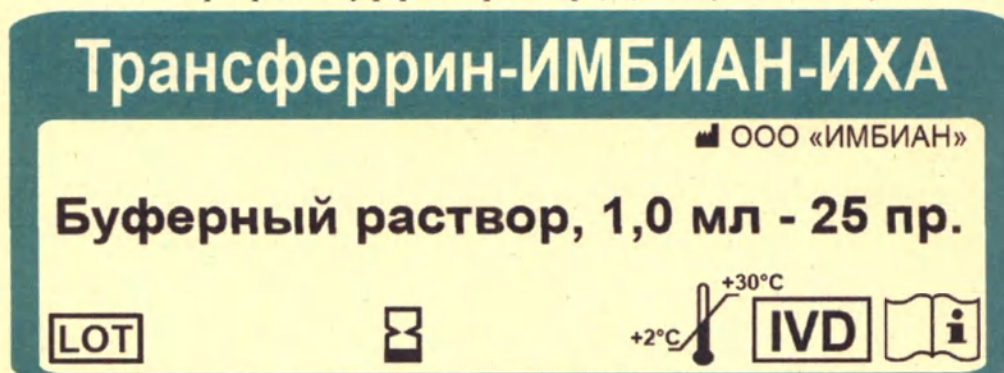

4. Наклейка для маркировки пробирки:

Label for the test tube. The label is rectangular with a dark blue border. At the top right, it contains the logo of "ООО «ИМБИАН»". Below this, there are three lines for text entry: "ФИО: _____", "№ образца: _____", and "Дата: _____".

5. Маркировка коробки (потребительской упаковки). Комплект 1:
сторона 1

Трансферрин-ИМБИАН-ИХА

Комплект № 1

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения белка трансферрина в образцах кала «Трансферрин-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-056-39271034-2023

- Тест-кассета 1 шт.
- Буферный раствор, 1,0 мл 1 пр.
- Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019: Пипетки для переноса жидкостей (Пастера), 0,25 мл (ПУ № РЗН 2019/8912) 1 шт.
- Инструкция по применению 1 шт.

ПУ № XXX XXXX/XXXXX Imbian

LOT	ГТММДД
REF	iBR-014/1
	ГТГ-ММ-ДД
	ГТГ-ММ-ДД

Замораживание не допускается.
Для профессионального применения.

+2°C

сторона 2

**ООО «ИМБИАН», 630554, Россия, Новосибирская область,
м.р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с. Барышево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1.
+7 (383) 209-34-54
www.imbian.ru
info@imbian.ru**

6. Маркировка коробки (потребительской упаковки). Комплект 2:
сторона 1

Трансферрин -ИМБИАН-ИХА

Комплект № 2

- Тест-кассета 25 шт.
- Буферный раствор, 1,0 мл 25 пр.
- Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019: Пипетки для переноса жидкостей (Пастера), 0,25 мл (РУ № РЗН 2019/8912) 25 шт.
- Наклейка для маркировки пробирки 25 шт.
- Инструкция по применению 1 шт.

Замораживание не допускается.
Для профессионального применения.

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения белка трансферрина в образцах кала
«Трансферрин-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-056-39271034-2023

РУ № XXX XXXX/XXXXX Imbian

LOT	ГГММДД
REF	iBR-014/2
	ГГГГ-ММ-ДД
	ГГГГ-ММ-ДД

+30°C
 25

сторона 2

ООО «ИМБИАН», 630554, Россия, Новосибирская область,
м.р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
с. Барышево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1.
+7 (383) 209-34-54
www.imbian.ru
info@imbian.ru

7. Маркировка транспортной тары. Комплект 1:

Трансферрин -ИМБИАН-ИХА

Экспресс-тест для качественного
иммунохроматографического
определения белка трансферрина в
образцах кала
«Трансферрин-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-056-39271034-2023

РУ № XXX XXXX/XXXXXX

Количество
Масса нетто
Масса брутто

ШТ.
КГ
КГ

LOT ГГММДД

 ГГГГ-ММ-ДД

REF iBR-014/1

 ГГГГ-ММ-ДД


Imbian

ООО «ИМБИАН»
630554, Новосибирская область,
м.р-н Новосибирский,
с.п. Барышевский сельсовет,
с. Барышево, ул. Ленина,
зд. 247, к. 4, помещ. 1
+7 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Замораживание не допускается.



8. Маркировка транспортной тары. Комплект 2:

Трансферрин -ИМБИАН-ИХА

Экспресс-тест для качественного
иммунохроматографического определения
белка трансферрина в образцах кала
«Трансферрин-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-056-39271034-2023

РУ № XXX XXXX/XXXXXX

Количество
Масса нетто
Масса брутто

ШТ.
КГ
КГ

LOT ГГММДД

 ГГГГ-ММ-ДД

REF iBR-014/2

 ГГГГ-ММ-ДД


Imbian

ООО «ИМБИАН»
630554, Новосибирская область,
м.р-н Новосибирский,
с.п. Барышевский сельсовет,
с. Барышево, ул. Ленина,
зд. 247, к. 4, помещ. 1
+7 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Замораживание не допускается.



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью



Лист
Директор ООО «ИМБИАН»

С.А. Иванов "5" 07 2023г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «ИМБИАН»



/С.А. Иванов/

2023 г.


Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения белка трансферрина в образцах кала «Трансферрин-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-056-39271034-2023

2023 г.

В состав медицинского изделия входят следующие компоненты:

1. Тест-кассета

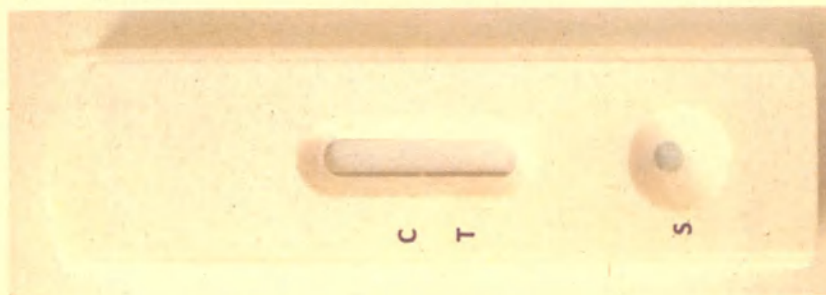

2. Фольгированный пакет с тест-кассетой



3. Буферный раствор, 1,0 мл



4. Пипетка Пастера



5. Наклейка для маркировки пробирки

ООО «ИМБИАН»

ФИО: _____

№ образца: _____

Дата: _____

Потребительская упаковка. Комплект 1, сторона 1.

Трансферрин-ИМБИАН-ИХА

Комплект № 1

- Тест-кассета
- Буферный раствор, 1,0 мл
- Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019: Пипетки для переноса жидкостей (Пастера), 0,25 мл (ПУ № РЗН 2019/8912)
- Инструкция по применению

Замораживание не допускается.
Для профессионального применения.

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения белка трансферрина в образцах кала «Трансферрин-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-056-39271034-2023

1 шт.	ПУ № XXX XXXX/XXXXX		Imbian
1 пр.	LOT	230303	 4610240911187
	REF	iBR-014/1	
		2023-03-03	
1 шт.		2025-03-03	
1 шт.			



+30°C

+2°C









Потребительская упаковка. Комплект 1, сторона 2.



**ООО «ИМБИАН», 630554, Россия, Новосибирская область,
 м.р-н Новосибирский, с.п. Барышевский сельсовет,
 с. Барышево, ул. Ленина, зд. 247, к. 4, помещ. 1.
 +7 (383) 209-34-54
www.imbian.ru
info@imbian.ru**





Потребительская упаковка. Комплект 2. Сторона 1.



Потребительская упаковка. Комплект 2. Сторона 2.

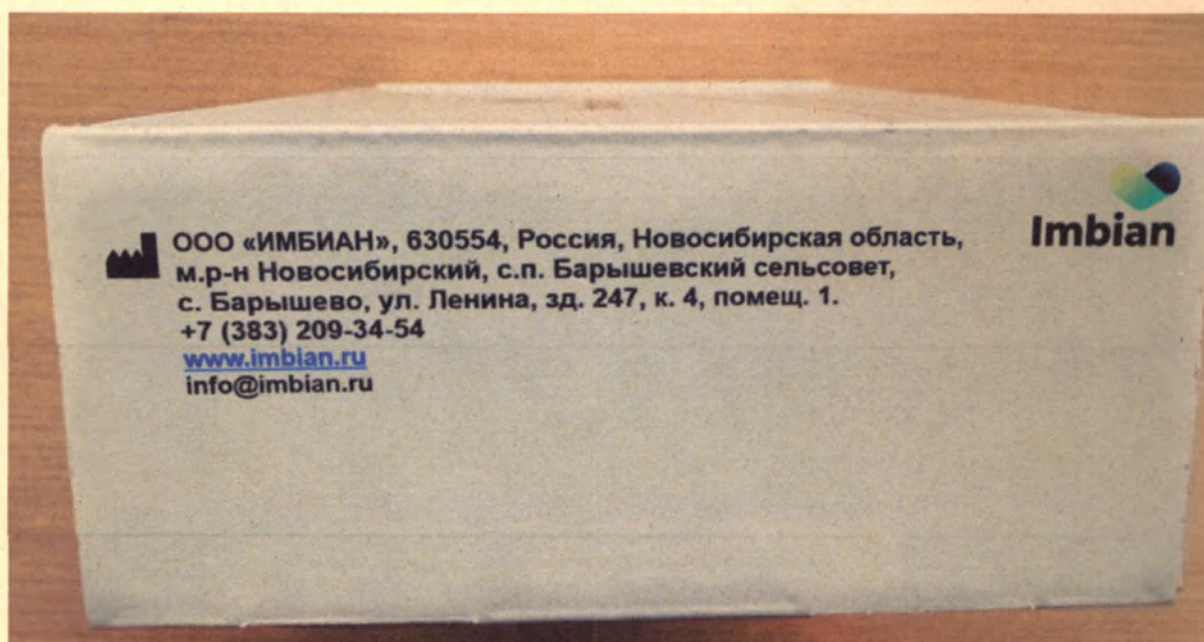

Общий вид медицинского изделия Комплект 1

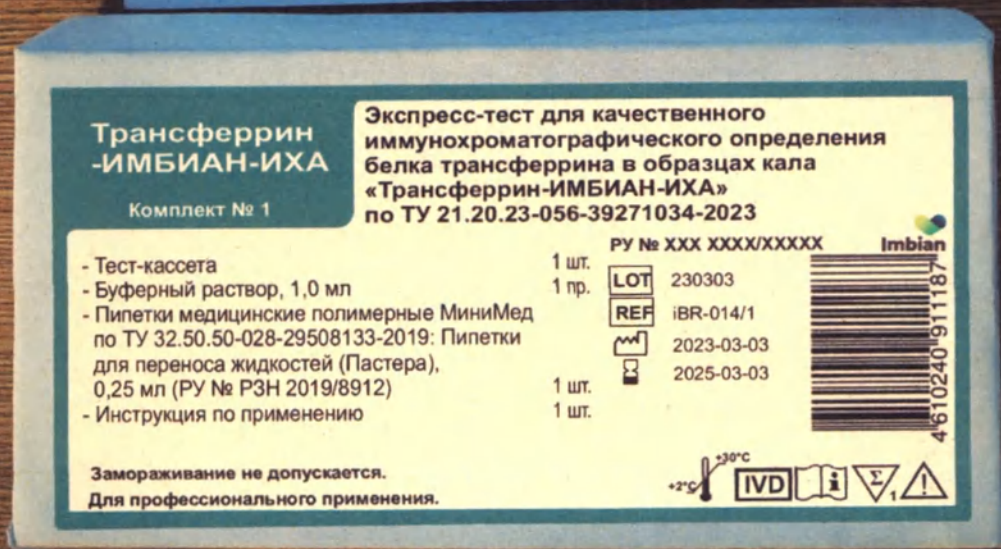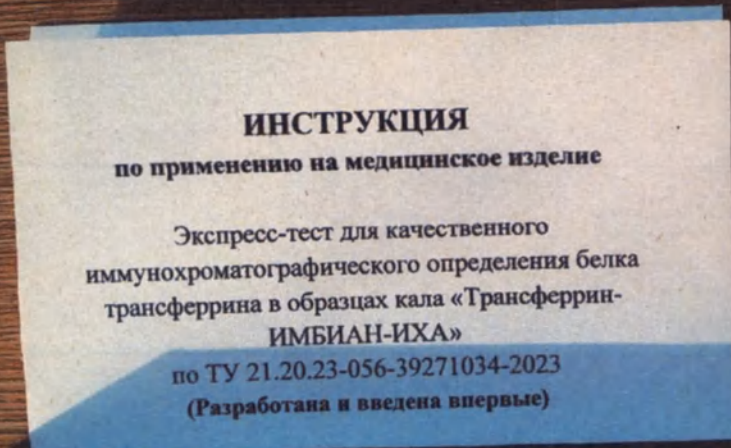

Общий вид медицинского изделия Комплект 2



Прошнуровано, пронумеровано
и укреплено печатью



лист 06
Директор ООО «ИМБИАН»

С.А. Иванов "6" 07 202 г.