

УТВЕРЖДАЮ



Генеральный директор
ООО «АКЦЕНТ»
Н.В. Фролина
«01» августа 2023 г.

**ШАБЛОНЫ
МАРКИРОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Гладилка стоматологическая для формирования контактного пункта -«Штопфер-контакт»
по ТУ 32.50.11-004-65966771-2021

2023

г. Санкт-Петербург

Маркировка потребительской упаковки на примере варианта исполнения Гладилка стоматологическая для формирования контактного пункта -«Штопфер-контакт» премоляр

Гладилка стоматологическая для формирования контактного пункта – «Штопфер-контакт» премоляр ТУ 32.50.11-004-65966771-2021 РУ от НЕСТЕРИЛЬНО Многоразовое Сделано в России
Производитель: ООО «АКЦЕНТ», e-mail: pavel@accentmed.ru, сайт accetmed.ru Юридический адрес: 194355, Россия, г. Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д.23, к.2 лит А, пом. 62Н Тел.: 8(812)973-86-88
ХРАНЕНИЕ: Штопфер-контакт в транспортной упаковке хранится по условиям хранения 2 в соответствии с ГОСТ 15150-69, но для температуры от -40°С до 40°С. Гарантийный срок эксплуатации: 3 месяца с даты производства, но не более 50 циклов стерилизации. Срок эксплуатации: 12 месяцев с даты производства изделия или 6 месяцев с даты продажи.
Дата изготовления _____ Партия номер _____

Маркировка транспортной упаковки на примере варианта исполнения Гладилка
стоматологическая для формирования контактного пункта -«Штопфер-контакт» моляр

Гладилка стоматологическая для формирования контактного пункта-

«Штопфер-контакт» моляр

ТУ 32.50.11-004-65966771-2021

РУ от

НЕСТЕРИЛЬНО

Многоразовое

Сделано в России

Производитель: ООО «АКЦЕНТ», e-mail: pavel@accentmed.ru, сайт: accentmed.ru

Юридический адрес: 194355, Россия, г.Санкт-Петербург, Выборгское ш., д.23, корп.2, лит А,
пом.62Н,

тел. 8(812)973-86-88

ХРАНЕНИЕ: Штопфер-контакт в транспортной упаковке хранится по условиям хранения 2, в соответствии с ГОСТ 15150-69, но при температуре от -40°C до 40°C.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ: Штопфер-контакт в транспортной упаковке транспортируется по условиям хранения 2, в соответствии с ГОСТ 15150-69, но при температуре от -40°C до 40°C.

Гарантийный срок эксплуатации 3 месяца с даты производства, но не более 50 циклов стерилизации.

Срок эксплуатации 12 месяцев с даты производства изделия или 6 месяцев с даты продажи.



Количество _____

Дата изготовления _____ Партия номер _____

Всего прошито пронумеровано и скреплено
печатью 3 (701)
листа(ов).
ООО «АКЦЕНТ»
Генеральный директор Фролина Н.В.



УТВЕРЖДАЮ



Генеральный директор

ООО «АКЦЕНТ»

Н.В. Фролина

«01» августа 2023 г.


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Гладилка стоматологическая для формирования контактного пункта -«Штопфер-контакт»


по ТУ 32.50.11-004-65966771-2021

2023


г. Санкт-Петербург

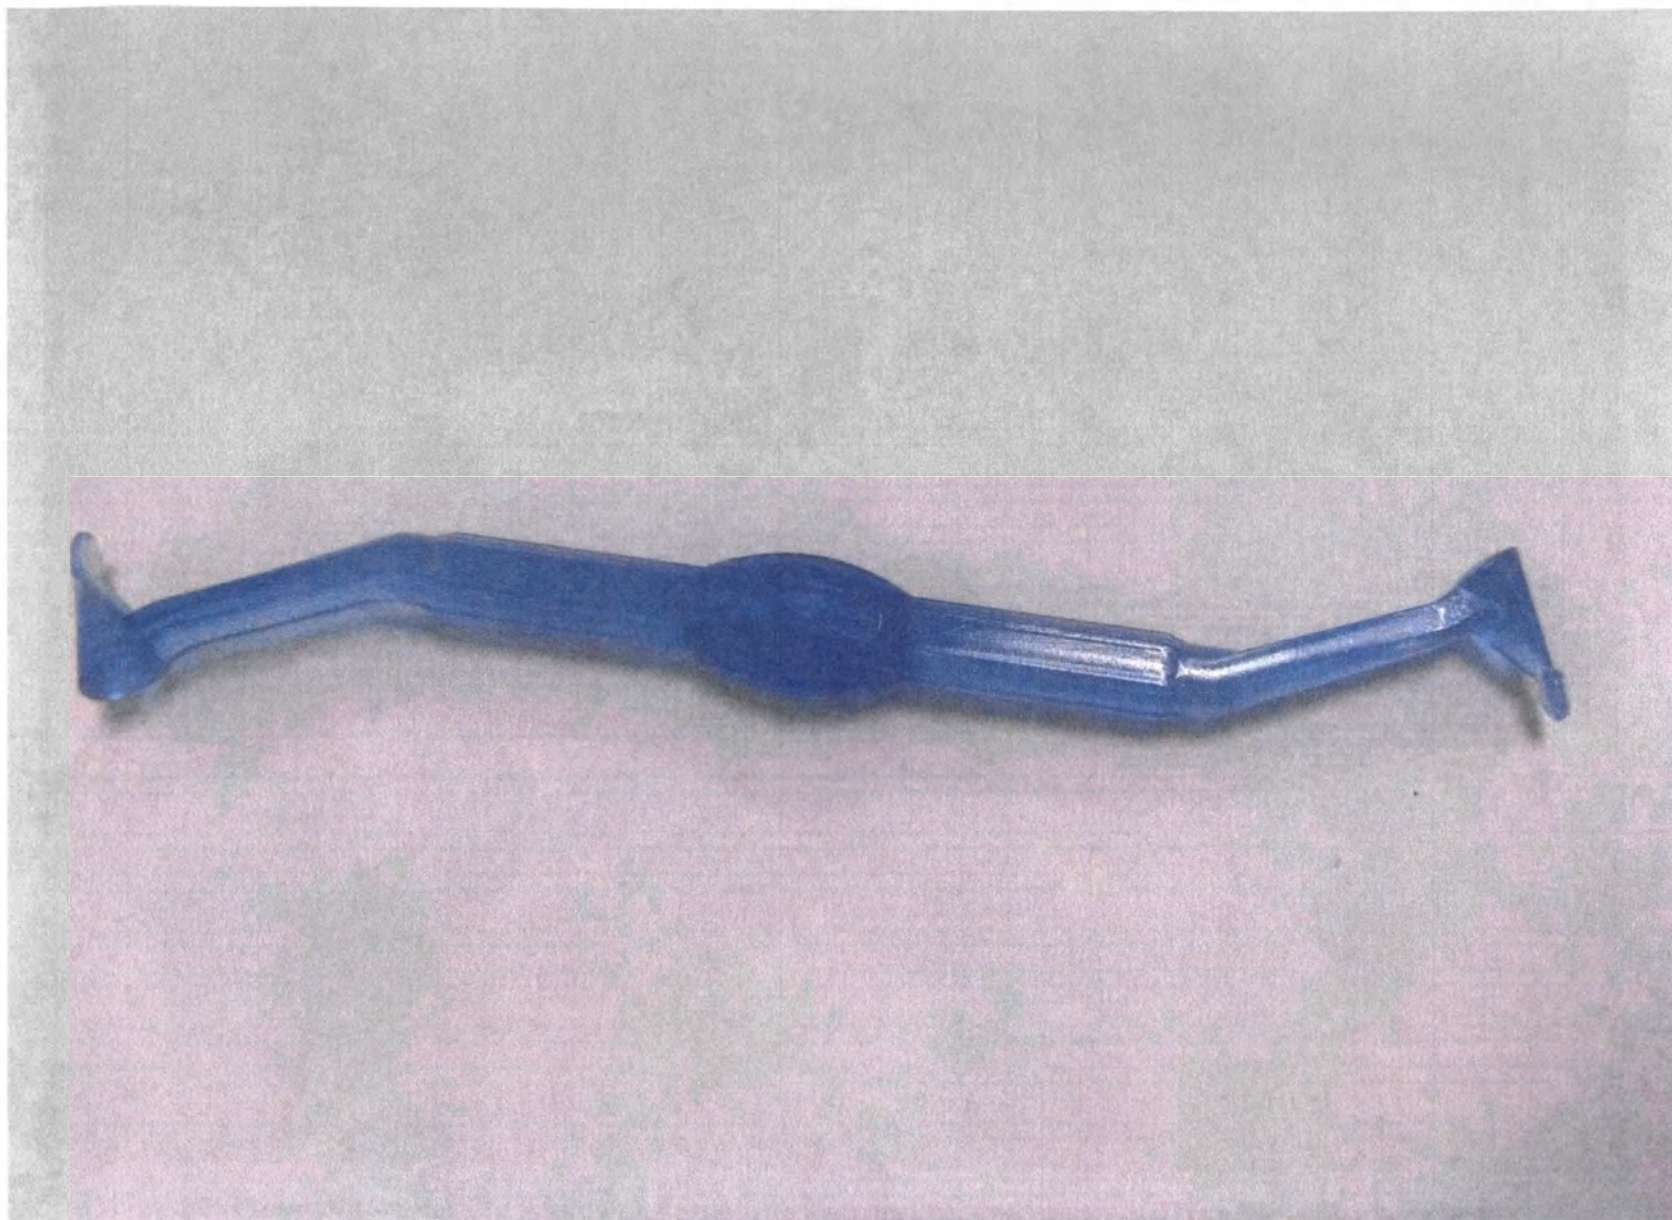

«Гладилка стоматологическая для формирования контактного пункта – «Штопфер-контакт» моляр

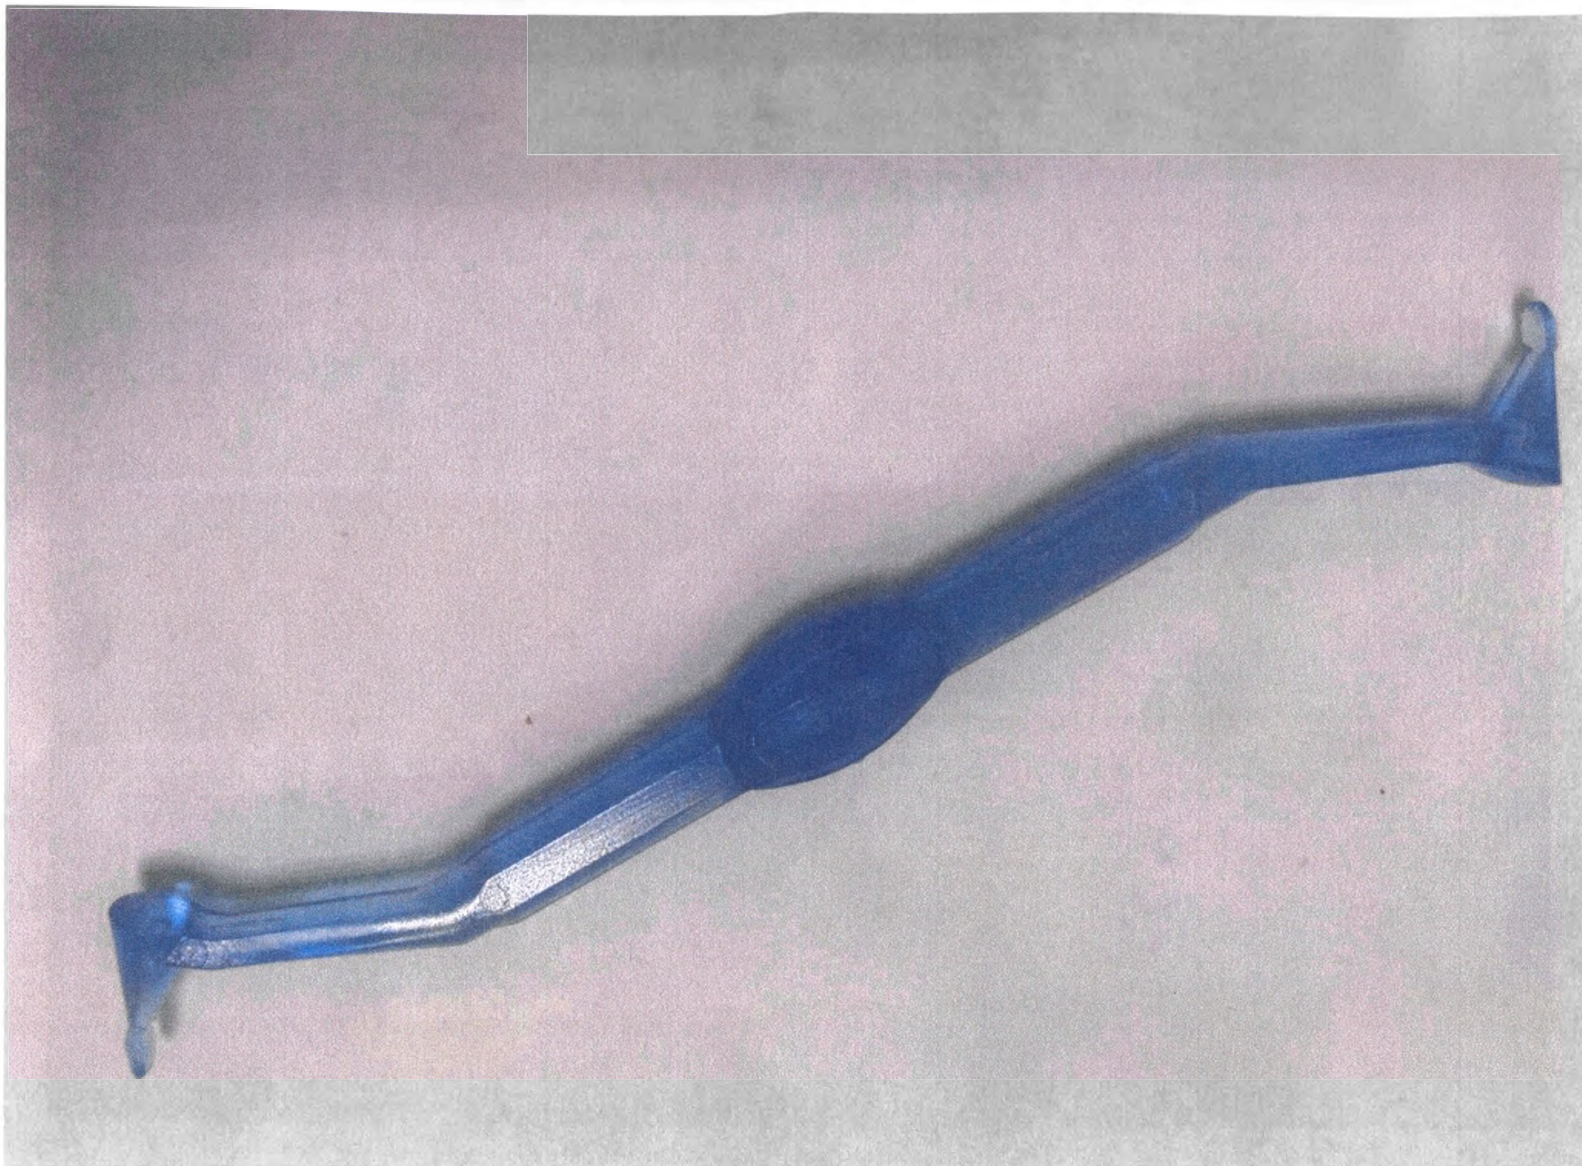

«Гладилка стоматологическая для формирования контактного пункта – «Штопфер-контакт» премоляр

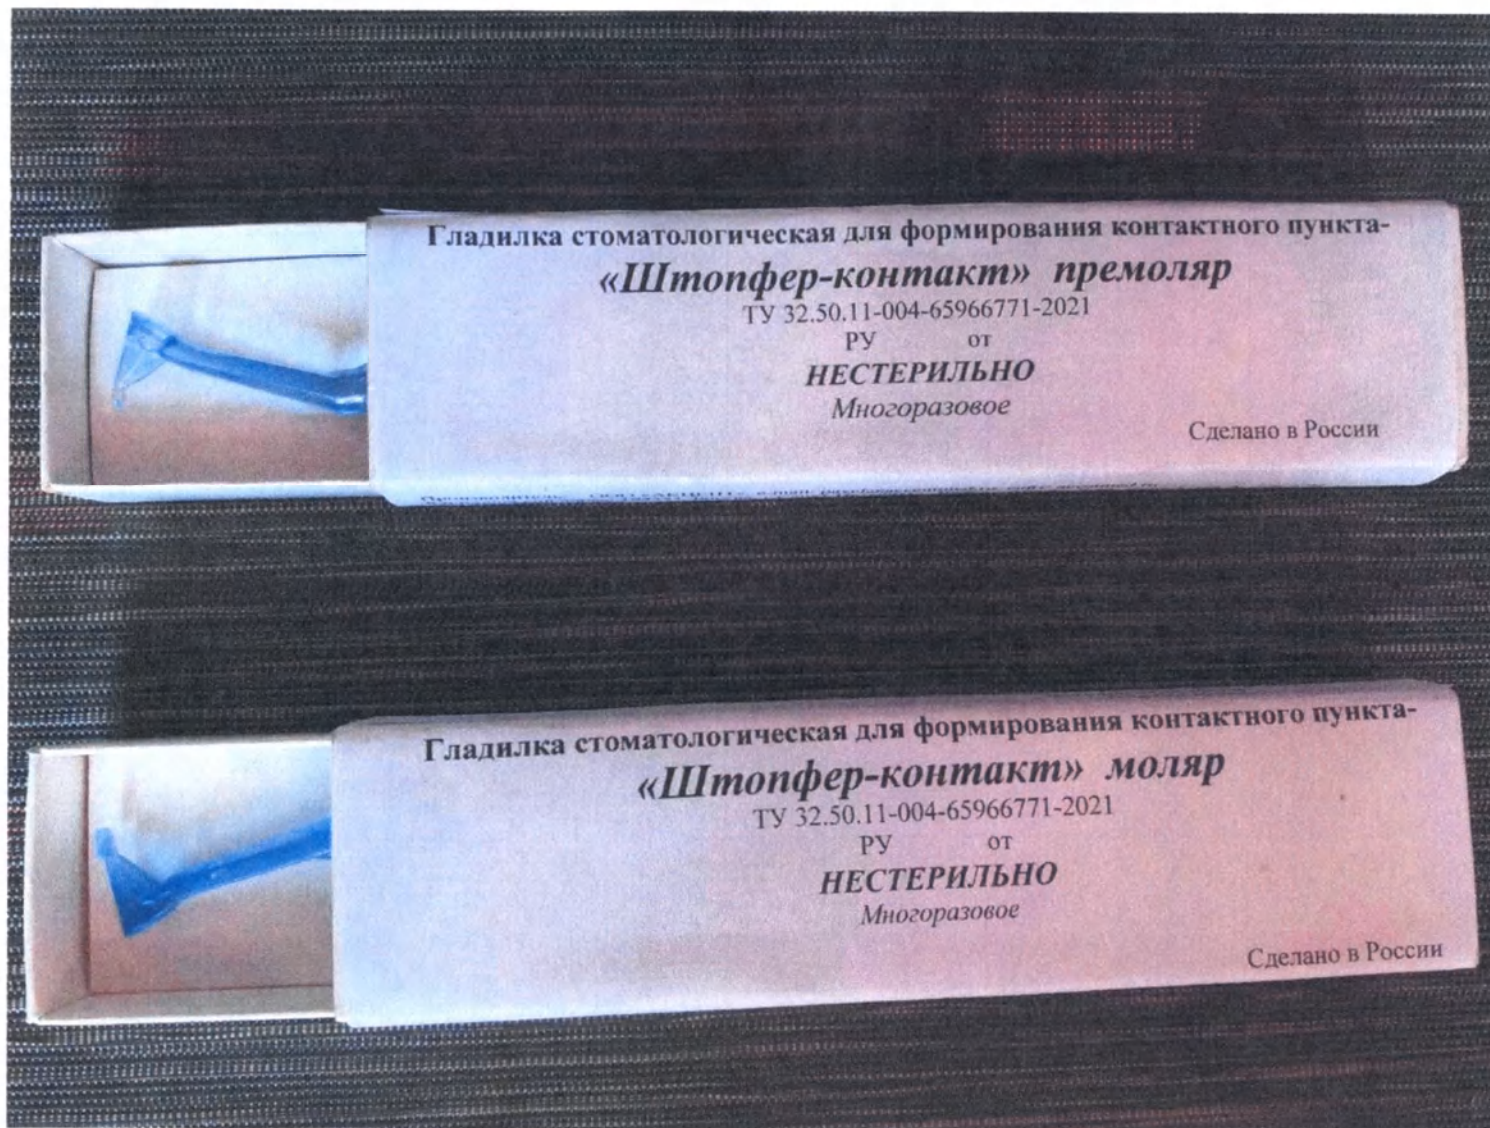

Гладилка стоматологическая для формирования контактного пункта-

«Штопфер-контакт» премоляр

ТУ 32.50.11-004-65966771-2021

РУ от

НЕСТЕРИЛЬНО

Многоразовое

Сделано в России

Гладилка стоматологическая для формирования контактного пункта-

«Штопфер-контакт» моляр

ТУ 32.50.11-004-65966771-2021


РУ от

НЕСТЕРИЛЬНО

Многоразовое


Сделано в России



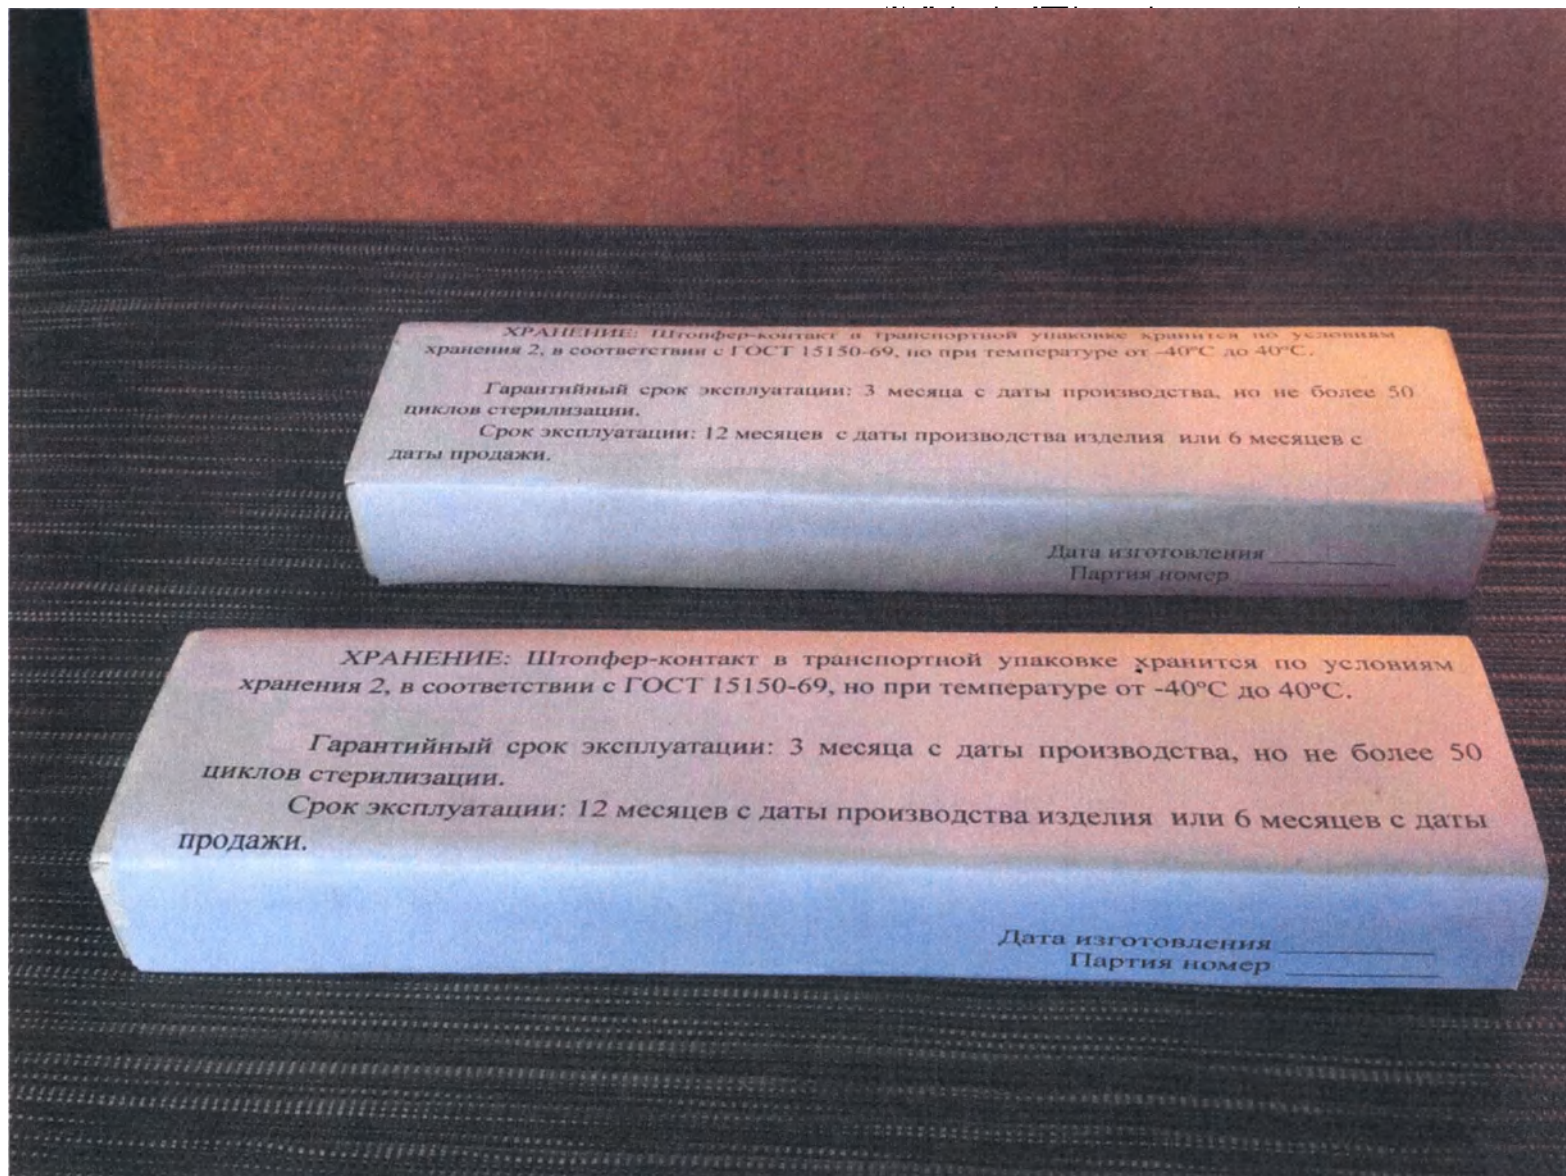

Потребительская упаковка с маркировкой на примере варианта исполнения Гладилка стоматологическая для формирования контактного пункта -«Штопфер-контакт» премоляр

Транспортная упаковка

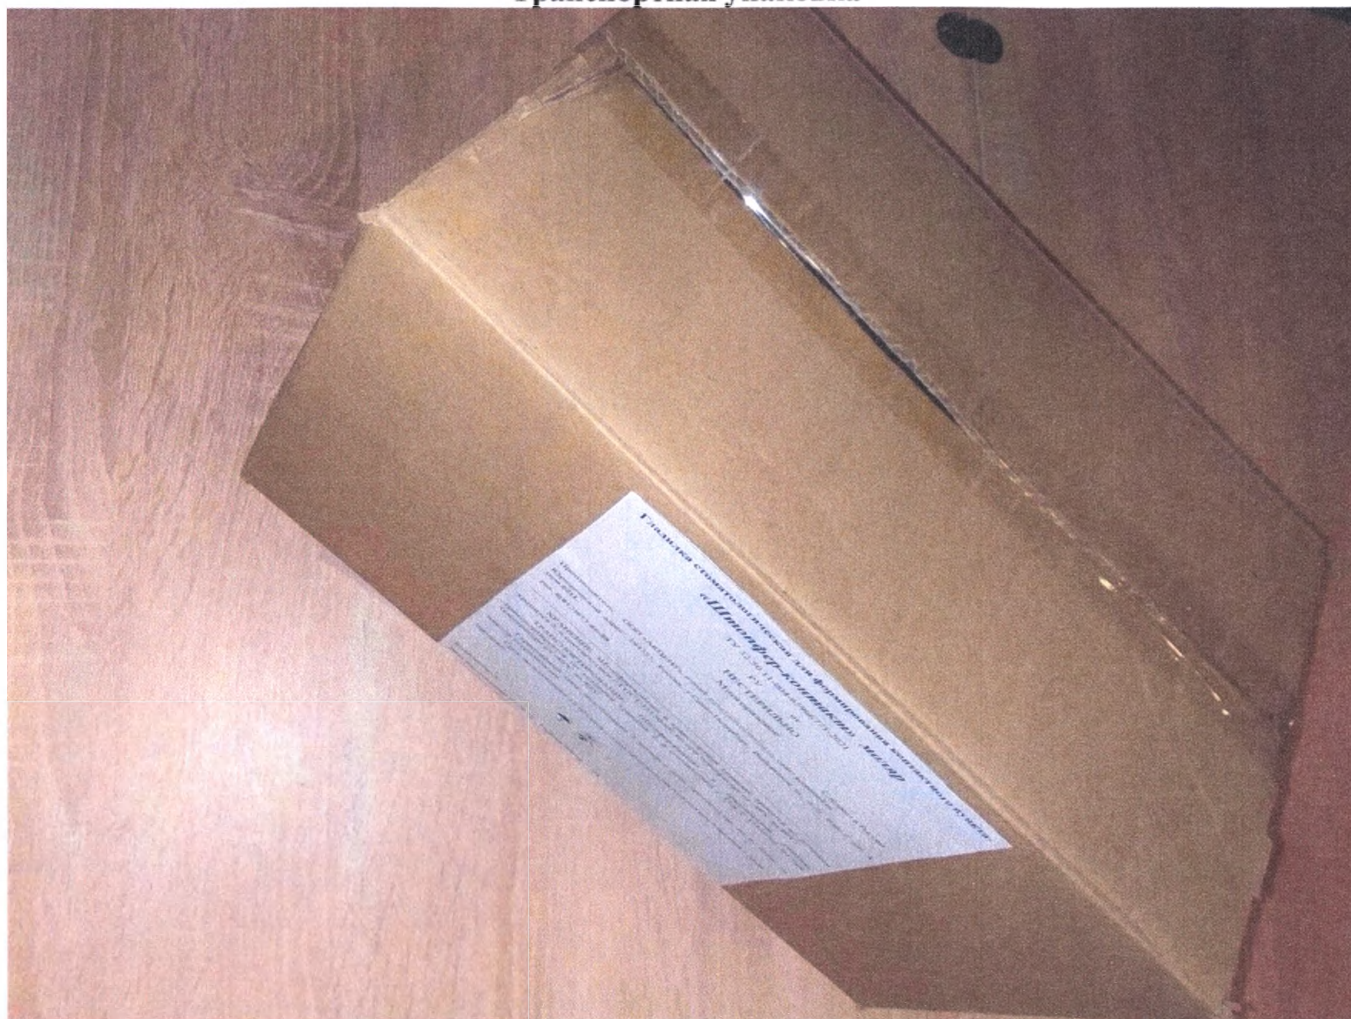

Всего прошито пронумеровано и скреплено
печатью 7 (Киев)
листа(ов).
ООО «АКЦЕНТ»
Генеральный директор Фролина Н.В.

