

Внешний вид медицинского изделия

Набор реагентов «Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный Ви-антигенный жидкий».

Набор реагентов «Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный Ви-антигенный жидкий», комплект № 1



ООО ЦИРМИ
Тел.: (812) 520 64 05
Факс: (812) 520 64 08

ИМЕРНЫЙ ОГИЧЕСКИХ О ПРИМЕНЕНИЯ

получают путем сенсibilизации
Д (1, 9, 12); Е (3, 10). Представлен
сальмонелл в фосфатном б
суспензия коричневого цвет
желтоватая надосадочная жи
Сыворотка диагностическая
коричневатым оттенком до 6
1% взвесь формализирован
без хлопьев; при отстаивани
жидкость
Раствор для разведений с
6,5 до 7,5
Планшет круглодонный дл
включает в себя 12 лунок с про

3.1. Диагностикумы должны быть
разведения не менее, чем 1:6400, диагностикум группы А (1, 2, 12) – 1:1600.

3.2. Время проведения анализа – 2 ч.

БИО-ДИАГНОСТИКА

Набор реактивов Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный Ви-антигенный жидкий

Комплект №2
Только для in vitro диагностики
Для учреждений здравоохранения



ООО ЦИРМИ
Тел.: (812) 520 94 08
Факс: (812) 520 94 08

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ НАБОР ПРИМЕНЕНИЯ

получают путем сенсификации
Д (1, 9, 12); Е (3, 10). Представлен
сальмонелл в фосфатном б
суспензия коричневого цвет
желтоватая надосадочная жи
Сыворотка диагностическая
коричневатым оттенком до 6
1% взвесь формализирова
без хлопьев; при отстаивани
жидкость

Раствор для разведений с
6,5 до 7,5

Планшет круглодонный для
включает в себя 12 лунок с про

3.1. Диагностикумы должны быть
разведении не менее, чем 1:6400, диагностикум группы А (1, 2, 12) – 1:1600.

3.2. Все материалы должны быть



БИО-ДИАГНОСТИКА

Набор реагентов

Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный Ви-антигенный жидкий

Комплект №3

Только для in vitro диагностики

Для учреждений здравоохранения



3.1. Диагностикумы должны
разведения не менее, чем 1:6400, диагностикум группы А (1, 2, 12) — 1:1000.

ИМЕРНЫЙ
ОГИЧЕСКИХ
О ПРИМЕНЕНИЯ

Исследуют путем сенситивизации
Д (1, 9, 12); Е (3, 10). Предста
сальмонелл в фосфатном б
суспензия коринцевого цвет
желтоватая надосадочная жи

Сыворотка диагностическ
коринцеватым оттенком до 6
1% взвесь формализир
без хлопьев; при отстаивани
жидкость

Раствор для разведений ст
6,5 до 7,5

Планшет круглодонный, дл
включает в себя 12 лунок с про



БИО-ДИАГНОСТИКА

Набор реагентов Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный Ви-антигенный жидкий

Комплект №4

Только для in vitro диагностики

Для учреждений здравоохранения

Образец упаковки
Комплект №1

■ Pantone 2736 C
■ Pantone 485 C
■ Black

140x40x90

ТУ 9388-002-68925985-2019
г. №
Дата регистрации
Хранить при температуре от 2 °С до 8 °С
Хранить в недоступном для детей месте



БИО-ДИАГНОСТИКА

Набор реагентов
**Диагностикум эритроцитарный
сальмонеллезный
Ви-антигенный жидкий**

Комплект №1

Только для in vitro диагностики

Для учреждений здравоохранения

ООО "Био-Диагностика"

Россия 111024, г. Москва, проезд Энтузиастов, д. 11 этаж 5 пом. 5/1
тел. (495) 646-23-51

Состав набора:

Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный Ви-антигенный жидкий (ДЭ)	1 флакон - 6 мл
Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная рецептор Ви сухая (КС)	1 флакон - из 0,1 мл
Раствор для постановки РПГА	2 флакона по 8 мл
1% взвесь формализированных несенсибилизированных эритроцитов барана (КЭ)	1 флакон - 1 мл
Планшет круглодонный для иммунологических реакций однократного применения	1 шт

С

Дата изготовления

Годен до

информация
ООО "Био-Диагностика"
Иванов И.И.
Александров
14.10.2019

Комплект №2

- Pantone 2736 C
- Pantone 485 C
- Black

140x40x90

ТУ 9388-002-66925985-2019
Р №
Дата регистрации
Хранить при температуре от 2 °С до 8 °С
Хранить в недоступном для детей месте



БИО-ДИАГНОСТИКА

Набор реагентов
**Диагностикум эритроцитарный
сальмонеллезный
Ви-антигенный жидкий**

Комплект №2

Только для in vitro диагностики
Для учреждений здравоохранения

ООО "Био-Диагностика"

Россия 111024, г. Москва, проезд Энтузиастов, д. 11 этаж 5 пом. 5/1
тел. (495) 646-23-51

Состав набора:

Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный Ви-антигенный жидкий (ДЭ)	1 флакон - 3 мл
Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная рецептор Ви сухая (КС)	1 флакон - из 0.1 мл
Раствор для постановки РПГА	2 флакона по 8 мл
1% взвесь формализированных, несенсибилизированных эритроцитов барана (КЭ)	1 флакон - 1 мл
Планшет круглодонный для иммунологических реакций однократного применения	1 шт

С
Дата изготовления
Годен до

Генеральный директор
ООО "Био-Диагностика"



Авсенов А.О.
28.11.2019

Комплект №3

■ Pantone 2736 C
■ Pantone 485 C
■ Black

140x40x90

ТУ 9388-002-68925985-2019

Р №

Дата регистрации

Хранить при температуре от 2°С до 8°С

Хранить в недоступном для детей месте



БИО-ДИАГНОСТИКА

Набор реагентов

**Диагностикум эритроцитарный
сальмонеллезный
Ви-антигенный жидкий**

Комплект №3

Только для in vitro диагностики

Для учреждений здравоохранения

ООО "Био-Диагностика"

Россия 111024, г. Москва, проезд Энтузиастов, д. 11 этаж 5 пом. 5/1
тел. (495) 646-23-51

Состав набора:

Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный Ви-антигенный жидкий (ДЭ)	1 флакон - 7 мл
Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная рецептор Ви сухая (КС)	1 флакон - из 0,1 мл
Раствор для постановки РПГА	2 флакона по 8 мл
1% взвесь формализированных, несенсибилизированных эритроцитов барана (КЭ)	1 флакон - 1 мл
Планшет круглодонный для иммунологических реакций однократного применения	1 шт

С.
Дата изготовления
Годен до




Генеральный директор
ООО "Био-Диагностика"
Александр Д. Д.
27.11.2019

Комплект №4

- Pantone 2736 C
- Pantone 485 C
- Black

140x40x90

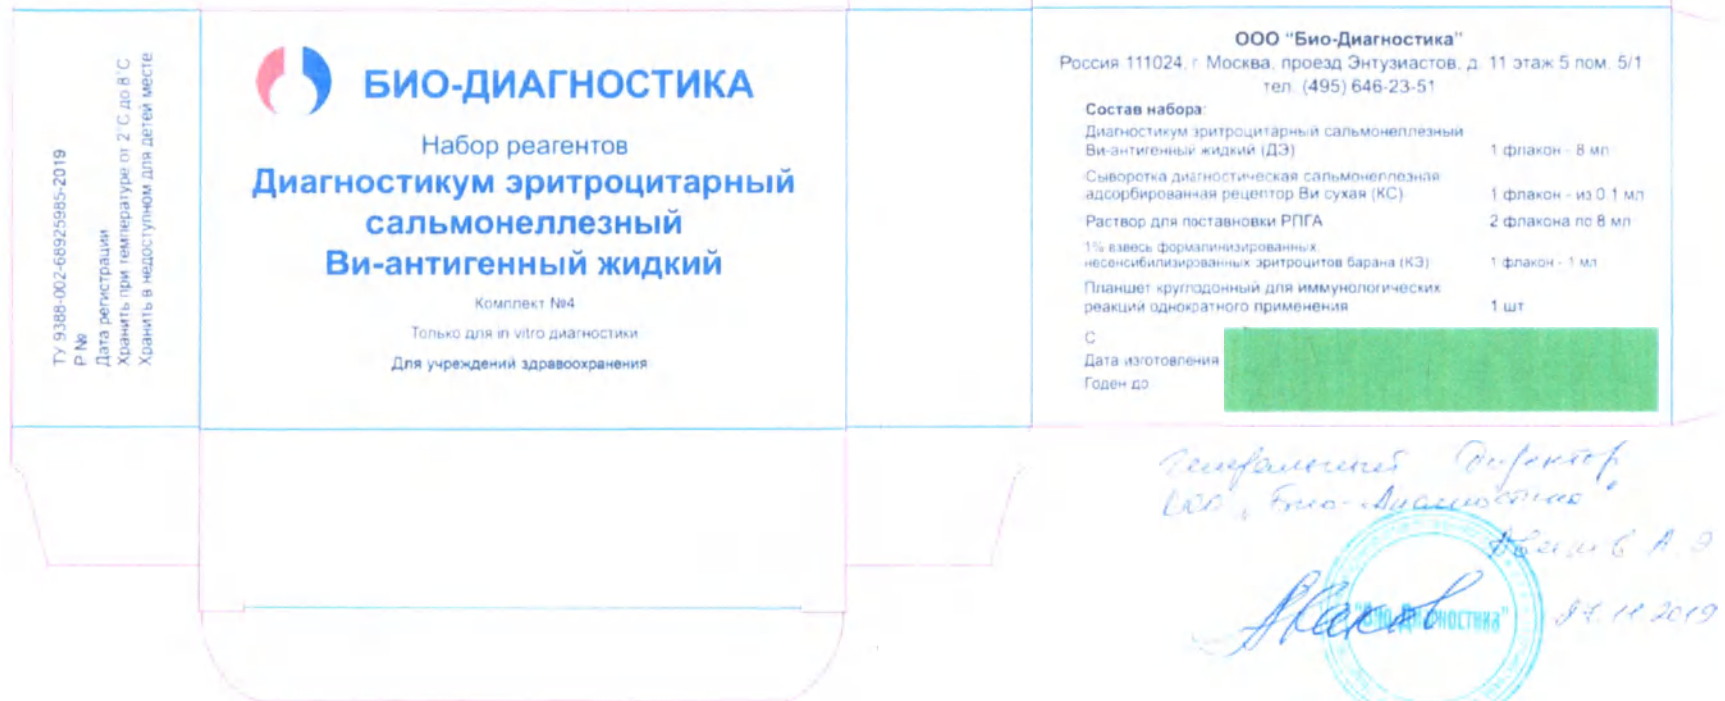

Генеральный директор ООО «Био-Диагностика» _____ А.Э. Аваков


Этикетки для маркировки комплектов

набора реагентов «Диагностикума эритроцитарного сальмонеллезного Ви-антигенного жидкого»

Наименование комплекта	Наименование компонента	Формат этикетки
Комплект № 1 Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный Ви-антигенный жидкий	Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный Ви-антигенный жидкий (ДЭ)	ООО "Био-Диагностика" г Москва Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный Ви-антигенный жидкий (ДЭ) 6 мл С 000000 Срок годности 00.0000
	Контрольная диагностическая сальмонеллезная адсорбированная сыворотка рецептор Ви сухая (КС)	ООО "Био-Диагностика" г Москва Контрольная диагностическая сальмонеллезная адсорбированная сыворотка рецептор Ви сухая (КС) Титр 1 320 С 000000 Срок годности 00.0000
	1% взвесь формализированных, несенсибилизированных эритроцитов барана (КЭ)	ООО "Био-Диагностика" г Москва 1% взвесь формализированных, несенсибилизированных эритроцитов барана (КЭ) 1 мл С 000000 Срок годности 00.0000
	Раствор для постановки РПГА	ООО "Био-Диагностика" г Москва Раствор для постановки РПГА 8 мл С 000000 Срок годности 00.0000
Комплект № 2 Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный Ви-антигенный жидкий	Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный Ви-антигенный жидкий (ДЭ)	ООО "Био-Диагностика" г Москва Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный Ви-антигенный жидкий (ДЭ) 3 мл С 000000 Срок годности 00.0000
	Контрольная диагностическая сальмонеллезная адсорбированная сыворотка рецептор Ви сухая (КС)	ООО "Био-Диагностика" г Москва Контрольная диагностическая сальмонеллезная адсорбированная сыворотка рецептор Ви сухая (КС) Титр 1 320 С 000000 Срок годности 00.0000
	1% взвесь формализированных, несенсибилизированных эритроцитов барана (КЭ)	ООО "Био-Диагностика" г Москва 1% взвесь формализированных, несенсибилизированных эритроцитов барана (КЭ) 1 мл С 000000 Срок годности 00.0000
	Раствор для постановки РПГА	ООО "Био-Диагностика" г Москва Раствор для постановки РПГА 8 мл С 000000 Срок годности 00.0000

Зав. лабораторией
ООО "Био-Диагностика"
Авеев В.В.
24.11.2019

Наименование комплекта	Наименование компонента	Формат этикетки
Комплект № 3 Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный Ви-антигенный жидкий	Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный Ви-антигенный жидкий (ДЭ)	ООО "Био-Диагностика" г. Москва Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный Ви-антигенный жидкий (ДЭ) 7 мл С 000000 Срок годности 00.0000
	Контрольная диагностическая сальмонеллезная адсорбированная сыворотка рецептор Ви сухая (КС)	ООО "Био-Диагностика" г. Москва Контрольная диагностическая сальмонеллезная адсорбированная сыворотка рецептор Ви сухая (КС) Титр 1 320 С 000000 Срок годности 00.0000
	1% взвесь формализированных, несенсибилизированных эритроцитов барана (КЭ)	ООО "Био-Диагностика" г. Москва 1% взвесь формализированных, несенсибилизированных эритроцитов барана (КЭ) 1 мл С 000000 Срок годности 00.0000
	Раствор для постановки РПГА	ООО "Био-Диагностика" г. Москва Раствор для постановки РПГА 8 мл С 000000 Срок годности 00.0000
Комплект № 4 Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный Ви-антигенный жидкий	Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный Ви-антигенный жидкий (ДЭ)	ООО "Био-Диагностика" г. Москва Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный Ви-антигенный жидкий (ДЭ) 8 мл С 000000 Срок годности 00.0000
	Контрольная диагностическая сальмонеллезная адсорбированная сыворотка рецептор Ви сухая (КС)	ООО "Био-Диагностика" г. Москва Контрольная диагностическая сальмонеллезная адсорбированная сыворотка рецептор Ви сухая (КС) Титр 1 320 С 000000 Срок годности 00.0000
	1% взвесь формализированных, несенсибилизированных эритроцитов барана (КЭ)	ООО "Био-Диагностика" г. Москва 1% взвесь формализированных, несенсибилизированных эритроцитов барана (КЭ) 1 мл С 000000 Срок годности 00.0000
	Раствор для постановки РПГА	ООО "Био-Диагностика" г. Москва Раствор для постановки РПГА 8 мл С 000000 Срок годности 00.0000

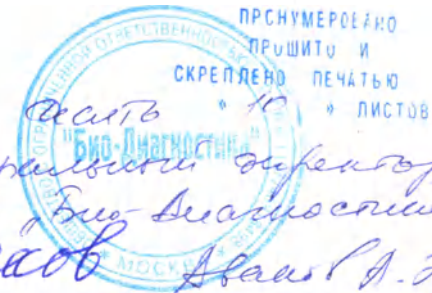

Всероссийский институт
Биомедицинской науки
Иванов А.А.