



Общество с ограниченной ответственностью "Бард Рус"
(ООО «Бард Рус»)

ИНН/КПП 7718775215/773101001

Юридический адрес: 121596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 204

Тел.: +7 (499) 372-5002, факс: +7 (499) 372-5003

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:
«Стент-графт сосудистый Covera Plus в комплекте с системой доставки 80 или 120 см, варианты исполнения»

РИС.1. ИЗОБРАЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ УПАКОВКЕ.


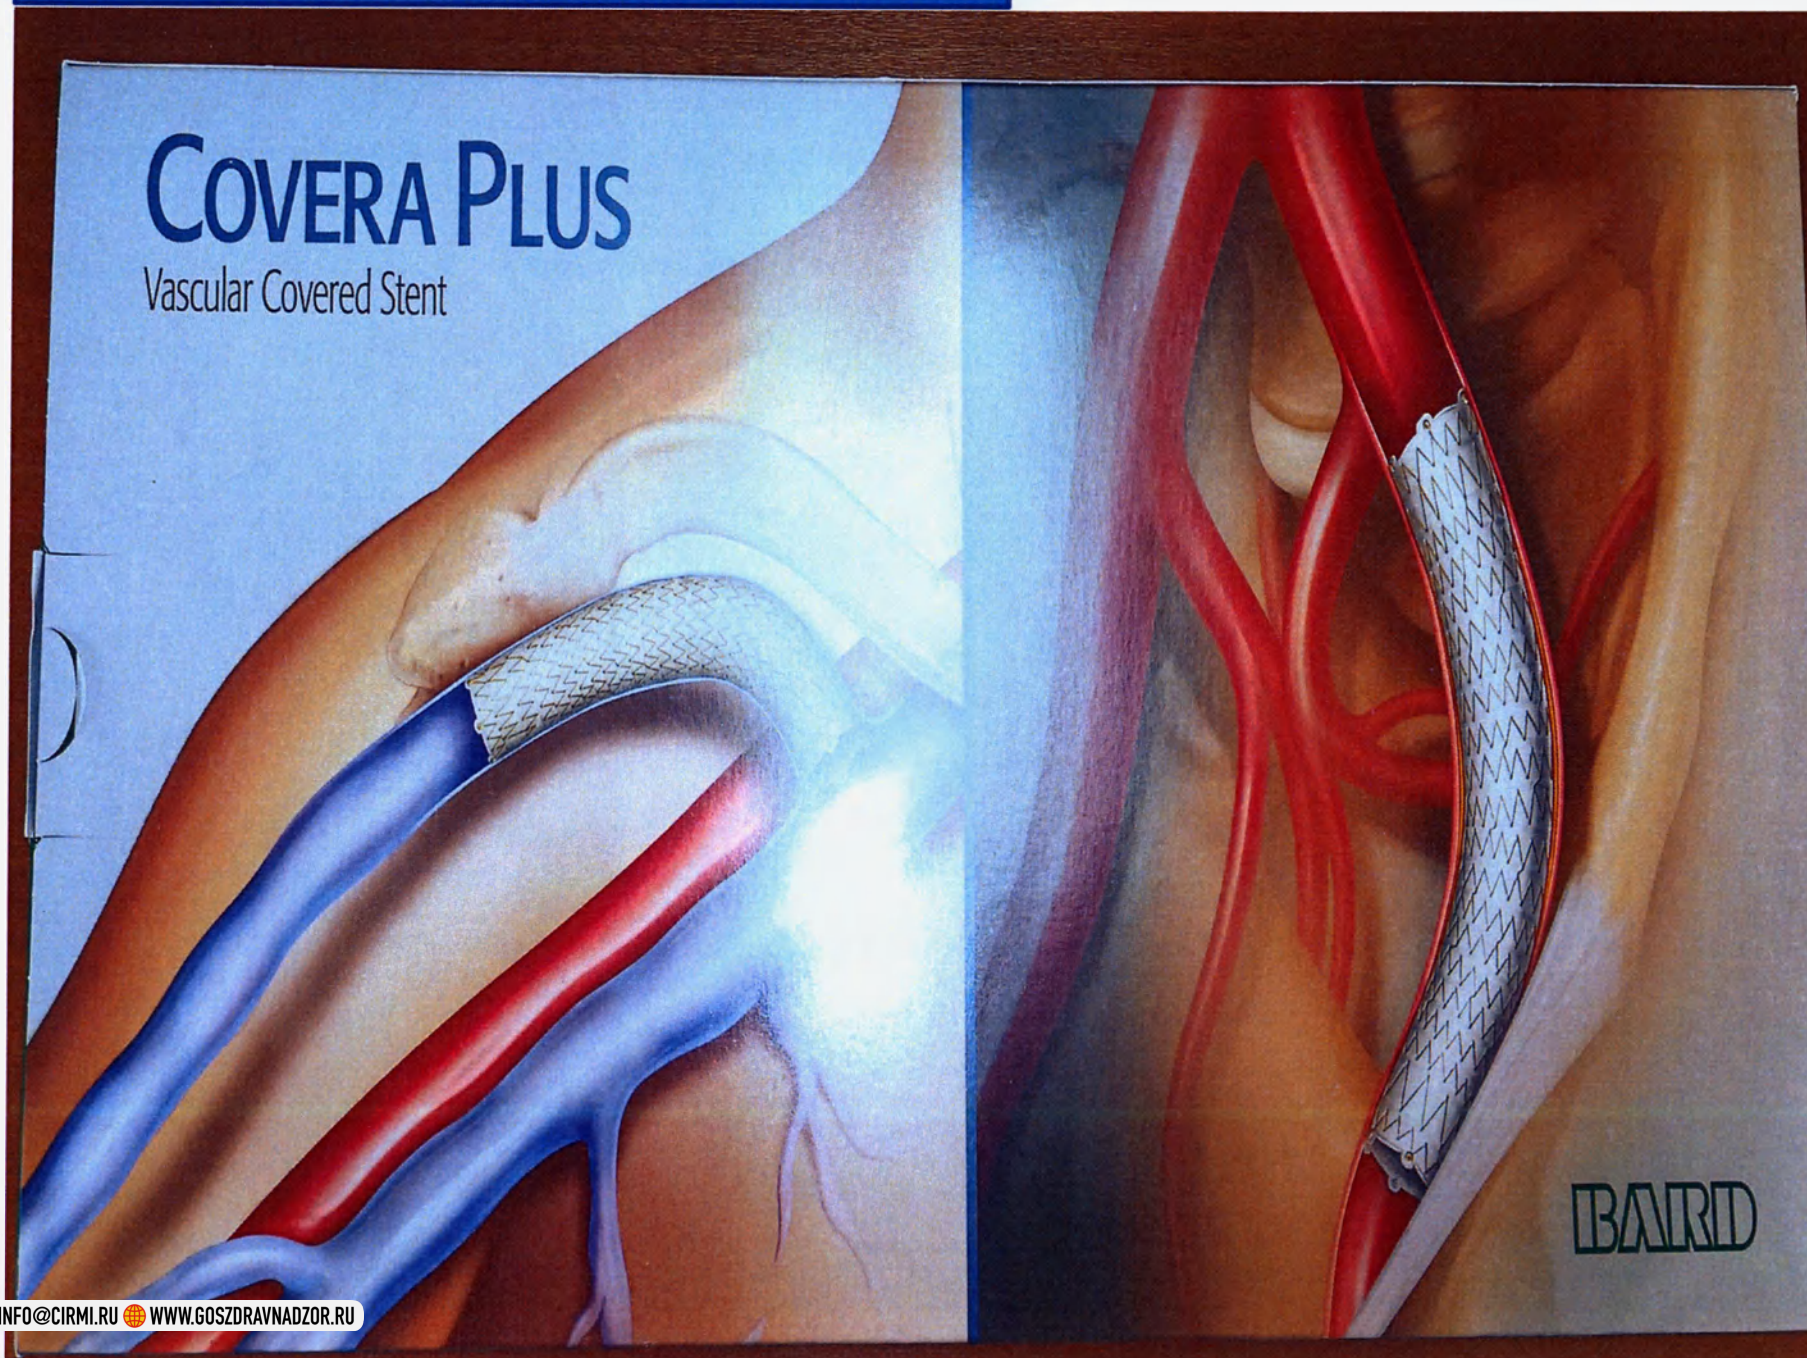


РИС.2. ИЗОБРАЖЕНИЕ МАРКИРОВКИ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ УПАКОВКЕ МЕД ИЗДЕЛИЯ

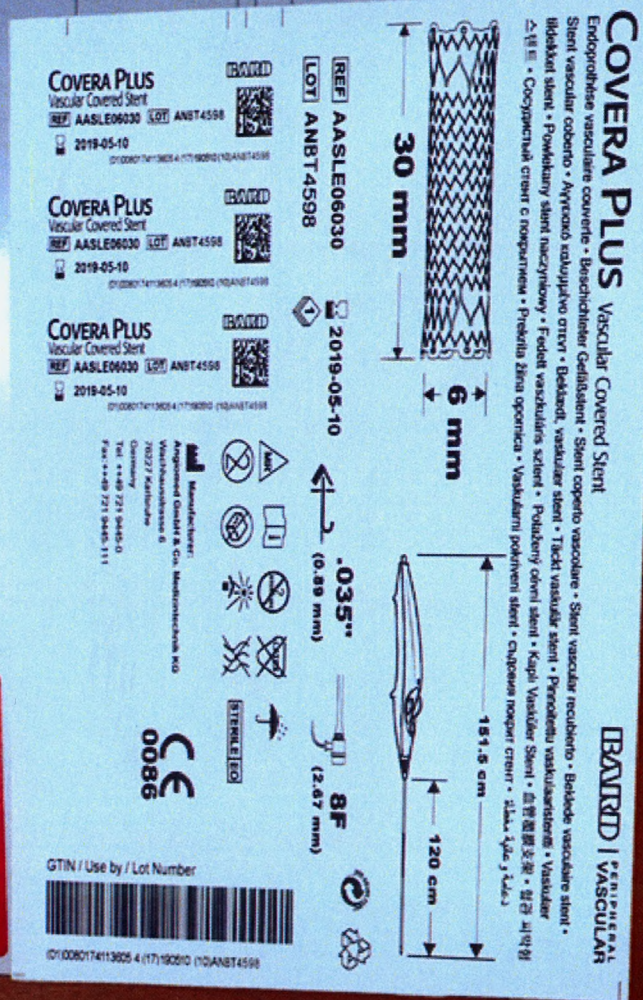

SAMPLES
NOT FOR HUMAN USE

COVERA PLUS

Vascular Covered Stent

RADIOPAQUE MARKERS

**DUAL LAYER
EPTFE COVERING**



TRIAXIAL DELIVERY SYSTEM

BAIRD

РИС.3. ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ В БЛИСТЕРНОЙ
УПАКОВКЕ


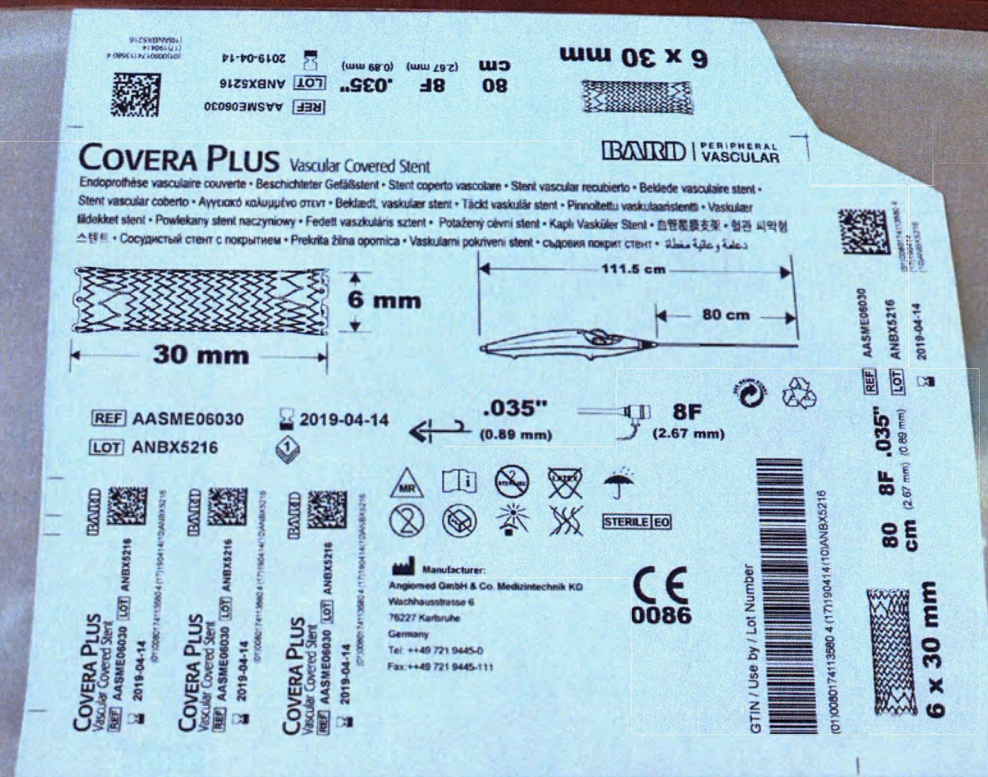


РИС.4. ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ НА МОНТАЖНОЙ
КАРТЕ




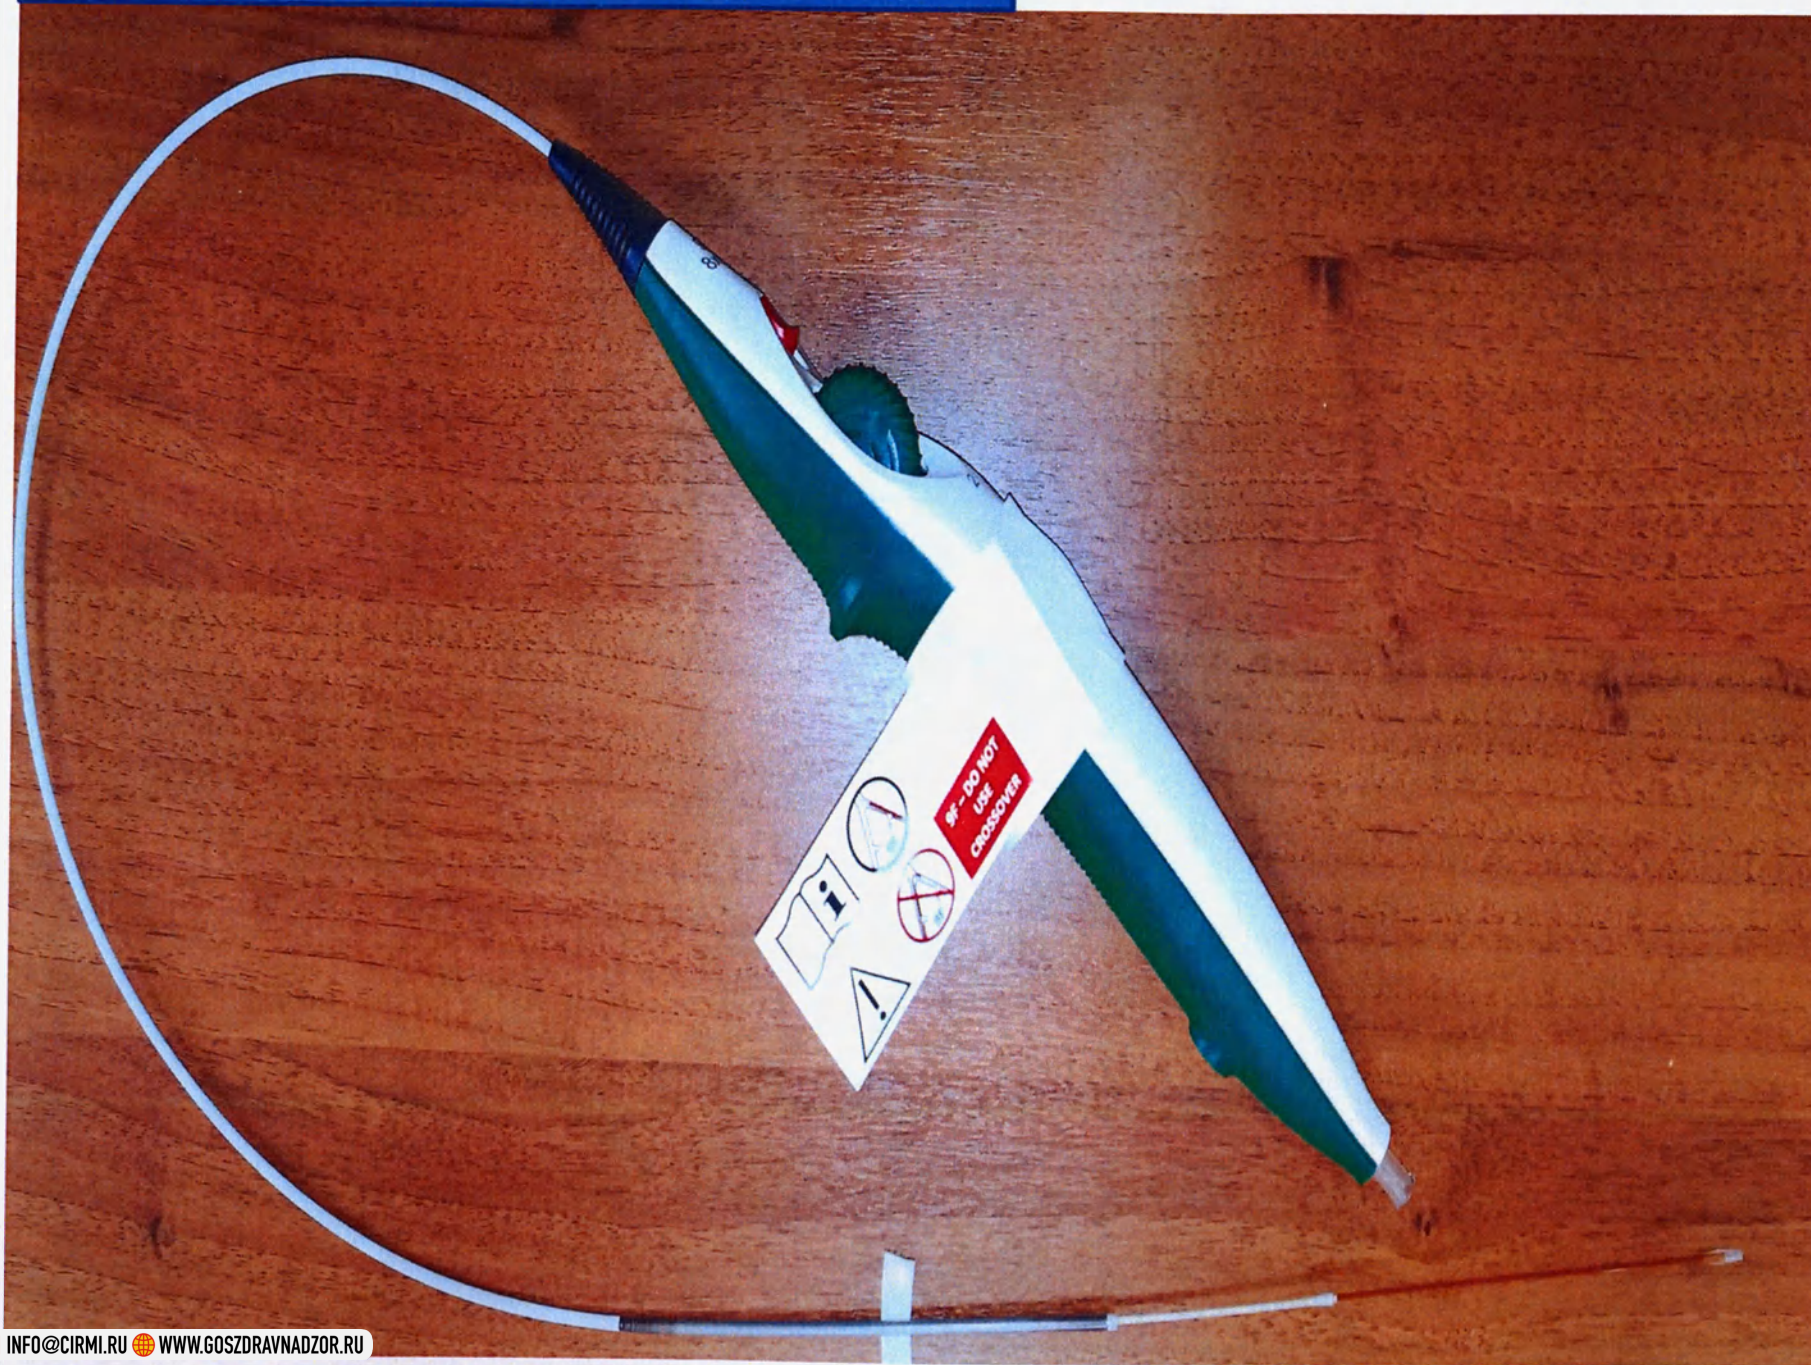

В документе пронумеровано и
скреплено печатью 6
(шесть) листа(ов)

Ген. Директор ООО «Бард Рус»

О.Н. Веков

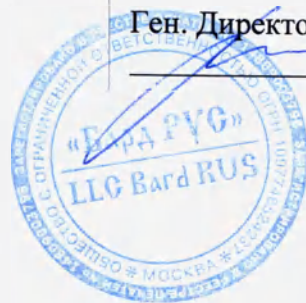

**Дополнительные
ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
медицинского изделия**

«Стент-графт сосудистый Covega Plus в комплекте с системой доставки 80 или 120 см, варианты исполнения»


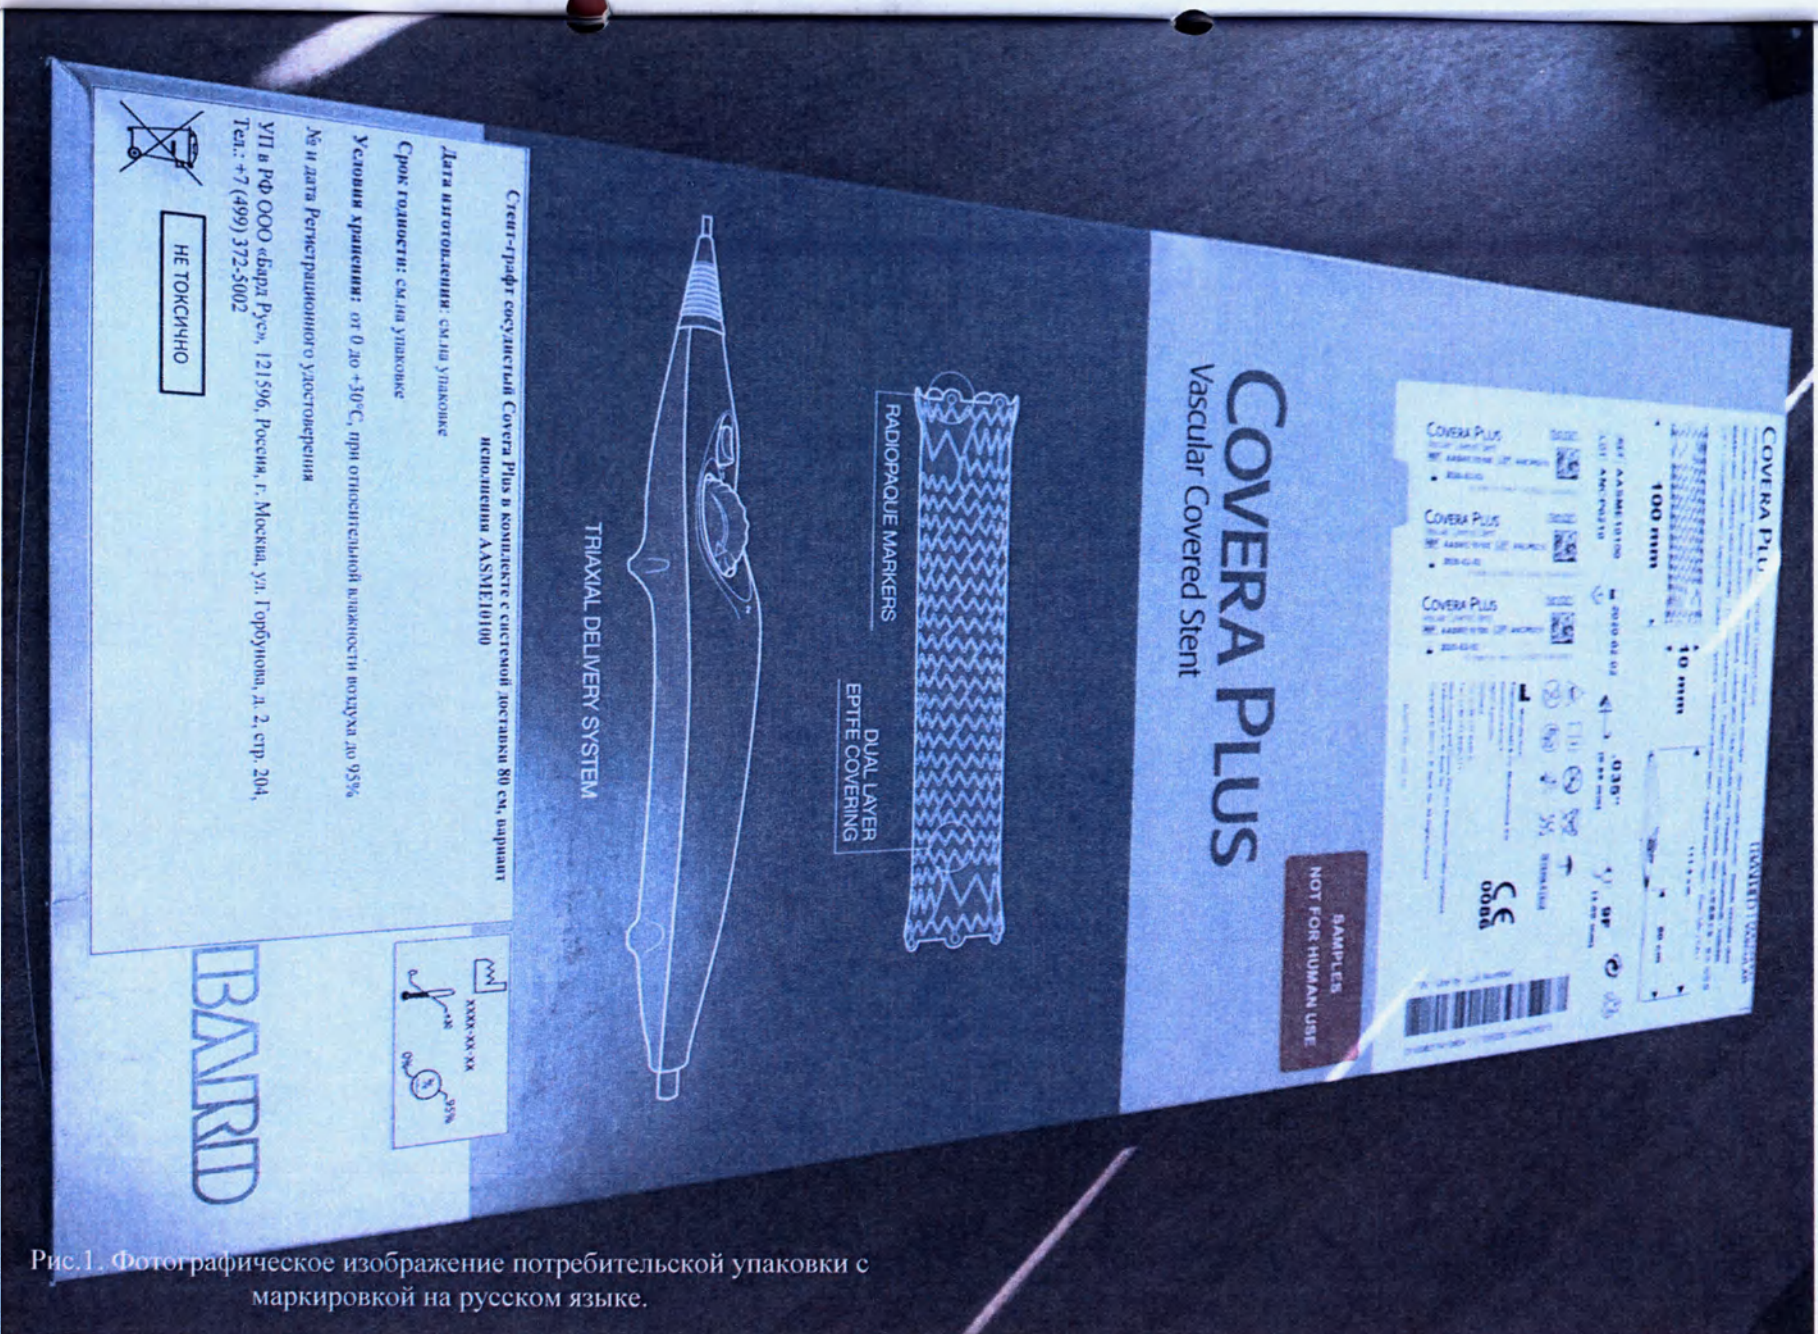


Рис.1. Фотографическое изображение потребительской упаковки с маркировкой на русском языке.

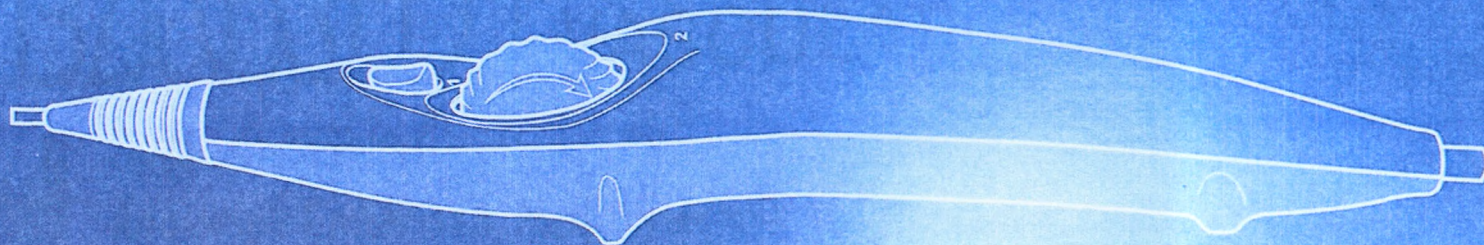

TRIAxIAL DELIVERY SYSTEM

Стент-графт сосудистый Covera Plus в комплекте с системой доставки 80 см, вариант исполнения AASME10100

Дата изготовления: см. на упаковке

Срок годности: см. на упаковке


Условия хранения: от 0 до +30°C, при относительной влажности воздуха до 95%

№ и дата Регистрационного удостоверения

УП в РФ ООО «Бард Рус», 121596, Россия, г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 204,
Тел.: +7 (499) 372-5002



НЕ ТОКСИЧНО

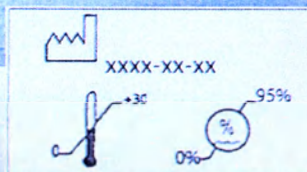

BAIRD

Рис.2. Фотографическое изображение потребительской упаковки с маркировкой на русском языке. Увеличенное изображение

BAIRD

PERIPHERAL VASCULAR



Производитель:

Angiomed GmbH & Co. Medizintechnik KG

Wachhausstrasse 6

76227 Karlsruhe

Тел.: ++49 721 9445 - 0

Germany (Германия)

Факс: ++49 721 9445 - 111

Прикрепите отрывную наклейку с этикетки изделия здесь

Рис.3. Макет этикетки для прослеживания с маркировкой на русском языке. Лицевая сторона.



Стент-графт сосудистый Covera Plus

Доклинические испытания показывают, что стент-графт сосудистый Covera Plus, предназначенный для отдельной установки в сосуды верхних конечностей и отдельной установки или установки с перекрытием с другим стентом в подвздошной и поверхностной бедренной артериях, во всех вариантах клинически значимой длины условно совместим с МРТ. В соответствии с доклиническими исследованиями проведение МРТ для пациентов со стент-графтом сосудистым Covera Plus сразу после установки данного имплантата безопасно, если соблюдены следующие условия:

- Статическое магнитное поле: 1,5 или 3 тесла;
- Поле с пространственным градиентом не более 3000 Гс/см;
- Максимальный общий усредненный удельный коэффициент поглощения (УКП) — 1 Вт/кг за 15 минут обследования;
- Нормальный режим работы системы МРТ.

ФИО пациента: _____

Дата внедрения имплантата: _____

Врач, внедривший имплантат: _____

Тел. врача, внедрившего имплантат: _____

Название медучреждения: _____

Адрес: _____

Дополнительную информацию см. В Инструкции по использованию изделия

Рис.4. Макет этикетки для прослеживания с маркировкой на русском языке. Обратная сторона.

В документе пронумеровано и
скреплено печатью 4
(Кенгофе) листа(ов)

Ген. Директор ООО «Бард Рус»
О.Н. Веков

