

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Набор реагентов для количественного определения аутоантител к рецептору ТТГ в сыворотке крови иммунохемилюминесцентным методом для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-TSHR cobas e analyzers/ATSHR), варианты исполнения 100, 300 тестов

Набор реагентов для количественного определения аутоантител к рецептору ТТГ в сыворотке крови иммунохемилюминесцентным методом для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-TSHR cobas e analyzers/ATSHR), вариант исполнения 100 тестов (общий вид)



Набор реагентов для количественного определения аутоантител к рецептору ТТГ в сыворотке крови иммунохемилюминесцентным методом для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-TSHR cobas e analyzers/ATSHR), вариант исполнения 100 тестов

Elecsys Anti-TSHR

cobas e analyzers

REF 08496609190

GTIN 07613336160305

LOT 65410903

 2024-01-31

COBAS, COBAS E
and ELECSYS are
trademarks of Roche.

 Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Str. 116
D-68305 Mannheim

Distribution in USA by:
Roche Diagnostics,
Indianapolis, IN
Made in Germany

CONTENT

 100

M 6.5 mL

R1 7 mL

R2 7 mL


PT1 4 mL

PT2 → 4 mL

PTR → 1 x 4.0 mL

PTB 1 x 5.0 mL

H317,H412
P261,P273
P280
P333+P313
P362+P364
P501



IVD  0123  2-8 °C

 dialog.roche.com

03

0702025501(1)



cobas[®]

Набор реагентов для количественного определения аутоантител к рецептору ТТГ в сыворотке крови иммунохемилюминесцентным методом для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-TSHR cobas e analyzers/ATSHR), вариант исполнения 100 тестов



Набор реагентов для количественного определения аутоантител к рецептору ТТГ в сыворотке крови иммунохемилюминесцентным методом для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-TSHR cobas e analyzers/ATSHR), вариант исполнения 100 тестов

Elecsys Anti-TSHR

REF 08496609 190

For **USA**: **CONTENT**

- M** Streptavidin-coated microparticles 0.72 mg/mL
- R1** Phosphate buffer 20 mmol/L
- R2** Monoclonal anti-TSHR antibody M22 (human)
labeled with ruthenium complex approx. 0.3 mg/L
- PT1** Pretreatment buffer solution
- PT2** Empty bottle for PTR reconstituted with PTB
- PTR** Pretreatment reagent, pTSHR-anti-pTSHR-Ab-biotin complex
- PTB** Pretreatment buffer



Rx only

002



Макет маркировки на русском языке

Набор реагентов для количественного определения аутоантител к рецептору ТТГ в сыворотке крови иммунохемилюминесцентным методом для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-TSHR cobas e analyzers/ATSHR), вариант исполнения 100 тестов, в составе:

1. Кассета с основными реагентами на три отделения (флакона): M, R1, R2 - 1 шт. в упаковке;
2. Кассета с реагентами для предварительной обработки на два отделения (флакона): PT1, PT2 - 1 шт. в упаковке;
3. Реагент для предварительной обработки (ATSHR PTR), флакон, объем 4,0 мл - 1 шт.;
4. Буфер для предварительной обработки (ATSHR PTB), флакон, объем 5,0 мл - 1 шт.;
5. Инструкция по применению.

Регистрационное удостоверение № P3H 2020/12080 от 07.10.2021 г.

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рош Диагностика ГмбХ").

Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено только для диагностики in vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество

с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош

Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495

229-69-99, факс: +7 495 229-62-64.

E-mail: moscow.reception_dia@roche.com

Кат. номер 08496609190

TOP

Elecsys®

TOP

Набор реагентов для количественного определения аутоантител к рецептору ТТГ в сыворотке крови иммунохемилюминесцентным методом для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-TSHR cobas e analyzers/ATSHR), вариант исполнения 100 тестов, в составе:

1. Кассета с основными реагентами на три отделения (флакона): M, R1, R2, 1 шт. в упаковке



Набор реагентов для количественного определения аутоантител к рецептору ТТГ в сыворотке крови иммунохемилюминесцентным методом для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-TSHR cobas e analyzers/ATSHR), вариант исполнения 100 тестов, в составе:

1. Кассета с основными реагентами на три отделения (флакона): M, R1, R2, 1 шт. в упаковке



Набор реагентов для количественного определения аутоантител к рецептору ТТГ в сыворотке крови иммунохемилюминесцентным методом для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-TSHR cobas e analyzers/ATSHR), вариант исполнения 100 тестов, в составе:

2. Кассета с реагентами для предварительной обработки на два отделения (флакона): PT1, PT2, 1 шт. в упаковке;





Набор реагентов для количественного определения аутоантител к рецептору ТТГ в сыворотке крови иммунохемилюминесцентным методом для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-TSHR cobas e analyzers/ATSHR), вариант исполнения 100 тестов, в составе:

2. Кассета с реагентами для предварительной обработки на два отделения (флакона): PT1, PT2, 1 шт. в упаковке;



реактивов для количественного определения аутоантител к рецептору TTR в сыворотке крови
флюоресцентным методом для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Elecsys
TSHR cobas e analyzer/ATSHR), вариант исполнения 100 тестов, в составе:

Реактив для предварительной обработки (ATSHR PTR), флакон, объем 4,0 мл – 1 шт

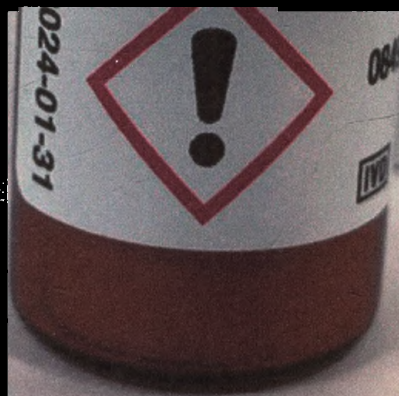


Набор реагентов для количественного определения аутоантител к рецептору ТТГ в сыворотке крови иммунохемилюминесцентным методом для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-TSHR cobas e analyzers/ATSHR), вариант исполнения 100 тестов, в составе:

3. Реагент для предварительной обработки (ATSHR PTR), флакон, объем 4,0 мл – 1 шт




Набор реагентов для количественного определения аутоантител к рецептору ТТГ в сыворотке крови иммунохемилюминесцентным методом для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-TSHR cobas e analyzers/ATSHR), вариант исполнения 100 тестов, в составе:

4. Буфер для предварительной обработки (ATSHR PTB), флакон, объем 5,0 мл – 1 шт

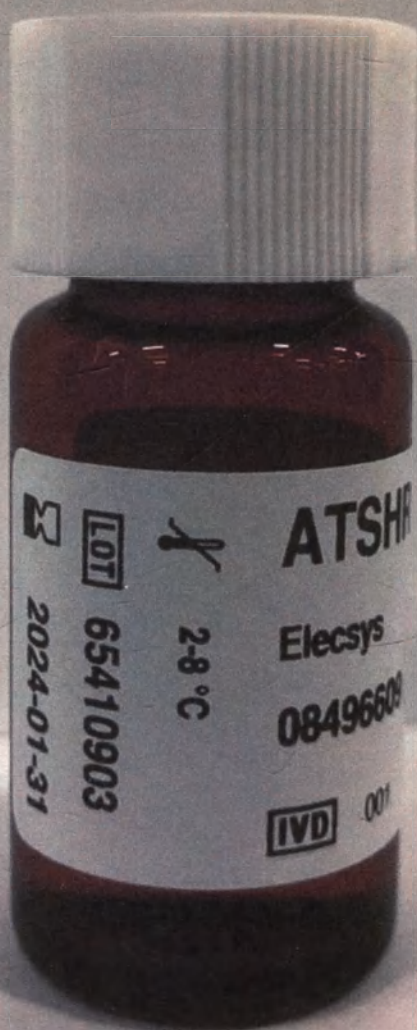

Набор реагентов для количественного определения аутоантител к рецептору ТТГ в сыворотке крови иммунохемилюминесцентным методом для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-TSHR cobas e analyzers/ATSHR), вариант исполнения 300 тестов (общий вид)

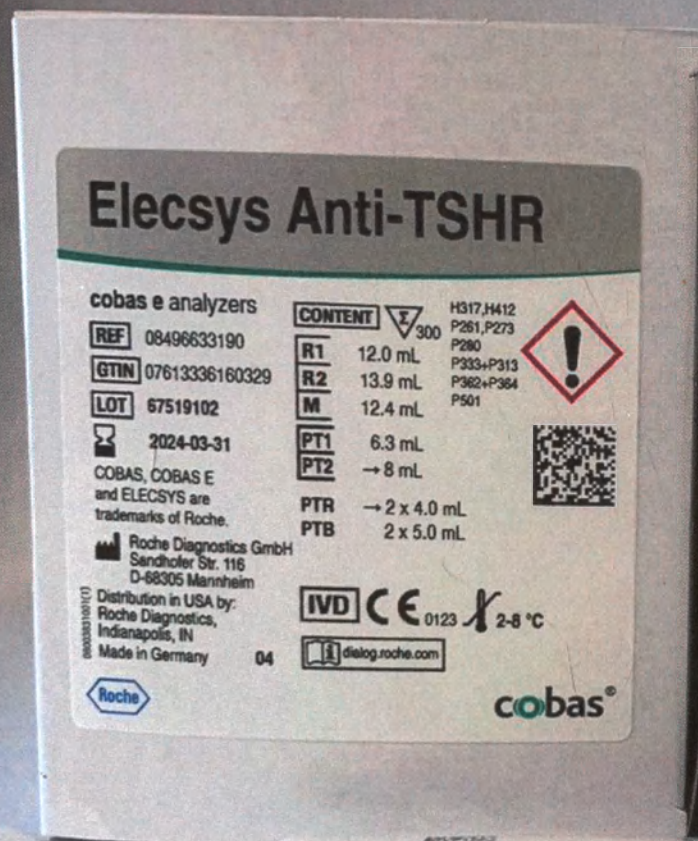

набор реагентов для количественного определения аутоантител к рецептору ТТГ в сыворотке крови
иммунохемилюминесцентным методом для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-
TSHR cobas e analyzers/ATSHR), вариант исполнения 300 тестов

Elecsys Anti-TSHR

cobas e analyzers

REF 08496633190

GTIN 07613336160329

LOT 67519102



2024-03-31

COBAS, COBAS E
and ELECSYS are
trademarks of Roche.




Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Str. 116
D-68305 Mannheim

080033831001(1)

Distribution in USA by:
Roche Diagnostics,
Indianapolis, IN
Made in Germany



CONTENT



R1 12.0 mL

R2 13.9 mL

M 12.4 mL

PT1 6.3 mL

PT2 → 8 mL

PTR → 2 x 4.0 mL

PTB 2 x 5.0 mL

H317, H412
P261, P273
P280
P333+P313
P362+P364
P501



0123 2-8 °C



dialog.roche.com

04

cobas[®]

реагентов для количественного определения аутоантител к рецептору ТТГ в сыворотке крови
мунохемилюминесцентным методом для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-TSHR
as e analyzers/ATSHR), вариант исполнения 300 тестов



ATSHR

REF (240)08496633190

GTIN

(01)07613336160329

UDI



LOT (10)67519102



2024-03-31



2023-02-02

03



Набор реагентов для количественного определения аутоантител к рецептору ТТГ в сыворотке крови иммунохемилюминесцентным методом для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-TSHR cobas e analyzers/ATSHR), вариант исполнения 300 тестов

Elecsys Anti-TSHR

REF 08496633190

For **USA**: **CONTENT**

- M** Streptavidin-coated microparticles 0.72 mg/mL
- R1** Phosphate buffer 20 mmol/L
- R2** Monoclonal anti-TSHR antibody M22 (human)
labeled with ruthenium complex approx. 0.3 mg/L
- PT1** Pretreatment buffer solution
- PT2** Empty bottle for PTR reconstituted with PTB
- PTR** Pretreatment reagent, pTSHR-anti-pTSHR-Ab-biotin complex
- PTB** Pretreatment buffer



Rx only

001



Набор реагентов для количественного определения аутоантител к рецептору ТТГ в сыворотке крови иммунохемилюминесцентным методом для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-TSHR cobas e analyzers/ATSHR), вариант исполнения 300 тестов

Макет маркировки на русском языке

Набор реагентов для количественного определения аутоантител к рецептору ТТГ в сыворотке крови иммунохемилюминесцентным методом для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-TSHR cobas e analyzers/ATSHR), вариант исполнения 300 тестов, в составе:

1. Кассета с основными реагентами на три отделения (флакона): M, R1, R2 - 1 шт. в упаковке.
2. Кассета с реагентами для предварительной обработки PT1, PT2 - 1 шт. в упаковке;
3. Реагент для предварительной обработки (ATSHR PTR), флакон, объем 4,0 мл - 2 шт.;
4. Буфер для предварительной обработки (ATSHR PTB), флакон, объем 5,0 мл - 2 шт.;
5. Инструкция по применению.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/12080 от 07.10.2021 г.

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рош Диагностика ГмбХ"), Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено только для диагностики in vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64.

E-mail: moscow.reception_dia@roche.com

Кат. номер 08496633190



2. Набор реагентов для количественного определения аутоантител к рецептору ТТГ в сыворотке крови иммунохемилюминесцентным методом для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-TSHR cobas e analyzers/ATSHR), вариант исполнения 300 тестов, в составе:

1. Кассета с основными реагентами на три отделения (флакона): М, R1, R2, 1 шт. в упаковке.

Набор реагентов для количественного определения аутоантител к рецептору ТТГ в сыворотке крови иммунохемилюминесцентным методом для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-TSHR cobas e analyzers/ATSHR), вариант исполнения 300 тестов, в составе:

1. Кассета с основными реагентами на три отделения (флакона): M, R1, R2, 1 шт. в упаковке



Набор реагентов для количественного определения аутоантител к рецептору ТТГ в сыворотке крови иммунохемилюминесцентным методом для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-TSHR cobas e analyzers/ATSHR), вариант исполнения 300 тестов, в составе:

1. Кассета с основными реагентами на три отделения (флакона): M, R1, R2, 1 шт. в упаковке





2. Набор реагентов для количественного определения аутоантител к рецептору ТТГ в сыворотке крови иммунохемилюминесцентным методом для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-TSHR cobas e analyzers/ATSHR), вариант исполнения 300 тестов, в составе:

2. Кассета с реагентами для предварительной обработки: PT1, PT2, 1 шт. в упаковке




2. Набор реагентов для количественного определения аутоантител к рецептору ТТГ в сыворотке крови иммунохемилюминесцентным методом для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-TSHR cobas e analyzers/ATSHR), вариант исполнения 300 тестов, в составе:

2. Кассета с реагентами для предварительной обработки: PT1, PT2, 1 шт. в упаковке


набор реагентов для количественного определения аутоантител к рецептору ТТГ в сыворотке крови
мунохемилюминесцентным методом для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-TSHR cobas e
analyzers/ATSHR), вариант исполнения 300 тестов, в составе:

2. Кассета с реагентами для предварительной обработки: PT1, PT2, 1 шт. в упаковке

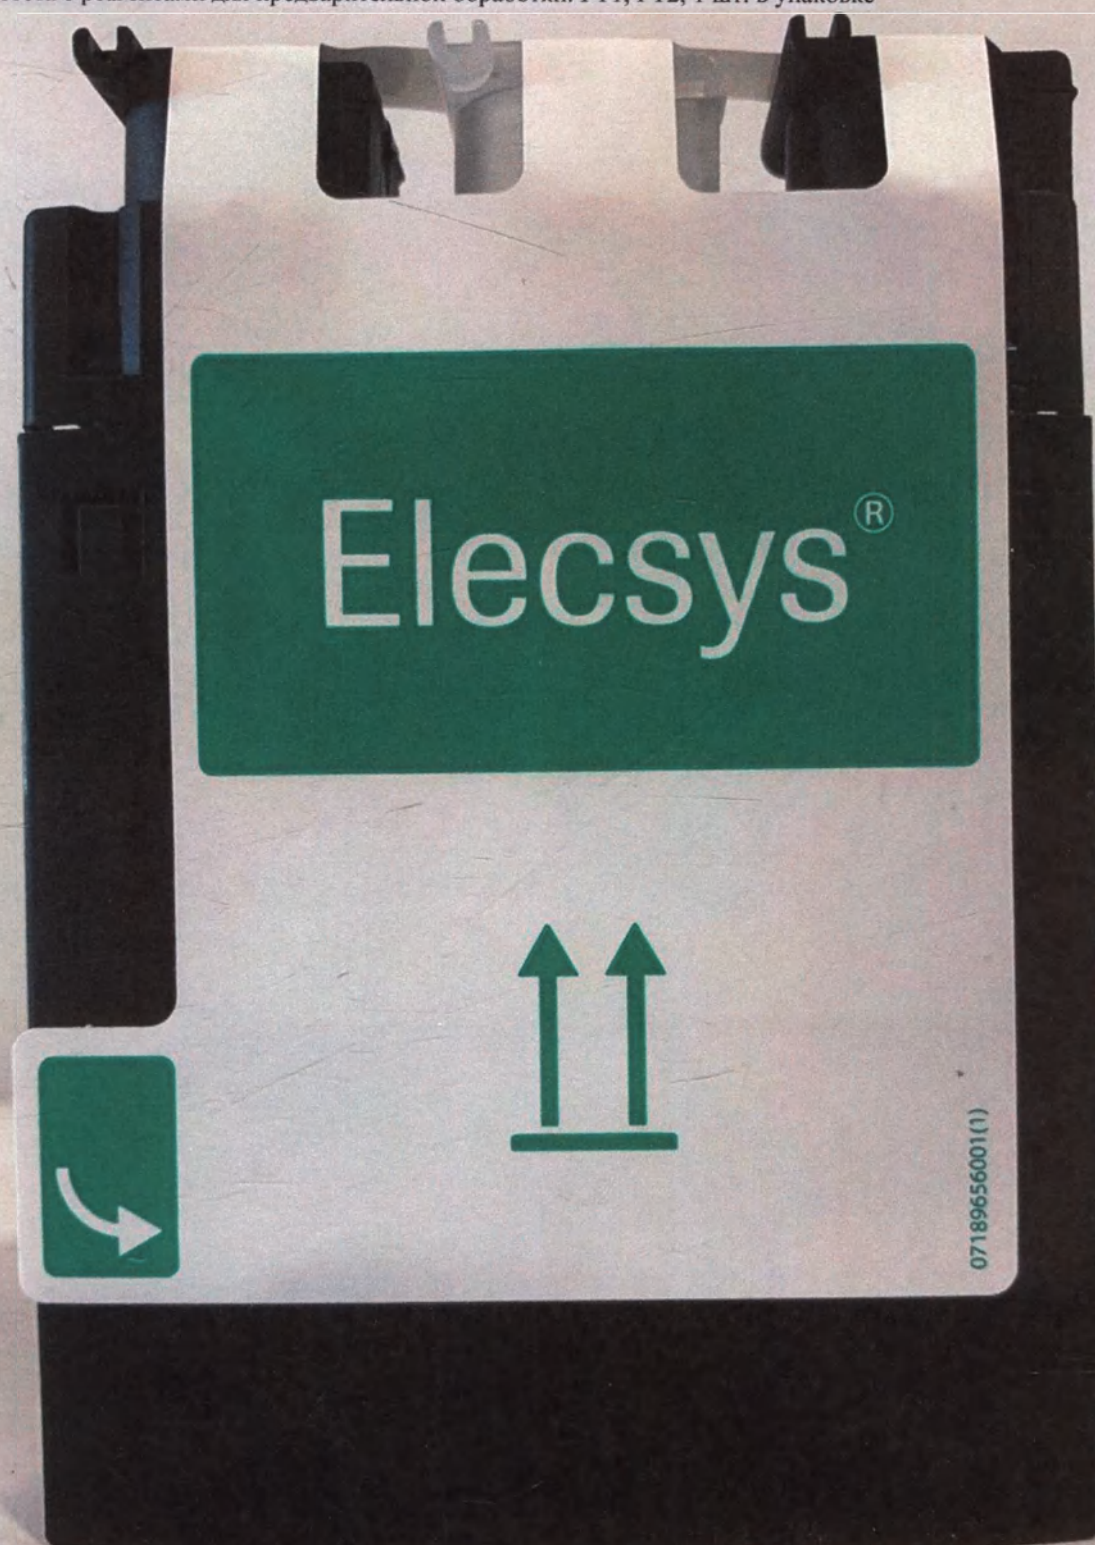


набор реагентов для количественного определения аутоантител к рецептору ТТГ в сыворотке крови
мунохемилюминесцентным методом для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-TSHR cobas e
alyzers/ATSHR), вариант исполнения 300 тестов, в составе:

3. Реагент для предварительной обработки (ATSHR PTR), флакон, объем 4,0 мл – 2 шт.;

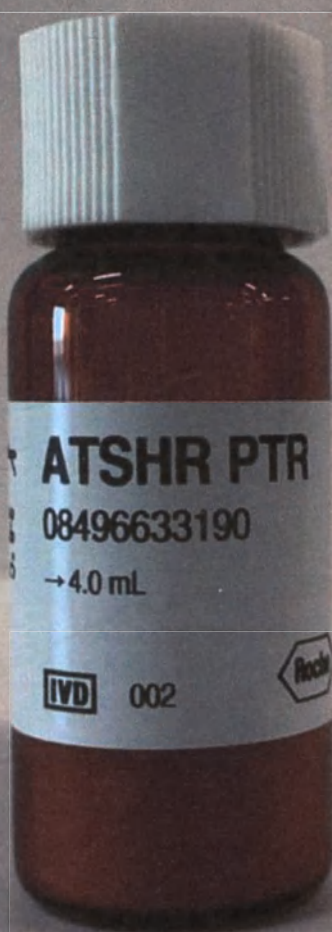


набор реагентов для количественного определения аутоантител к рецептору ТТГ в сыворотке крови
мунохемилюминесцентным методом для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-TSHR cobas e
analyzer/ATSHR), вариант исполнения 300 тестов, в составе:

3. Реагент для предварительной обработки (ATSHR PTR), флакон, объем 4,0 мл – 2 шт.;

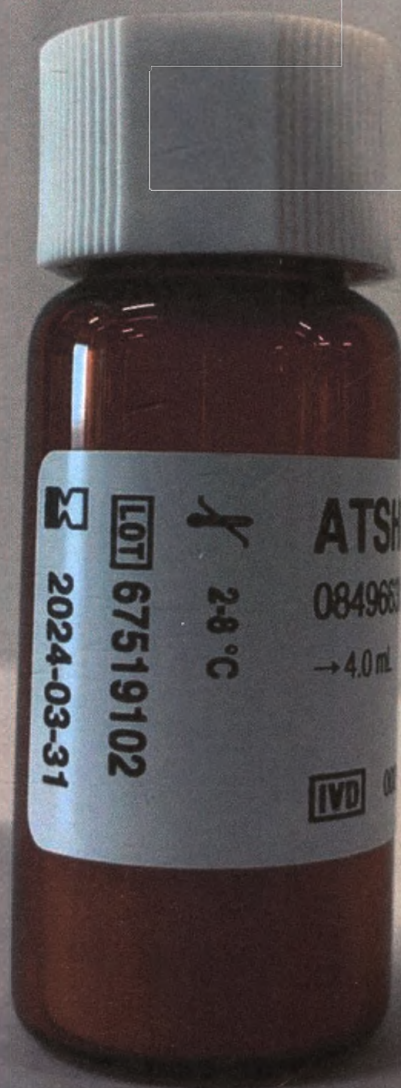


...ор реагентов для количественного определения аутоантител к рецептору ТТГ в сыворотке крови
...унохемилюминесцентным методом для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-TSHR cobas e
...alizers/ATSHR), вариант исполнения 300 тестов, в составе:

Буфер для предварительной обработки (ATSHR PTB), флакон, объем 5,0 мл – 2 шт.;

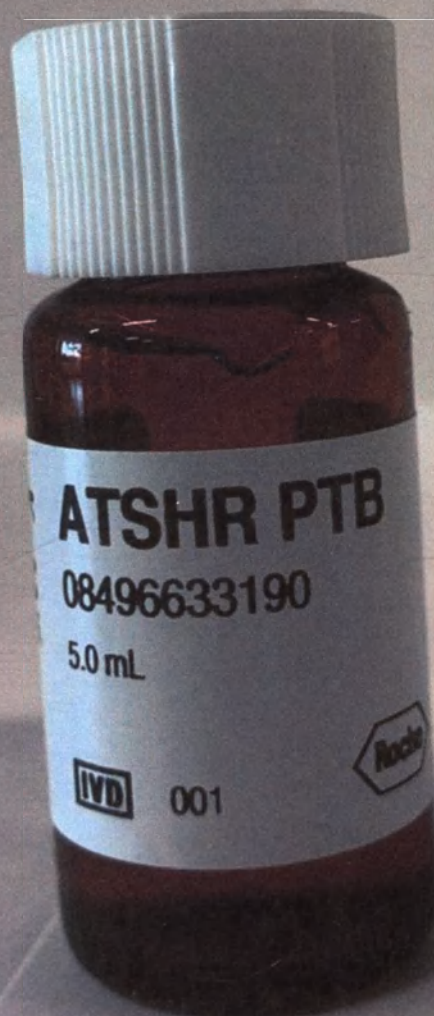

Набор реагентов для количественного определения аутоантител к рецептору ТТГ в сыворотке крови
иммунохемилюминесцентным методом для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-TSHR cobas e
analyzers/ATSHR), вариант исполнения 300 тестов, в составе:

4. Буфер для предварительной обработки (ATSHR РТВ), флакон, объем 5,0 мл – 2 шт.;

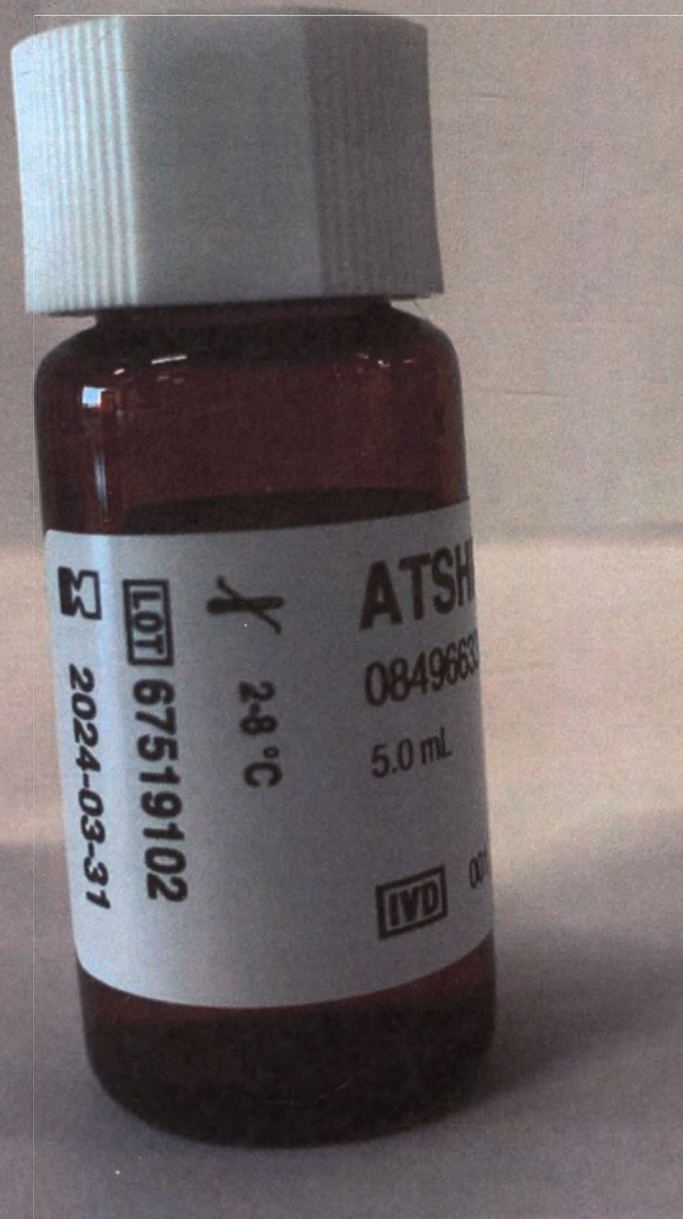

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
22 листа (ов)

Светлова Н. Г.



по доверенности
от 30.01.2023 г.