

Макет маркировки транспортной упаковки

**«Инструменты для систем дентальной имплантации.
Сверла хирургические, сверло центровочное, сверло для Пина, фрезы
костные и мукотом»
ТУ 32.50.11– 005 – 94681064 – 2022**

НЕСТЕРИЛЬНО

Регистрационное удостоверение № _____ от

Дата изготовления _____

Количество 100 шт.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с дня продажи.

Условия хранения и транспортирования – по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69 при для температуры от - 50°C до 50°C.

МАССА брутто - 0,3 кг

ИЗГОТОВИТЕЛЬ.

ООО «Ультра»


Юр. адрес 198215, Россия, Санкт-Петербург,

Дачный проспект, дом 36, корпус 6, литер А, пом. 4Н

Тел. (812) 379-79-76



 ООО ЦИПМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

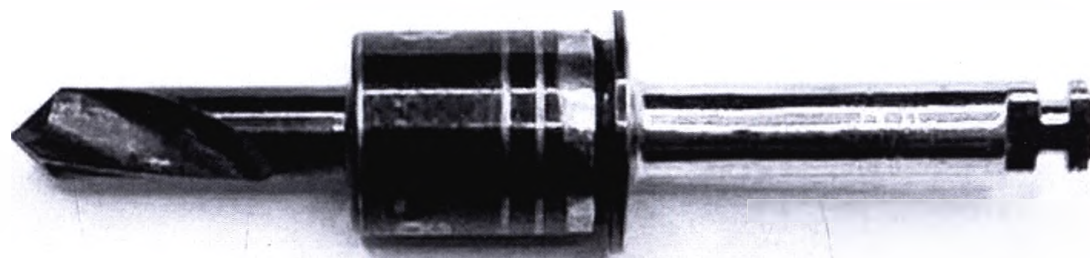

D2.3 L8.5

Ref 0951

D2.3 L10

Ref 0952

D2.3 L11.5


Ref 0953

D2.3 L13

Ref 0954

D2.3 L16

Ref 0955

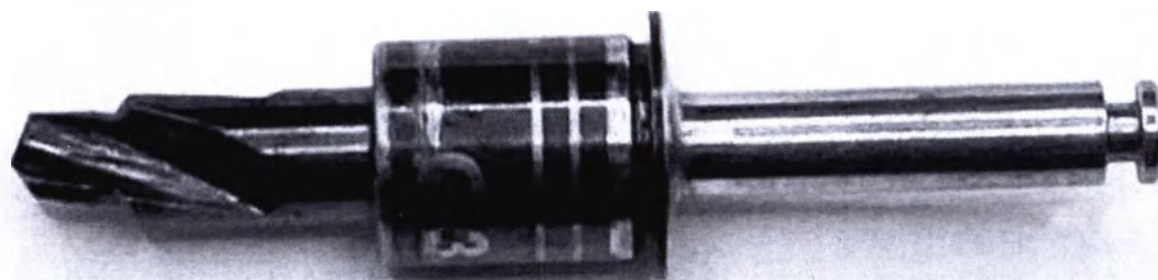

D3 L8.5

Ref 0956

D3 L10

Ref 0957

D3 L11.5

Ref 0958


D3 L13

Ref 0959

D3 L16

Ref 0960

Сверло хирургическое D3 L8.5 REF 0956; Сверло хирургическое D3 L10 REF 0957; Сверло хирургическое D3 L11.5 REF 0958;
Сверло хирургическое D3 L13 REF 0959; Сверло хирургическое D3 L16 REF 0960

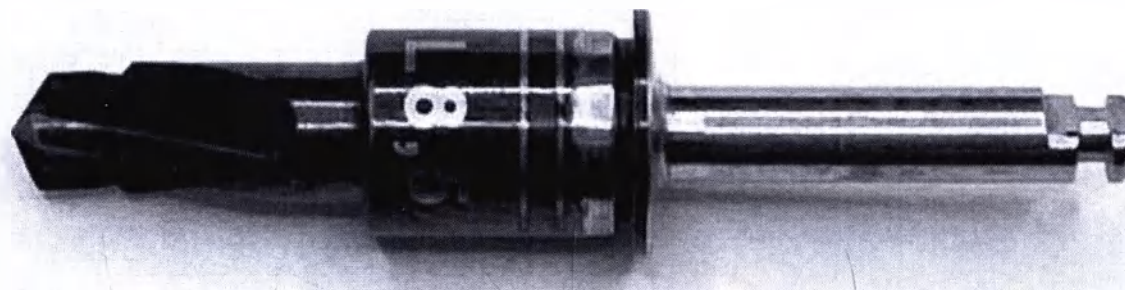

D3,4 L8,5

Ref 0961

D3,4 L10

Ref 0962

D3,4 L11,5


Ref 0963

D3,4 L13

Ref 0964

D3,4 L16

Ref 0965

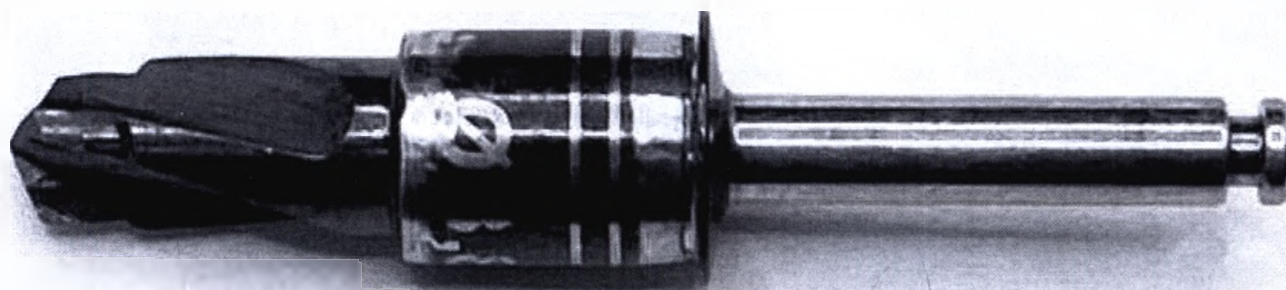

D3.8 L8.5

Ref 0966

D3.8 L10

Ref 0967

D3.8 L11,5

Ref 0968

D3.8 L13


Ref 0969

D3.8 L16


Ref 0970

Сверло хирургическое D3.8 L8.5 REF 0966; Сверло хирургическое D3.8 L10 REF 0967; Сверло хирургическое D3.8 L11.5 REF 0968;

ООО ЦРМИ info@cirmi.ru www.goszdravnadzor.ru 13 REF 0969; Сверло хирургическое D3.8 L16 REF 0970

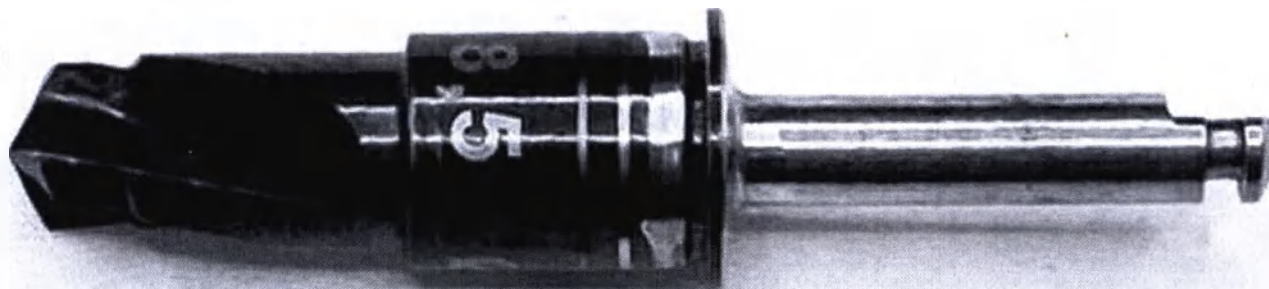

D4.2 L8.5	Ref 0971
D4.2 L10	Ref 0972
D4.2 L11.5	Ref 0973
D4.2 L13	Ref 0974
D4.2 L16	Ref 0975

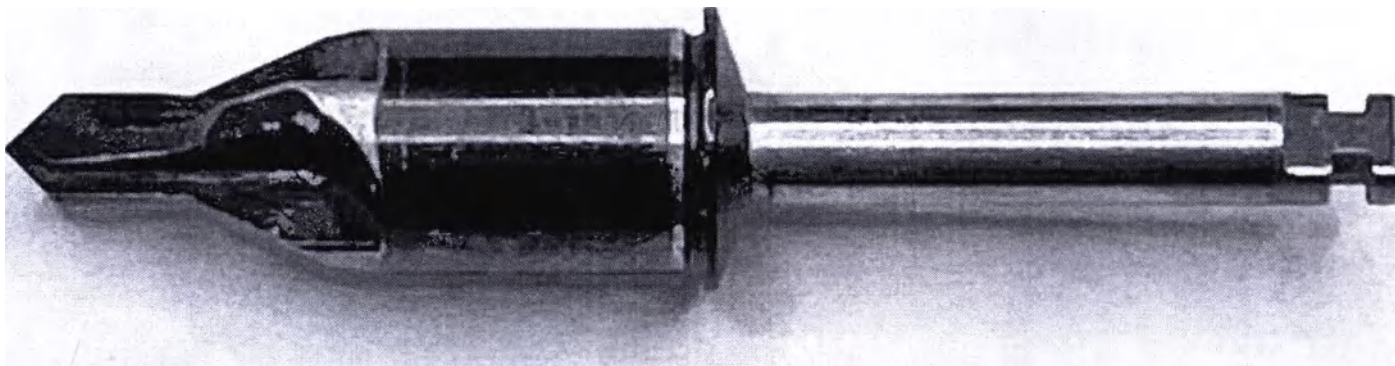


Ref 0980




Ref 0982

Сверло для Пина REF 0982 0982

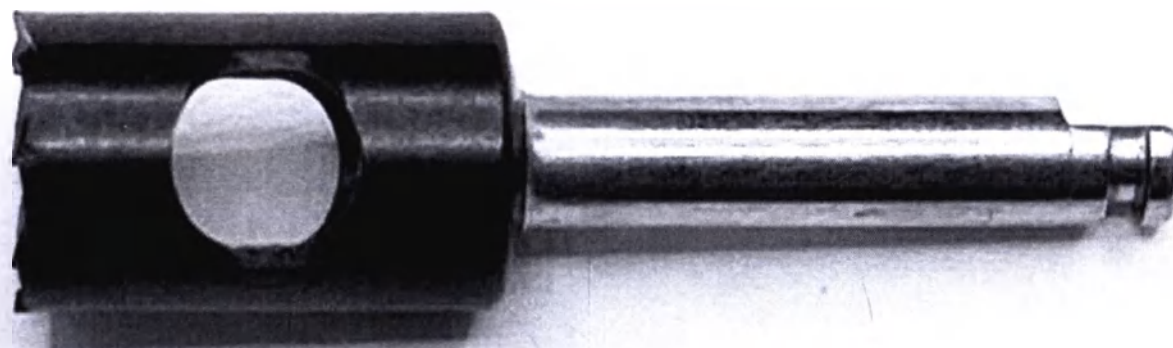


Ref 0977

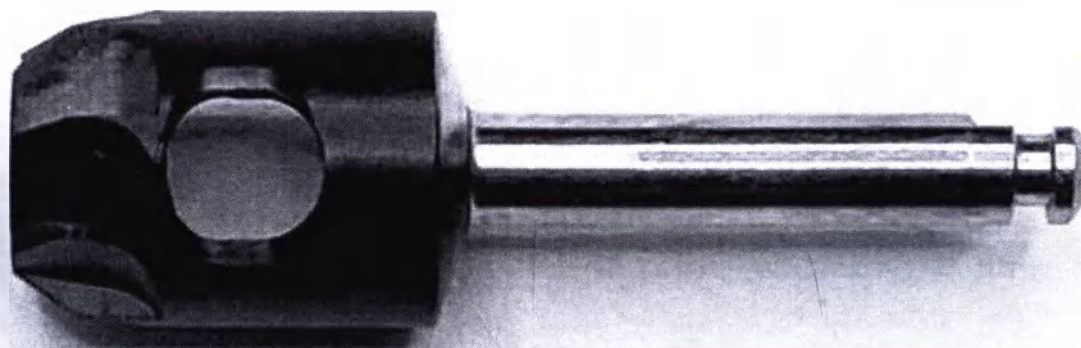

Ref 0978

Фреза костная 2 REF 0978

МУКОТОМ

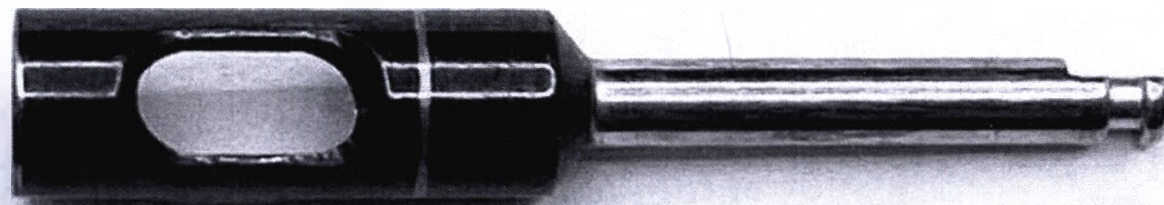

Ref 0979

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 10 лист(ов)

Руководитель организации

