

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ЗАО НПО «АСТА»

Спиридонов В. Н.

«2» июня 2023 г.


М.П.



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО
ИЗДЕЛИЯ УПАКОВКИ И МАРКИРОВКИ**

**«Жидкий Моноклональный реагент Anti-k (KEL 2) для
определения эритроцитарных антигенов к методом
агглютинации»**

Жидкий Моноклональный реагент Anti-k (KEL 2) для определения эритроцитарных антигенов к методом агглютинации (Общий вид)

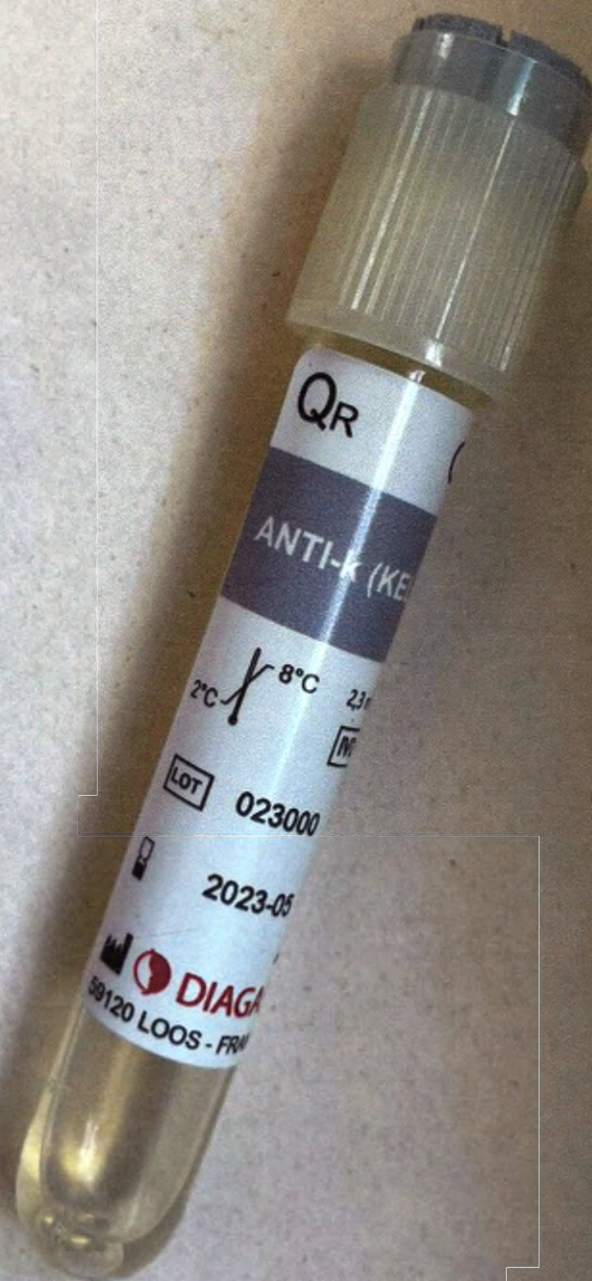



Потребительская упаковка

Жидкий Моноклональный реагент Anti-k (KEL 2) для определения эритроцитарных антигенов к методом агглютинации



rev2



Attention

H317 P261
P280 P272
P333+P313
P302+P352
P501

QR

ANTI-k (KEL2)

P3A118OL67



(01) 23661502205004

(17) 200131



(10) 017000


(21) 000175



www.diagast.com

Key code : DIA00000

REF 20508	LOT 017000	 2020-01
2.3 ml	CE	 2°C - 8°C
		IVD

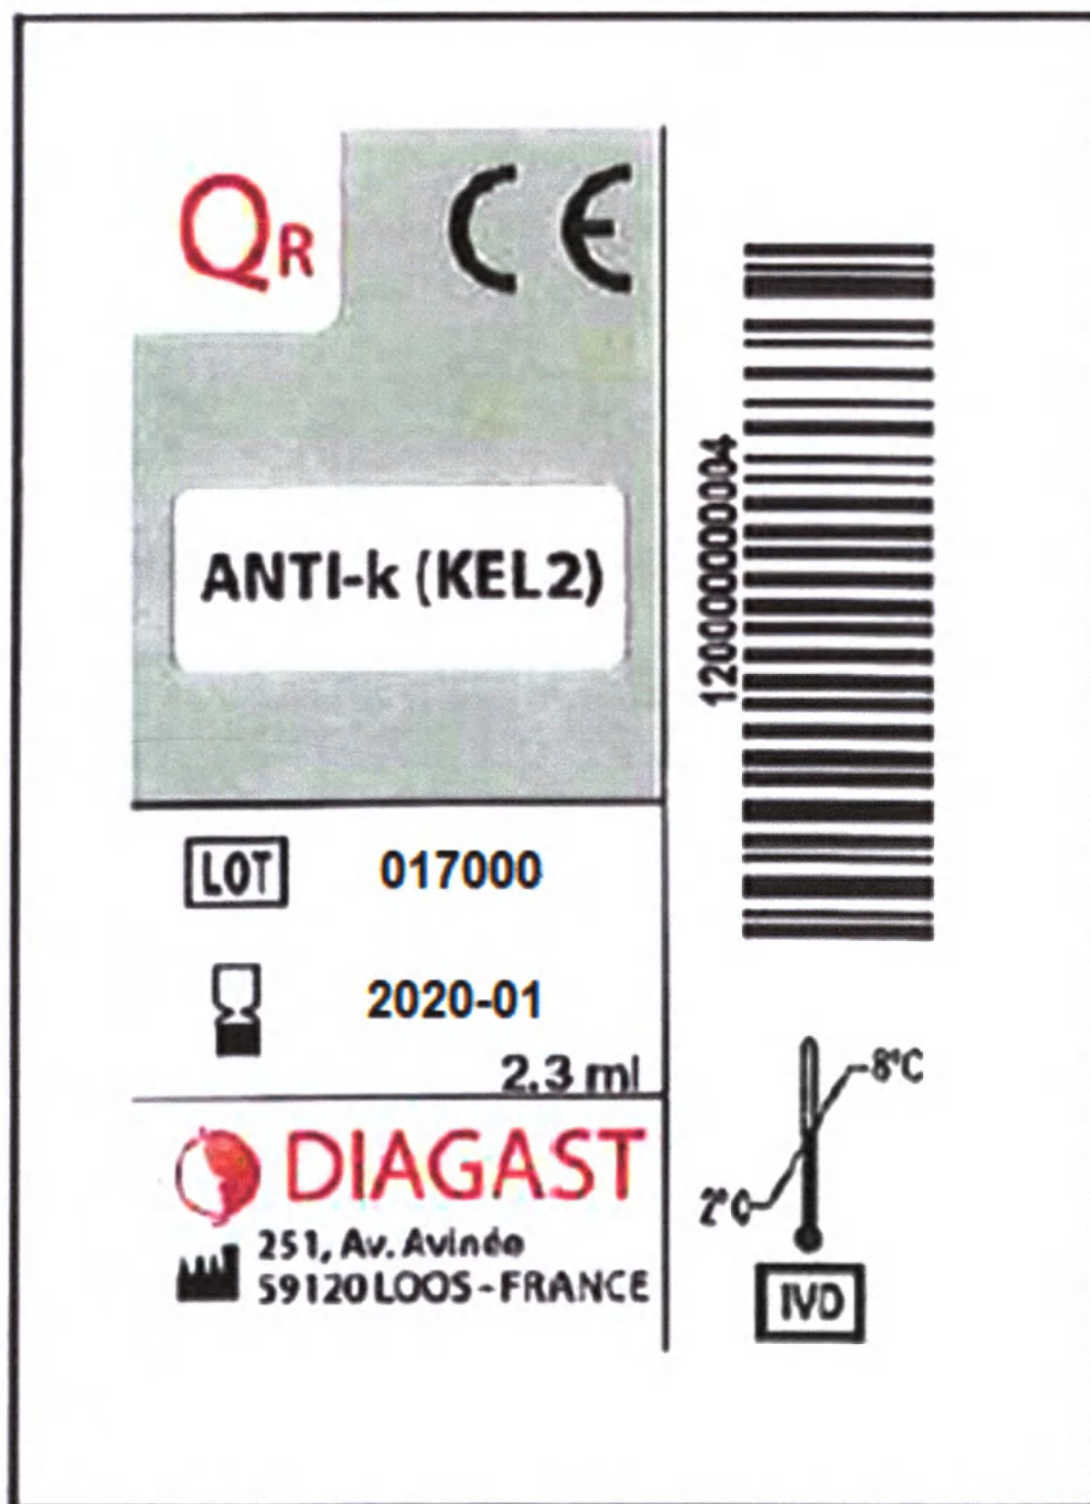

Макет русскоязычного стикера на упаковке медицинского изделия

Жидкий Моноклональный реагент Anti-k (KEL 2) для определения эритроцитарных антигенов k методом агглютинации

1. Пробирка с реагентом (2,3 мл.)– 1 шт.
2. Инструкция по применению – 1 шт.

антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют



Регистрационное удостоверение _____

Утилизировать как потенциально опасные отходы (класса Б)



Произведено во Франции

DIAGAST S.A.S., FRANCE ДИАГАСТ С.А.С., Франция

Адрес производства: 251, avenue Eugène Avinée, Eurasanté Parc, 59120 LOOS, FRANCE

Уполномоченный представитель в РФ: ЗАО «НПО АСТА», адрес: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, 6 эт., оф. 1, тел. +7 495 781 04 08, факс +7 405 781 04 08 доб. 120, эл. почта:

blood@asta.ru, сайт: www.asta.ru.

