


Фотографические изображения ообщего вида
Набор контрольных образцов для контроля качества количественного определения гликозилированного гемоглобина в цельной крови методом латексной
иммунотурбидиметрии (ЭкспрессМ-контроль-HbA1c)
Комплект 1, серия 001 от 2022.07., срок годности до 2023.07.

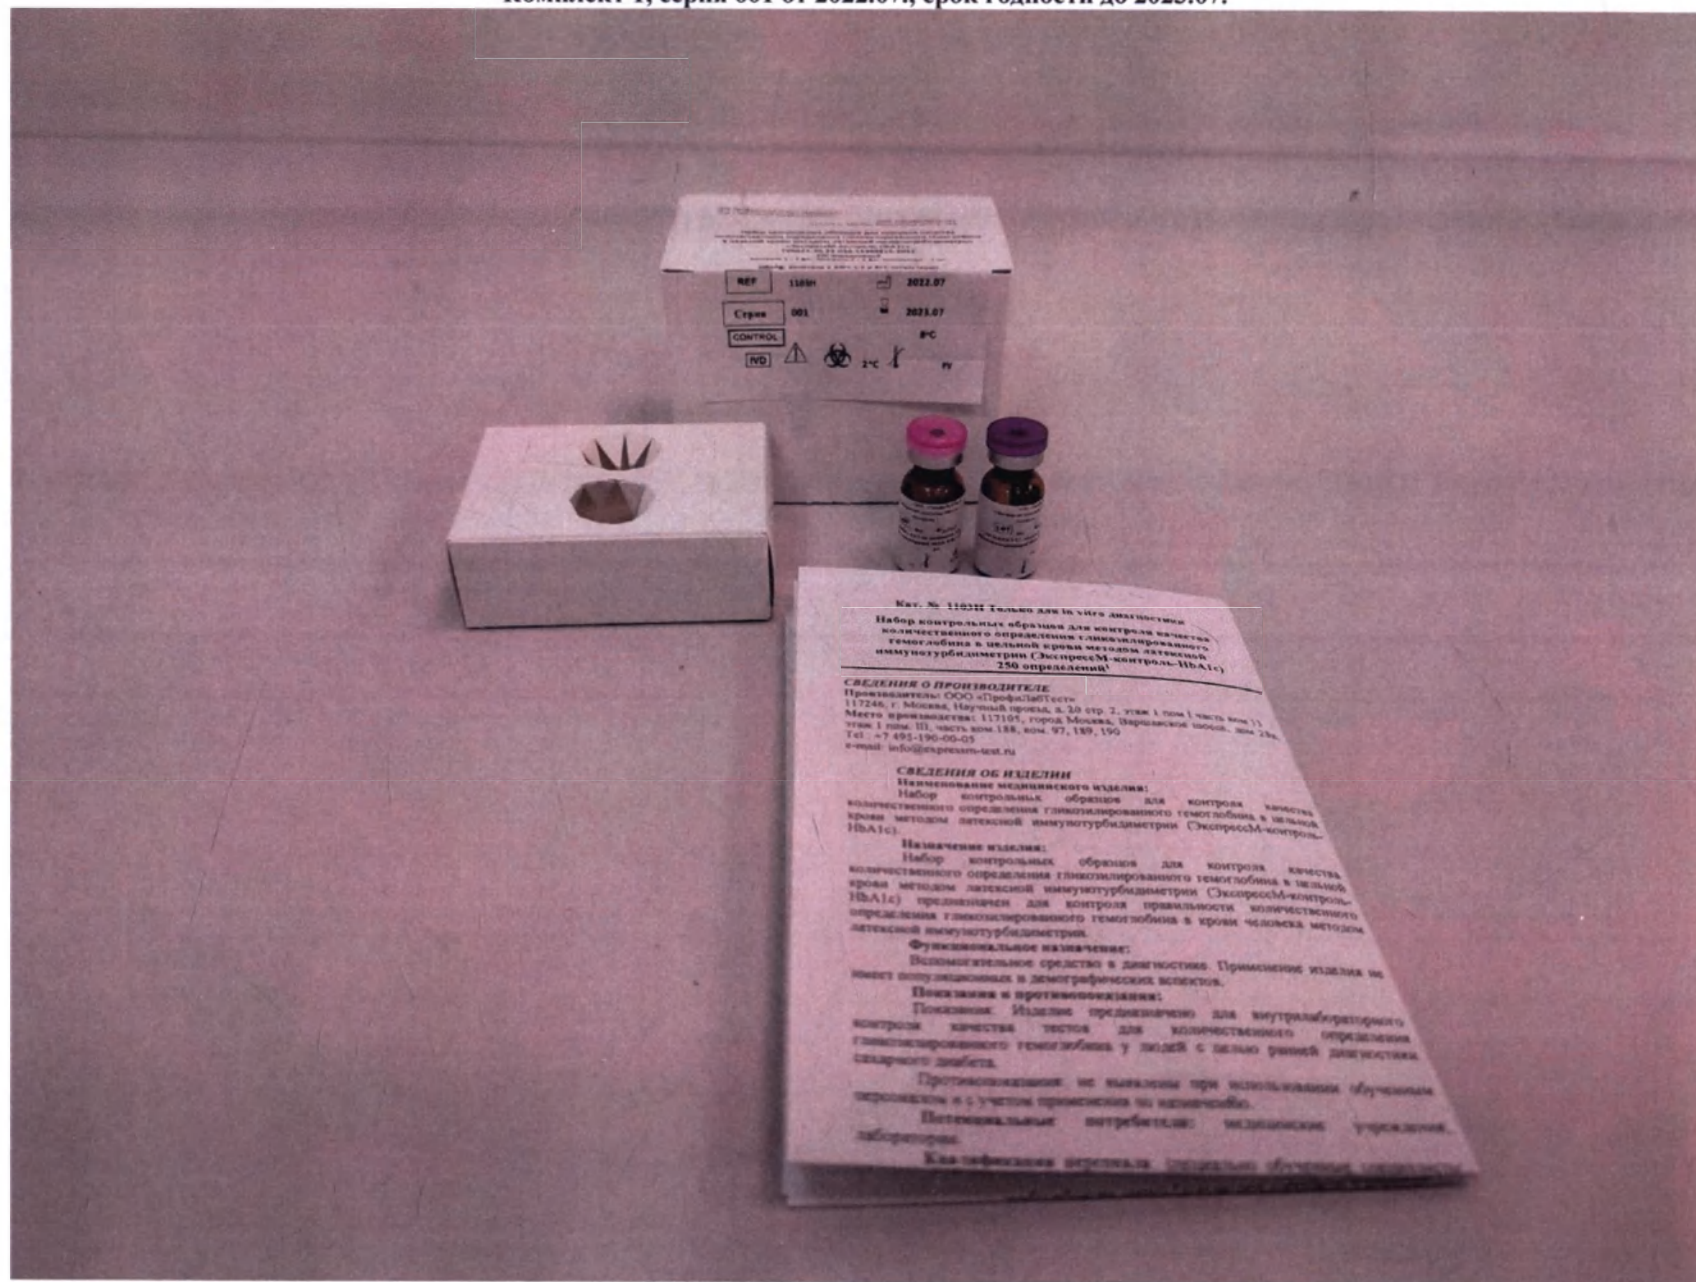

Для профессионального применения
Для учреждений здравоохранения


ООО «ПрофиЛабТест»
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 28А

Набор контрольных образцов для контроля качества
количественного определения гликозилированного гемоглобина
в цельной крови методом латексной иммунотурбидиметрии

«ЭкспрессМ-контроль-HbA1c»
ТУ № 21.20.23-034-13399815-2022

250 определений
Контроль 1 – 1 фла., Контроль 2 – 1 фла., Инструкция – 1 шт.

HbA_{1c}, антитела к ВИЧ-1, 2 и ВГС отсутствуют

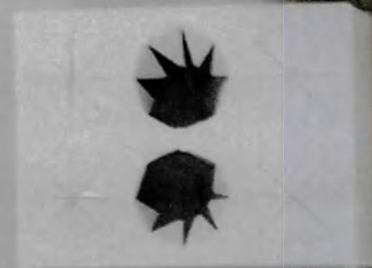

Кат. № 1103Н Только для in vitro диагностики

Набор контрольных образцов для контроля качества
количественного определения гликозилированного
гемоглобина в цельной крови методом латексной
иммунотурбидиметрии (ЭкспрессМ-контроль-HbA_{1c})
250 определений¹

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Производитель: ООО «ПрофиЛабТест»

117246, г. Москва, Научный проезд, д. 20 стр. 2, этаж I пом. I часть ком. I/1
Место производства: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 28А,
этаж I пом. III, часть ком. 188, ком. 97, 189, 190

Tel.: +7 495-190-00-05

e-mail: info@express-test.ru

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование медицинского изделия:

Набор контрольных образцов для контроля качества
количественного определения гликозилированного гемоглобина в цельной
крови методом латексной иммунотурбидиметрии (ЭкспрессМ-контроль-
HbA_{1c})

Назначение изделия:

Набор контрольных образцов для контроля качества
количественного определения гликозилированного гемоглобина в цельной
крови методом латексной иммунотурбидиметрии (ЭкспрессМ-контроль-
HbA_{1c}) предназначен для контроля правильности количественного
определения гликозилированного гемоглобина в крови человека методом
латексной иммунотурбидиметрии

Функциональное назначение:

Вспомогательное средство в диагностике. Применяемое изделие не
имеет побочных эффектов и аллергических реакций.


Показания и противопоказания:

Показания. Изделие предназначено для внутривенного введения
контроля качества теста для количественного определения
гликозилированного гемоглобина у людей с целью ранней диагностики
сахарного диабета.

Противопоказания не известны при использовании обученным
персоналом и с учетом применения по назначению.

Потенциальные потребители: медицинские учреждения,
лаборатории

Квалификация персонала: специалисты, обученные специальным

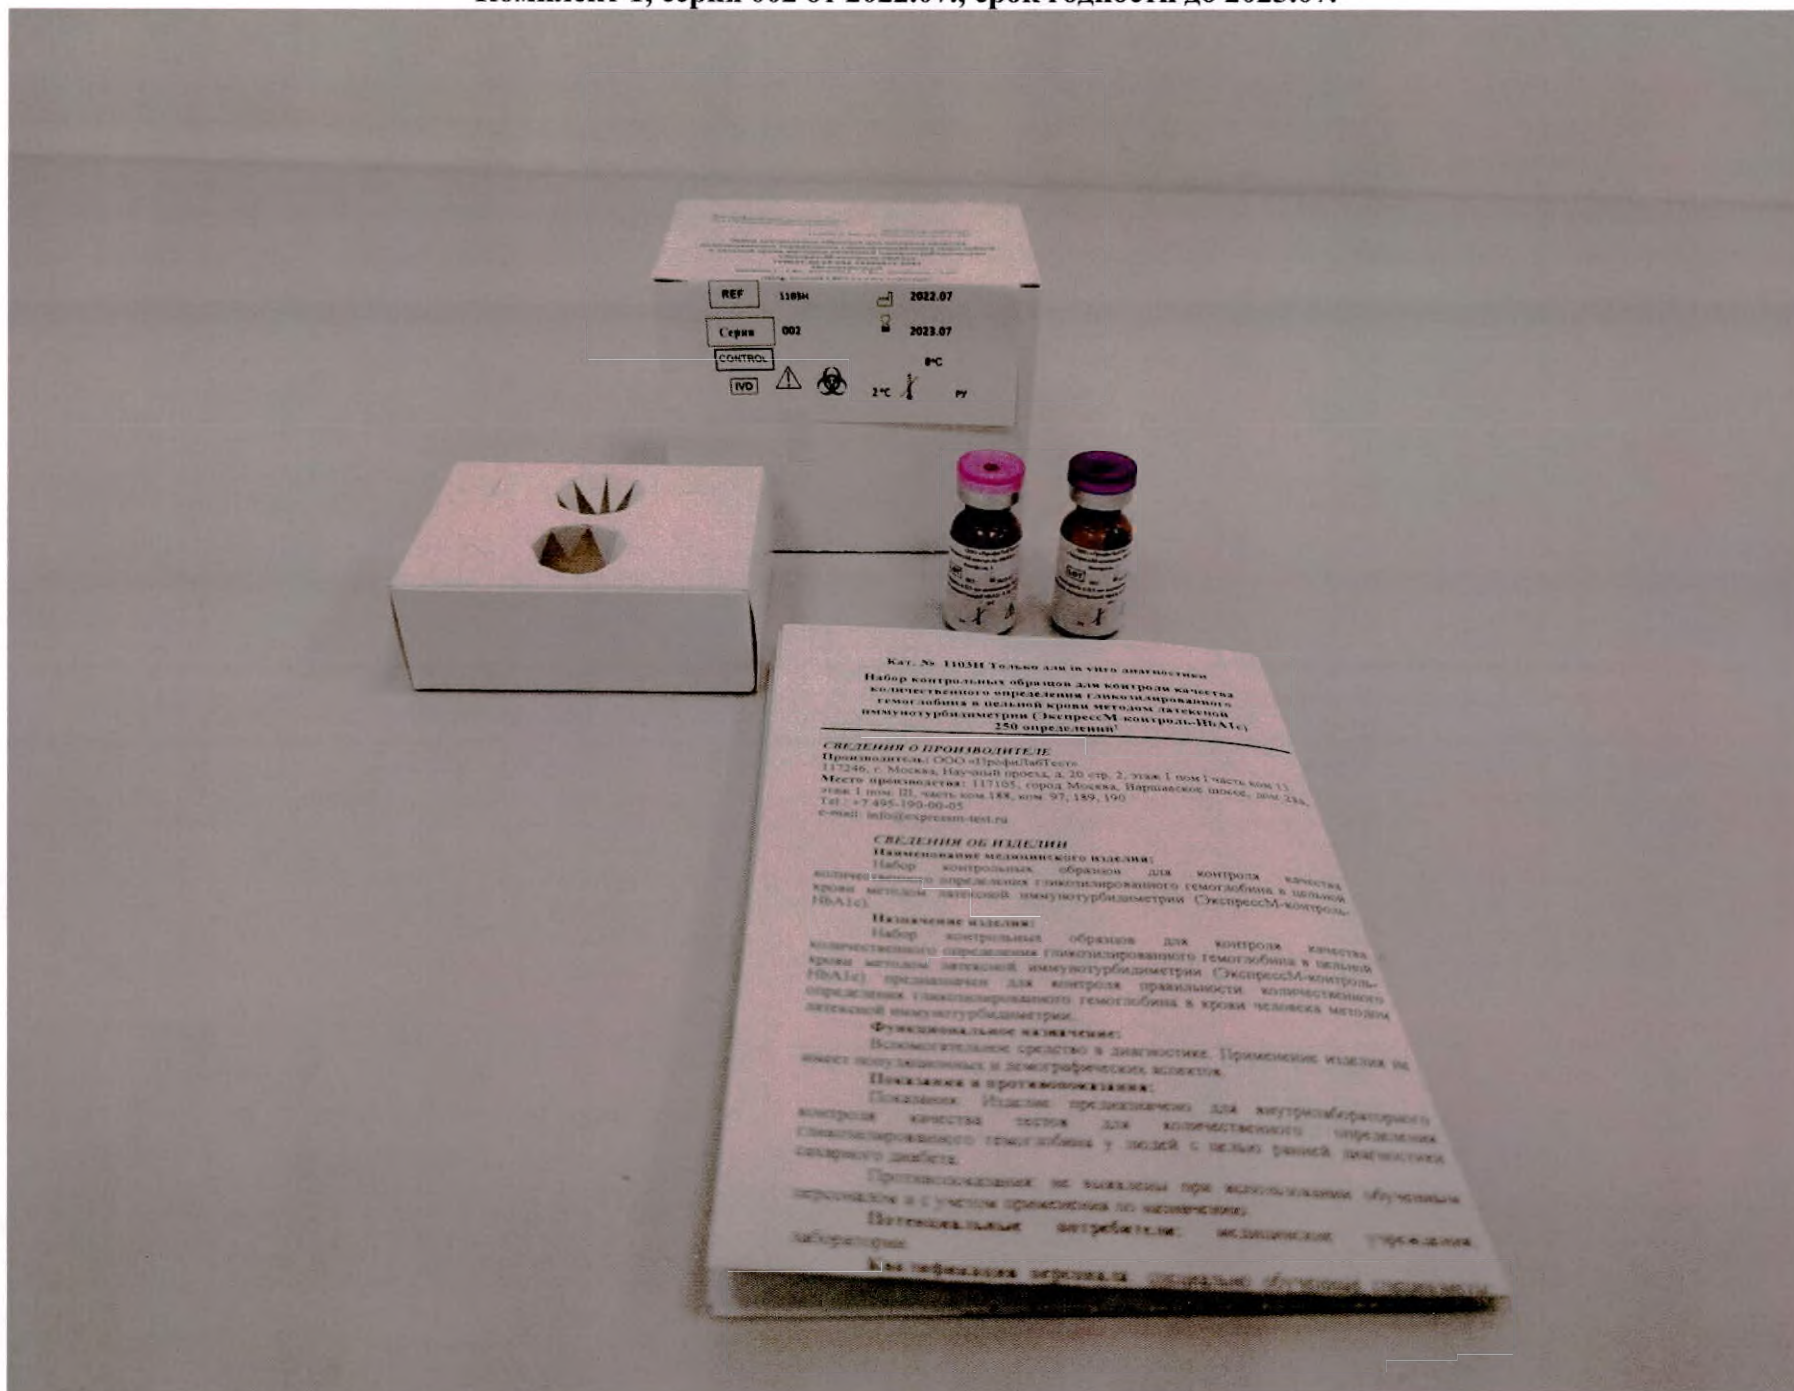

Для профессионального применения
Для учреждений здравоохранения

ООО «ПроФабрика»
117108, г. Москва, Вешняковское шоссе, 21А

Набор контрольных образцов для контроля качества
количественного определения никотинированного гемоглобина
в цельной крови методом иммунотурбидиметрии
«Экспресс-М-контроль-НВА1с»

ТУМ-21-30.23.014.11390815.2022

250 порцелиновых

Контроль 1 - 1 фл. Контроль 2 - 1 фл. Инструкция - 1 шт.

НВА1с, упаковка в 50 шт. 1 шт. в БС, сертификат

сертификат

сертификат

сертификат

сертификат

сертификат

сертификат

сертификат

сертификат

сертификат

сертификат

сертификат

сертификат

сертификат

сертификат

сертификат

сертификат

сертификат

сертификат

сертификат

сертификат

сертификат

сертификат

сертификат

сертификат

сертификат

сертификат

сертификат

сертификат

сертификат

сертификат

сертификат

сертификат

сертификат

сертификат

сертификат

сертификат

сертификат

сертификат

сертификат

сертификат

сертификат

сертификат

сертификат

сертификат

сертификат

сертификат

сертификат

сертификат

сертификат

сертификат

сертификат

сертификат

сертификат

сертификат

сертификат

сертификат

сертификат

сертификат

сертификат

сертификат

сертификат

сертификат

сертификат

сертификат

сертификат

сертификат

сертификат

сертификат

сертификат

сертификат

сертификат

сертификат

сертификат

сертификат

сертификат

сертификат

Кат. № 110311 Только для in vitro диагностики

Набор контрольных образцов для контроля качества
количественного определения никотинированного гемоглобина
в цельной крови методом иммунотурбидиметрии
«Экспресс-М-контроль-НВА1с»
250 порцелиновых

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВИТЕЛЕ

Производитель: ООО «ПроФабрика»
117246, г. Москва, Вешняковское шоссе, д. 20, стр. 2, этаж 1 (пол. 1-й этаж ком. 1)
Место производства: 117108, г. Москва, Вешняковское шоссе, дом 21А,
этаж 1 (пол. 1-й этаж ком. 18, пол. 91, 189, 190)
Tel.: +7 495 390-00-65
e-mail: info@profabrika.ru

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование медицинского изделия:
Набор контрольных образцов для контроля качества
количественного определения никотинированного гемоглобина в цельной
крови методом иммунотурбидиметрии «Экспресс-М-контроль-
НВА1с»

Назначение изделия

Набор контрольных образцов для контроля качества
количественного определения никотинированного гемоглобина в цельной
крови методом иммунотурбидиметрии «Экспресс-М-контроль-
НВА1с» предназначен для контроля правильности количественного
определения никотинированного гемоглобина в крови человека методом
иммунотурбидиметрии

Функциональные назначения:

Использовать в качестве средства для диагностики. Промышленное изделие не
имеет аналогов, созданных в профессиональных целях.

Положения в сертификации:


Положения. Изделие предназначено для использования в качестве
контрольных образцов для количественного определения
никотинированного гемоглобина у людей с целью ранней диагностики
сахарного диабета.

Противопоказания не выявлены при использовании обученным
персоналом с учетом рекомендаций по применению.
Потребляемые материалы: медицинские учреждения,
лаборатории.


Как показана информация об изделии, см. в инструкции.

Фотографические изображения компонентов Набор контрольных образцов для контроля качества количественного определения гликозилированного гемоглобина в цельной крови методом латексной иммунотурбидиметрии (ЭкспрессМ-контроль-HbA1c), имеющих маркировку


1. Контроль 1

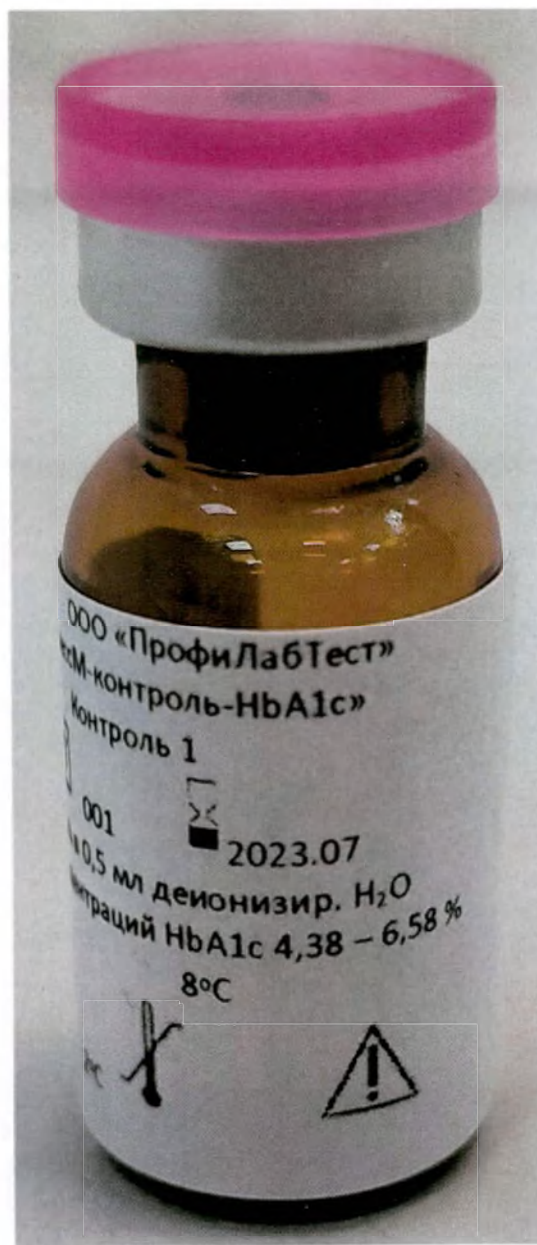

2. Контроль 2

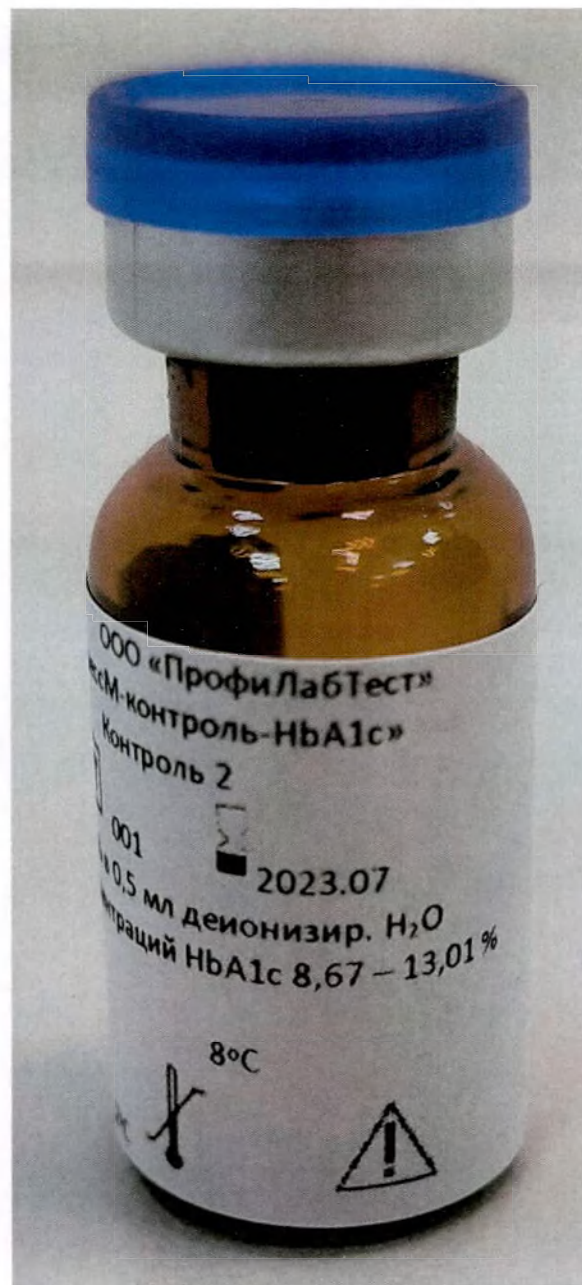

3. Упаковка

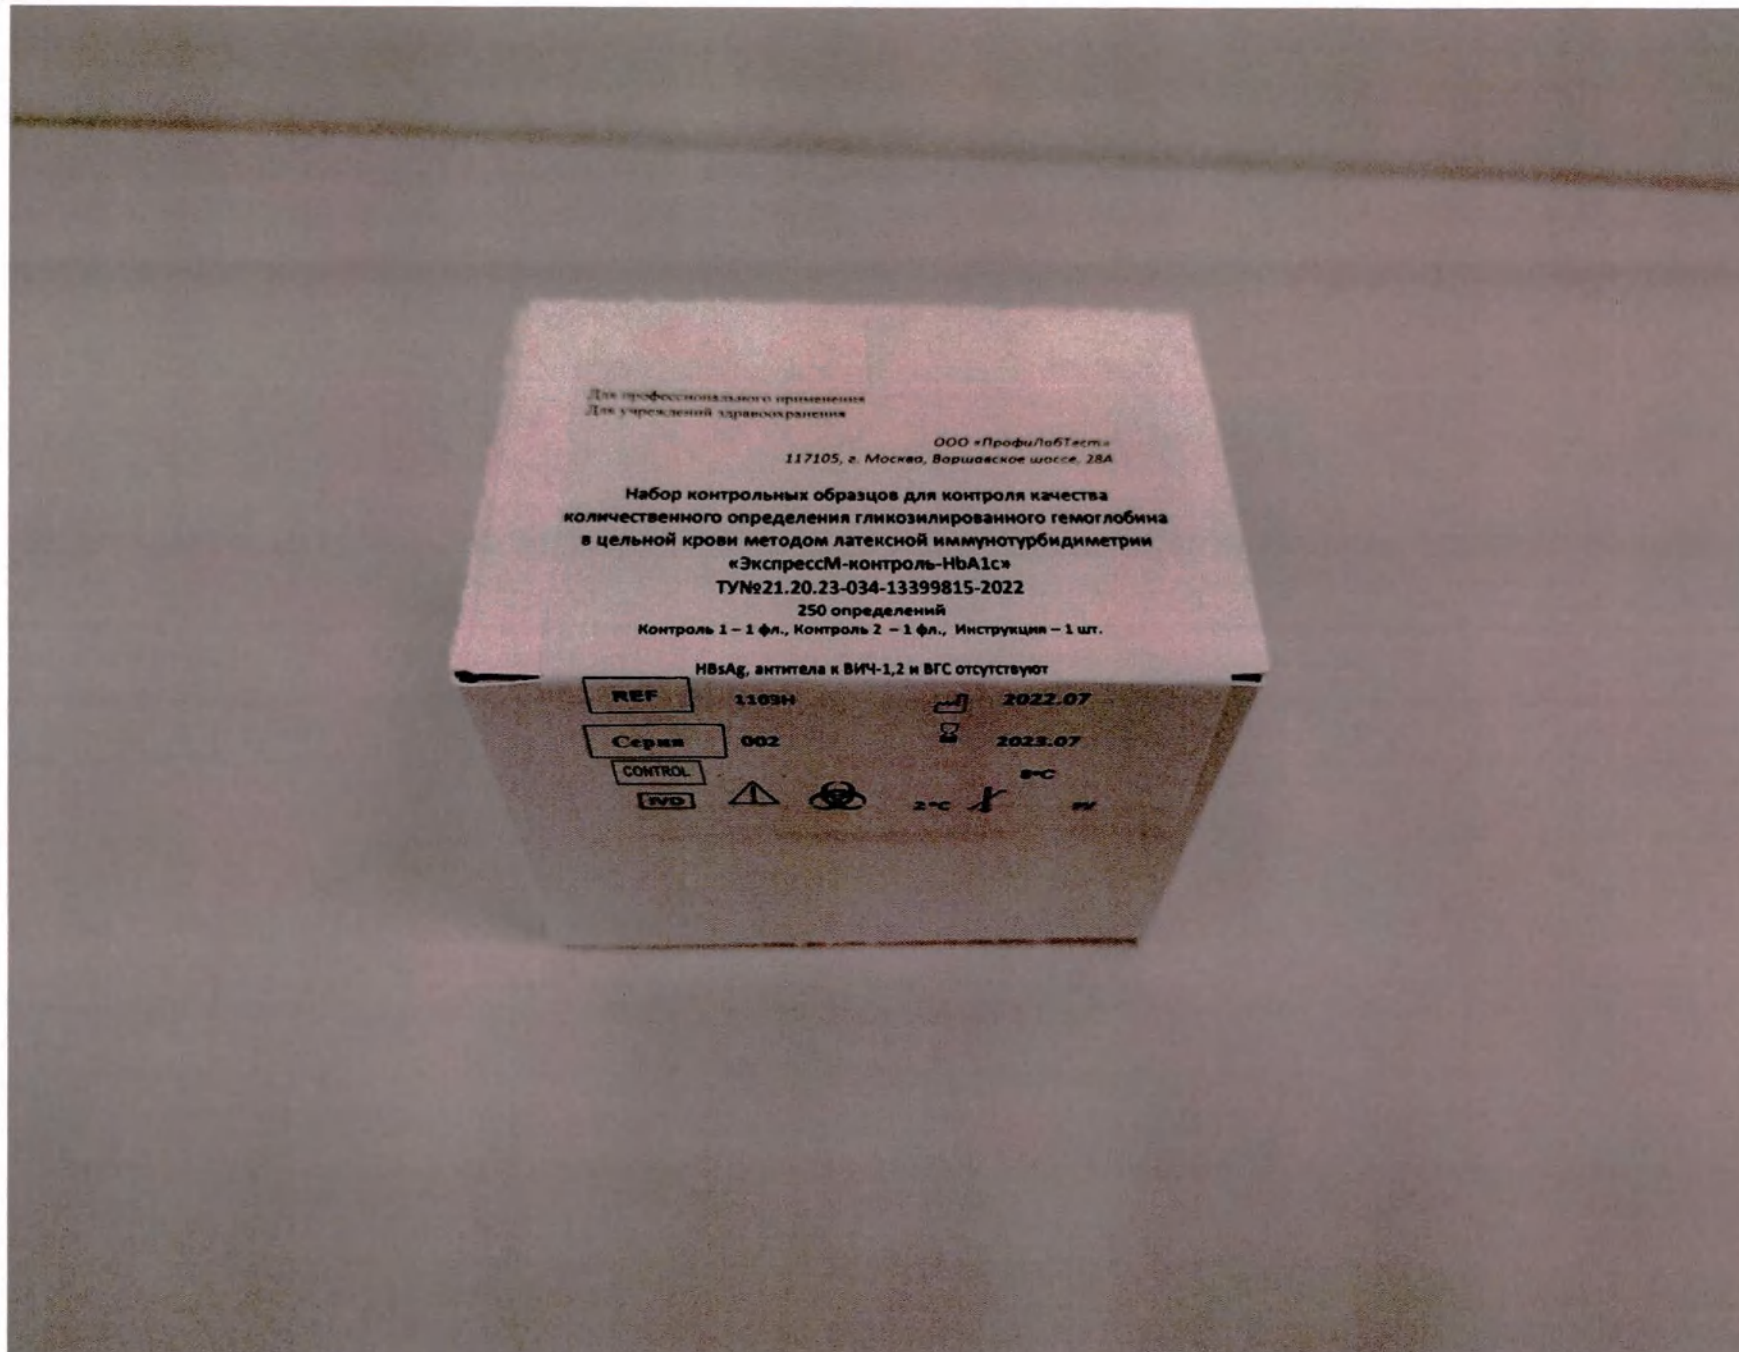



ООО «ПрофиЛабТест»



117246, г. Москва, Научный проезд,
д. 20 стр. 2, этаж 1 пом I часть ком 13.



+7 495-19-0000-5

+7-985-57-2233-0



info@expressm-test.ru



www.expressm-test.ru



4. Макеты транспортной упаковки





ООО «ПрофиЛабТест»

Набор контрольных образцов для контроля качества
количественного определения гликозилированного
гемоглобина в цельной крови методом латексной
иммунотурбидиметрии
(ЭкспрессМ-контроль-HbA1c)

REF

1103H



2022.07

Серия

002



2023.07

Σ 14 шт.

8°C

2°C




Масса нетто: 457,8 г

Масса брутто: 1089,5 г

Масса потребительской упаковки: 1089,5 г



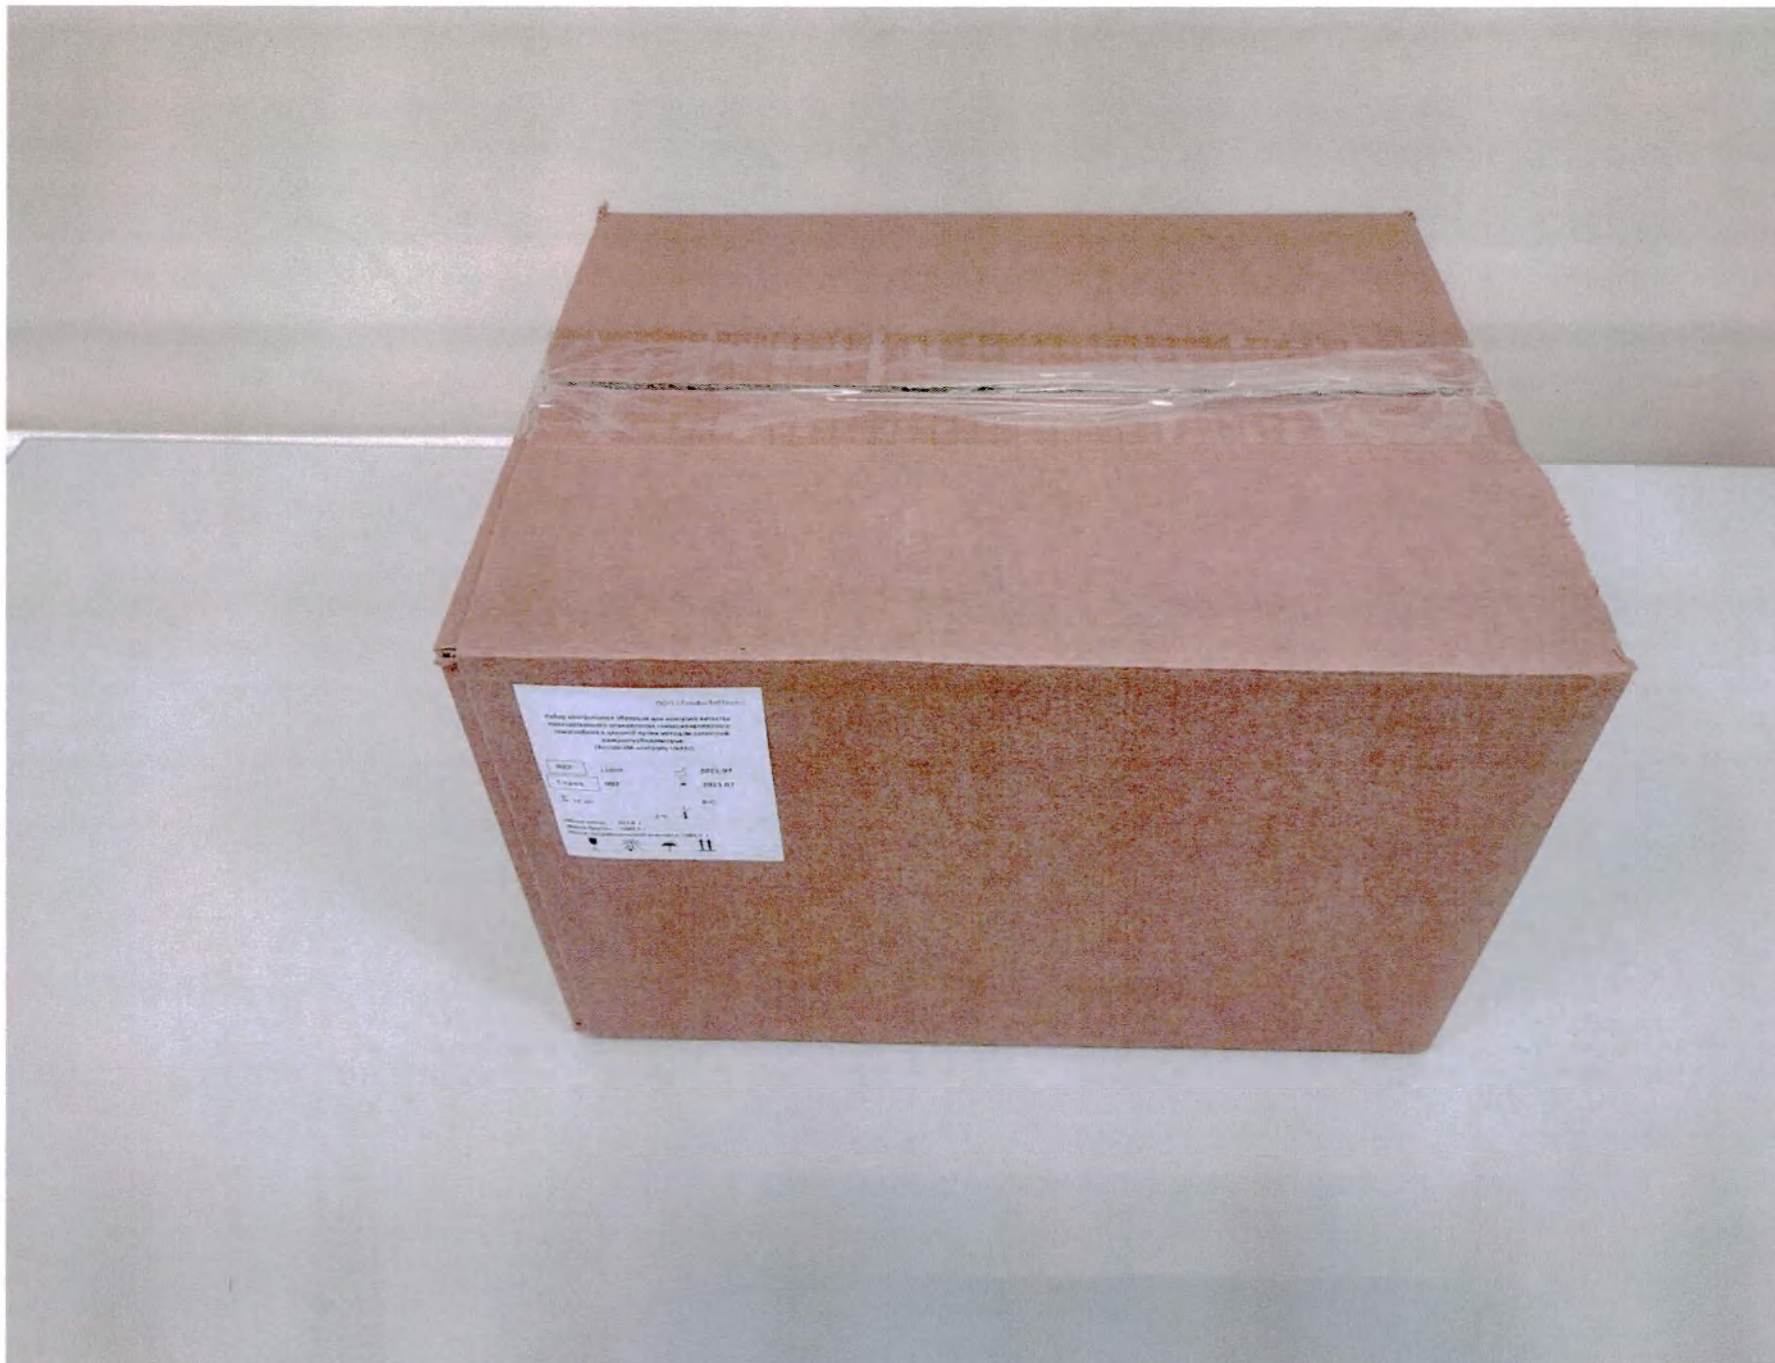

ООО «ПрофиЛабТест»

Набор контрольных образцов для контроля качества
количественного определения гликозилированного
гемоглобина в цельной крови методом латексной
иммунотурбидиметрии
(ЭкспрессМ-контроль-HbA1c)

REF

1103H



2022.07

Серия

003



2023.07

Σ 5 шт.

8°C

2°C



Масса нетто: 163,5 г

Масса брутто: 689,2 г

Масса потребительской упаковки: 689,2 г





Генеральный директор ООО «ПрофиЛабТест»



Киреев А.И.



Прошнуровано, пронумеровано,
скреплено печатью

14 лист

Генеральный директор

ООО "ПрофиЛабТест"



Киреев А.И.

