

Руководитель отдела качества и корпоративных технологий

ООО «Сименс Здравоохранение»

И.Б.Медведева



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:**

**«Система ультразвуковая диагностическая, варианты исполнения ACUSON NX3, ACUSON NX3 Elite с принадлежностями»,**  
производства «Siemens Medical Solutions USA, Inc.»  
(Сименс Медикал Солюшенс США, Инк.), США

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия  
**«Система ультразвуковая диагностическая, варианты исполнения ACUSON NX3 с принадлежностями»**



Рисунок 1. Система ультразвуковая диагностическая с сенсорным экраном ACUSON NX3

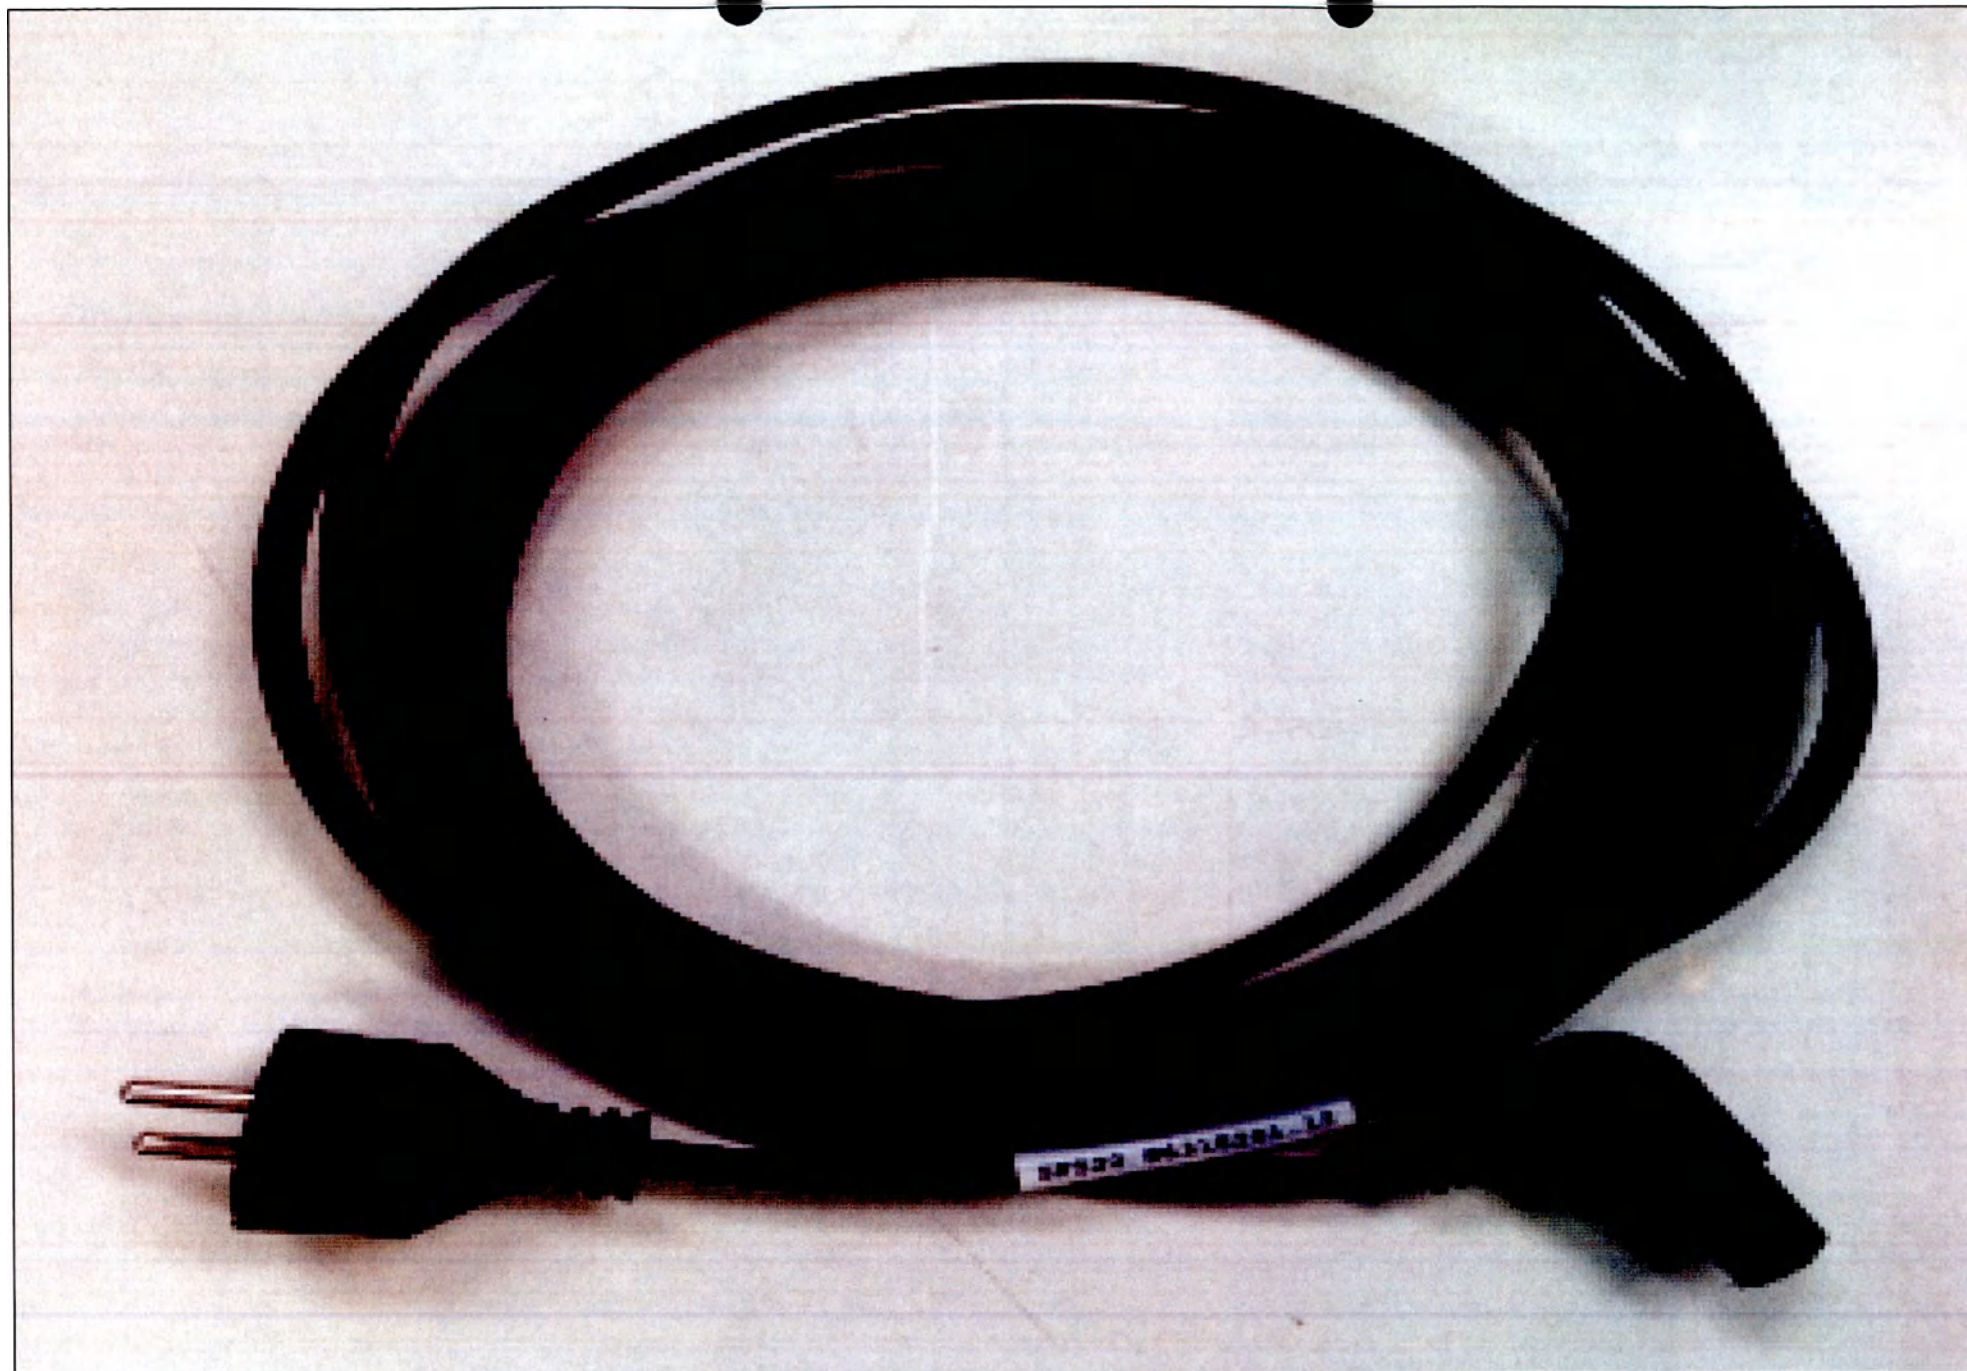


Рисунок 2. Кабель электропитания — 1 шт. (но не более 10 шт. при необходимости).



Рисунок 3. Датчик CH5-2 конвексный — 1 шт. (но не более 30 шт. при необходимости).

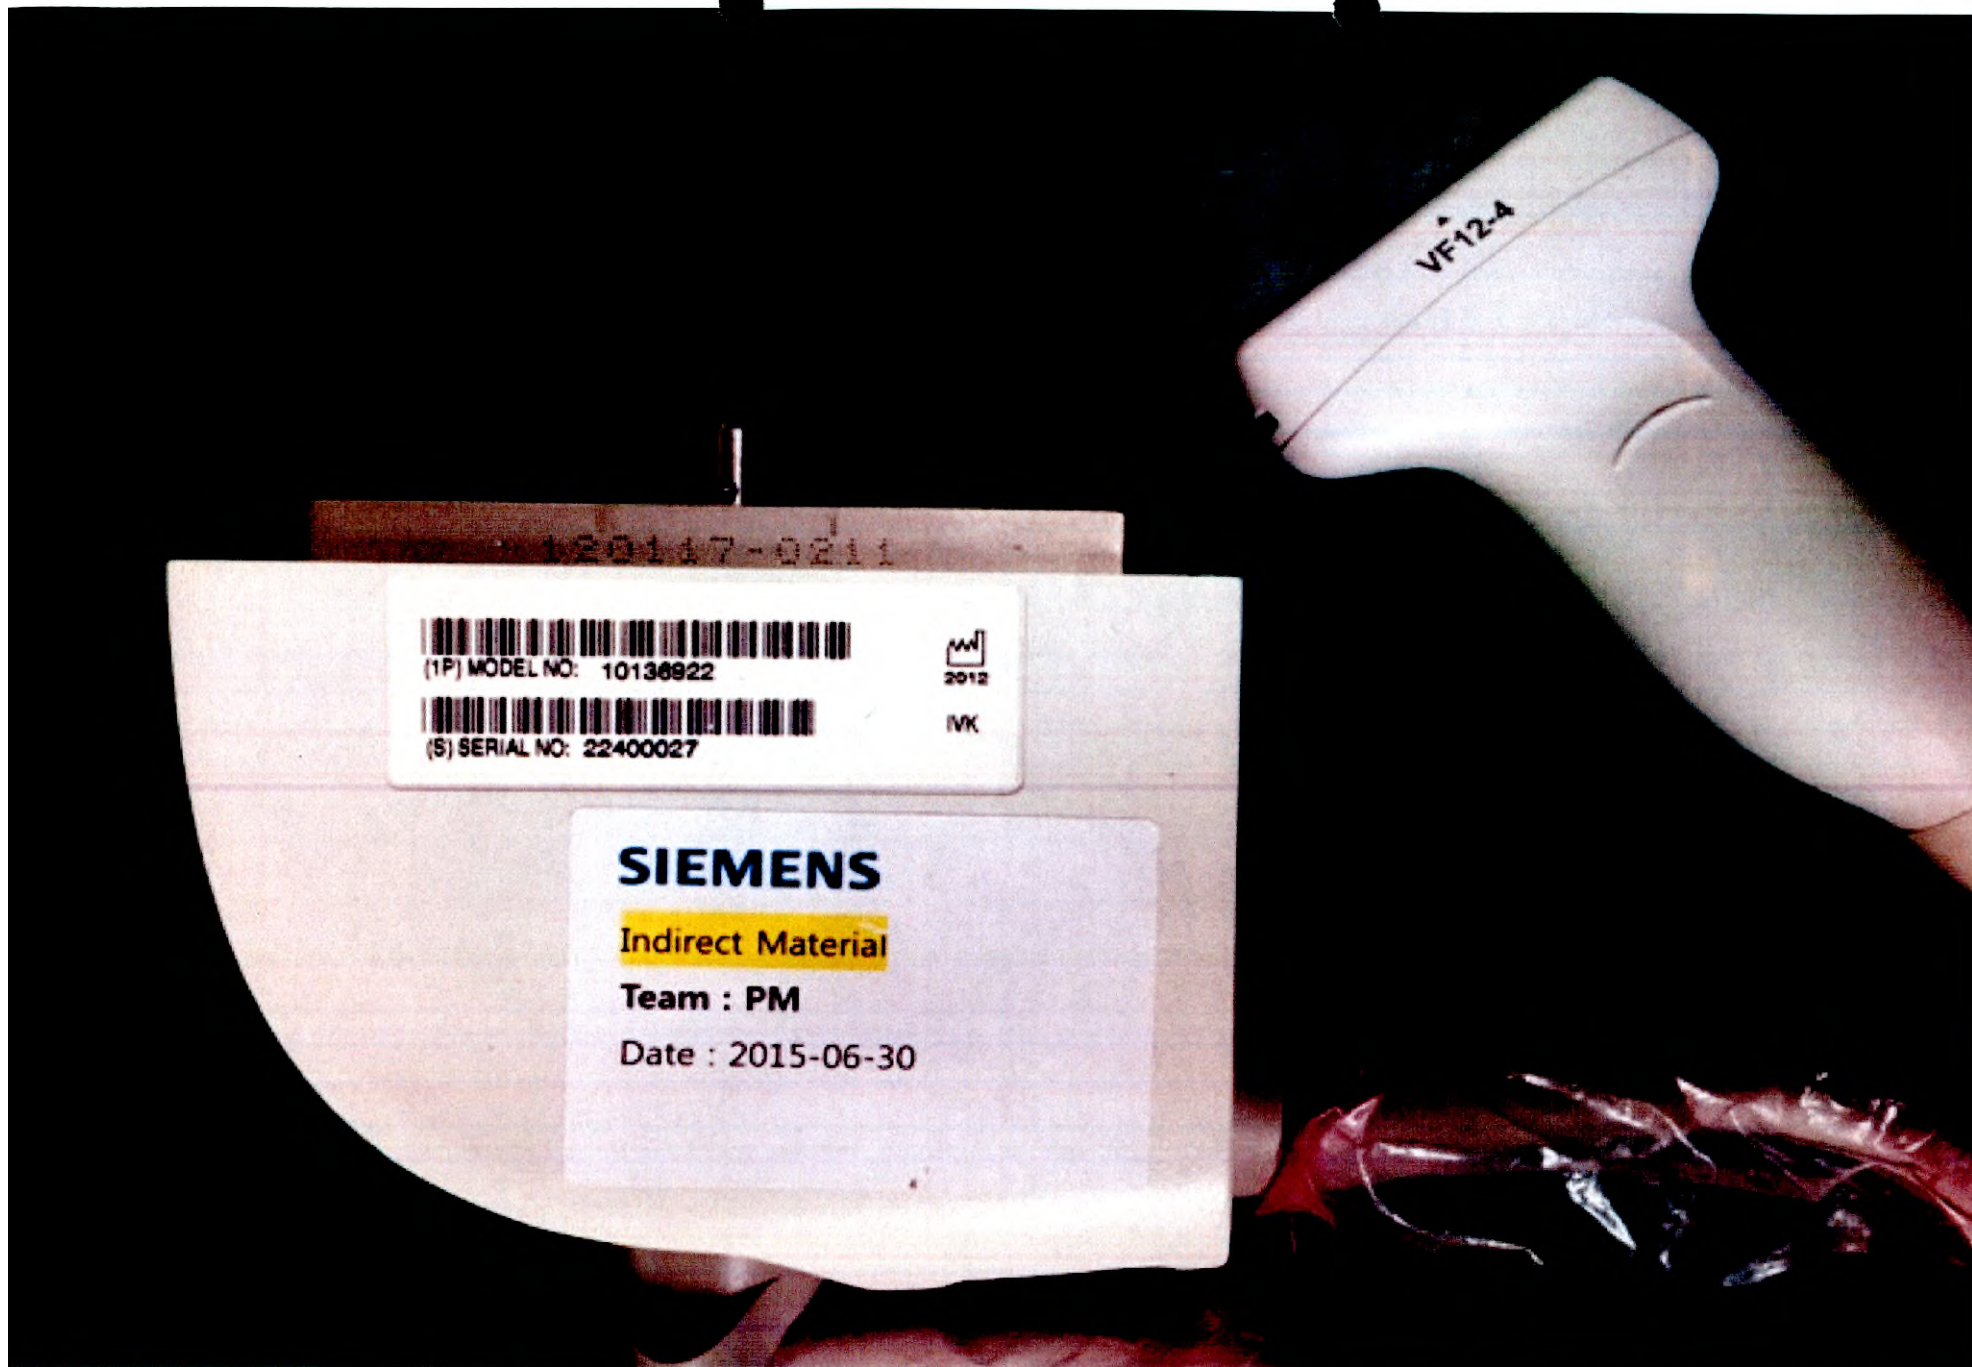


Рисунок 4. Датчик VF12-4 линейный — 1 шт. (но не более 30 шт. при необходимости).

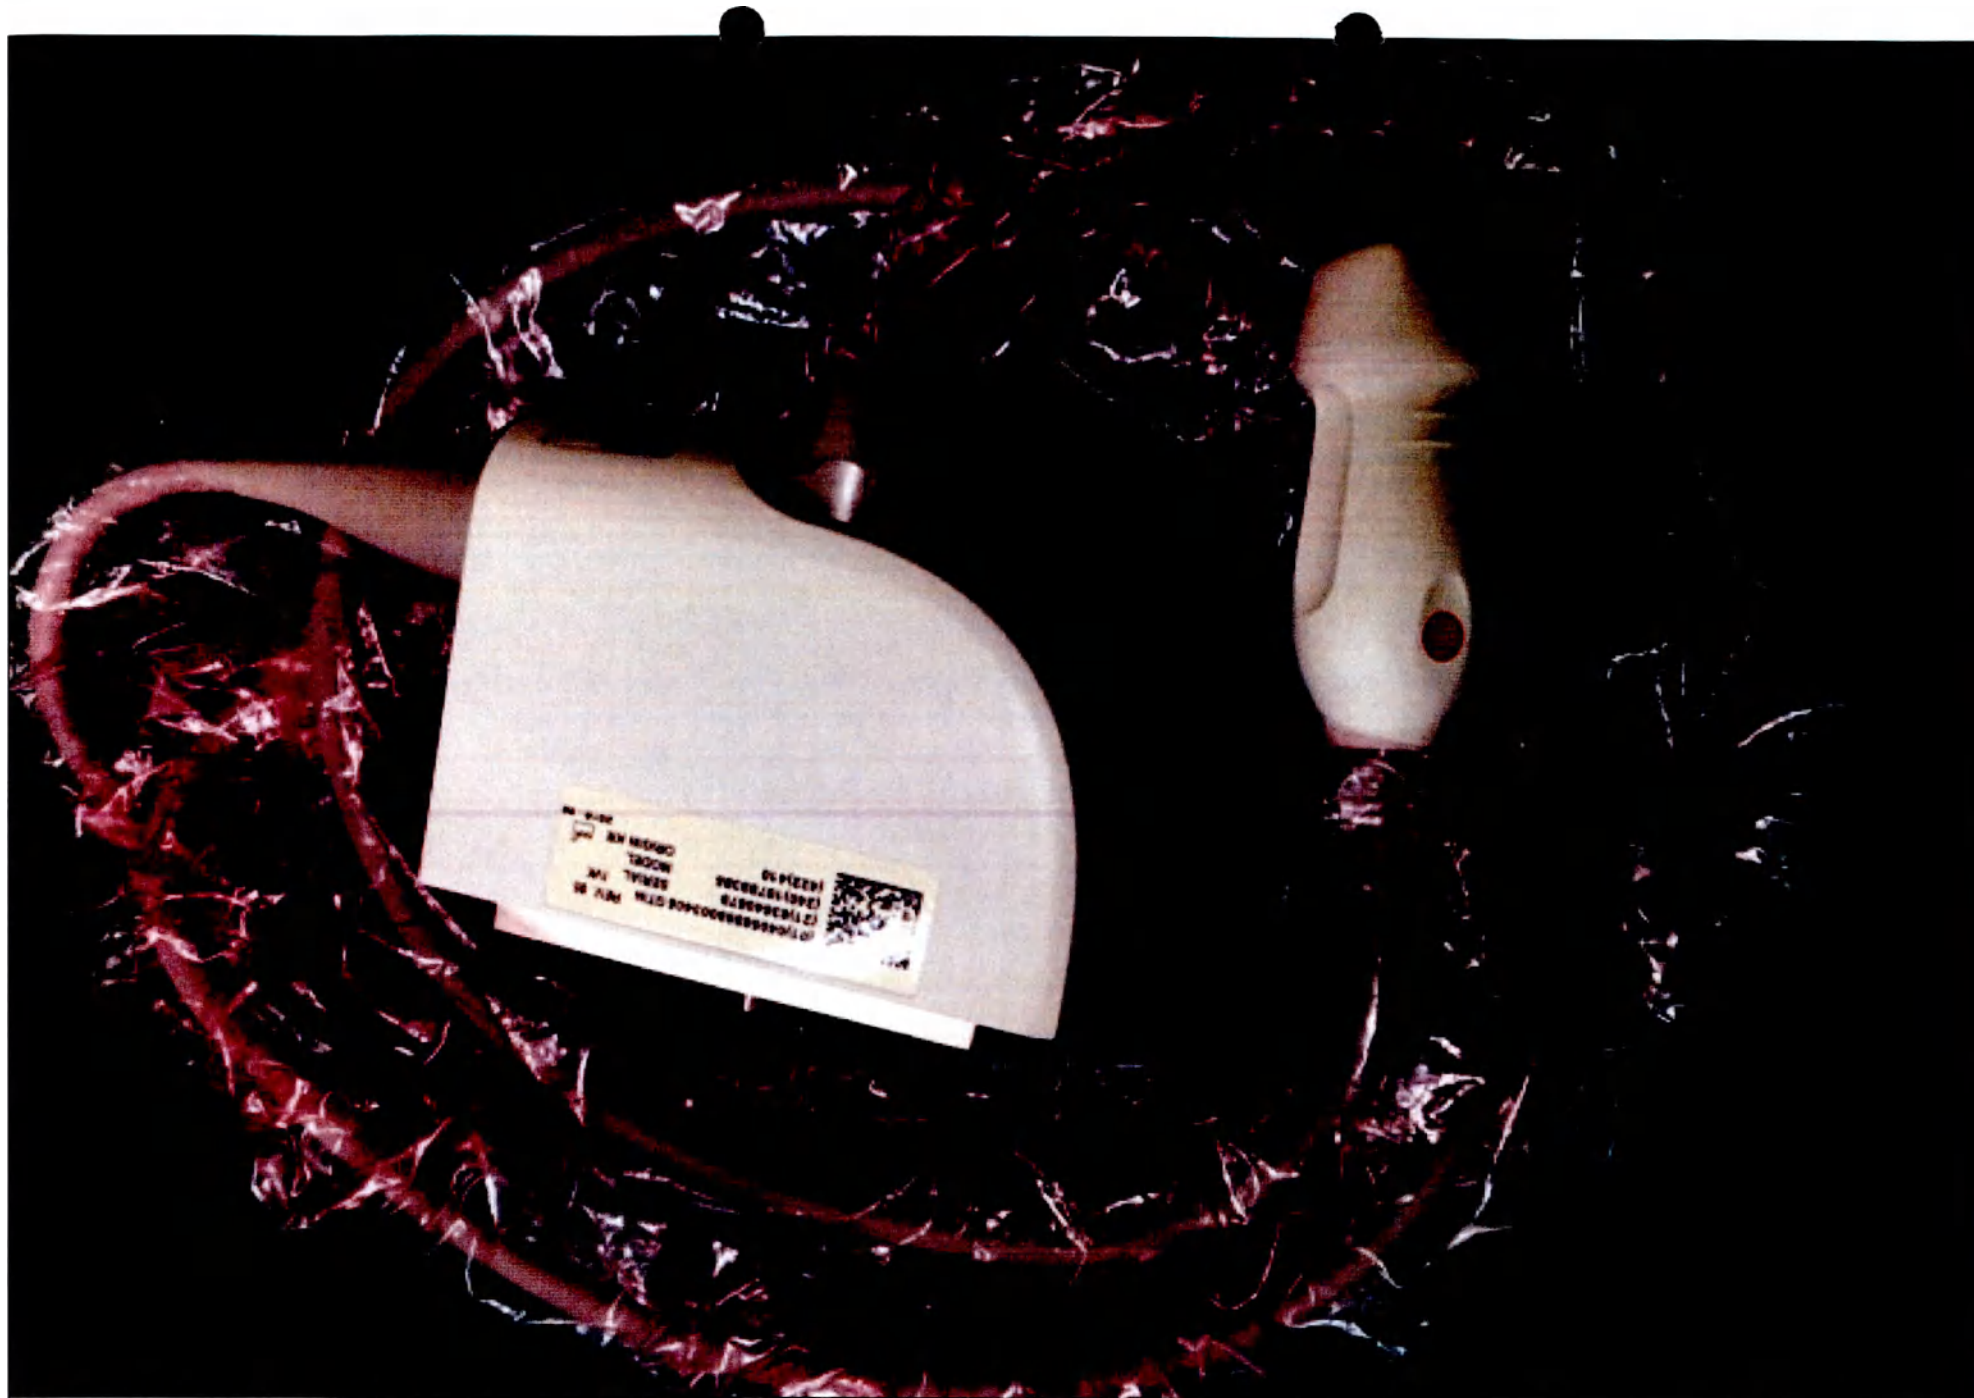


Рисунок 5. Датчик Р4-2 фазированный — 1 шт. (но не более 30 шт. при необходимости).

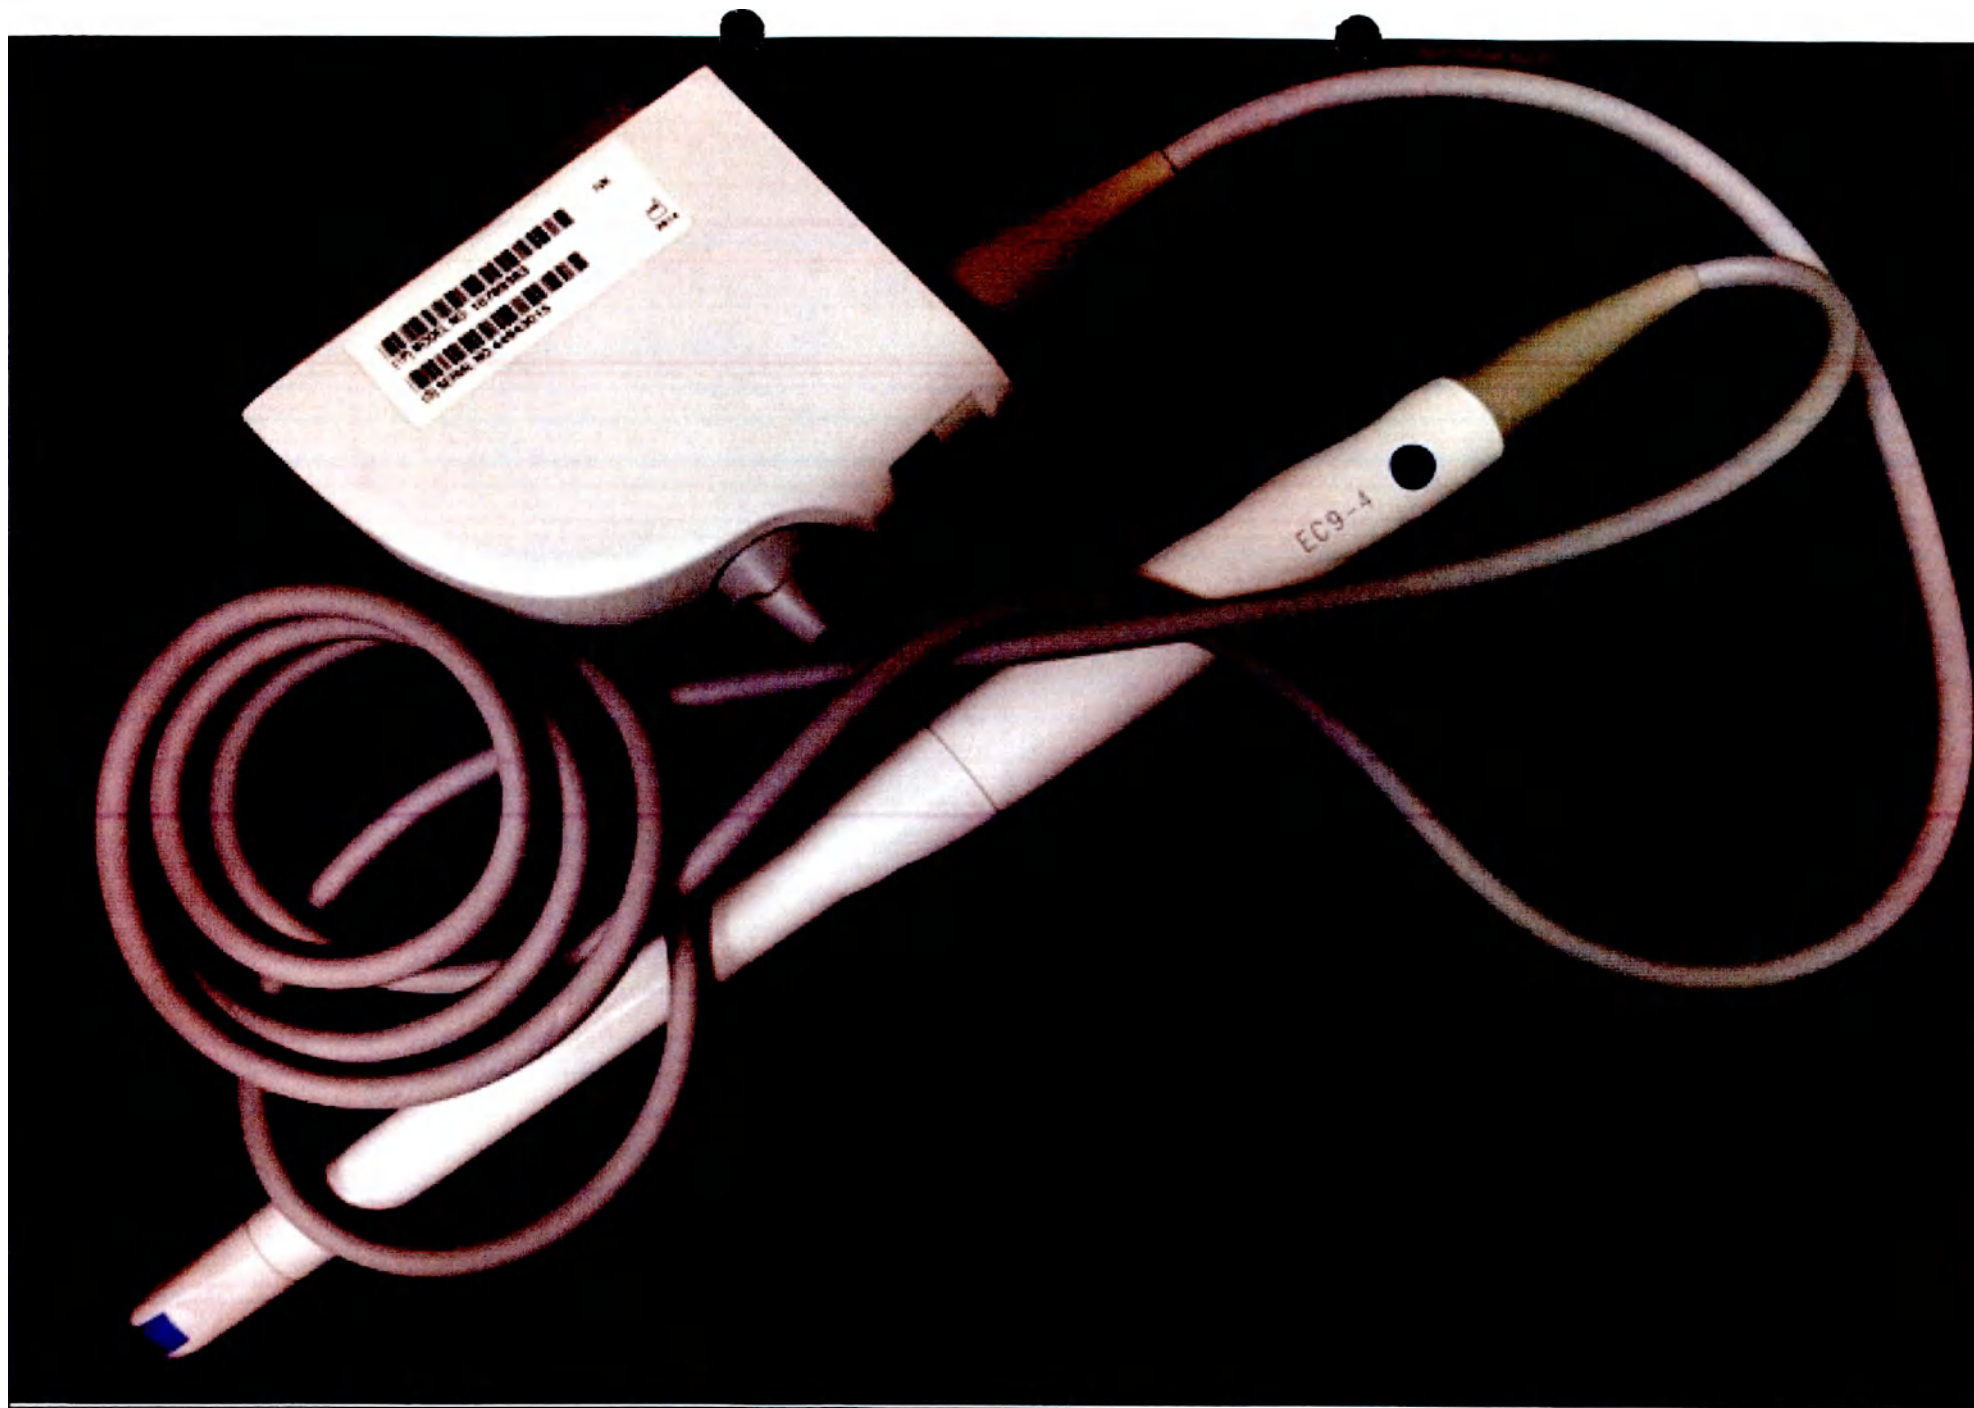


Рисунок 6. Датчик EC9-4 внутриполостной — 1 шт. (но не более 30 шт. при необходимости).

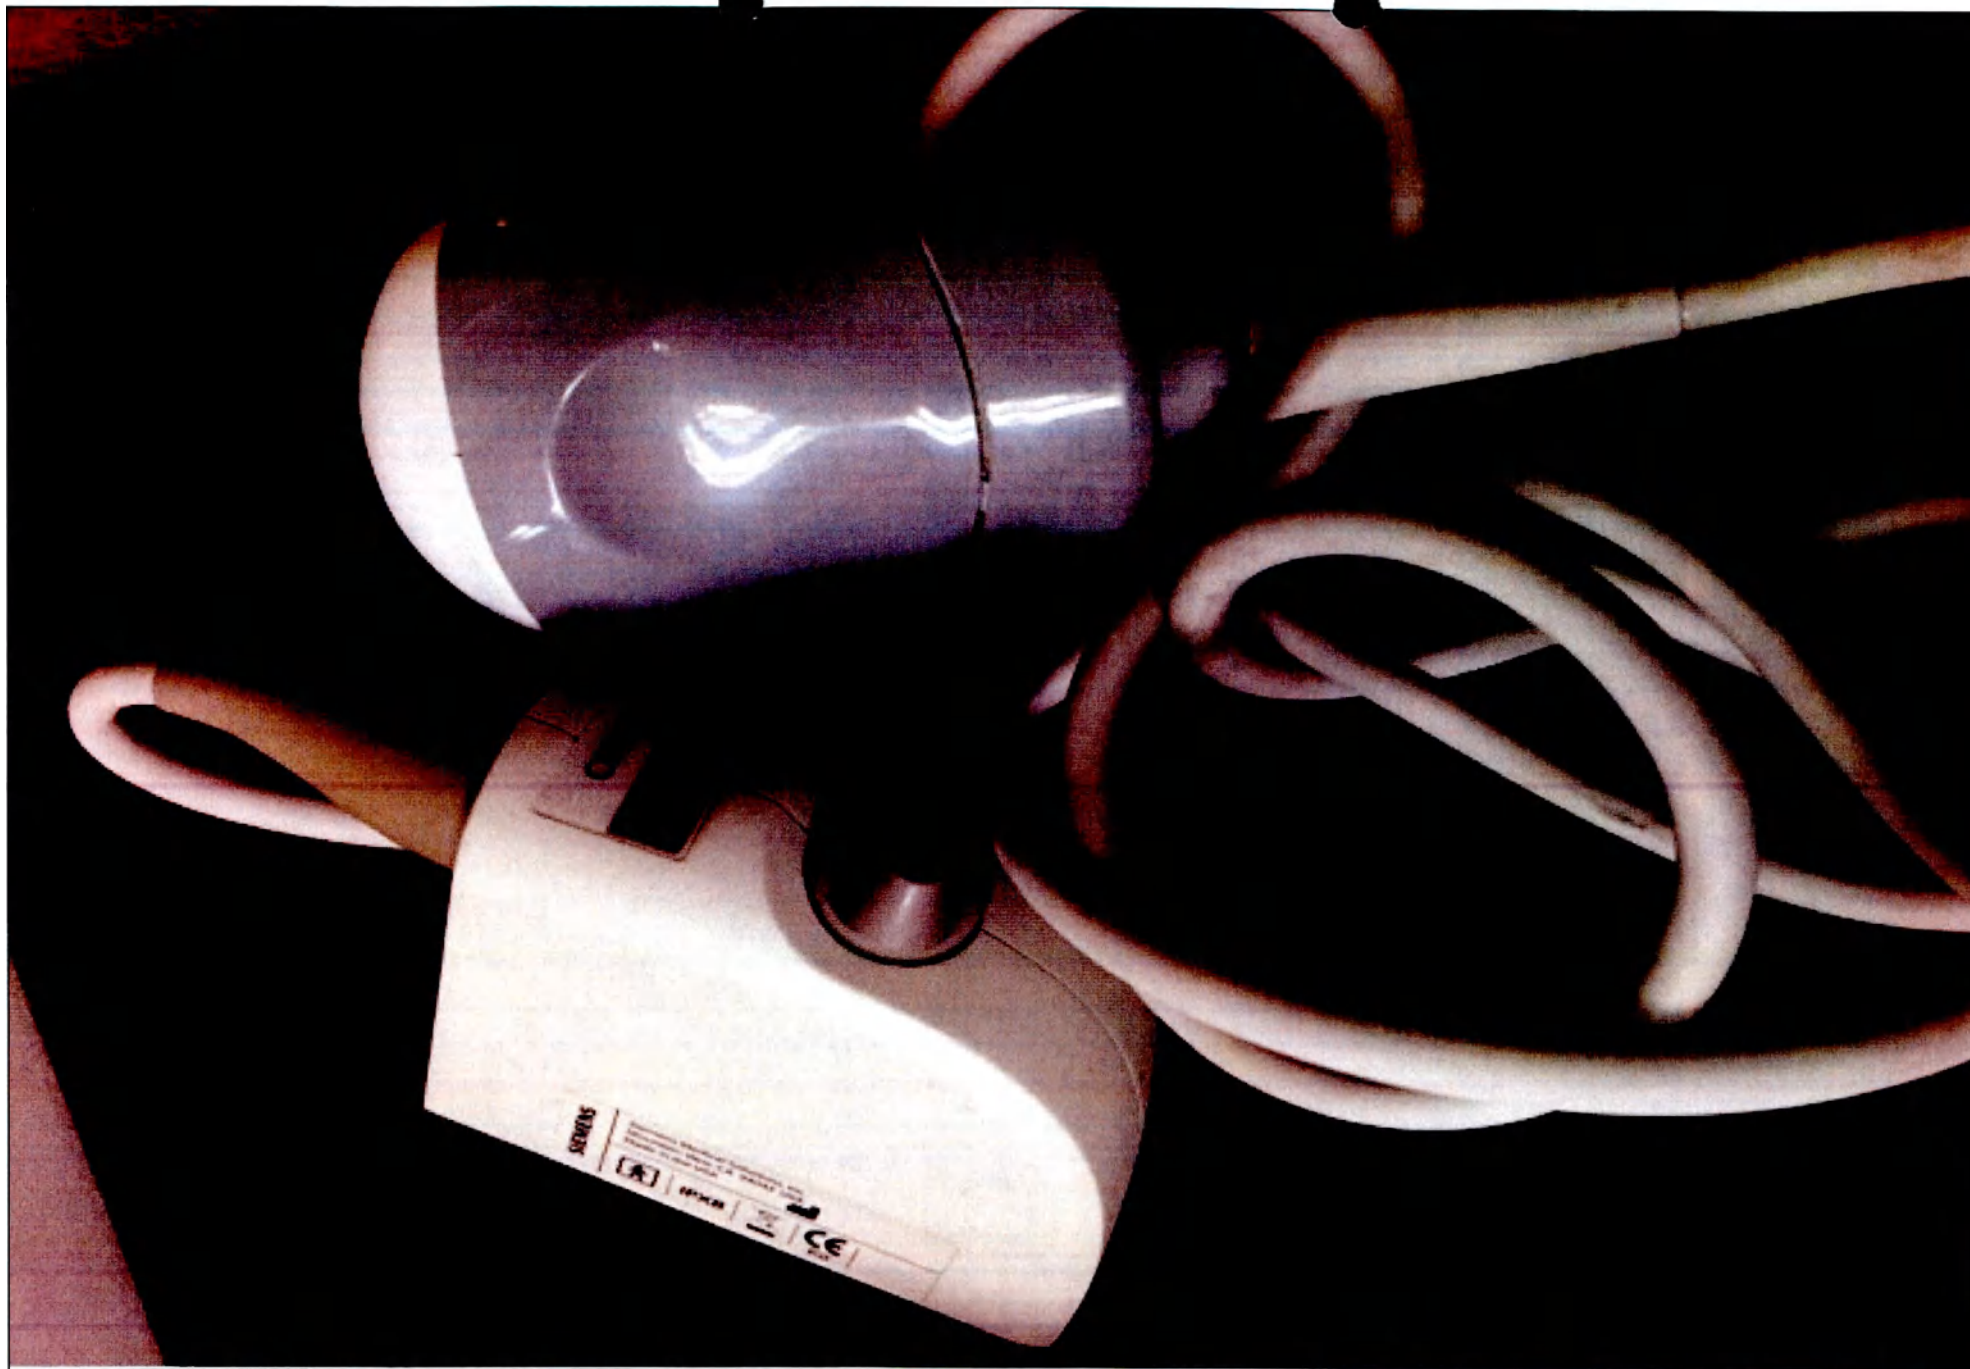


Рисунок 7. Датчик fourSight 4D конвексный C8F3 — 1 шт. (но не более 30 шт. при необходимости).

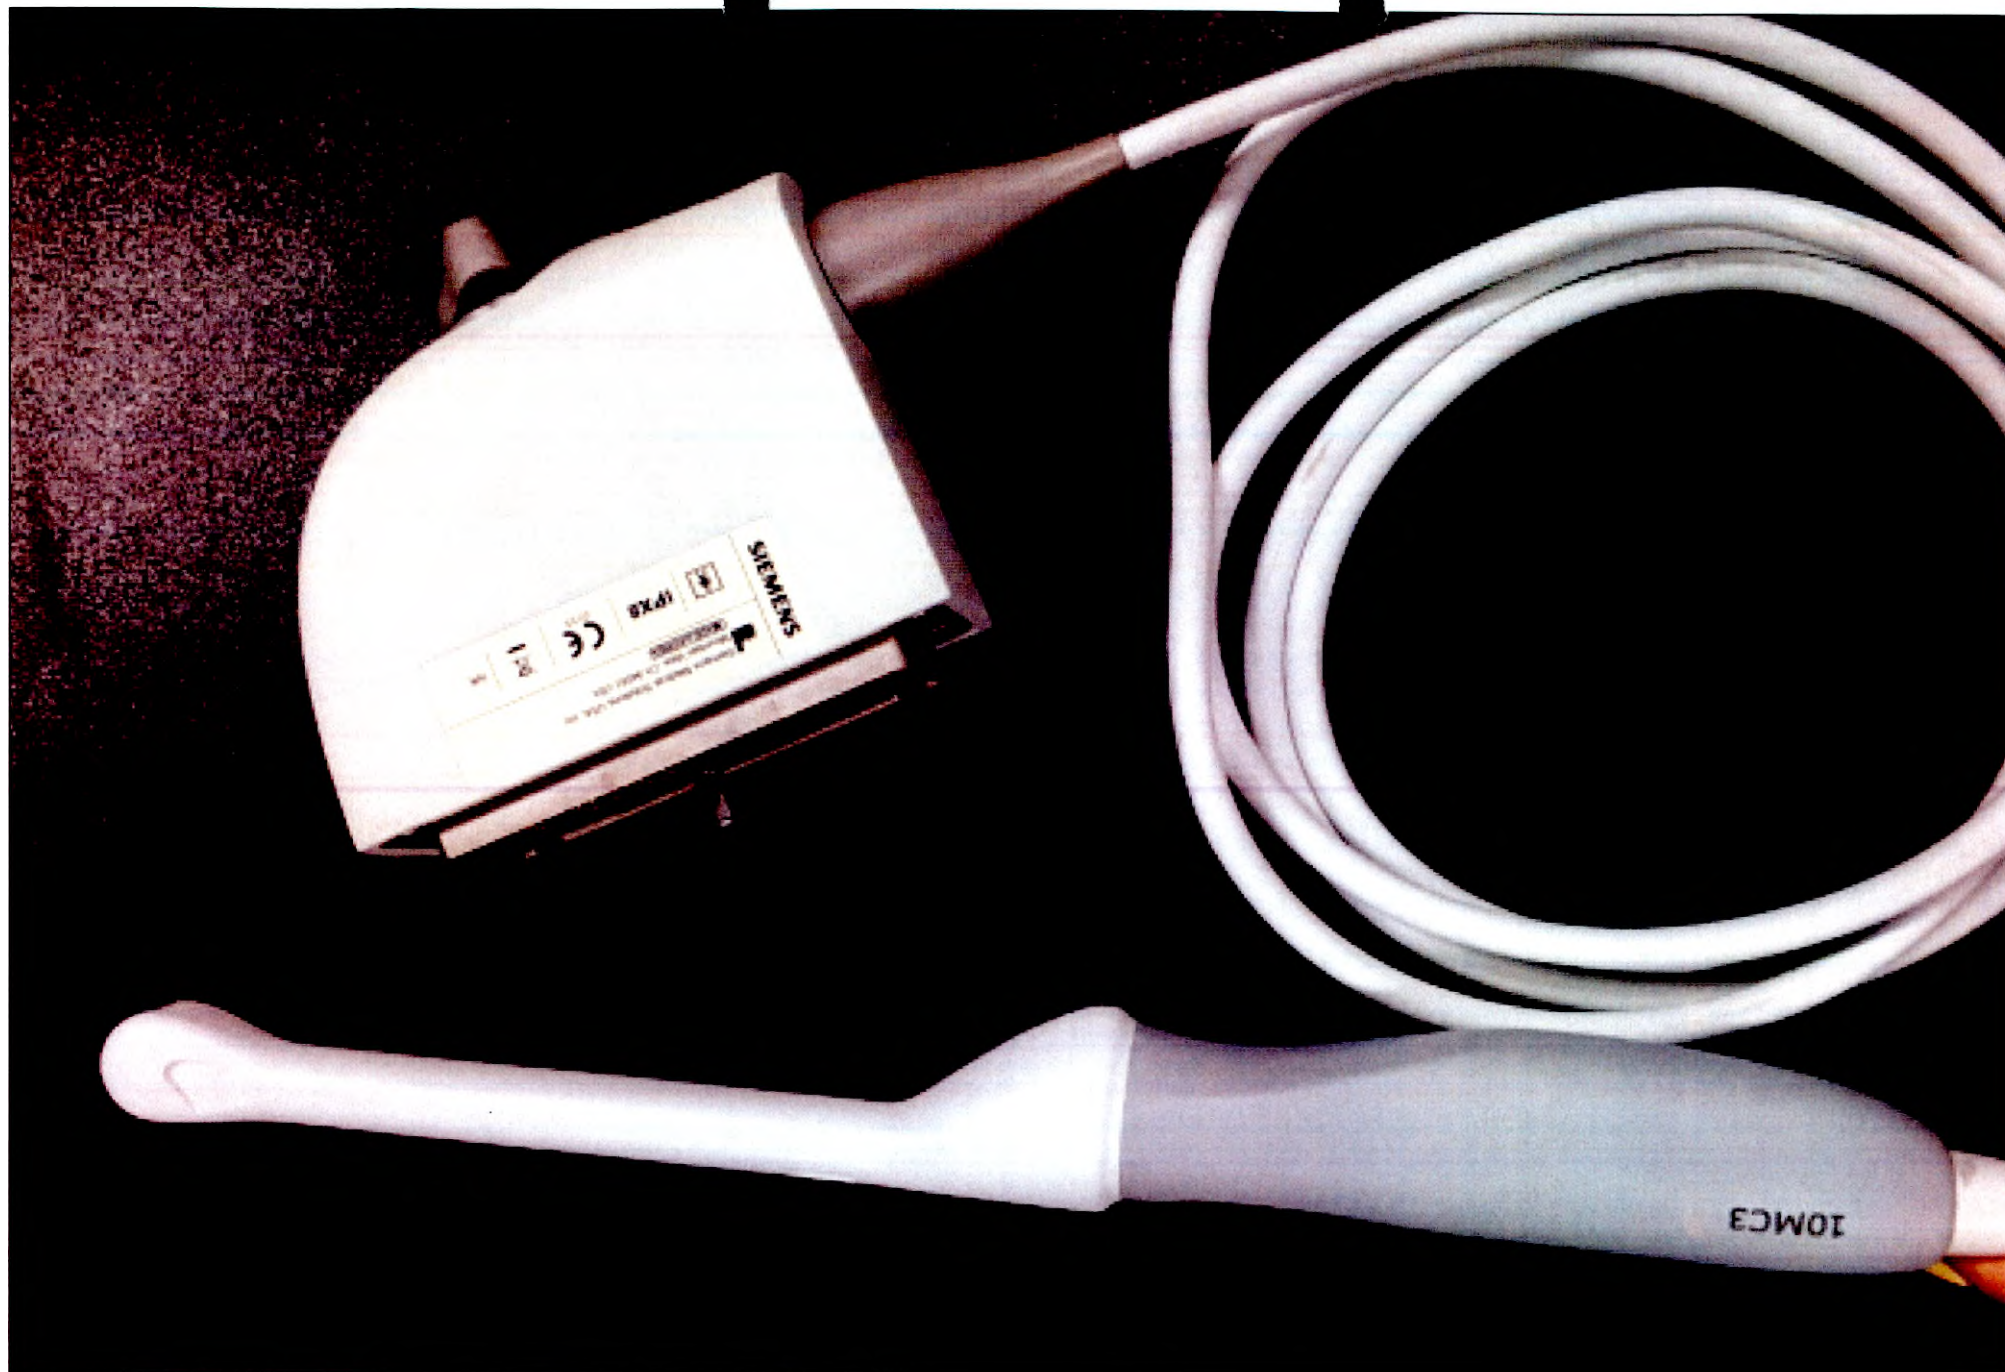


Рисунок 8. Датчик 10MC3 внутриматочный — 1 шт. (но не более 30 шт. при необходимости).

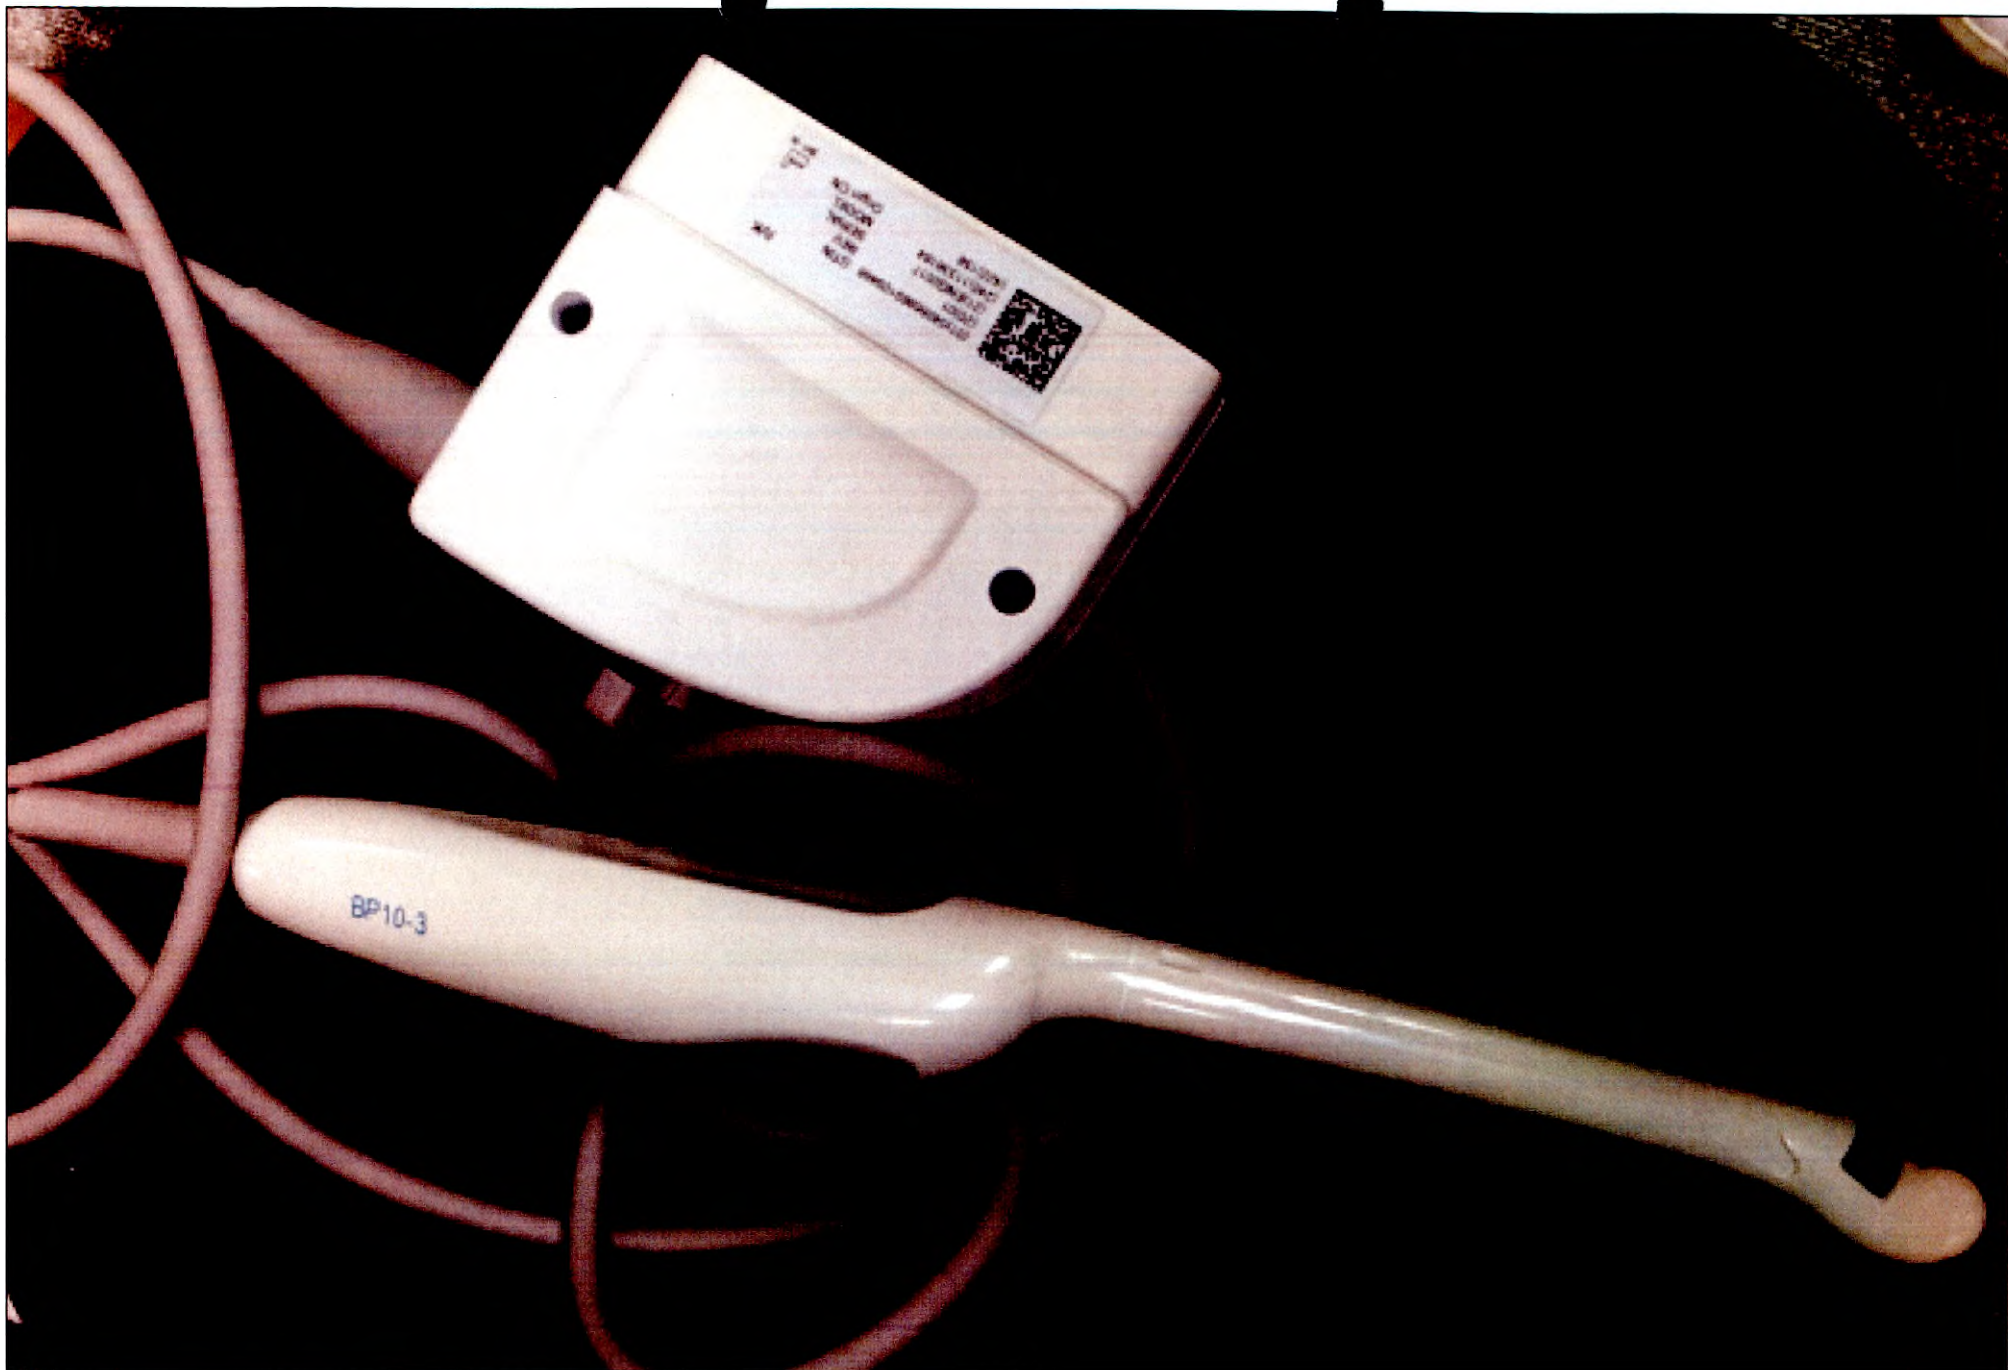


Рисунок 9. Датчик BP10-3 биплановый внутриполостной — 1 шт. (но не более 30 шт. при необходимости).

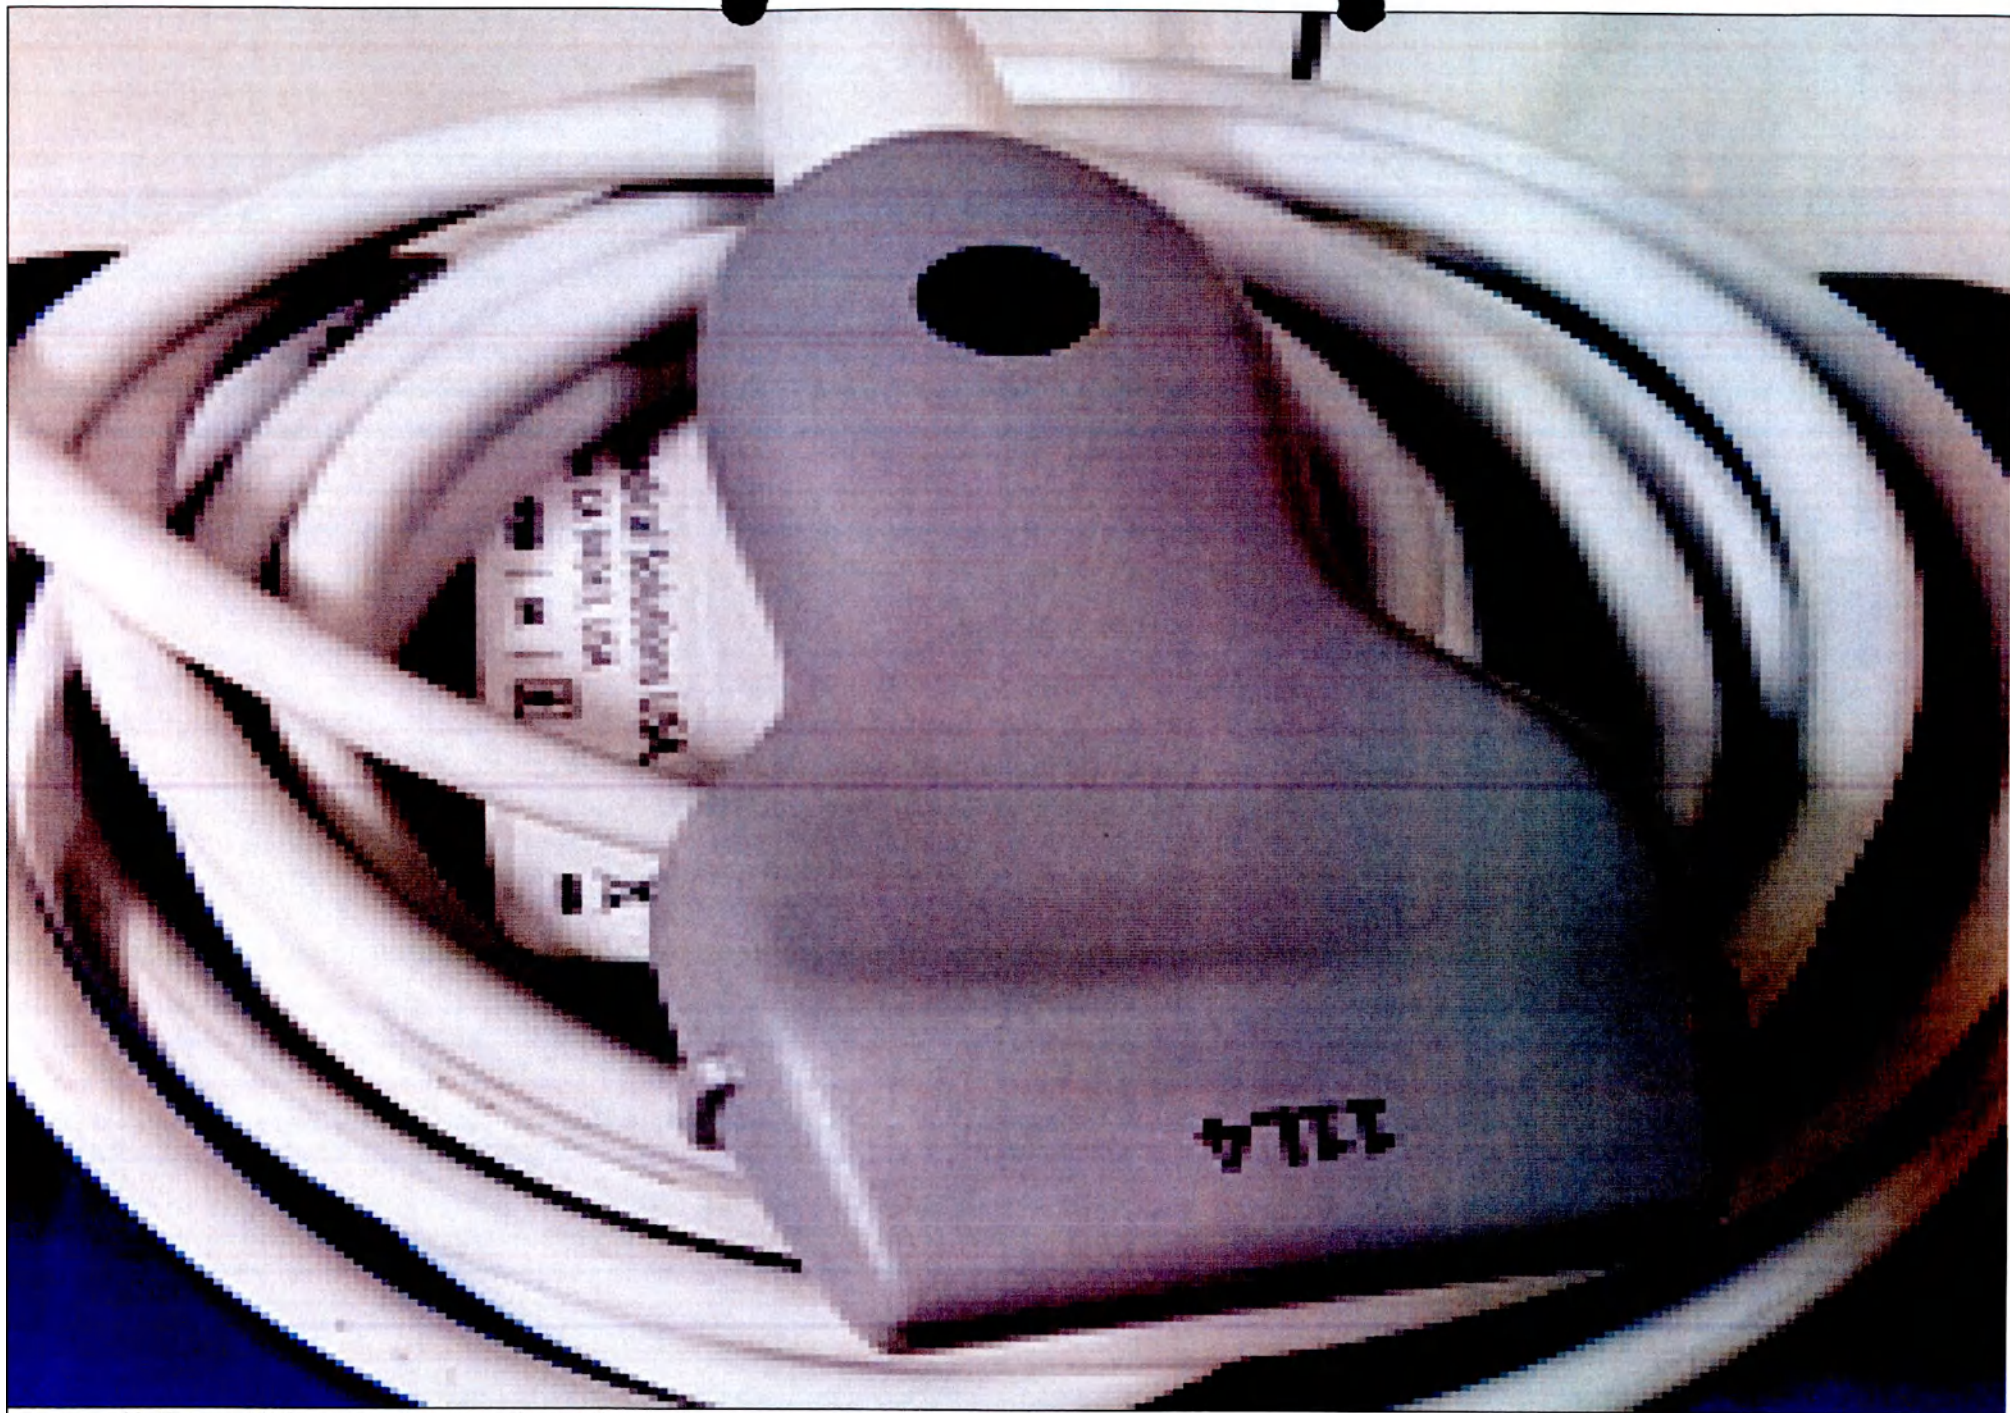


Рисунок 10. Датчик 11L4 линейный — 1 шт. (но не более 30 шт. при необходимости).

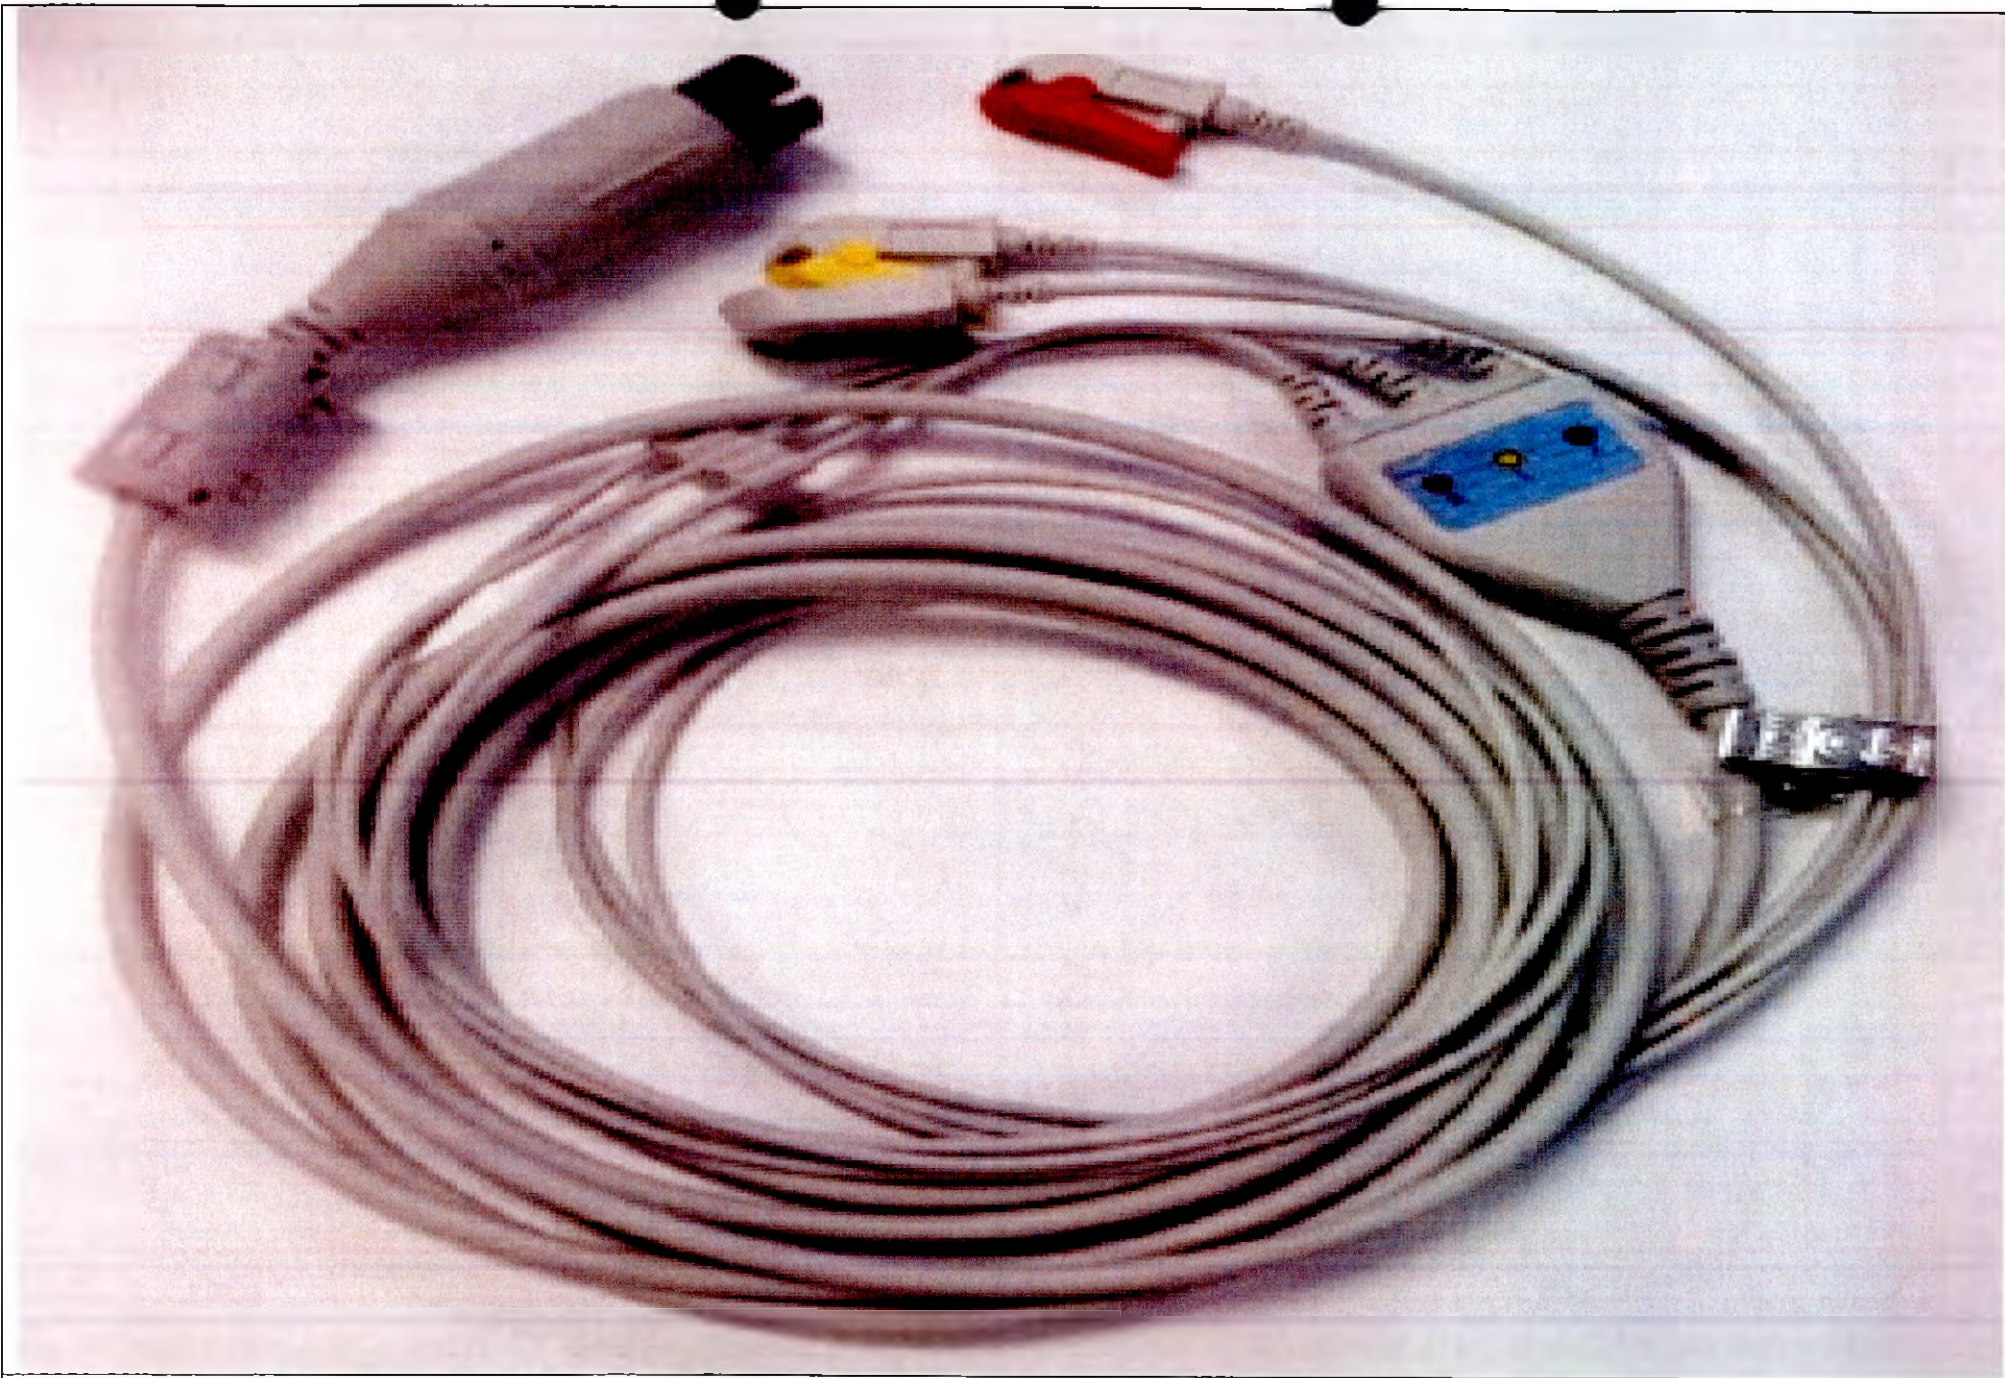


Рисунок 11. Кабель ЭКГ (европейский стандарт на три отведения) — 1 шт. (но не более 30 шт. при необходимости).



Рисунок 12. Дополнительный активный порт для подключения датчиков (при необходимости).

**ACUSON NX3**  
**ACUSON NX3 Elite**  
Диагностическая ультразвуковая система  
Инструкция по эксплуатации

**11336408-01**

11336408-01

**CE**  
**0123**

Siemens Medical Solutions USA, Inc.

11336408-01

## Приложение к инструкции по эксплуатации для России

---

Система ультразвуковая диагностическая, варианты исполнения:  
ACUSON NX3, ACUSON NX3 Elite  
с принадлежностями

*\* Значения по весу и размеру, а также по другим характеристикам медицинского изделия,  
его комплектации и элементов, поставляемых в качестве вспомогательных принадлежностей  
±10 % если не указано иное.*

Фотографические изображения базового блока медицинского изделия:  
**«Система ультразвуковая диагностическая, варианты исполнения ACUSON NX3 Elite с принадлежностями»**



Рисунок 1. Система ультразвуковая диагностическая с сенсорным экраном, вариант исполнения ACUSON NX3 Elite



Рисунок 2. Кабель электропитания — 1 шт. (но не более 10 шт. при необходимости).



Рисунок 3. Датчик CH5-2 конвексный — 1 шт. (но не более 30 шт. при необходимости).

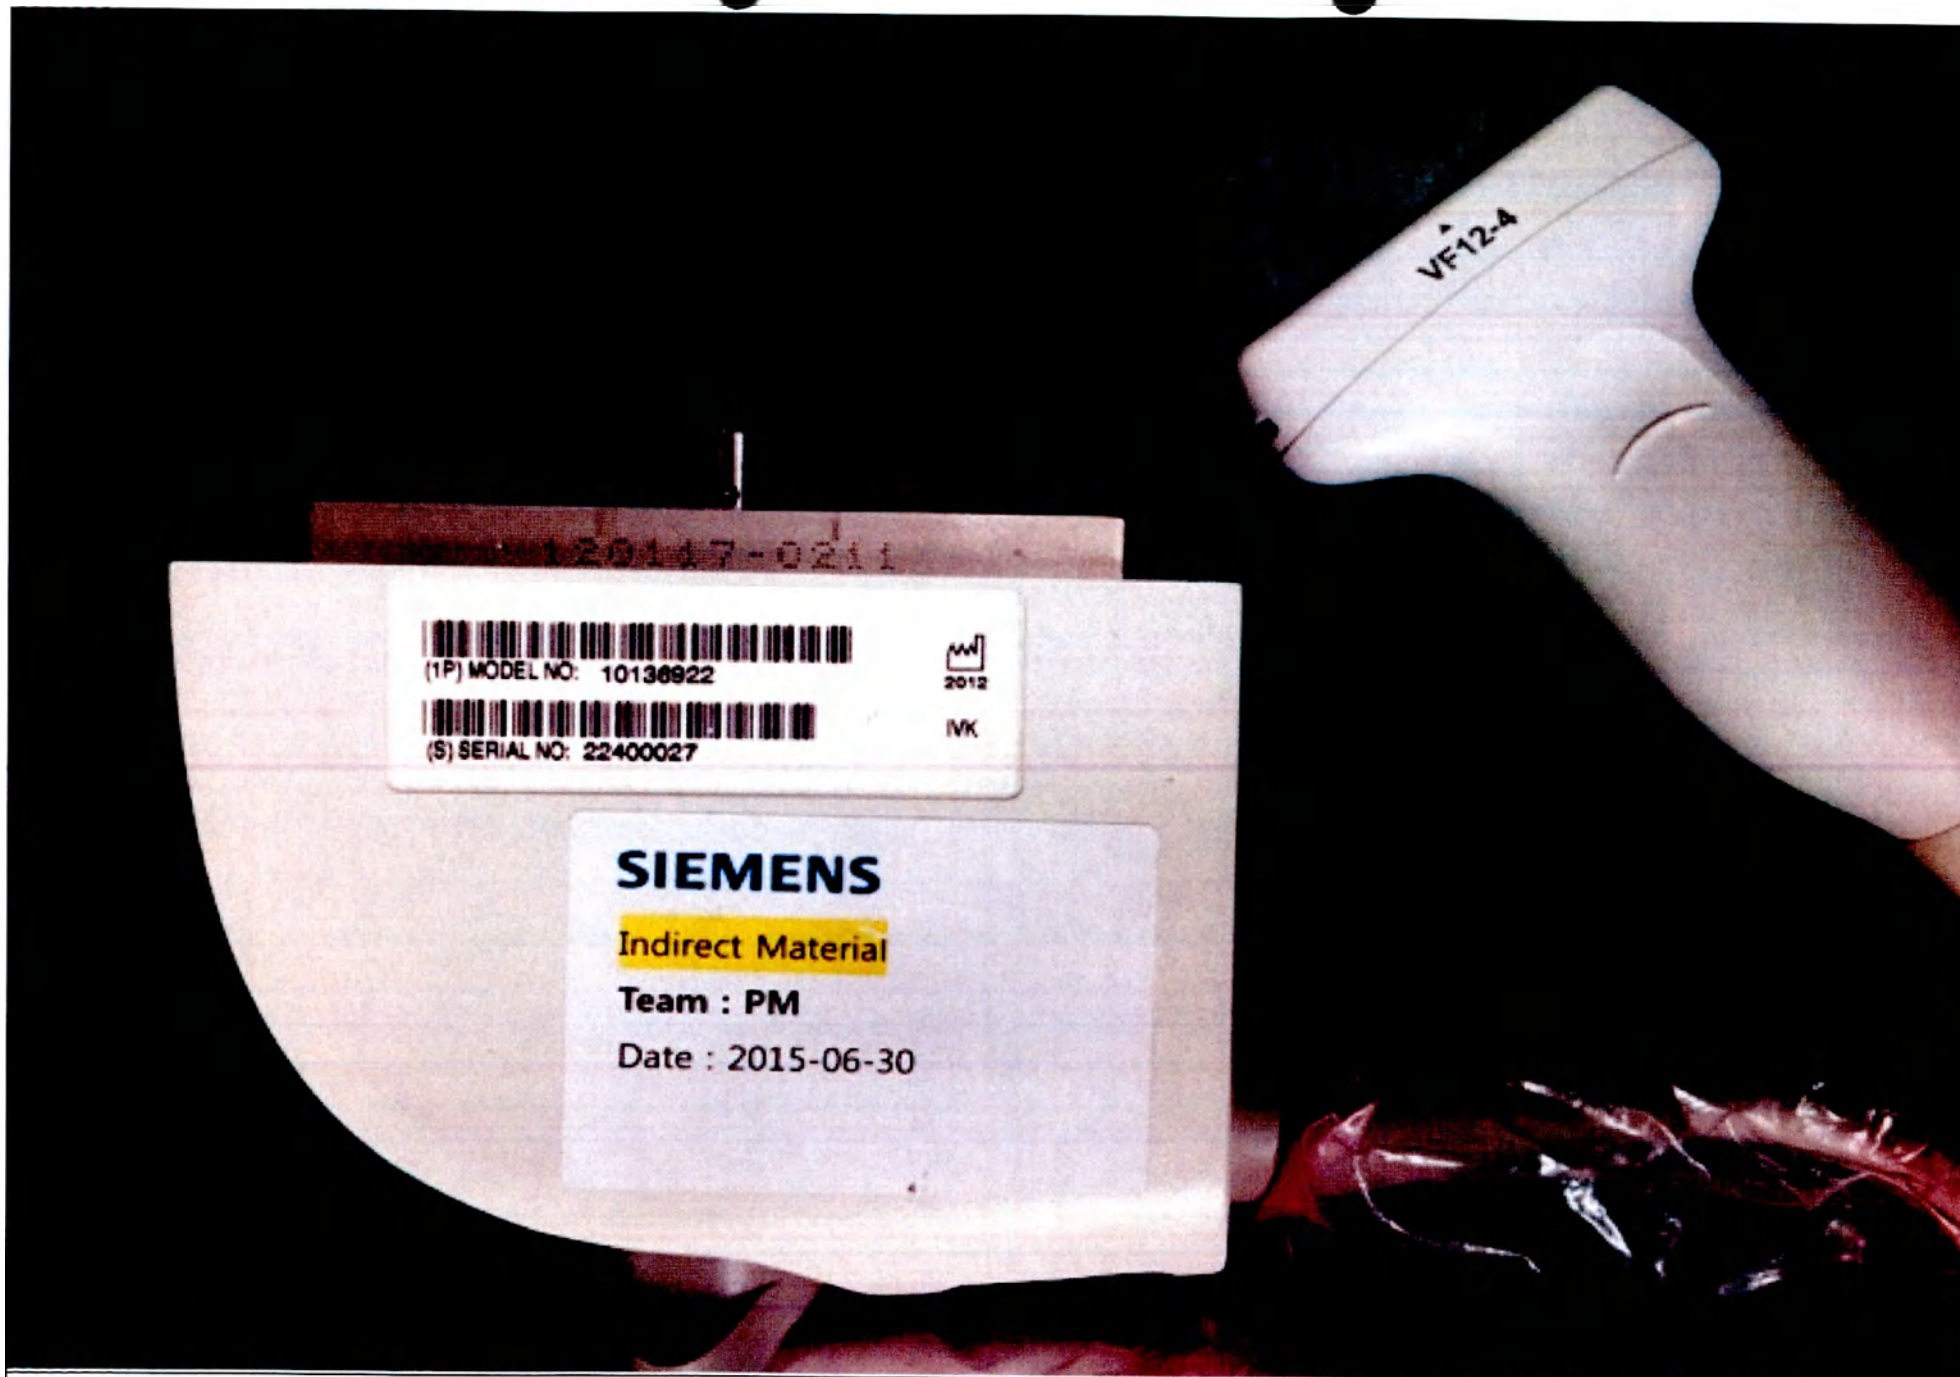


Рисунок 4. Датчик VF12-4 линейный — 1 шт. (но не более 30 шт. при необходимости).

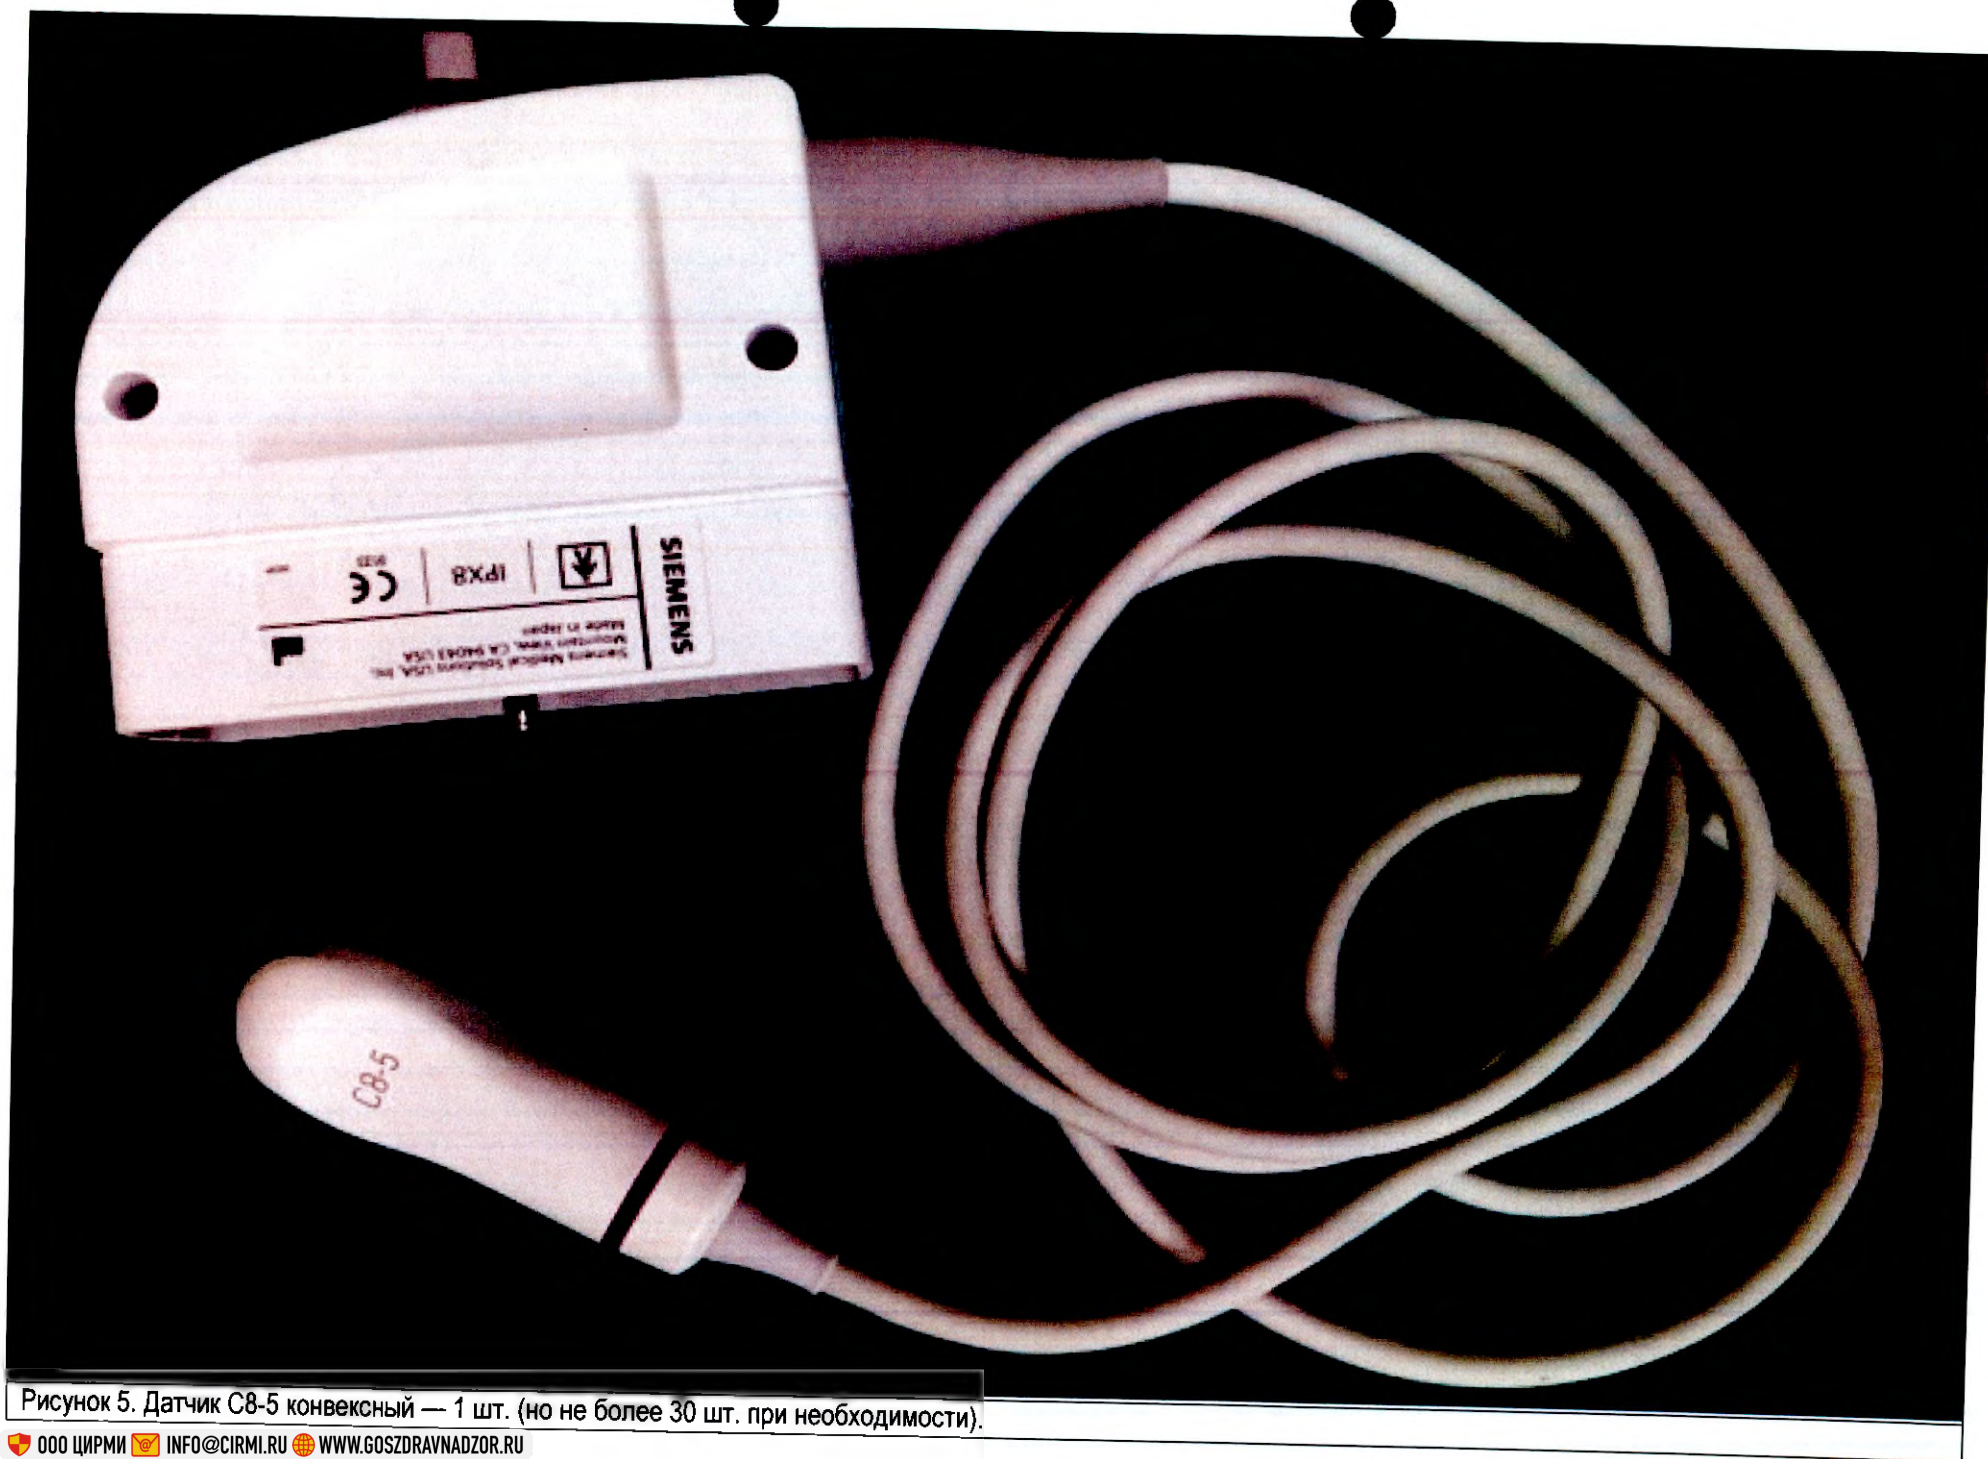


Рисунок 5. Датчик C8-5 конвексный — 1 шт. (но не более 30 шт. при необходимости).



Рисунок 6. Датчик VF13-5SP линейный — 1 шт. (но не более 30 шт. при необходимости)



Рисунок 7. Датчик VF16-5 линейный — 1 шт. (но не более 30 шт. при необходимости).

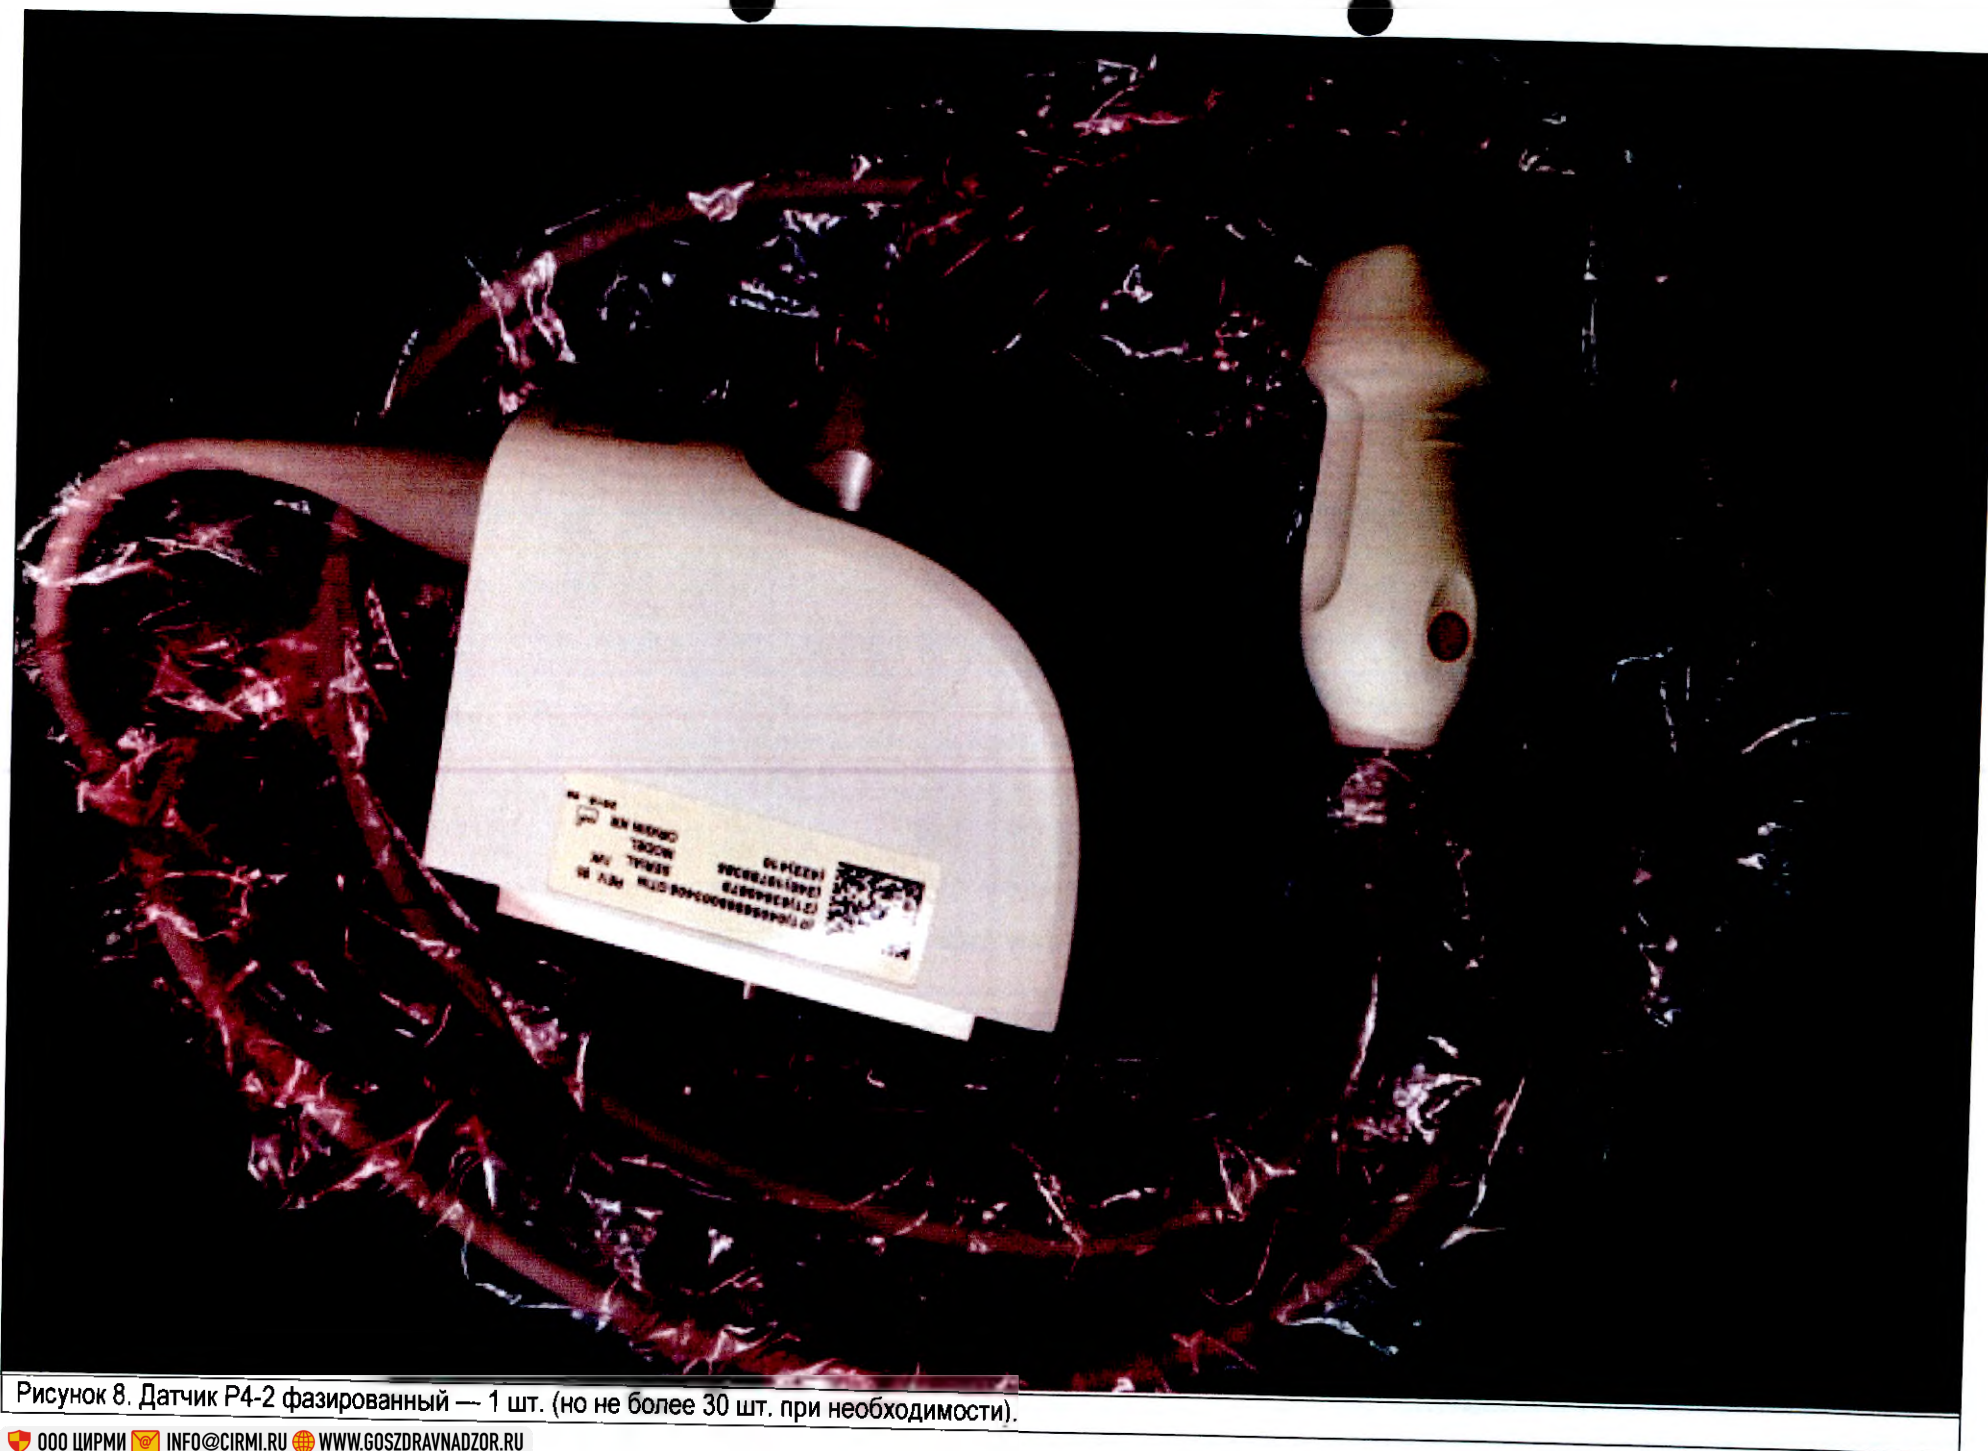


Рисунок 8. Датчик Р4-2 фазированный — 1 шт. (но не более 30 шт. при необходимости).

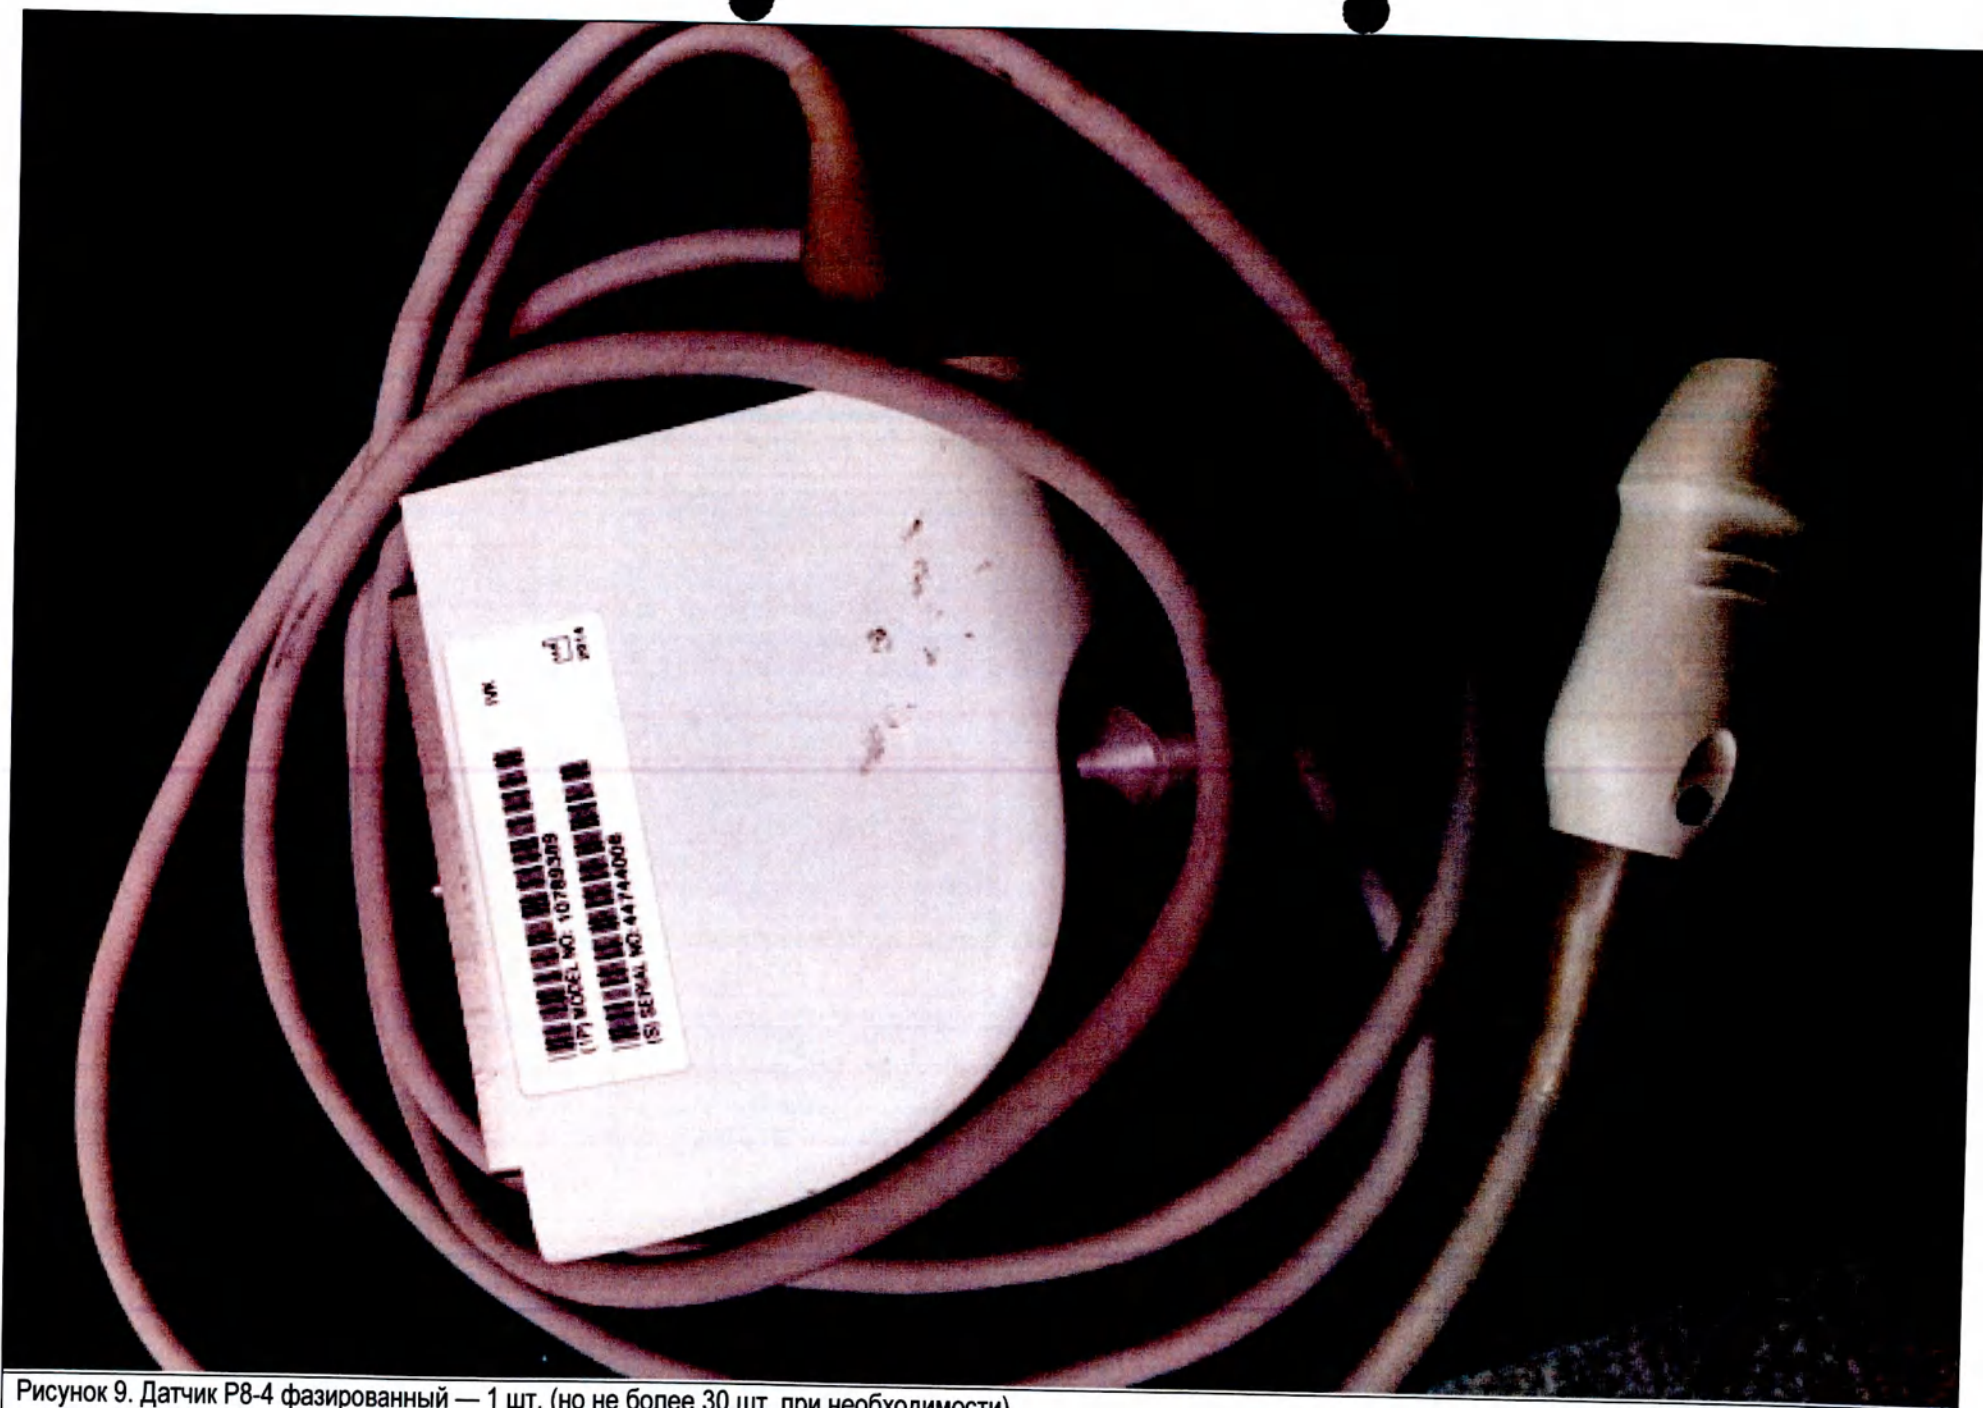


Рисунок 9. Датчик Р8-4 фазированный — 1 шт. (но не более 30 шт. при необходимости).

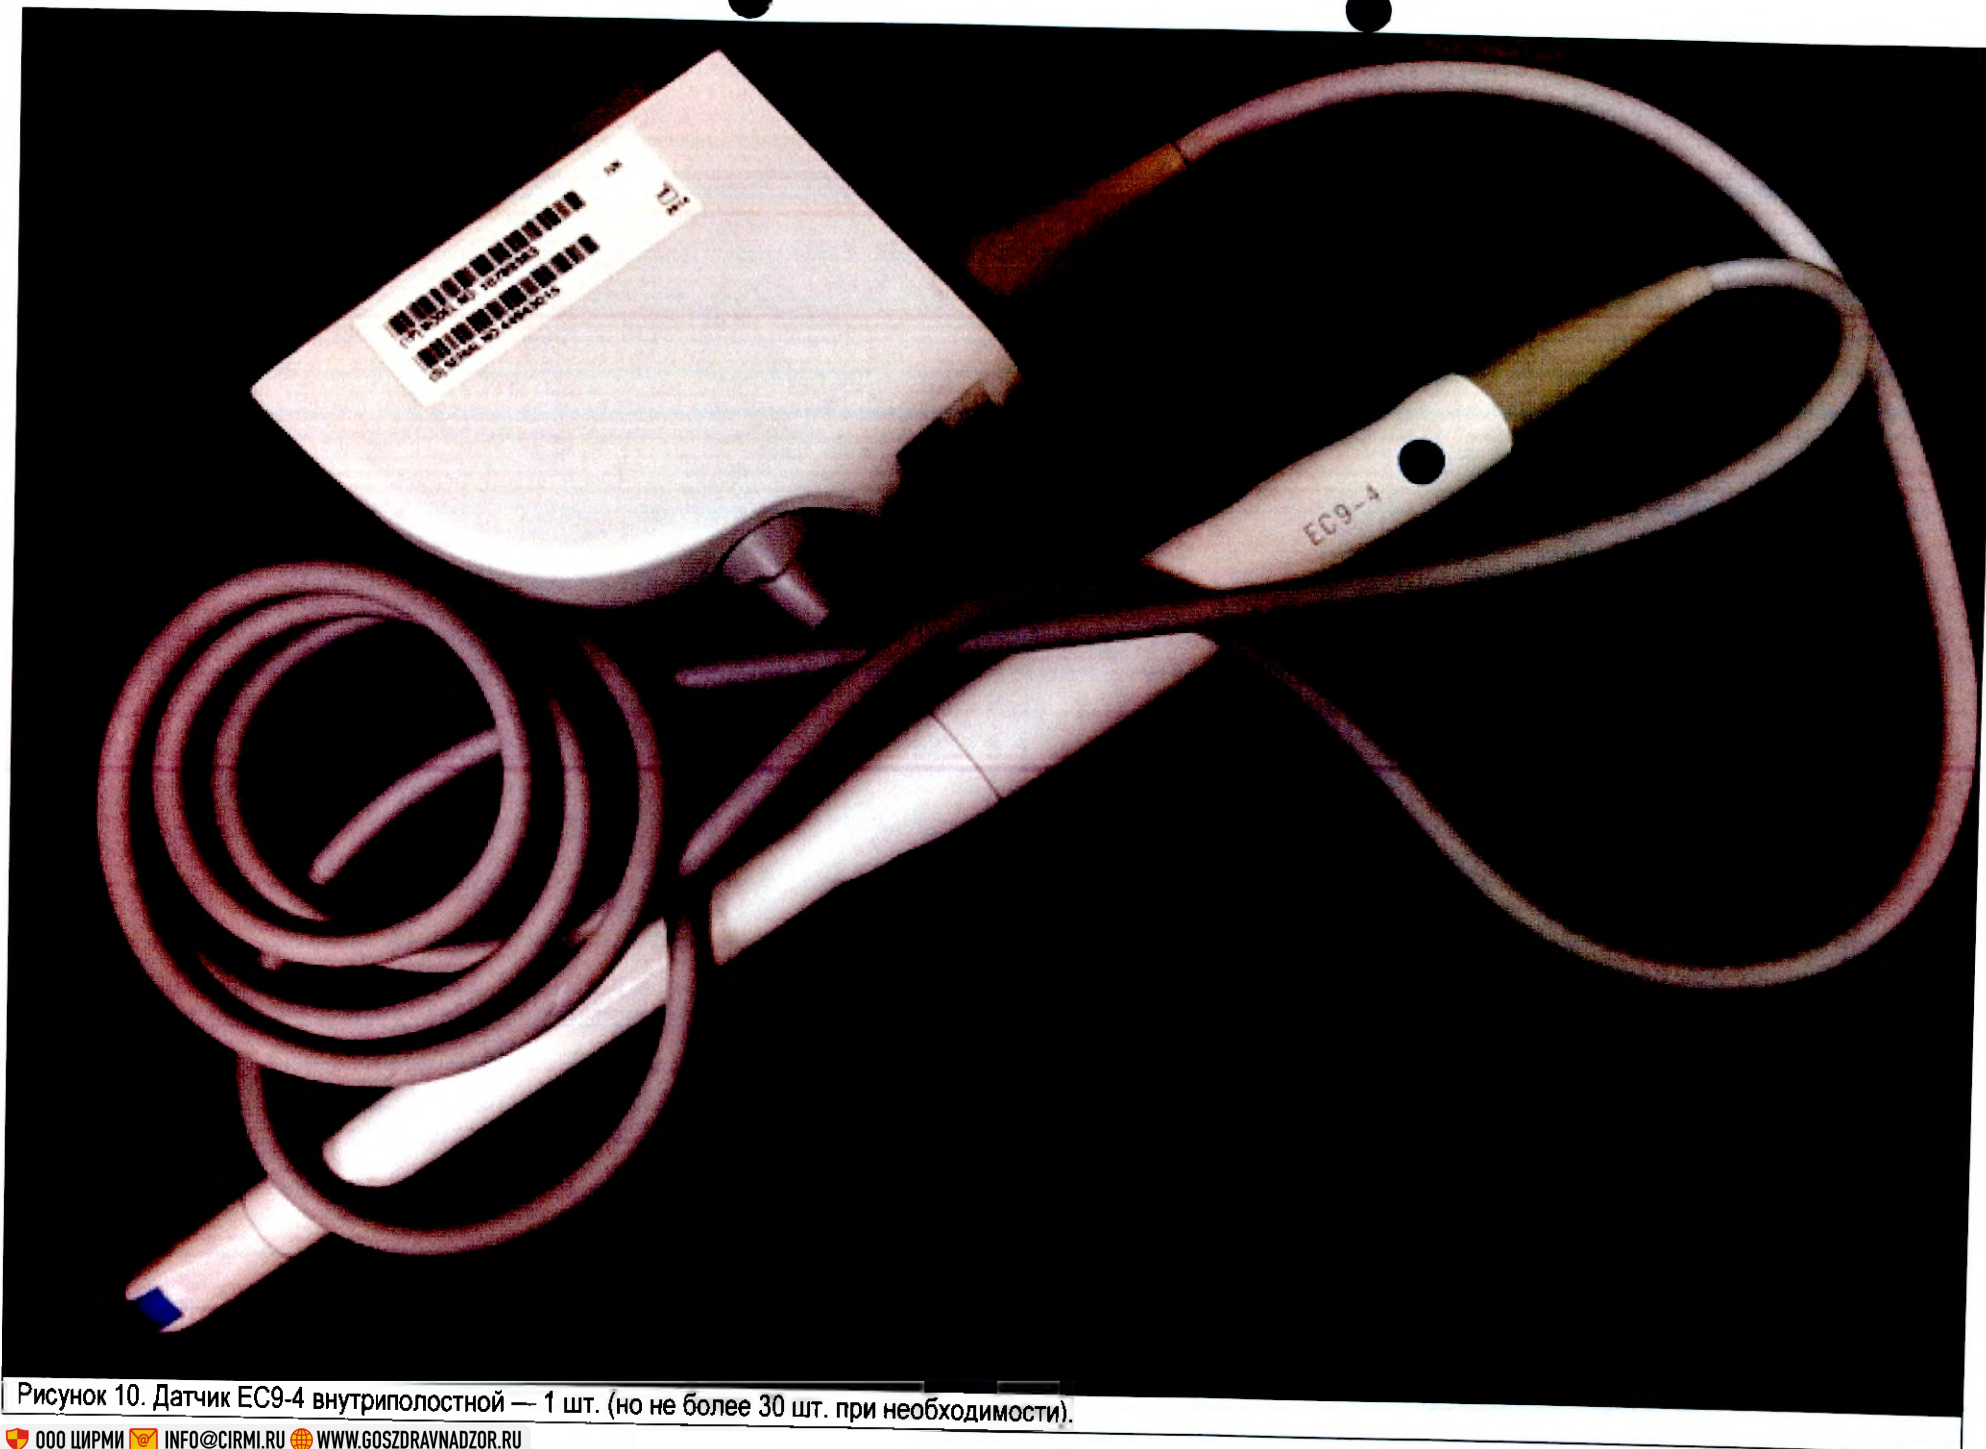


Рисунок 10. Датчик ЕС9-4 внутриматочный — 1 шт. (но не более 30 шт. при необходимости).



Рисунок 11. Датчик ЕС10-5w внутриполостной — 1 шт. (но не более 30 шт. при необходимости).

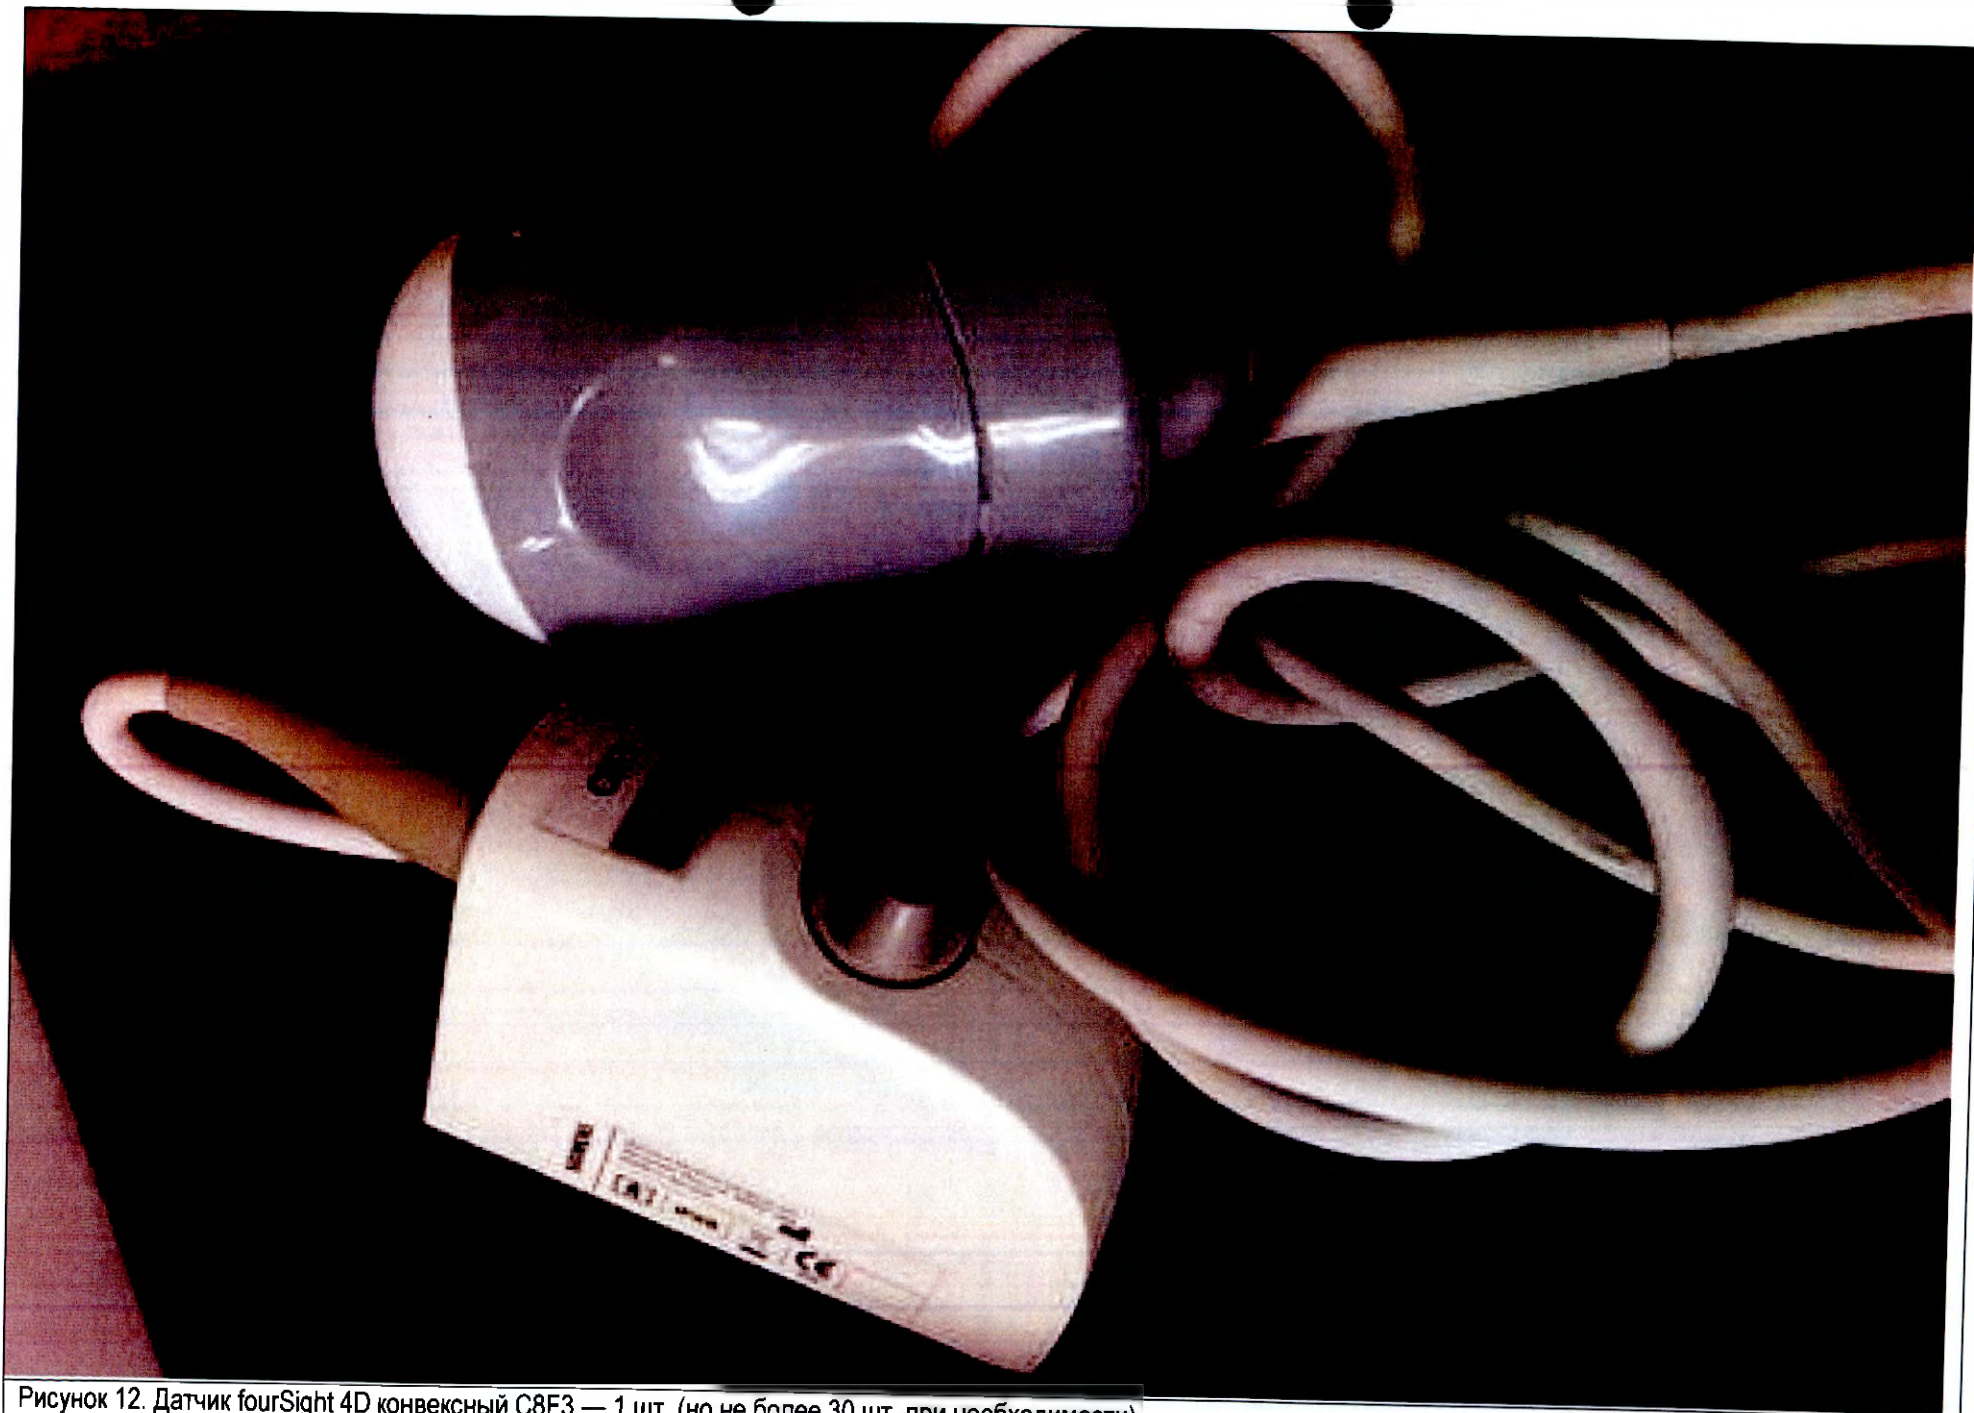


Рисунок 12. Датчик fourSight 4D конвексный C8F3 — 1 шт. (но не более 30 шт. при необходимости).

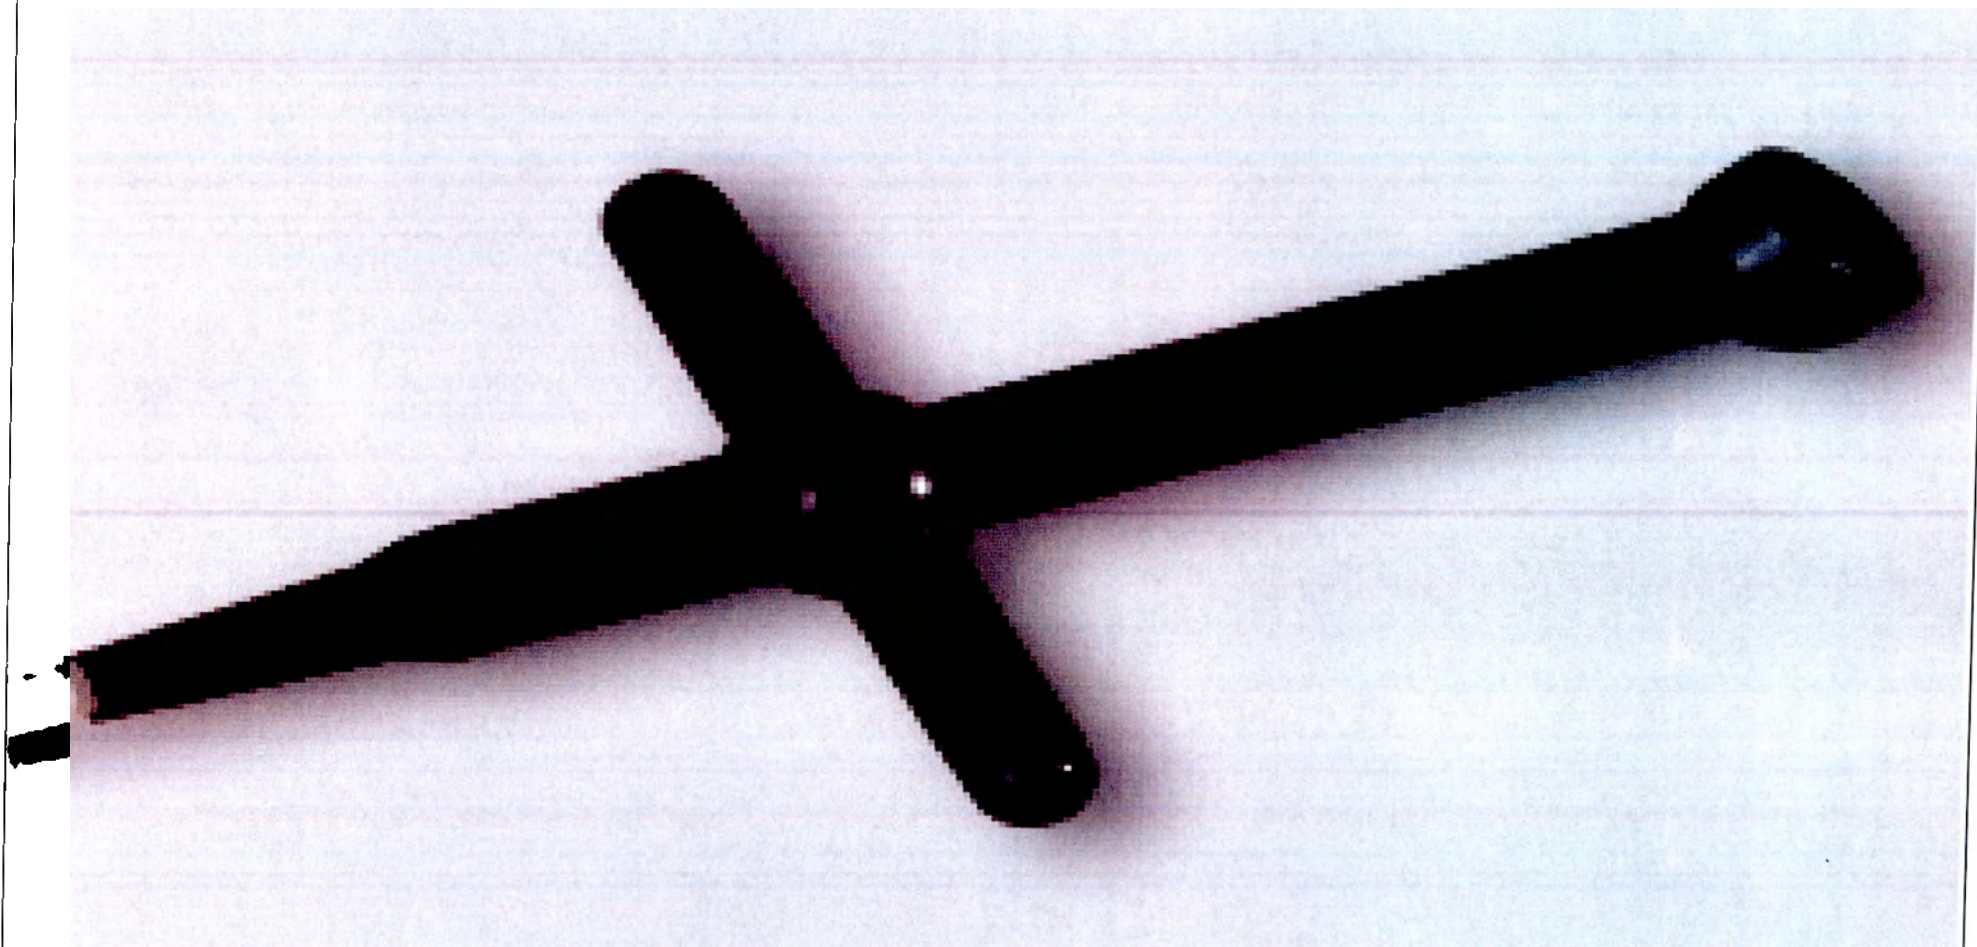


Рисунок 13. Датчик непрерывно-волновой CW2 — 1 шт. (но не более 30 шт. при необходимости).



Рисунок 14. Датчик непрерывно-волновой CW5 — 1 шт. (но не более 30 шт. при необходимости).

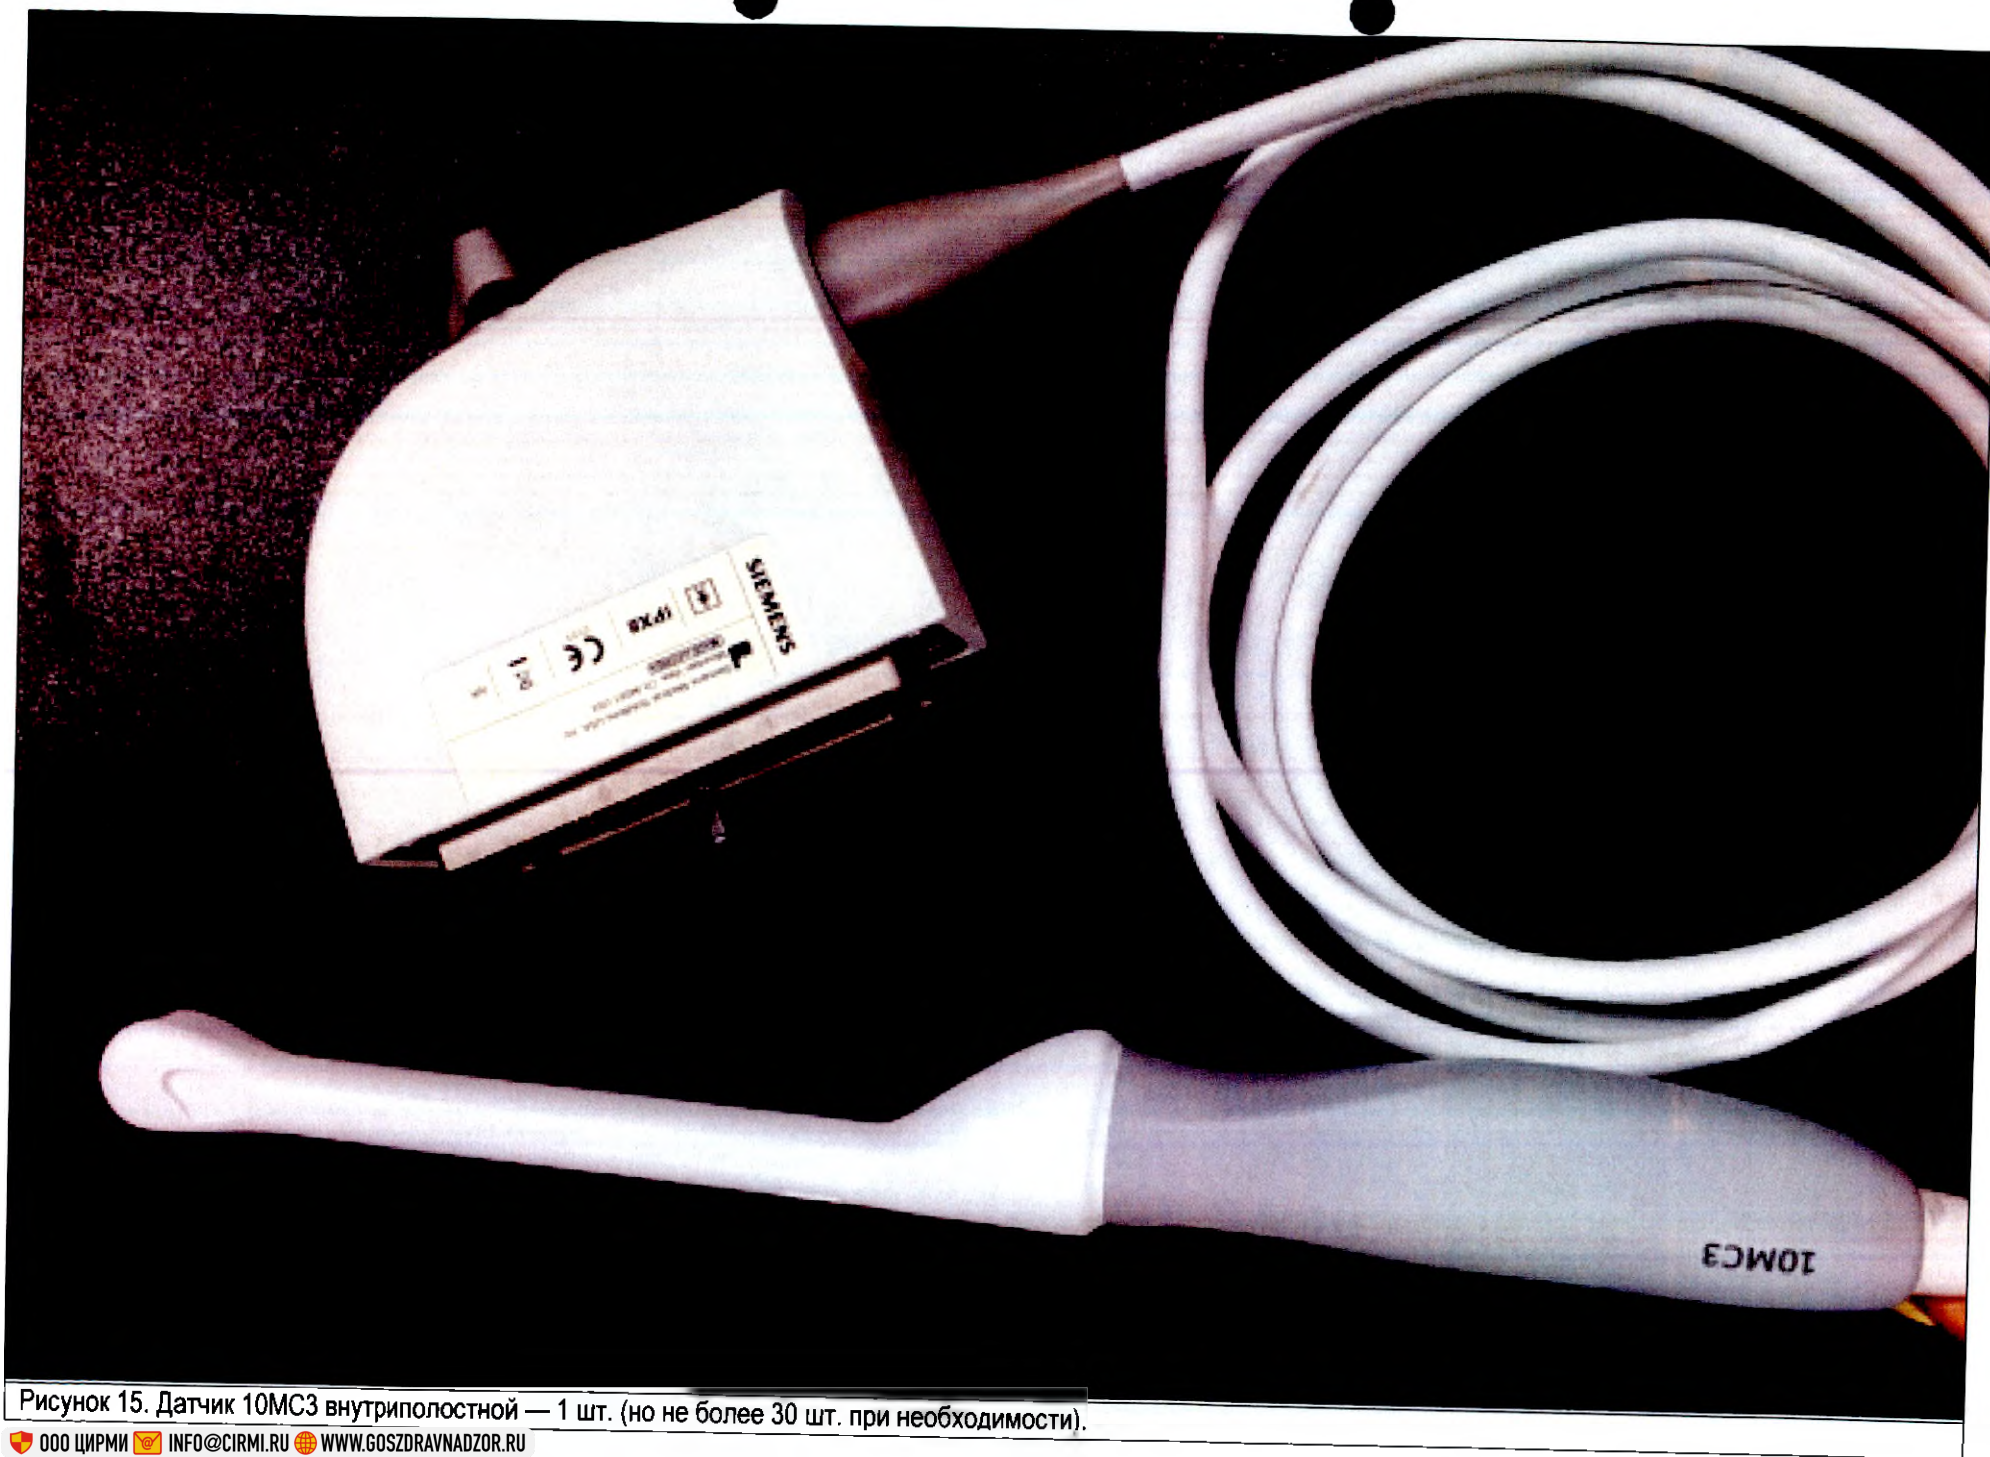


Рисунок 15. Датчик 10MC3 внутриматочный — 1 шт. (но не более 30 шт. при необходимости).

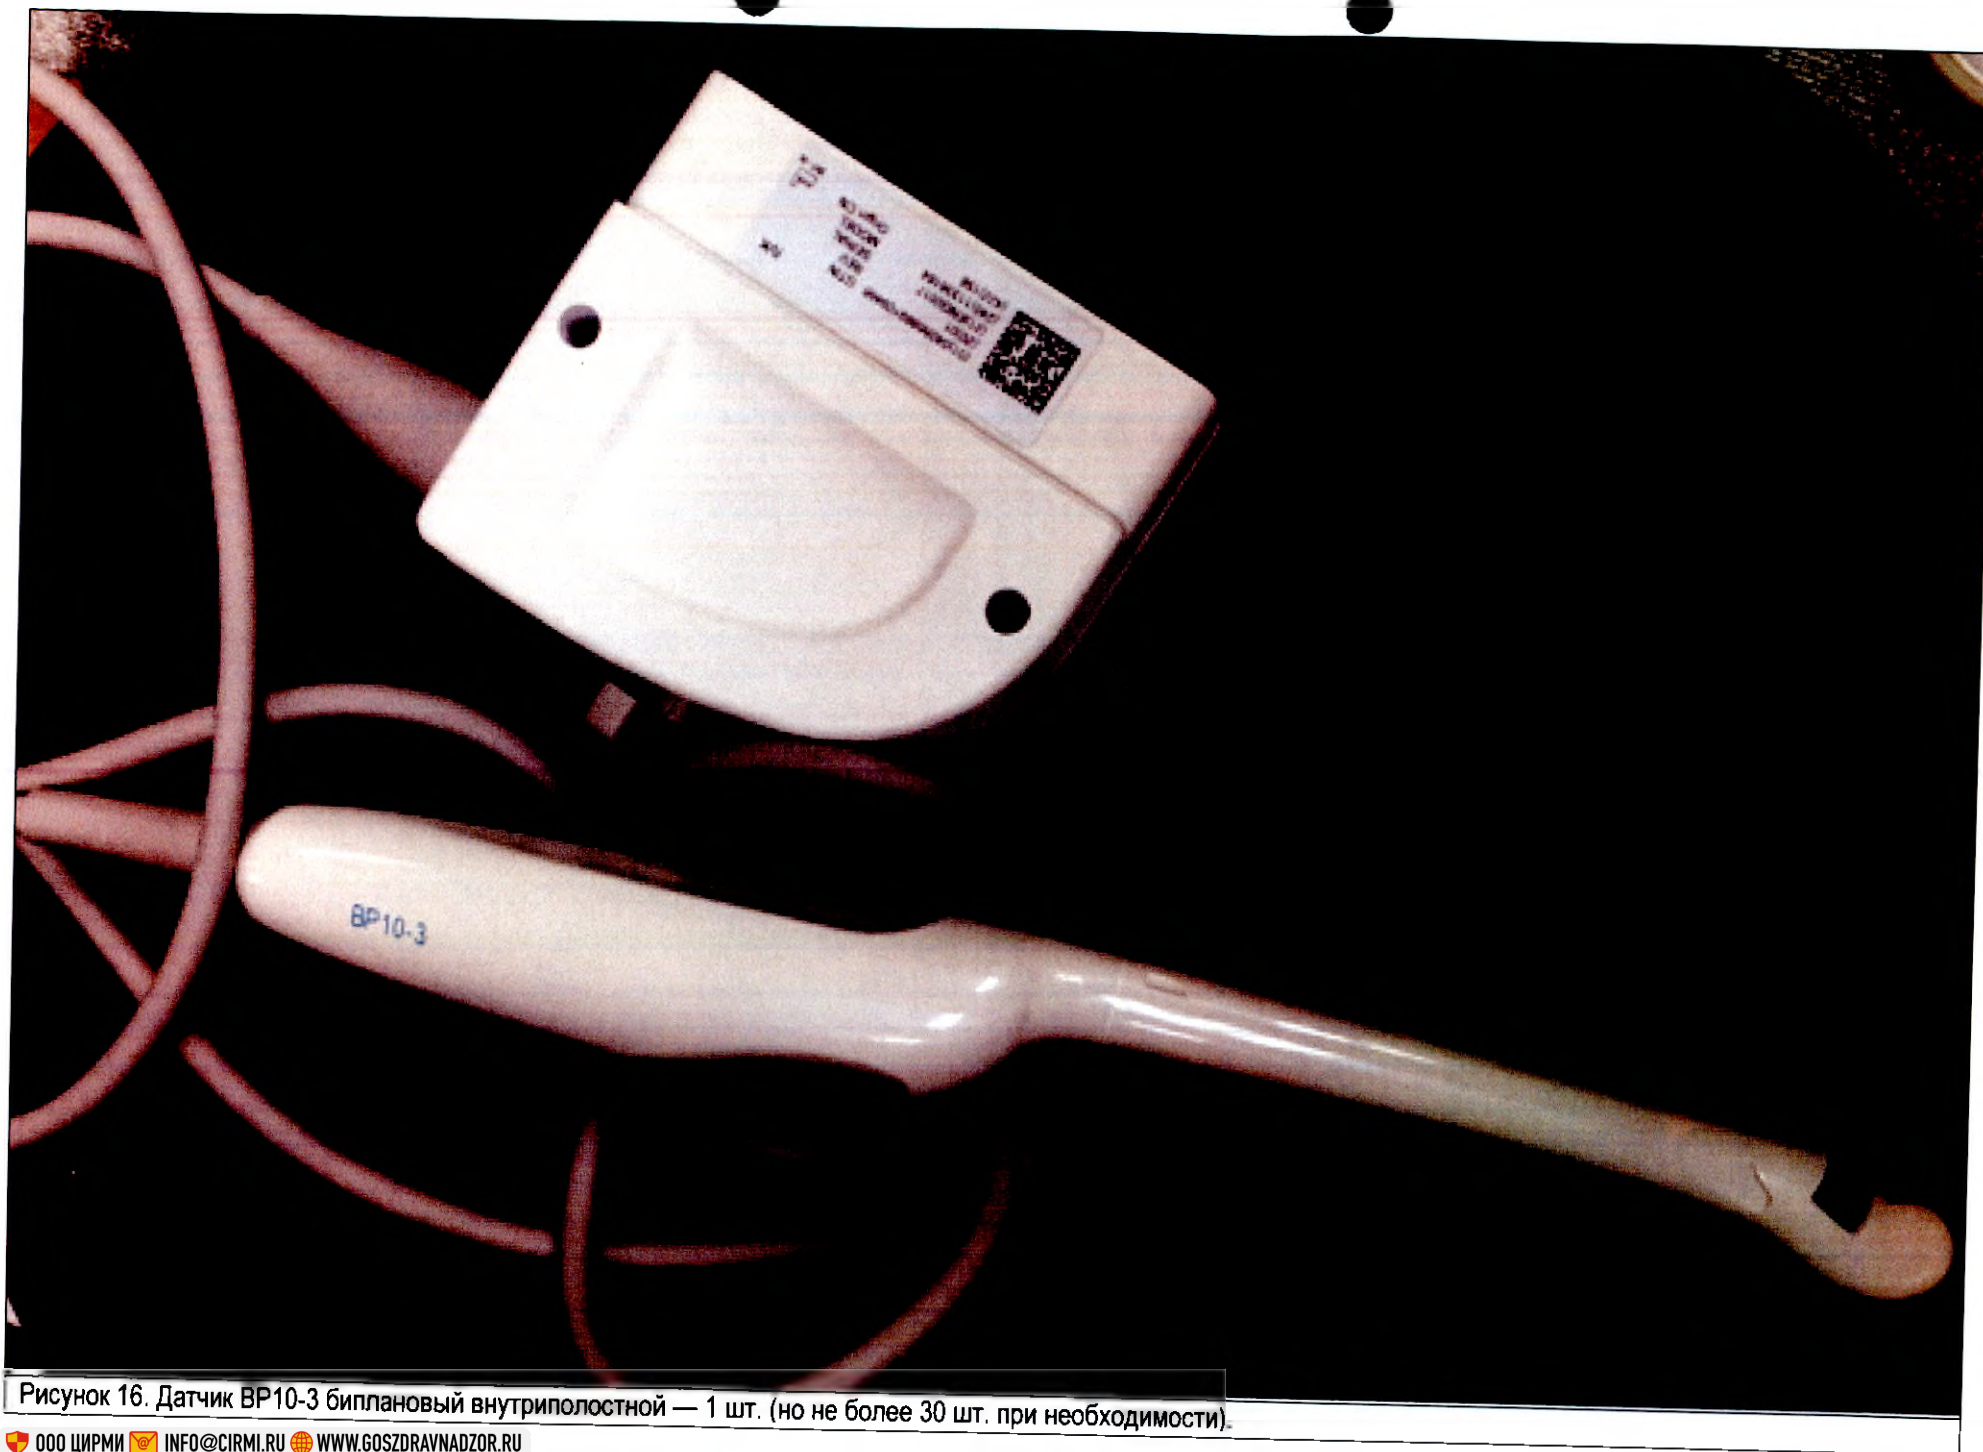


Рисунок 16. Датчик BP10-3 биплановый внутриполостной — 1 шт. (но не более 30 шт. при необходимости).



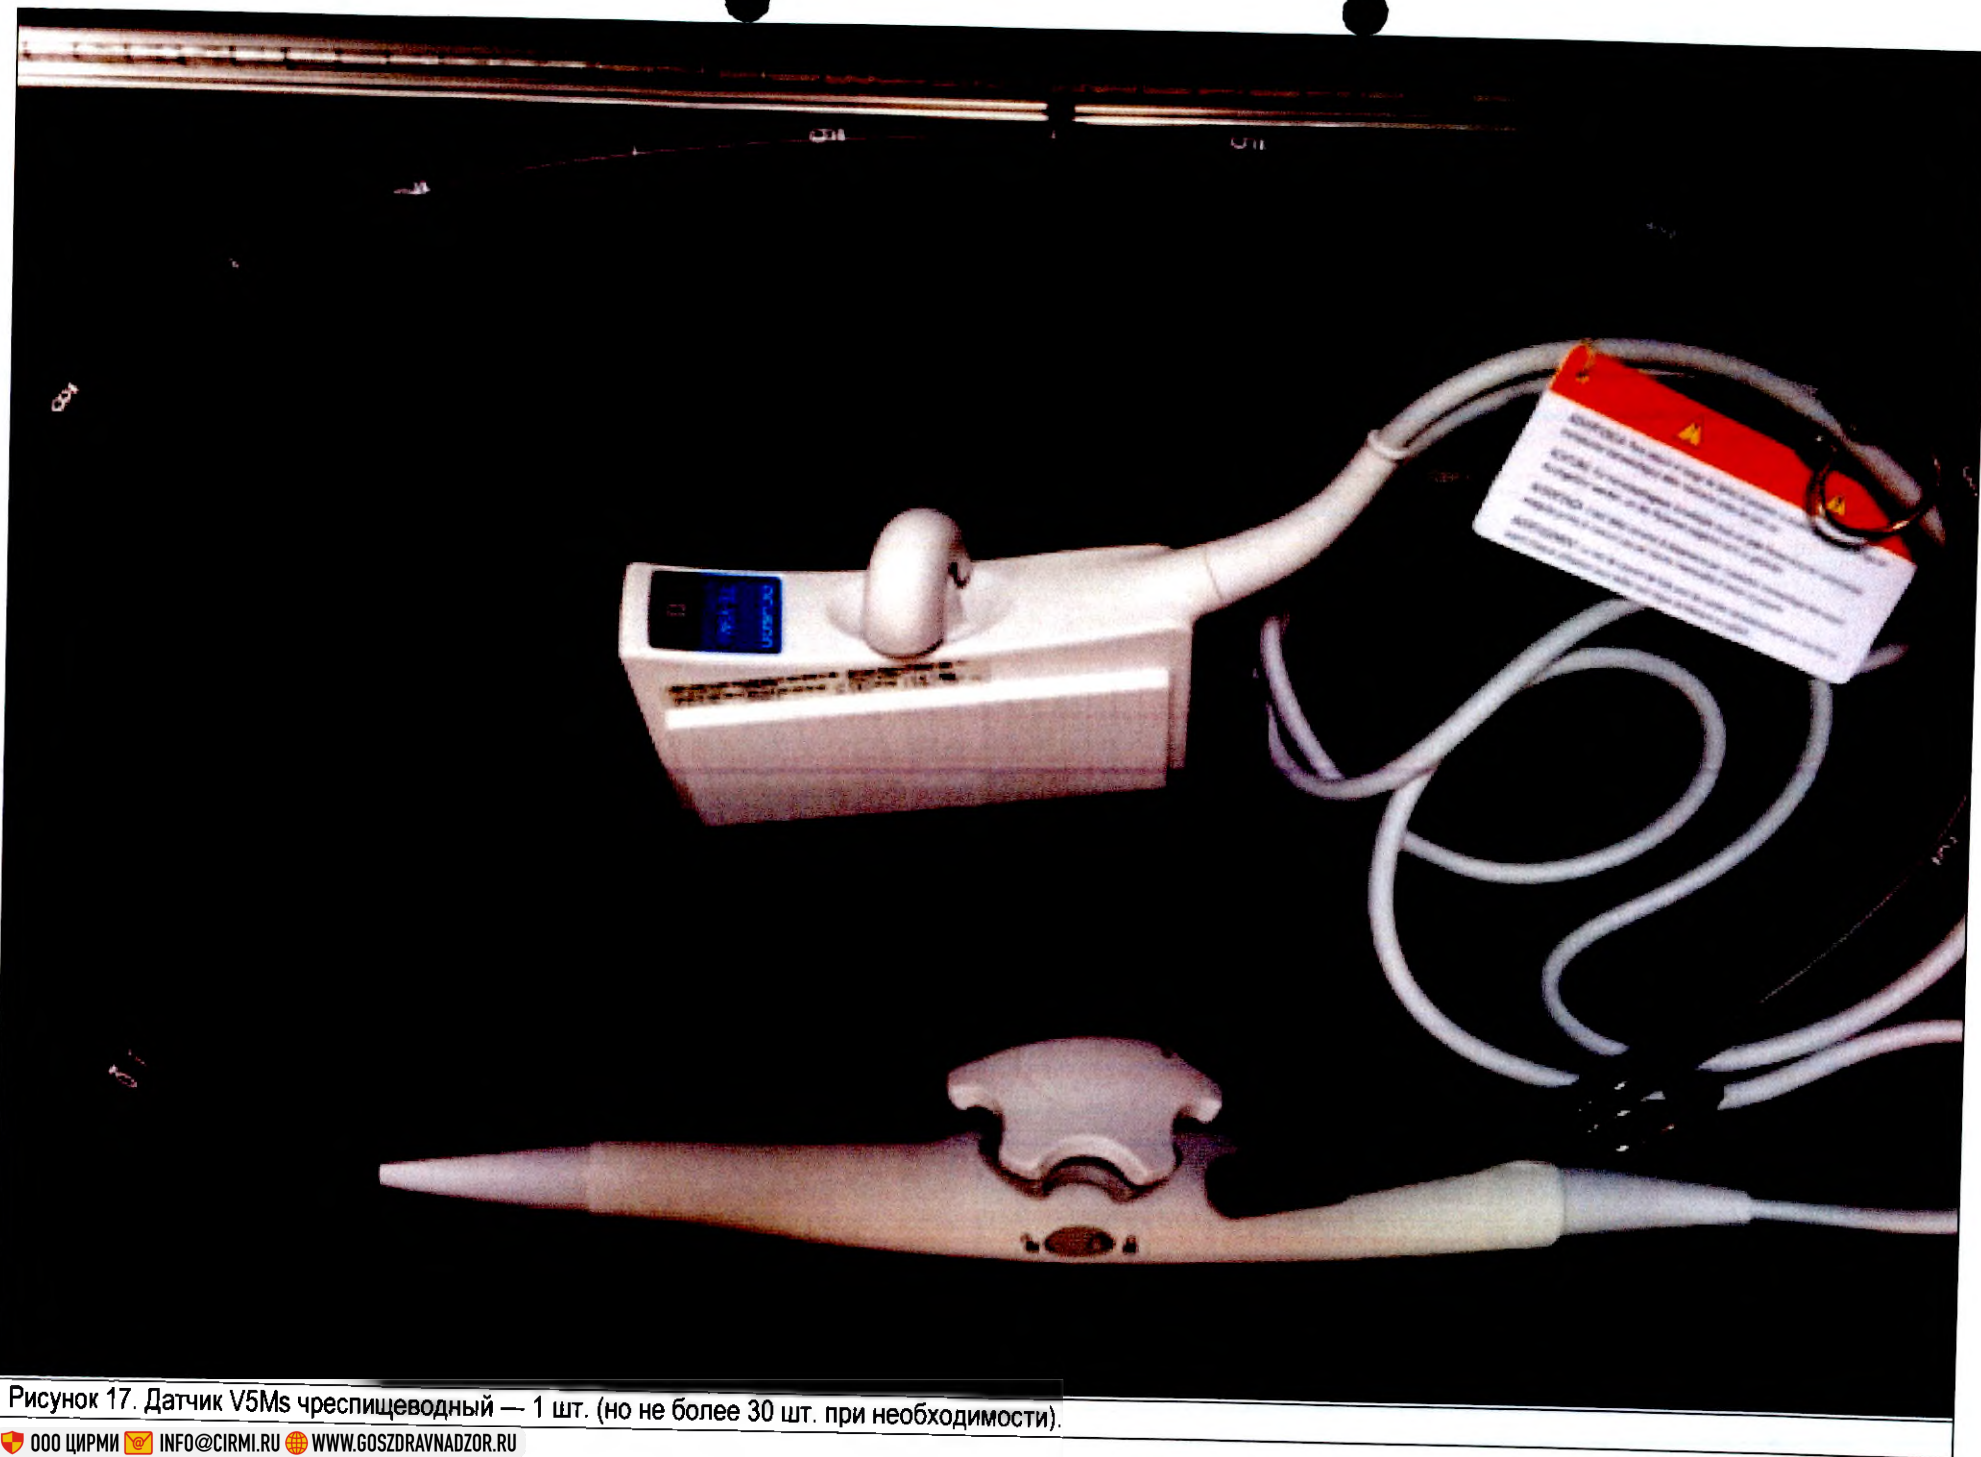


Рисунок 17. Датчик V5Ms чреспищеводный — 1 шт. (но не более 30 шт. при необходимости).

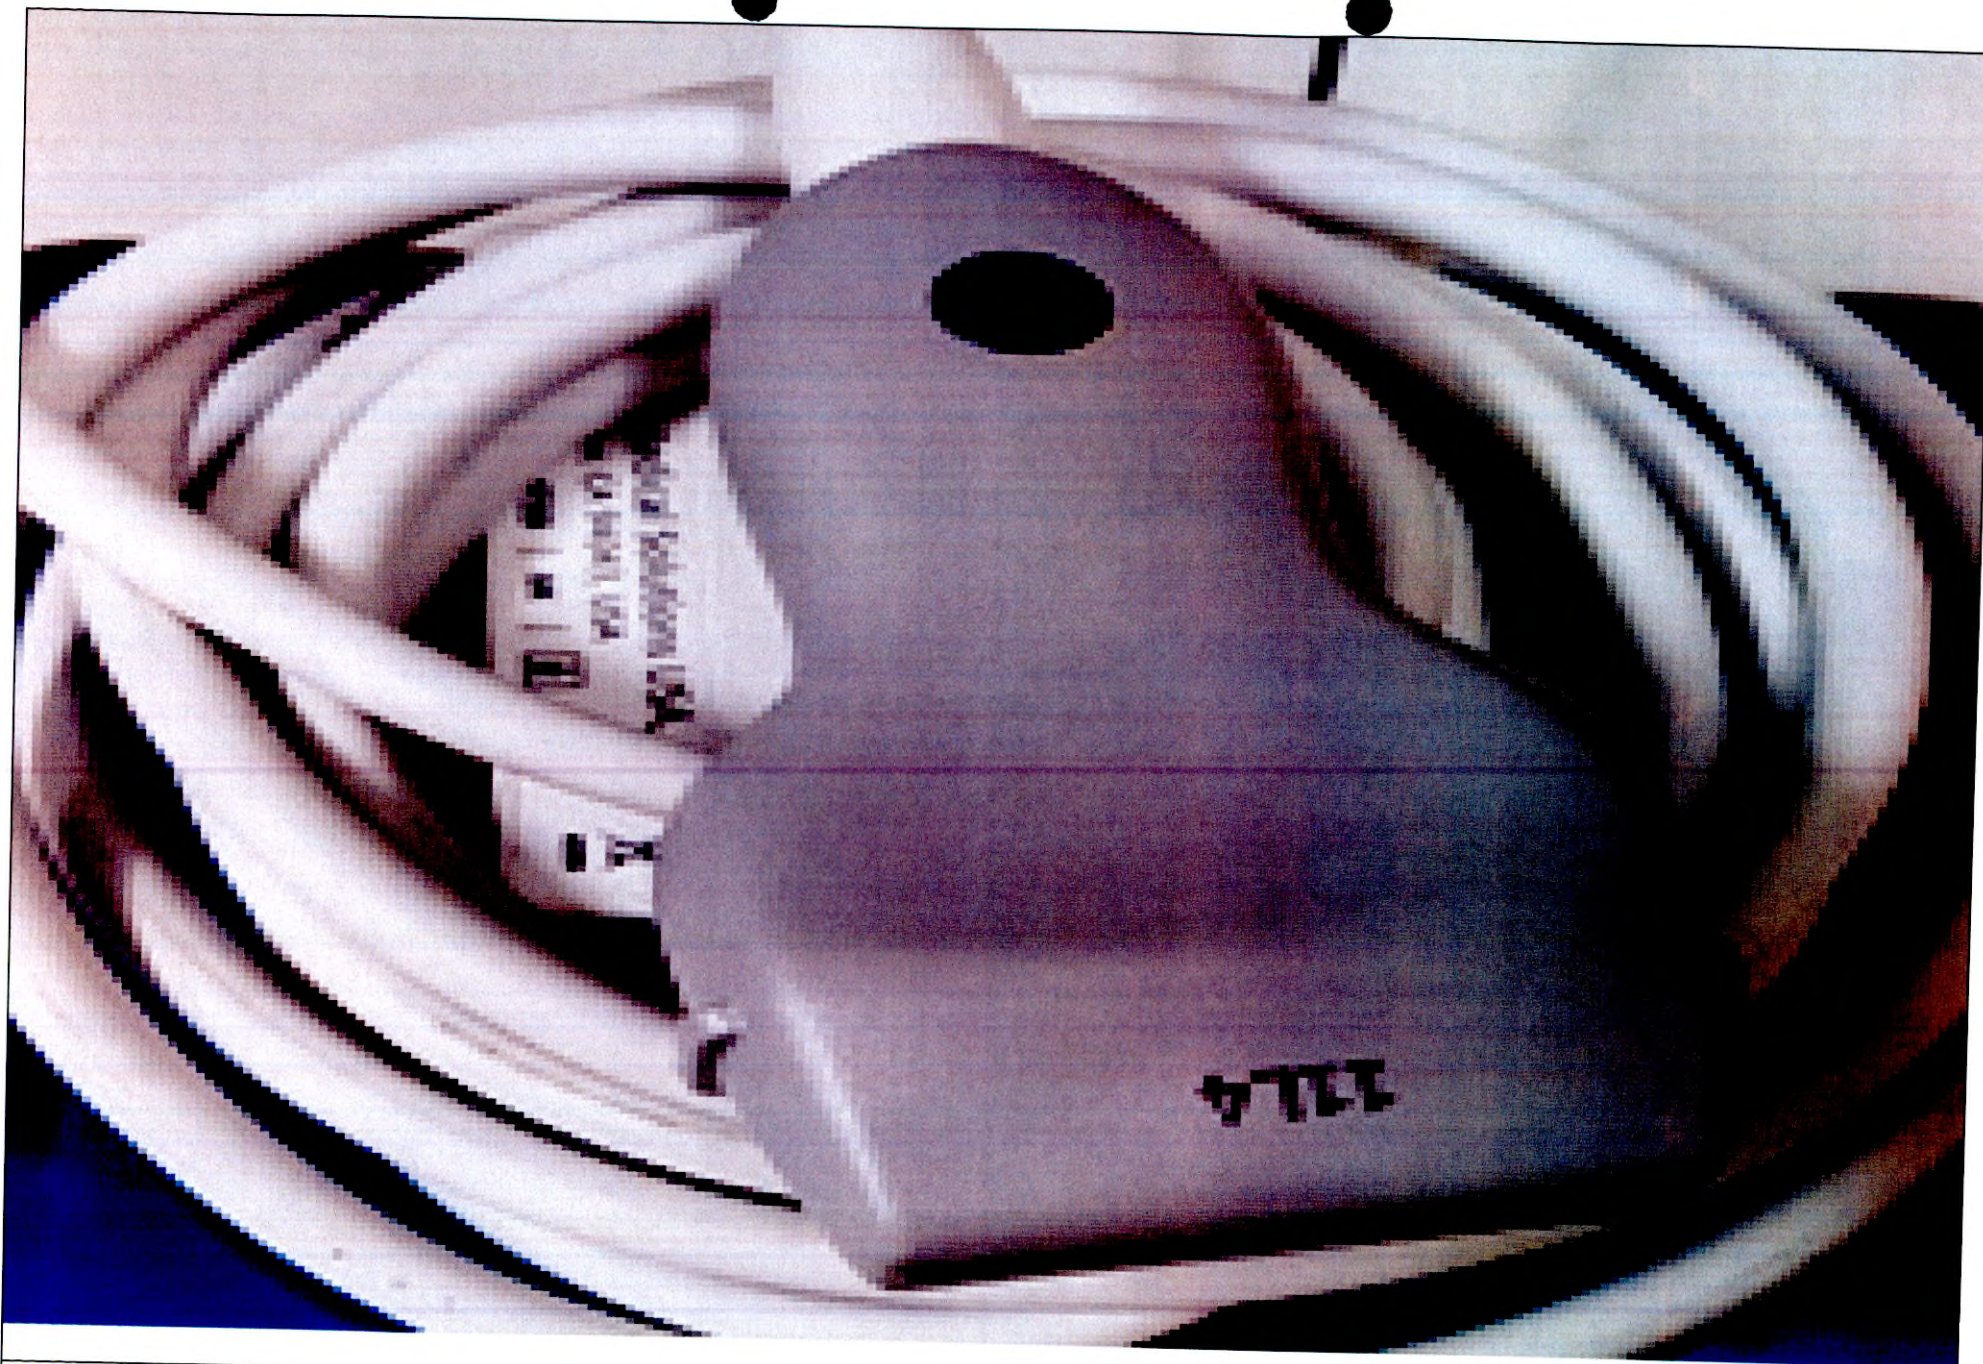

18. Датчик 11L4 линейный — 1 шт. (но не более 30 шт. при необходимости).

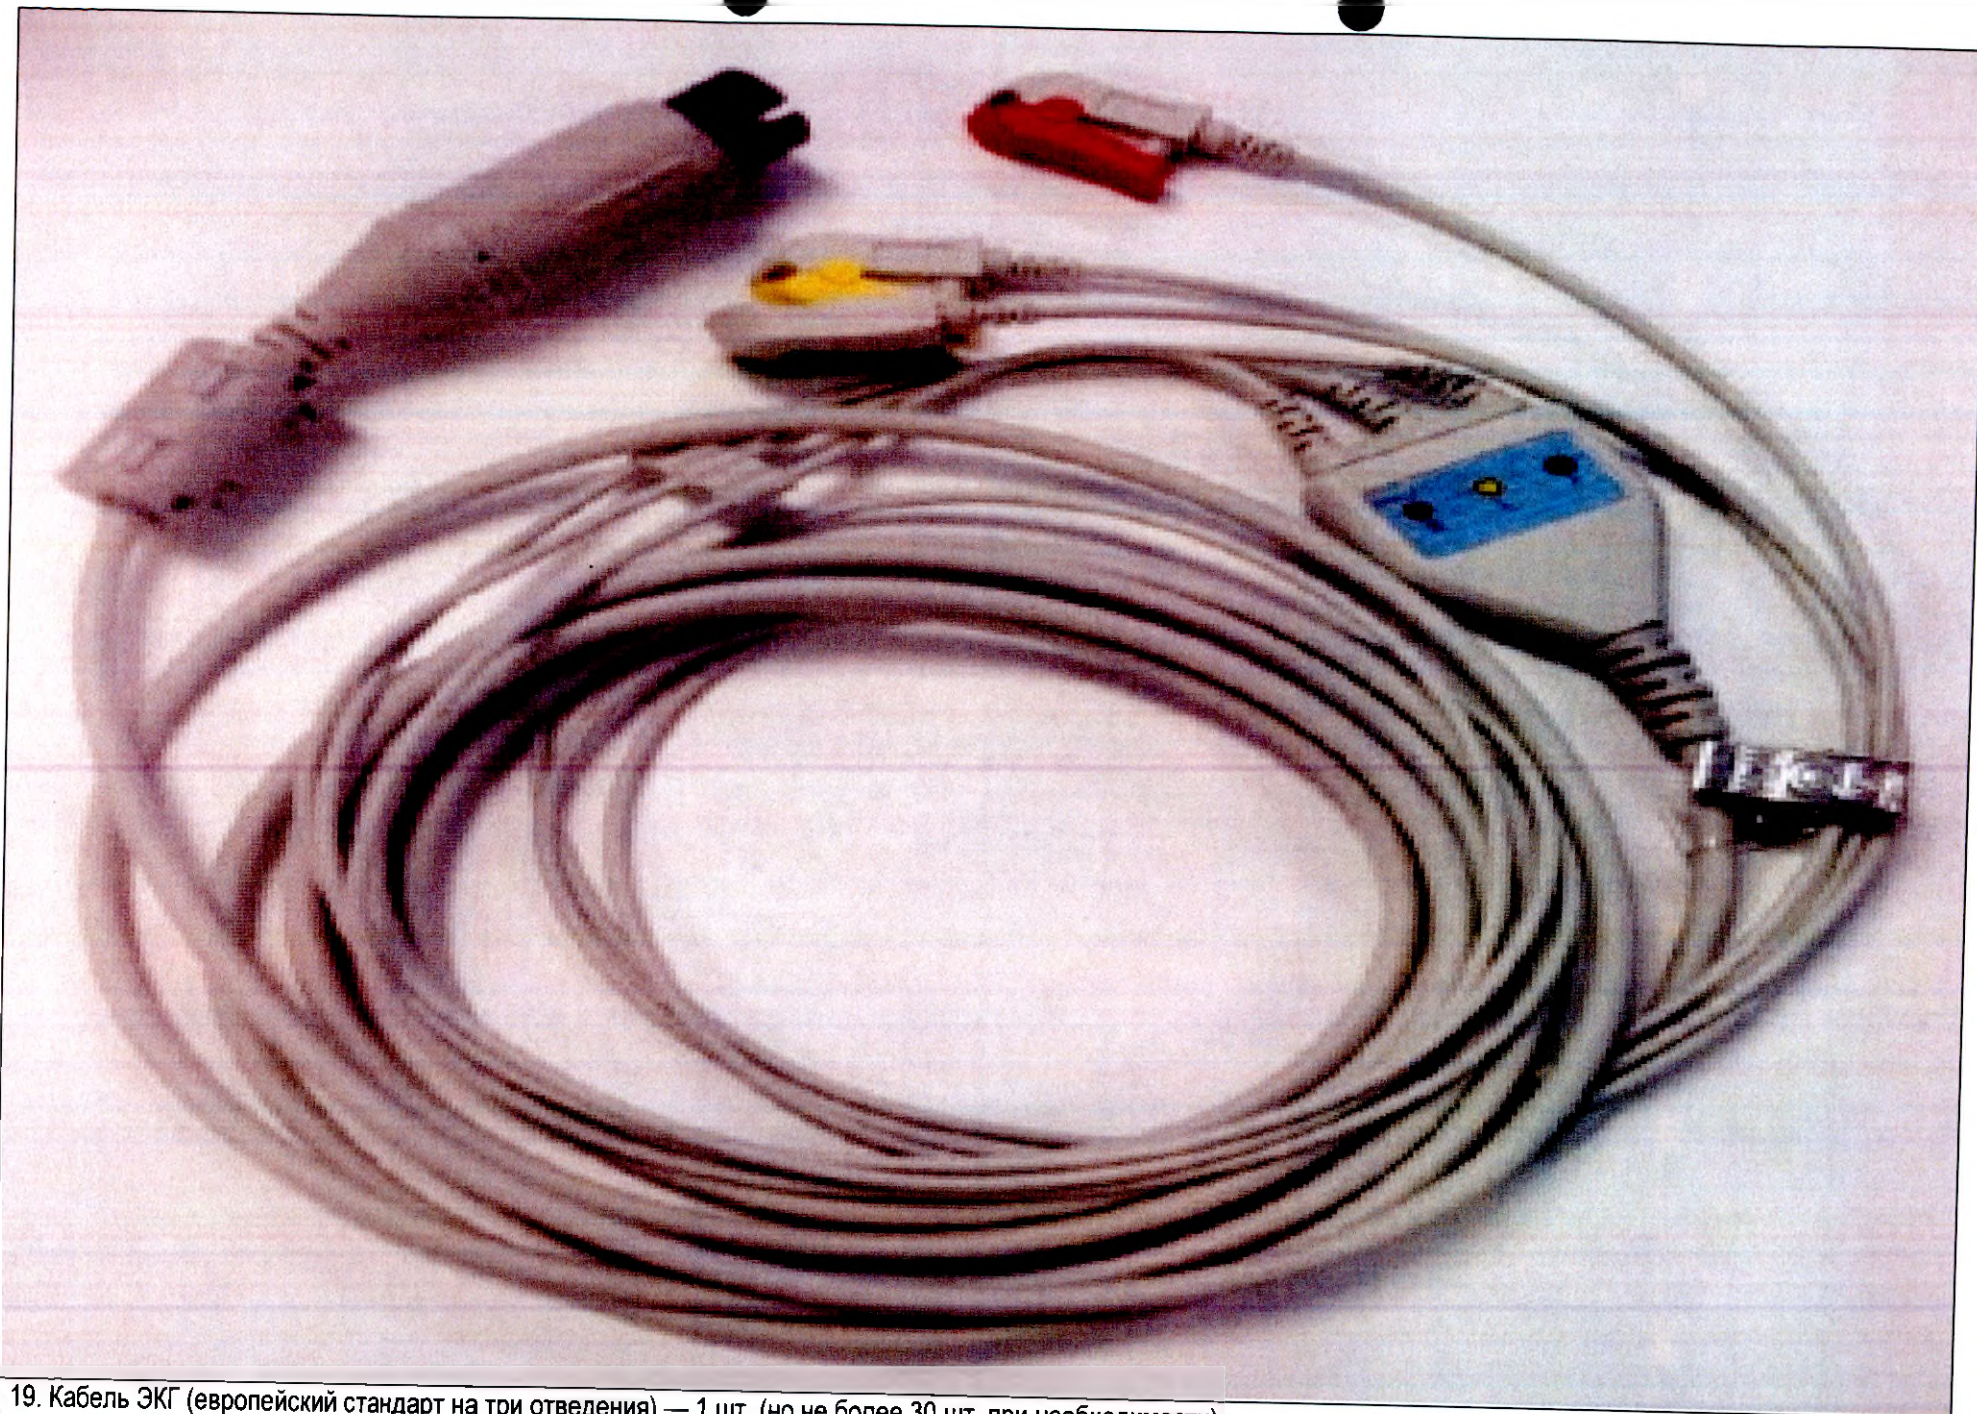

19. Кабель ЭКГ (европейский стандарт на три отведения) — 1 шт. (но не более 30 шт. при необходимости)

**ACUSON NX3**  
**ACUSON NX3 Elite**  
Диагностическая ультразвуковая система  
Инструкция по эксплуатации

**US**

11336408-01

**CE**  
**0123**

**Siemens Medical Solutions USA, Inc.**

**11336408-01**

## Приложение к инструкции по эксплуатации для России

---

Система ультразвуковая диагностическая, варианты исполнения:  
ACUSON NX3, ACUSON NX3 Elite  
с принадлежностями

\* зависит от веса и размера, а также от других характеристикам медицинского изделия,  
его конструктивных элементов, предоставляемых в качестве возмездных принадлежностей  
±10 % (если не указано иное)

Фотографические изображения базового блока медицинского изделия:  
**«Принадлежности для ACUSON NX3»**

CHS12  
Abdomen  
30 dB  
THI 2.2 MHz  
CR 60 dB  
Edge 2  
Persist 4  
R/S 4  
Map C  
Tint 3  
4 fps

Tissue Harmonic Imaging  
Hemangioma Seen Within Liver



Рисунок 2. Лицензионный ключ для технологии динамической оптимизации ткани (DTO) на оптическом и/или электронном носителе.

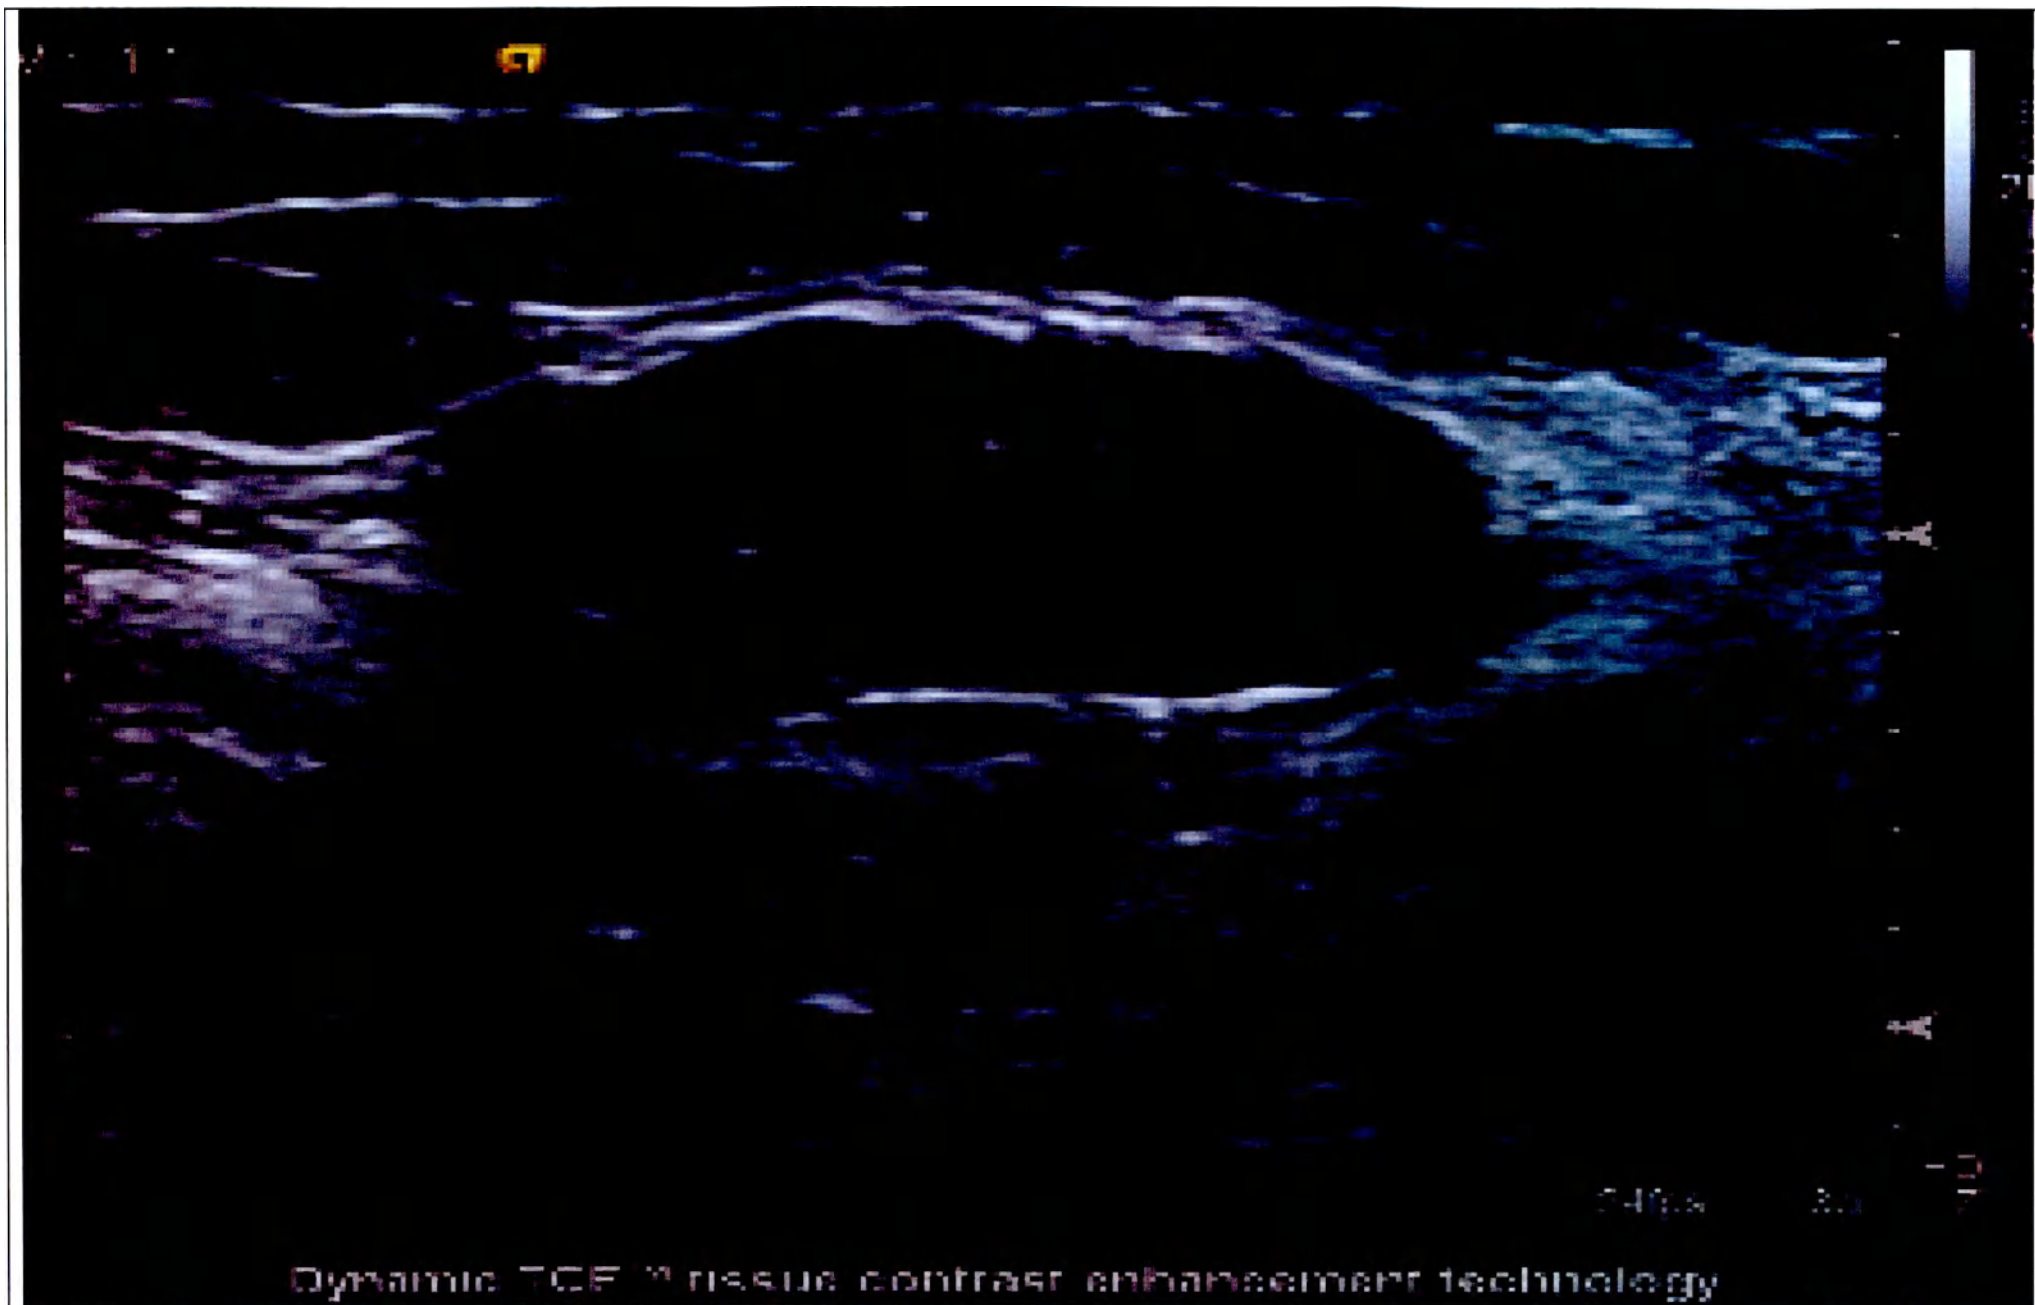


Рисунок 3. Лицензионный ключ для технологии снижения зернистости и повышения контрастности изображения (DTCE) на оптическом и/или электронном носителе.

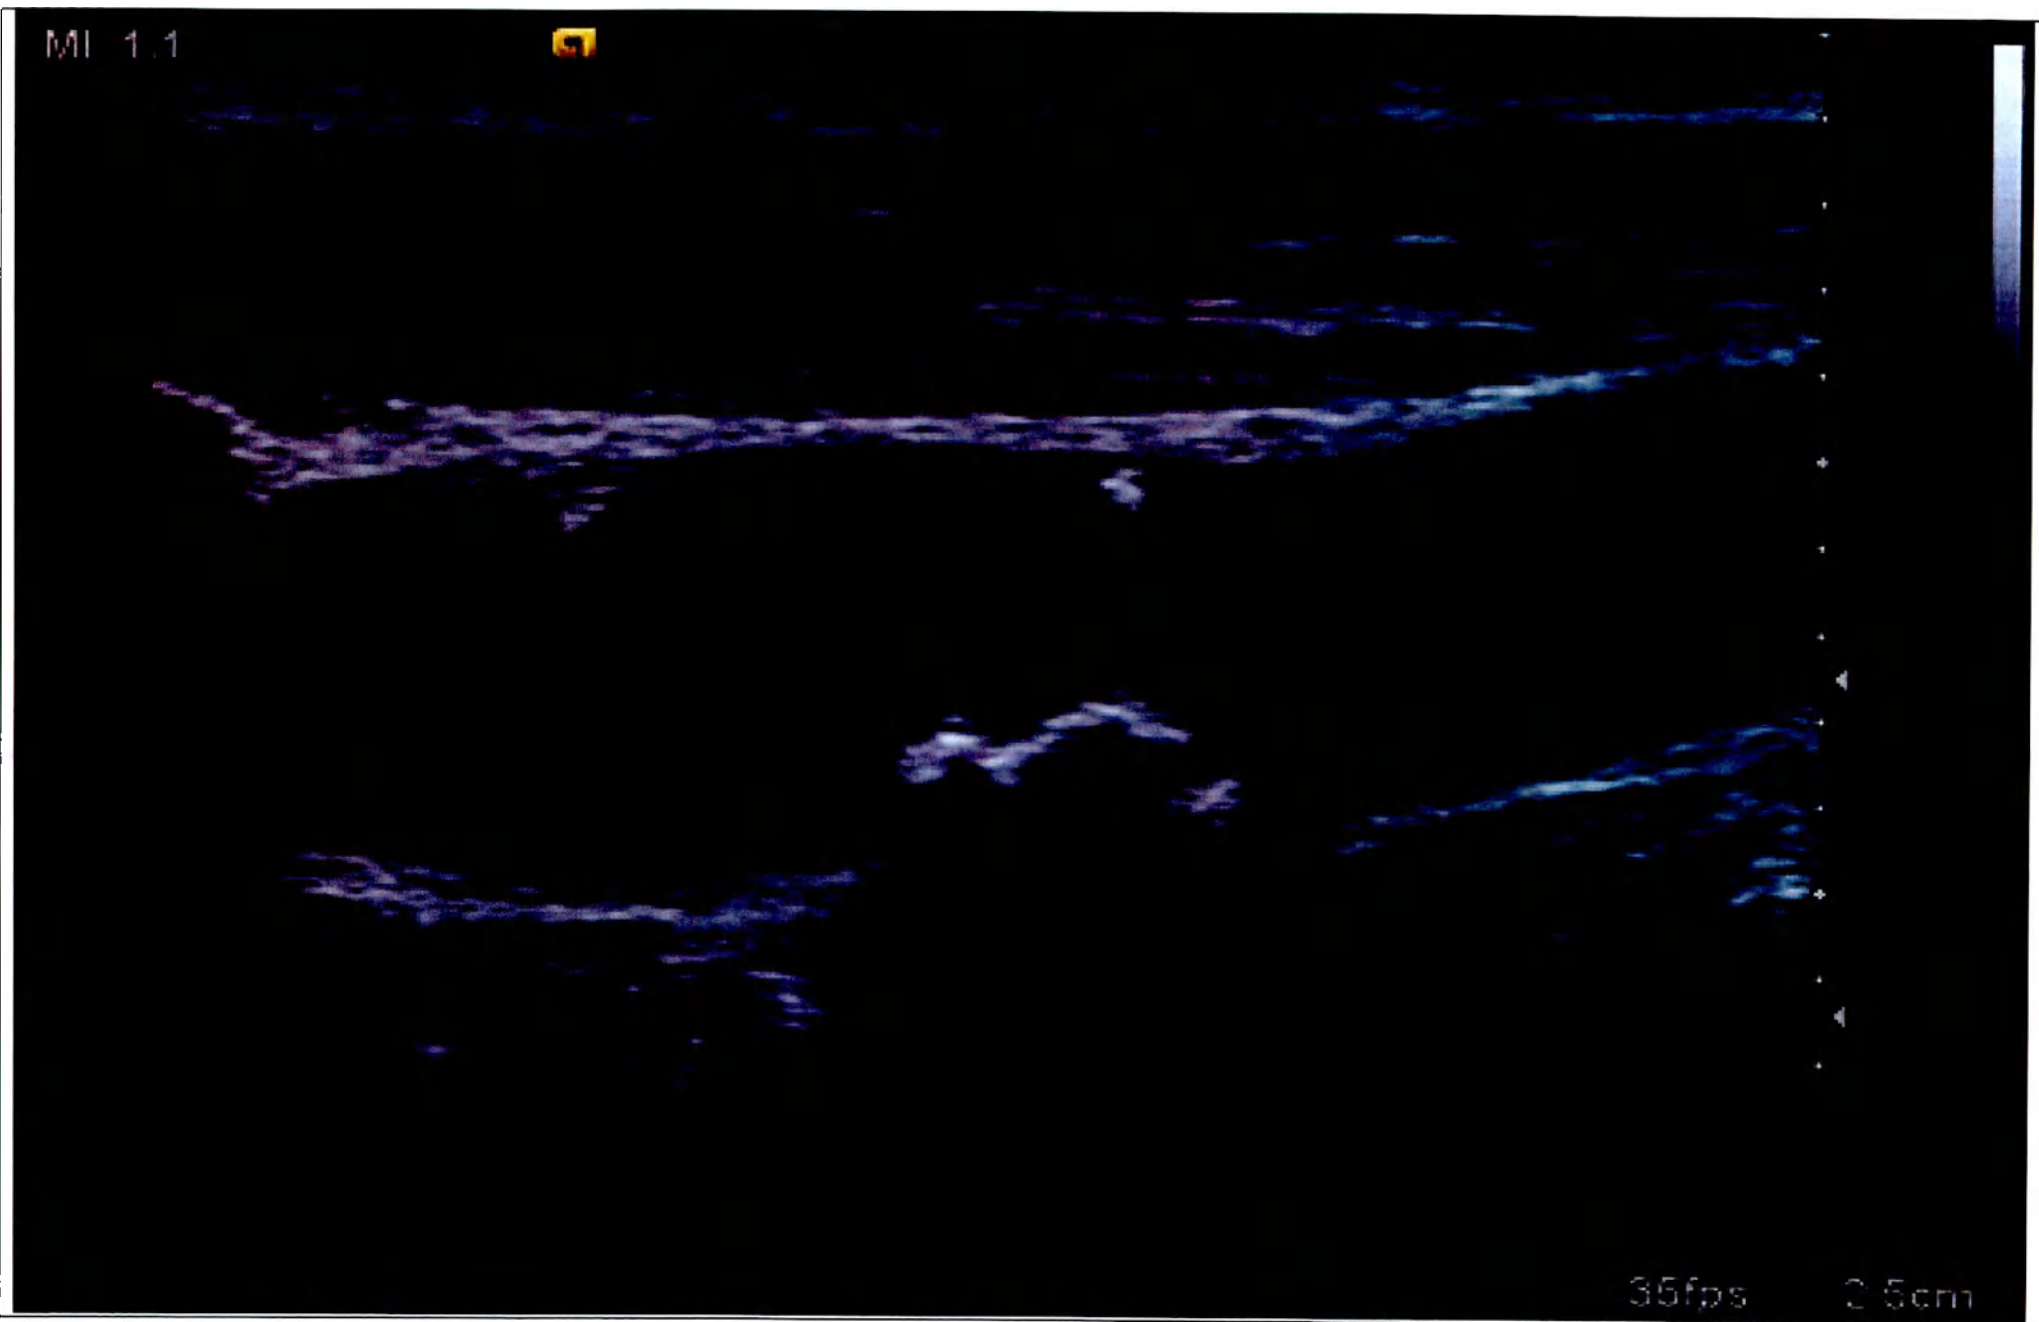


Рисунок 4. Лицензионный ключ для технологии пространственного компаундинга для снижения зернистости и повышения дифференциации тканей (Adv. SieClear) на оптическом и/или электронном носителе.

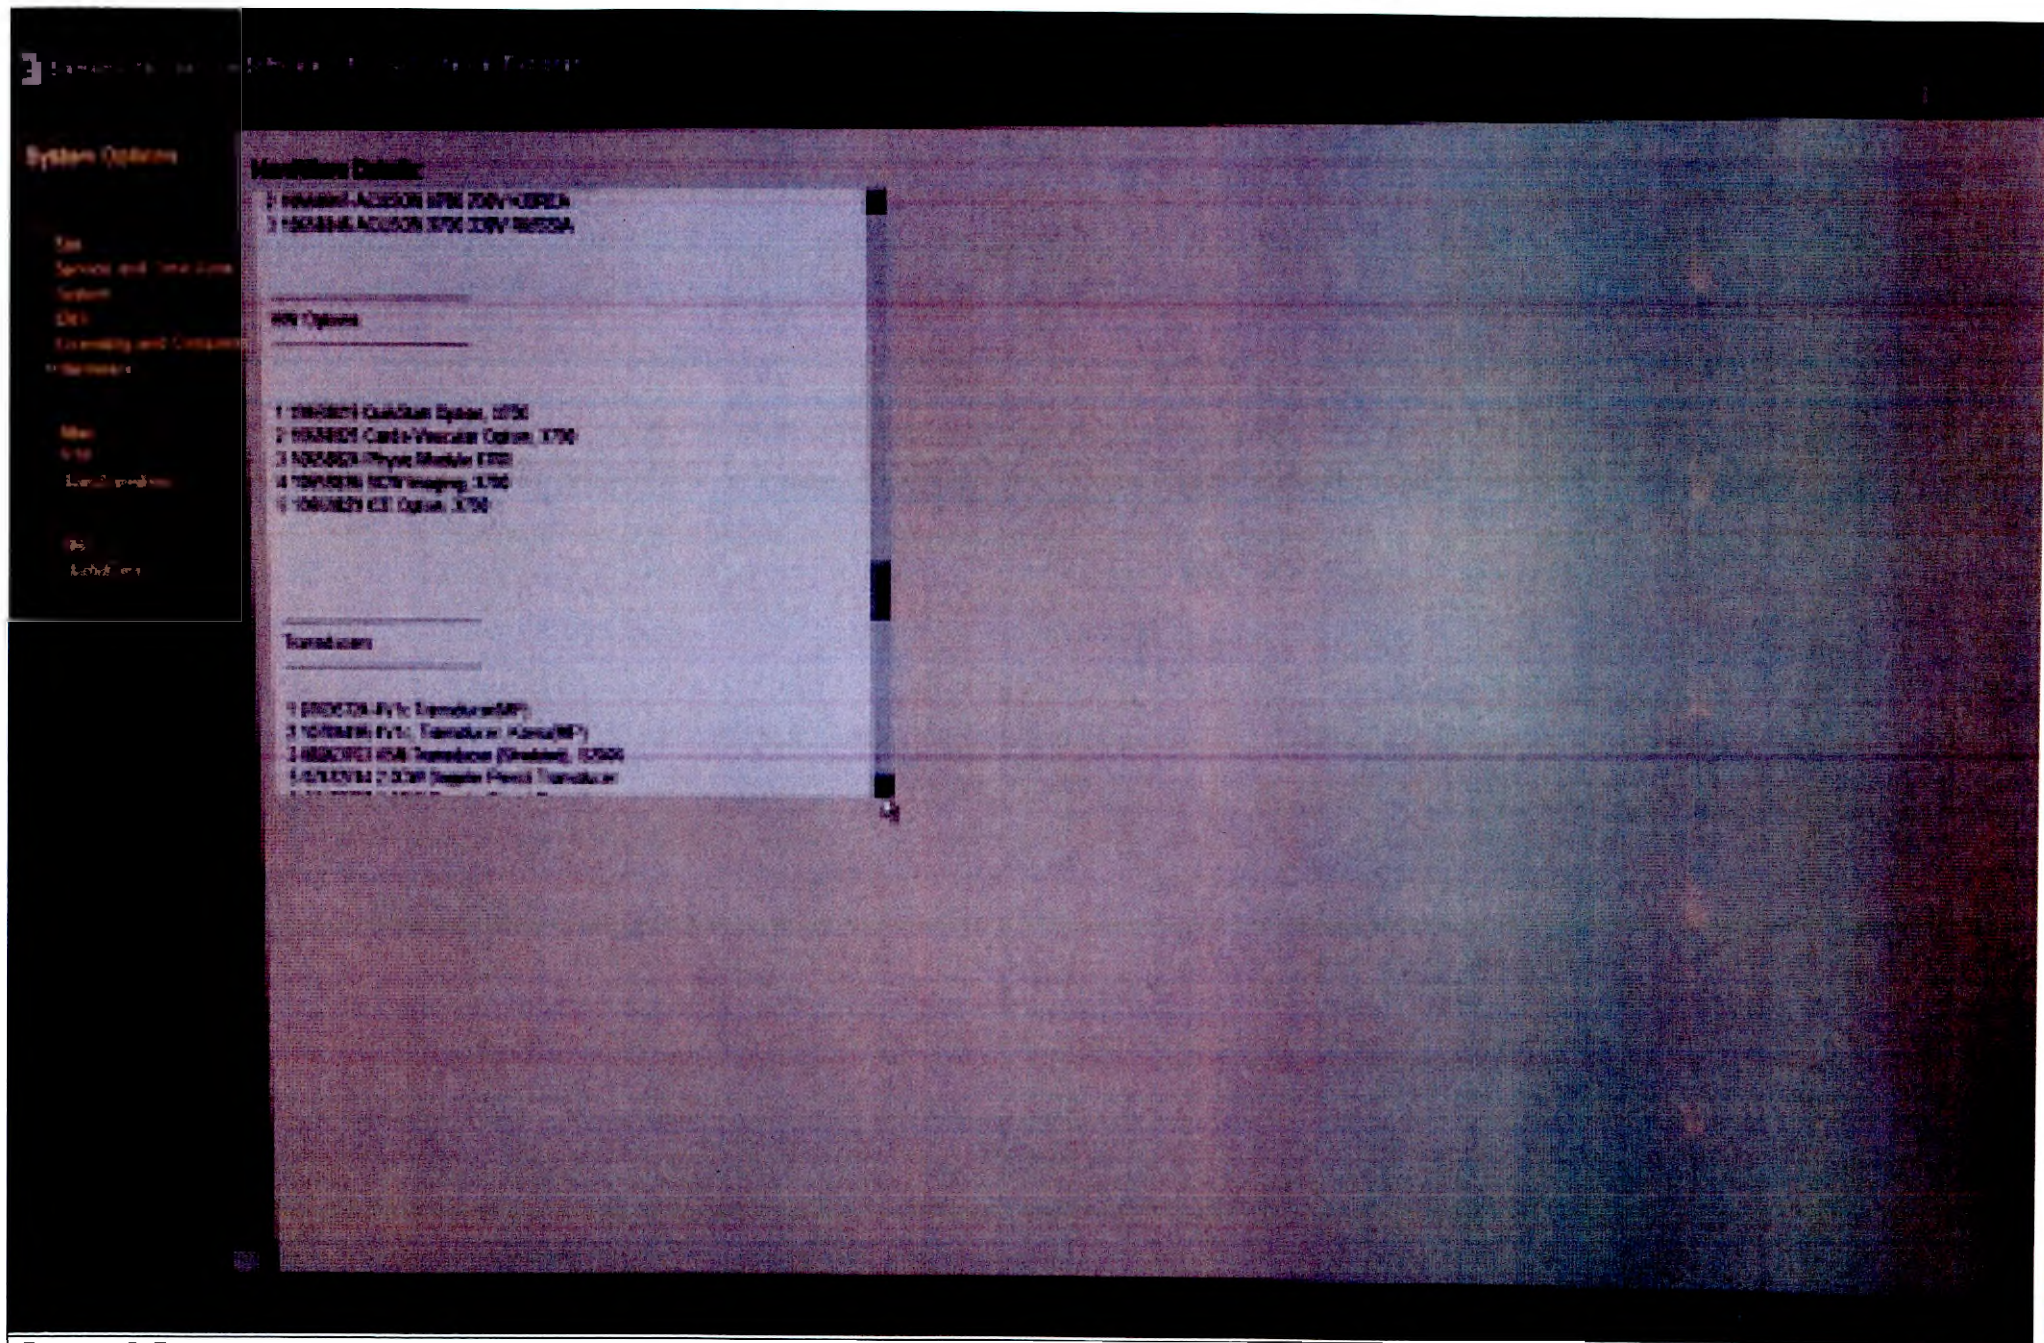


Рисунок 5. Лицензионный ключ для питания от аккумулятора в режиме ожидания (QuikStart) на оптическом и/или электронном носителе.

**Presets**

- General 1
- General 2
- Peripheral
- Customize Keys
- Display
- Exam Configuration
- User-Defined Exam List
- Text Annotation
- Pictogram List
- M & R Configuration
- Summary
- Service
- Stress Echo
- SieScape
- CAI
- Wireless
- DICOM**
- DIMAQ Utility
- Clip Capture
- Network Export
- Authorization
- Archive
- Printer

**DICOM**

Local Host | Storage Server | Worklist Server | MPPS Server | B/W Printer | Color Printer | Query/Retrieve |

Local Host ☒ Show network status

☒ Default

Alias: Default

AE Title: Default

Host Name: Default

MAC Address: 00-19-0F-23-2C-DE

New Edit Delete

☐ DHCP

☐ Mapping Application

☒ Fixed IP address

IP Address: 192 168 0 1

Subnet Mask: 255 255 255 0

Default Gateway: 0 0 0 0

Media Type: HardwareDefault

Duplex Mode: HardwareDefault

Save Cancel

Рисунок 6. Лицензионный ключ для стандарта DICOM (стандарт создания, хранения, передачи и печати медицинских данных и изображений) (DICOM Connectivity) на оптическом и/или электронном носителе

General 1

General 2

Peripheral

Customize Keys

Display

Exam Configuration

User-Defined Exam List

Text Annotation

Pictogram List

M & R Configuration

Summary

Service

Stress Echo

SieScape

CAI

Wireless

DICOM

DIMAQ Utility

Clip Capture

Network Export

Authorization

Archive

Printer

| Local Host                                                                                                                                                                          | Storage Server | Worklist Server                                                                                                                             | MPPS Server | B/W Printer | Color Printer | Query/Retrieve |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Storage Server                                                                                                                                                                      |                | <input type="checkbox"/> Uses Commitment                                                                                                    |             |             |               |                |
| <input checked="" type="checkbox"/> SS_AL                                                                                                                                           |                | Alias: <input type="text" value="SS_AL"/>                                                                                                   |             |             |               |                |
|                                                                                                                                                                                     |                | AE Title: <input type="text" value="SS_AE"/>                                                                                                |             |             |               |                |
|                                                                                                                                                                                     |                | IP Address: <input type="text" value="192"/> <input type="text" value="168"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="3"/> |             |             |               |                |
|                                                                                                                                                                                     |                | Port Number: <input type="text" value="5104"/>                                                                                              |             |             |               |                |
|                                                                                                                                                                                     |                | Ping and Echo Timeout in seconds: <input type="text" value="10"/>                                                                           |             |             |               |                |
| <input type="button" value="New"/> <input type="button" value="Apply"/> <input type="button" value="Cancel"/>                                                                       |                | <input type="button" value="Ping"/> <input type="button" value="Echo"/>                                                                     |             |             |               |                |
| <input checked="" type="radio"/> Autostore to DICOM <input type="radio"/> Store During Exam <input checked="" type="radio"/> Store At End Of Exam                                   |                |                                                                                                                                             |             |             |               |                |
| <input type="radio"/> After Every Image is Stored <input checked="" type="radio"/> After All Images are Stored                                                                      |                |                                                                                                                                             |             |             |               |                |
| Number of Times to Retry Failure                                                                                                                                                    |                | <input type="text" value="2"/>                                                                                                              |             |             |               |                |
| Seconds Between Each Retry:                                                                                                                                                         |                | <input type="text" value="60"/>                                                                                                             |             |             |               |                |
| Write Timeout in Seconds:                                                                                                                                                           |                | <input type="text" value="30"/>                                                                                                             |             |             |               |                |
| Connect Timeout in Seconds                                                                                                                                                          |                | <input type="text" value="30"/>                                                                                                             |             |             |               |                |
| Image Format:                                                                                                                                                                       |                | <input type="text" value="Automatic"/> <input type="button" value="v"/> <input checked="" type="checkbox"/> Send SR                         |             |             |               |                |
| <input checked="" type="radio"/> No Monochrome conversion<br><input type="radio"/> Store all images as Monochrome<br><input type="radio"/> Store all images and clips as Monochrome |                |                                                                                                                                             |             |             |               |                |
|                                                                                                                                                                                     |                | <input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Cancel"/>                                                                   |             |             |               |                |

Рисунок 7. Лицензионный ключ для создания структурированных отчетов в формате DICOM для акушерских/гинекологических исследований (DICOM SR OB/GYN) на оптическом и/или электронном носителе.

**Presets**

- General 1
- General 2
- Peripheral
- Customize Keys
- Display
- Exam Configuration
- User-Defined Exam List
- Text Annotation
- Pictogram List
- M & R Configuration
- Summary
- Service
- Stress Echo
- SieScape
- CAI
- Wireless
- DICOM
- DIMAQ Utility
- Clip Capture
- Network Export
- Authorization
- Archive
- Printer

**Local Host | Storage Server | Worklist Server | MPPS Server | B/W Printer | Color Printer | Query/Retrieve**

**Storage Server** ☐ Uses Commitment

☒ SS\_AL

Alias: SS\_AL

AE Title: SS\_AE

IP Address: 192 168 0 3

Port Number: 5104

Ping and Echo Timeout in seconds: 10

☒ Autostore to DICOM ☐ Store During Exam ☒ Store At End Of Exam

☐ After Every Image is Stored ☒ After All Images are Stored

Number of Times to Retry Failure: 2

Seconds Between Each Retry: 60

Write Timeout in Seconds: 30

Connect Timeout in Seconds: 30

Image Format: Automatic ☒ Send SR

☒ No Monochrome conversion

☐ Store all images as Monochrome

☐ Store all images and clips as Monochrome

Рисунок 8. Лицензионный ключ для создания структурированных отчетов в формате DICOM для кардиологических исследований (DICOM SR Cardiac) на оптическом и/или электронном носителе.

## Presets

General 1  
 General 2  
 Peripheral  
 Customize Keys  
 Display  
 Exam Configuration  
 User-Defined Exam List  
 Text Annotation  
 Pictogram List  
 M & R Configuration  
 Summary  
 Service  
 Stress Echo  
 SieScape  
 CAI  
 Wireless  
 DICOM  
 DIMAQ Utility  
 Clip Capture  
 Network Export  
 Authorization  
 Archive  
 Printer

Local Host | Storage Server | Worklist Server | MPPS Server | B/W Printer | Color Printer | Query/Retrieve |

Storage Server ☐ Uses Commitment

SS\_AL Alias: SS\_AL

AE Title: SS\_AE

IP Address 192 168 0 3

Port Number 5104

Ping and Echo Timeout in seconds. 10

New Apply Cancel Ping Echo

☒ Autostore to DICOM ☐ Store During Exam ☒ Store At End Of Exam

☐ After Every Image is Stored ☒ After All Images are Stored

Number of Times to Retry Failure 2

Seconds Between Each Retry: 60

Write Timeout in Seconds: 30

Connect Timeout in Seconds: 30

Image Format: Automatic ☒ Send SR

☒ No Monochrome conversion

☐ Store all images as Monochrome

☐ Store all images and clips as Monochrome

Save Cancel

Рисунок 9. Лицензионный ключ для создания структурированных отчетов в формате DICOM для сосудистых исследований (DICOM SR Vascular) на оптическом и/или электронном носителе.

VF10-5  
MSK  
32 dB  
10.0 MHz TGO  
DR 60 dB  
Edge 3  
Persist 4  
R S 3  
Map B  
Tint 0  
38 fps

Рисунок 10. Лицензионный ключ для оптимизации оттенков серого на изображении и доплеровского спектра (TGO) на оптическом и/или электроном носителе.

EC9-4  
 GYN  
 2dB  
 THI 6.5 MHz  
 DR 60 dB  
 Edge C  
 Persist 1  
 RIS 3  
 Map C  
 Tint 2  
 ASC 3  
 DTCE Med  
 31 fps

#2 D1 = 5.5mm  
 #2 Avg = 7.1mm  
 #3 D2 = 11.7mm

#2 D2 = 3.7mm  
 #3 D1 = 9.3mm  
 #3 Avg = 10.9mm

Sagittal Right Ovary

P 100% M 0.82

TIS 0.2 TIR 0.2

Рисунок 11. Лицензионный ключ для технологии автоматического исследования фолликулов (Auto Follicle) на оптическом и/или электронном носителе.

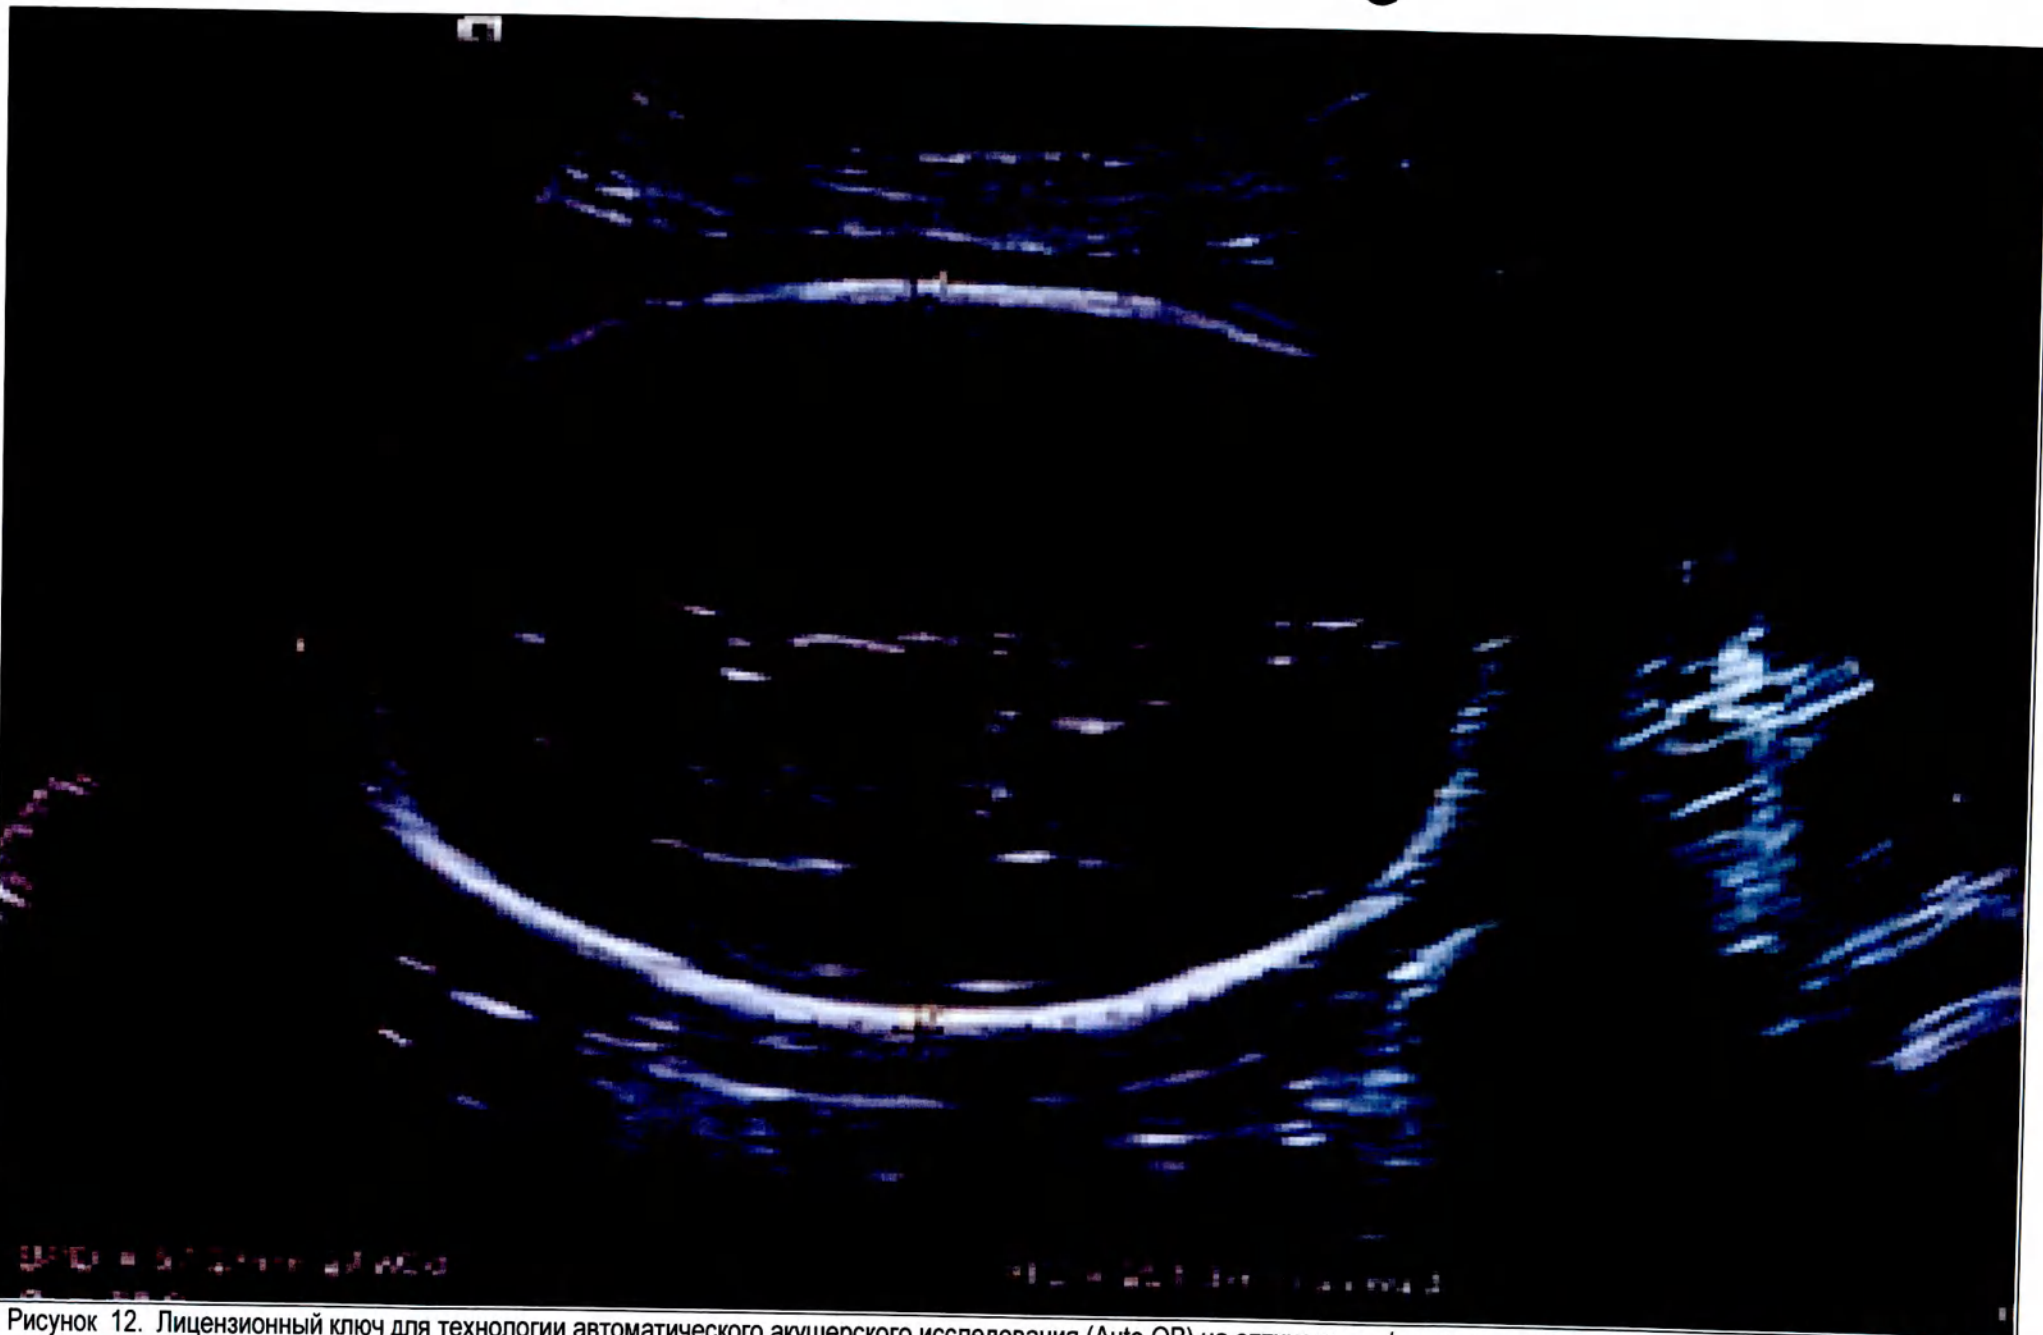


Рисунок 12. Лицензионный ключ для технологии автоматического акушерского исследования (Auto OB) на оптическом и/или электронном носителе.

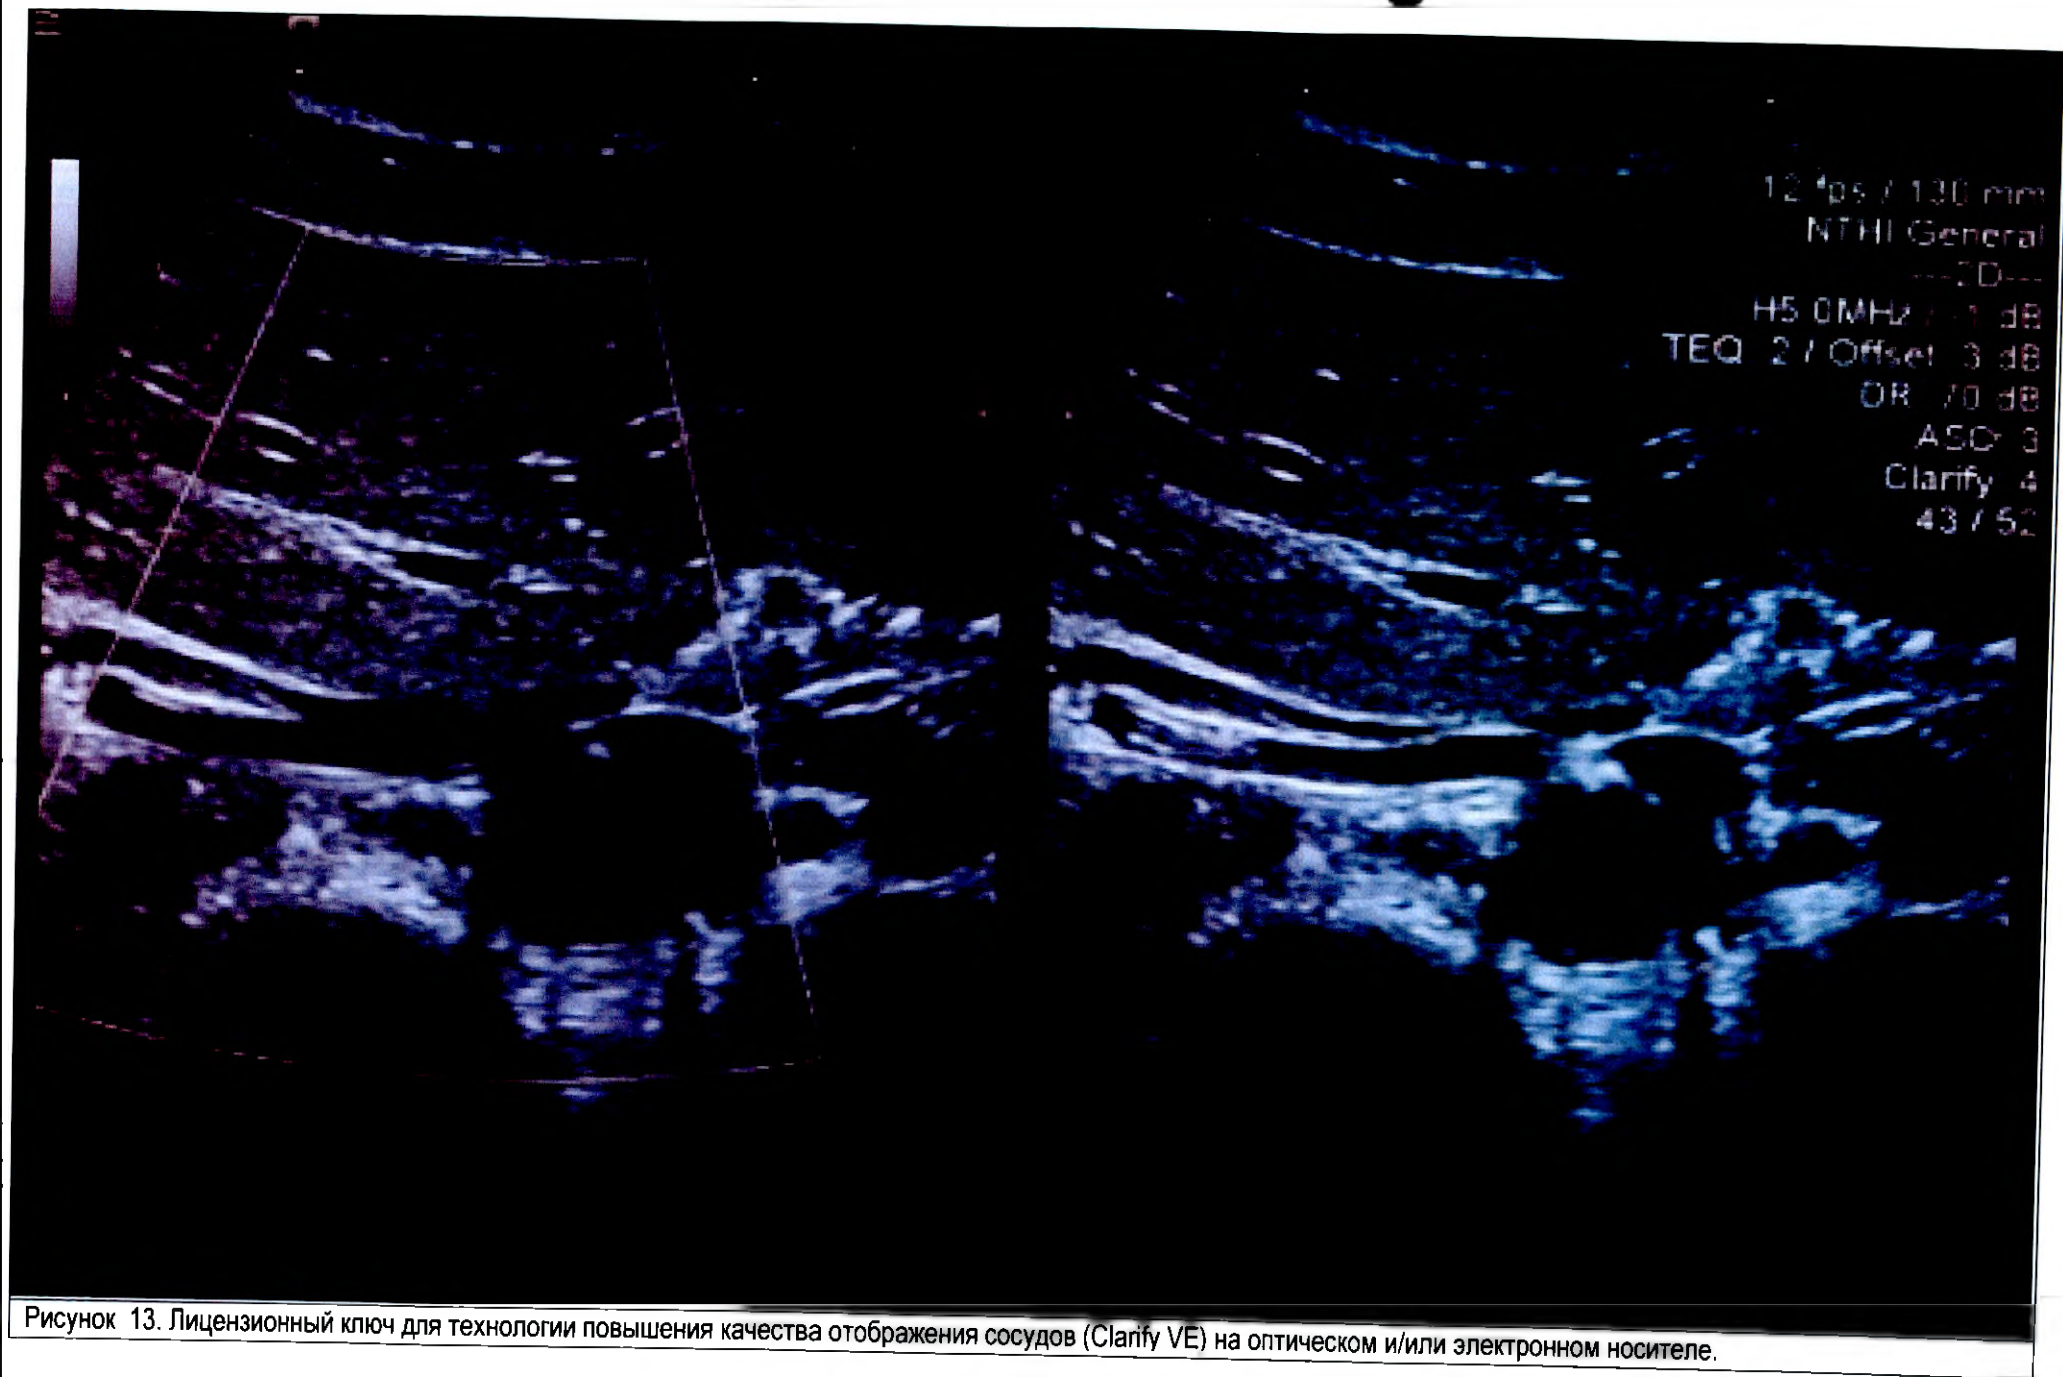




Рисунок 14. Лицензионный ключ для технологии панорамной визуализации (SieScape) на оптическом и/или электронном носителе.



Рисунок 15. Лицензионный ключ для технологии масштабирования изображения высокой плотности (HD Zoom) на оптическом и/или электронном носителе.

СБП2  
000  
Surface  
Opacity  
Opacity 77  
0.00 0.0  
Contrast 14  
Brightness 14  
Auto Contrast 25  
Low Th 64  
Map 8  
Test 13  
1.7 xps





Рисунок 16. Лицензионный ключ для технологии четырехмерной визуализации (fourSight 4D) на оптическом и/или электронном носителе.



Рисунок 17. Лицензионный ключ для технологии трехмерной визуализации (3-Scene 3D) на оптическом и/или электронном носителе

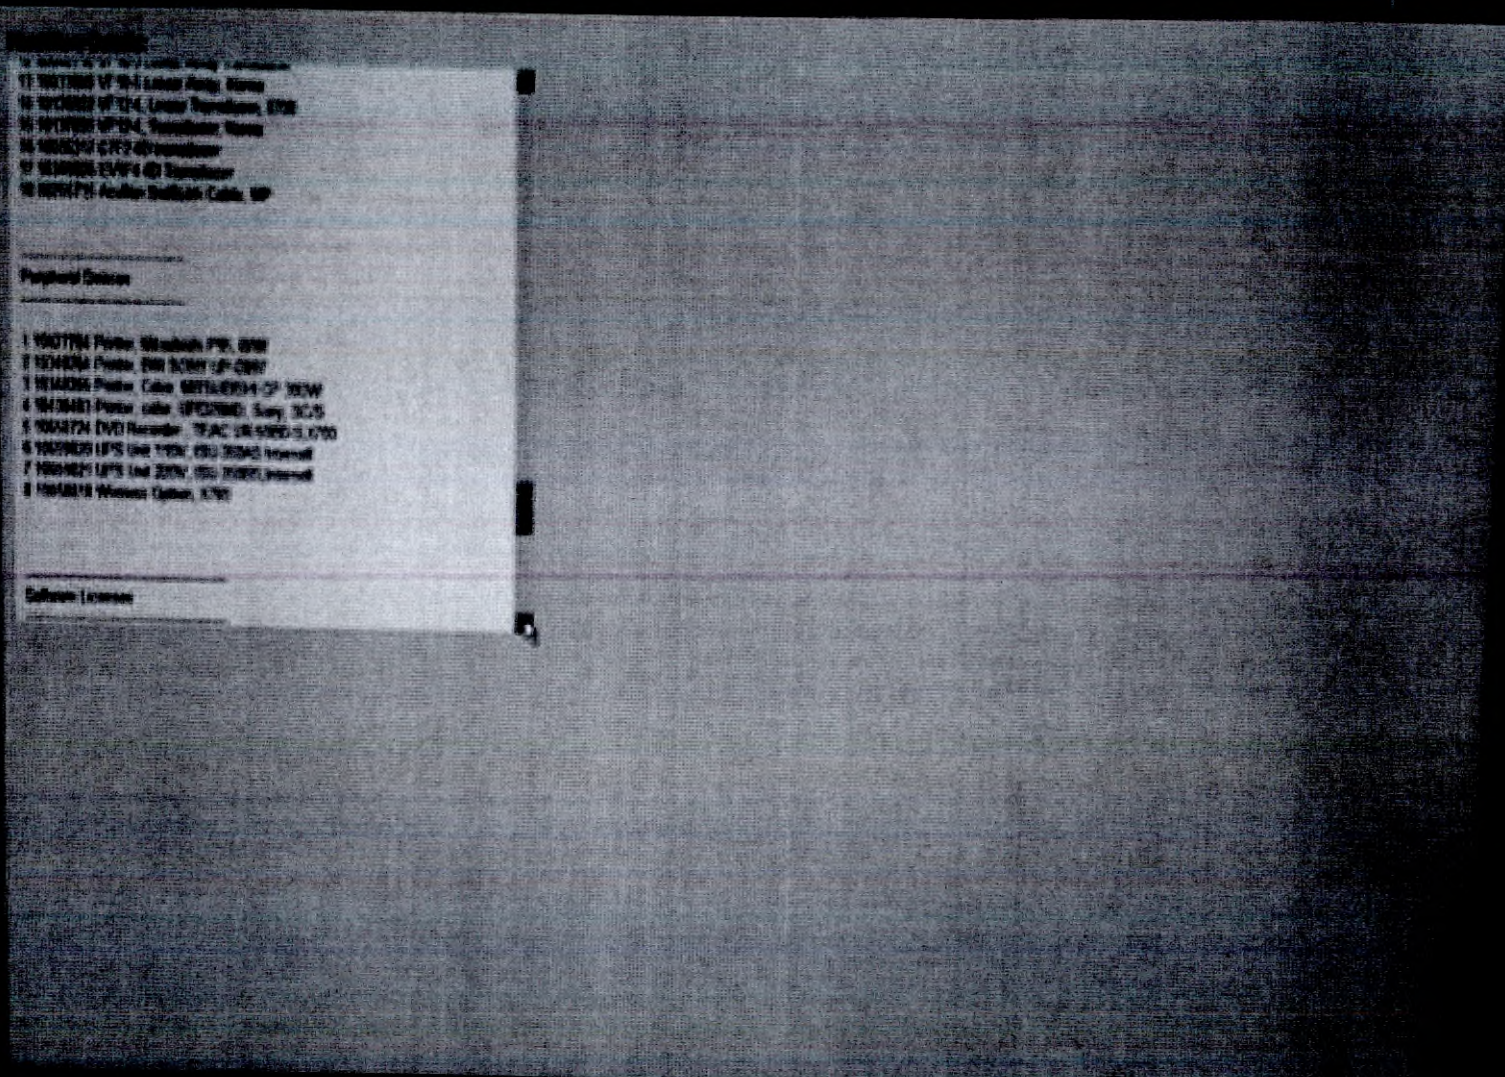

Product Details

- 11 10011000 10011000 10011000
- 12 10011000 10011000 10011000
- 13 10011000 10011000 10011000
- 14 10011000 10011000 10011000
- 15 10011000 10011000 10011000
- 16 10011000 10011000 10011000
- 17 10011000 10011000 10011000
- 18 10011000 10011000 10011000

Software Licenses

- 1 10011000 10011000 10011000
- 2 10011000 10011000 10011000
- 3 10011000 10011000 10011000
- 4 10011000 10011000 10011000
- 5 10011000 10011000 10011000
- 6 10011000 10011000 10011000
- 7 10011000 10011000 10011000
- 8 10011000 10011000 10011000

Software Licenses

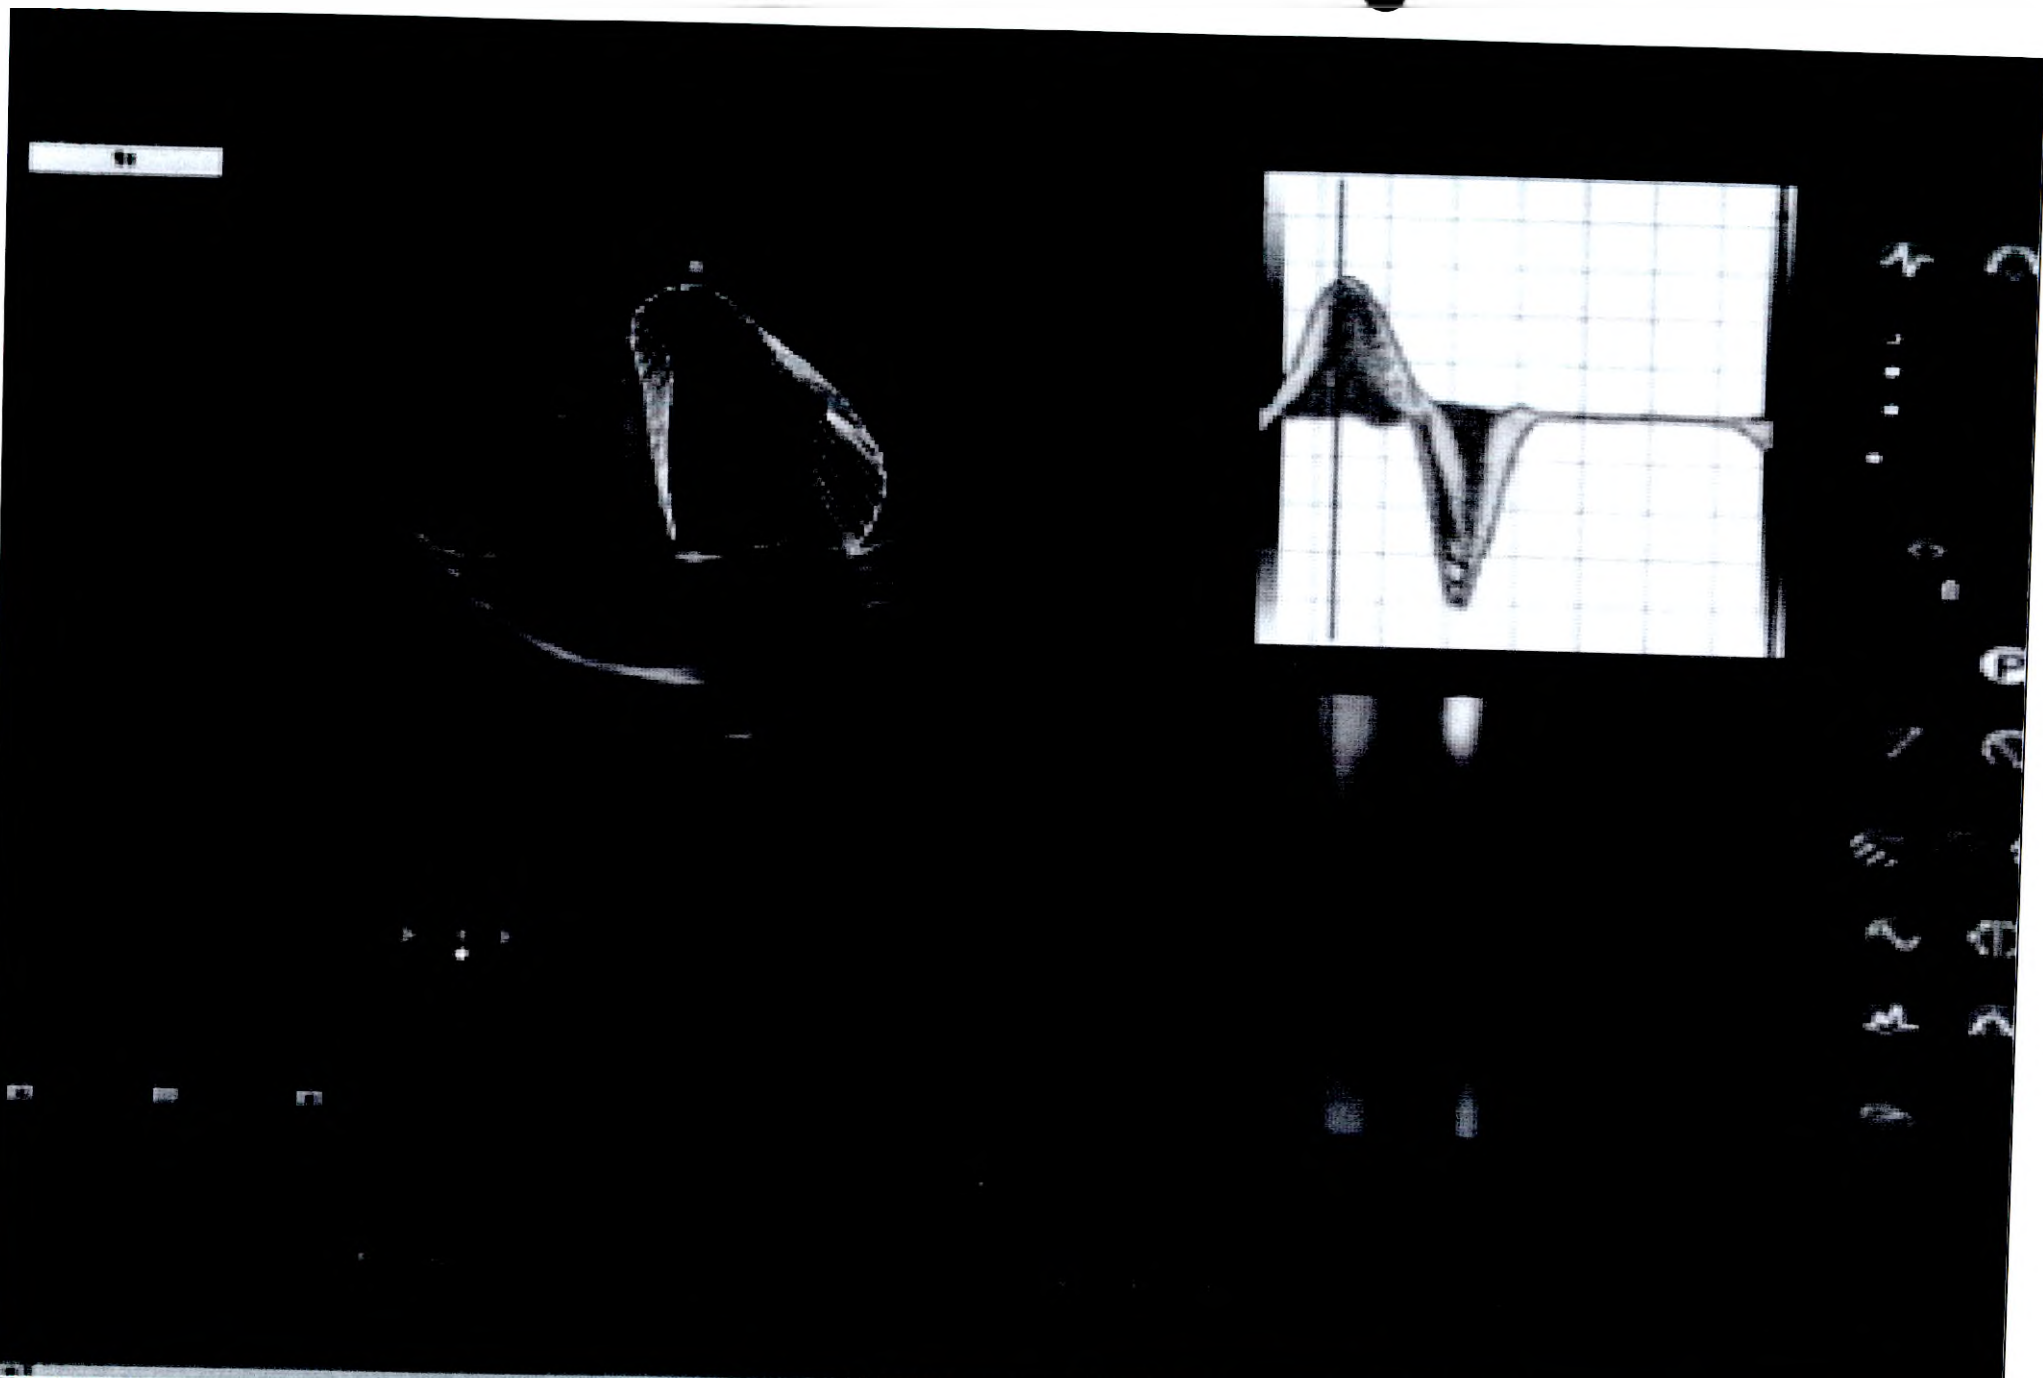


Рисунок 19. Лицензионный ключ для физиологического модуля с функцией ЭКГ (Physio Module) на оптическом и/или электронном носителе.

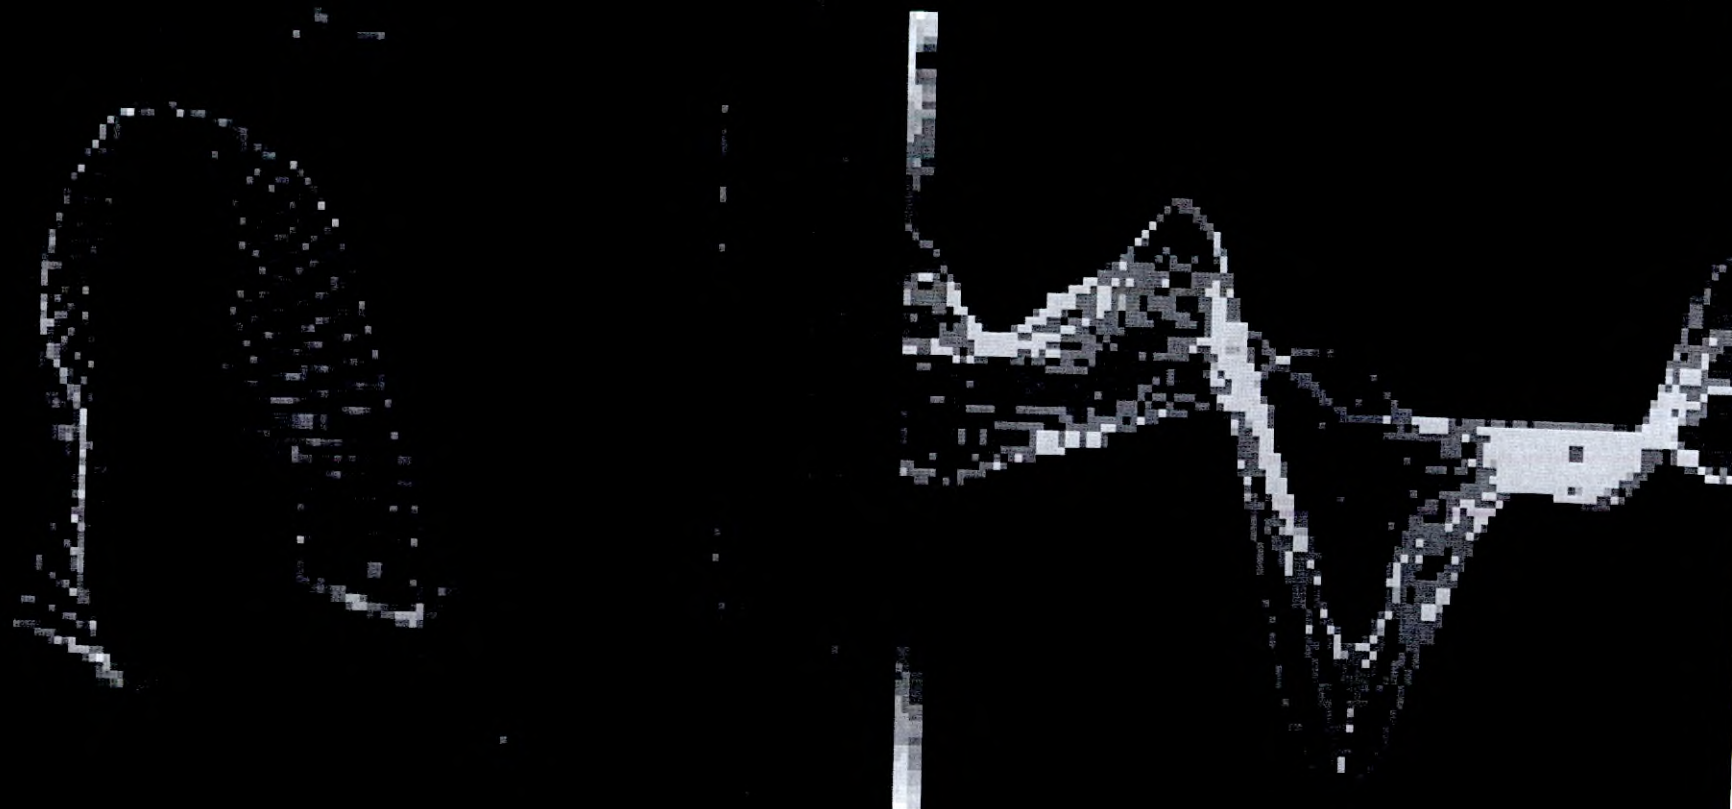


Рисунок 20. Лицензионный ключ для технологии автоматического анализа миокарда (VVI) на оптическом и/или электронном носителе.

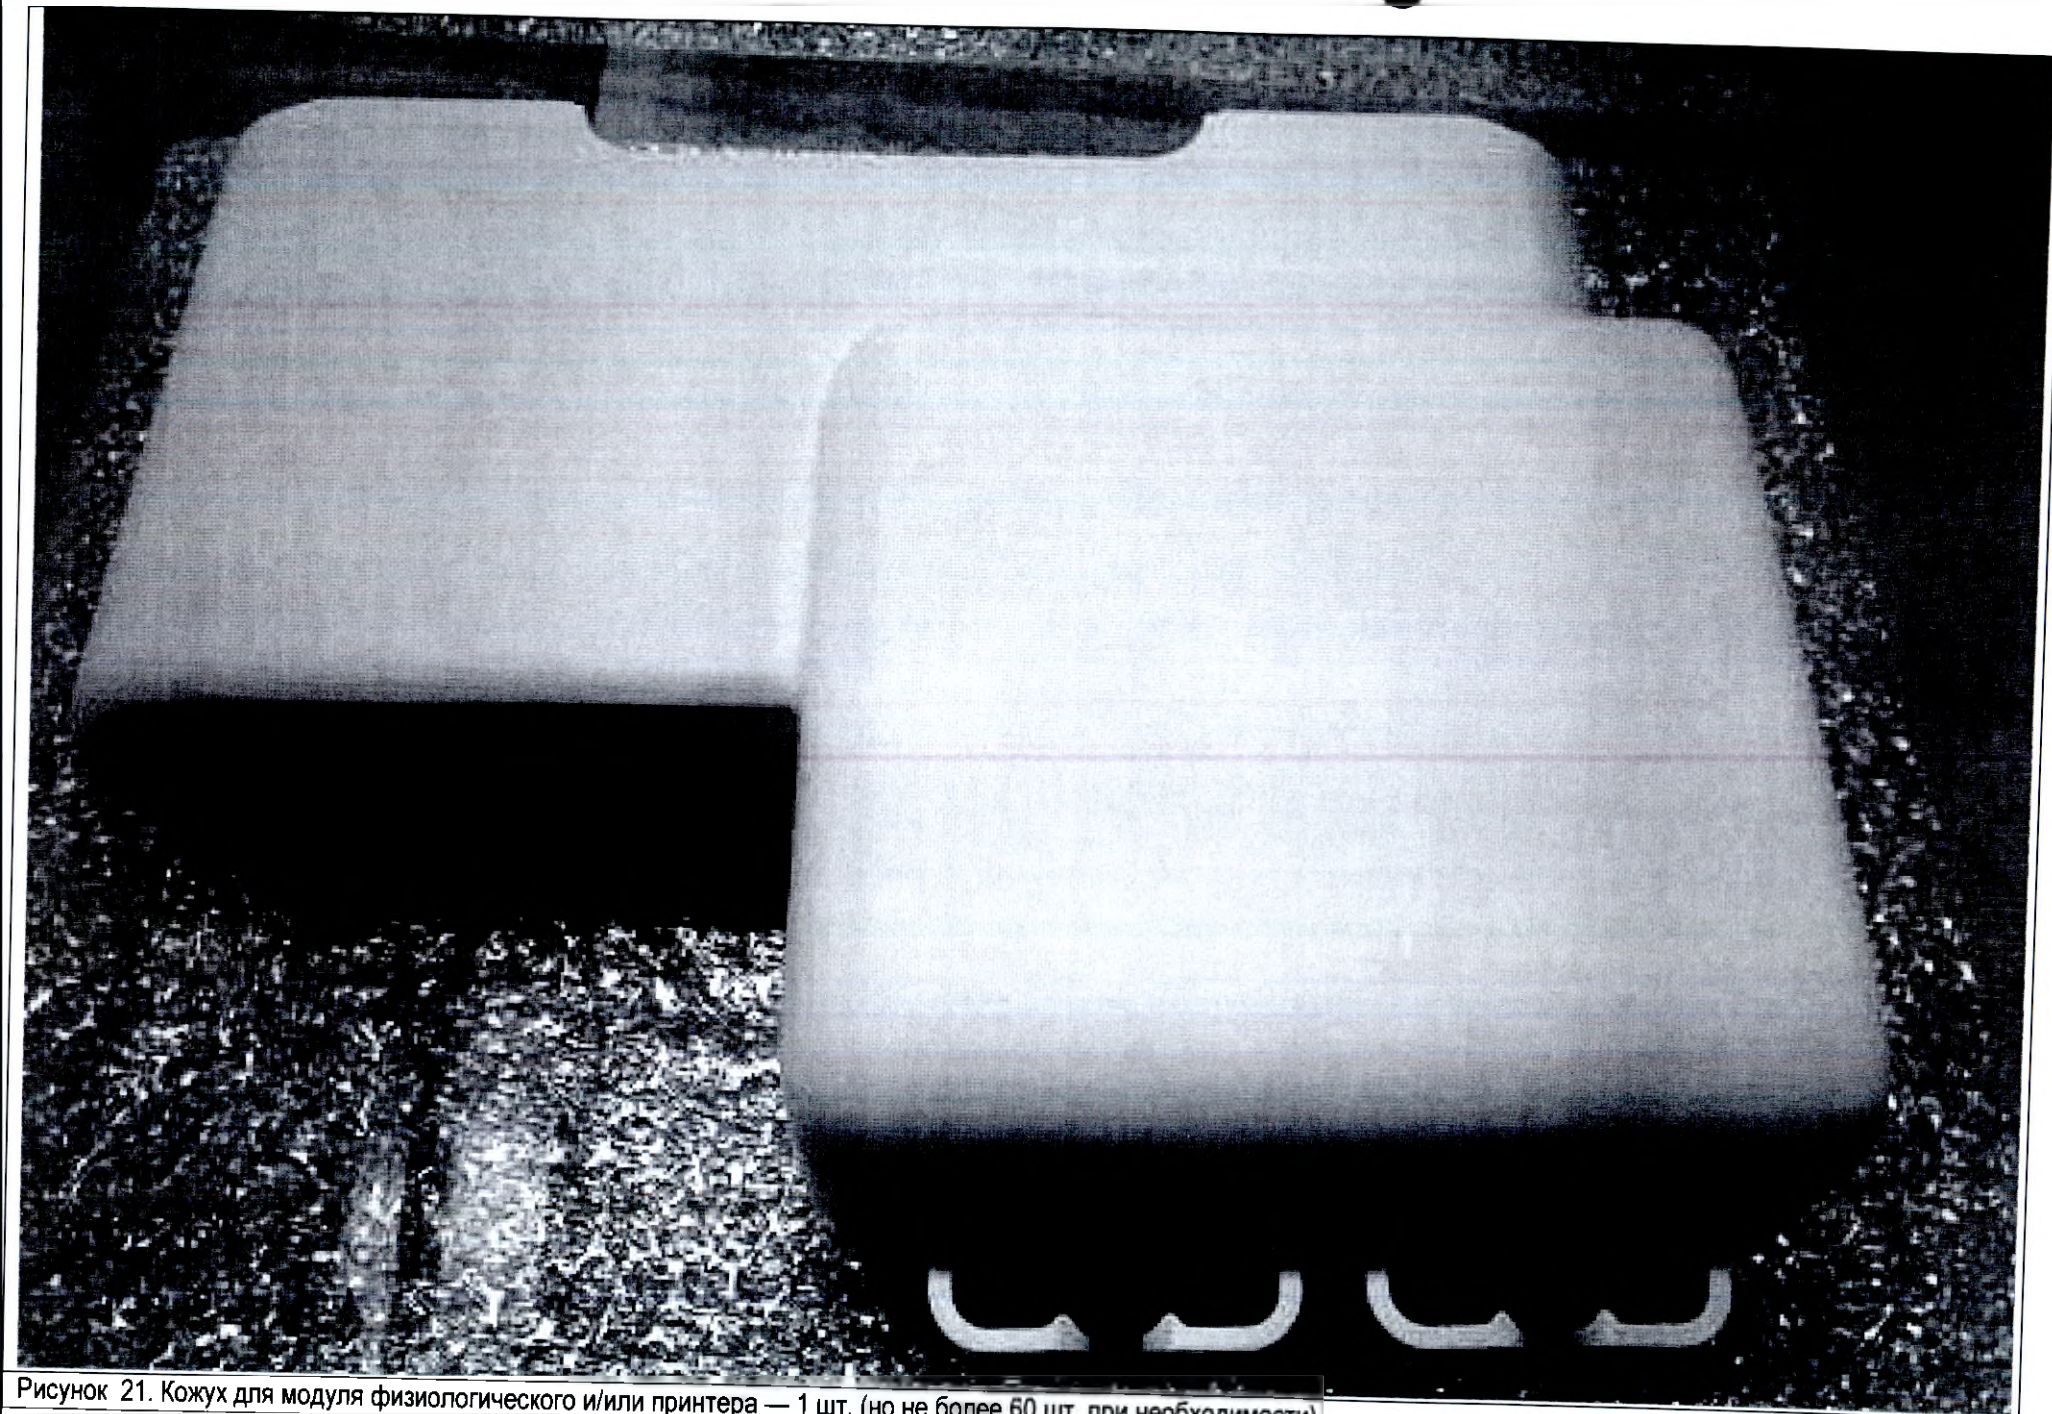


Рисунок 21. Кожух для модуля физиологического и/или принтера — 1 шт. (но не более 60 шт. при необходимости).



Рисунок 22. Лицензионный ключ для технологии стресс-эхокардиографии (Stress Echo) на оптическом и/или электронном носителе.



Рисунок 24. Лицензионный ключ для активации анатомического М-режима для визуализации сердца (Anatomical M-mode) на оптическом и/или электронном носителе

P4.2  
Card ac  
0 dB  
2.2 MHz  
977 Hz  
Filter 1  
Persistence  
R/S 1  
Map 0  
Priority 1  
Smooth 2  
Flow M  
11 fps  
STCE Low

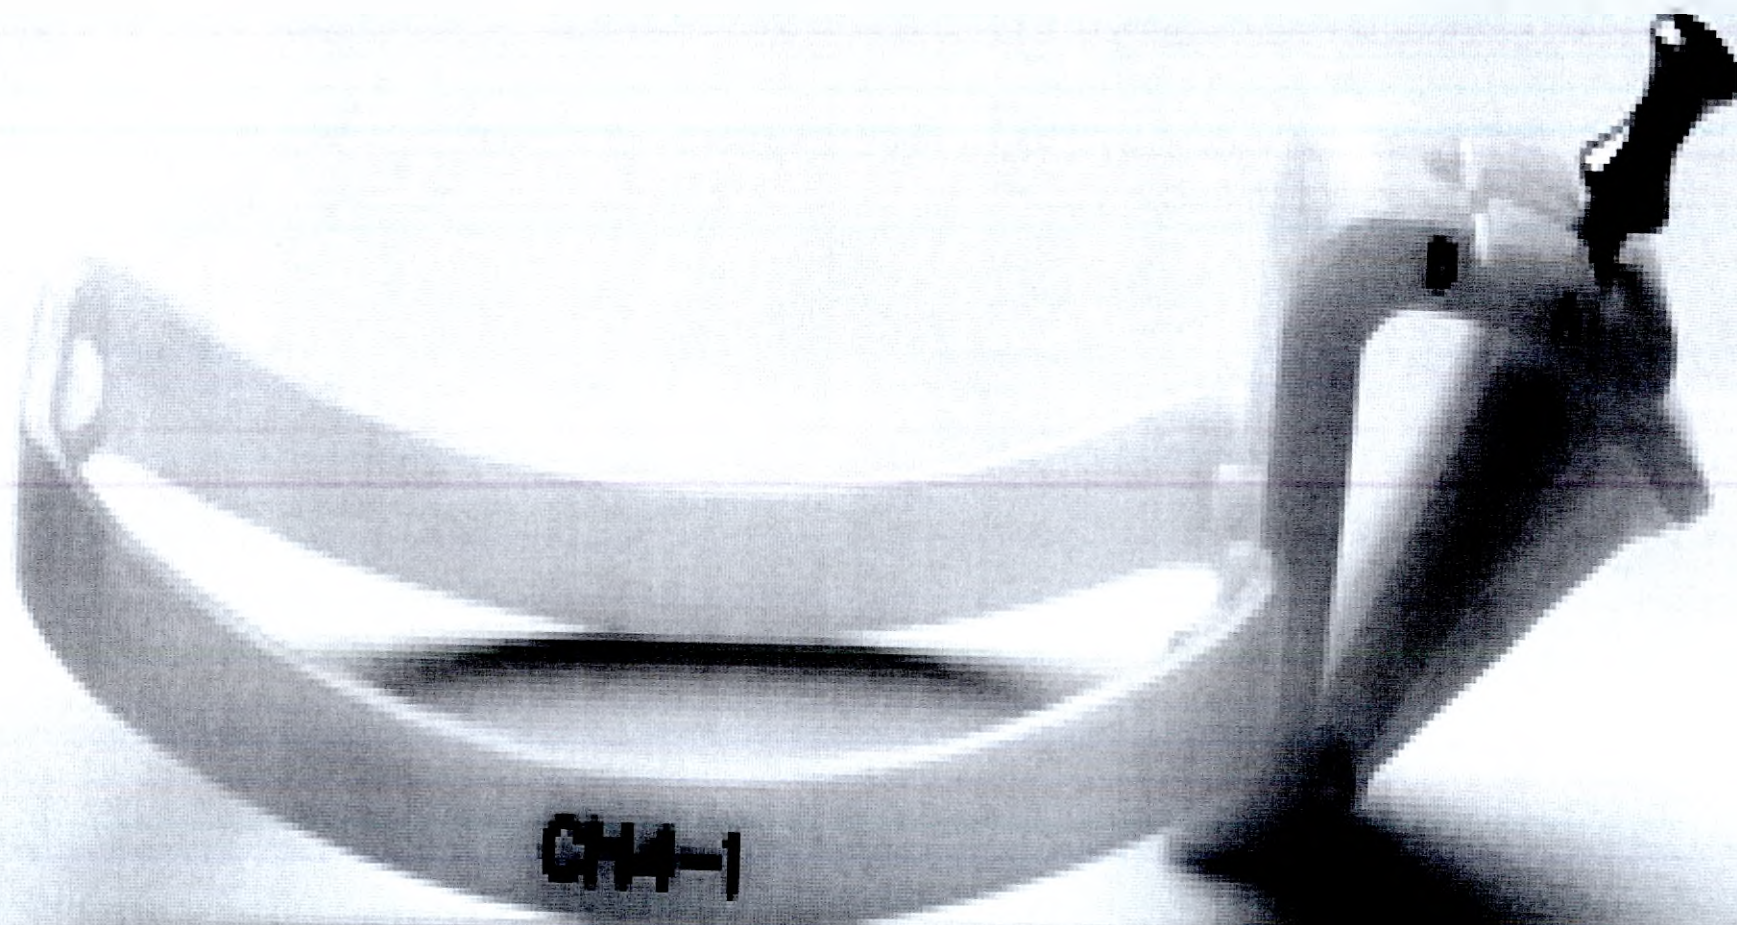


Рисунок 26. Адаптер иглопроводника к датчику CH5-2 — 1 шт. (но не более 50 шт. при необходимости).

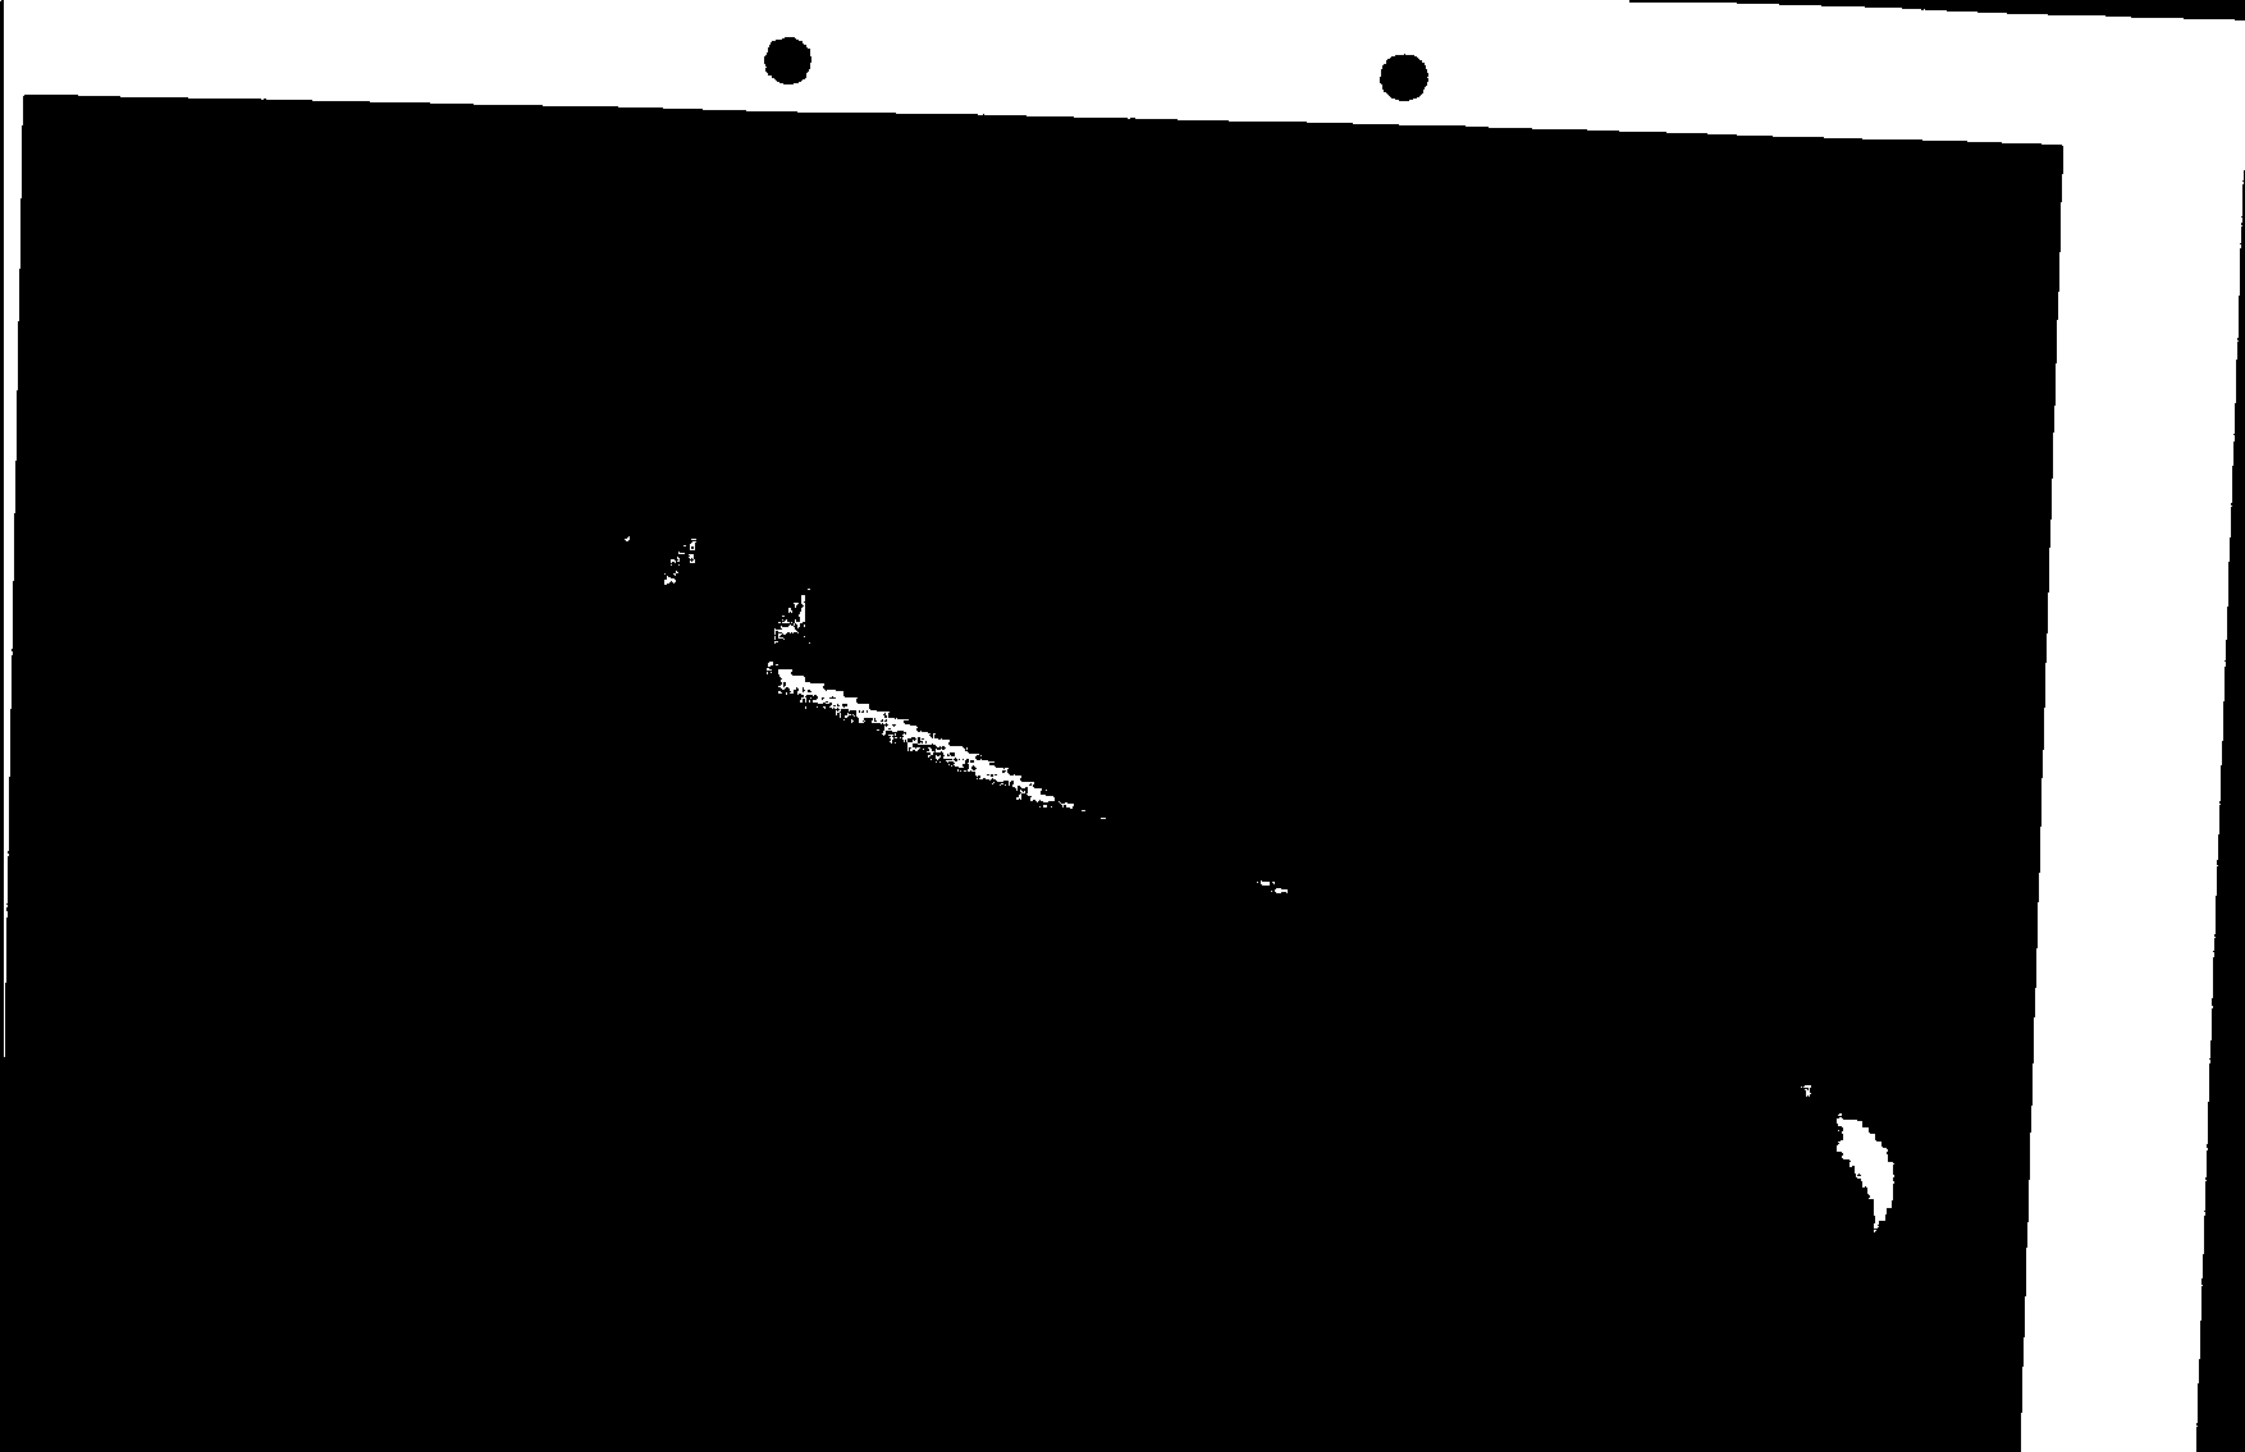


Рисунок 27. Адаптер иглопроводника, многоцветный, к датчику ЕС9-4 — 1 шт. (но не более 50 шт. при необходимости).

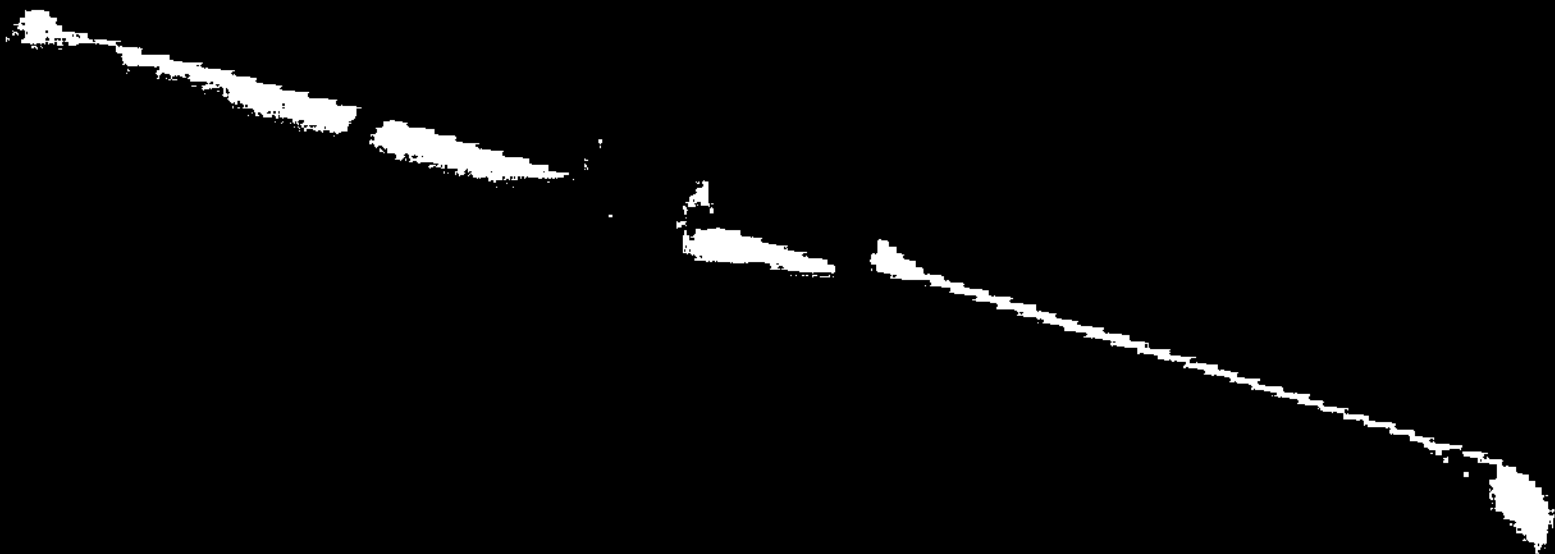


Рисунок 28. Адаптер иглопроводника, одноосевый, к датчику ЕС9-4 — 1 шт. (но не более 50 шт. при необходимости).



Рисунок 29. Адаптер иглопроводника к датчику VF12-4 — 1 шт. (но не более 50 шт. при необходимости).


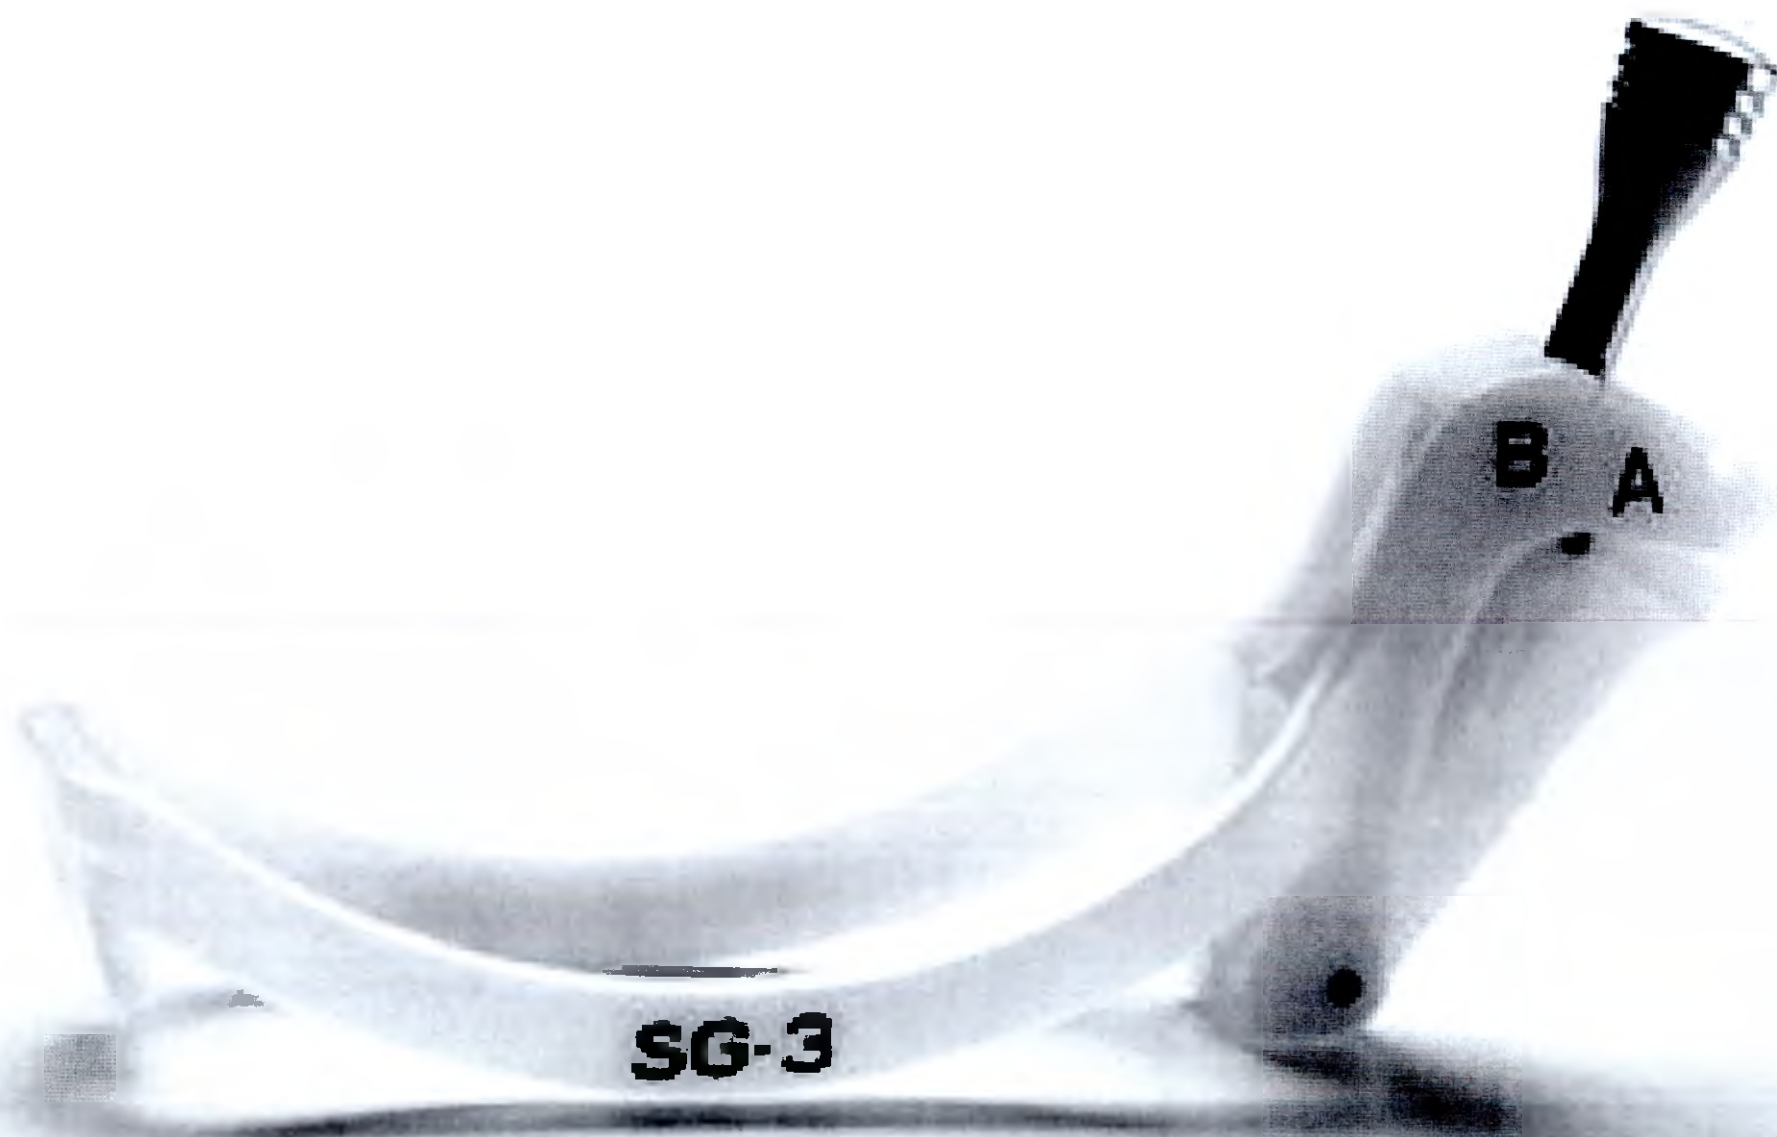


Рисунок 30. Адаптер иглопроводника к датчику 11L4 — 1 шт. (но не более 50 шт. при необходимости).

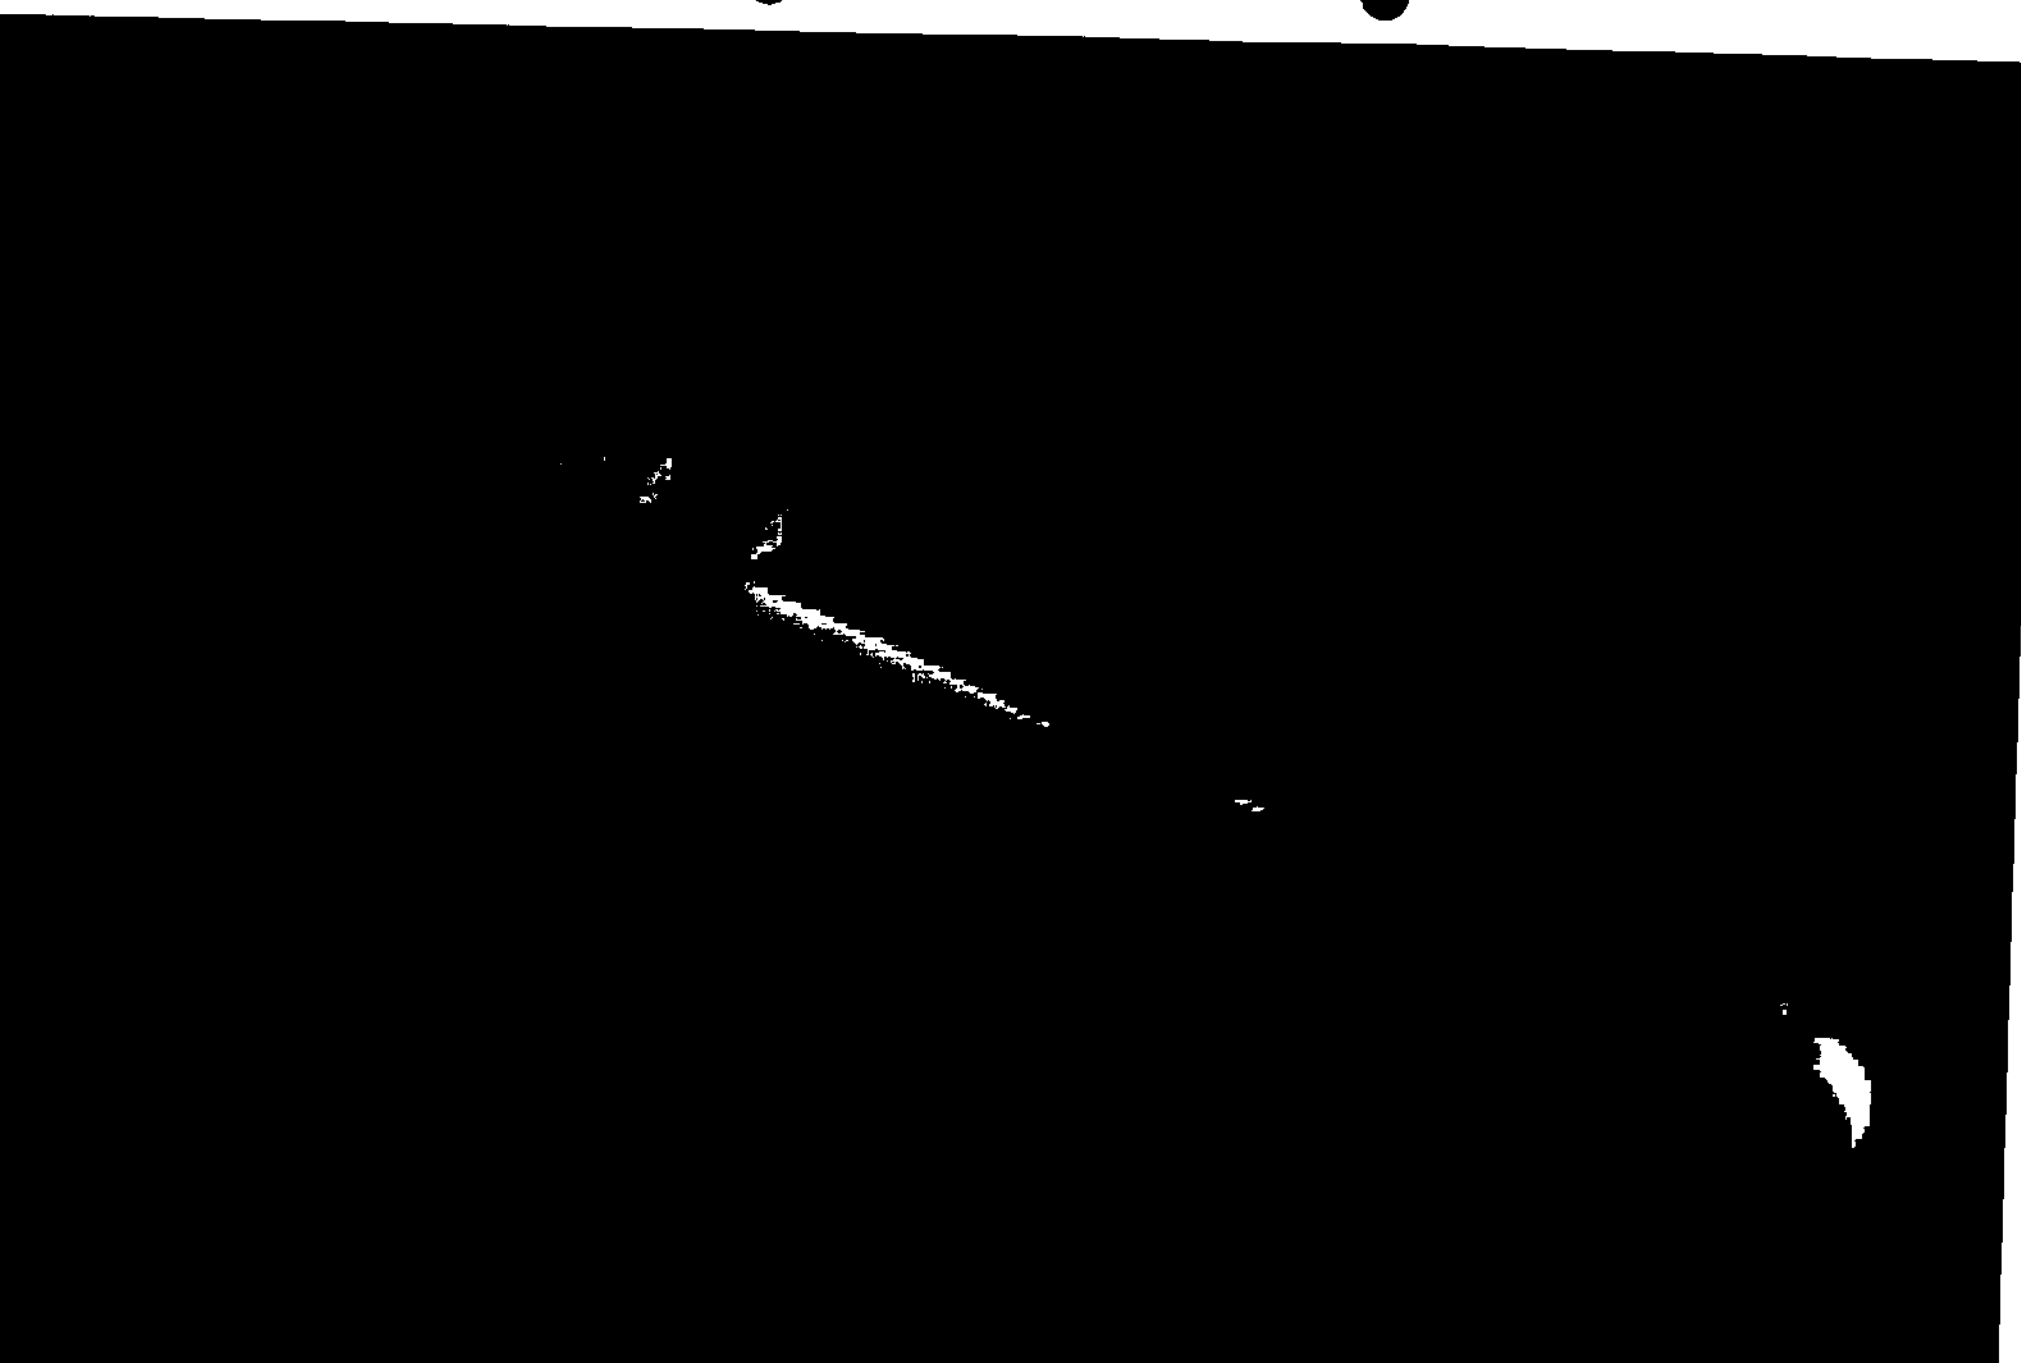

31. Адаптер иглопроводника, многоцветный, к датчику 10МС3 — 1 шт. (но не более 50 шт. при необходимости).

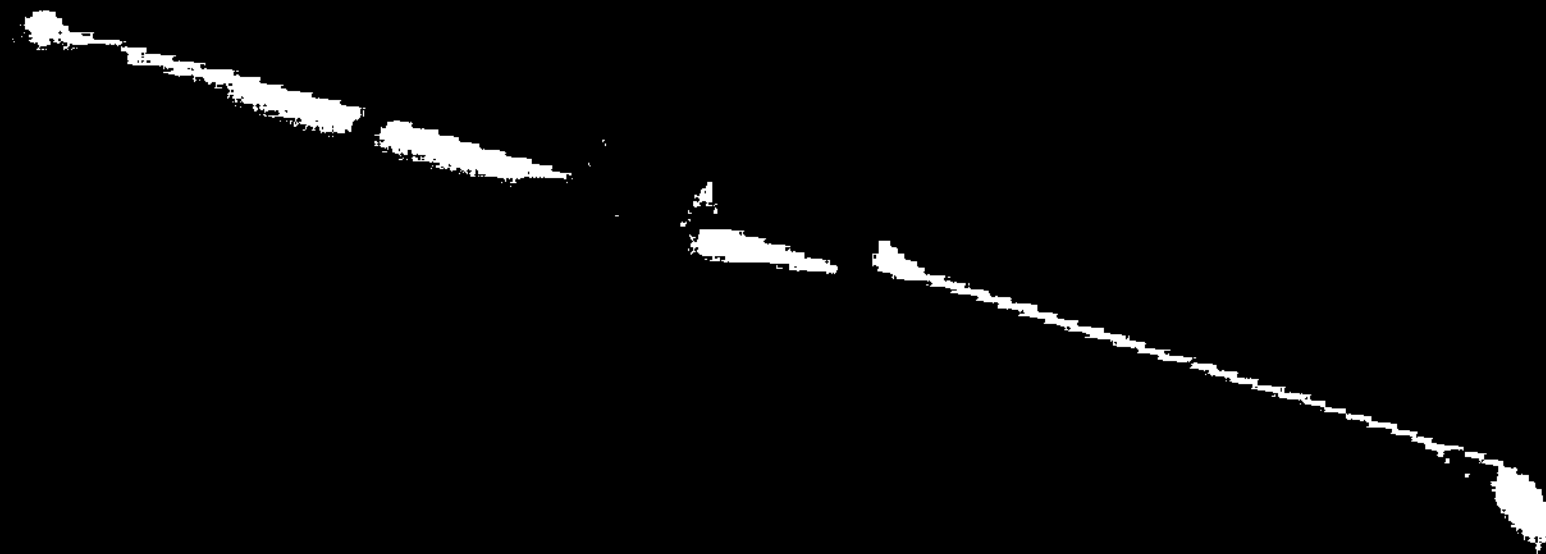


Рисунок 32. Адаптер иглопроводника, одноразовый, к датчику 10МС3 — 1 шт. (но не более 50 шт. при необходимости).

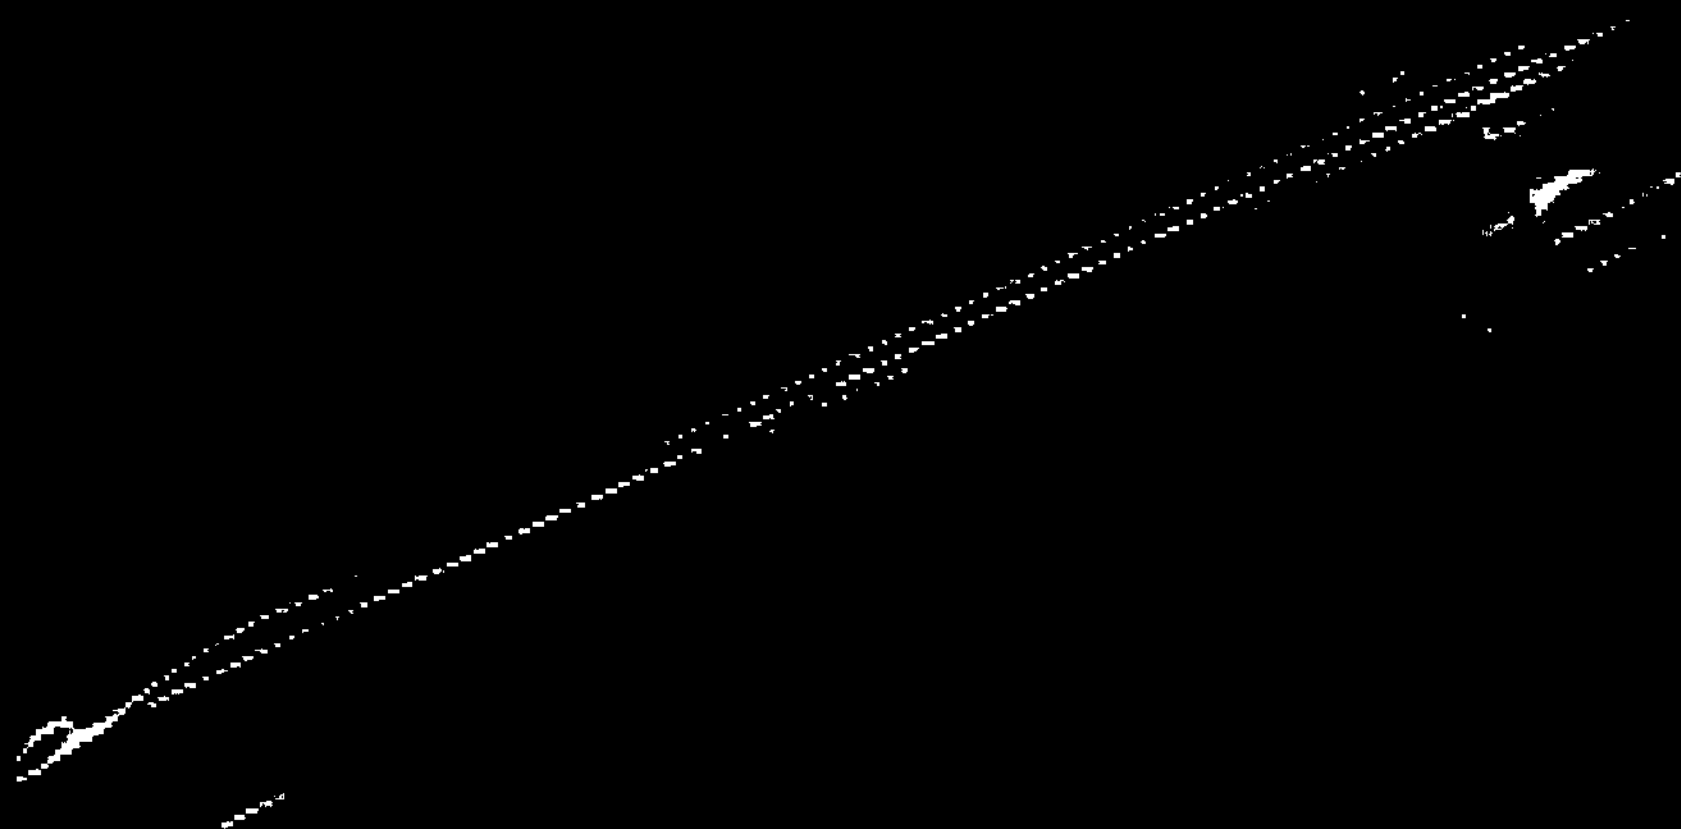


Рисунок 33 Аппарат управления микропроцессорный, к датчику ВР10-3 — 1 шт. (но не более 50 шт. при необходимости).

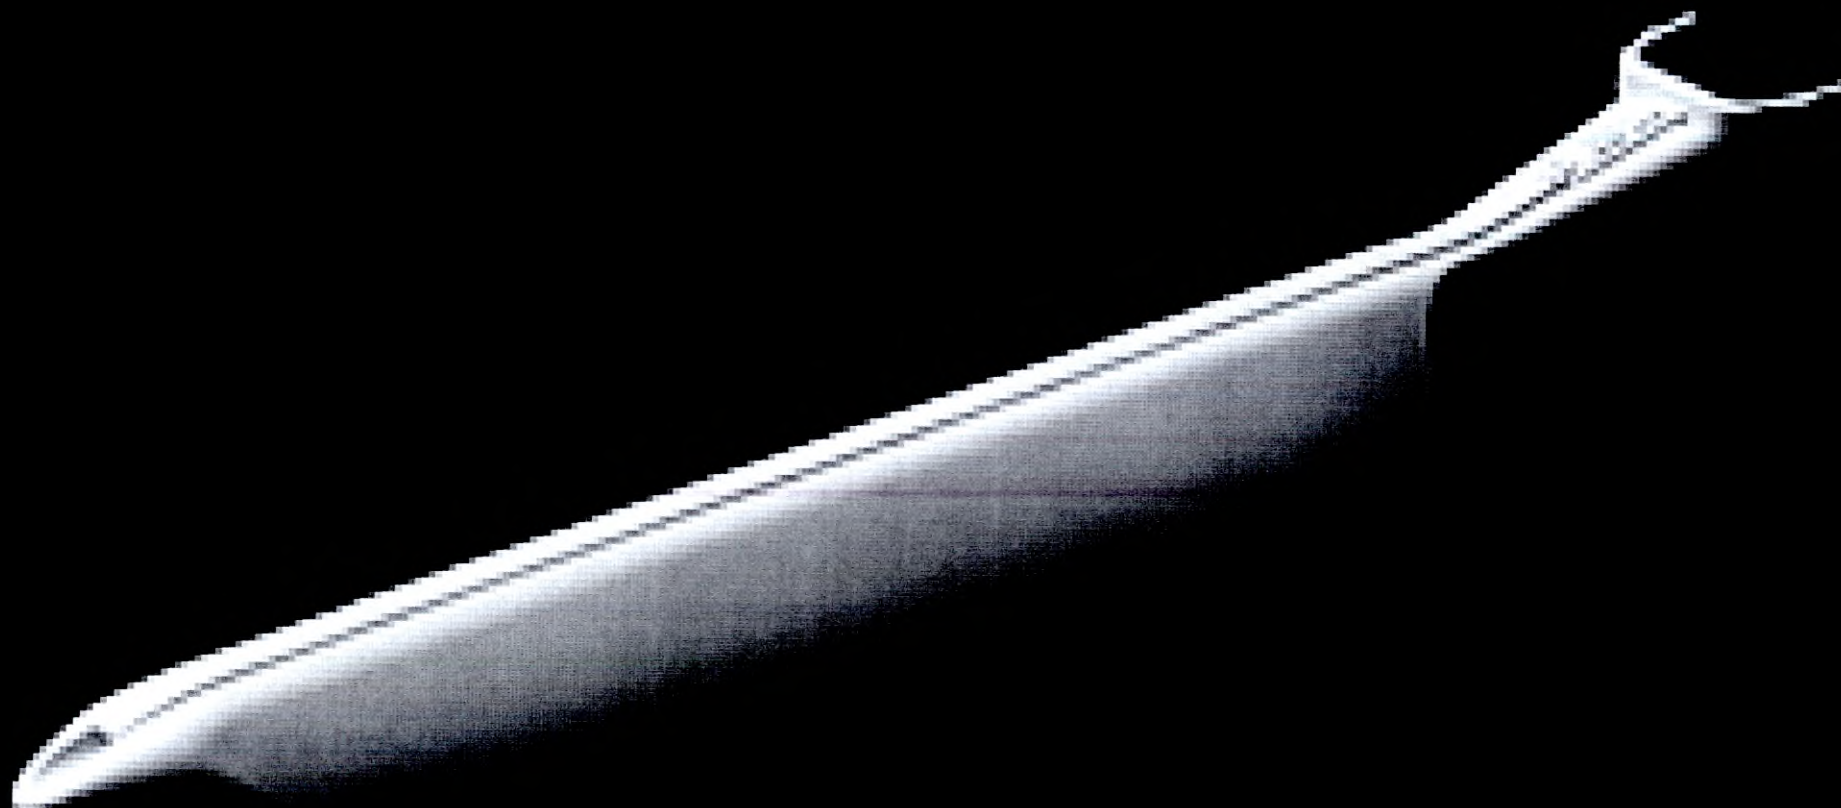




Рисунок 35. Защитные оболочки, стерильные, для датчиков — 1 шт. (но не более 500 шт. при необходимости).

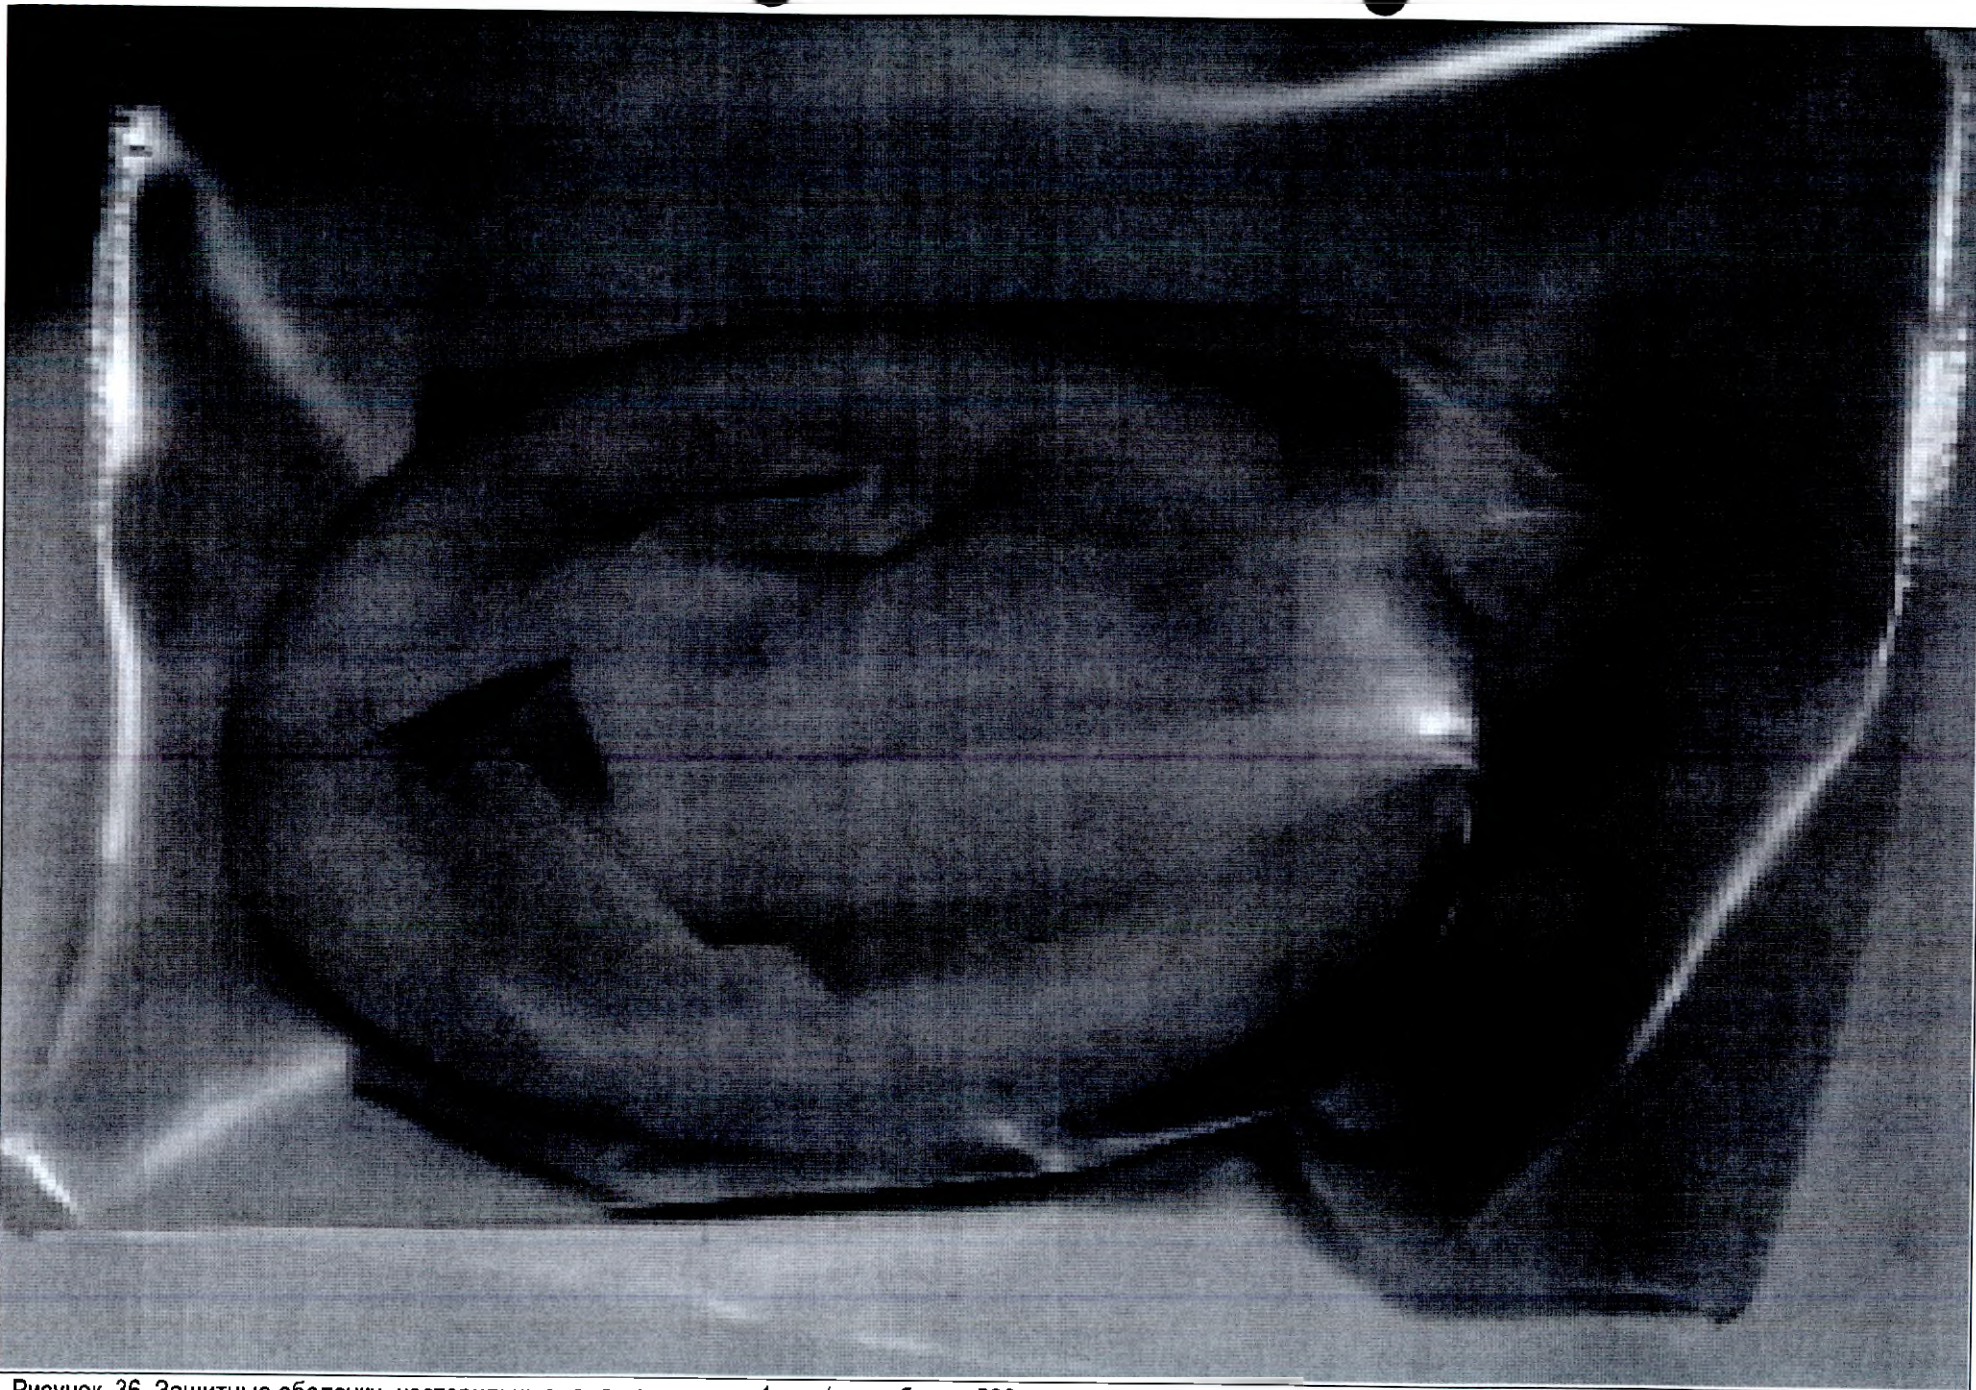


Рисунок 36. Защитные оболочки, нестерильные, для датчиков — 1 шт. (но не более 500 шт. при необходимости).

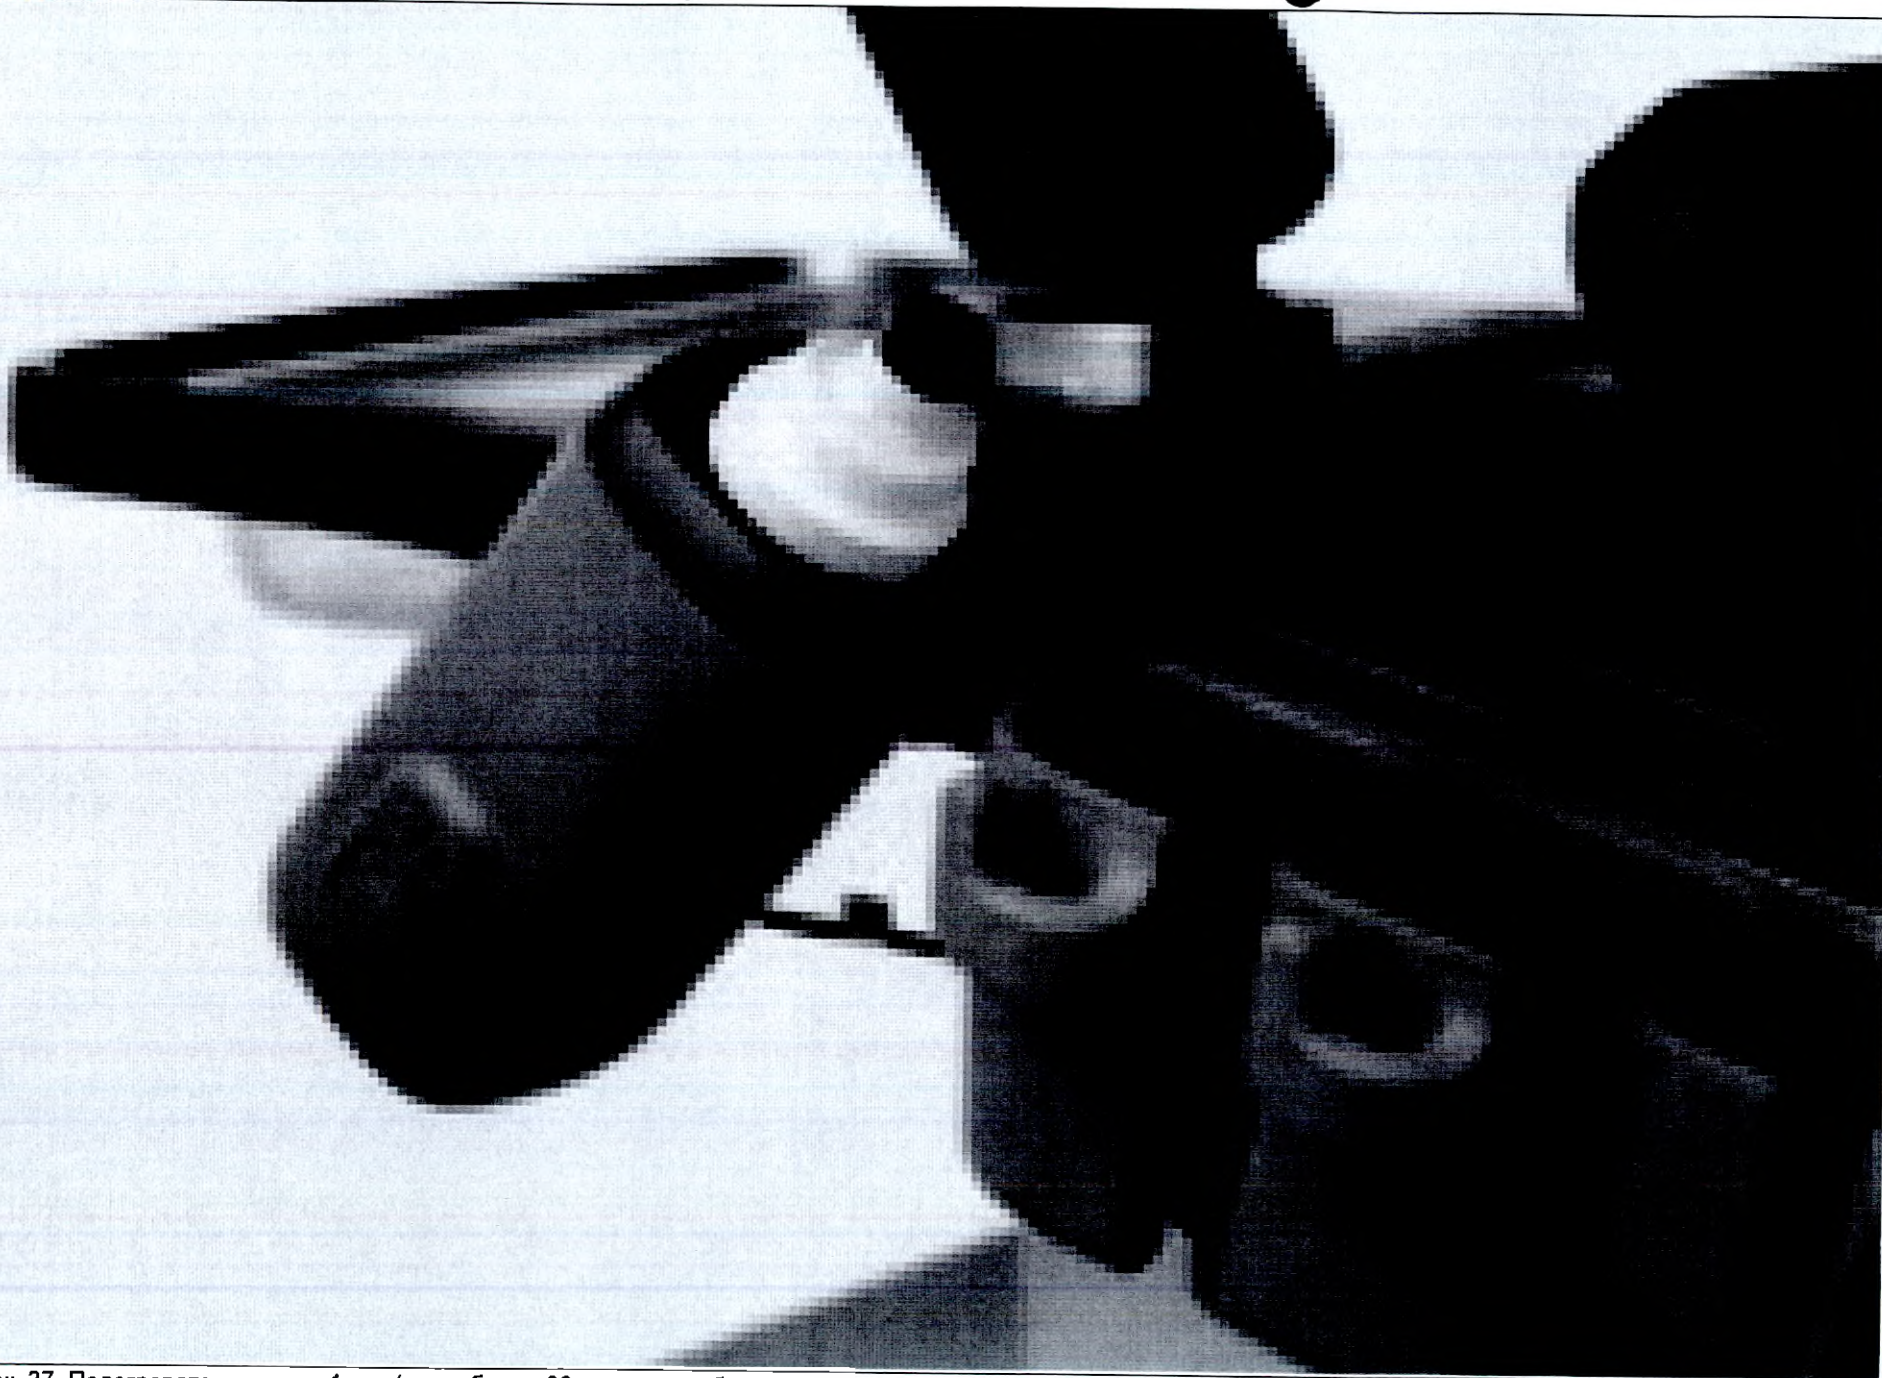


Рисунок 37. Подогреватель геля — 1 шт. (но не более 30 шт. при необходимости).

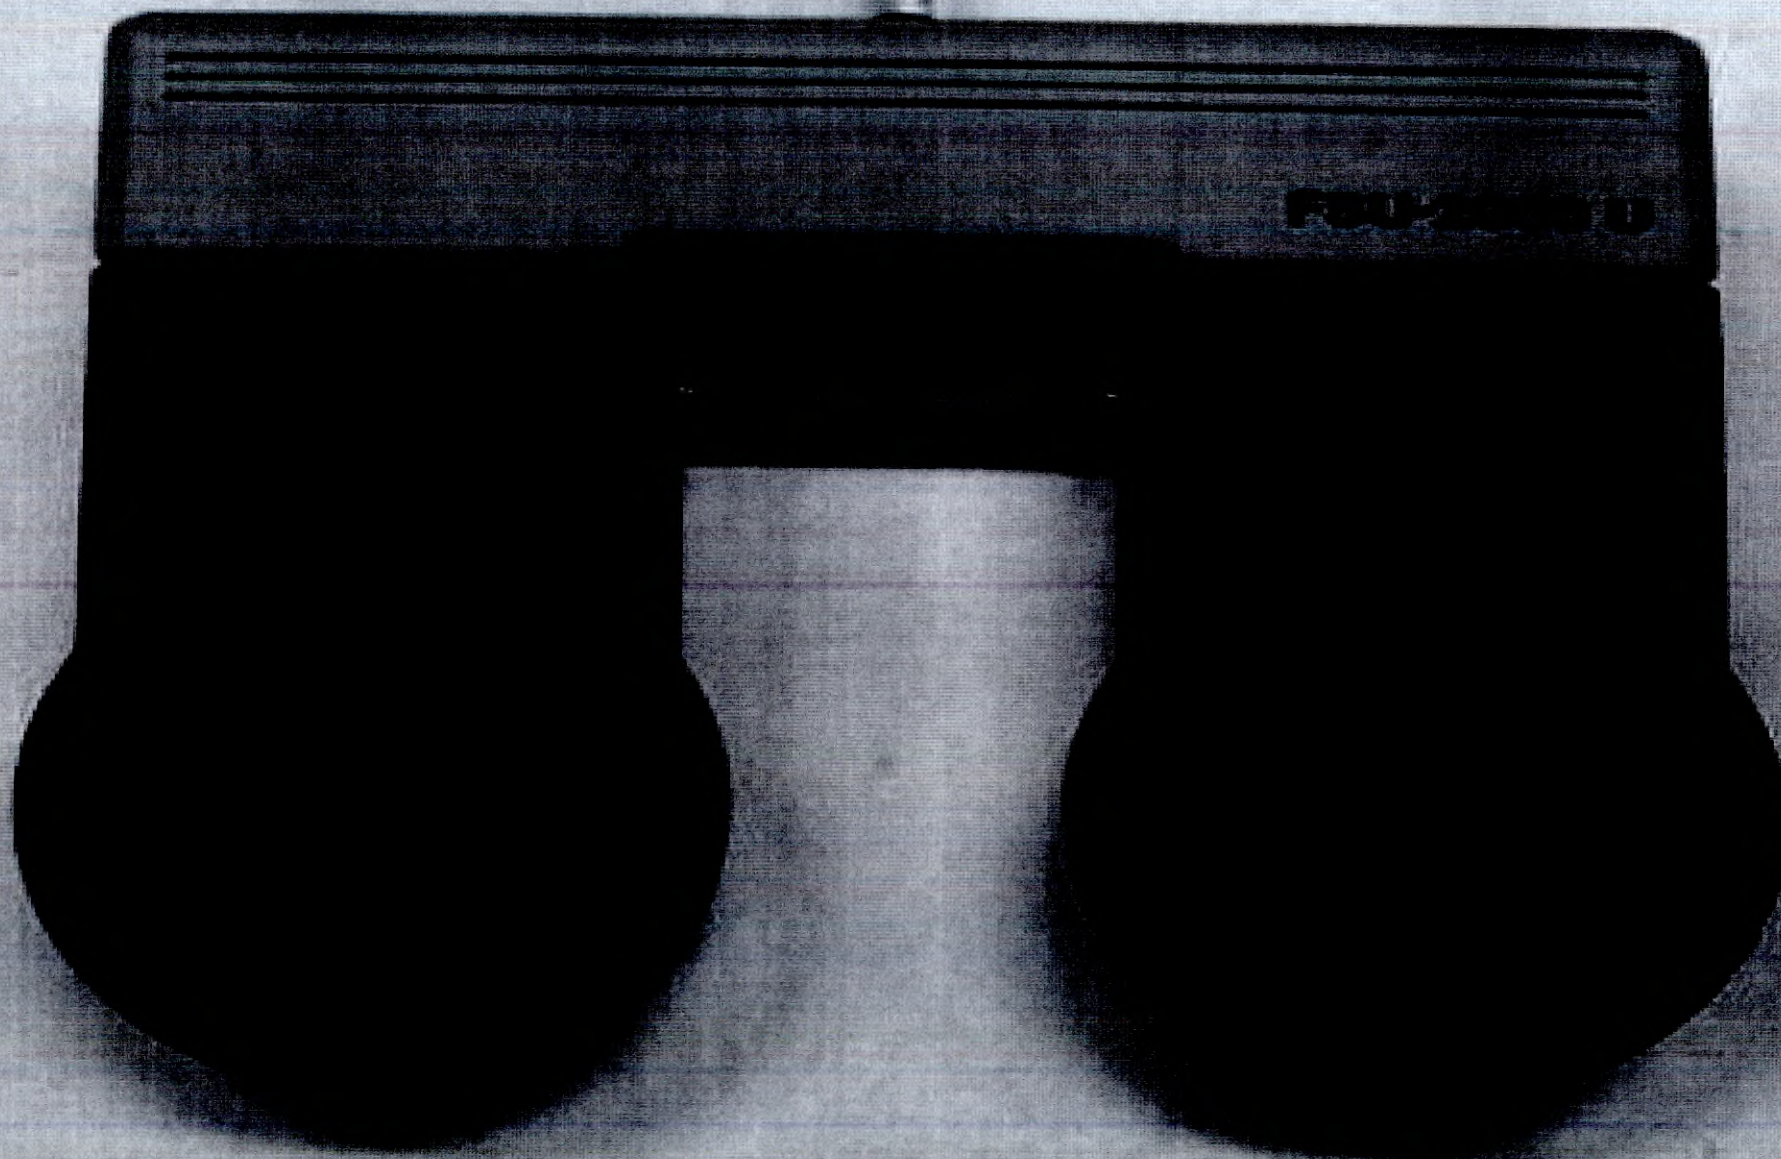


Рисунок 38. Ножной переключатель — 1 шт. (но не более 30 шт. при необходимости).

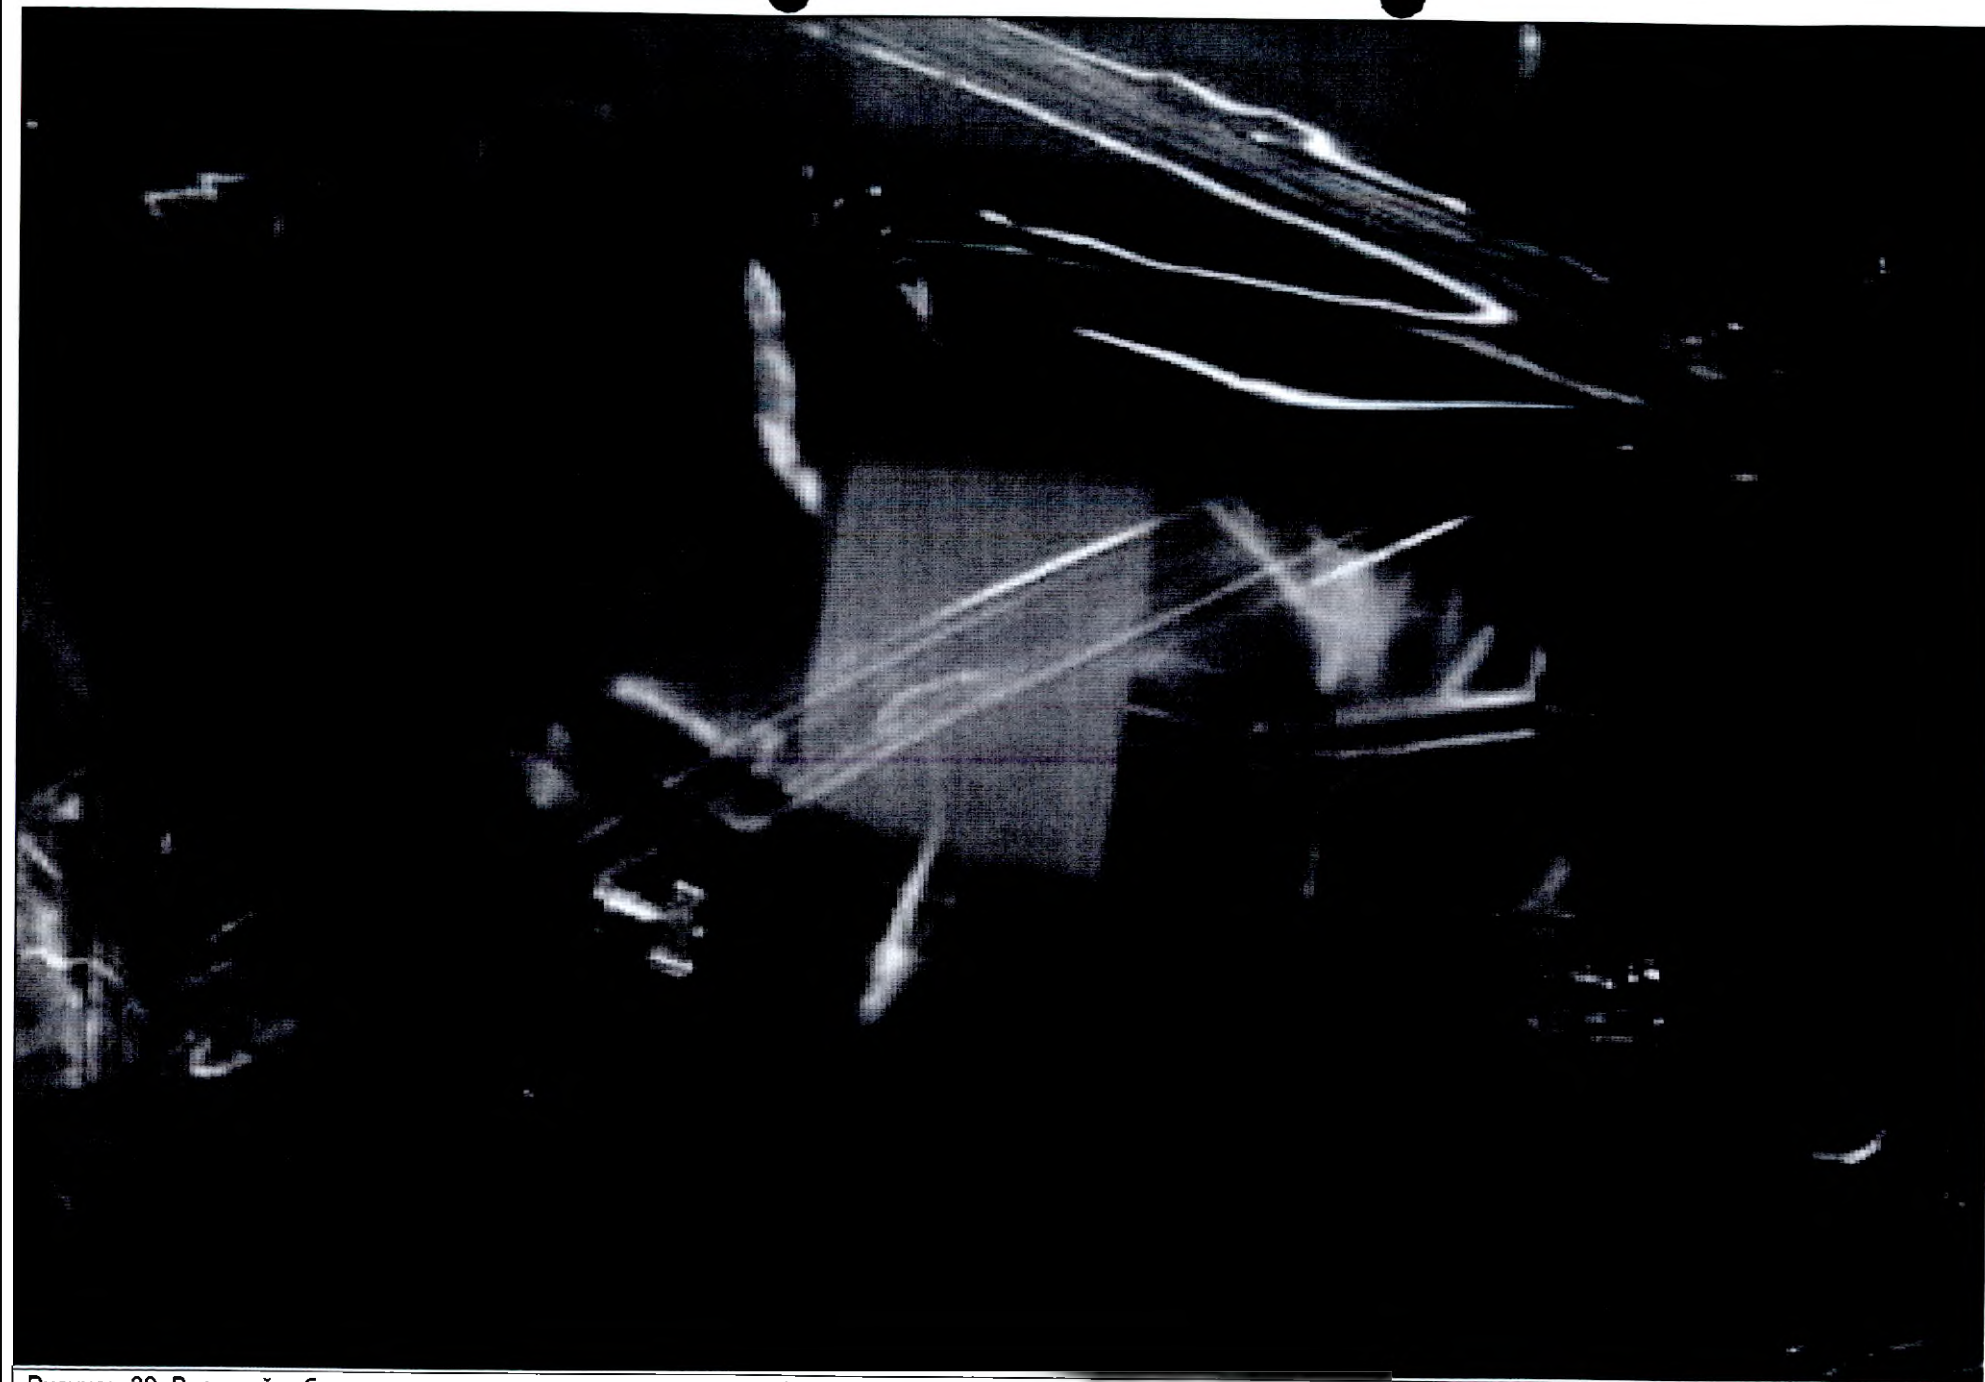


Рисунок 39. Внешний кабель — адаптер для стресс-эхокардиографии — 1 шт. (но не более 60 шт. при необходимости).



Рисунок 40. Черно-белый принтер — 1 шт. (но не более 30 шт. при необходимости).



Рисунок 41. Цветной принтер — 1 шт. (но не более 30 шт. при необходимости).



Рисунок 42. Бумага для черно-белого принтера — 1 шт. (но не более 300 шт. при необходимости).

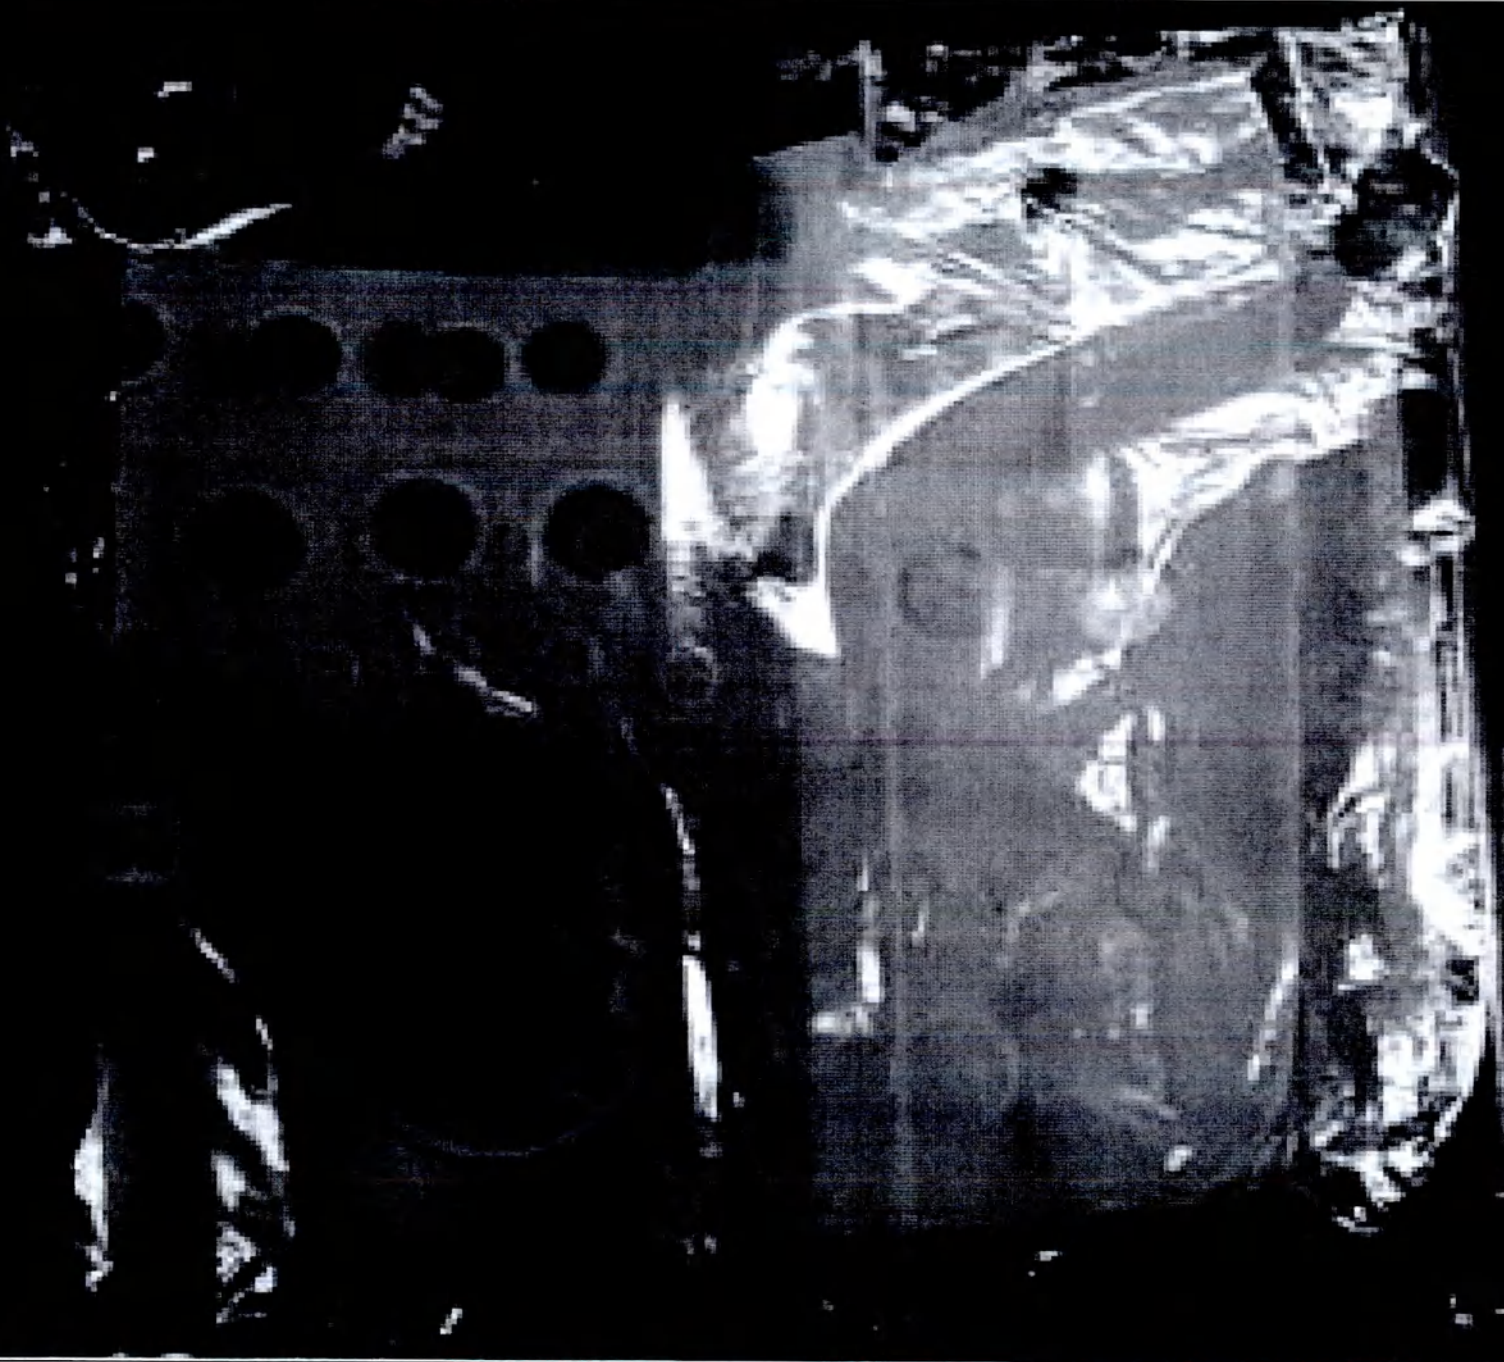


Рисунок 43. Защитная накладка для панели управления — 1 шт. (но не более 60 шт. при необходимости).



Рисунок 44. Контейнер для хранения протезов — 1 шт. (но не более 30 шт. при необходимости).

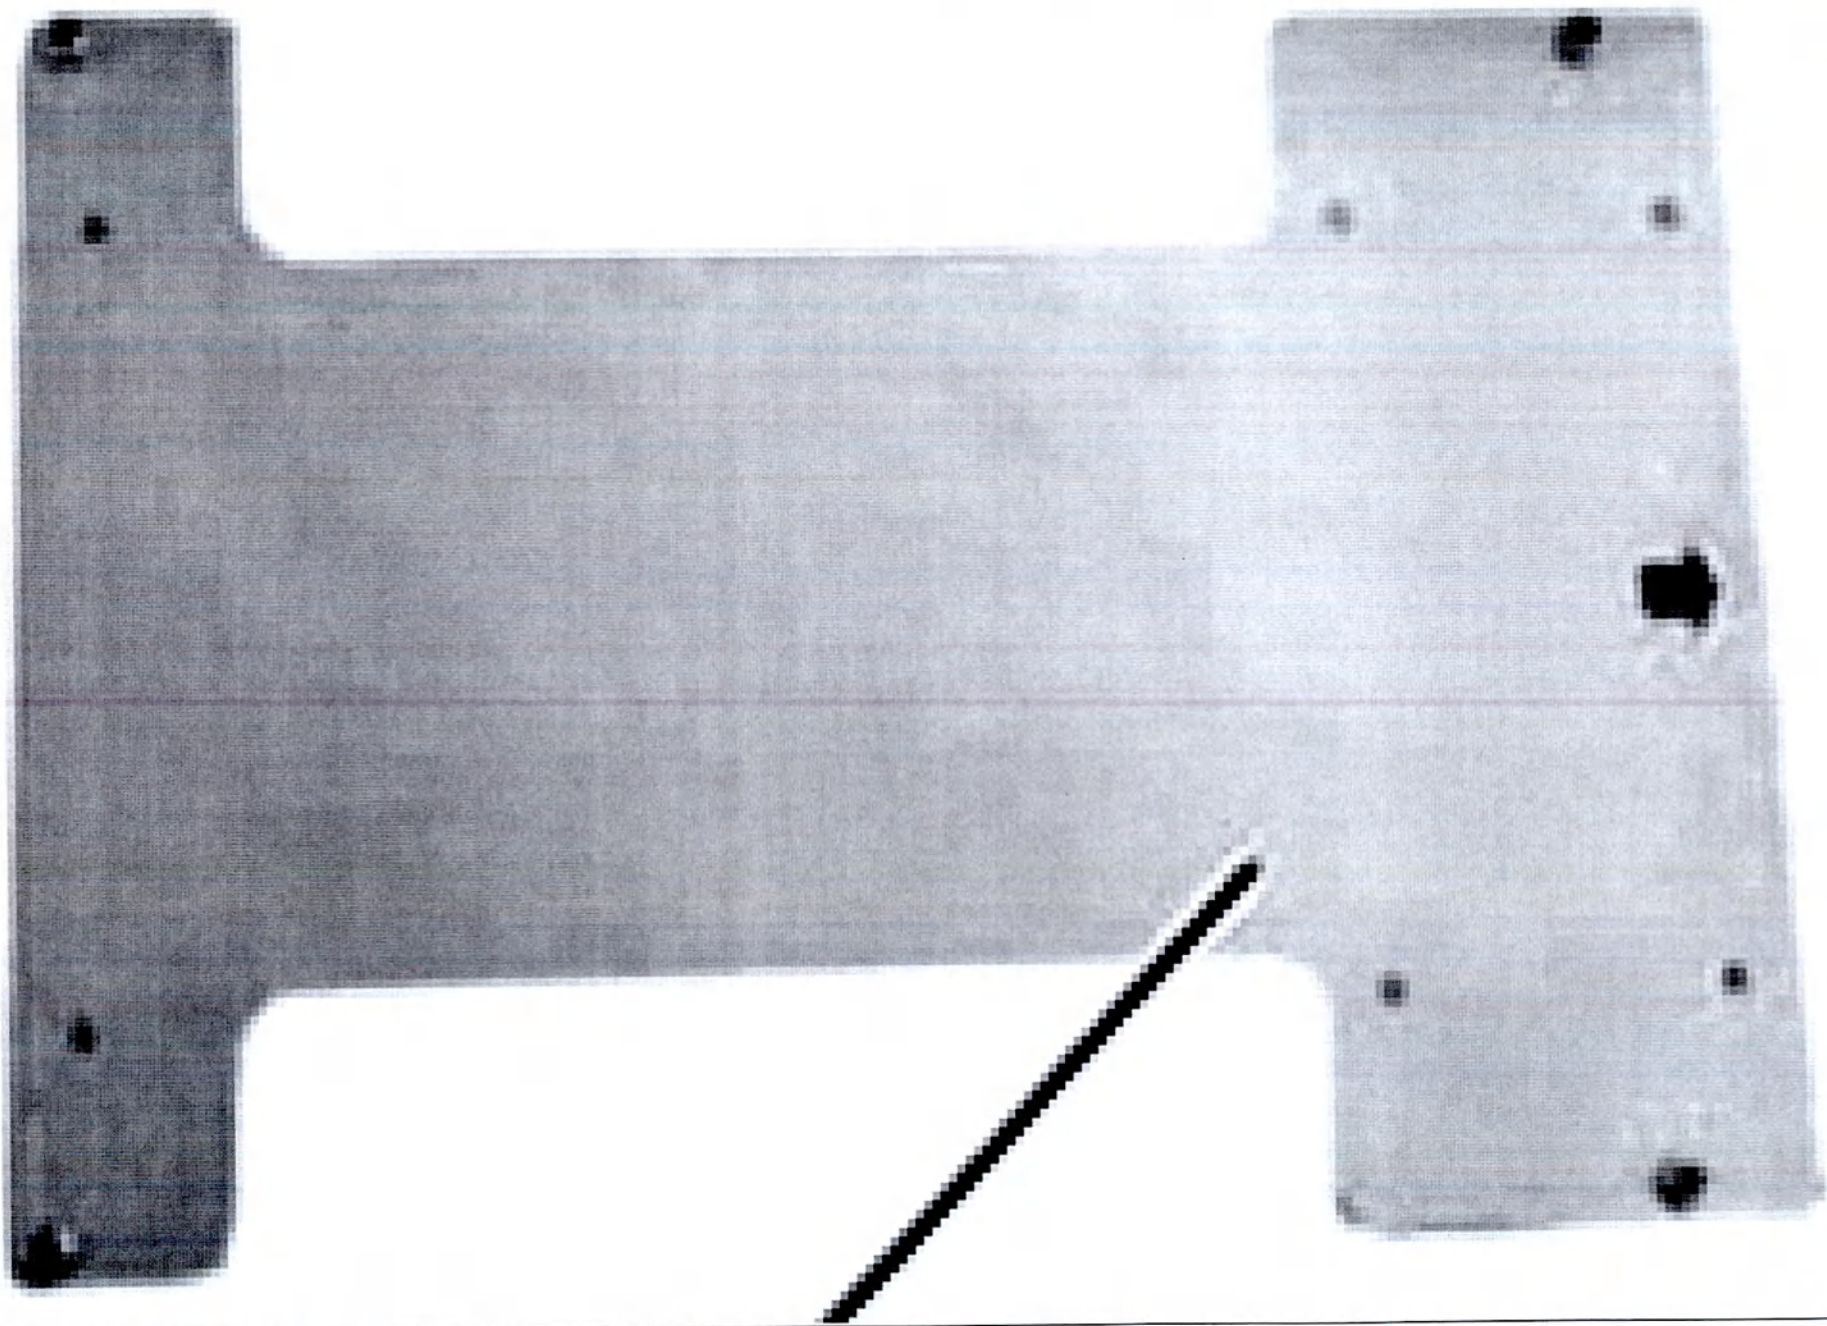


Рисунок 45 Клеппение для принтера — 1 шт. (но не более 60 шт. при необходимости).




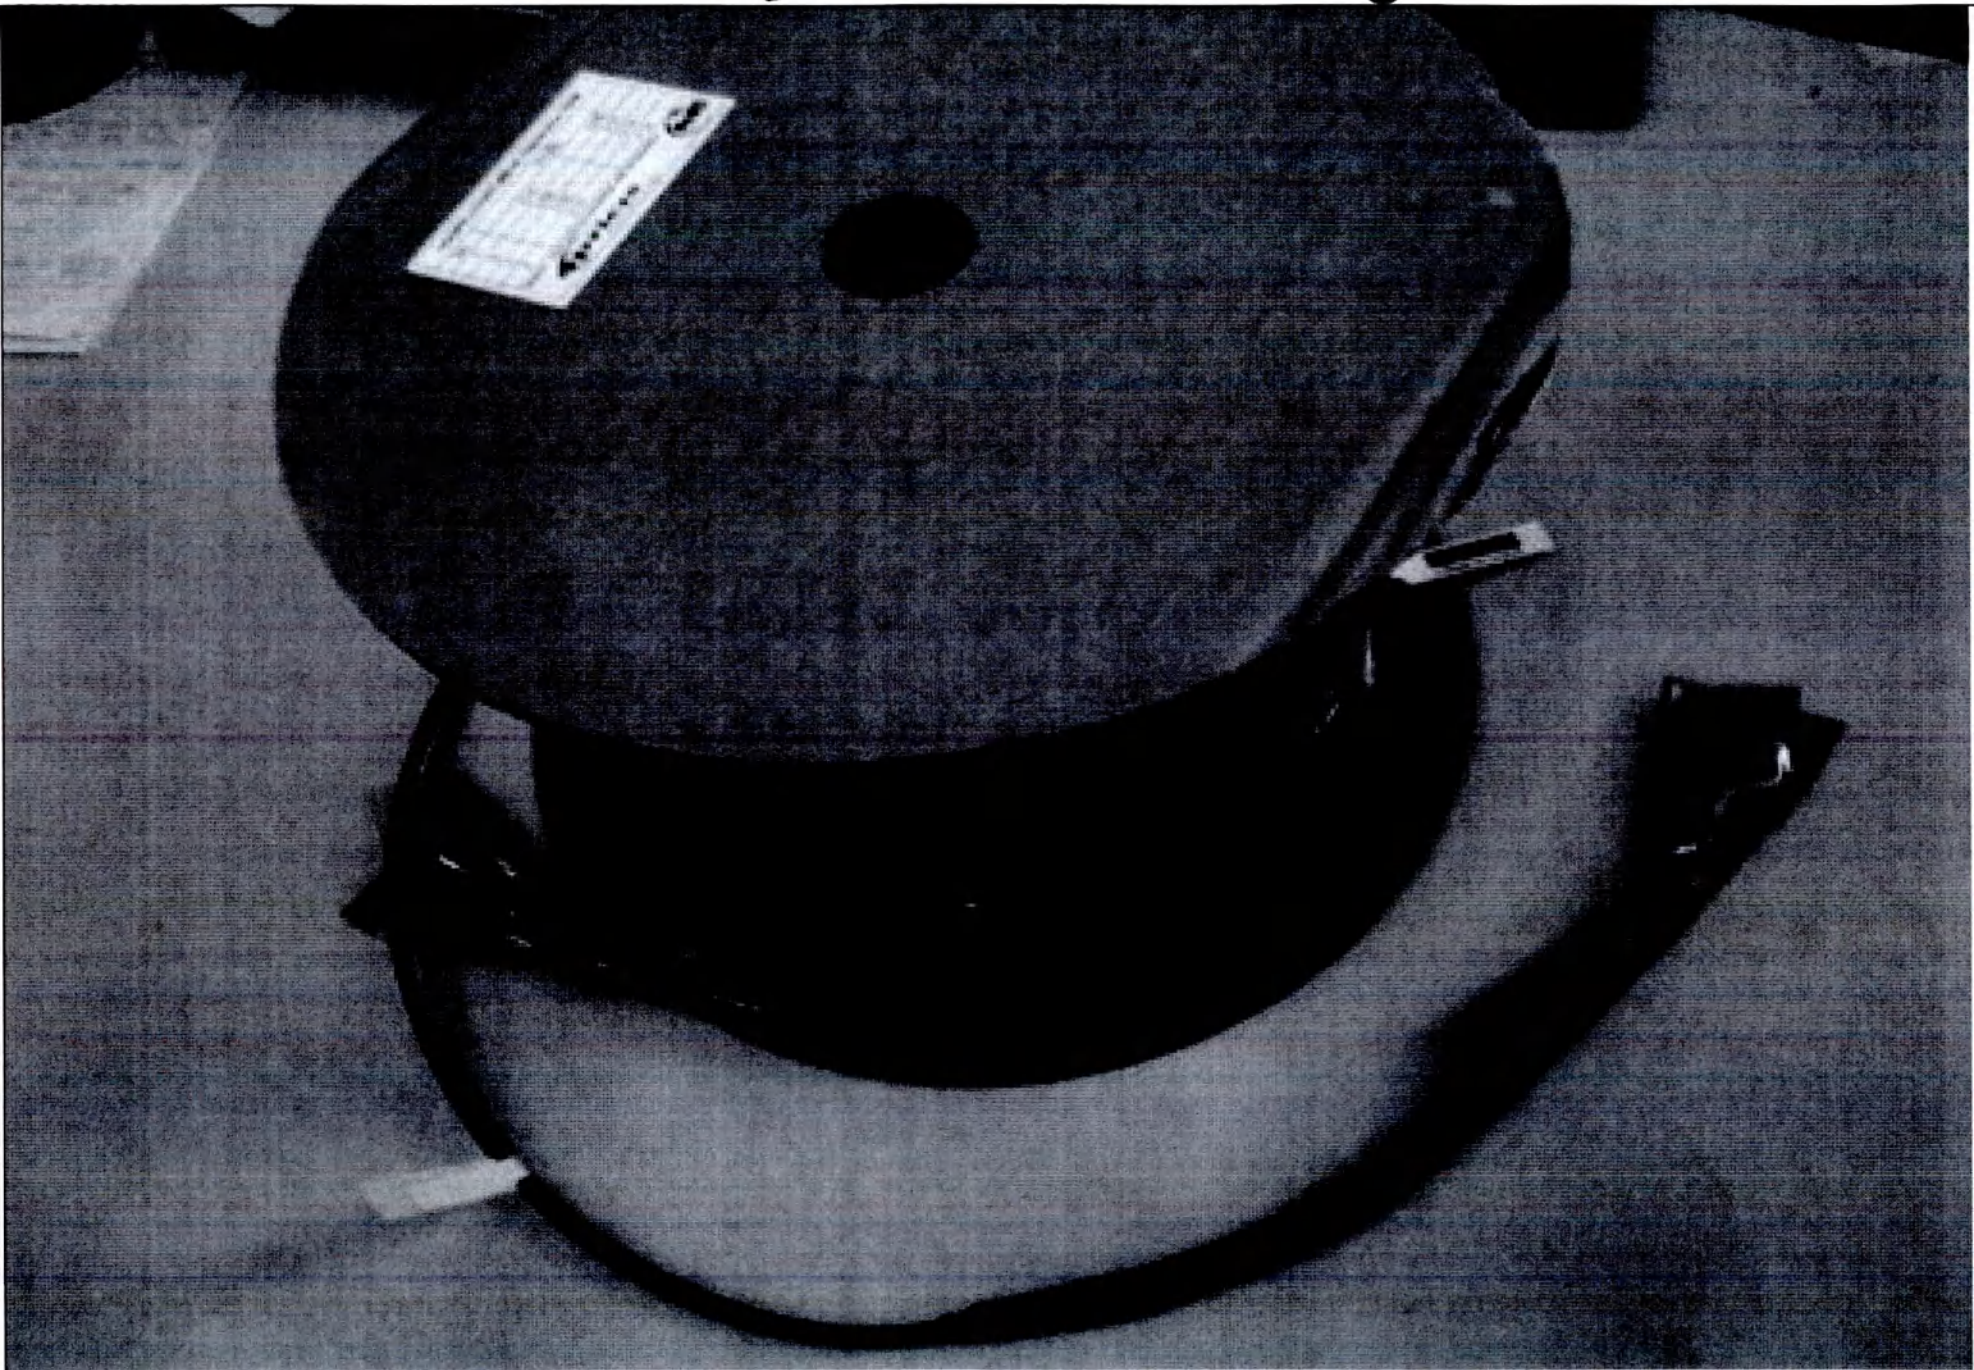


Рисунок 16. Кабели для подключения периферийного оборудования — 1 шт. (но не более 10 шт. при необходимости).

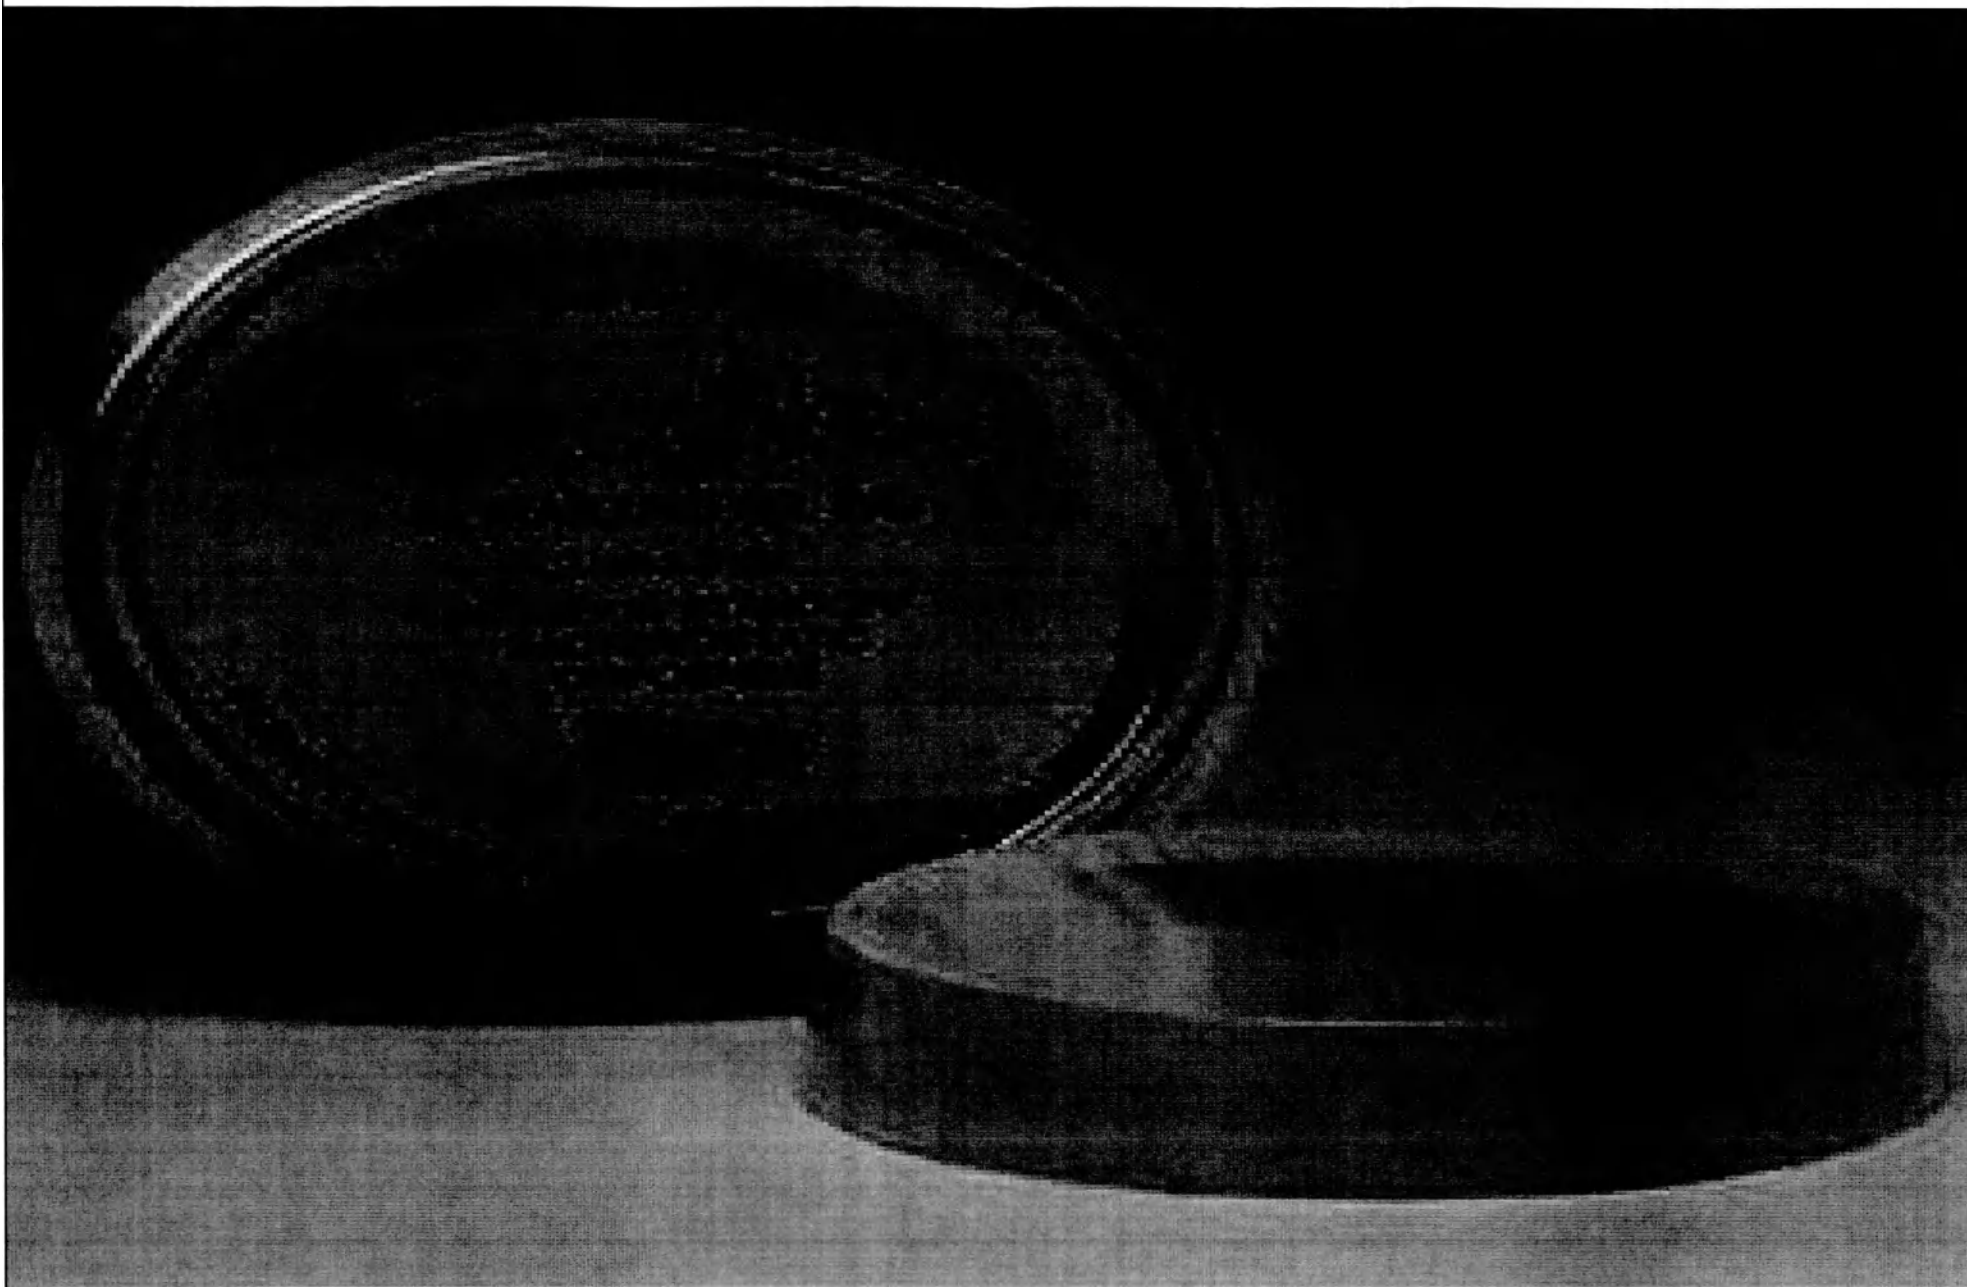


Видеоскоп 17. Обнаружение головных прокладок для линейных датчиков — 1 шт. (но не более 500 шт. при необходимости).

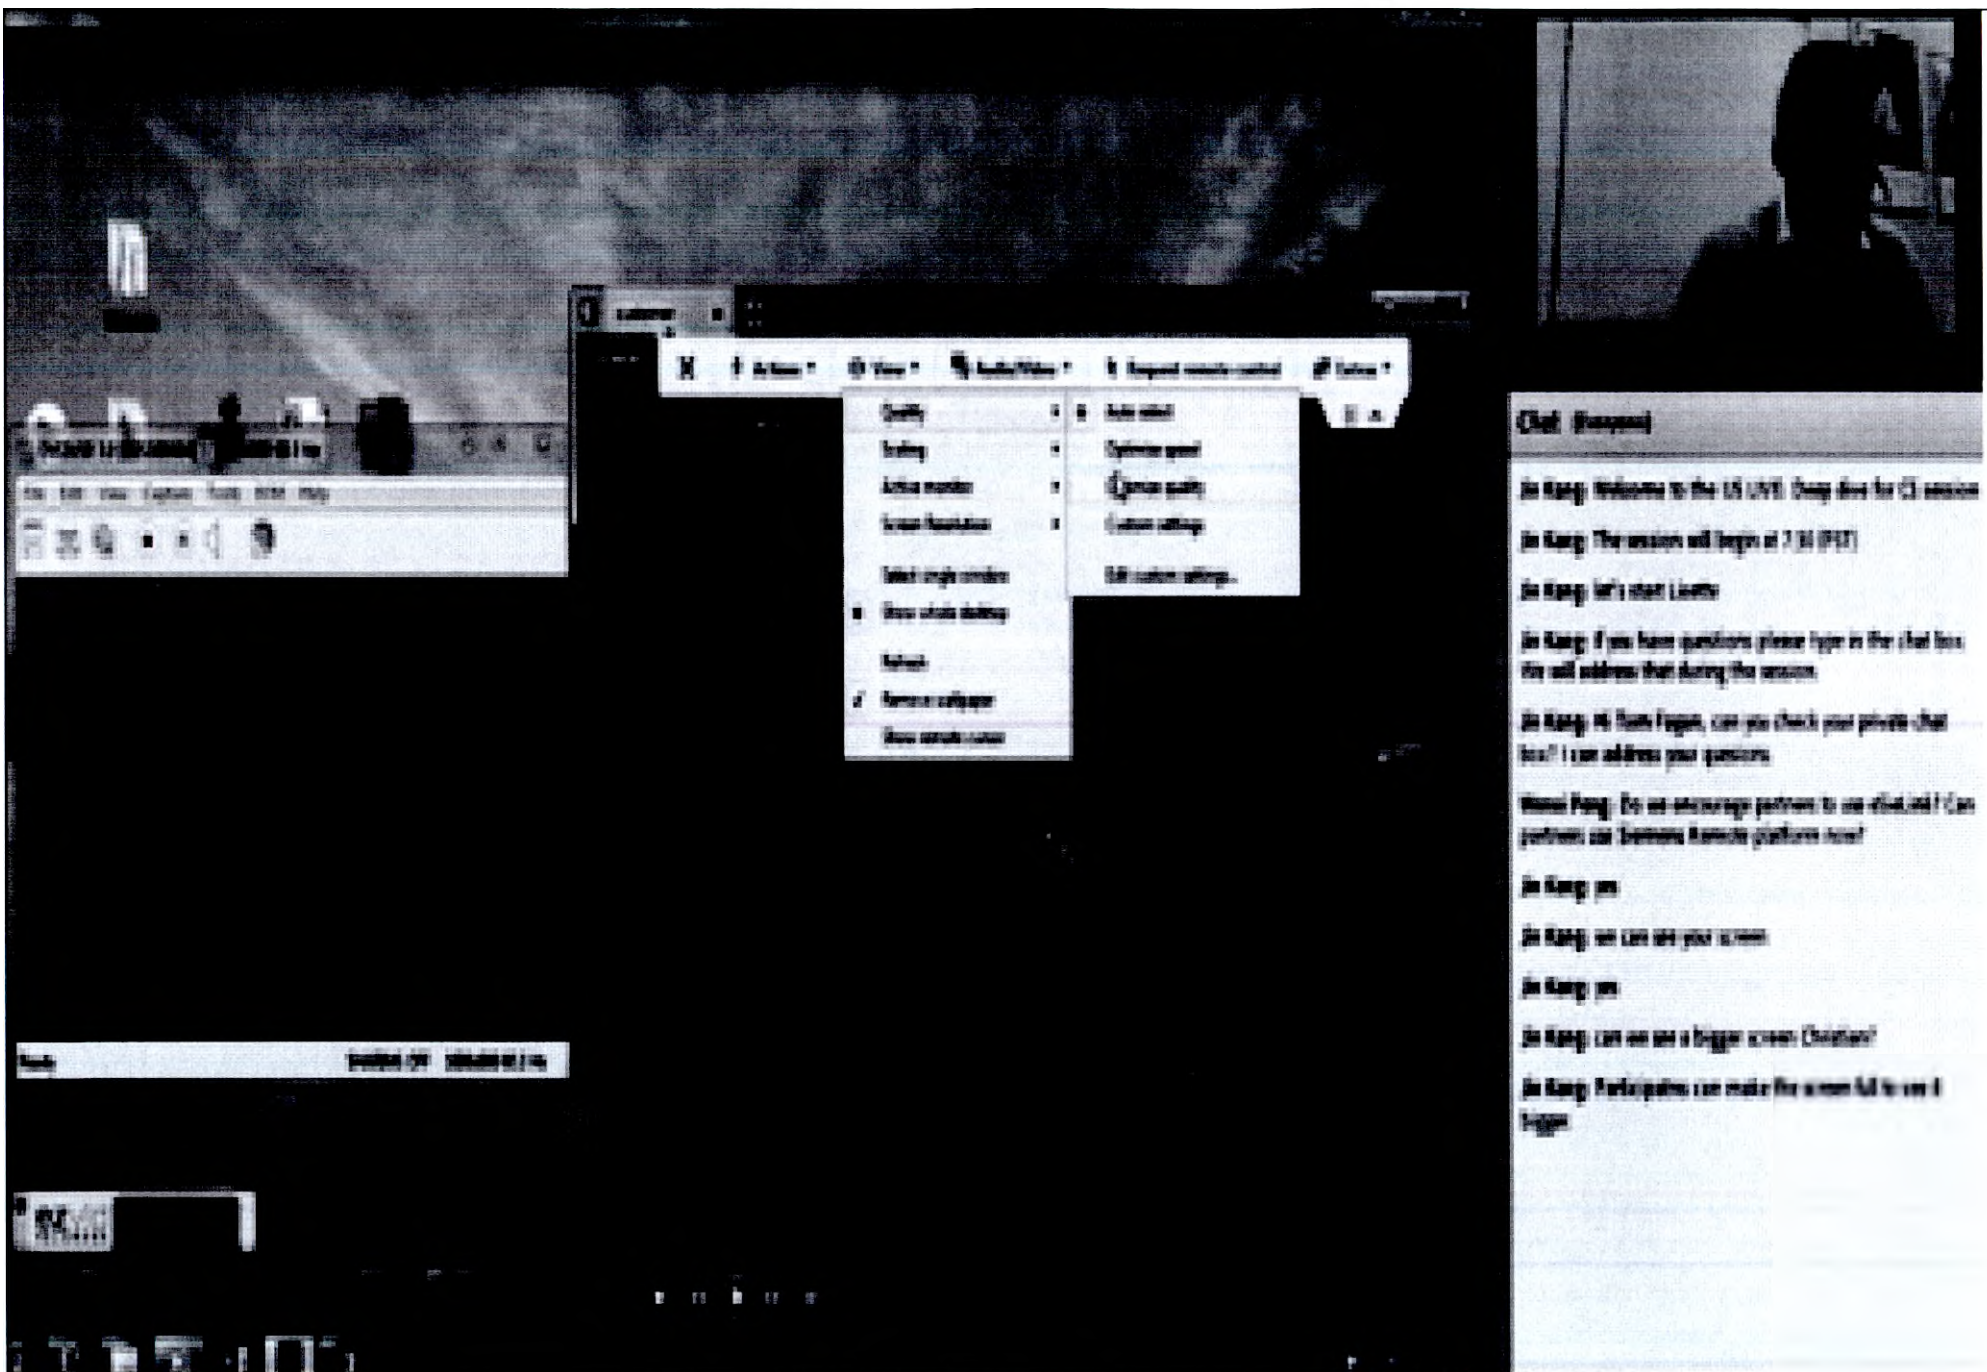

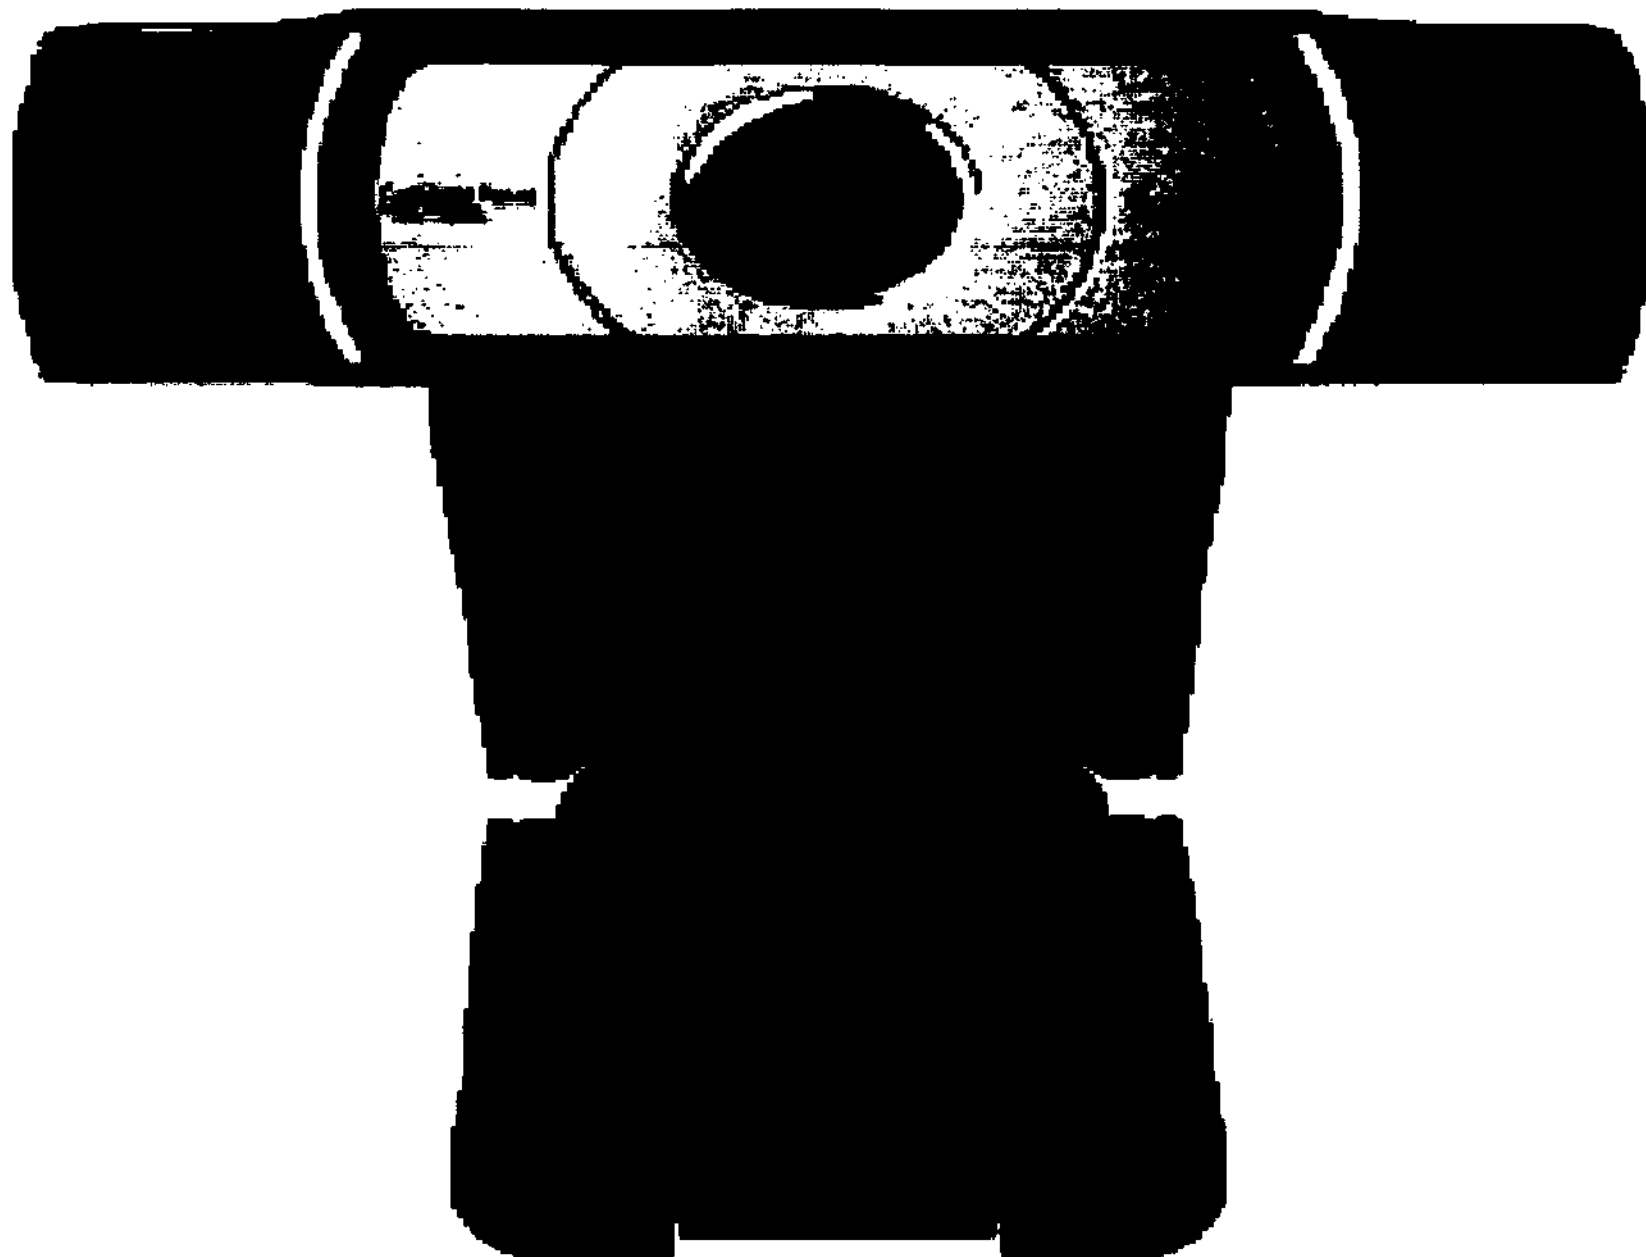



Набор для удаленного сервисного обслуживания: камера; наушники; микрофон; крепления.

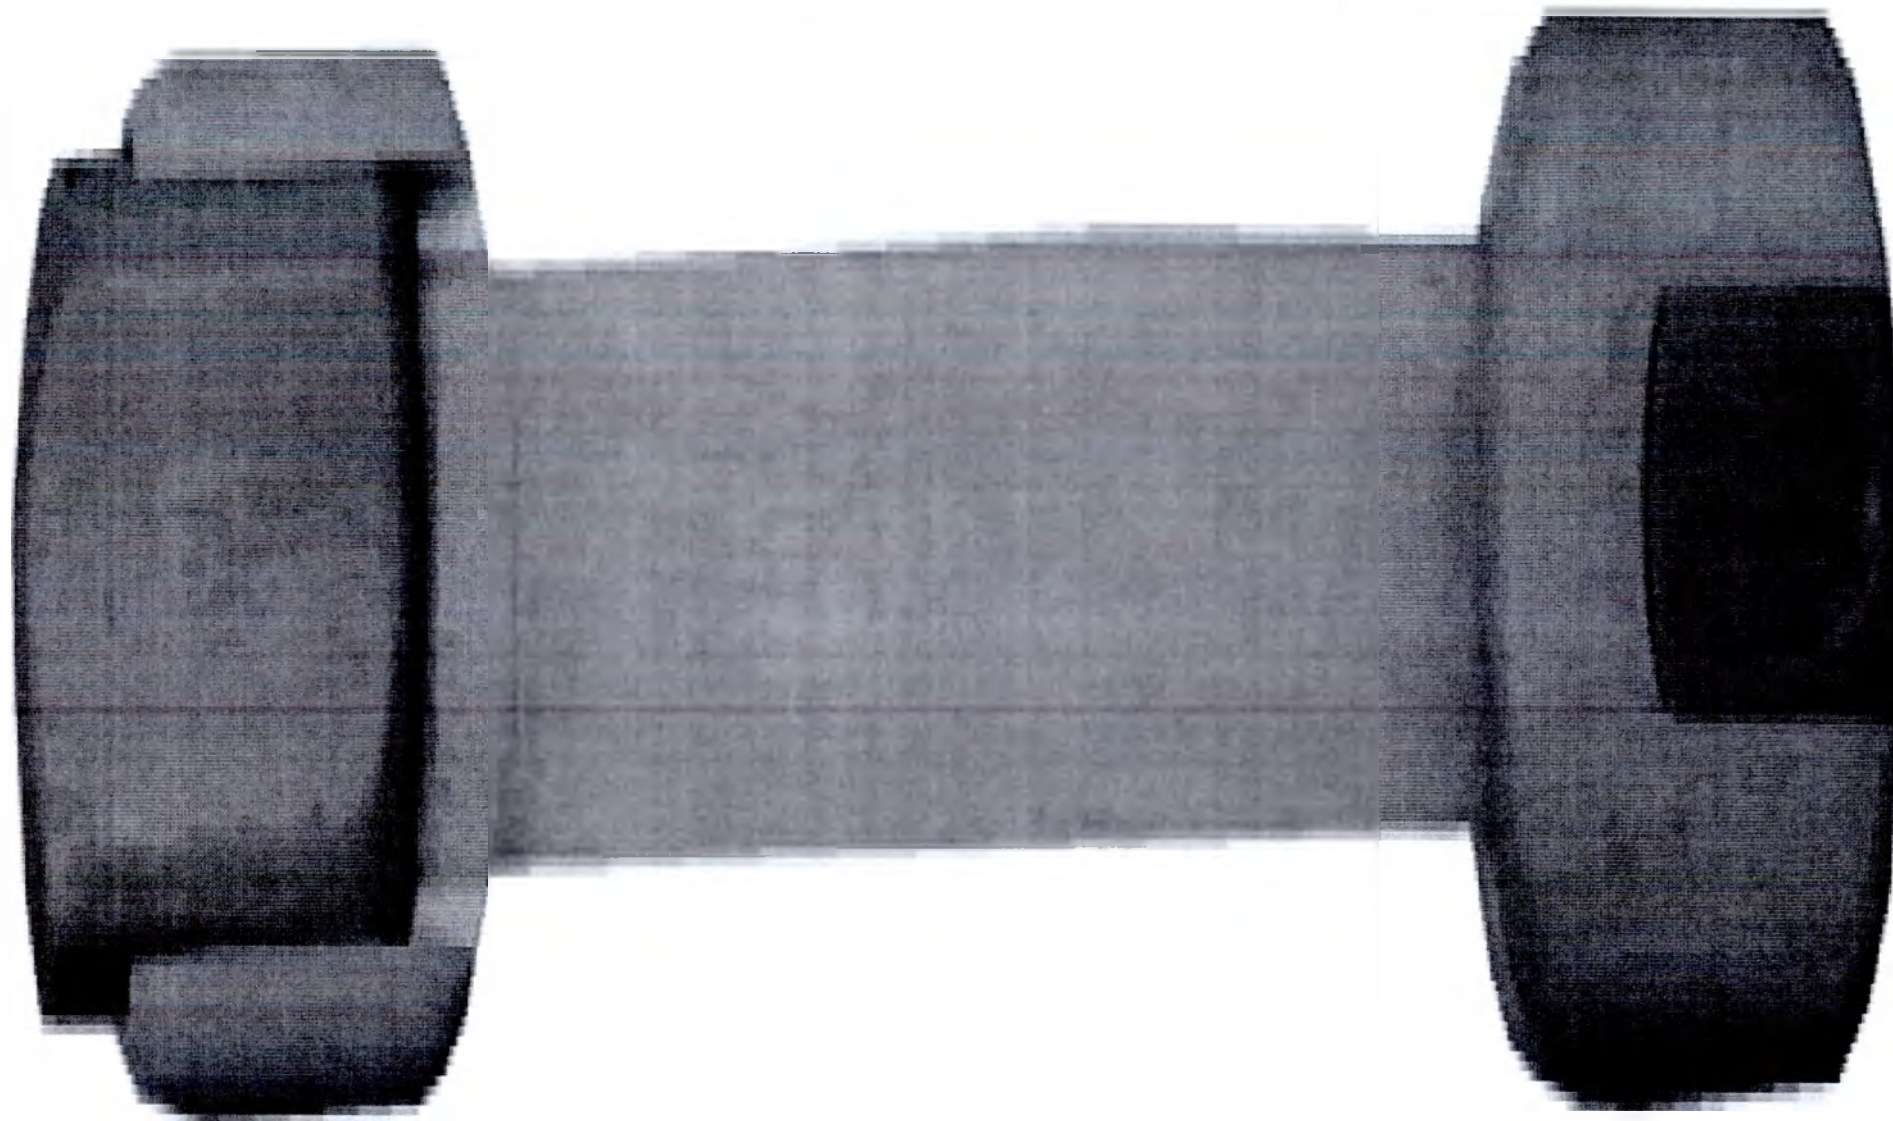

Набор для удаленного сервисного обслуживания: камера; наушники; микрофон; крепления.

ООО ЦИРМИ  [info@cirmi.ru](mailto:info@cirmi.ru)  [www.goszdravnadzor.ru](http://www.goszdravnadzor.ru)

Фотографические изображения принадлежностей для медицинского изделия:  
**«Принадлежности для ACUSON NX3 Elite»**

Add-on

30 dB

HP 2.2 MHz

CR 60 dB

Edge 2

Persist 4

RGB 4


Map 1


Img 0

4:00

Tissue Harmonic Imaging  
Hemangioma Seen Within Liver


Рисунок 1. Лицензионный ключ для технологии тканевой гармоник (THI) на оптическом или электронном носителе.

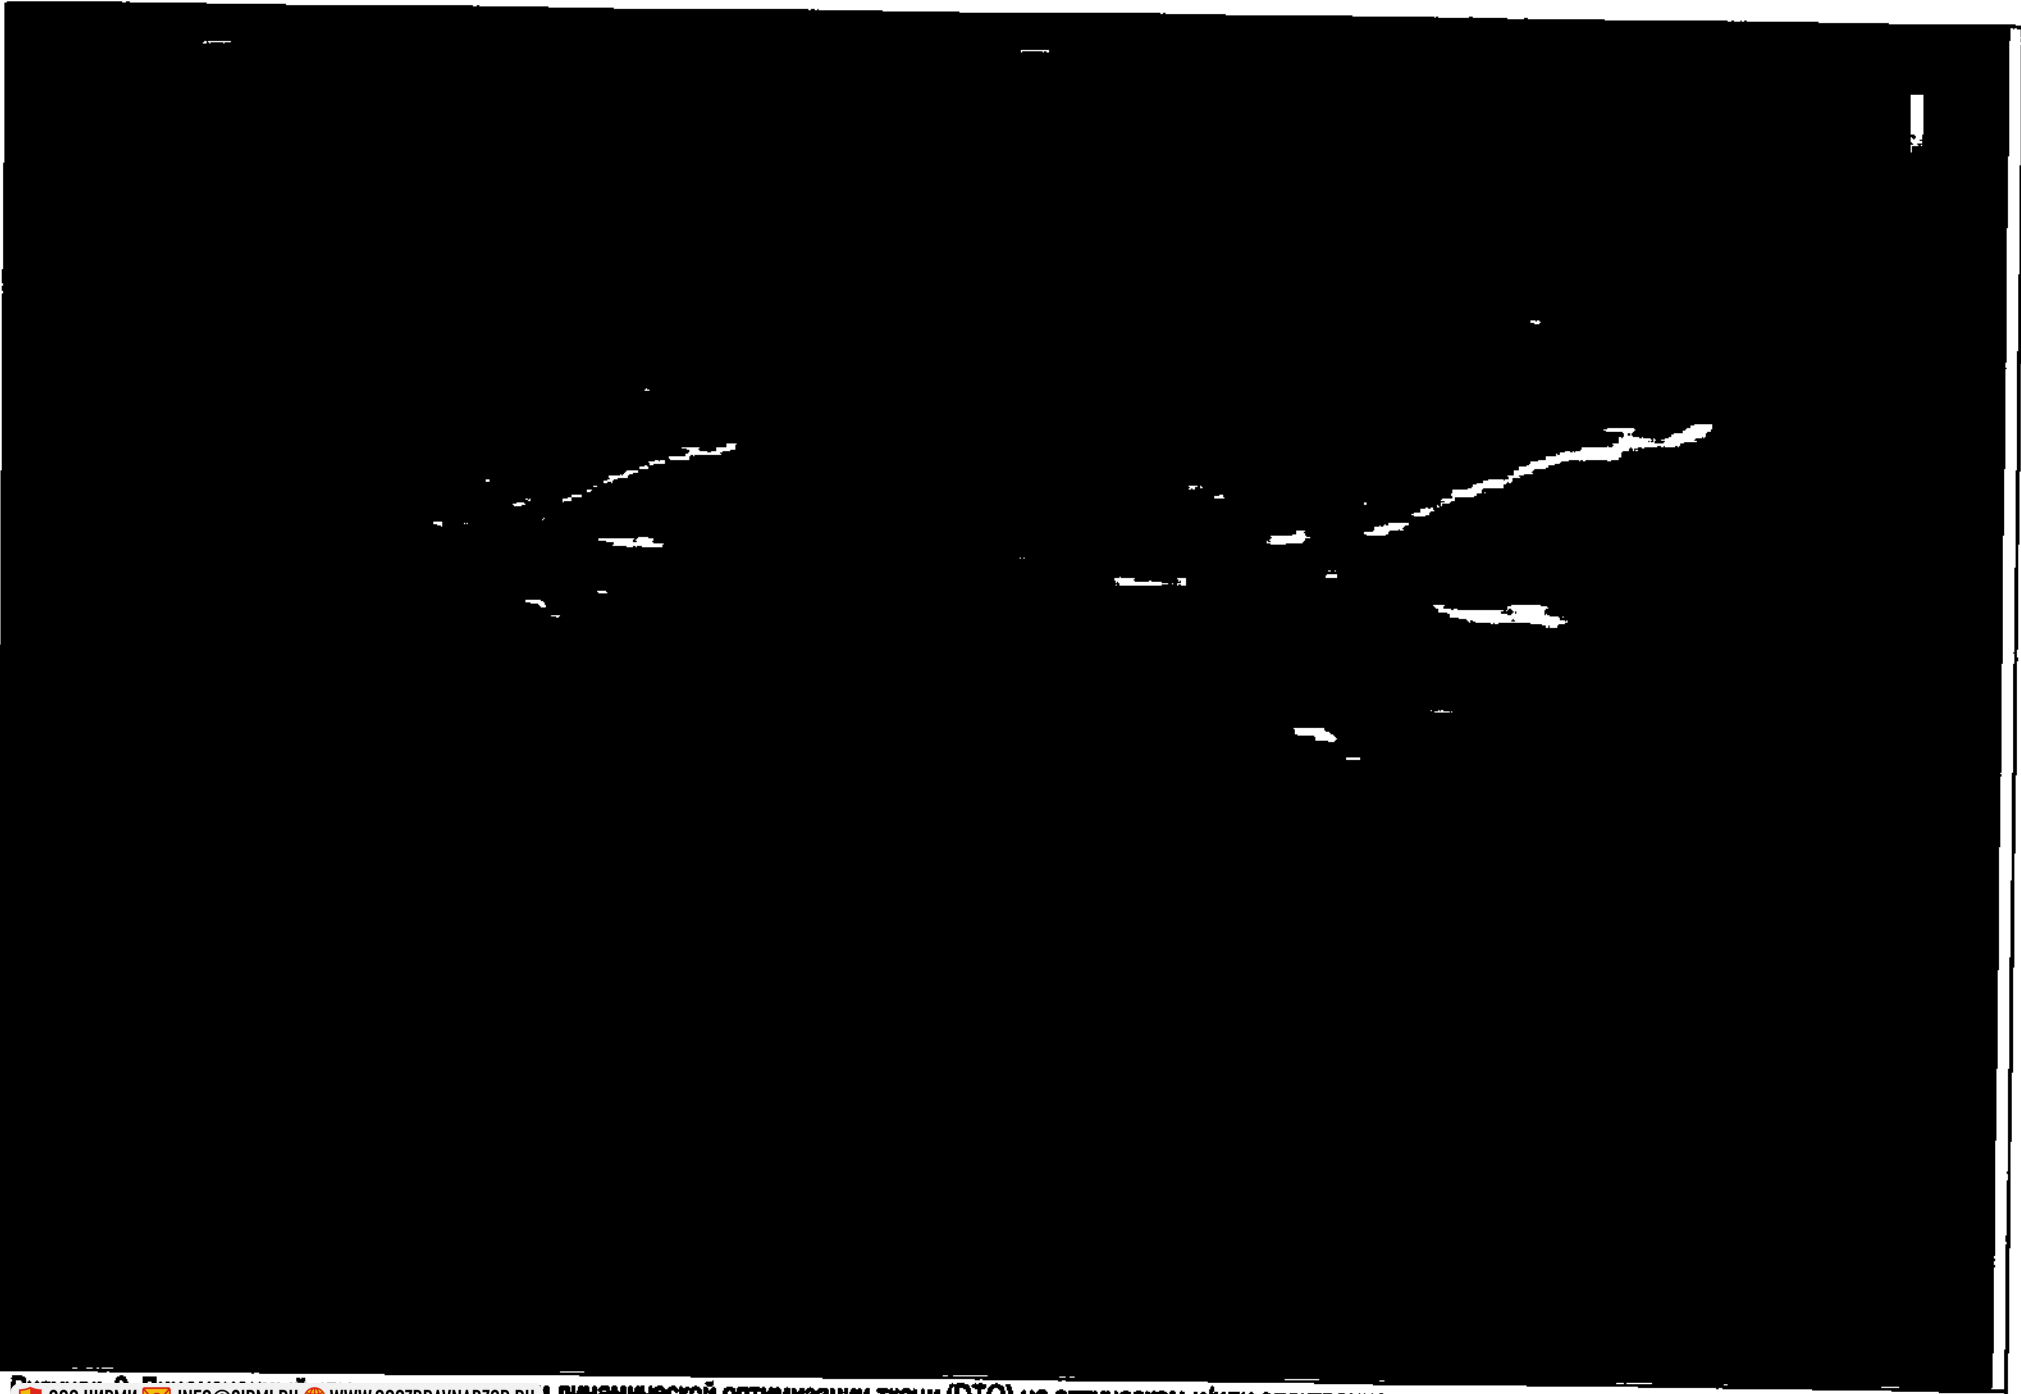

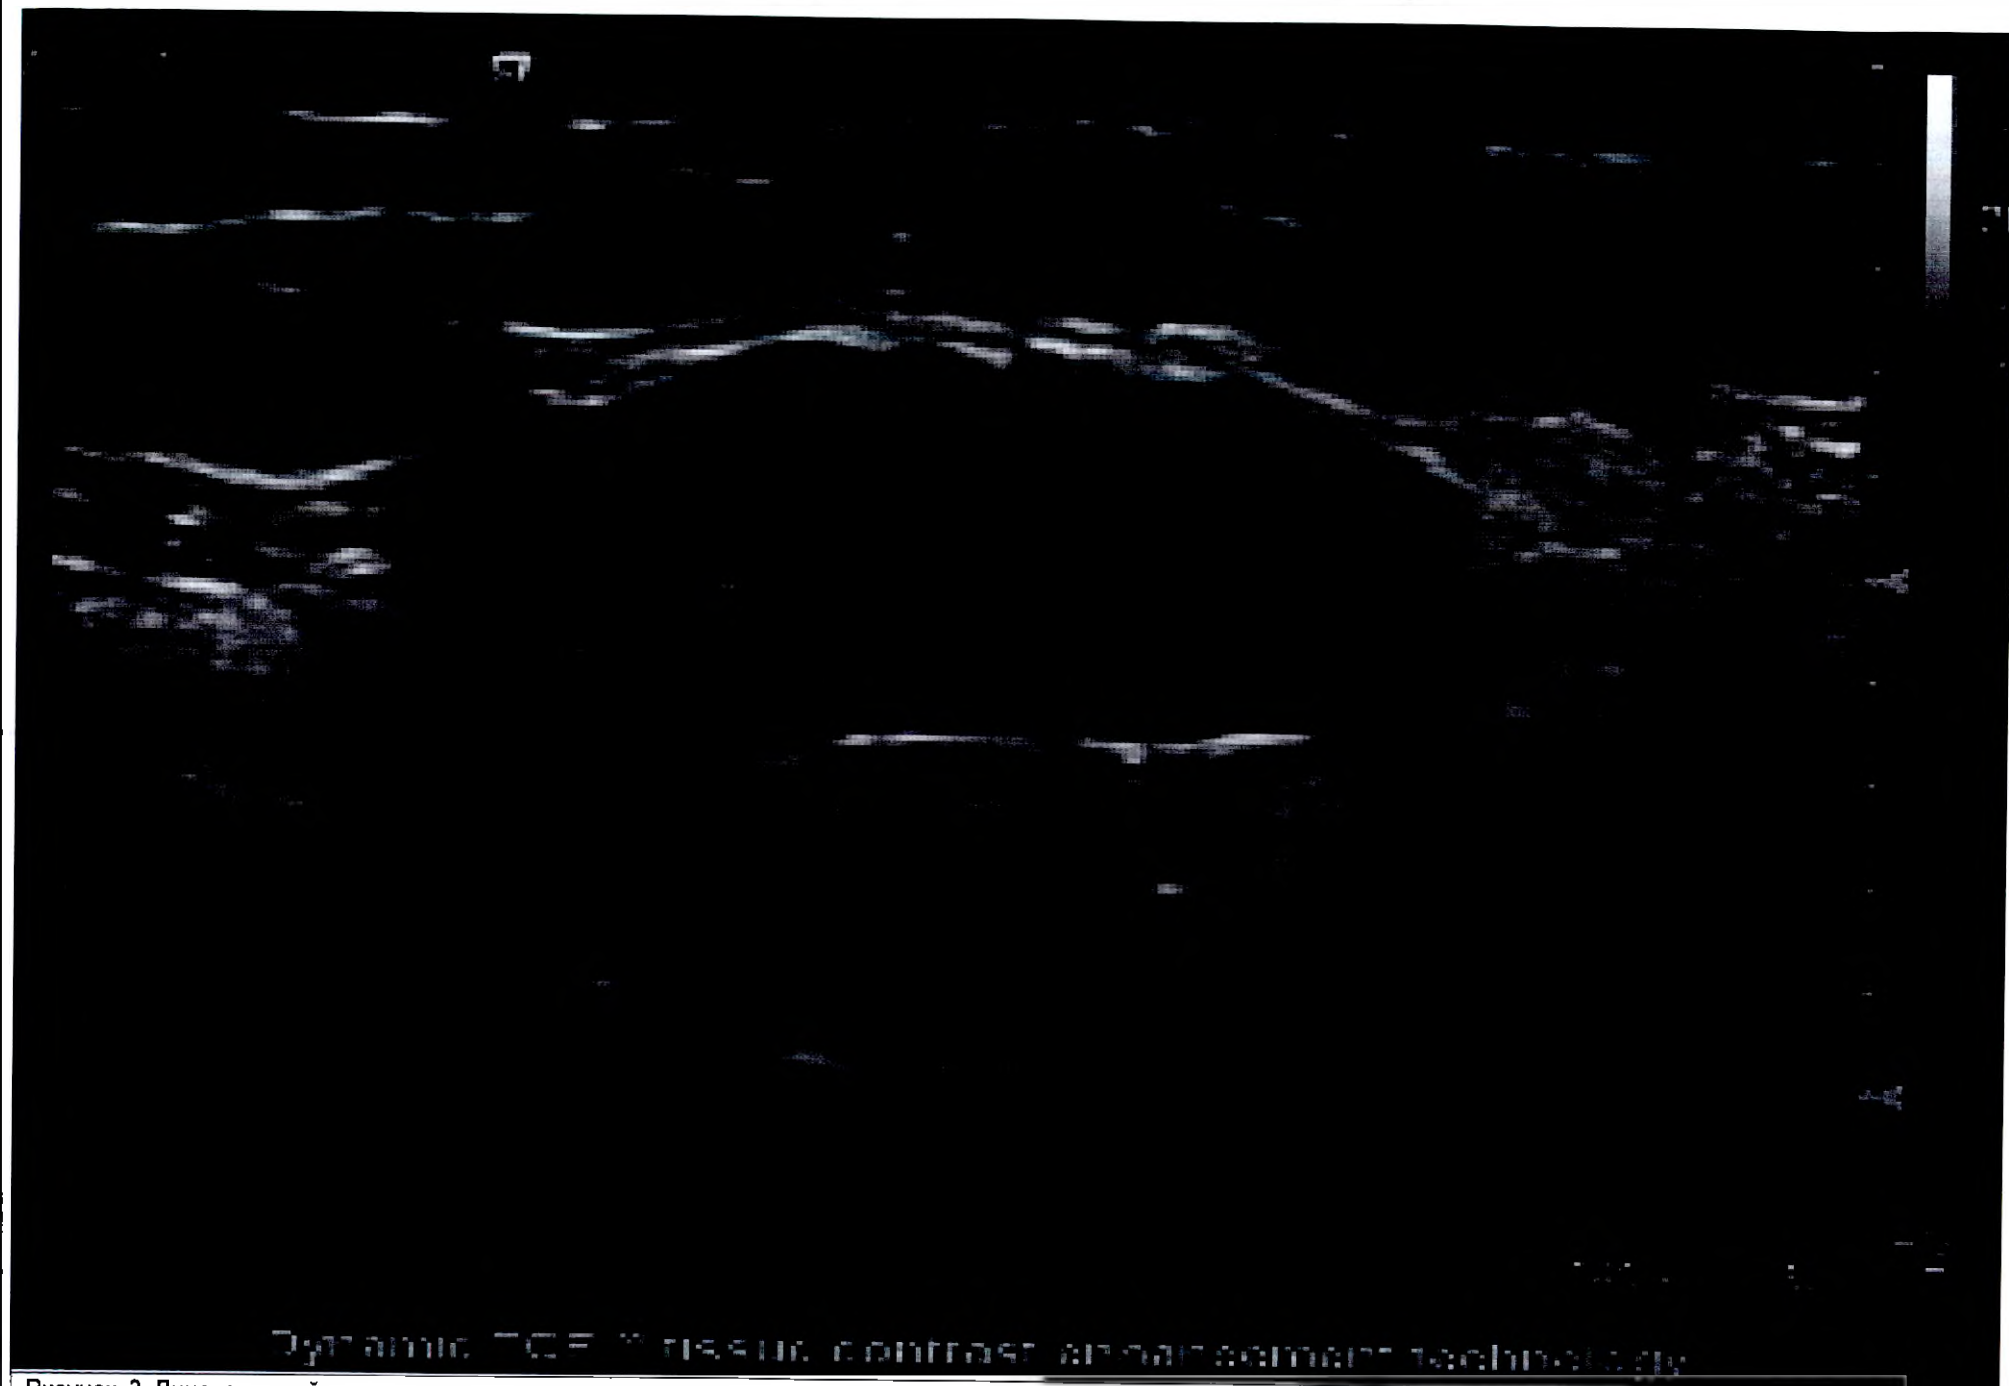

Dynamic TCE - tissue contrast adaptation technology



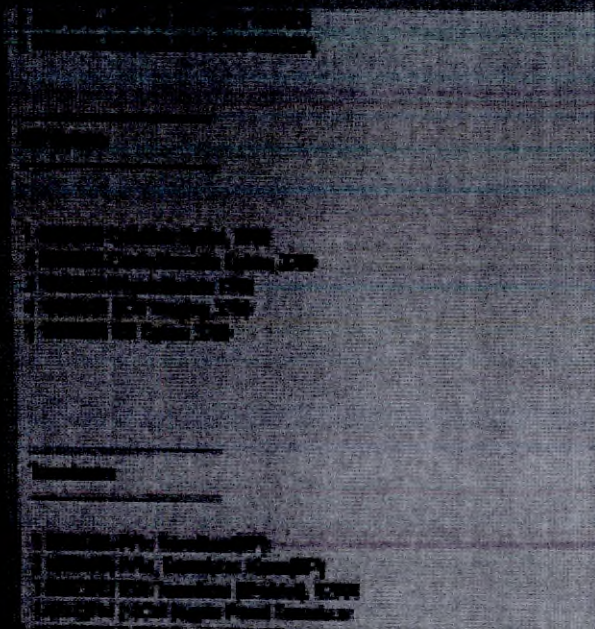

**Presets**

- General 1
- General 2
- Peripheral
- Customize Keys
- Display
- Exam Configuration
- User-Defined Exam List
- Text Annotation
- Pictogram List
- M & R Configuration
- Summary
- Service
- Stress Echo
- SieScape
- CAI
- Wireless
- DICOM
- DIMAQ Utility
- Clip Capture
- Network Export
- Authorization
- Archive
- Printer

**Local Host | Storage Server | Worklist Server | MPPS Server | BW Printer | Color Printer | Query/Retrieve**

**Storage Server** ☐ Uses Commitment

☒ SS\_AL

Alias: SS\_AL

AE Title: SS\_AE

IP Address: 192 168 0 3

Port Number: 5104

Ping and Echo Timeout in seconds: 10

New Apply Cancel

☒ Autostore to DICOM ☐ Store During Exam ☒ Store At End Of Exam

☐ After Every Image is Stored ☒ After All Images are Stored

Number of Times to Retry Failure: 2

Seconds Between Each Retry: 60

Write Timeout in Seconds: 30

Connect Timeout in Seconds: 30

Image Format: Automatic ☒ Send SR

☒ No Monochrome conversion

☐ Store all images as Monochrome

☐ Store all images and clips as Monochrome

Save Cancel

## Presets

General 1  
General 2  
Peripheral  
Customize Keys  
Display  
Exam Configuration  
User-Defined Exam List  
Text Annotation  
Pictogram List  
M & R Configuration  
Summary  
Service  
Stress Echo  
SieScape  
CAI  
Wireless  
DICOM  
DIMAQ Utility  
Clip Capture  
Network Export  
Authorization  
Archive  
Printer

Local Host | Storage Server | Worklist Server | MPPS Server | B/W Printer | Color Printer | Query/Retrieve |

Storage Server ☐ Uses Commitment

☒ SS\_AL

Alias: SS\_AL

AE Title: SS\_AE

IP Address: 192 168 0 3

Port Number: 5104

Ping and Echo Timeout in seconds: 10

New

Apply

Cancel

Ping

Echo

☒ Autostore to DICOM

☐ Store During Exam

☒ Store At End Of Exam

☐ After Every Image is Stored

☒ After All Images are Stored

Number of Times to Retry Failure: 2

Seconds Between Each Retry: 60

Write Timeout in Seconds: 30

Connect Timeout in Seconds: 30

Image Format: Automatic

☒ Send SR

☒ No Monochrome conversion

☐ Store all images as Monochrome

☐ Store all images and clips as Monochrome

Save

Cancel

**Presets**

- General 1
- General 2
- Peripheral
- Customize Keys
- Display
- Exam Configuration
- User-Defined Exam List
- Text Annotation
- Pictogram List
- M & R Configuration
- Summary
- Service
- Stress Echo
- SieScape
- CAI
- Wireless
- DICOM
- DIMAQ Utility
- Clip Capture
- Network Export
- Authorization
- Archive
- Printer

**Local Host | Storage Server | Worklist Server | MPPS Server | B/W Printer | Color Printer | Query/Retrieve**

**Storage Server** ☐ Uses Commitment

☒ SS\_AL

Alias: SS\_AL

AE Title: SS\_AE

IP Address: 192 168 0 3

Port Number: 5104

Ping and Echo Timeout in seconds: 10

New Apply Cancel

☒ Autostore to DICOM ☐ Store During Exam ☒ Store At End Of Exam

☐ After Every Image is Stored ☒ After All Images are Stored

Number of Times to Retry Failure: 2

Seconds Between Each Retry: 60

Write Timeout in Seconds: 30

Connect Timeout in Seconds: 30

Image Format: Automatic ☒ Send SR

☒ No Monochrome conversion

☐ Store all images as Monochrome

☐ Store all images and clips as Monochrome

Save Cancel

CH1

MSK

32 dB

10.0 MHz

DR 60 dB

Edge 3

Persist 4

Map 0

Tint 0

38 fps

EC94

TH 0.3 MHz

DR 60 dB

Edge C

Persist 1

Map

Tint 2

ASC 3

DTCE MHz

31 MHz

L1 =

MS L2 =

L1 =

0.3 MHz

agittal Right

100% 1 0

1 1 0 0

Рисунок 10. Лицензионный ключ для технологии автоматического исследования фолликулов (Auto Follicle) на оптическом и/или электронном носителе.



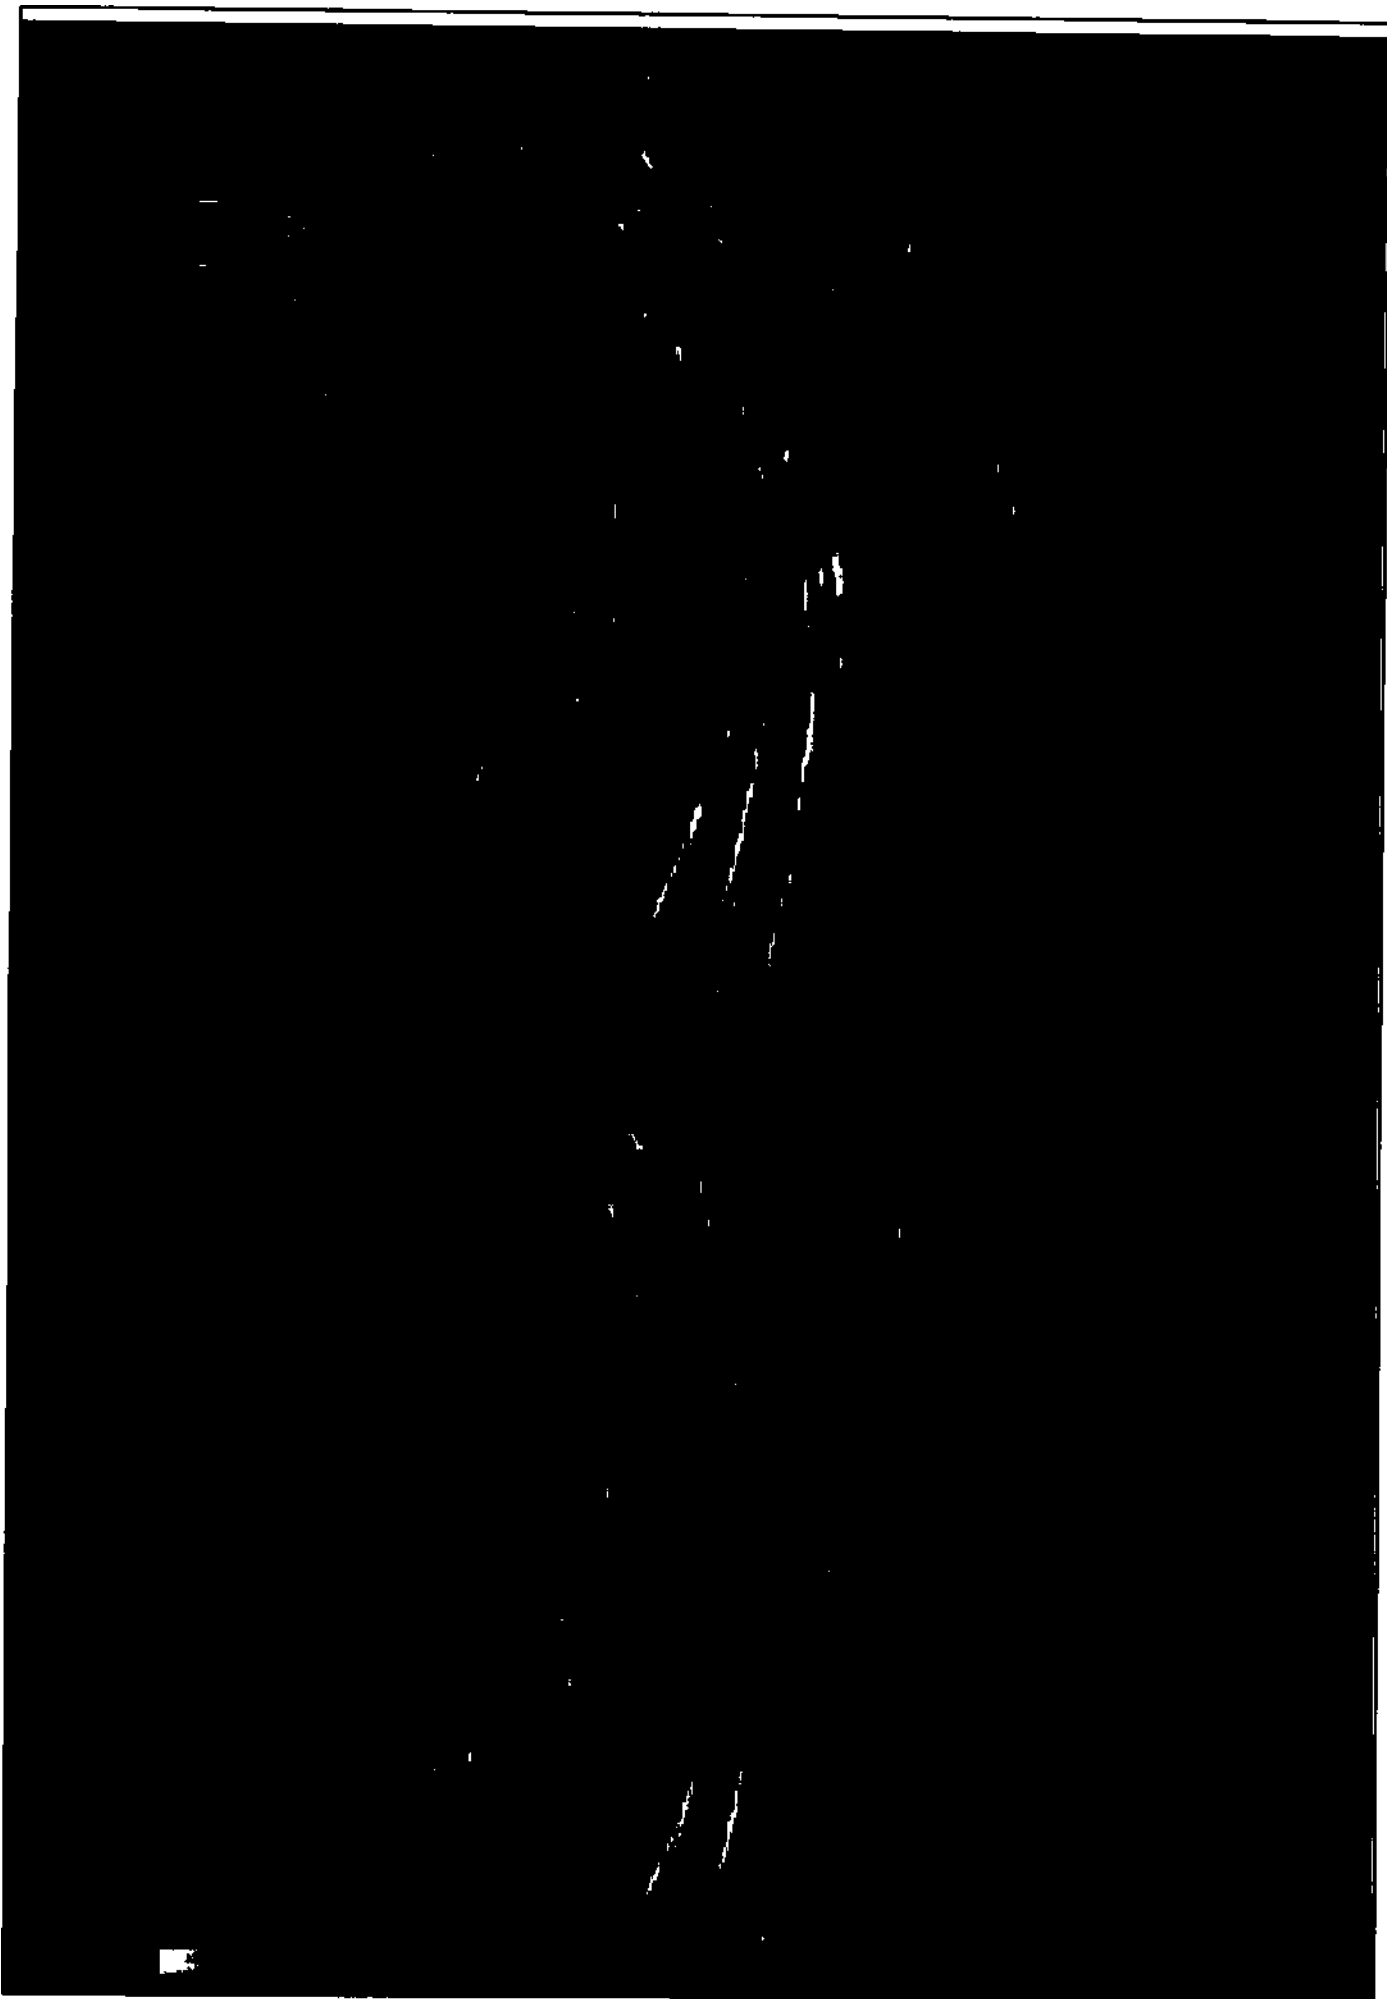


Рисунок 12. Лицензионный ключ для технологии повышения качества отображения сосудов (Clarify VE) на оптическом и/или электронном носителе.





Рисунок 14. Лицензионный ключ для технологии четырехмерной визуализации (fourSight 4D) на оптическом и/или электронном носителе.

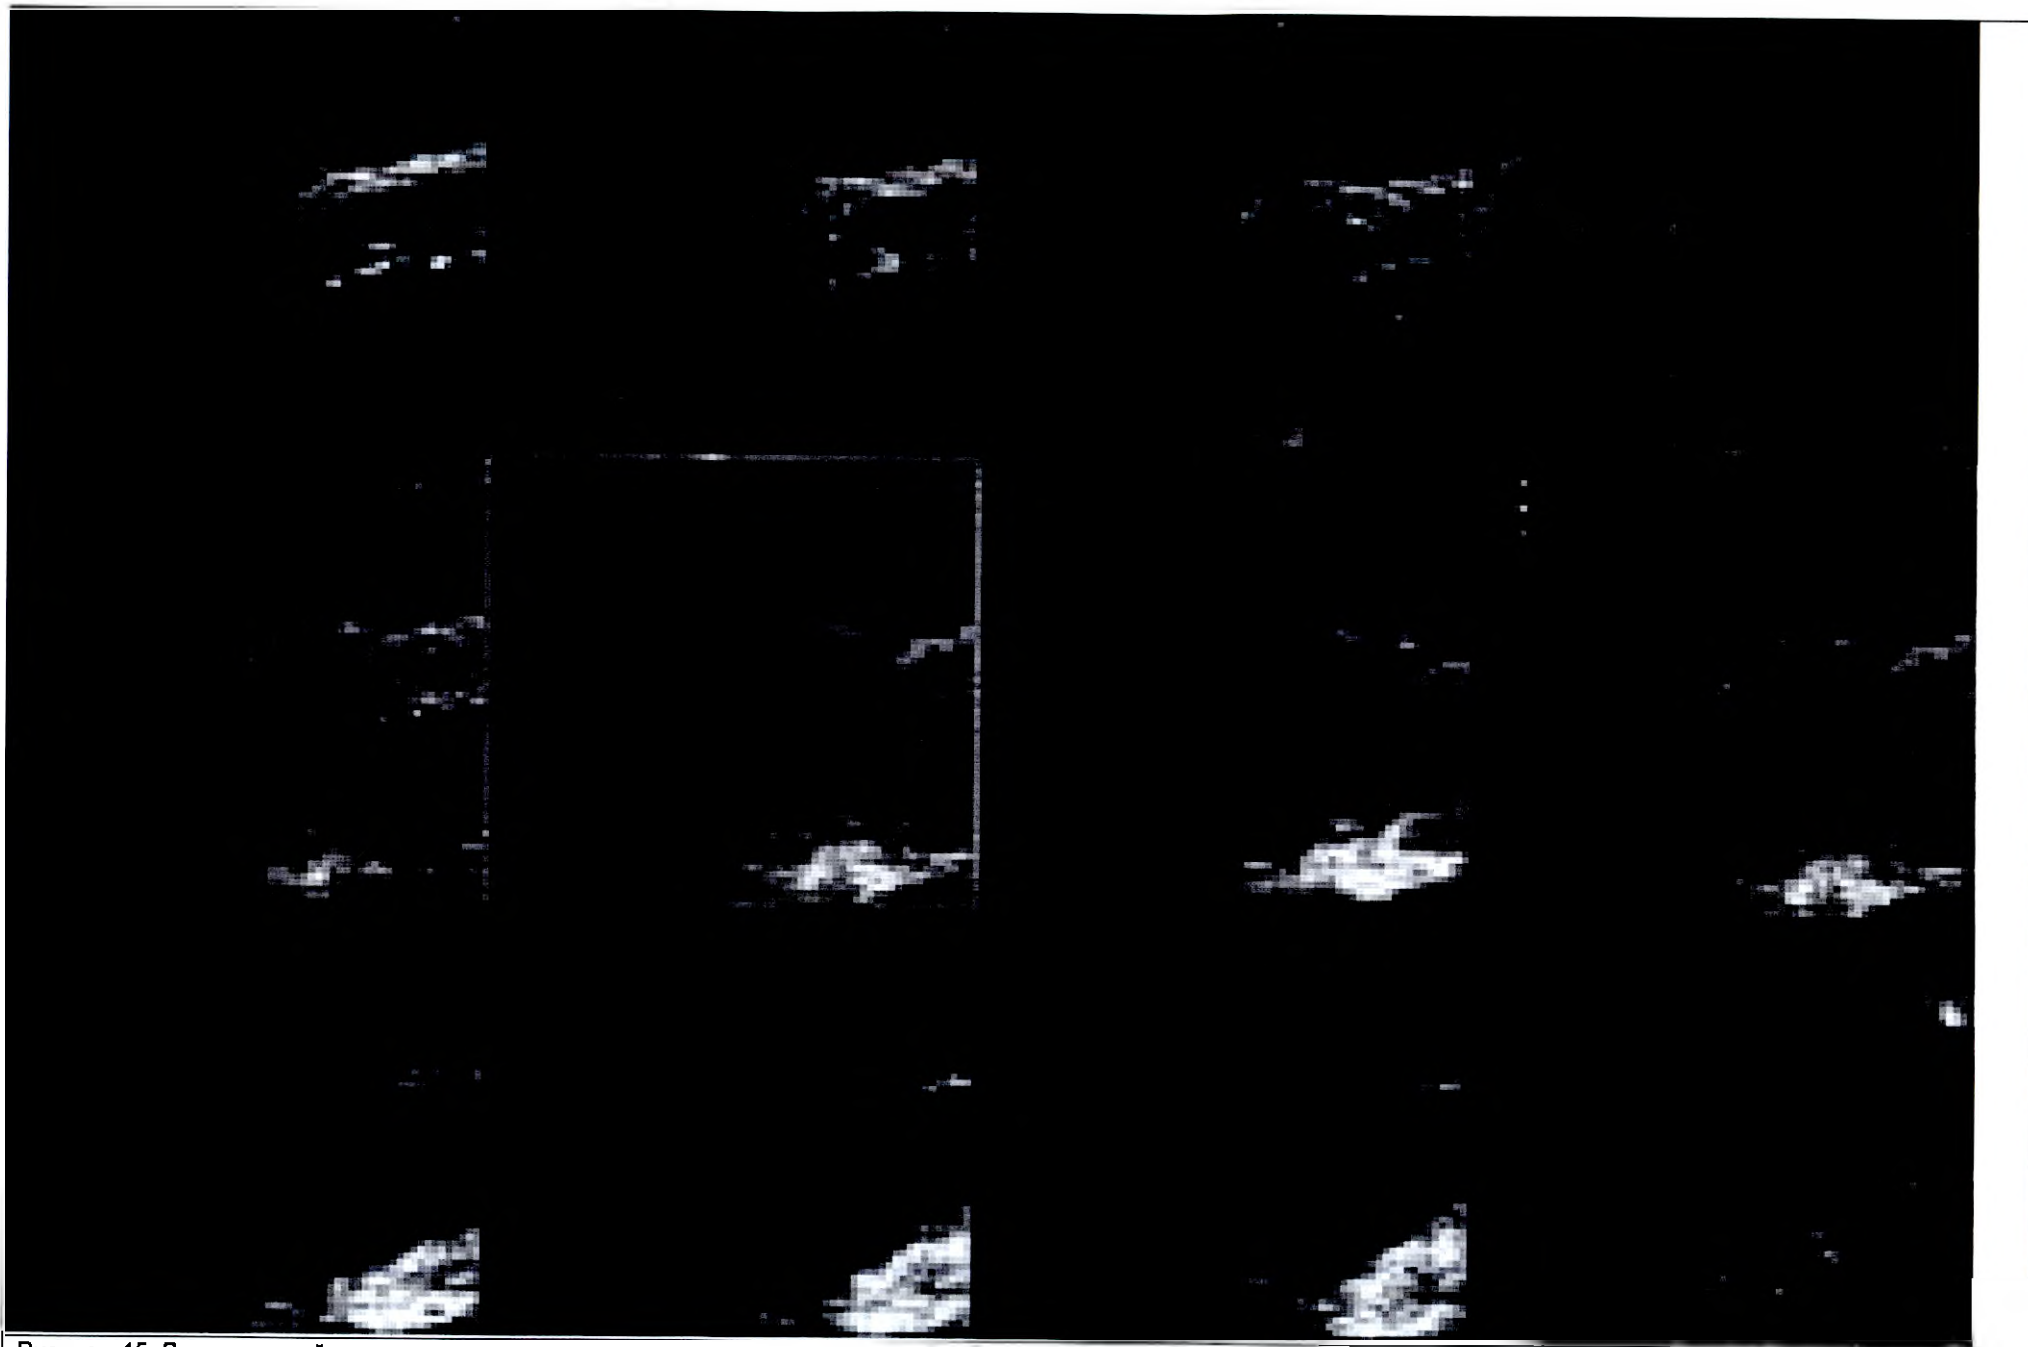


Рисунок 15. Лицензионный ключ для технологии расширенных возможностей обработки изображений четырехмерной визуализации (Advanced fourSight) на оптическом и/или



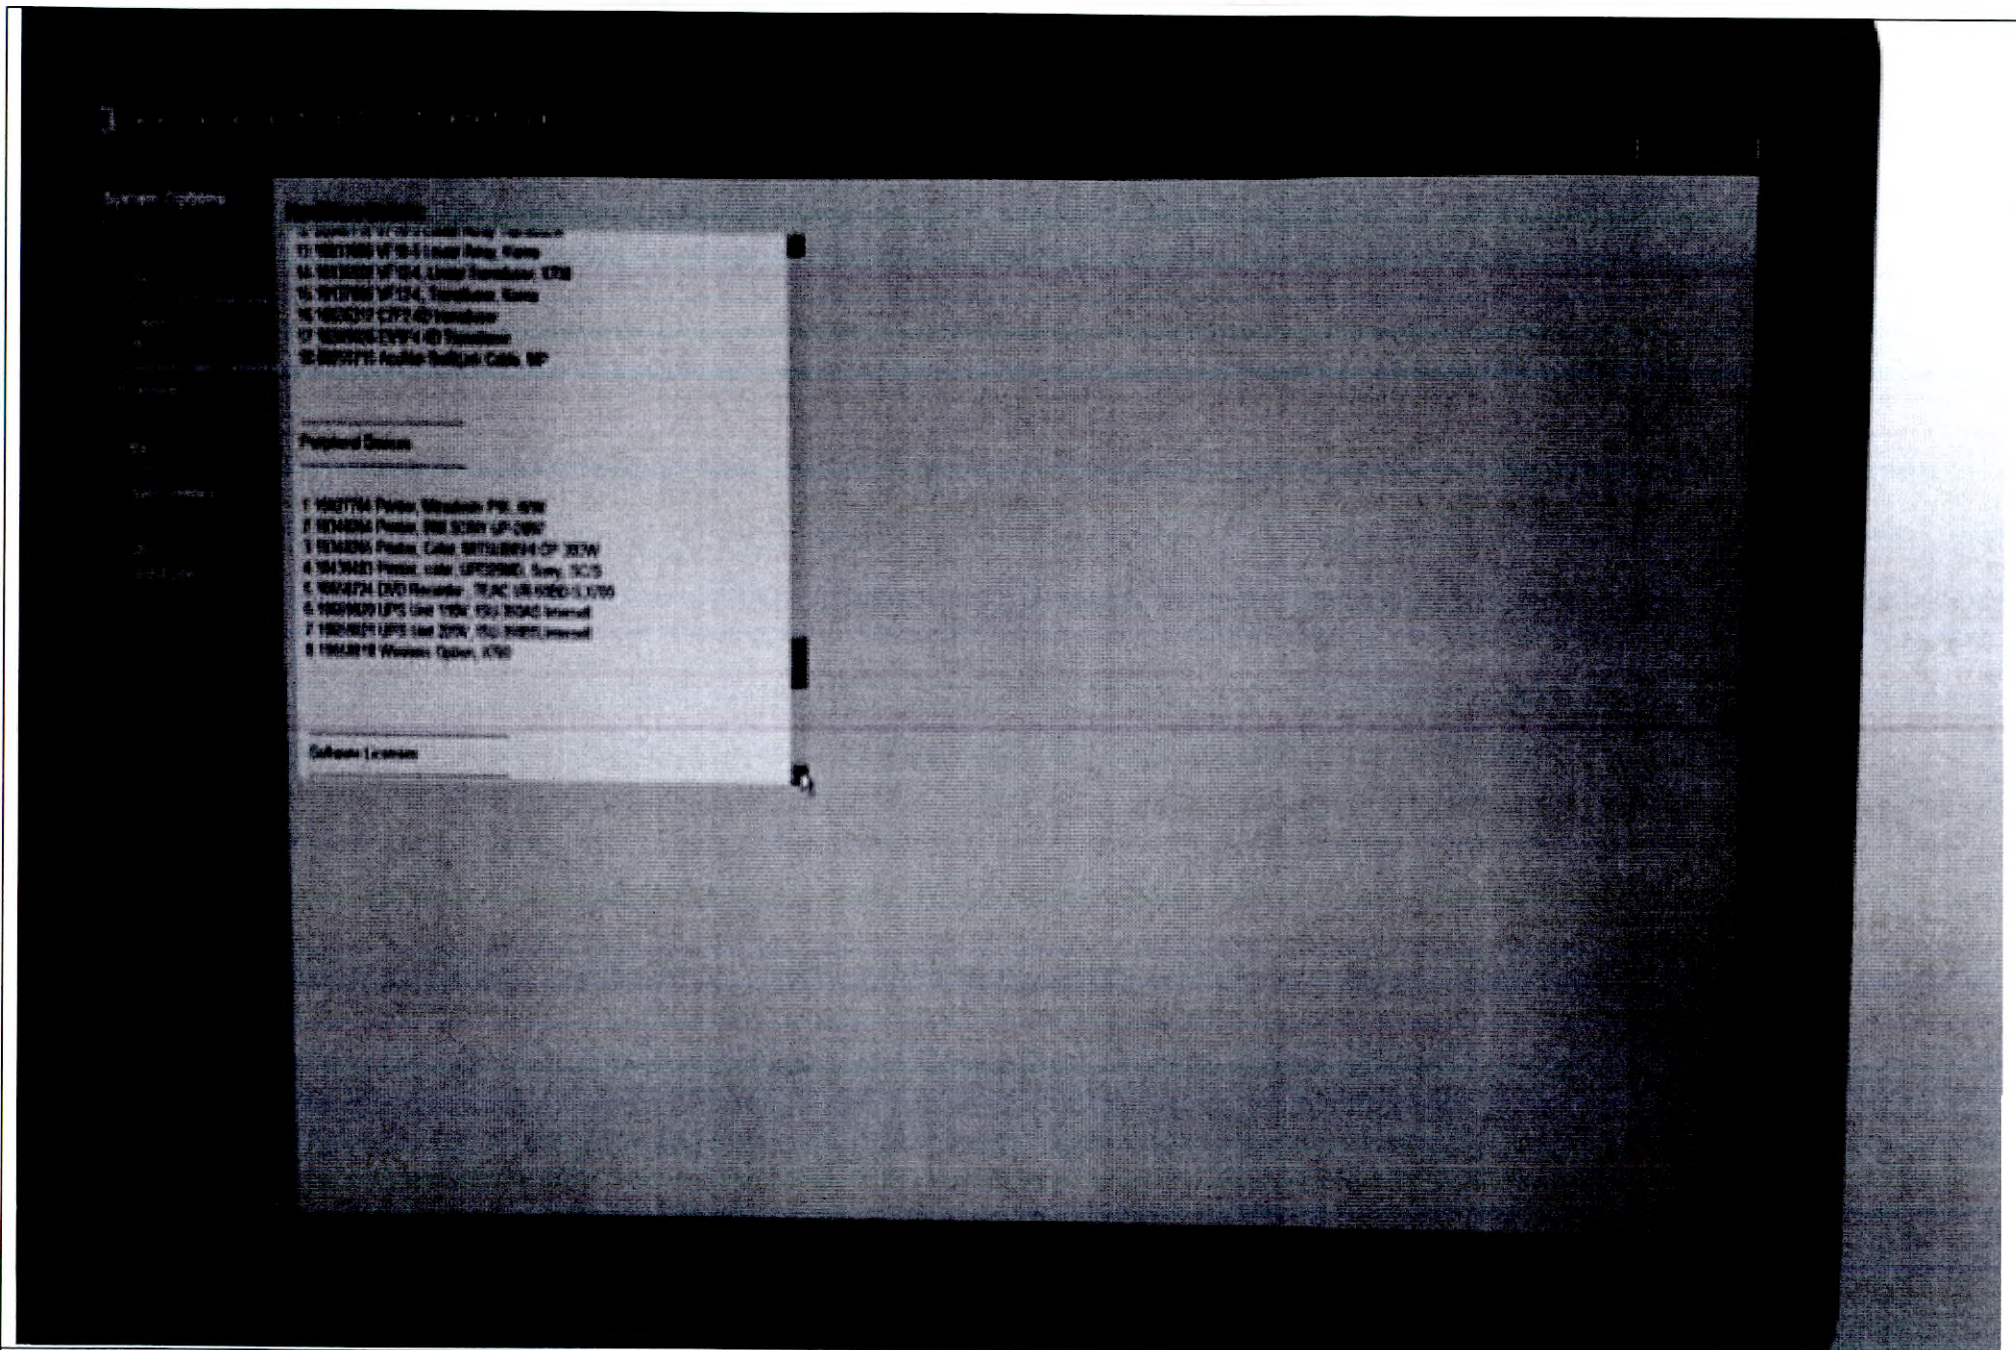



Рисунок 17. Лицензионный ключ для технологии беспроводной передачи данных (Wireless connection) на оптическом и/или электронном носителе.



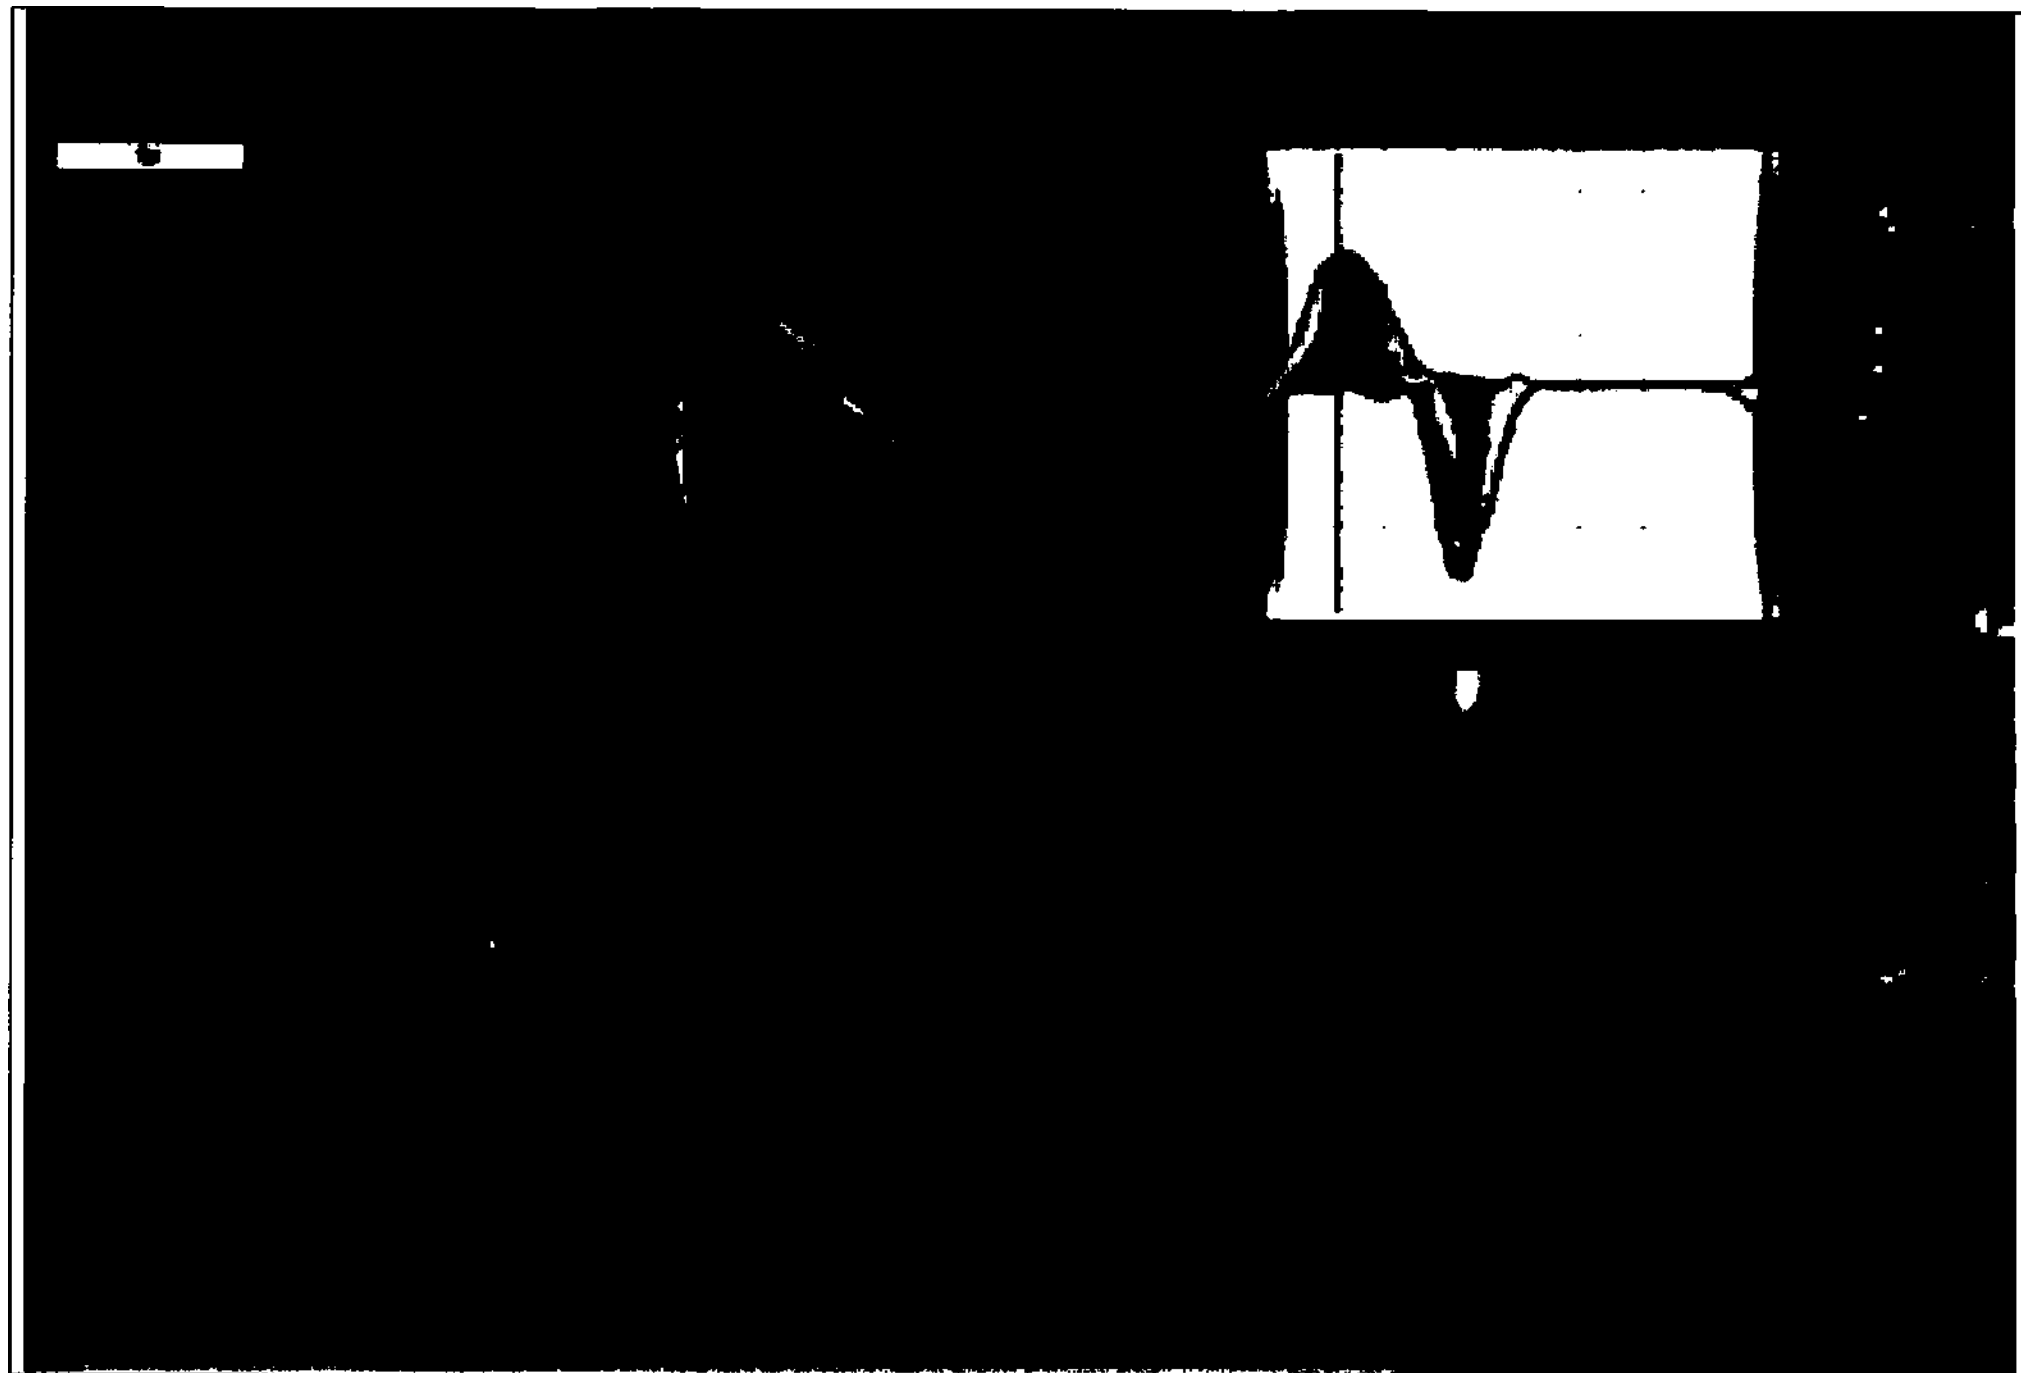
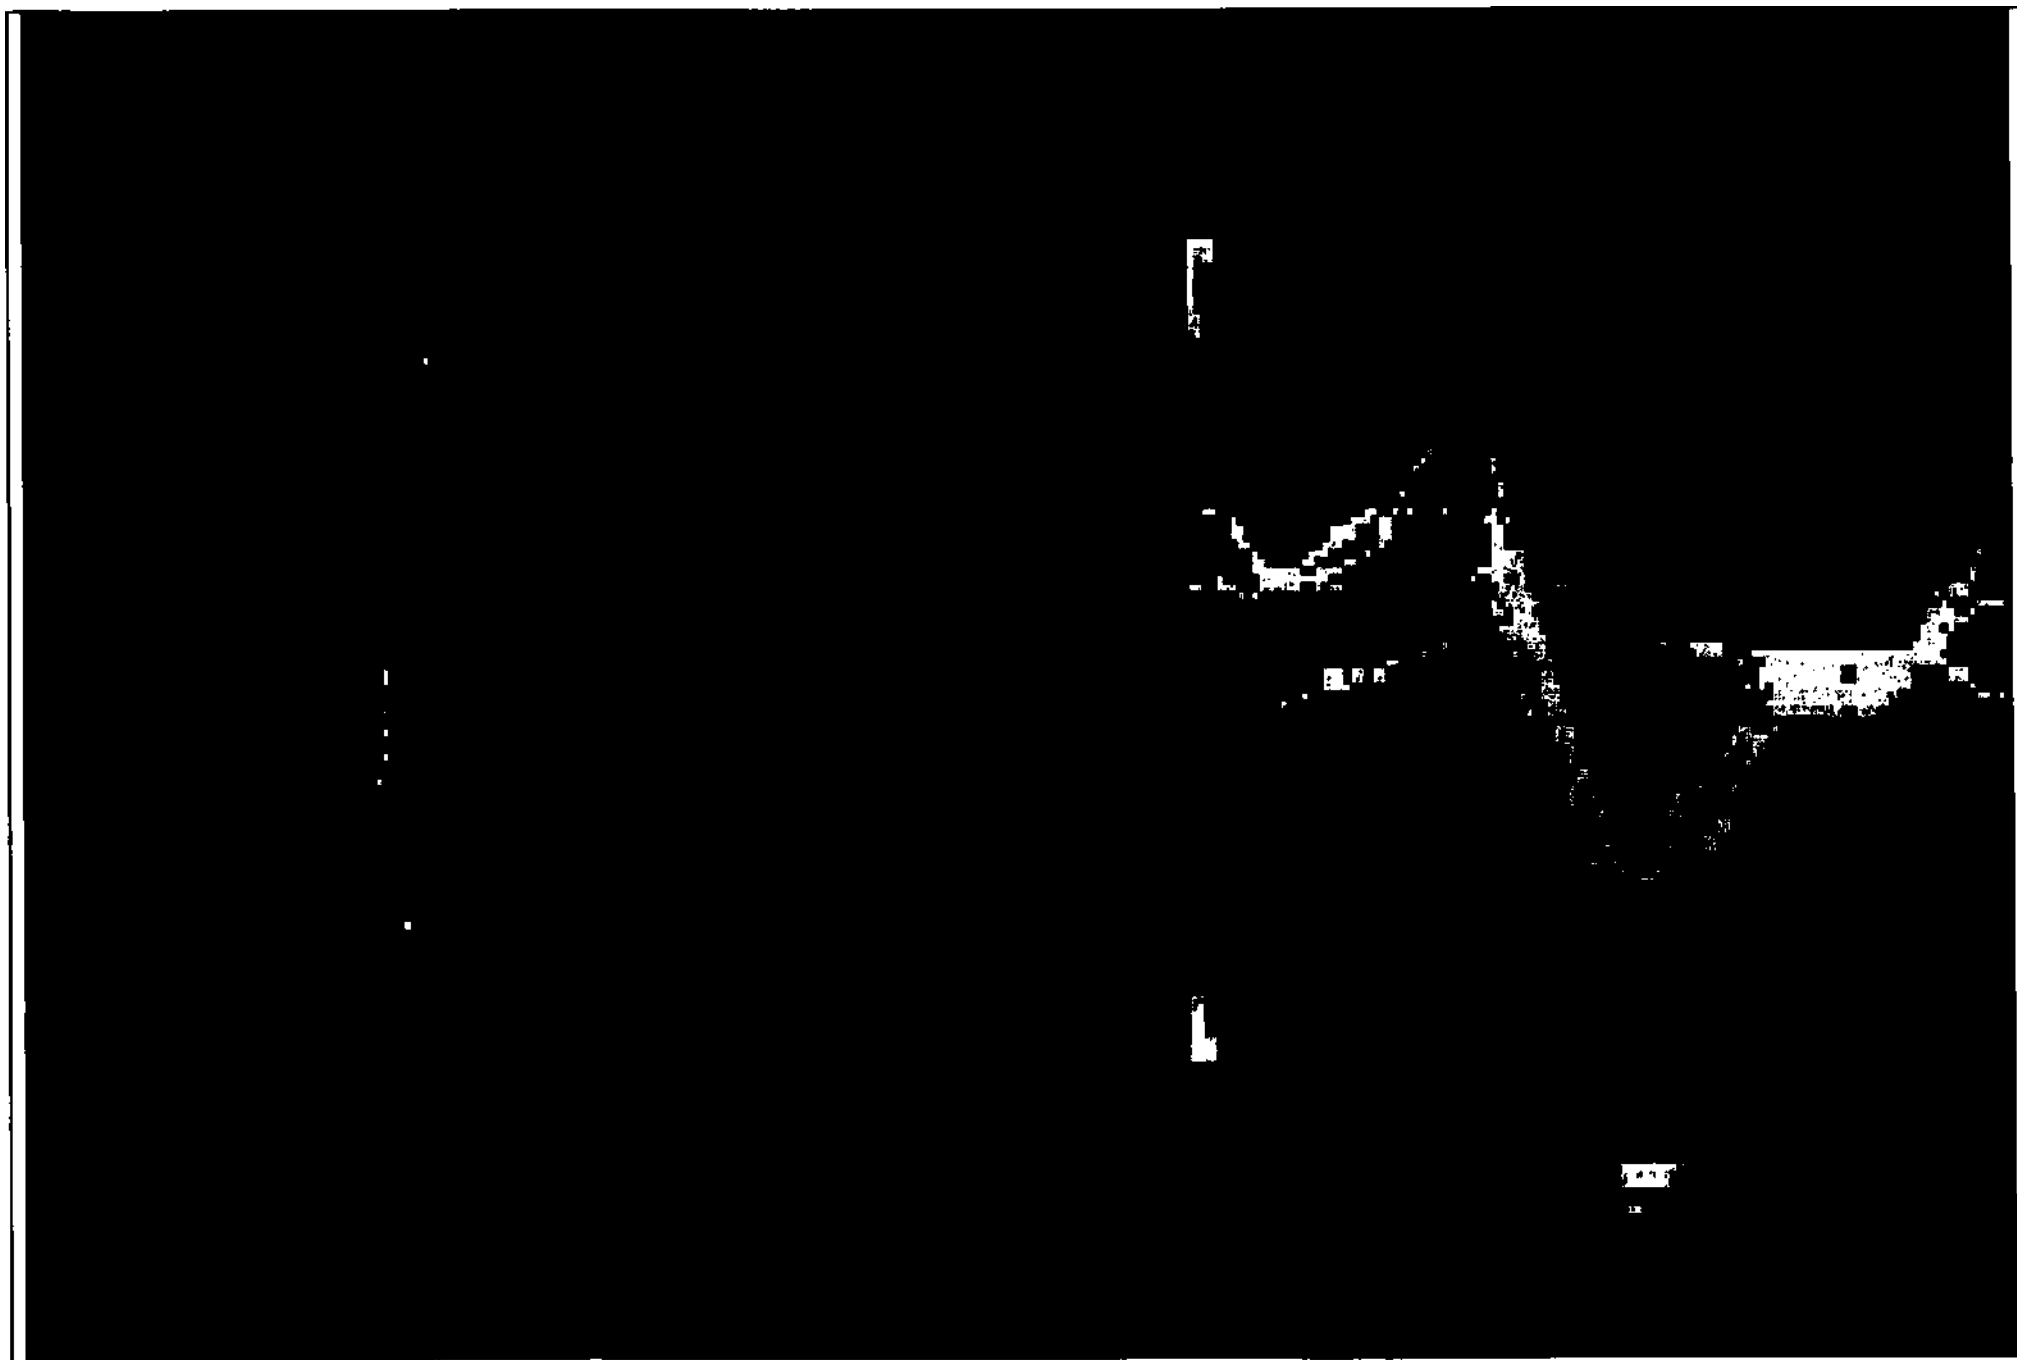






Рисунок 21. Лицензионный ключ для технологии оценки митрального клапана при 3D реконструкции на чреспищеводном датчике (MVA) на оптическом и/или электронном носителе







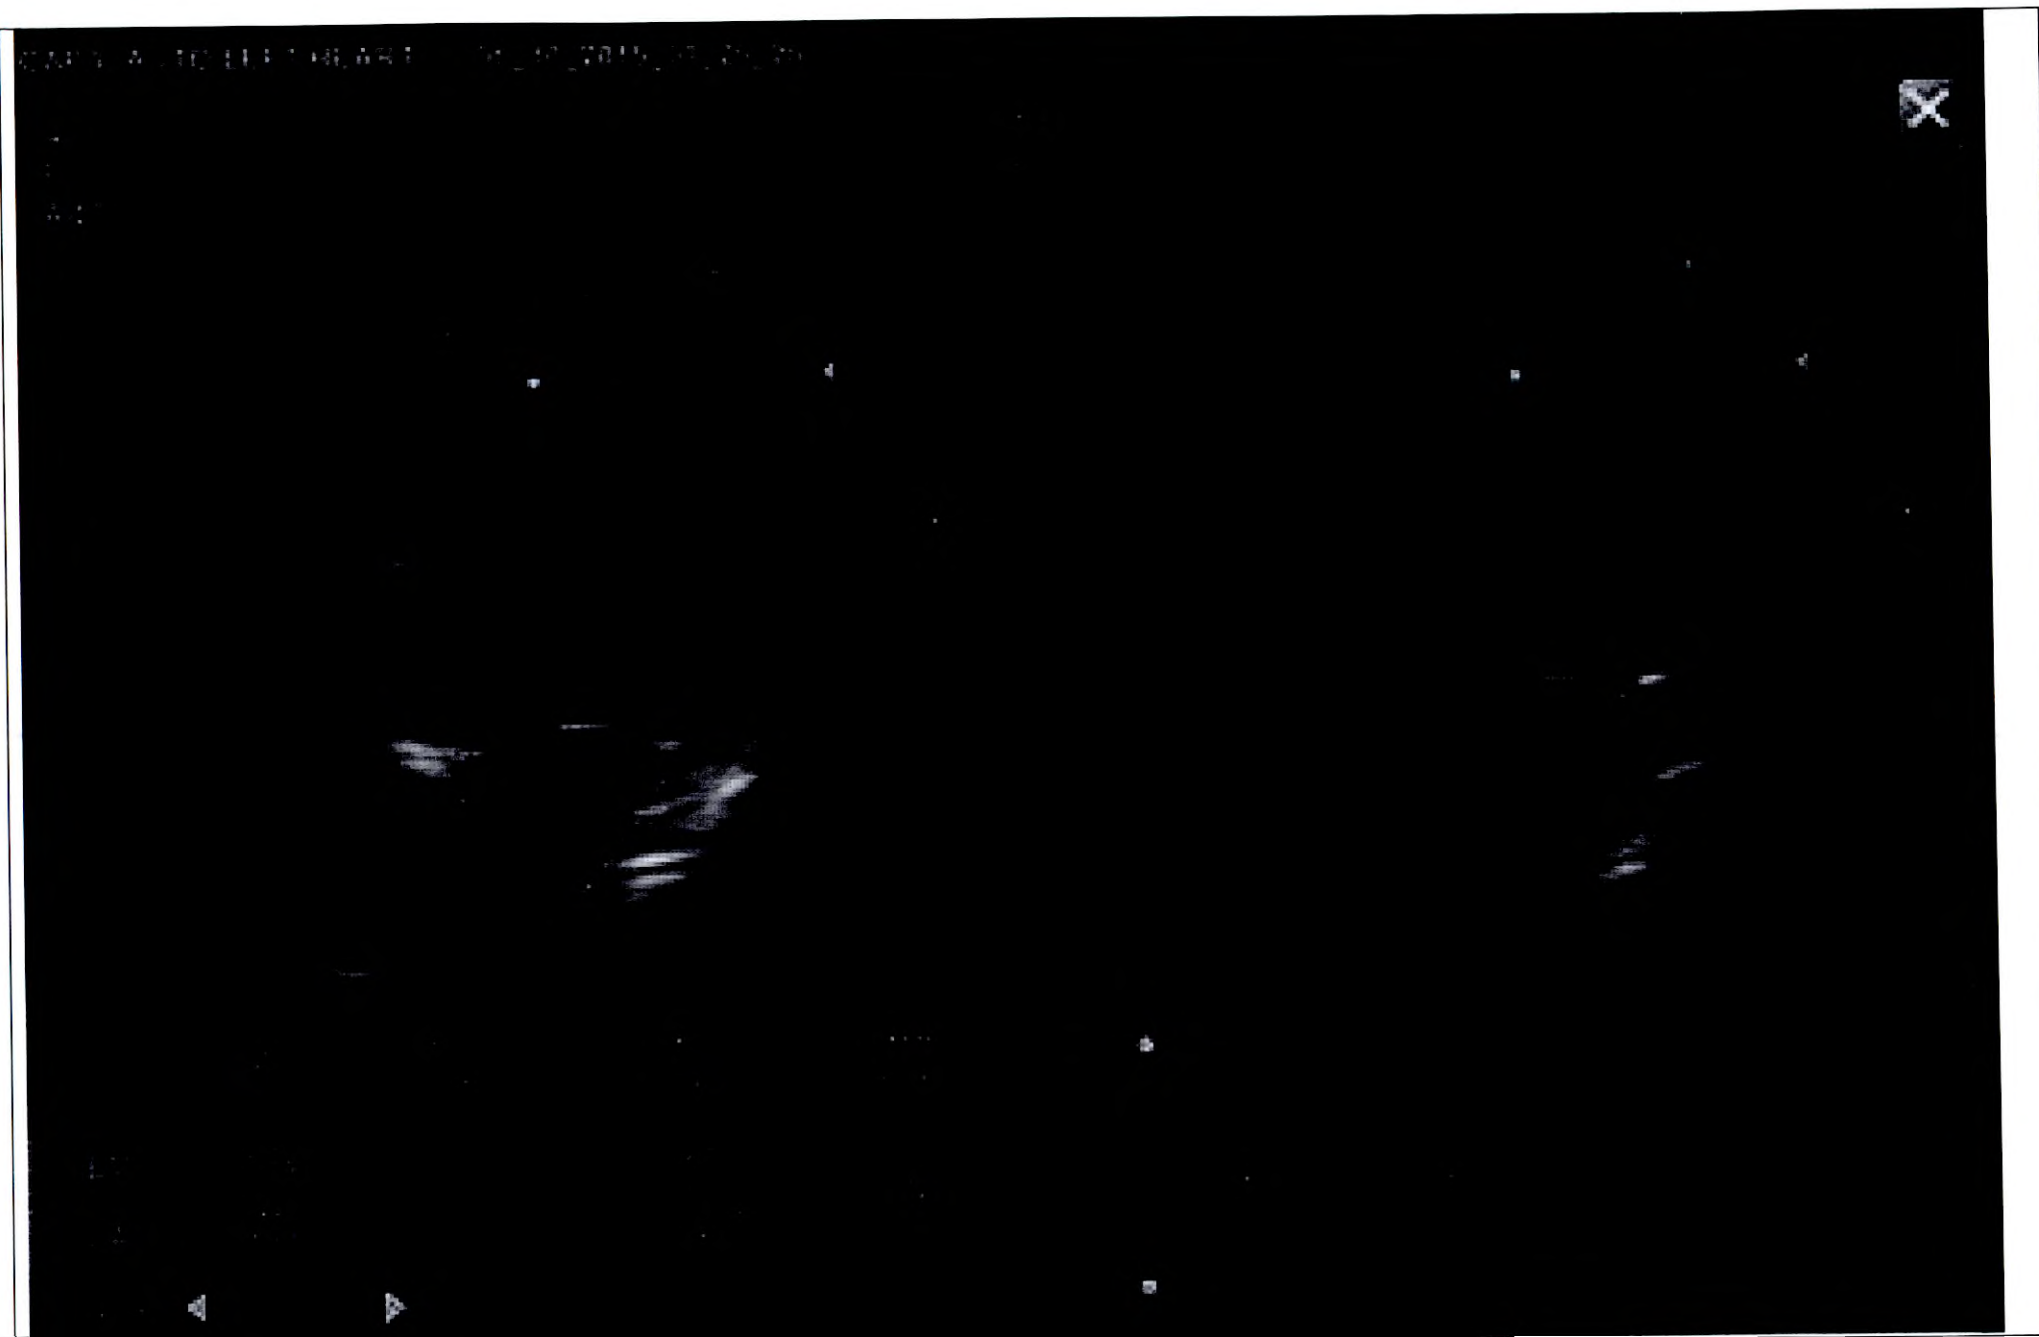


Рисунок 25. Лицензионный ключ для технологии полуавтоматического количественного анализа толщины комплекса интима-медиа сонных артерий (АНР) на оптическом и/или

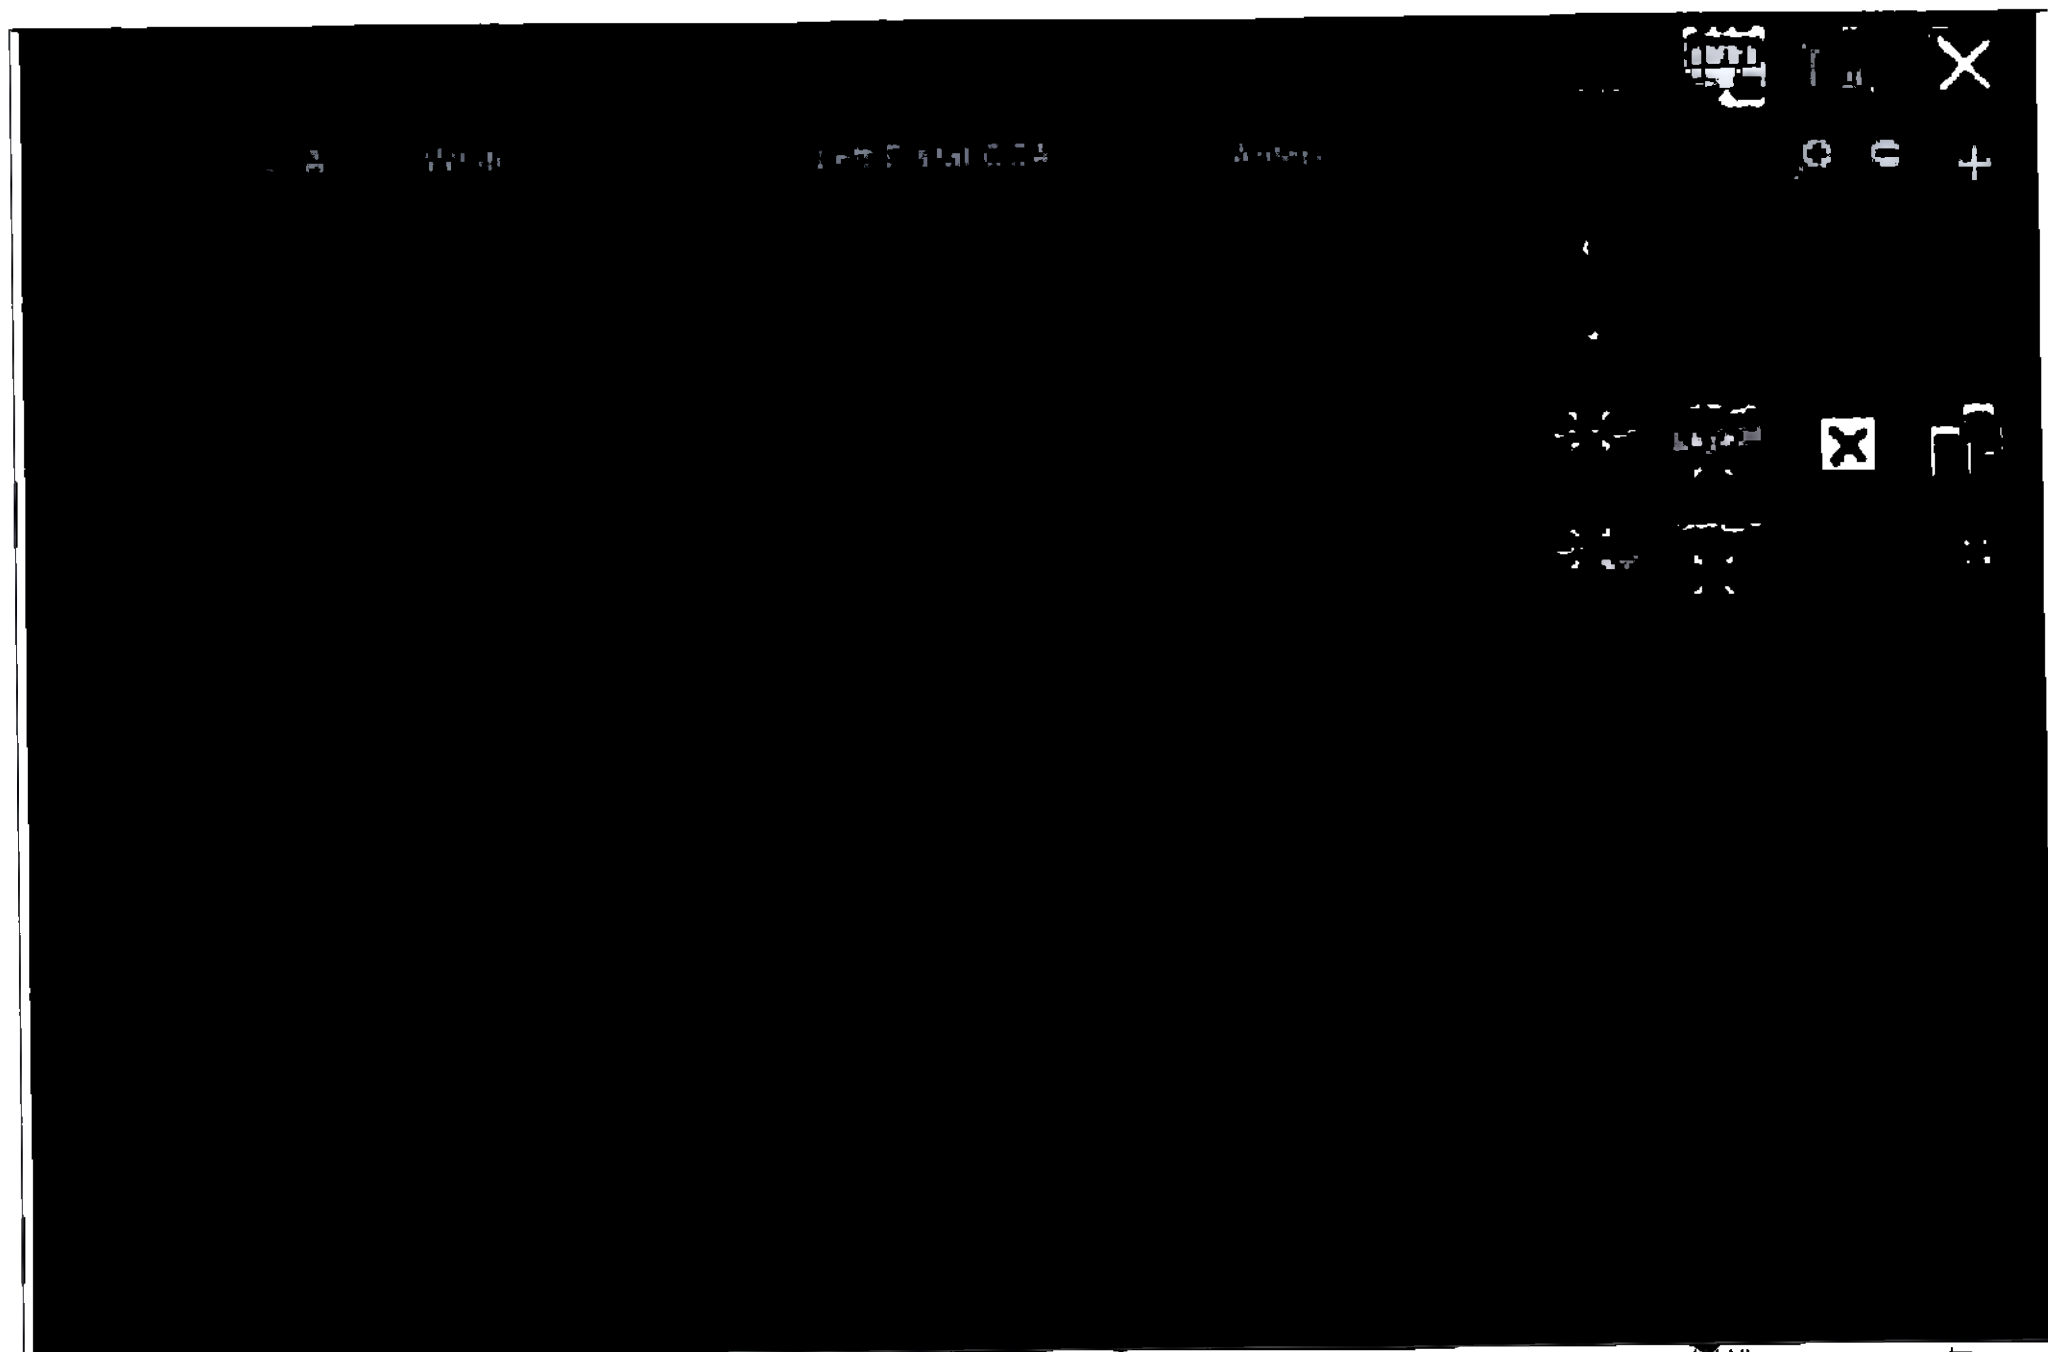


Рисунок 26. Лицензионный ключ для технологии автоматического количественного анализа объемов левого желудочка или левого предсердия (ALH) на оптическом или






Рисунок 28. Лицензионный ключ для технологии полуавтоматического количественного анализа фракции выброса и объемов левого желудочка (Axius EF) на оптическом

и/или спектральном анализе



#4.2  
Cardiac  
0 dB  
2.2 MHz  
977 Hz  
Filter 1  
Phase 10  
R/S 1  
Map 0  
Priority 1  
Smooth 2  
Flow 1  
11 fps  
DTCE Low

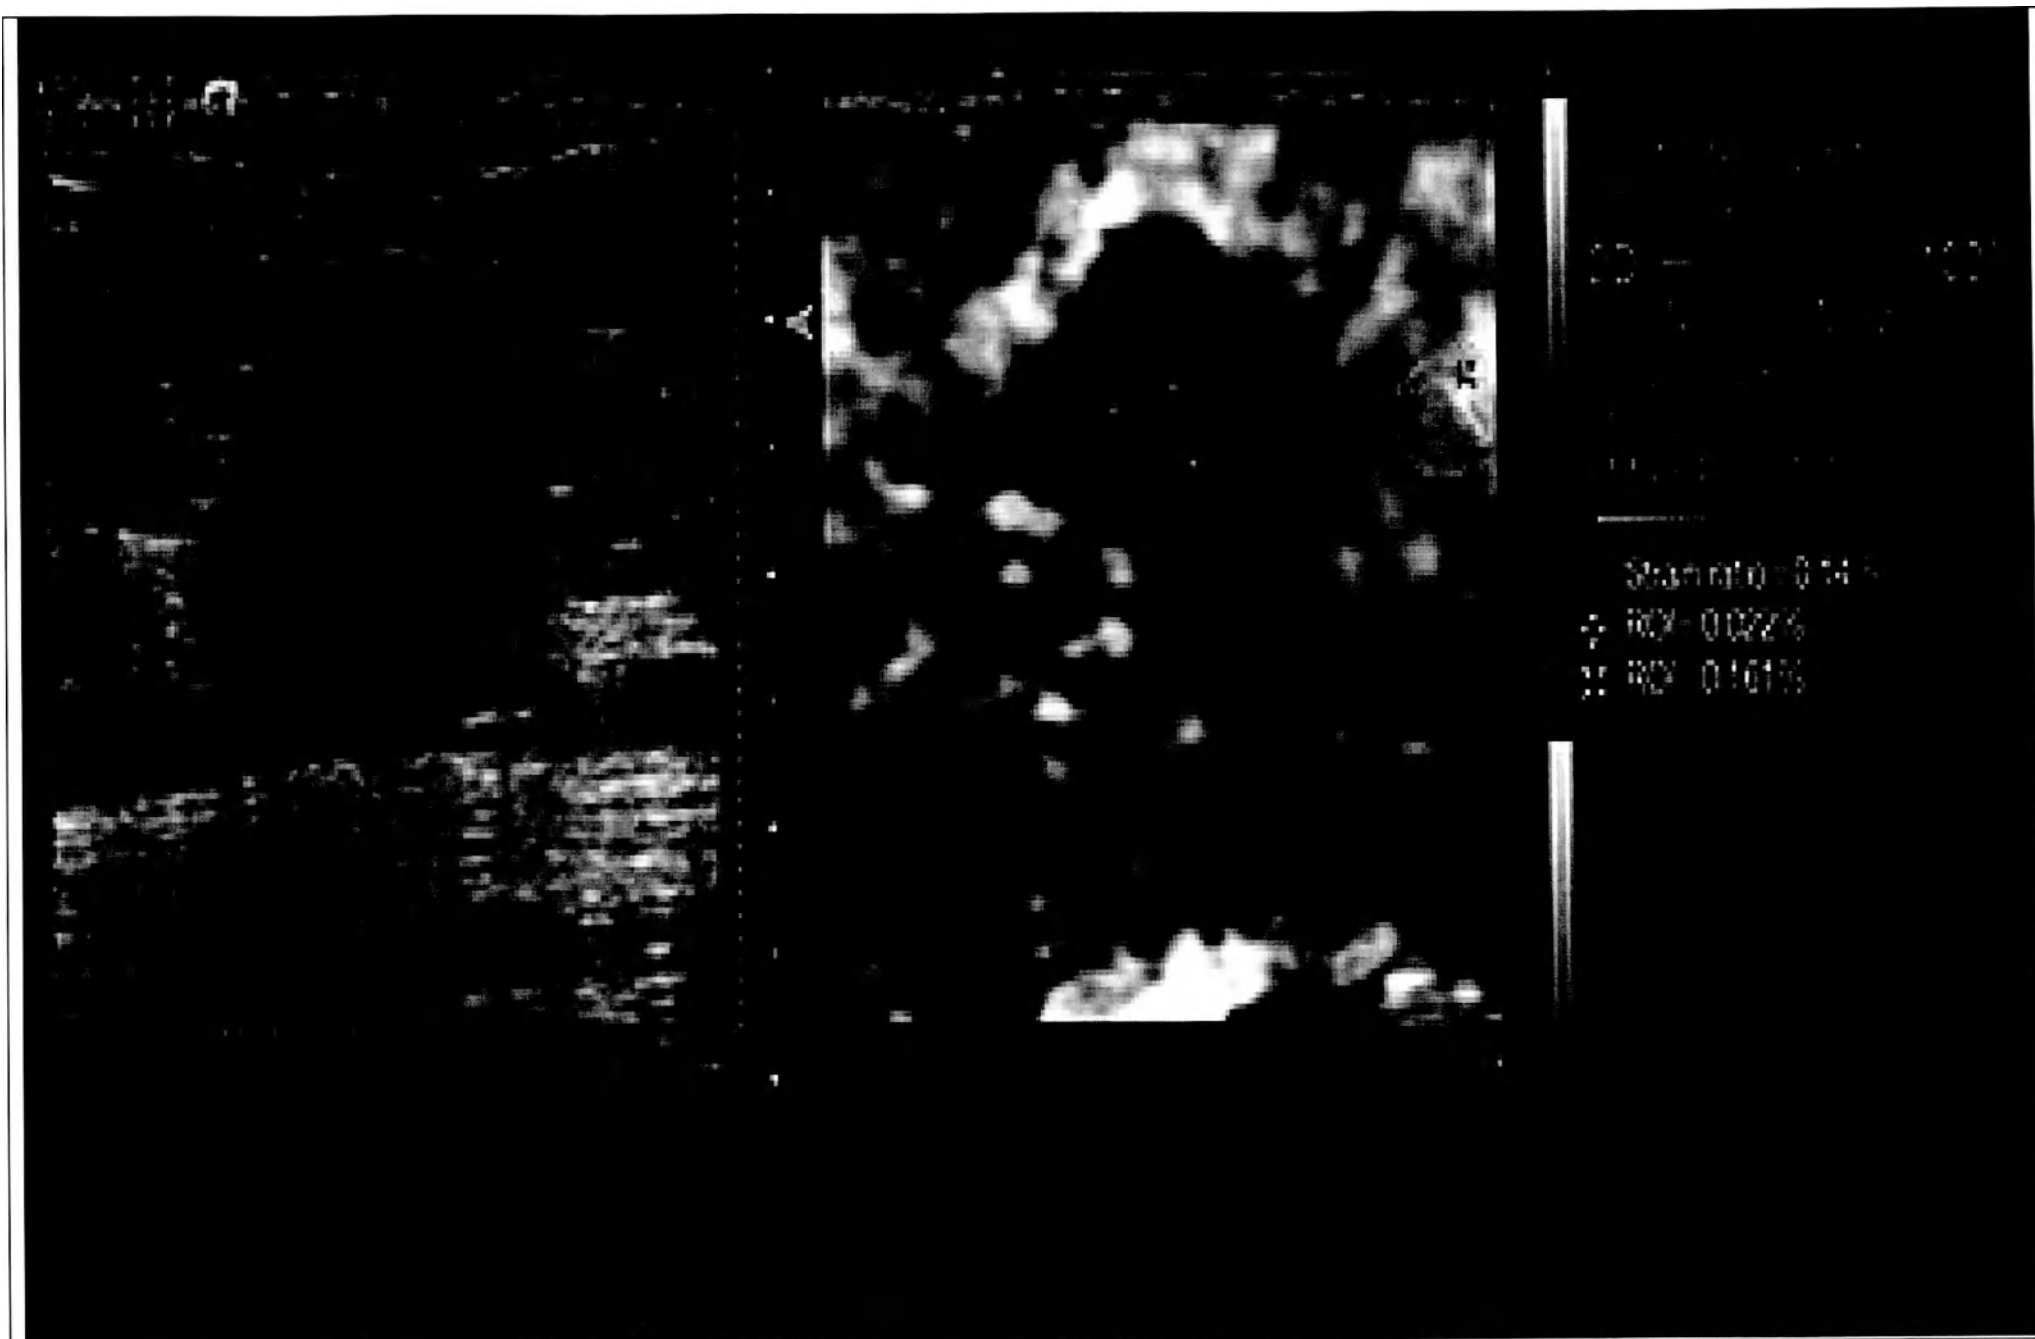
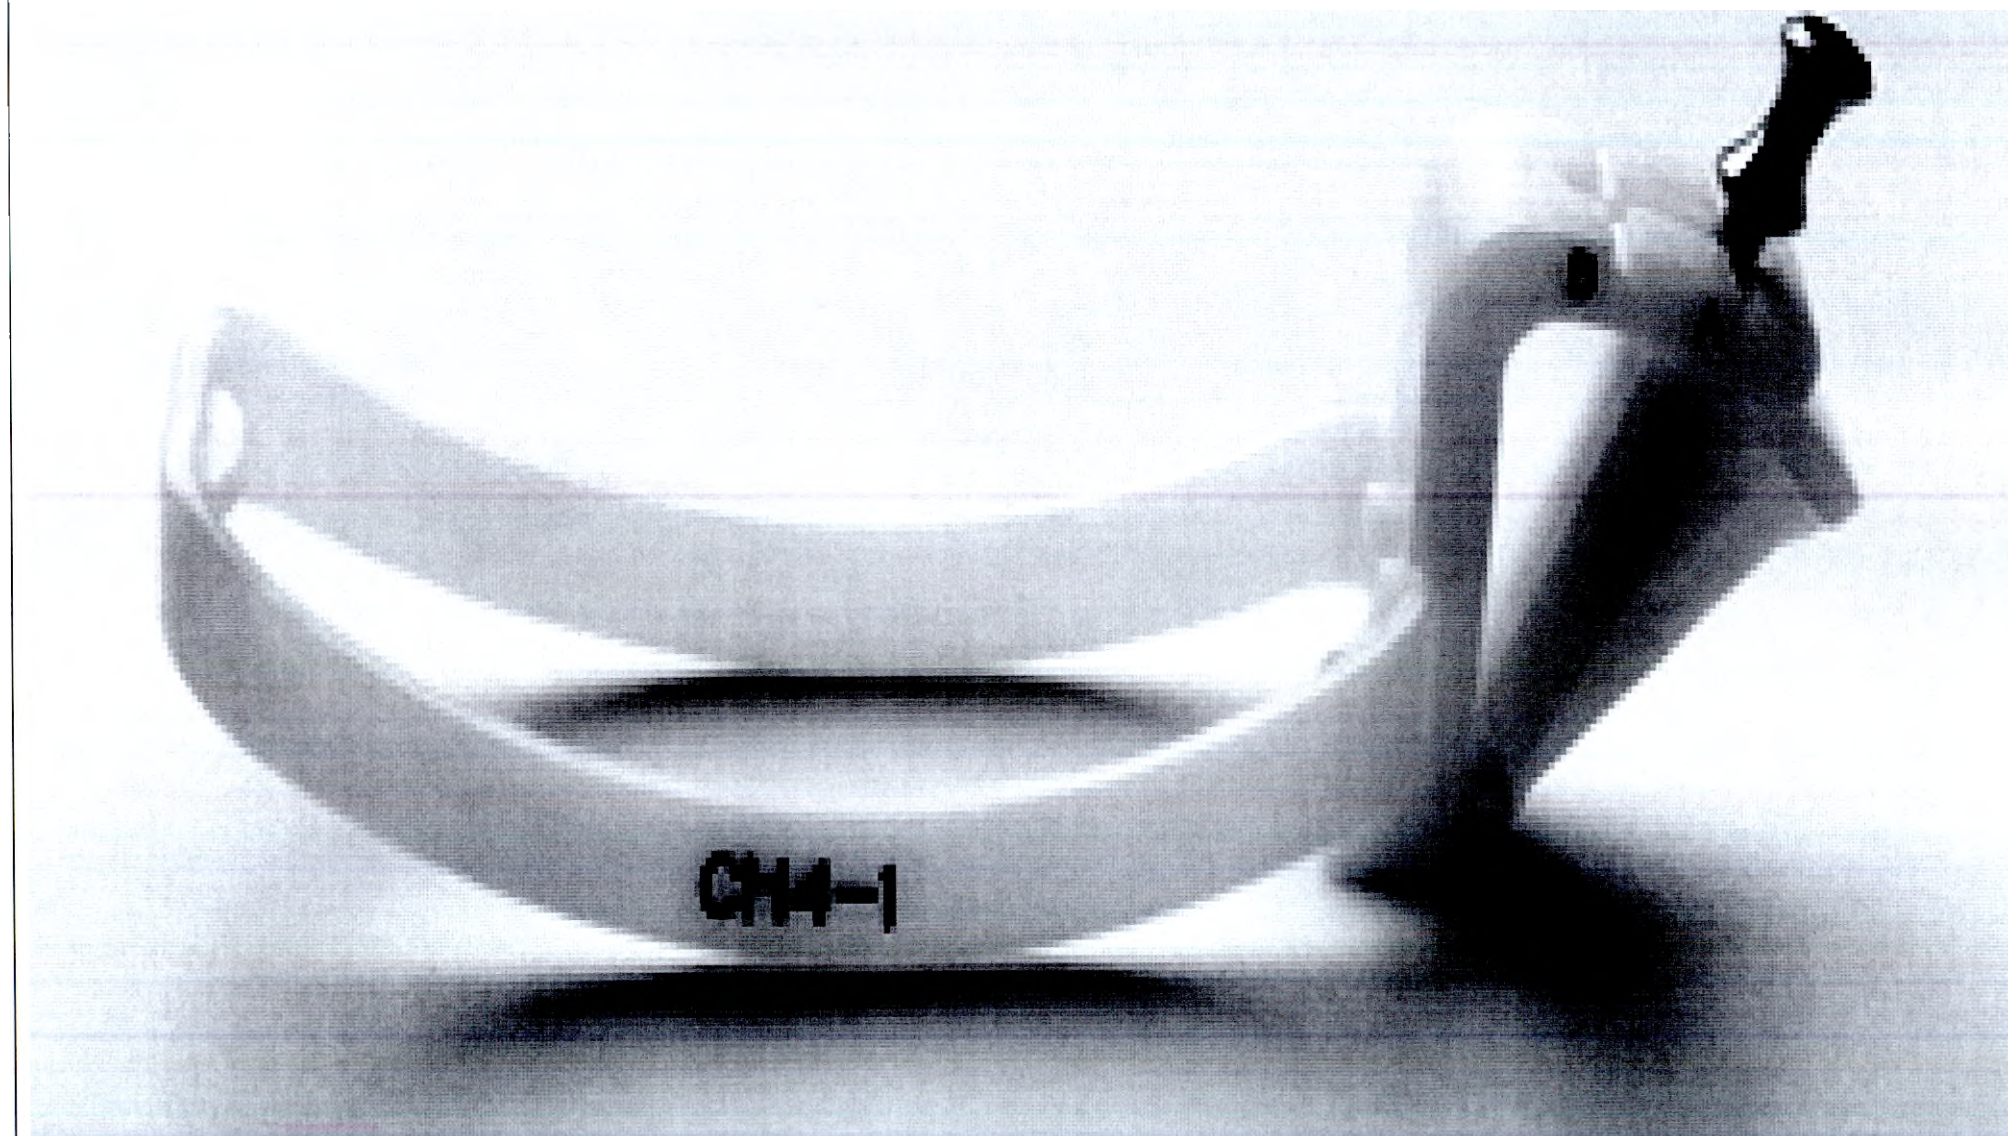
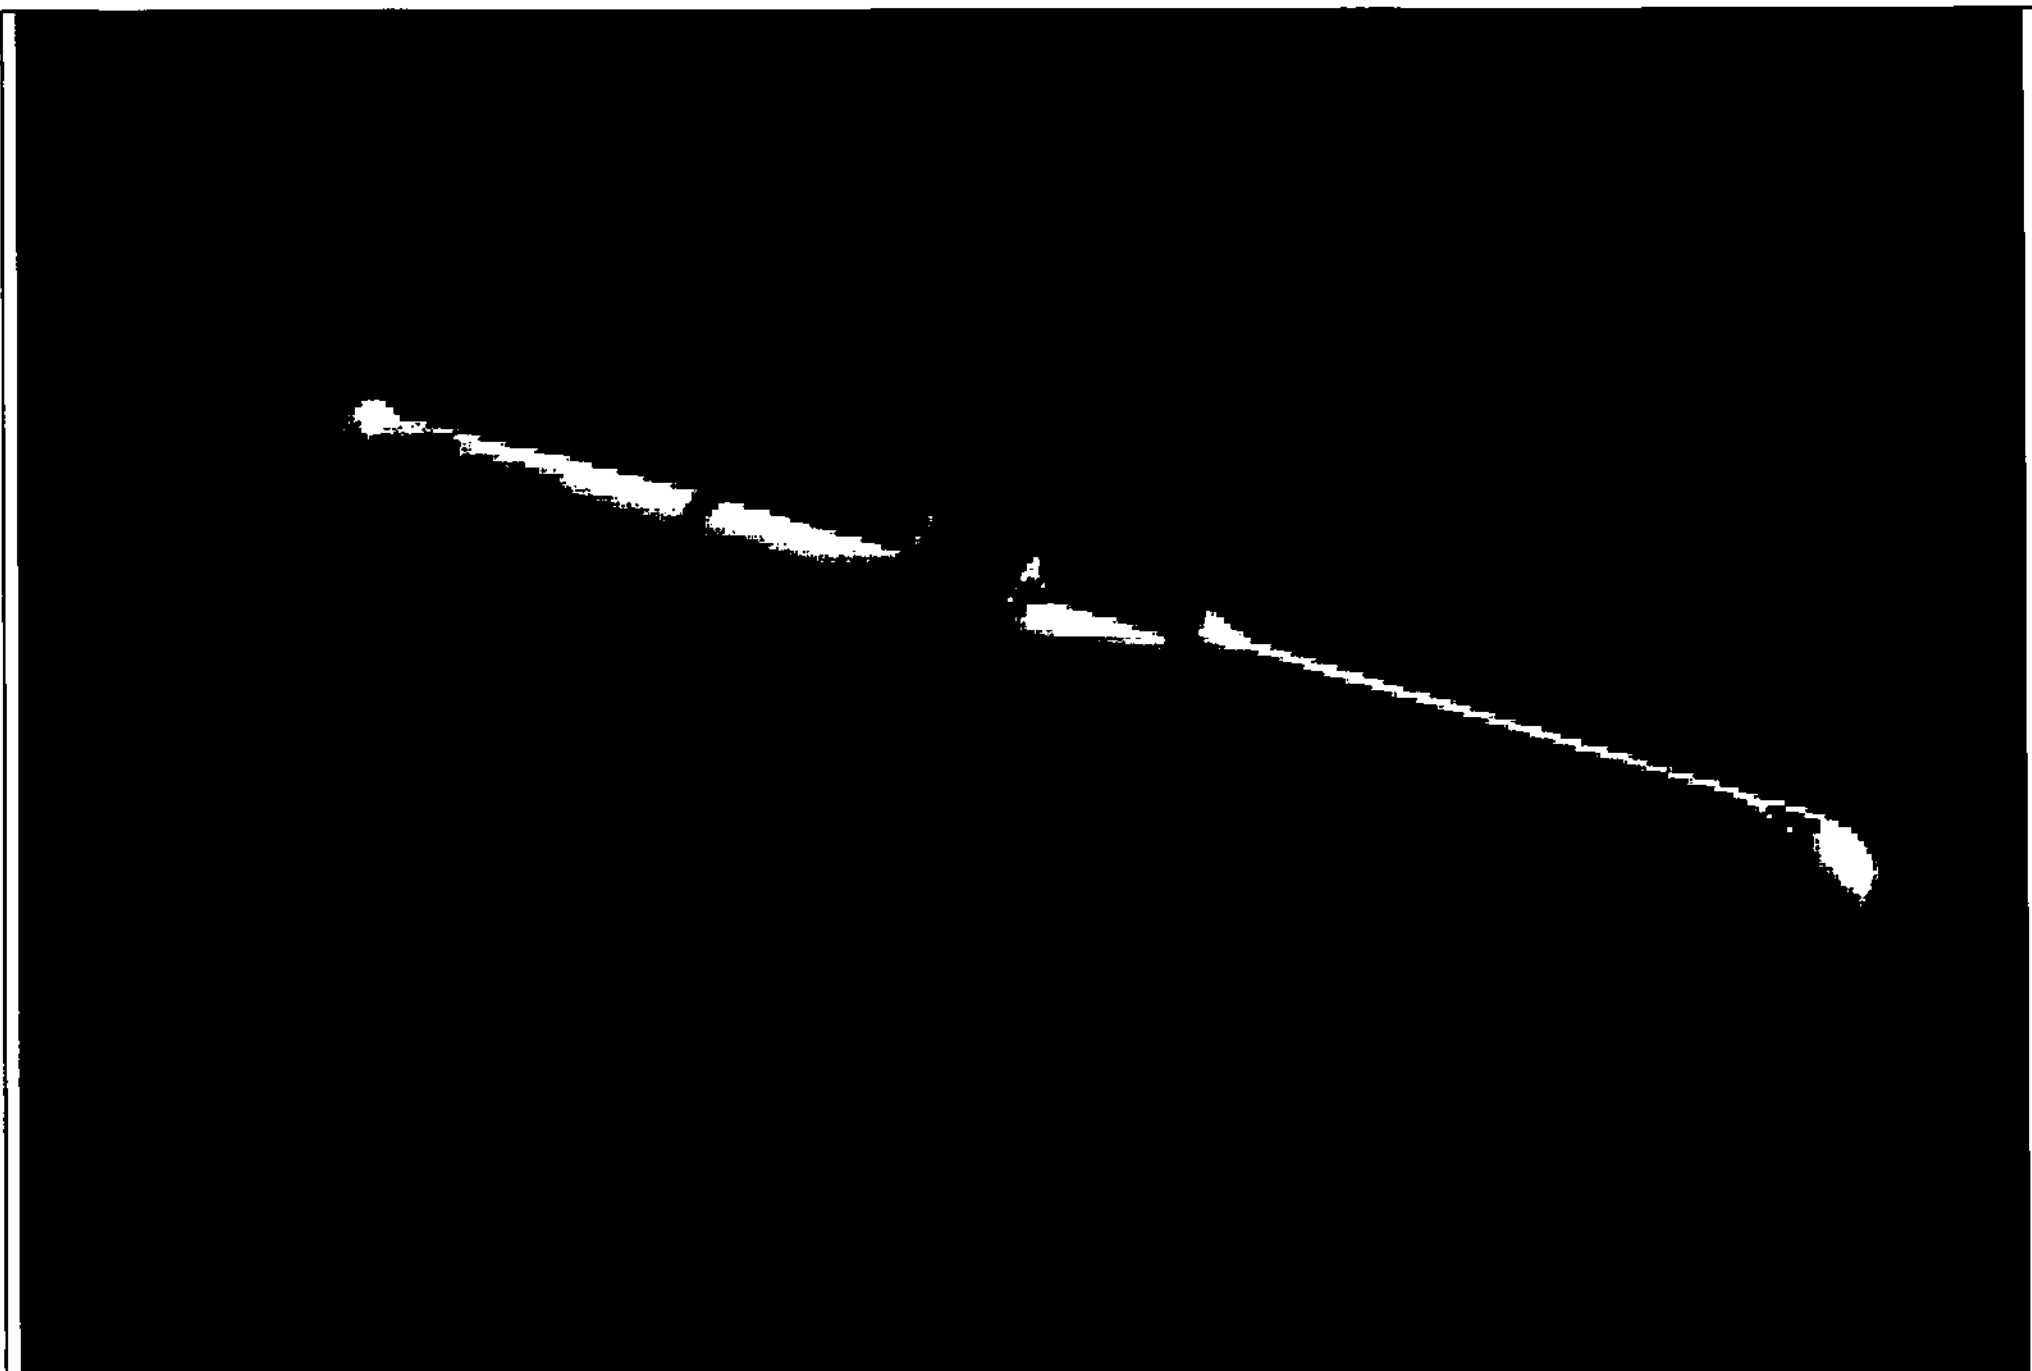
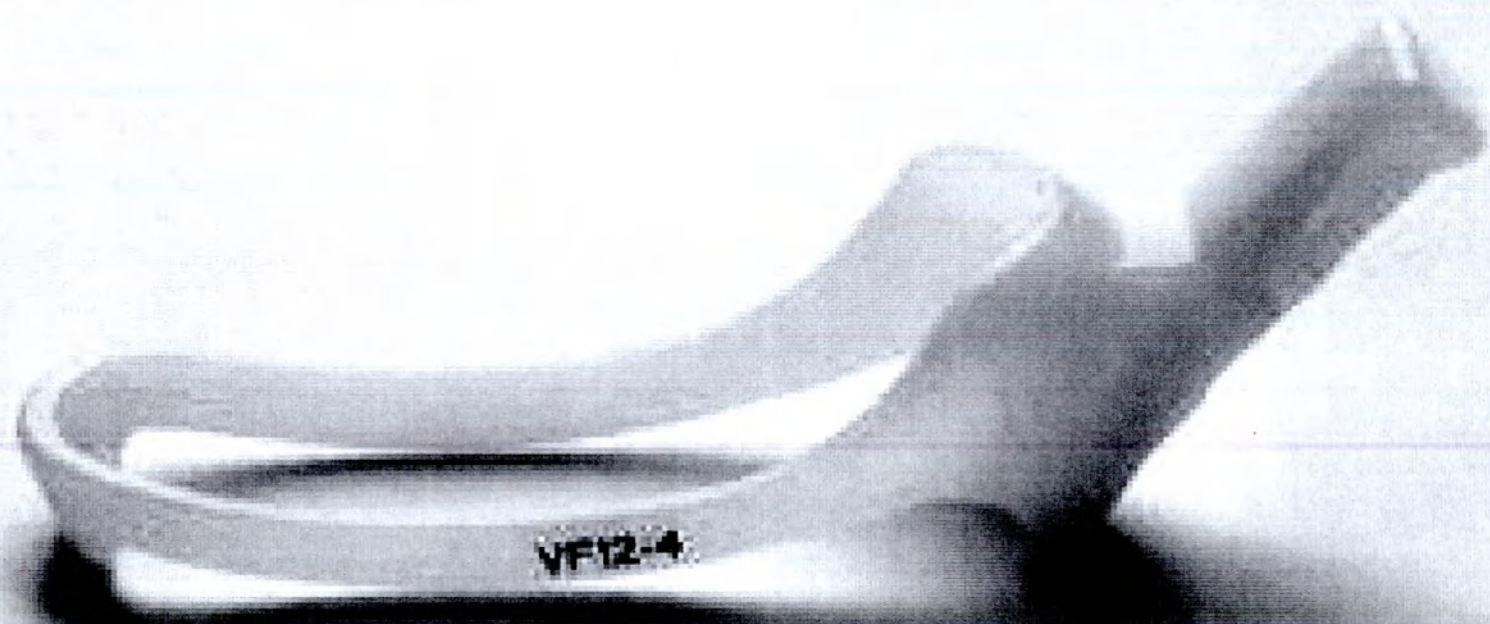



Рисунок 31. Лицензионный ключ для функции количественного метода сравнения относительной эластичности ткани между двумя областями интереса (Strain Ratio) на












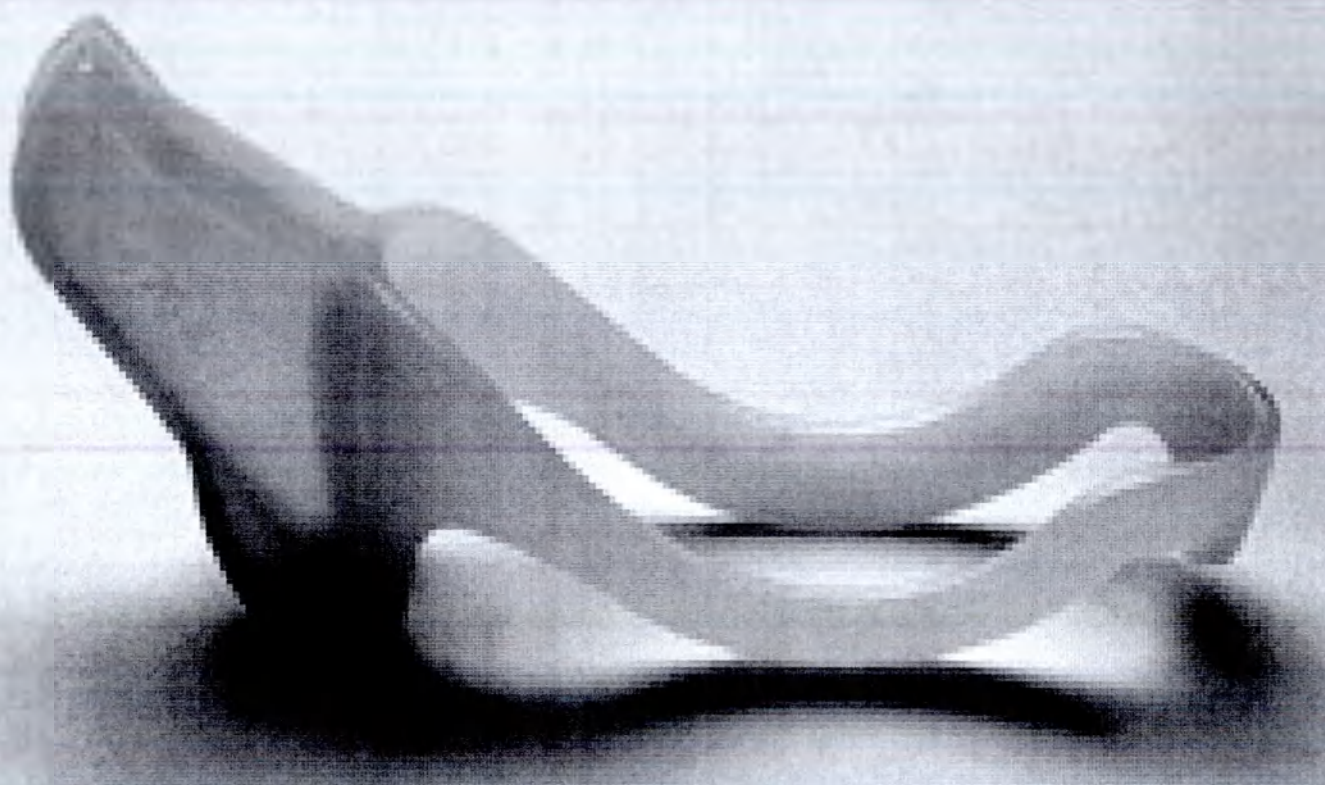


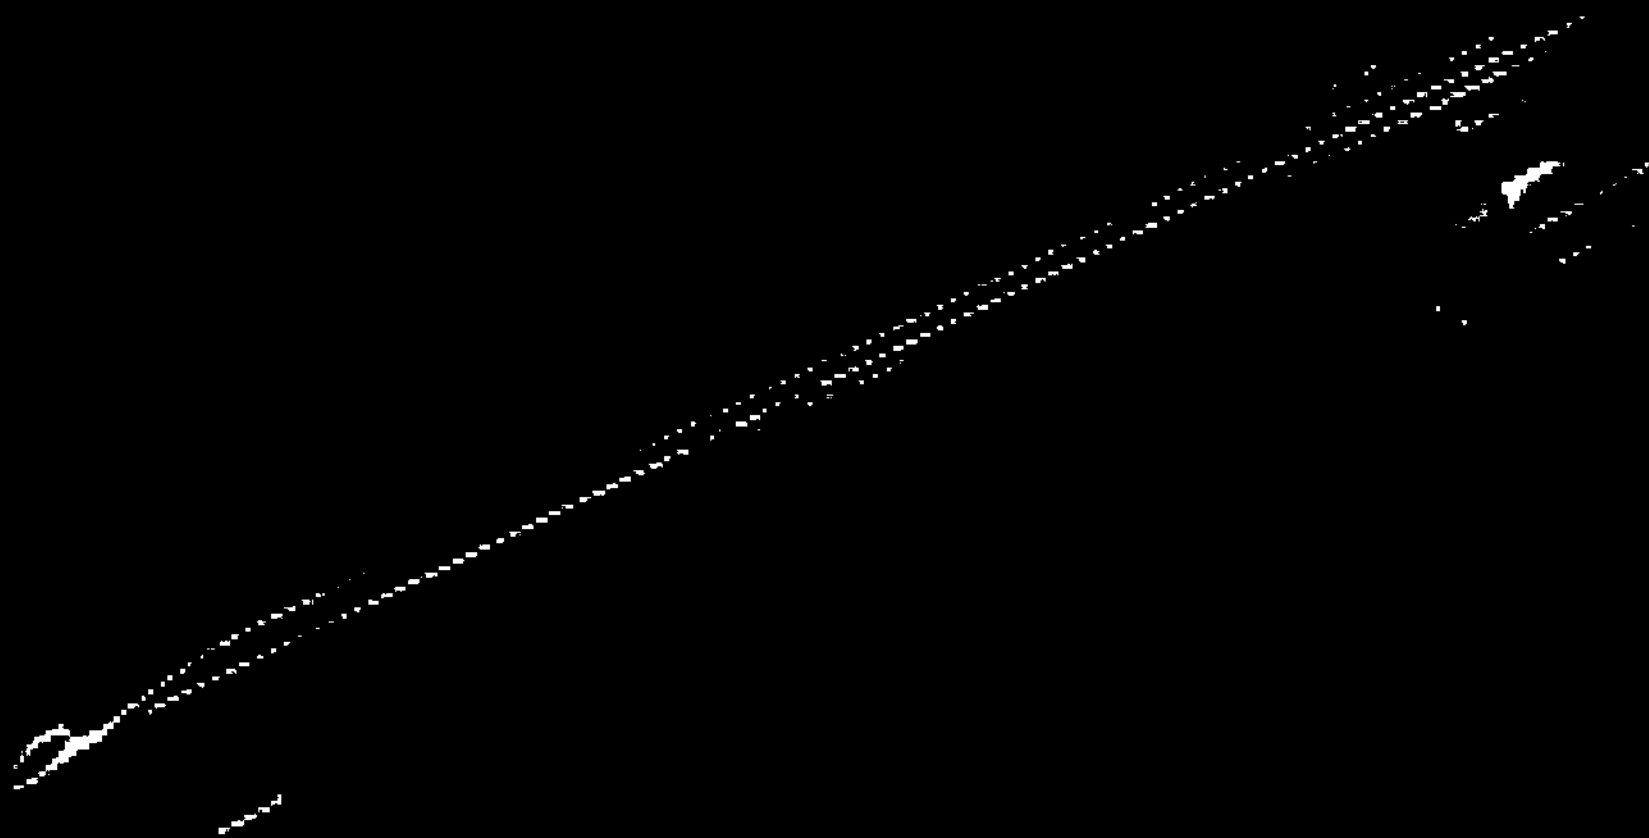

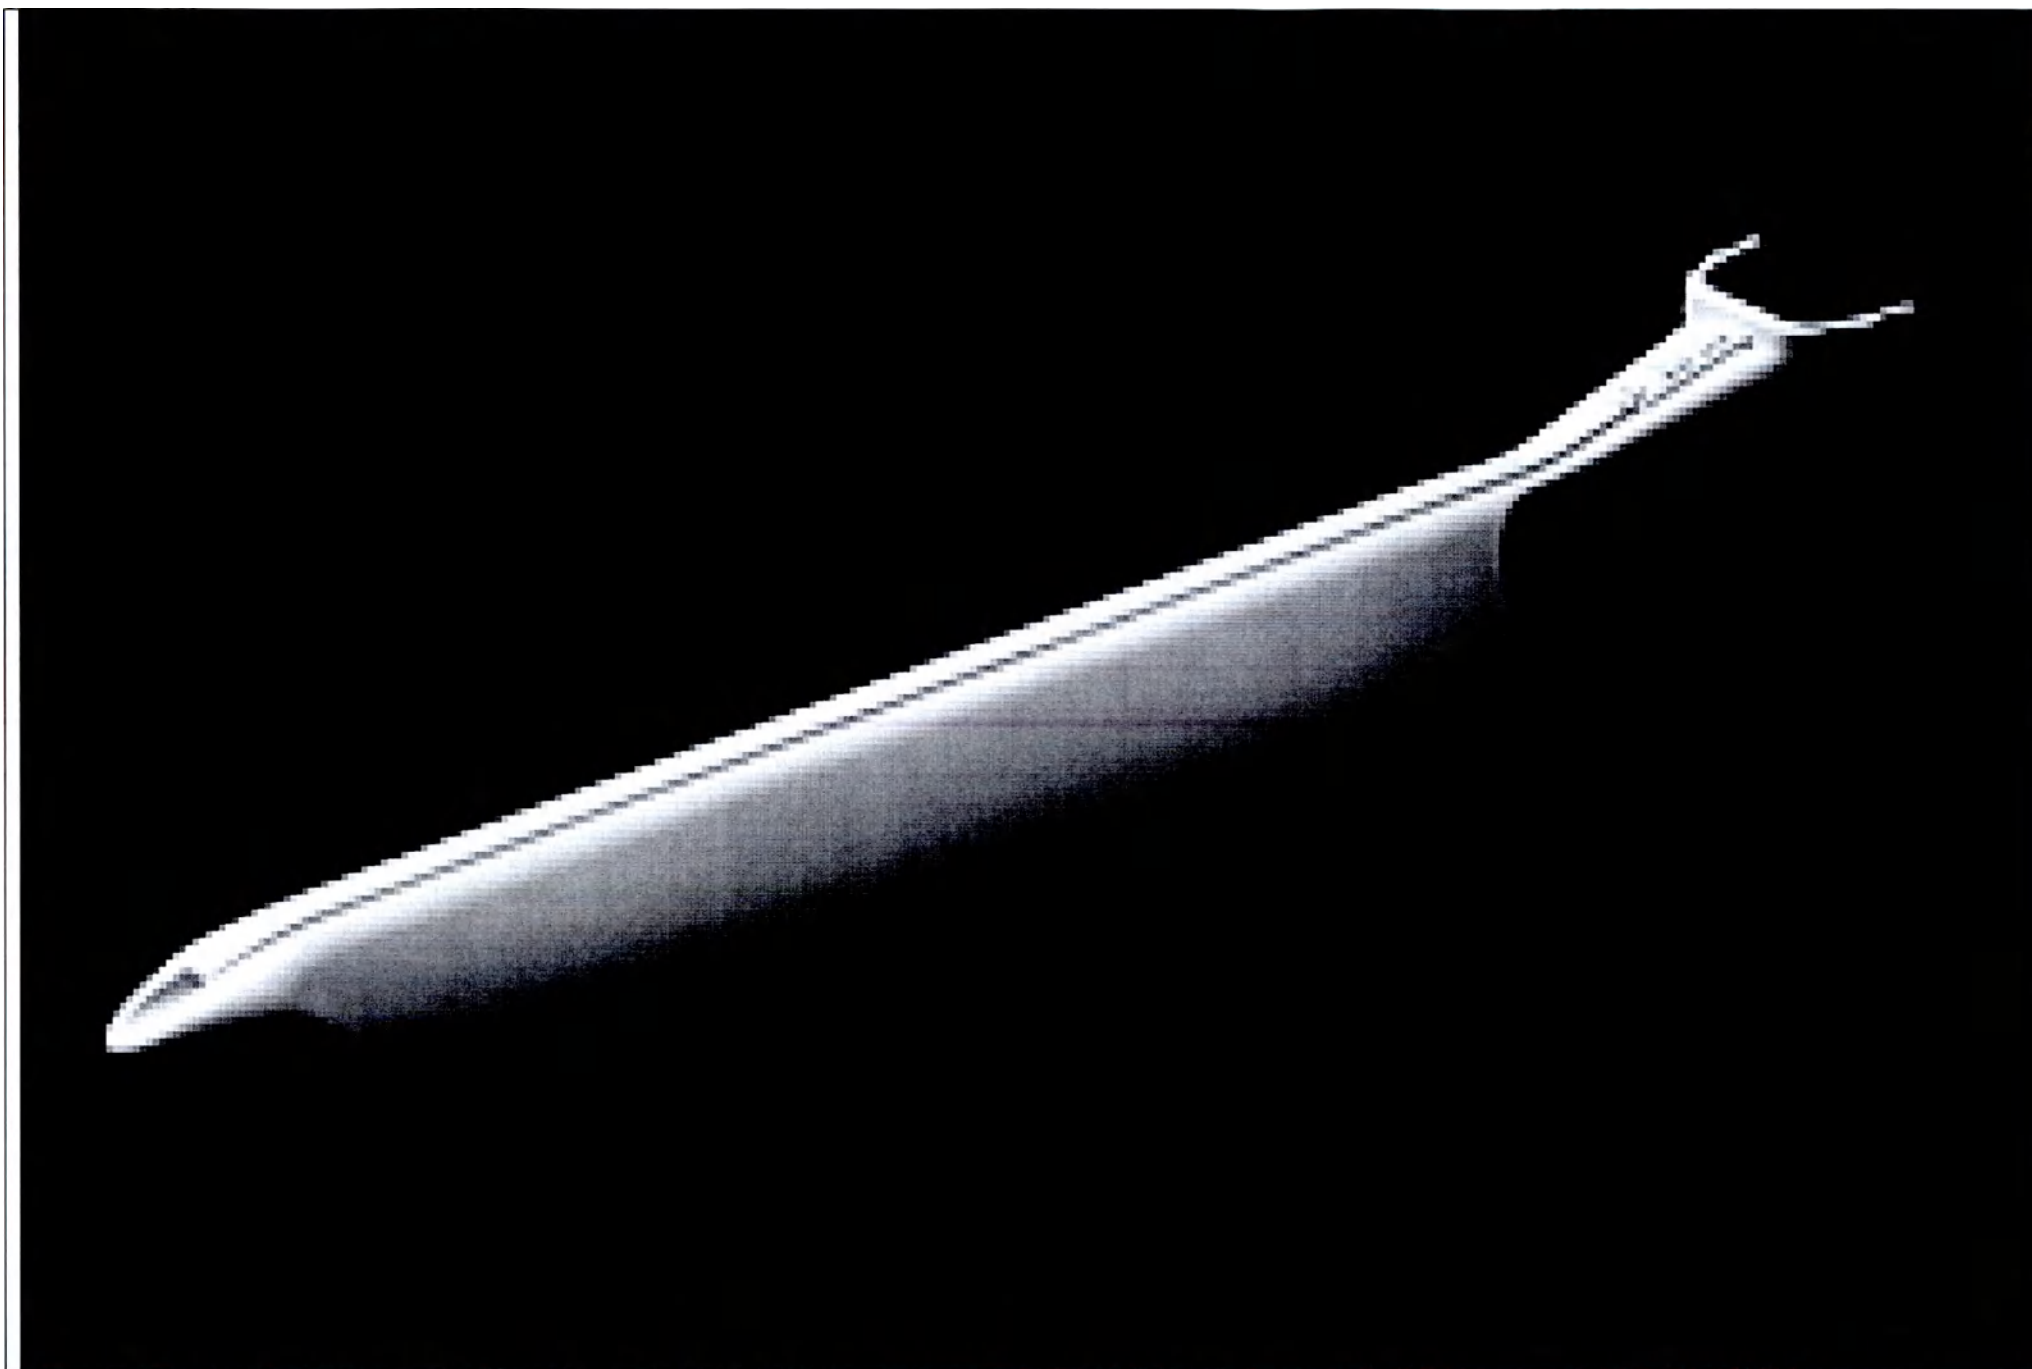

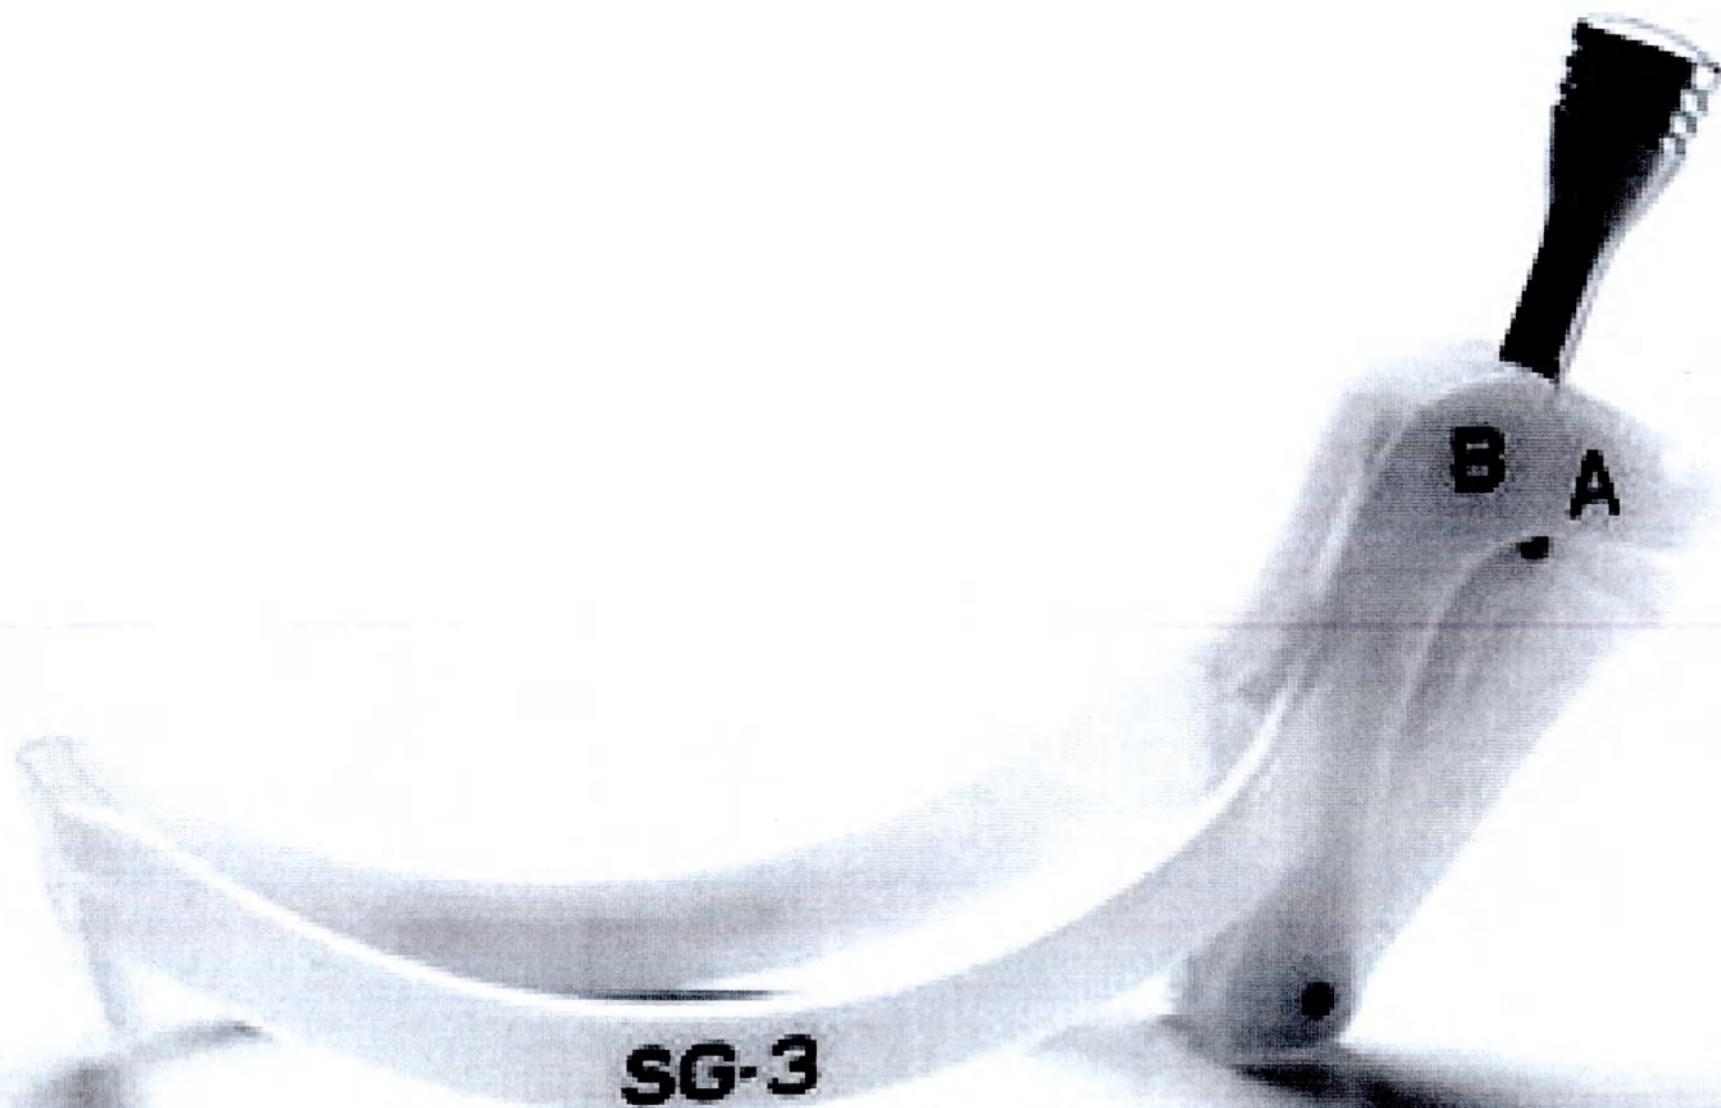



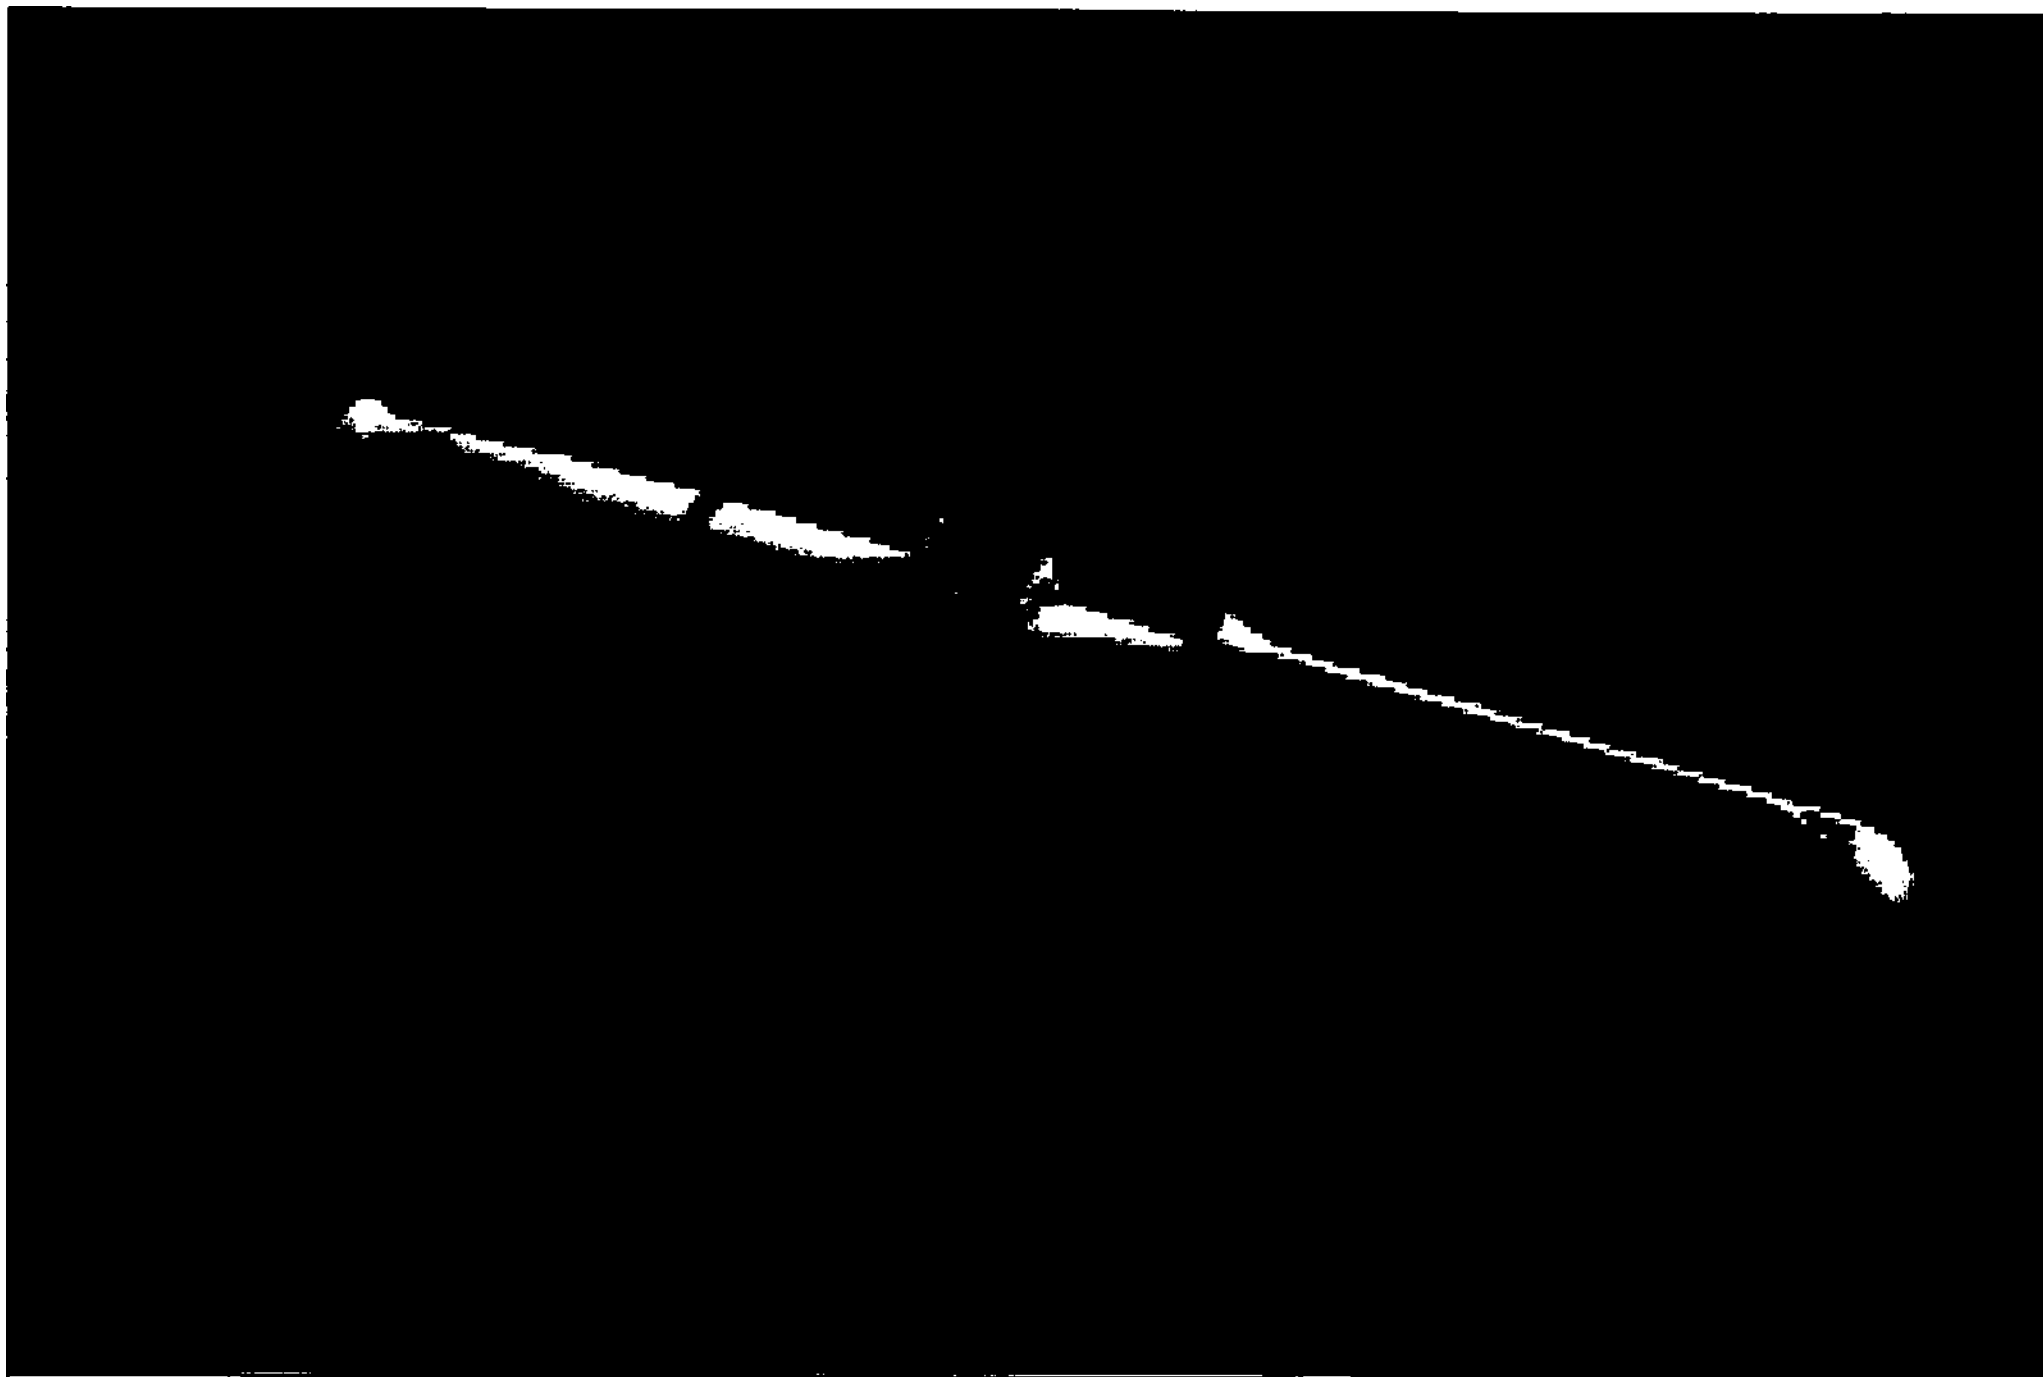

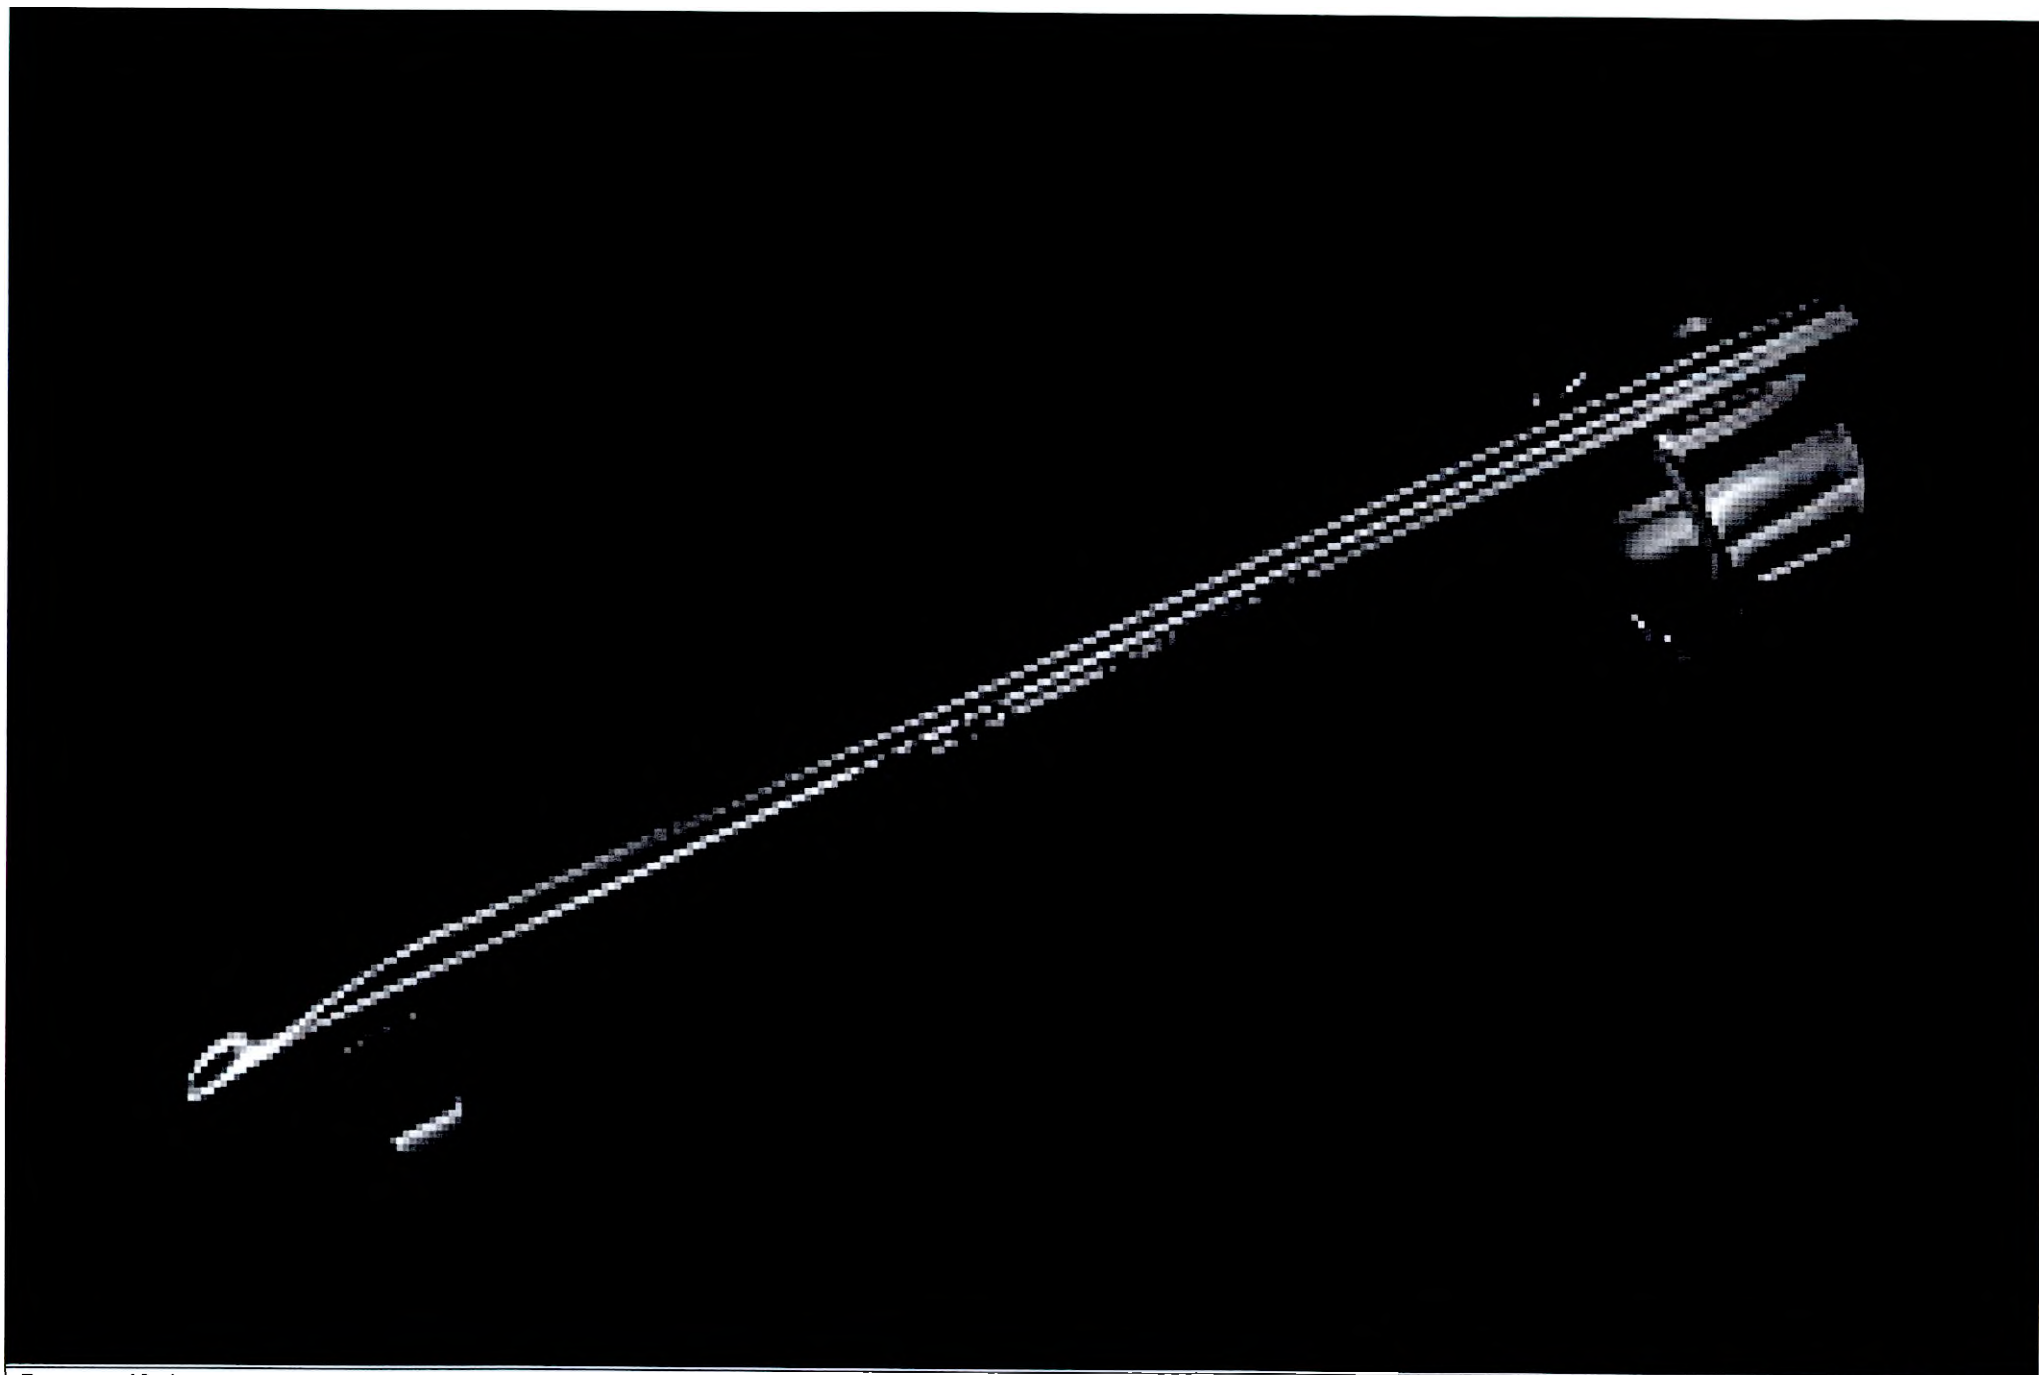
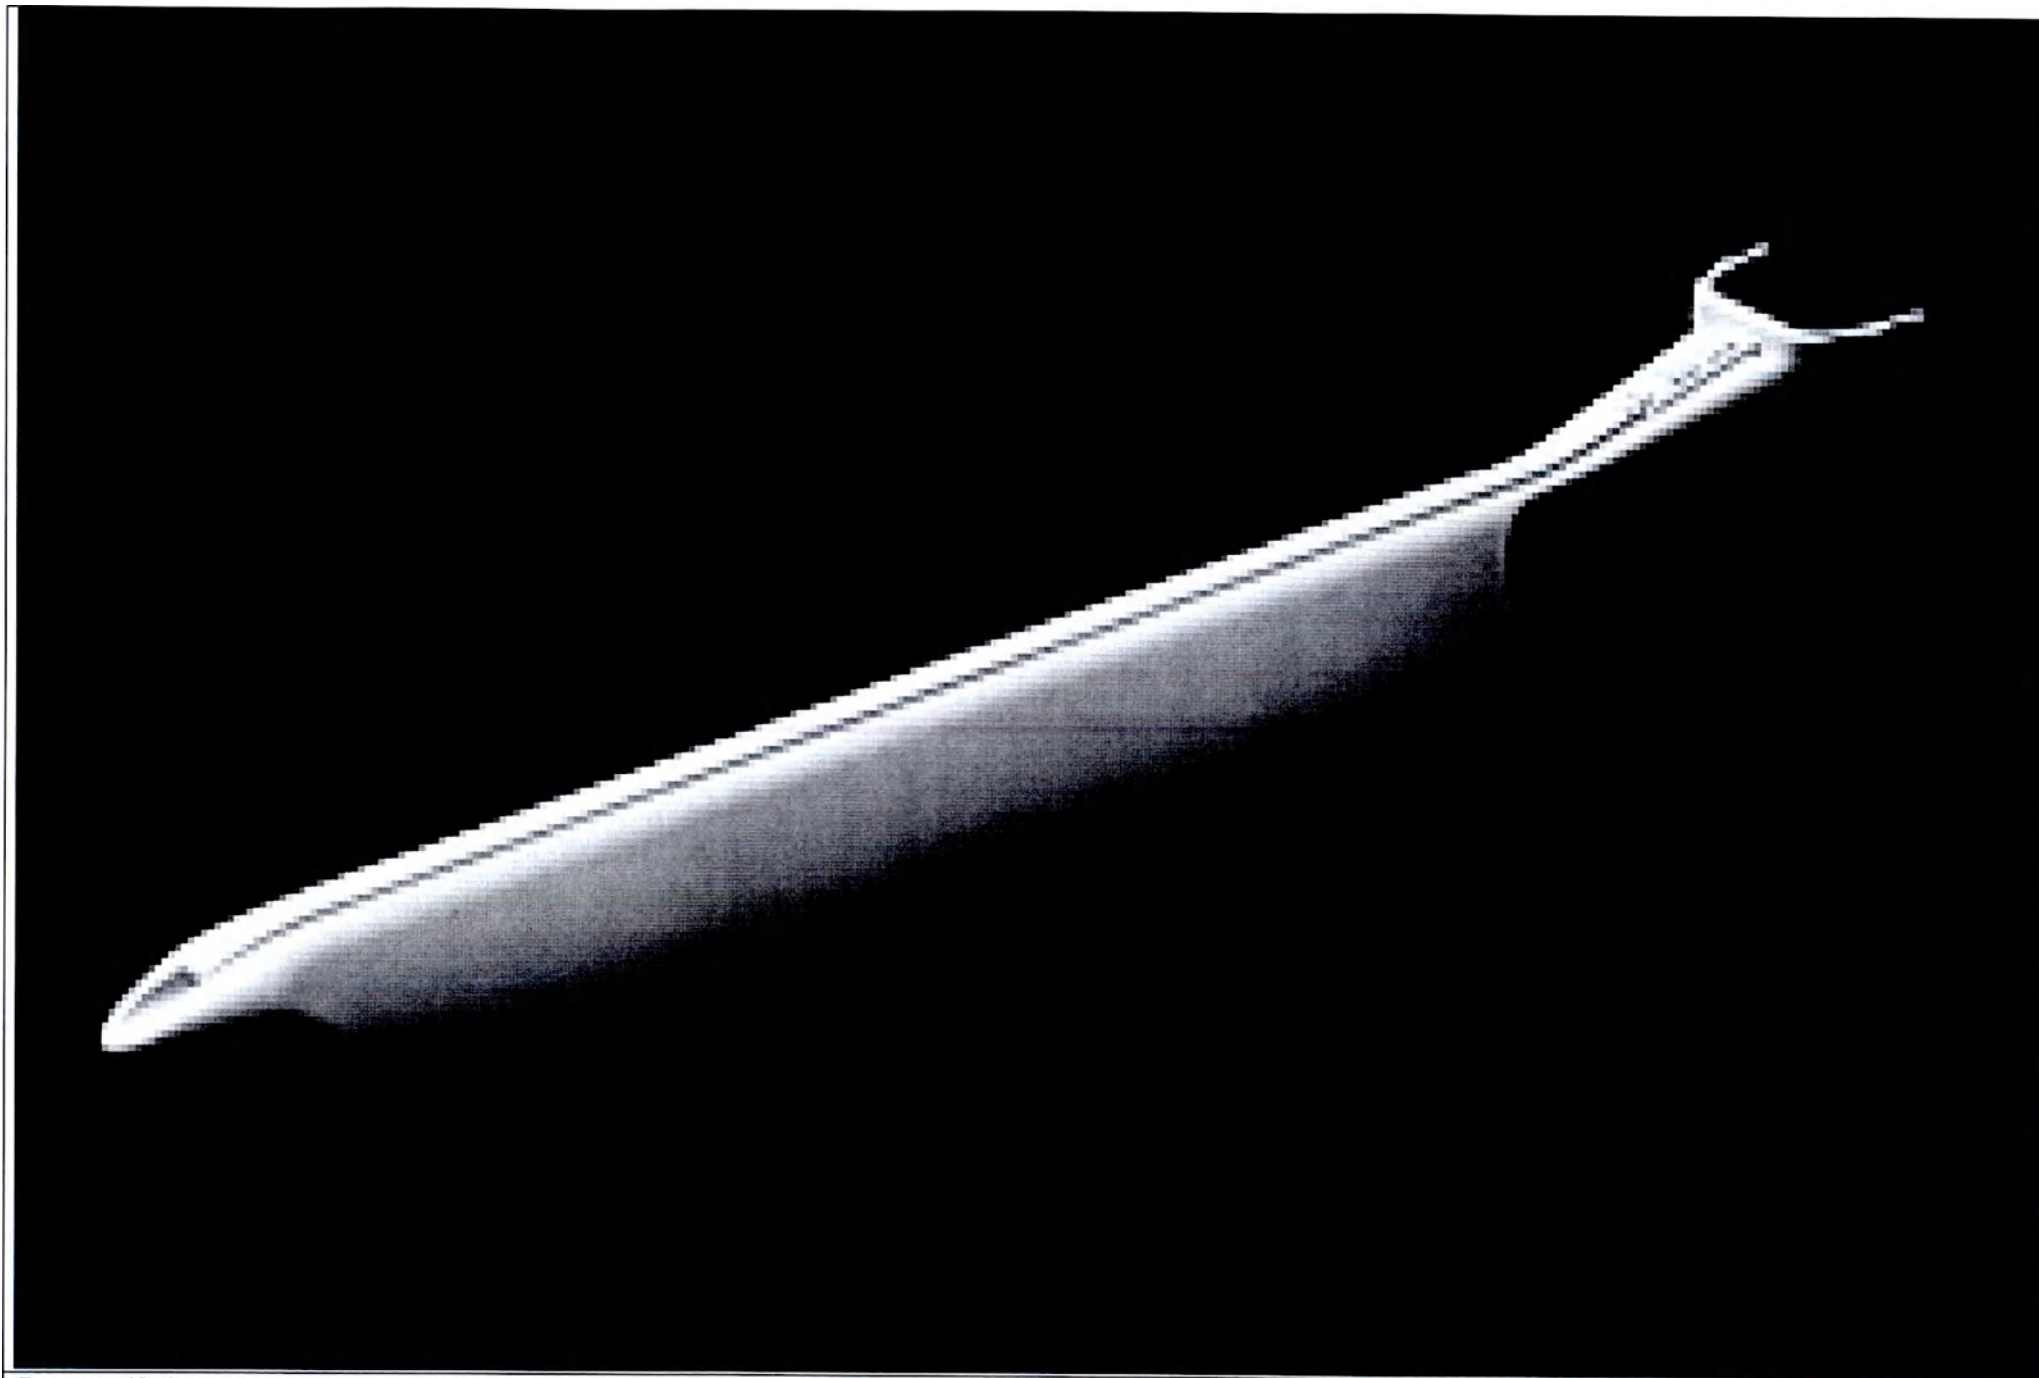
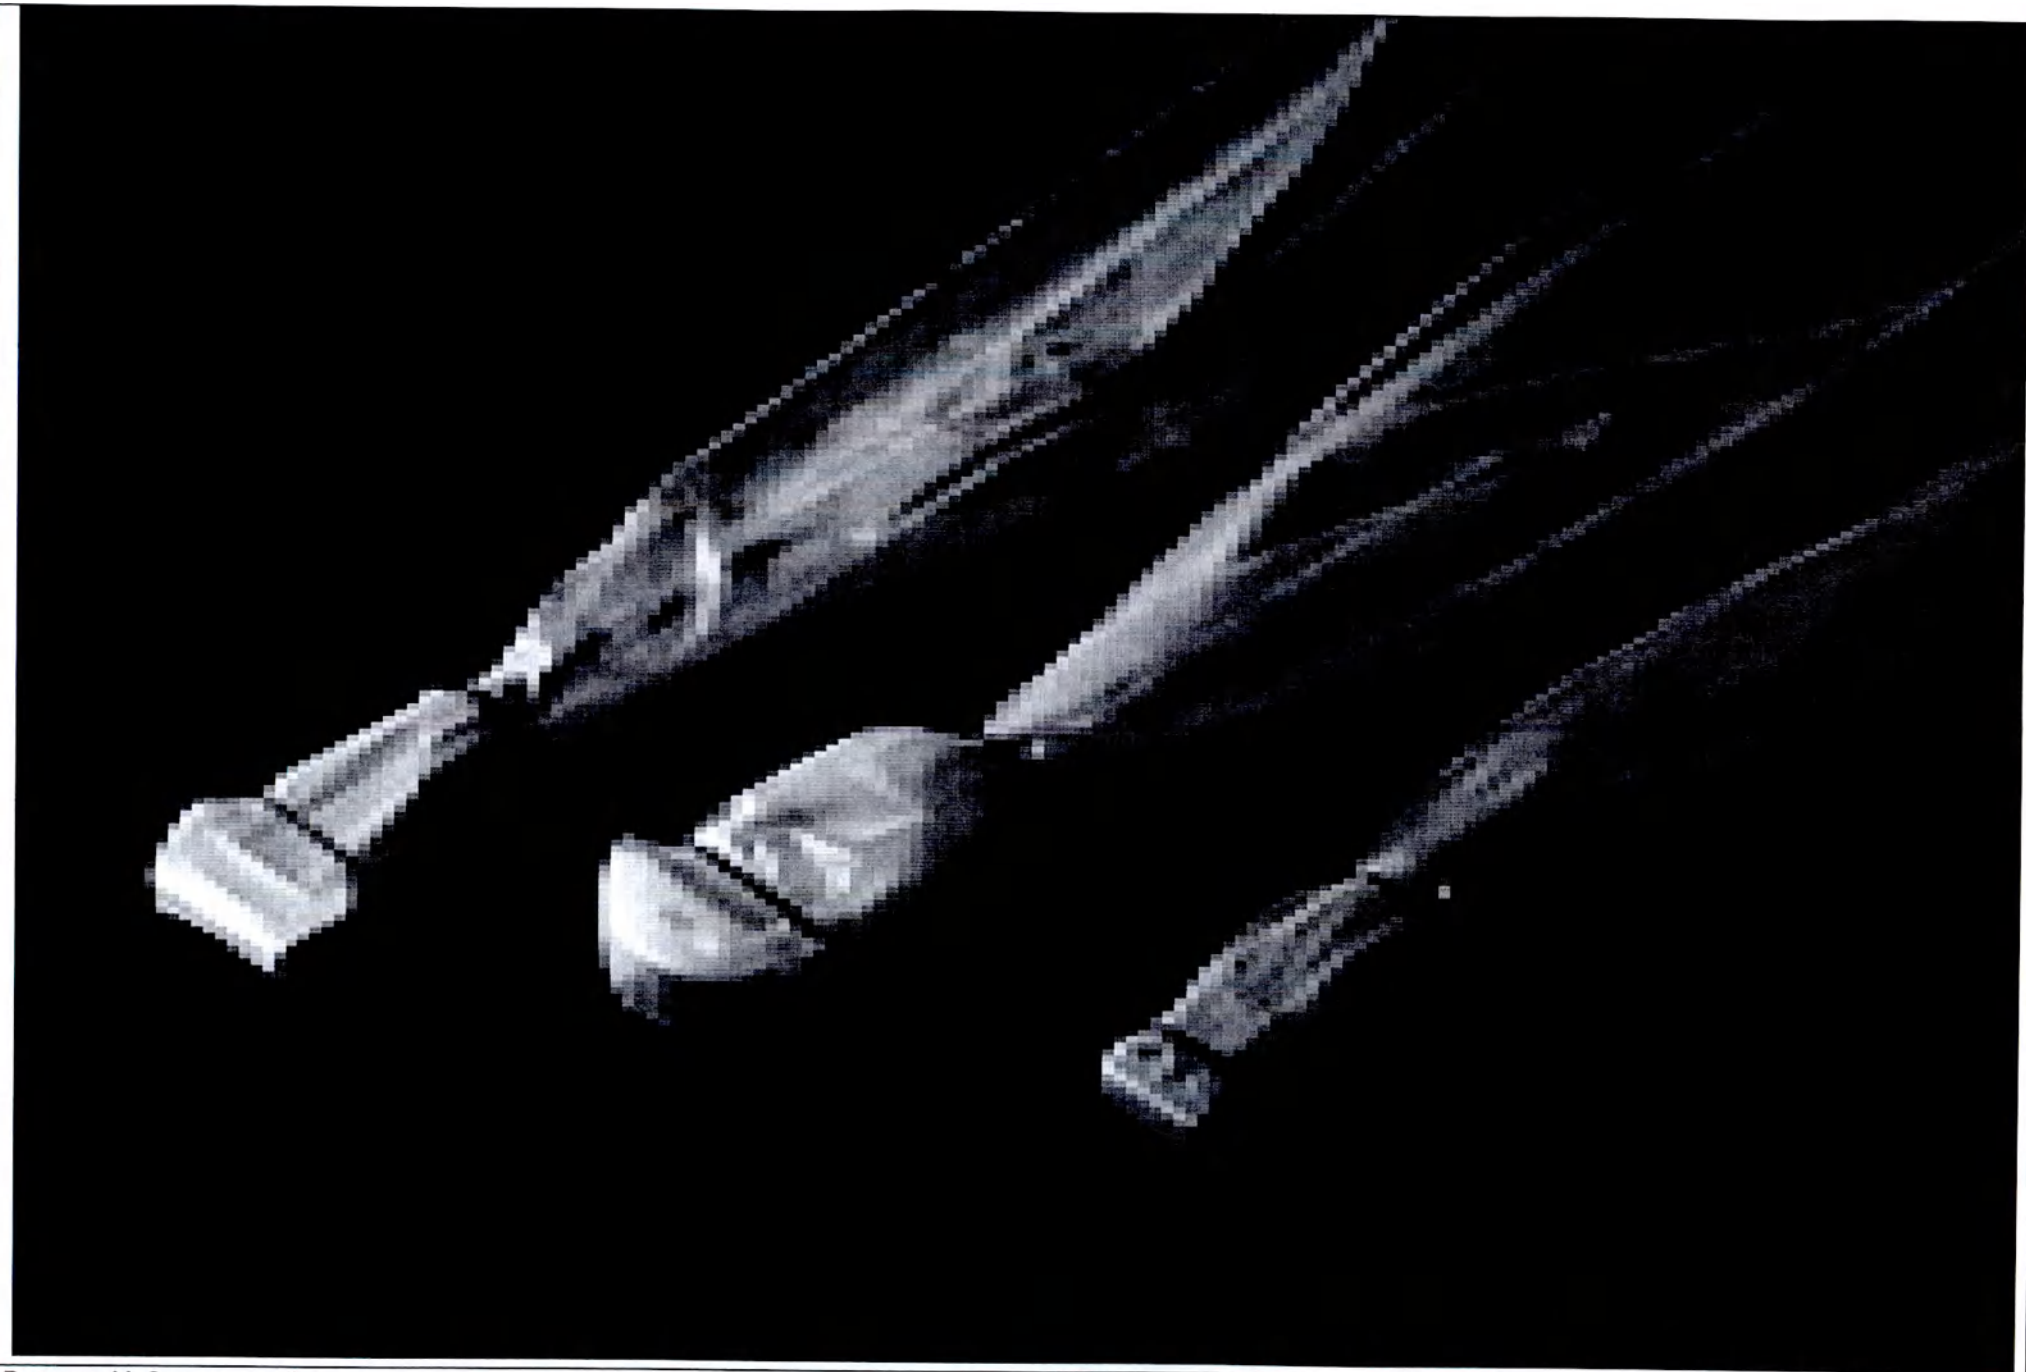
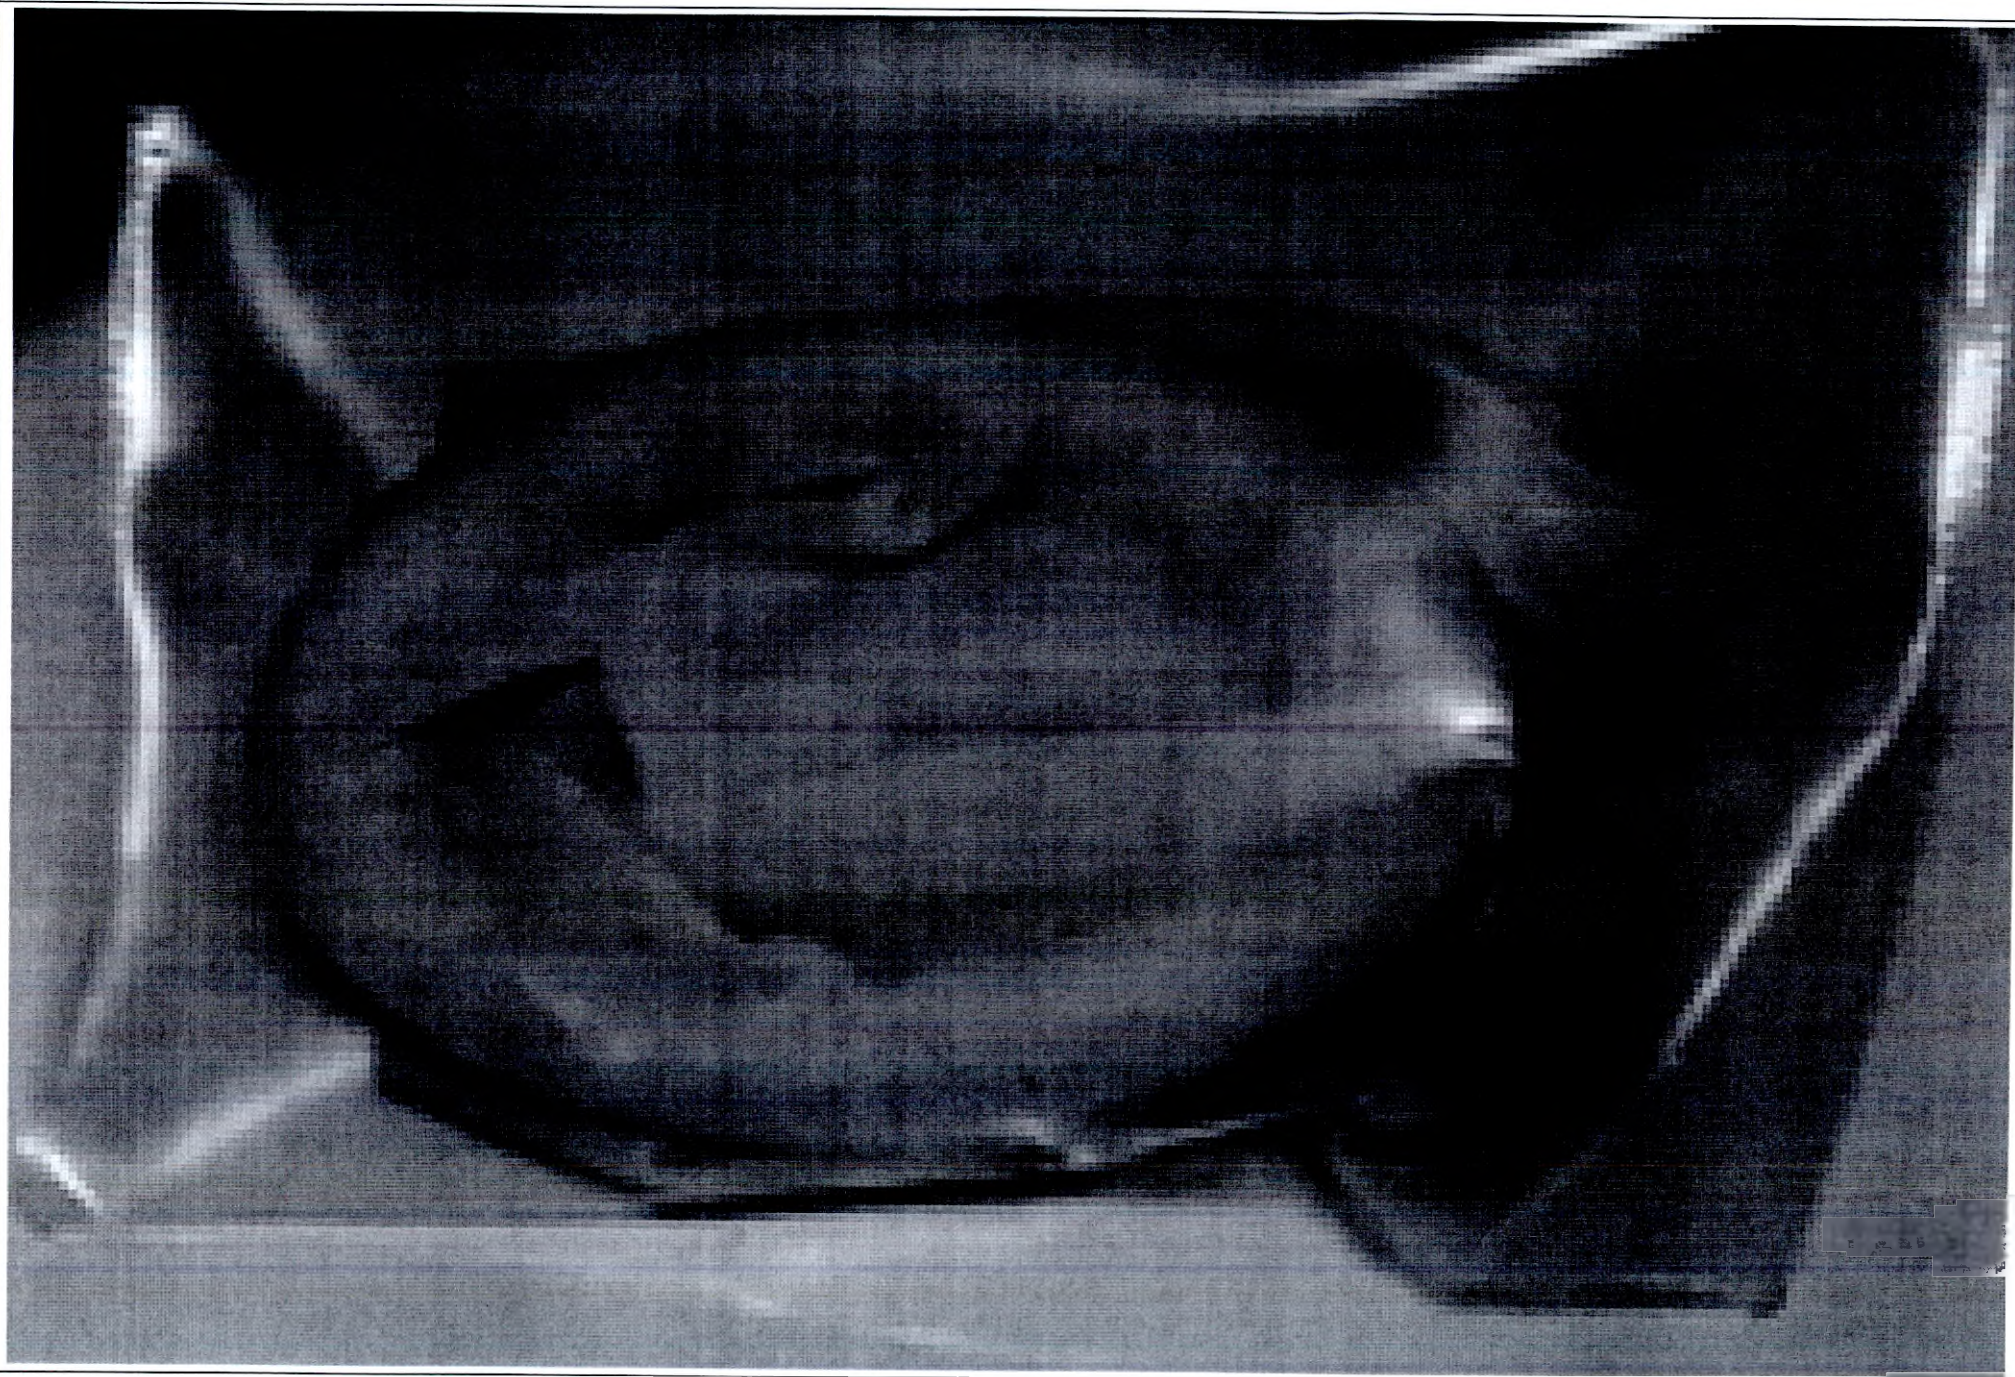
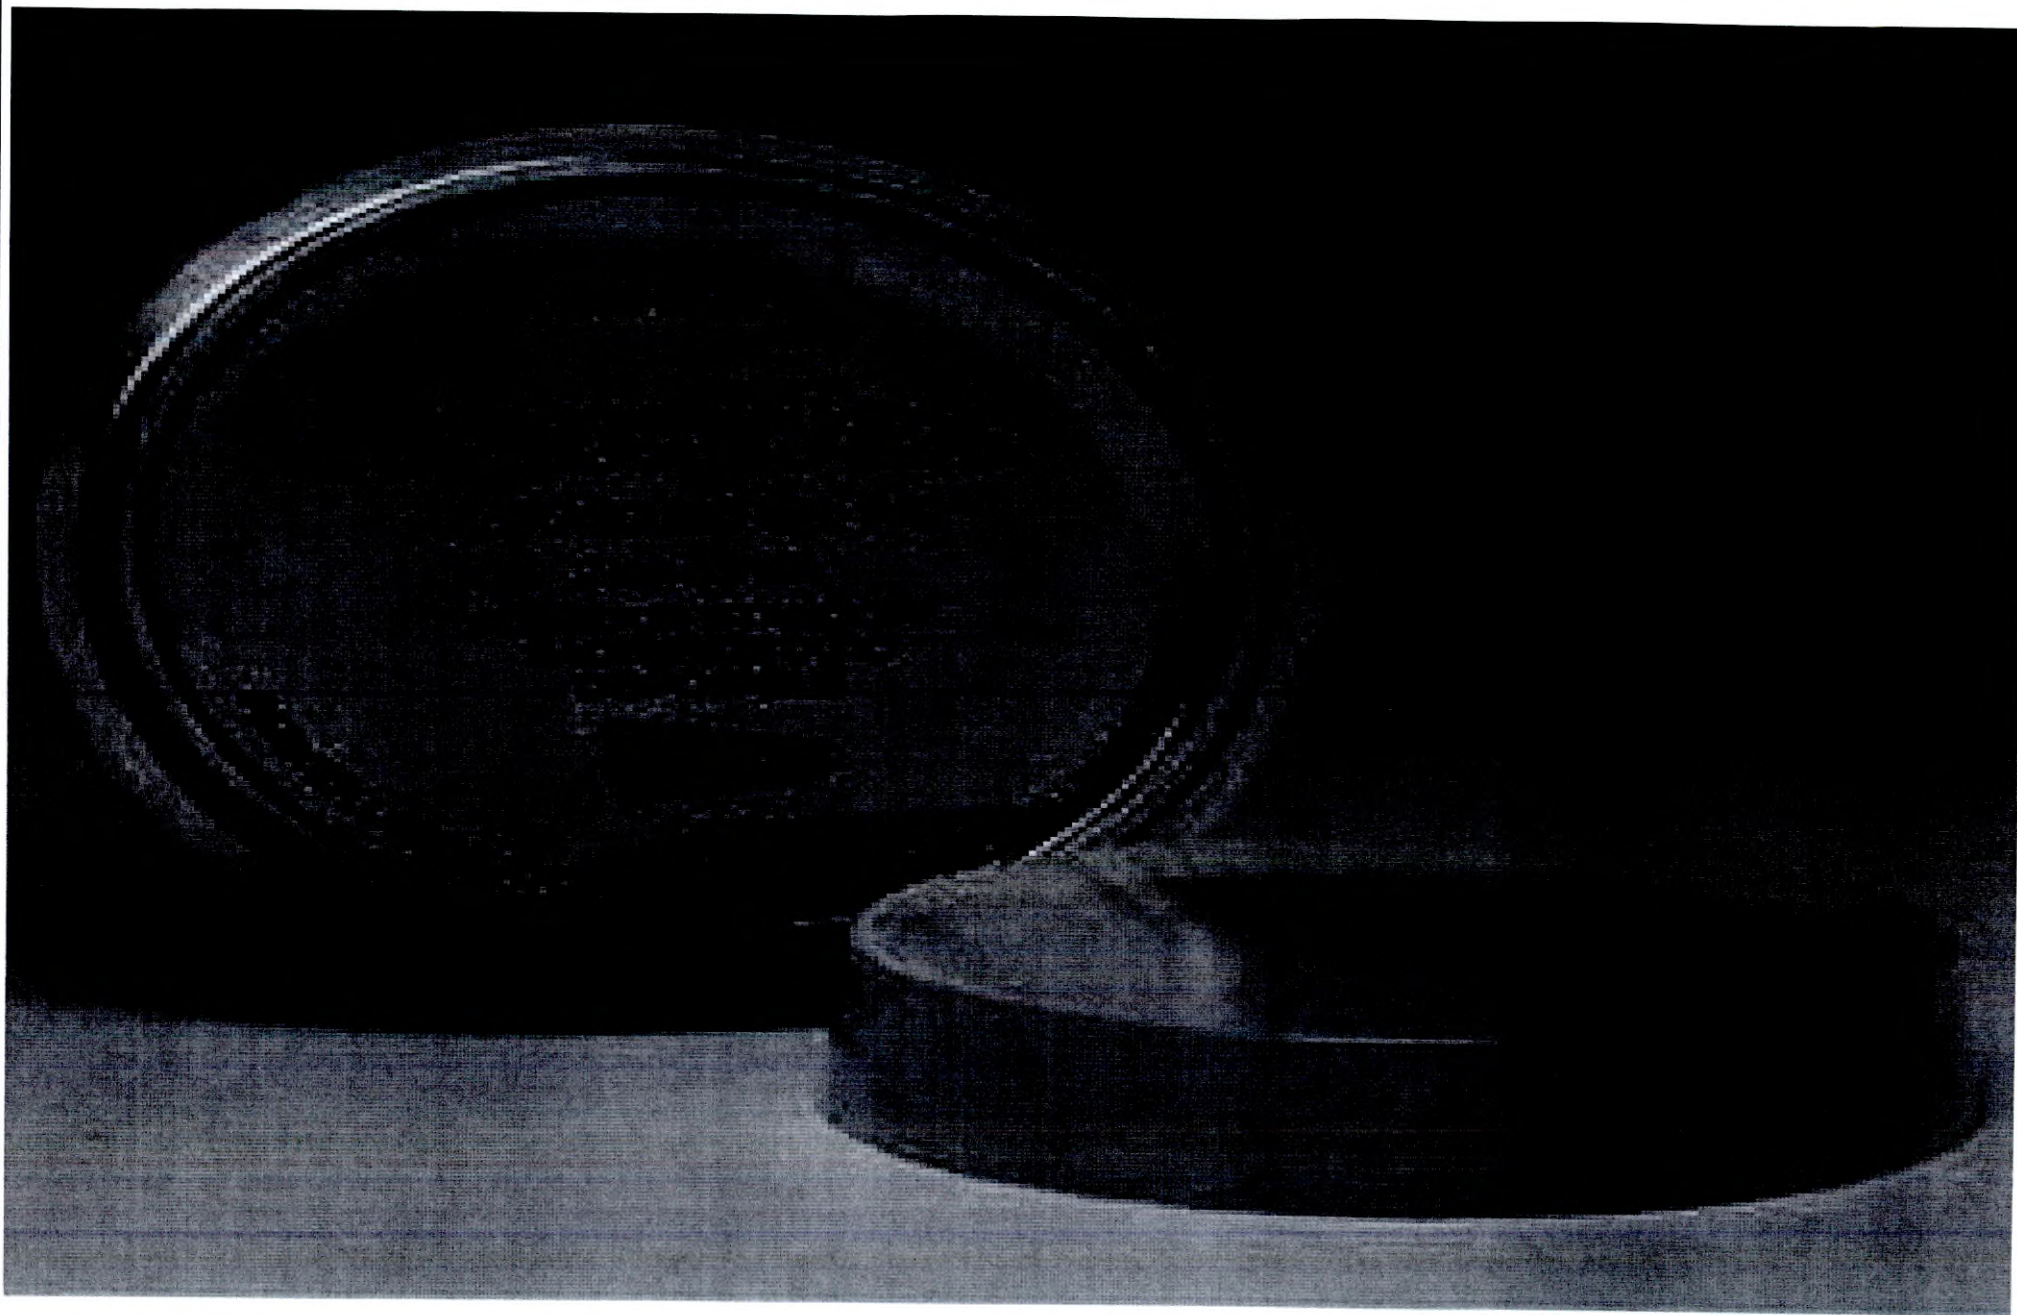



Рисунок 42. Адаптер иглопроводника, многоразовый, к датчику ВР10-3 — 1 шт. (но не более 50 шт. при необходимости).









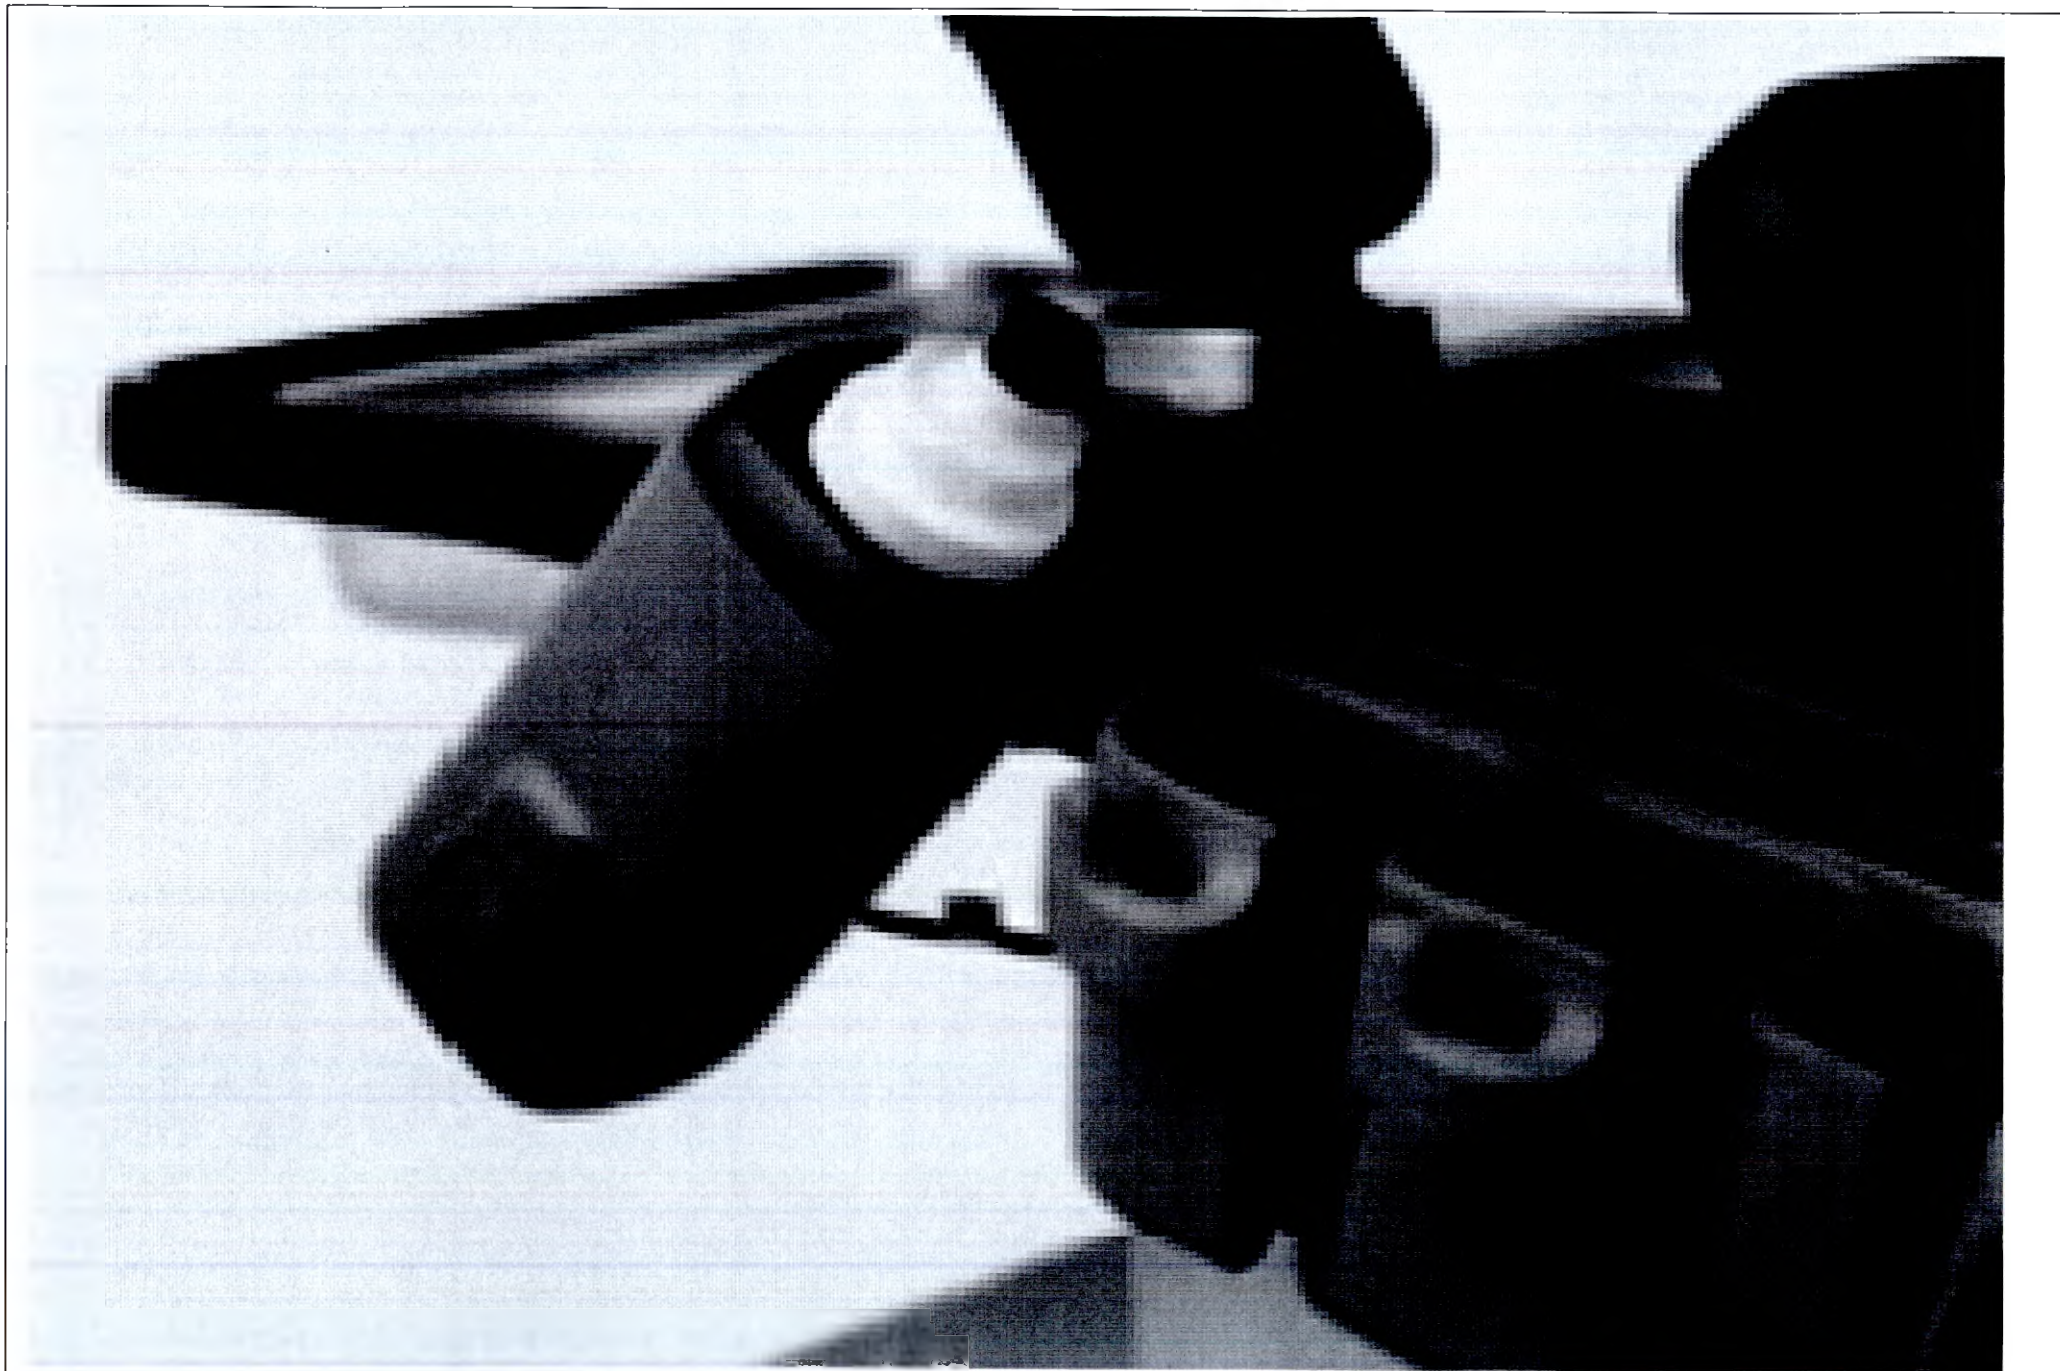

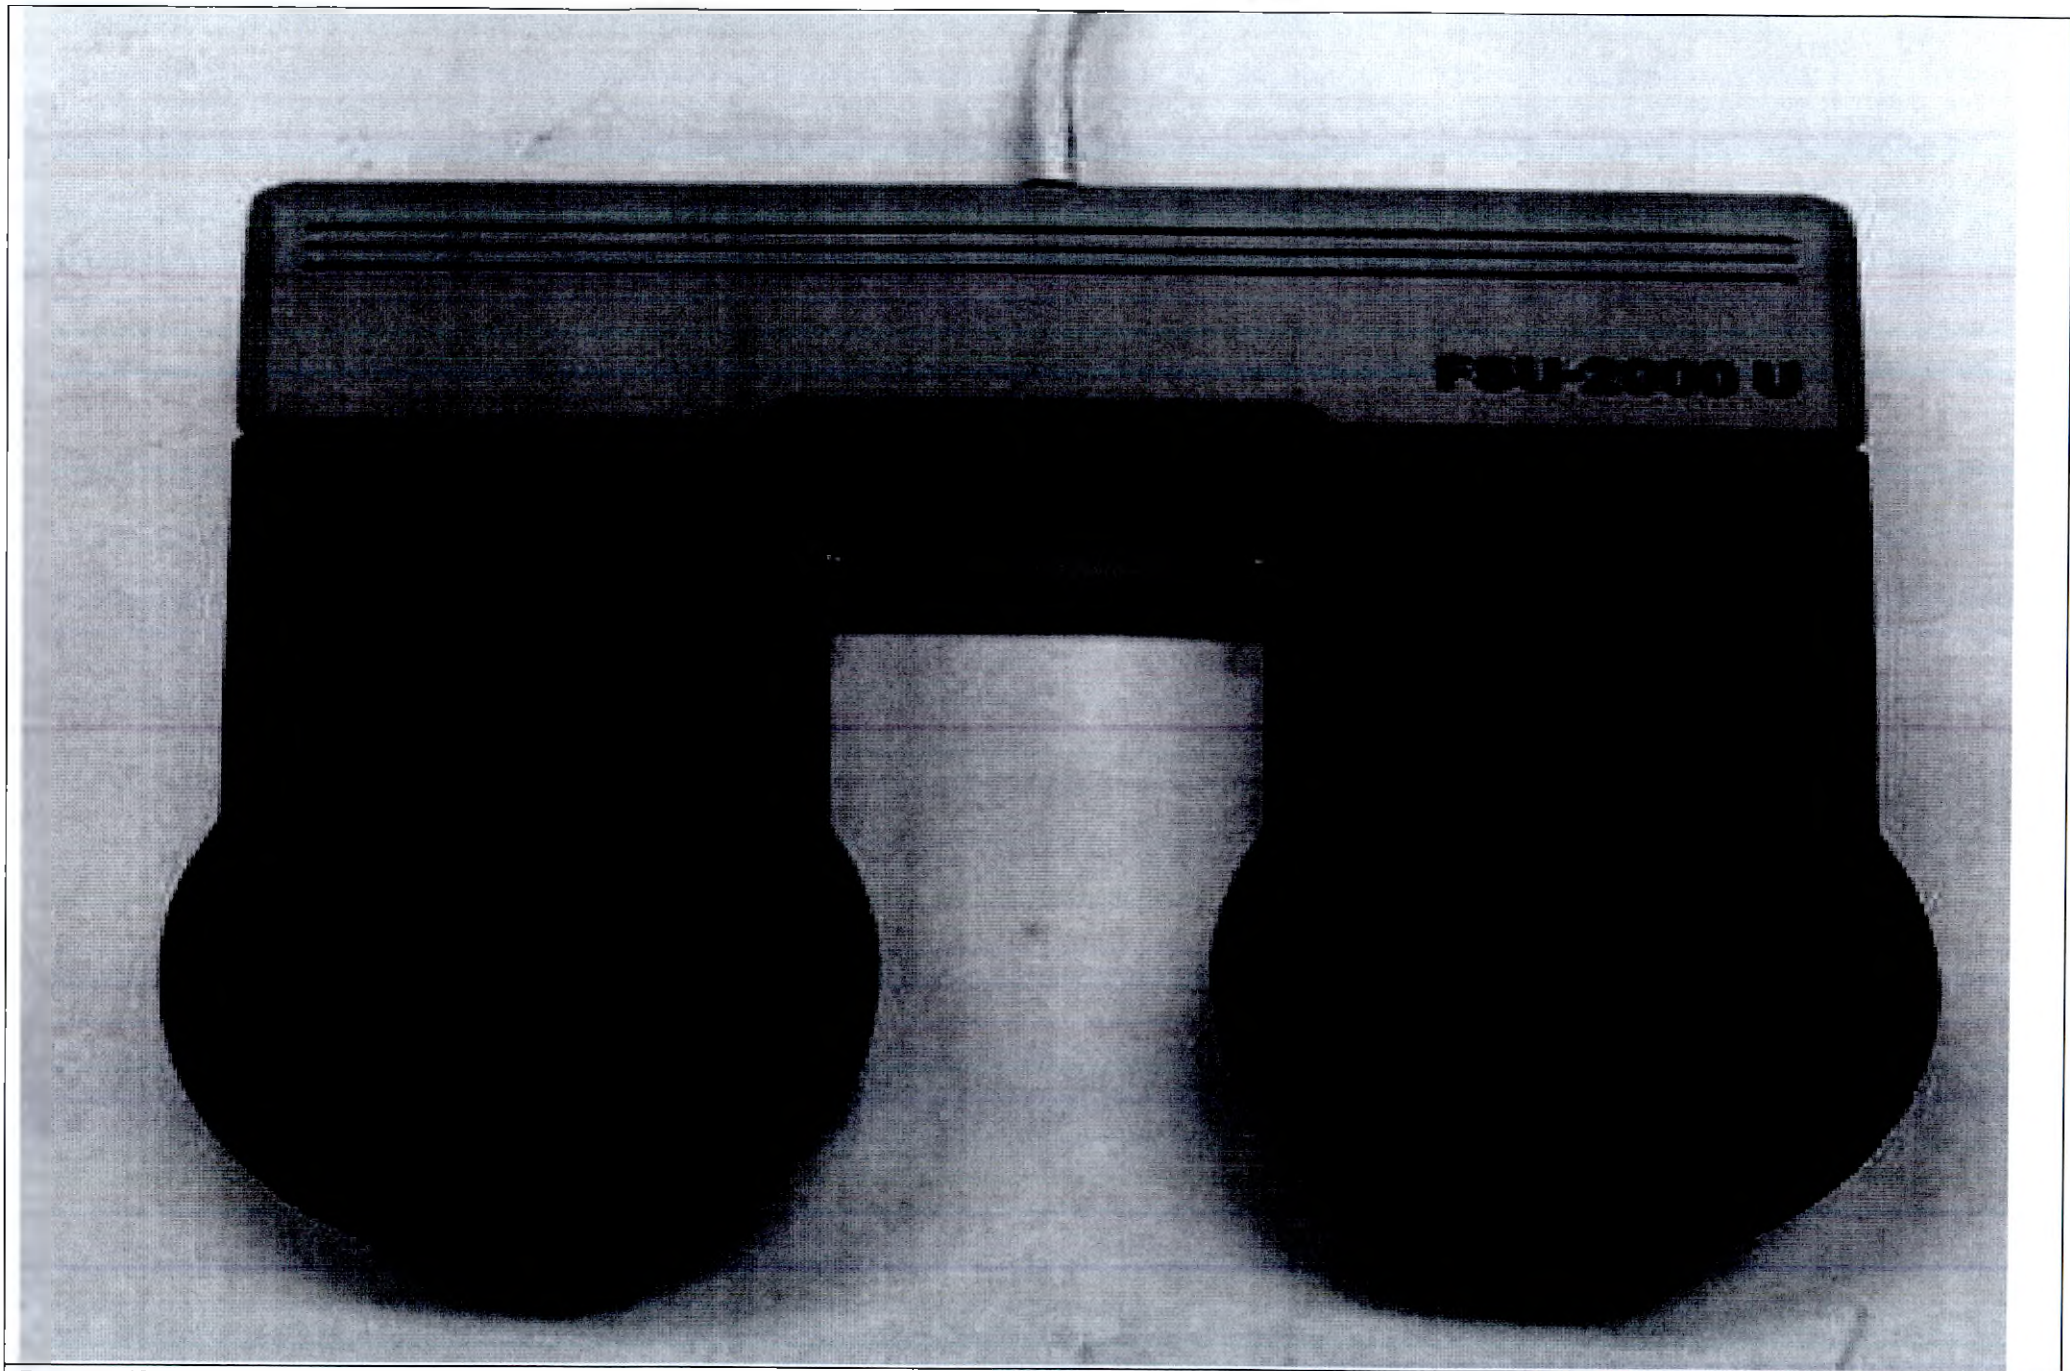
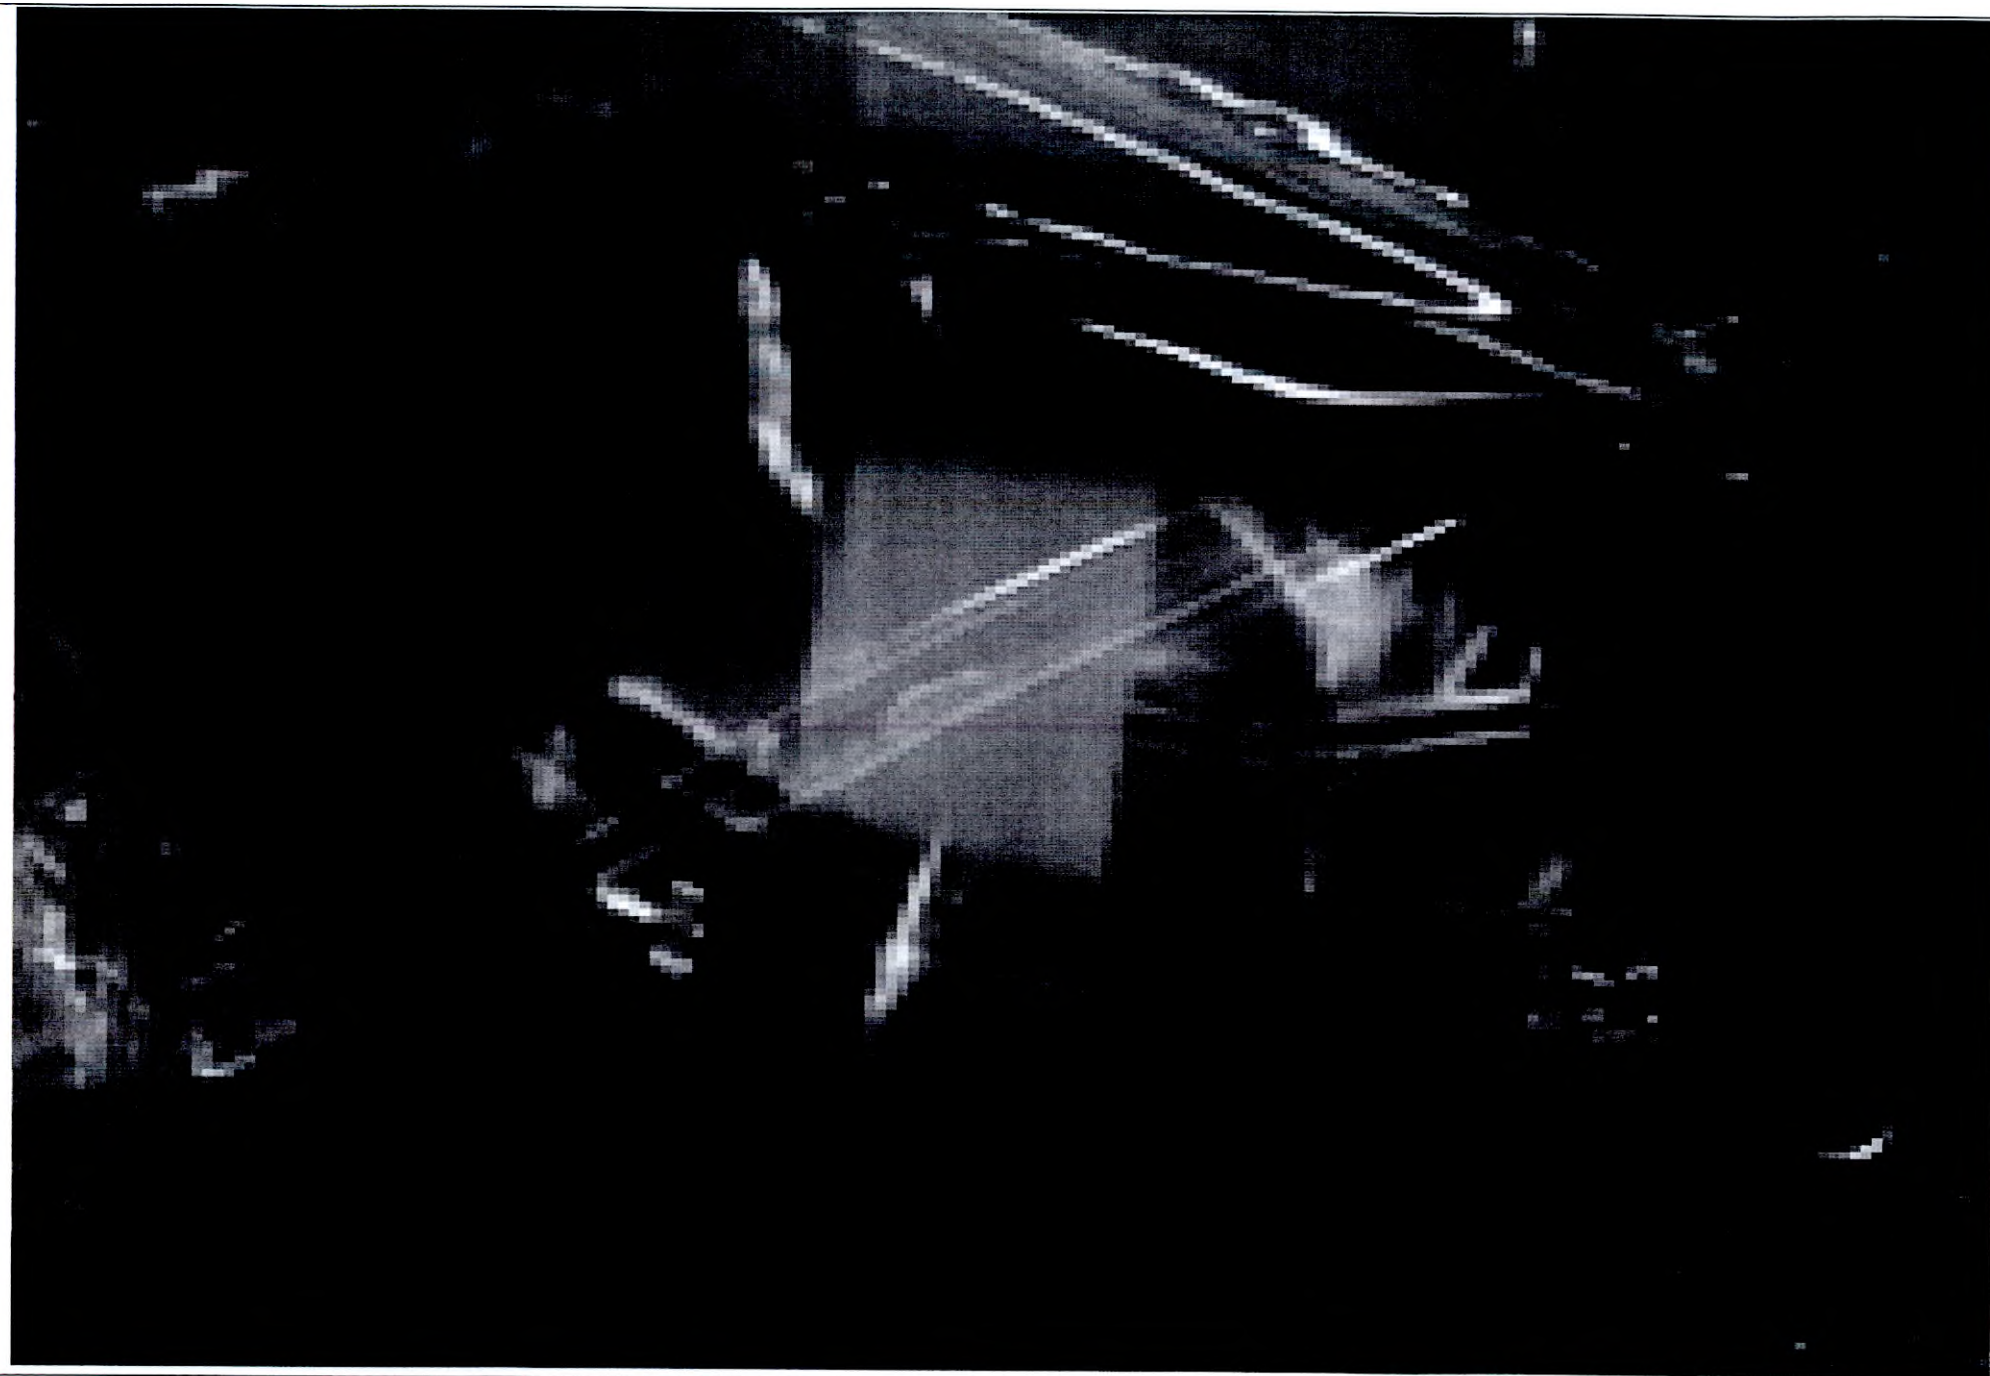



Рисунок 48. Механический переключатель — 1 шт. (но не более 30 шт. при необходимости).









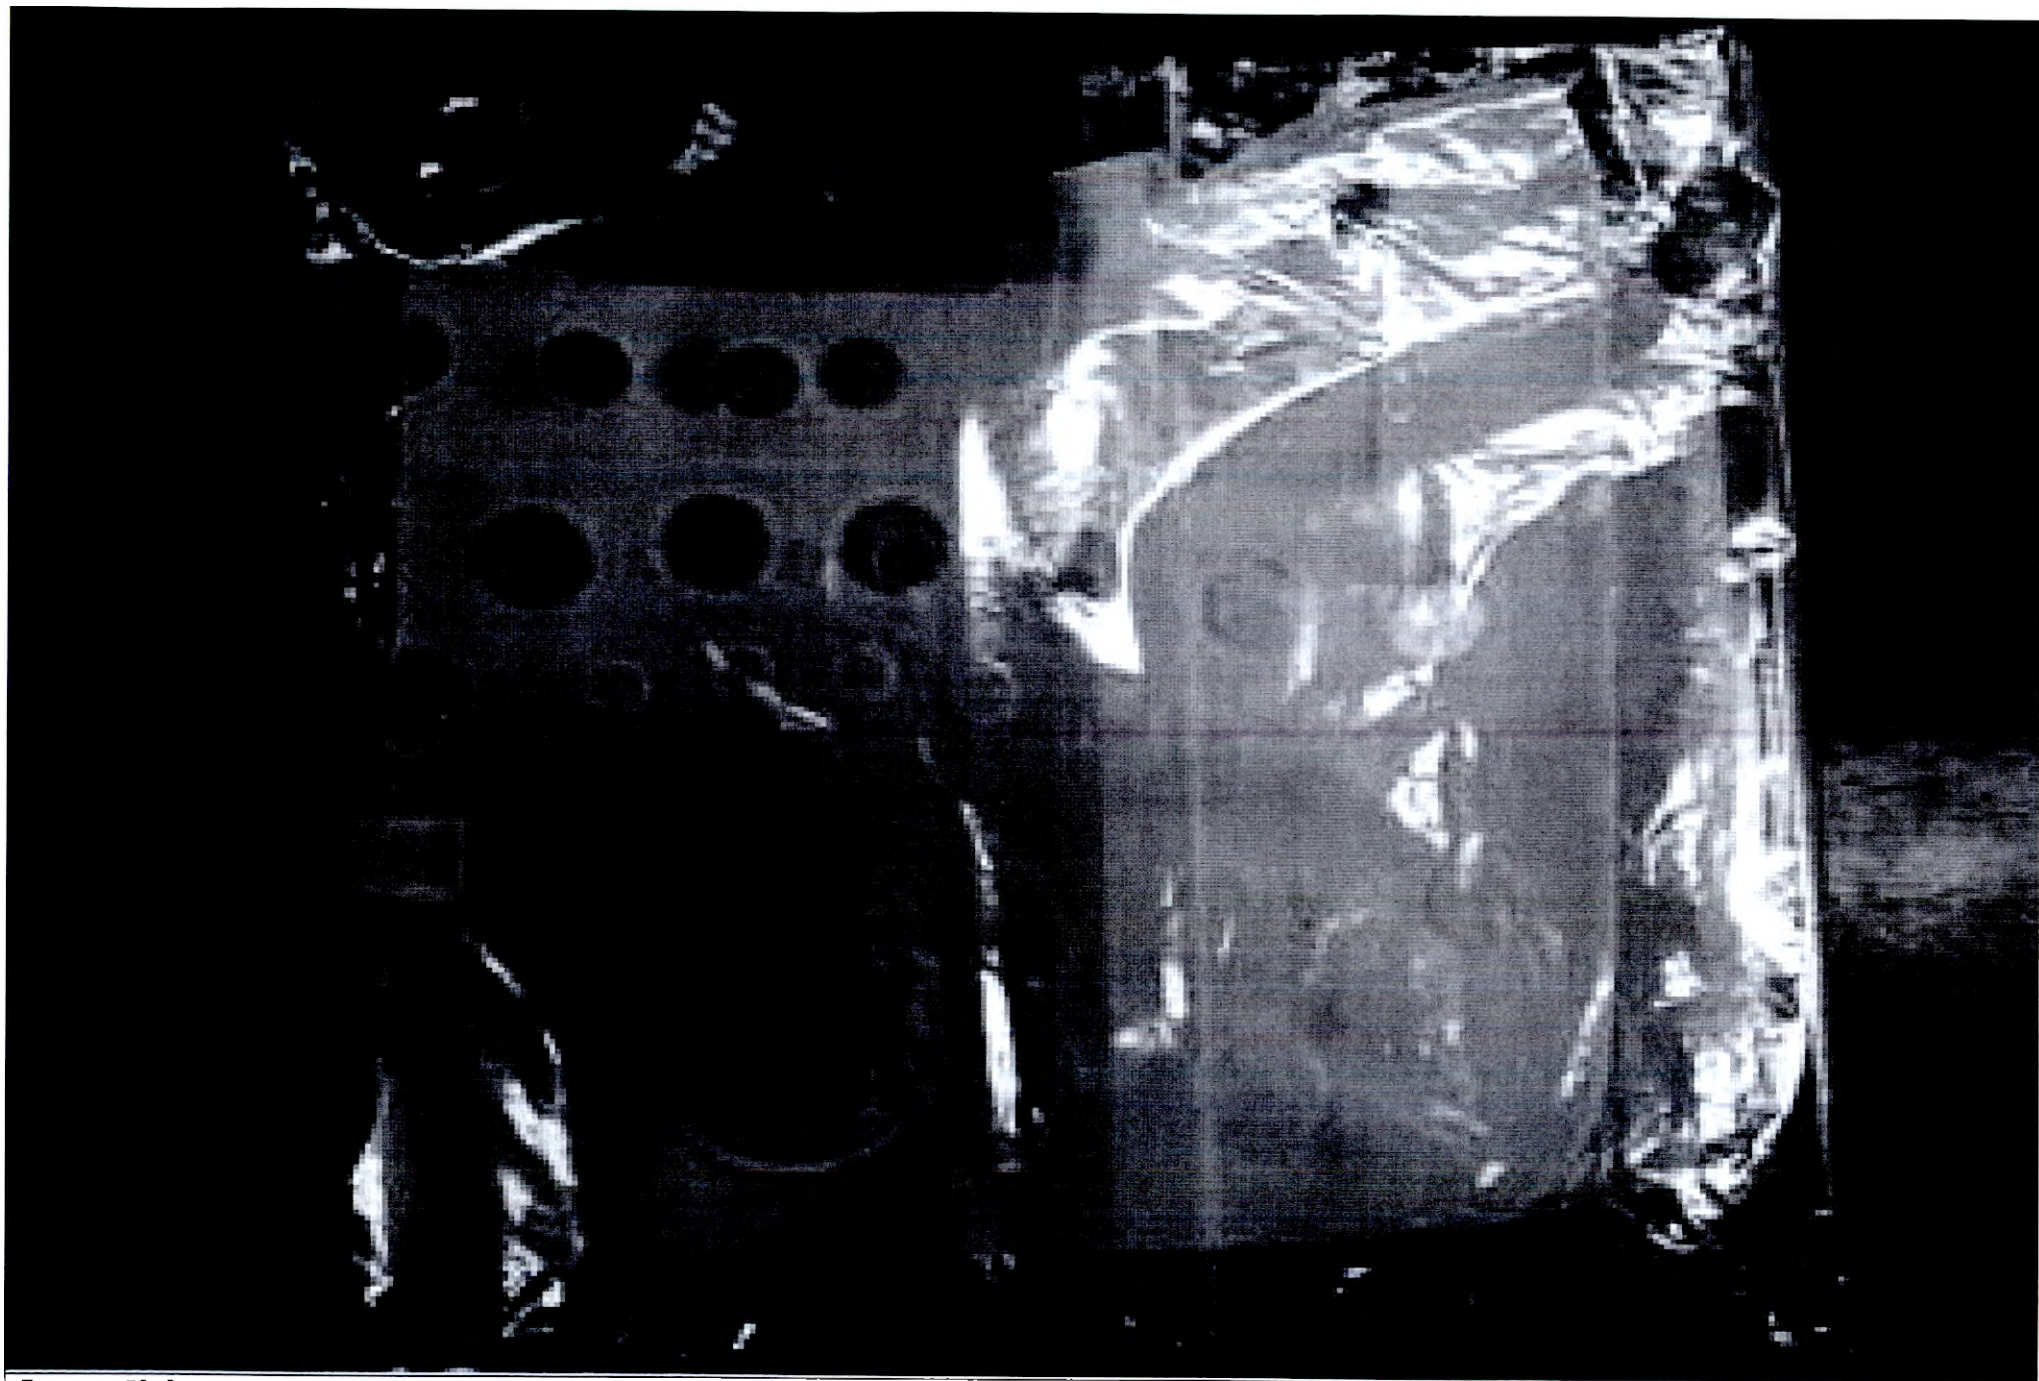

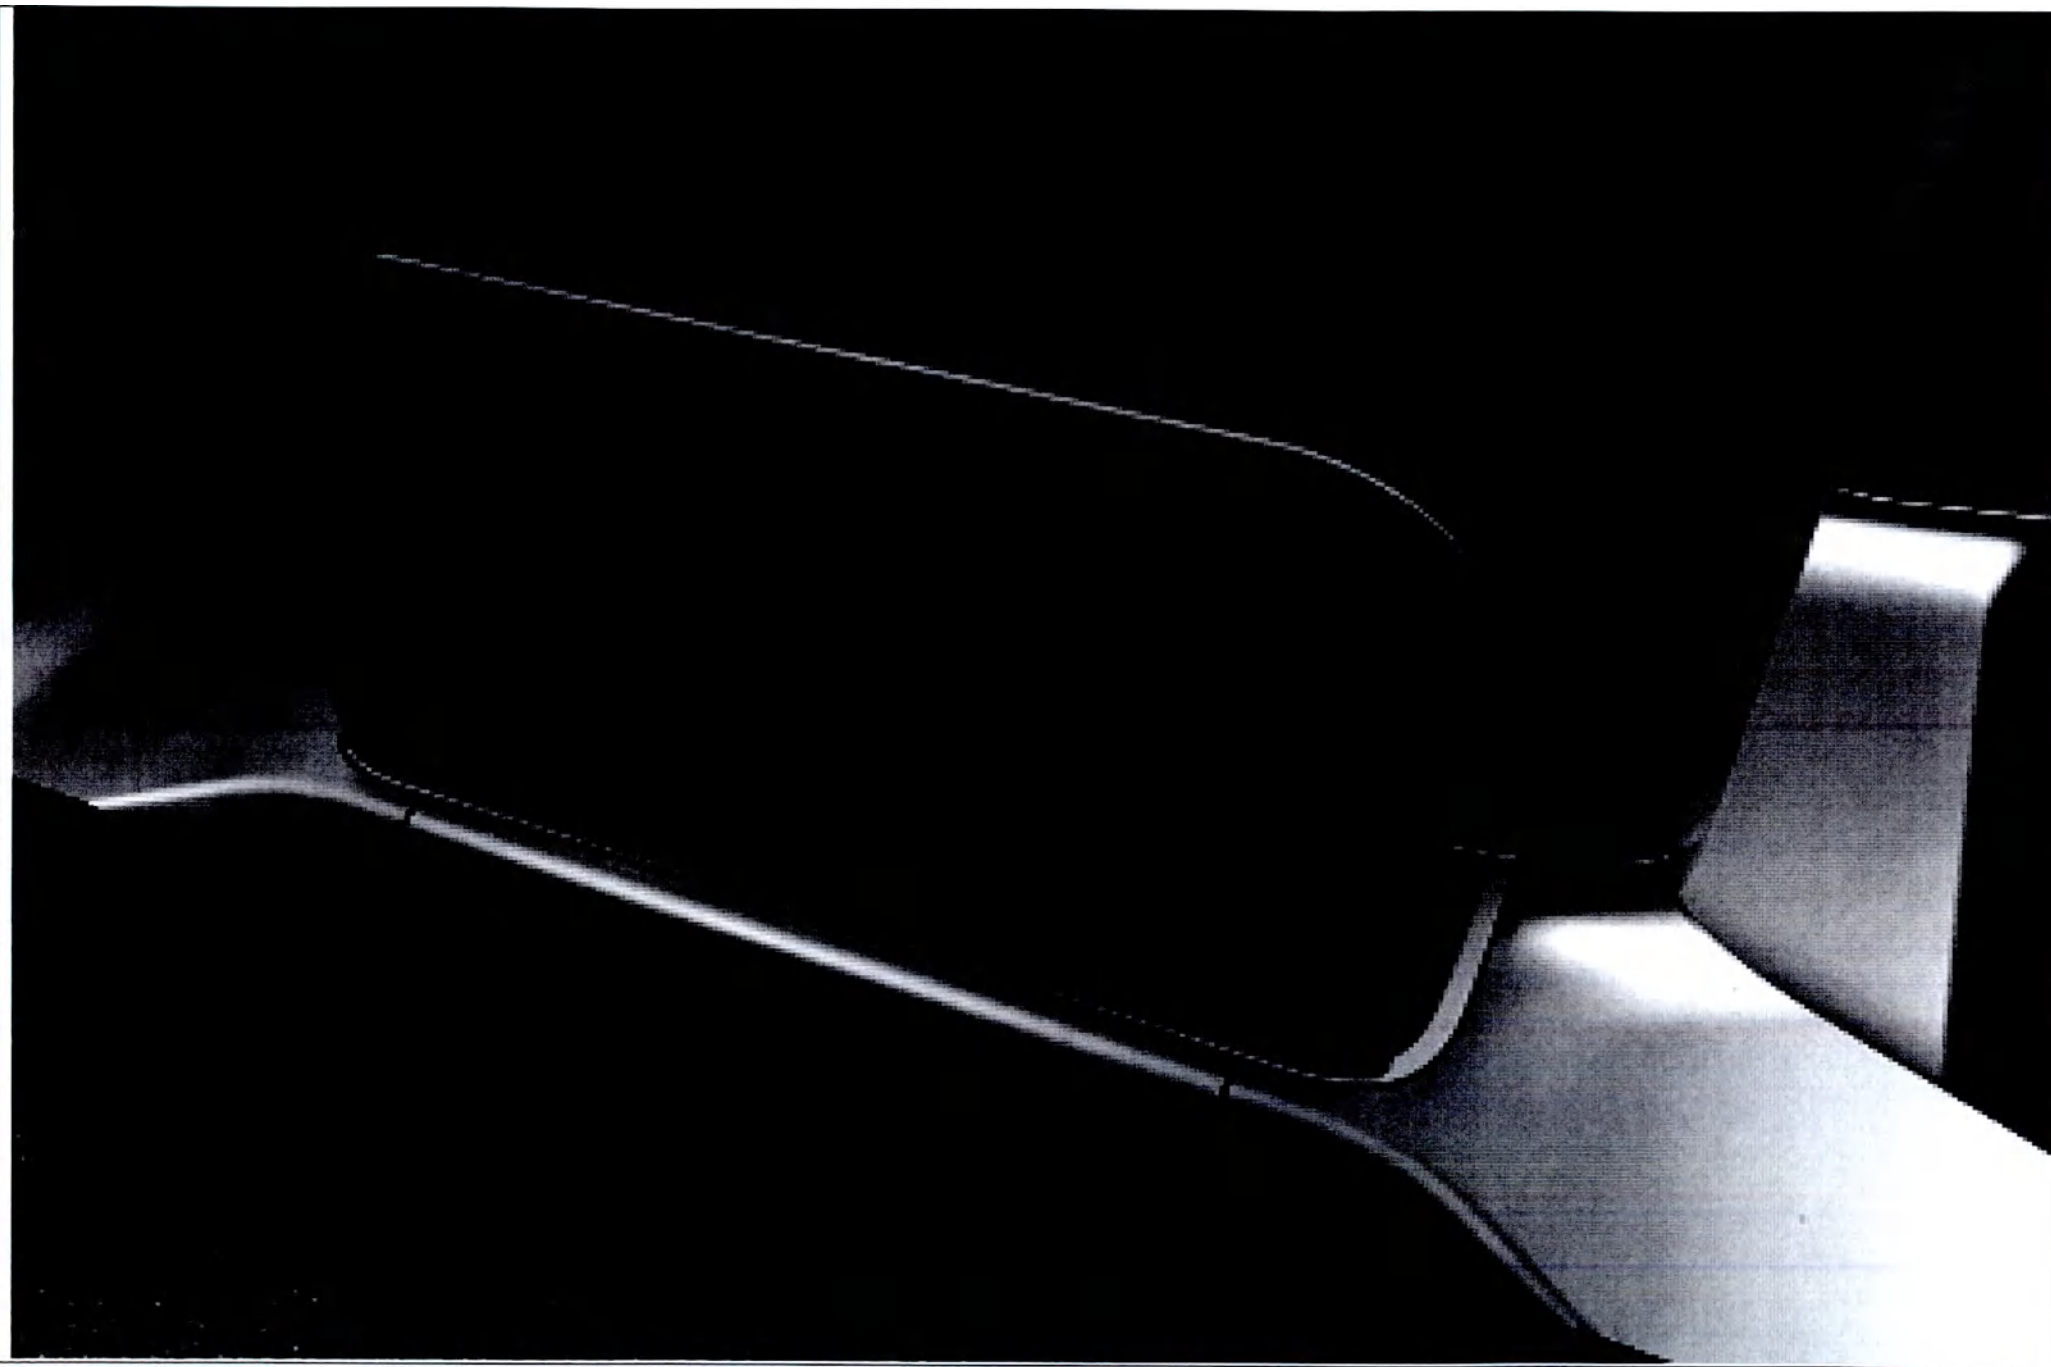
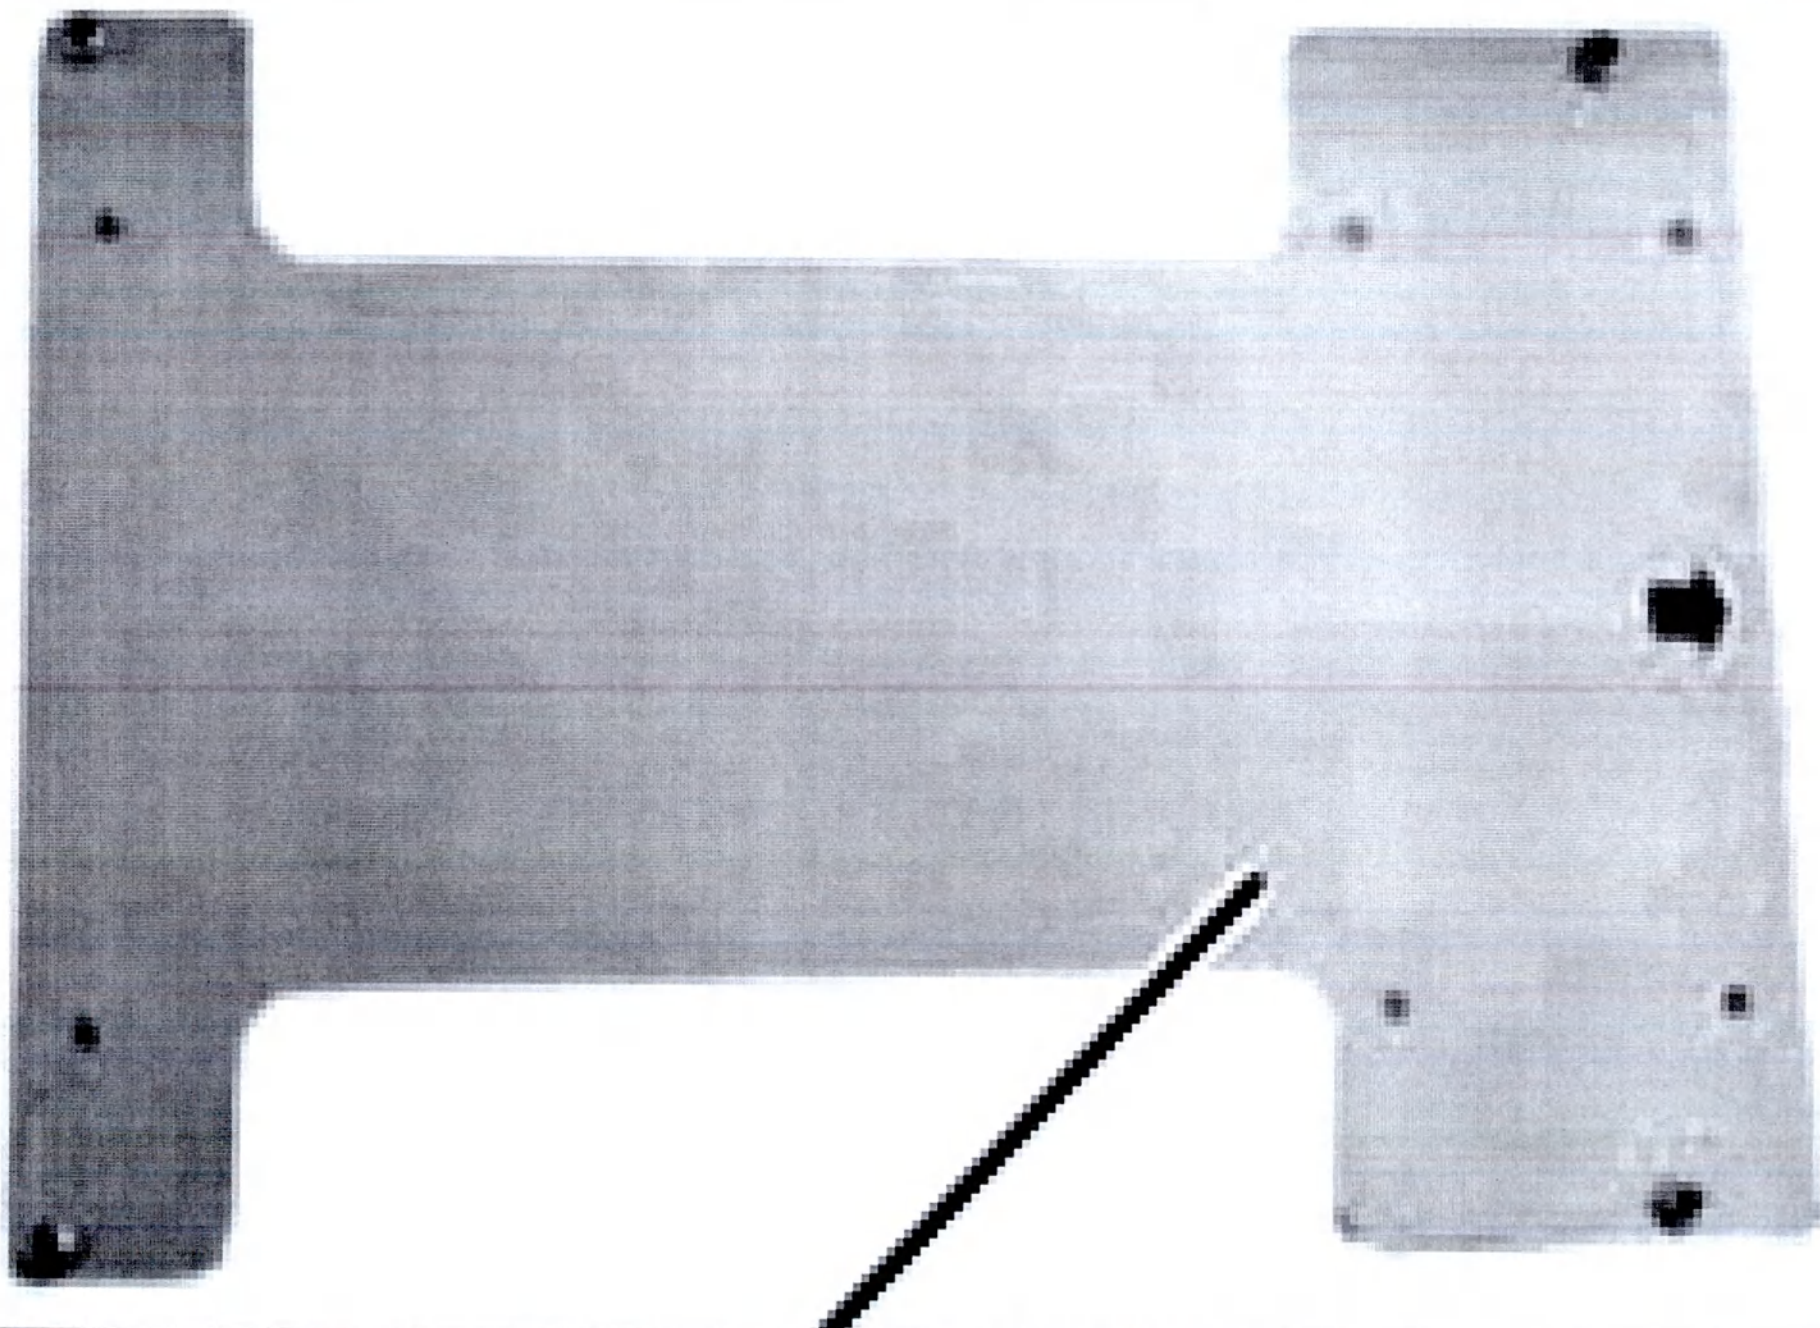
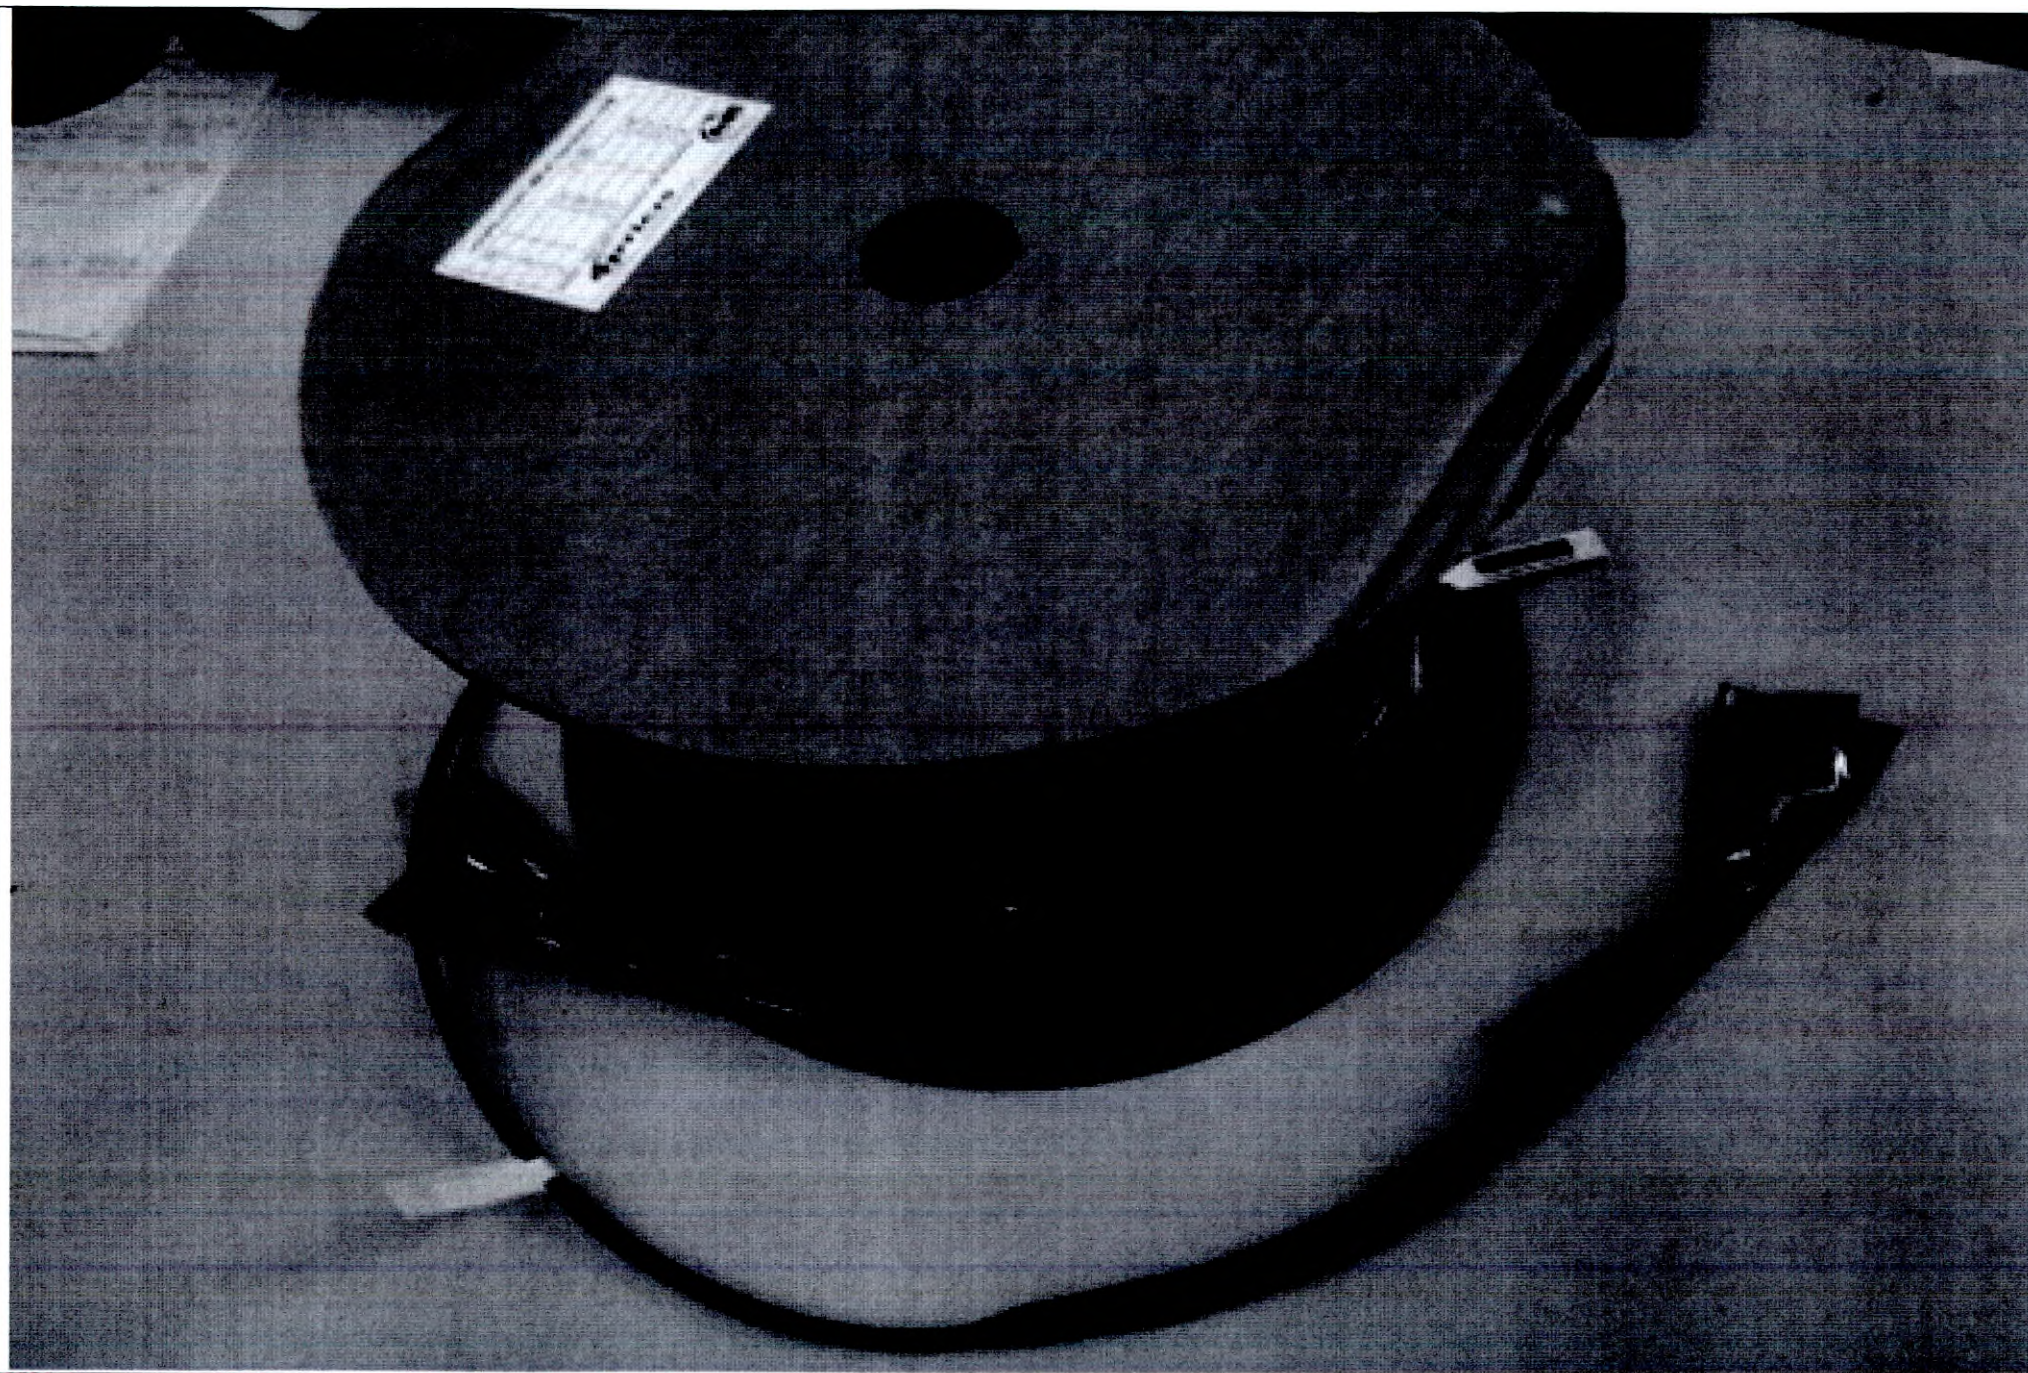


Рисунок 5А. Контейнер для хранения принадлежностей — 1 шт. (но не более 30 шт. при необходимости).








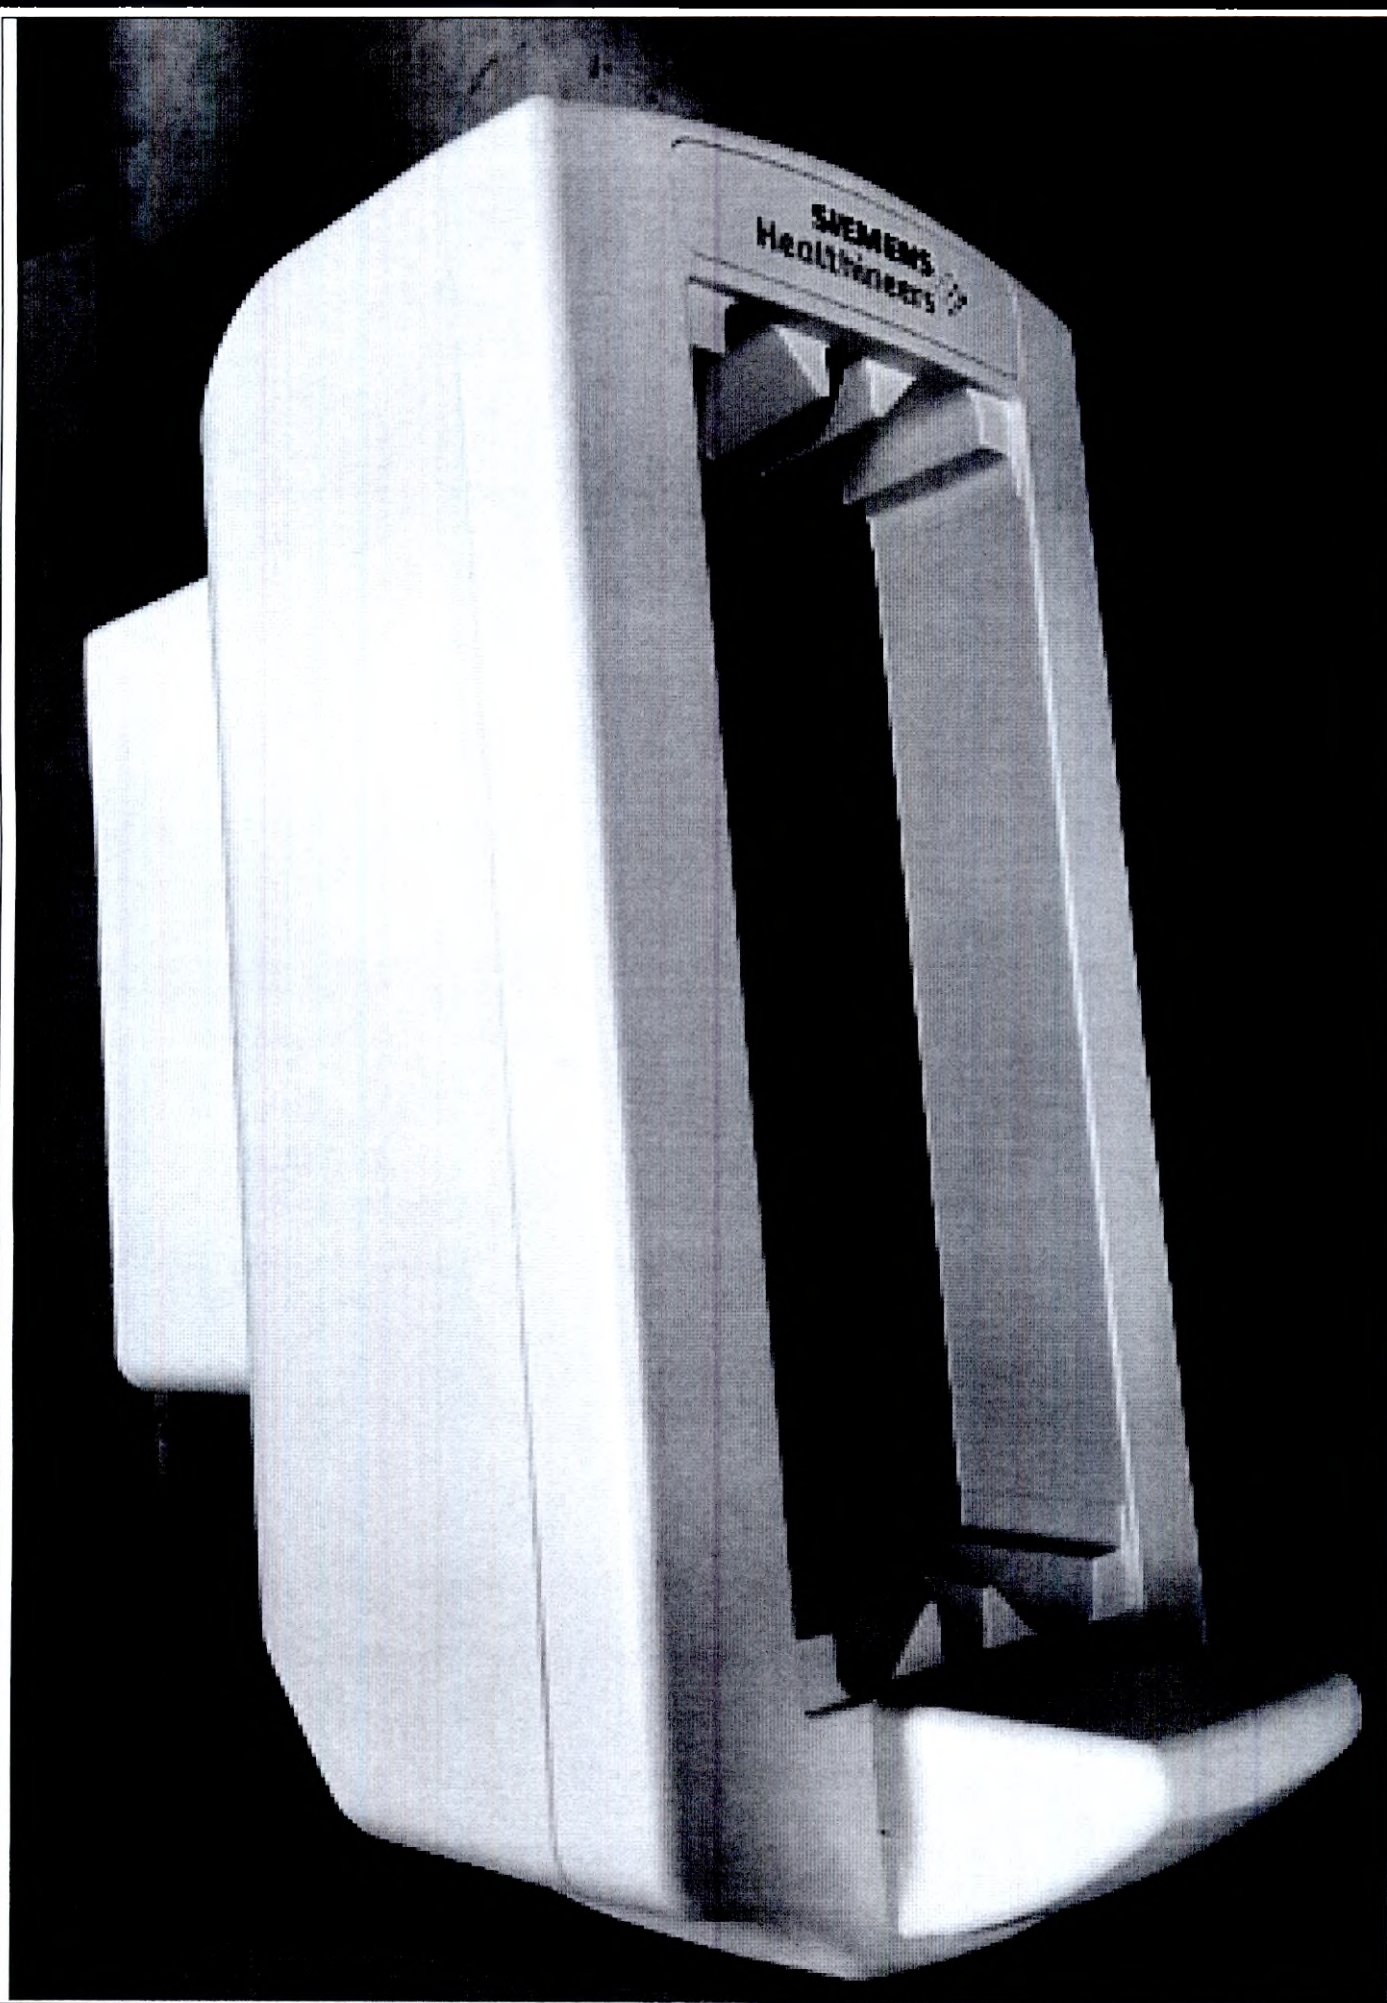


Рисунок 57. Адаптер для подключения чреспищеводного датчика — 1 шт. (но не более 10 шт. при необходимости).



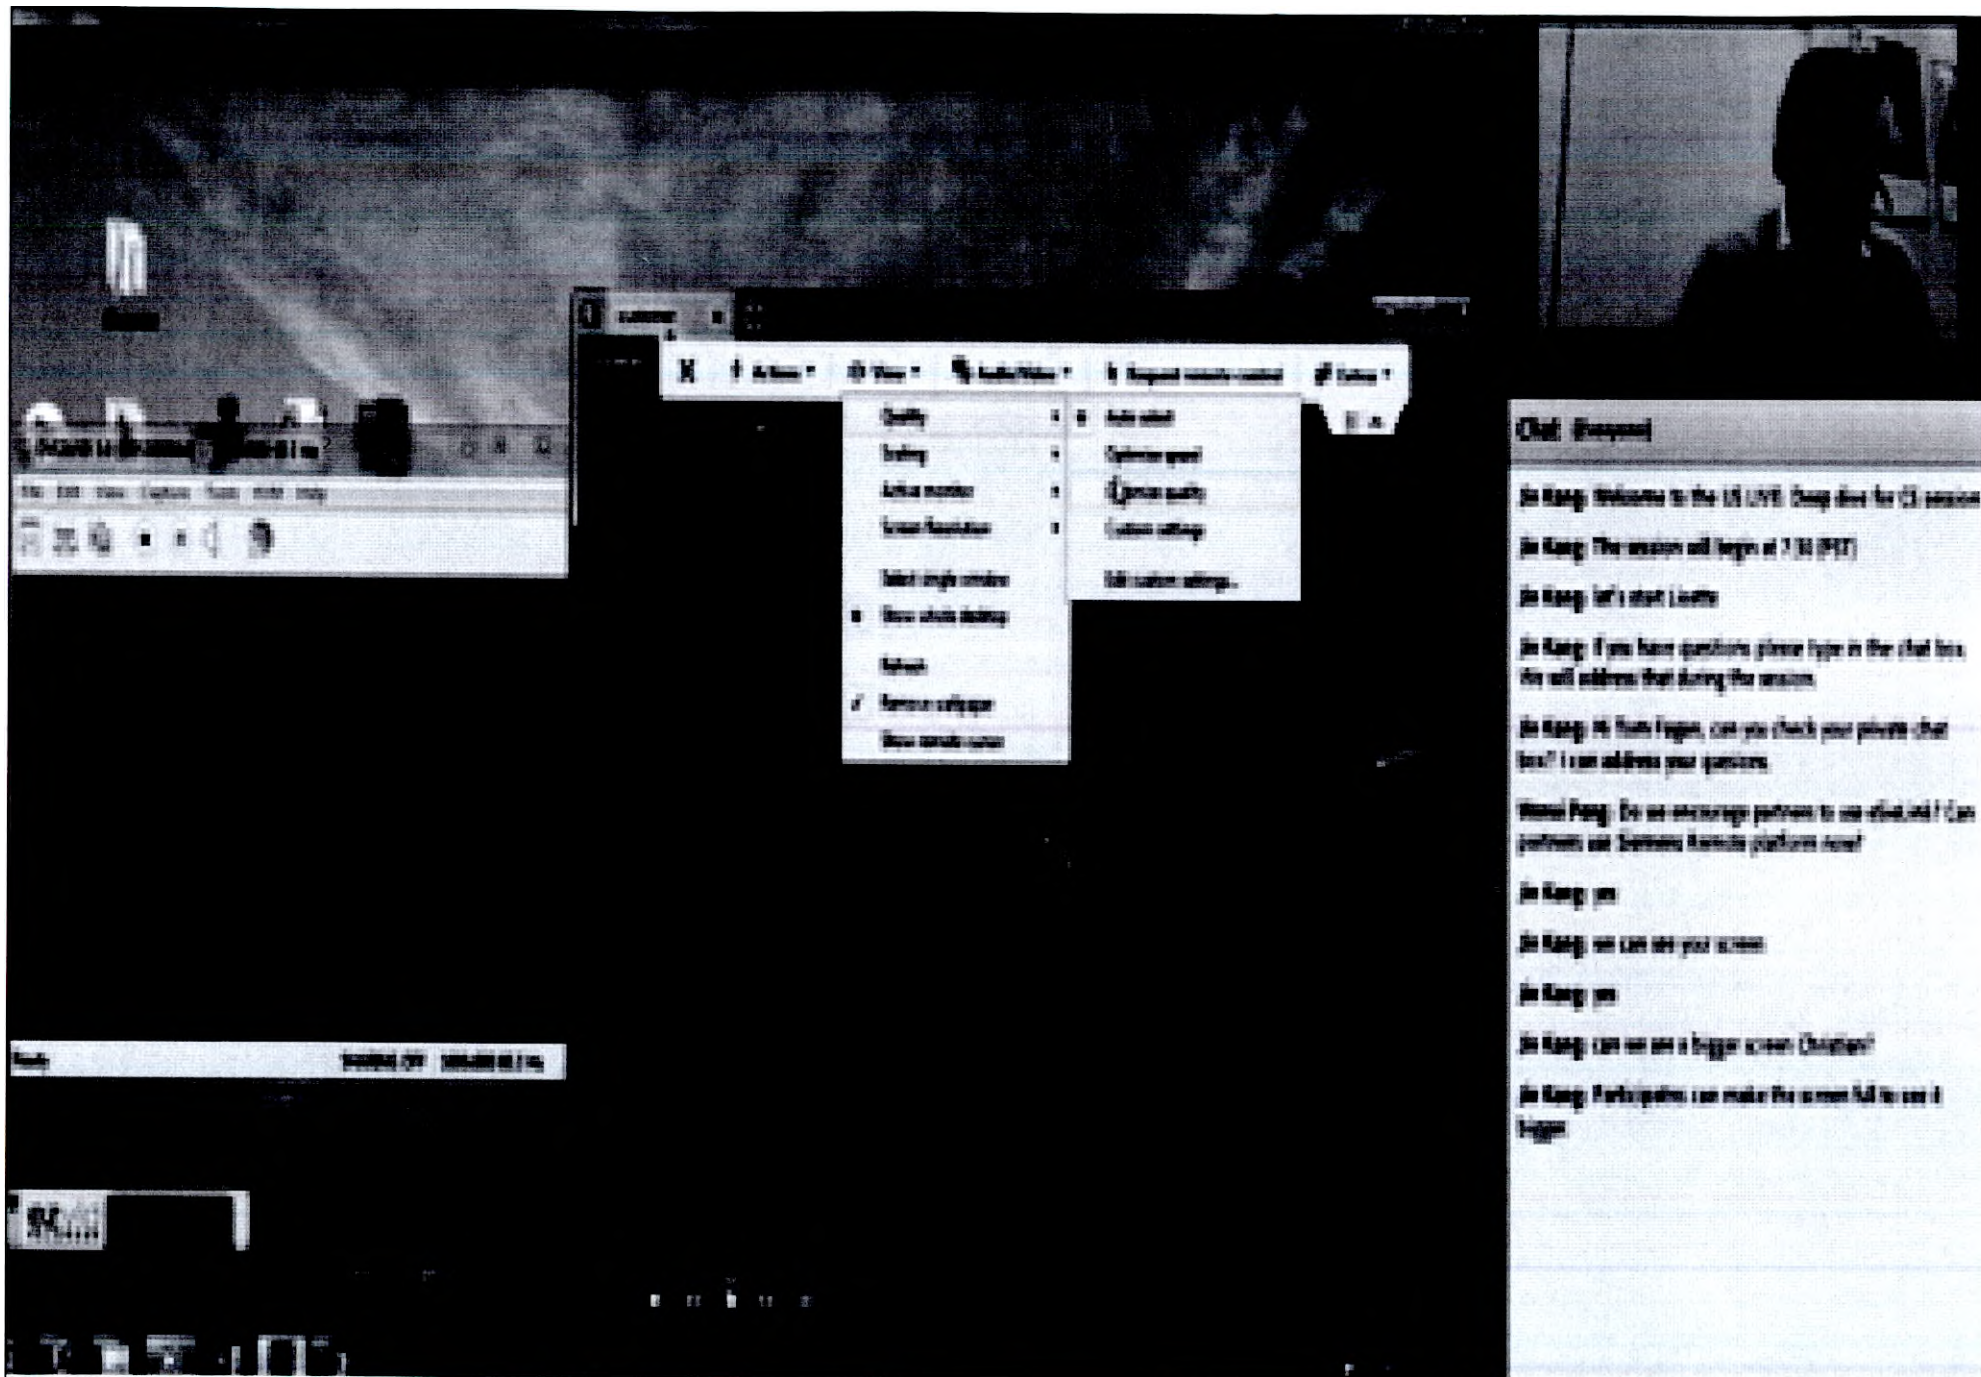

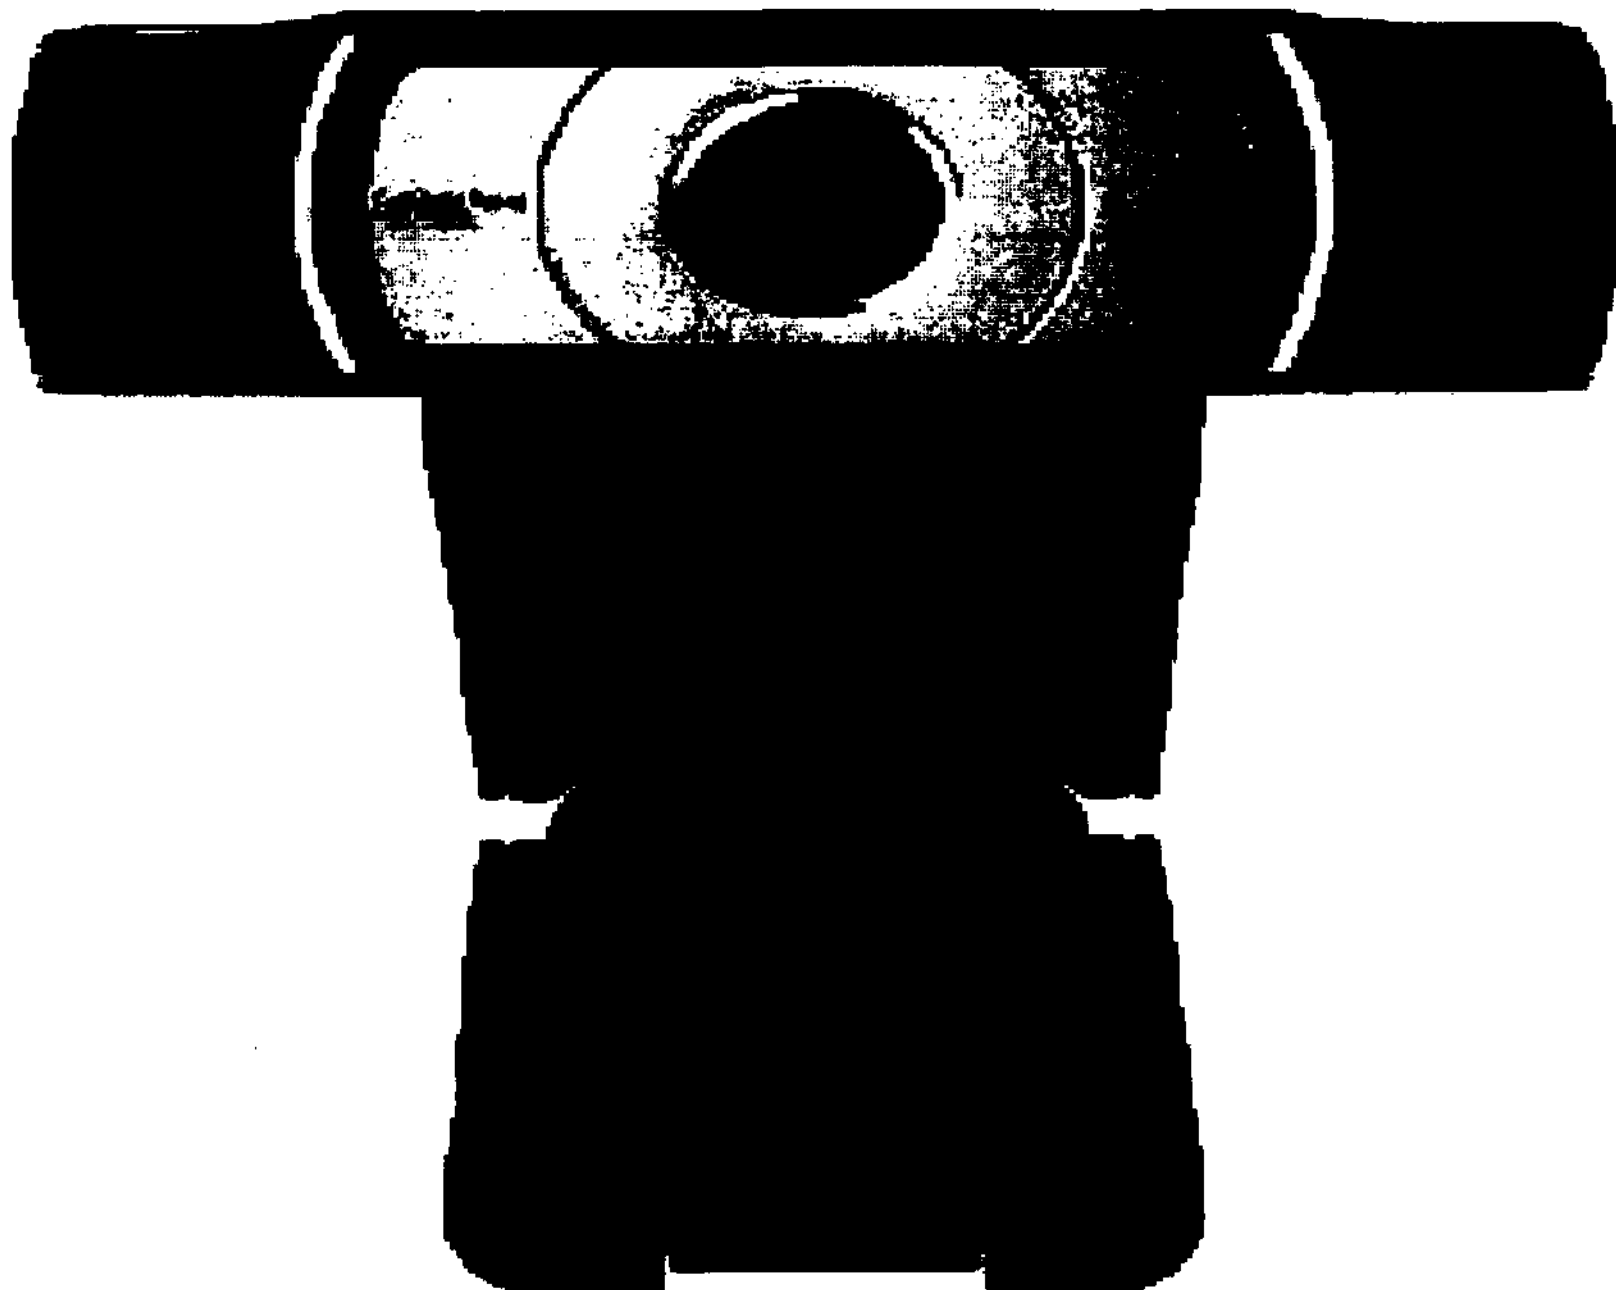

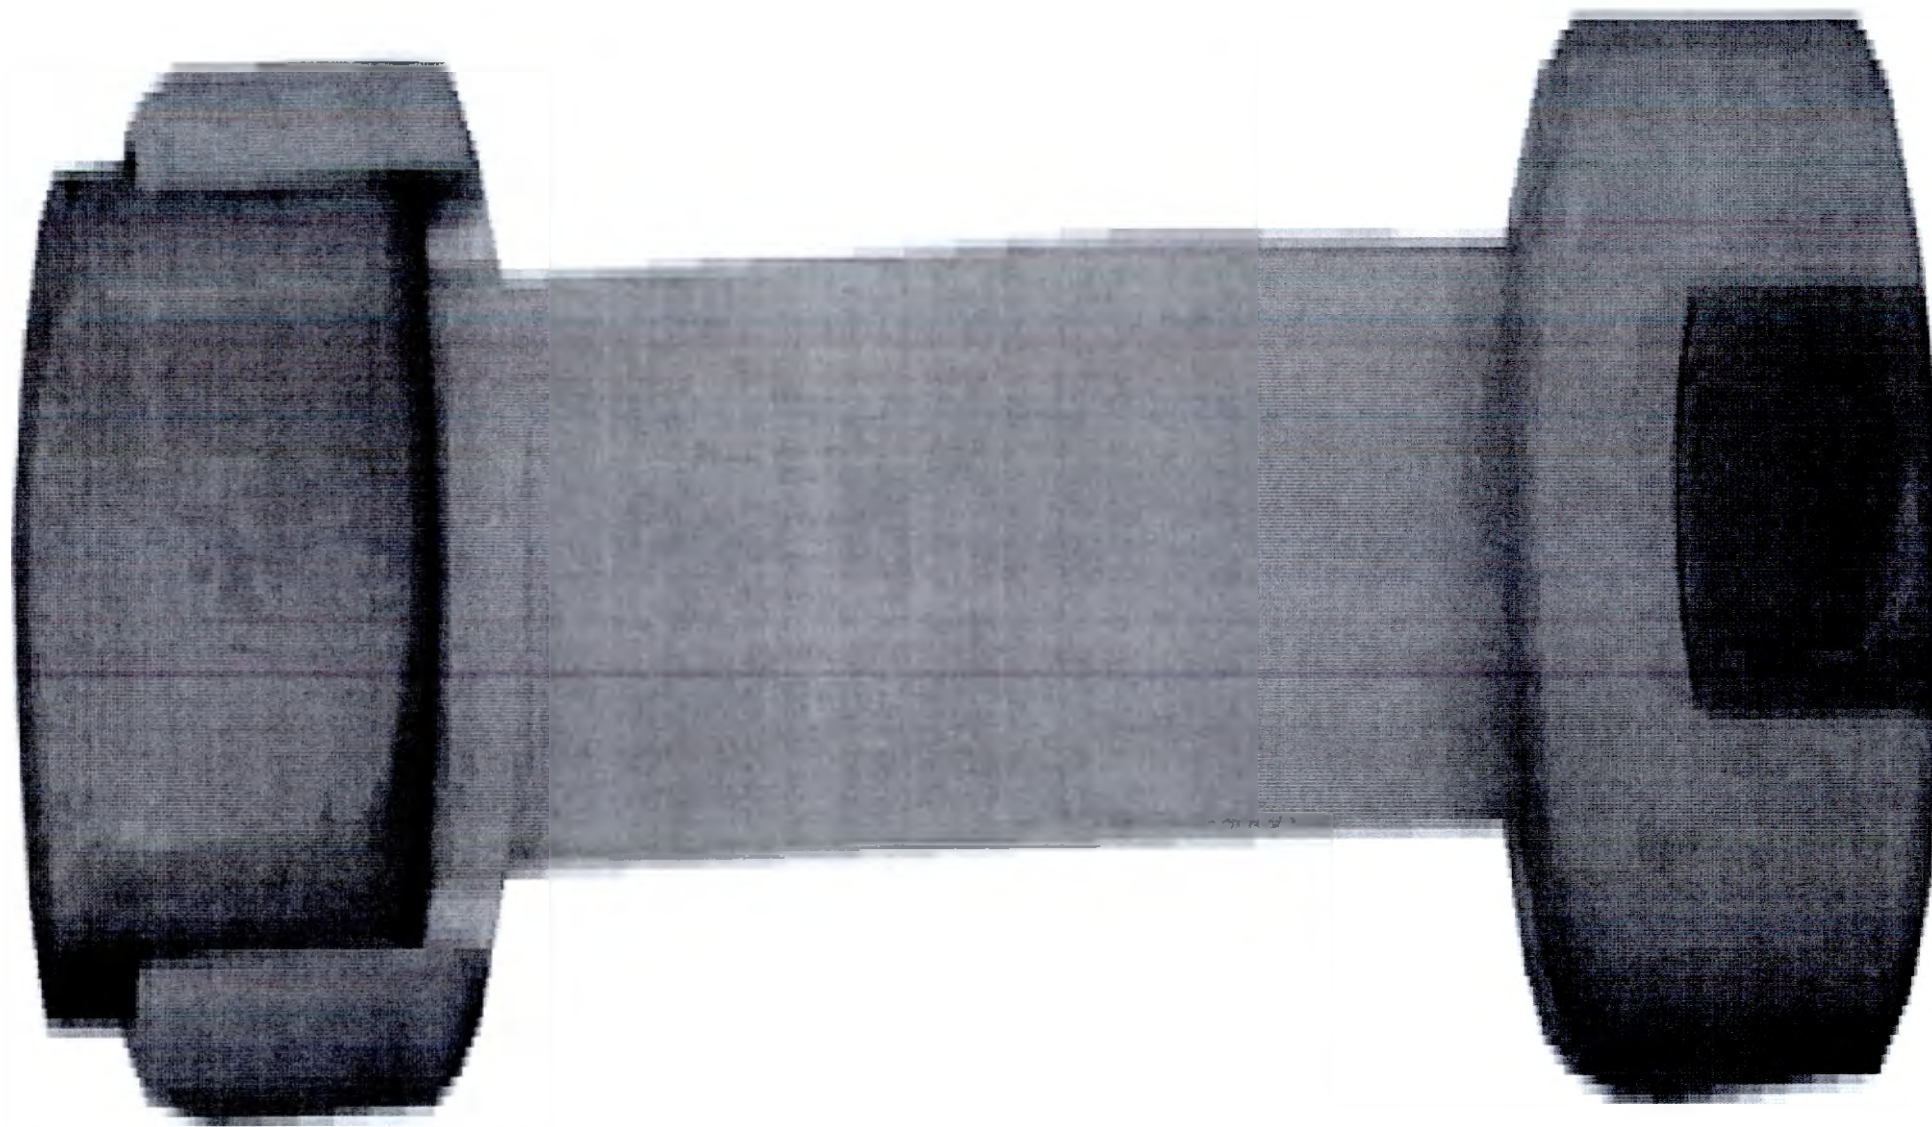

Всего прошито и пронумеровано  
153 листов.

ООО «Сименс Здоровоохранение»

